

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Синерджи Консалтинг»



## Фотографические изображения

**«Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis»**

Производитель: Boston Scientific Corporation/ Бостон Сайентифик Корпорейшн, США

300 Boston Scientific Way, Marlborough , MA 01752, USA

ер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона 3,0мм; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см



Фото общего вида первичной и вторичной упаковки изделия



р баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона 12.0мм; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см

**Athletis™**  
**OVER-THE-WIRE** **8F**

**PTA Balloon Dilatation Catheter**

Cathéter balón de dilatación PTA. Cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA. PTA Ballondilatationskatheter. Catetere de dilatazione a palloncino per PTA. PTA ballondilatatiekatheter. PTA ballondilatationskatheter. ρθητήρς μπαλονοειδούς διαστολής PTA. Cateter de Dilatação por Balão para PTA. PTA Ballongdilatacióskaateter. Ballonos táglókatéter perkután transzluminális angioplasztikához. Balónkový dilatáční katétr pro PTA. Balonowy cewnik rozszerzający do PTA. PTA-ballongdilatacijskatheter. PTA Balon Dilatasyon Kateteri. PTA-pallolajennuskatetri. Cateter de dilatare cu balonaș pentru PTA. Balónikový dilatáčný katéter na PTA. Balonski dilatacijski kateter za PTA.

**12.0mm x 20mm x 135cm**

**Contents (1)**

**Diagram:** 135cm (working length), 20mm (balloon length), 12.0mm (balloon diameter), 6.0F (≤2.01mm) (catheter diameter), ≤0.035in (0.89mm) (Recommended Guidewire), ≥8F (2.7mm) (Recommended Introducer Sheath).

**8atm (811kPa) Nominal Pressure**  
**20atm (2027kPa) Rated Burst Pressure**  
**≤0.089in (2.3mm) Maximum Crossing Profile**  
**Non-Pyrogenic**

**GTIN 08714729974239** **LOT 26830333** **REF H74939347120210**

**Use By 2022-08-17** **STERILE/EO** Sterilized using ethylene oxide.

**ONLY**  
For single use only. Do not reuse.  
Do Not Resterilize  
Consult instructions for use.  
Do not use if package is damaged.  
EU Authorized Representative  
Legal Manufacturer  
Boston Scientific Corporation  
300 Boston Scientific Way  
Marlborough, MA 01752  
USA  
USA Customer Service 888-272-1001

**Internal BSC Bar Code** 9222970-10A  
50759513-01

**CE 0344**  
Made in IRELAND  
Ballybrit Business Park  
Galway, IRELAND

**Boston Scientific Athletis™**  
12.0mm x 20mm x 135cm  
GTIN 08714729974239  
LOT H74939347120210  
REF 26830333

**Boston Scientific Athletis™**  
12.0mm x 20mm x 135cm  
GTIN 08714729974239  
LOT H74939347120210  
REF 26830333

**Boston Scientific Athletis™**  
12.0mm x 20mm x 135cm  
GTIN 08714729974239  
LOT H74939347120210  
REF 26830333

**035**

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Маркировка изделия на вторичной упаковке

Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона 12.0мм; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см.

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XXг.

Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis

Московское представительство компании Бостон Сайентифик: 125315, Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72 к2  
E-mail: [Info-russia@bsci.com](mailto:Info-russia@bsci.com)

Нетоксично

Температура транспортировки: -29°C - + 60°C

Макет этикетки для России



р баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона 1,5мм; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см



Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона 12,0мм; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см.

Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) *Athletis*

Московское представительство компании Бостон Сайентифик: 125315,  
Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72 к2  
E-mail: Info-russia@bsci.com

Температура транспортировки: -29°C - + 60°C

### Маркировка изделия на первичной упаковке

Макет этикетки для России



баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона 1,5F; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см



Фото общего вида с защитными элементами упаковки.



, баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона ; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см



Фото общего вида изделия



**Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона 12.0мм; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см**



**Фото маркировки на разъеме с лицевой стороны**



катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона 2,0мм; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см



Фото маркировки на разъеме с обратной стороны



катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 8F; диаметр баллона 2,0мм; длина баллона 20мм; рабочая длина катетера 135см



Фото баллона



катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона 3мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см



Фото общего вида первичной и вторичной упаковки изделия



**REF** H74939347080370  
**Use By** 2022-07-05

**LOT** 26592101

**REF** H74939347080370  
**GTIN** 08714729974024  
8.0mm x 30mm x 75cm  
Athletis™  
Boston Scientific

**LOT** 26592101

**REF** H74939347080370  
**GTIN** 08714729974024  
8.0mm x 30mm x 75cm  
Athletis™  
Boston Scientific

**LOT** 26592101

**REF** H74939347080370  
**GTIN** 08714729974024  
8.0mm x 30mm x 75cm  
Athletis™  
Boston Scientific

50497465-01

**Internal BSC Bar Code**

9222296744A

(01)08714729974024 G S1

(17)2207051026592101 G S1

**CE 0344**

Made in IRELAND  
Ballybri Business Park  
Galway, IRELAND

**LOT** 26592101

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

**STERILE** EO  
Sterilized using ethylene oxide.

Маркировка на лицевой стороне вторичной упаковки

**Boston Scientific**

**8.0mm x 30mm x 75cm**

**Athletis™**

**OVER-THE-WIRE 6F**

**PTA Balloon Dilatation Catheter**

Cathéter ballon de dilatation PTA, Cathéter de dilatation à ballonnet pour PTA, PTA Ballondilatationskatheter, Cateter de dilatazione a palloncino per PTA, PTA ballondilatationskatheter, PTA Ballondilatationskatheter, Kóvetőrhóscsúszóvívíű dilatációs PTA, Cateter de Dilatação por Balão para PTA, PTA ballondilatationskatheter, Ballonostágiókatéter per kúrtán transzuminális angioplastizációhoz, Balónkový dilatční katétr pro PTA, Balonový cewnik rozszerzający do PTA, PTA-ballongdilatacijskatešter, PTA Balon Dilatasyon Kateteri, PTA-pallolaajennuskatetri, Cateter de dilatare cu balon as pentru PTA, Balónkový dilatčný katéter na PTA, Balonski dilatacijski kateter za PTA

**Contents (1)**

**Non-Pyrogenic**

**75cm**

**30mm**

**8.0mm**

**5.7F (≤1.90mm)**

**8atm (811kPa)**  
Nominal Pressure

**31atm (3141kPa)**  
Rated Burst Pressure

**≤0.035in (0.89mm)**  
Recommended Guidewire

**≥6F (2.0mm)**  
Recommended Intracatheter Sheath

**≤0.075in (1.9mm)**  
Maximum Crossing Profile

**GTIN 08714729974024**

**REF** H74939347080370

**Use By** 2022-07-05


Boston Scientific  
8.0mm x 30mm x 75cm  
H74939347080370  
26592101



катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона 8,0мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см



Маркировка на оборотной стороне вторичной упаковки

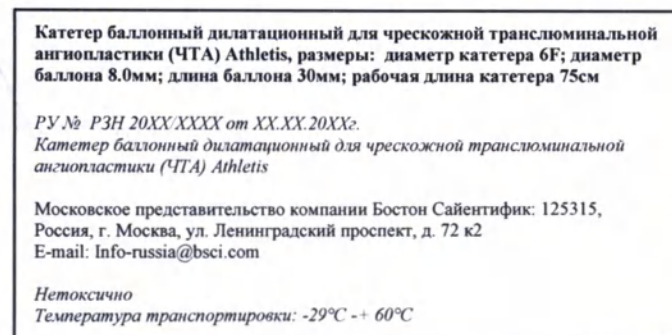

Макет этикетки для России



етер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см

**Boston Scientific**  
Athletis™  
8.0mm x 30mm x 75cm

**REF** H74939347080370  
**LOT** 26592101

**Boston Scientific**  
Athletis™  
8.0mm x 30mm x 75cm

**REF** H74939347080370  
**LOT** 26592101

**Boston Scientific**  
Athletis™  
8.0mm x 30mm x 75cm

**REF** H74939347080370  
**LOT** 26592101

**Internal BSC Bar Code**  
9222286-44A

**CE 0344**

Made in IRELAND  
Ballybrit Business Park  
Galway, IRELAND

**LOT** 26592101


This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

**STERILE EO** Sterilized using ethylene oxide.

Маркировка на лицевой стороне первичной упаковки



катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона 8мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см

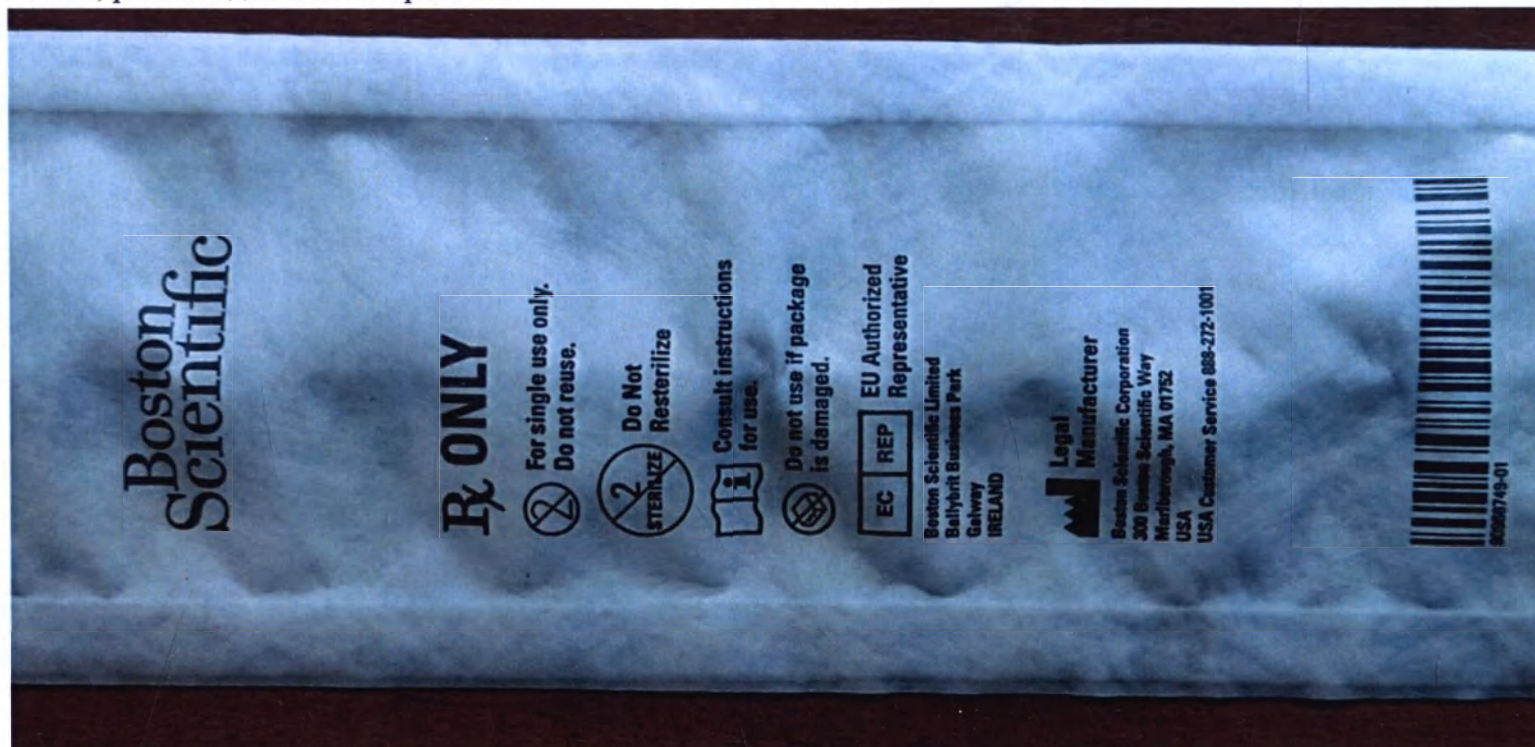

Маркировка на оборотной стороне первичной упаковки

Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона 8.0мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см

РУ № P3H 20XX/XXXX от XX.XX.20XXг.

Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis

Московское представительство компании Бостон Сайентифик: 125315,  
Россия, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 72 к2  
E-mail: Info-russia@bsci.com

Нетоксично

Температура транспортировки: -29°C - + 60°C

Макет этикетки для России



**катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона 1,5мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см**



**Фото общего вида с защитными элементами упаковки.**



катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона 3,0мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см



Фото общего вида изделия



Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона 8.0мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см



Фото маркировки на разъеме с обратной стороны



Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона 8.0мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см



Фото маркировки на разъеме с лицевой стороны



Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Athletis, размеры: диаметр катетера 6F; диаметр баллона 3.0мм; длина баллона 30мм; рабочая длина катетера 75см

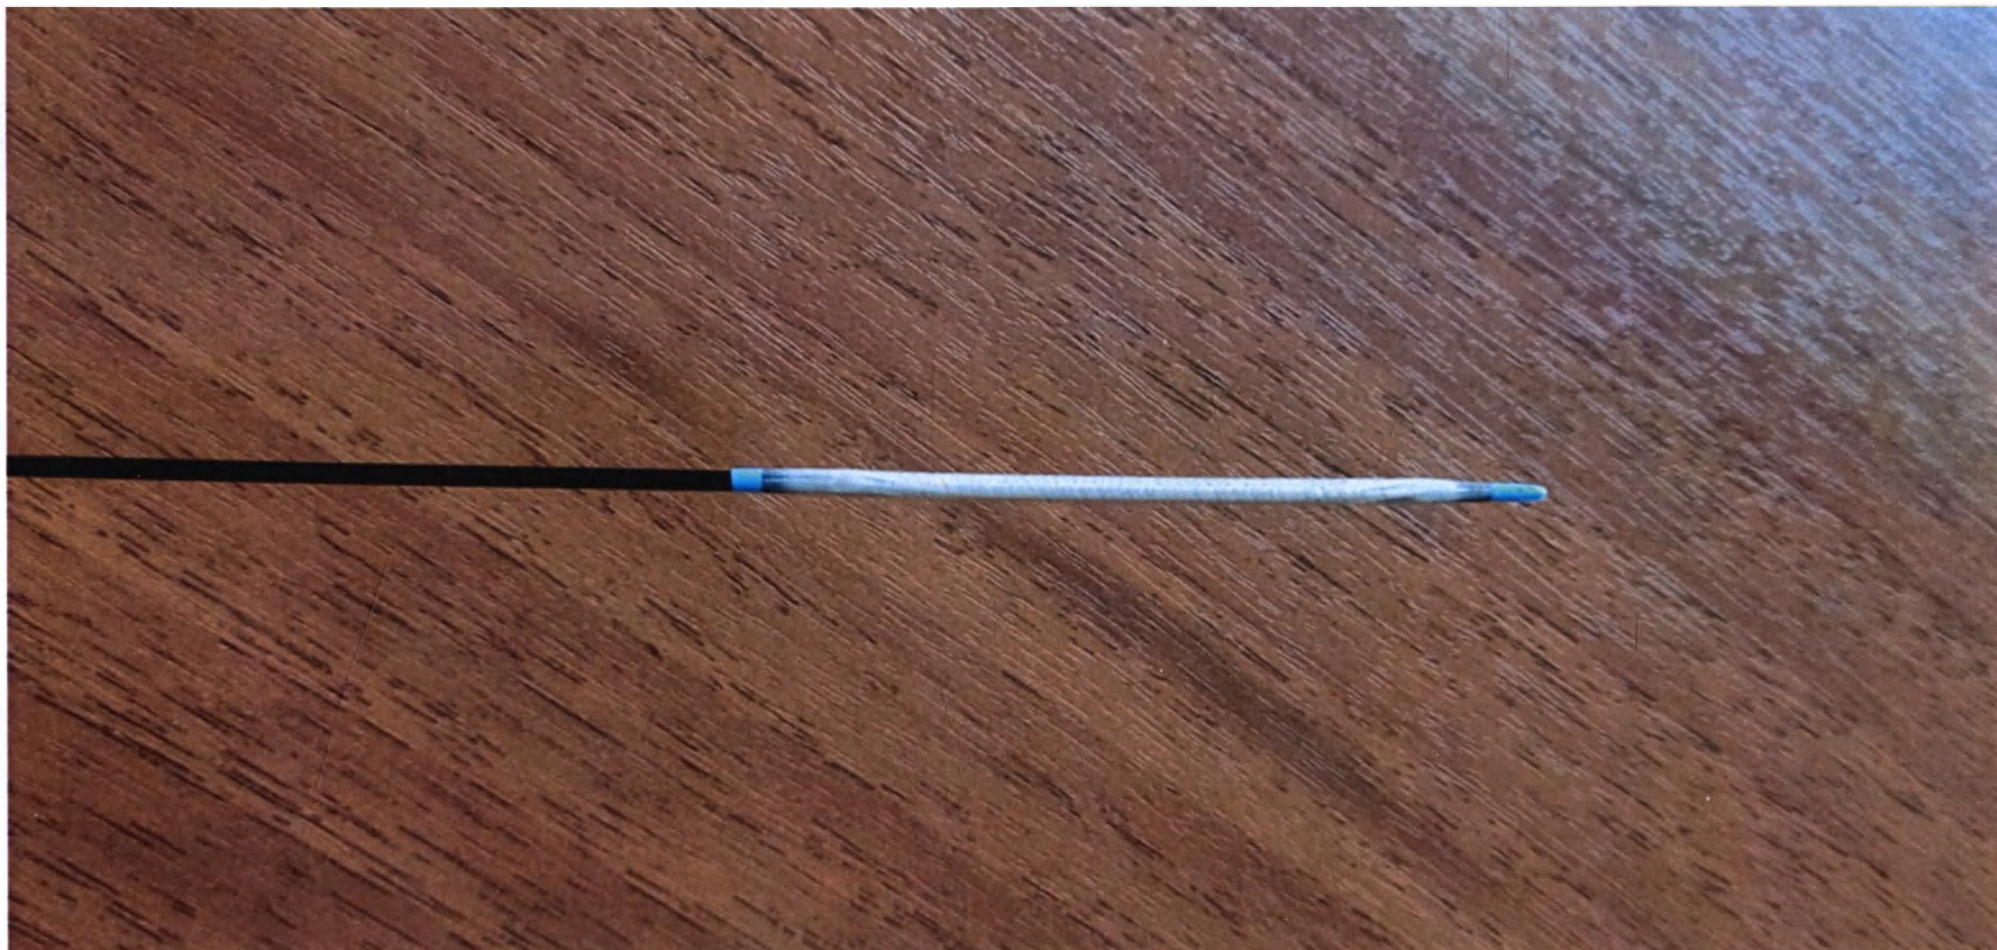


Фото баллона





Прошито, пронумеровано  
( 19 лист(ов))  
скреплено печатью

