

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПАО «АМИКО»

« 14 » \_\_\_\_\_ И. И. Билинов

« 14 »



**Комплекс рентгеновский диагностический стационарный  
«МЕДИКС-Р-АМИКО»**

**Макеты маркировки и упаковки  
Фотографические изображения**

**Макет маркировочной таблички**  
**комплекса рентгеновского диагностического стационарного**  
**«МЕДИКС-Р-АМИКО»**

Основная маркировочная табличка комплекса располагается на устройстве рентгеновском питающем.

Макет основной маркировочной таблички:

|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   | <b>НПАО «АМИКО»</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| Россия, г. Москва, 115432,<br>2-ой Кожуховский проезд, д.29, корп. 5.             |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| <b>Комплекс рентгеновский диагностический<br/>стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО»</b>   |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Исполнение _                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| <b>SN</b>                                                                         | <b>AXX-XX.XXX</b> |                                                                                                 | <b>XX XXXX</b>                                                                                               |
| <b>380 В</b>                                                                      | <b>50Гц</b>       | <b>80кВ·А</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| <b>ТУ 9442-005-34597883-99</b>                                                    |                   |   <b>3N ~</b> | <br><small>ИМ37</small> |

## Графические макеты первичной и вторичной упаковки

Макеты первичной и вторичной упаковки составных частей Комплекса рентгеновского диагностического стационарного «МЕДИКС-Р-АМИКО» (исполнение 3).

### Место № 1

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.1 Устройство рентгеновское питающее TOP-X 850 HF/или ТОП-X100 LS/или УРПвч-«АЗРТ»;

поз.6 дозиметр рентгеновского излучения клинический;

поз.7 излучатель рентгеновский диагностический;

поз.12 растр рентгеновский отсеивающий;

поз.14 кассеты медицинские рентгенографические;

поз.15 экраны усиливающие для рентгеновских аппаратов;


поз.16 система дистанционного видеонаблюдения ;

поз.17 комплект фотолабораторный;



поз. 20 комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов;

поз. 22 комплект сменных устройств;

поз. 24 комплект эксплуатационной документации на комплекс «МЕДИКС-Р-АМИКО» в составе: руководство по эксплуатации, формуляр, ведомость эксплуатационных документов.

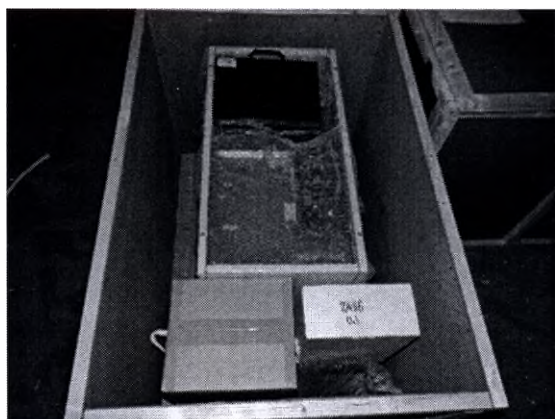

ТОП-X 850  
или УРПвч-  
«АЗРТ»

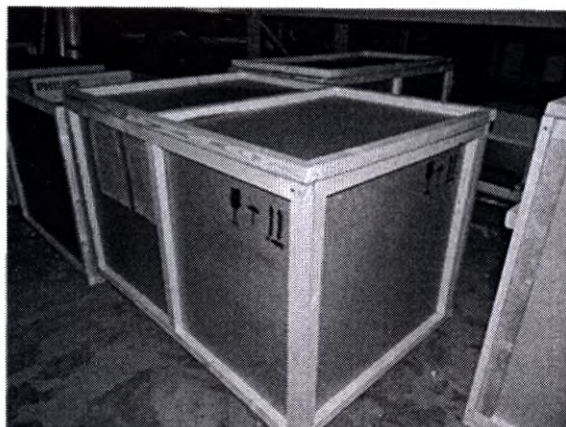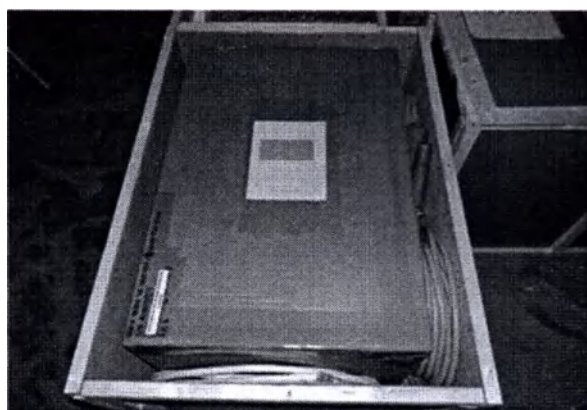

ТОП-X100  
LC



### Место №2.

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.2. Стол рентгеновский поворотный BIO Scope




### Место №3.

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.3 Усилитель яркости рентгеновского изображения УРИ/230 "Аметист" / или Усилитель яркости рентгеновского изображения цифровой для формирования и визуализации рентгеновского изображения в режимах рентгеноскопии и импульсной цифровой рентгенографии УРИ/300"Аметист")

поз.7 излучатель рентгеновский диагностический;

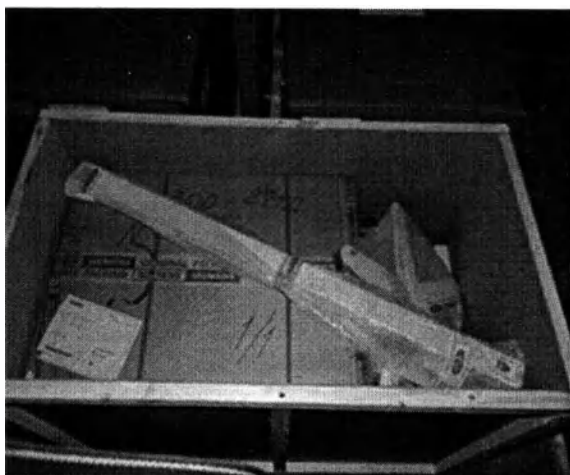





#### Место №4.

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.4 Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ- «АККОРД»;

поз.10 Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения;


поз.13 переговорное устройство;

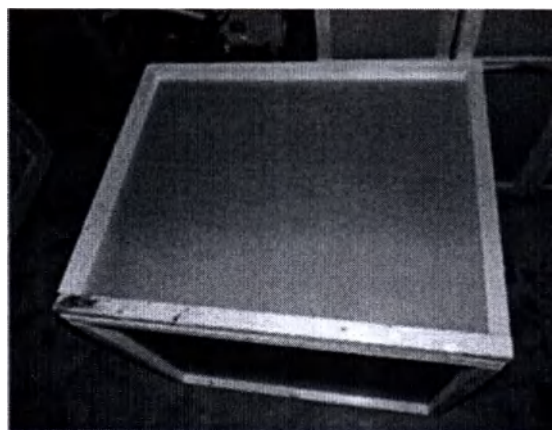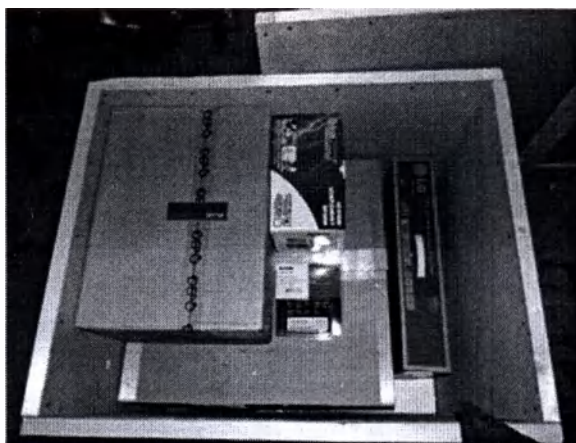

#### Место №5

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:


Поз.5. Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ».  
Стол снимков

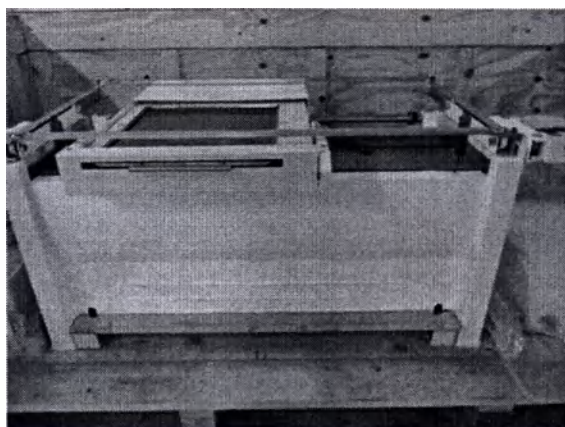

### Место №6

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.5. Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ». Колонна

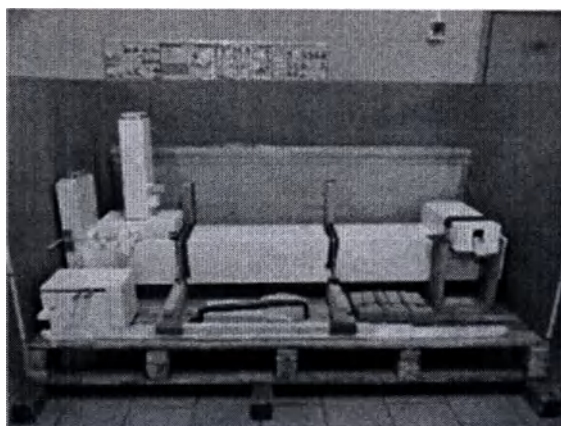

### Место №7

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.5. Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ». Стойка для рентгенографии.






### Место № 8

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:


Поз.9 Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-АМИКО»

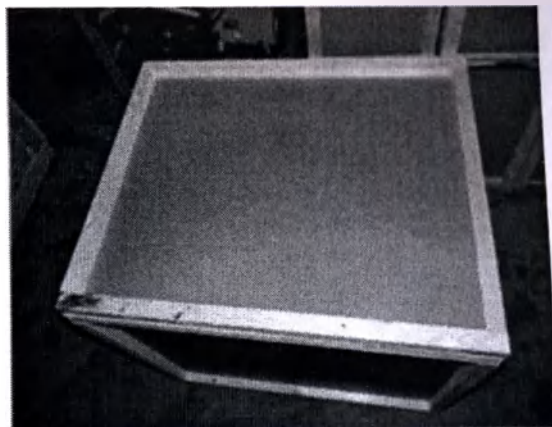

### Место № 9

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:


Поз.11 Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО»

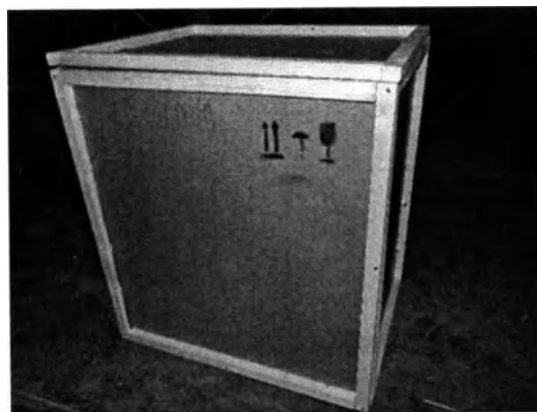

### Место №10

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.18. Каталка рентгенографическая

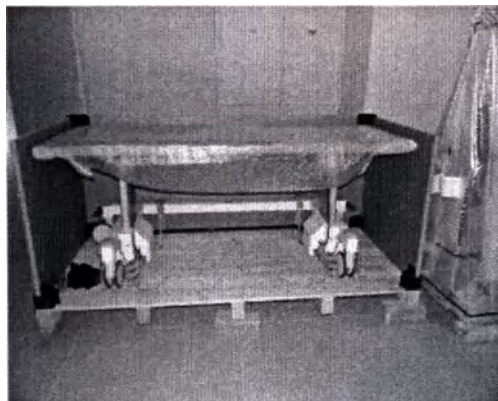

### Место №11

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.19 Устройство фиксации детей для рентгенографии



### Место №12

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.21 Окна защитные смотровые ОСЗ/или окна рентгенозащитные






### Место №13

Состав упаковочного места согласно комплектации «МЕДИКС-Р-АМИКО»:

Поз.23 Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER»/или стабилизатор напряжения серии «САТУРН»/или стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль

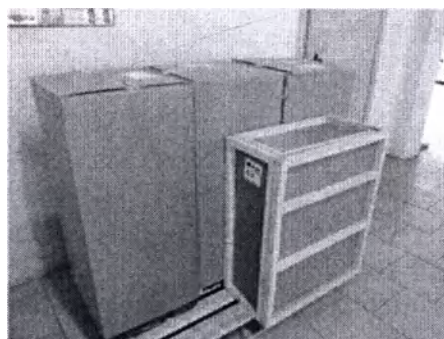

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью:

9 (девят) ) листов

Зам.директора по качеству

Ан /Никитушкин С.В./



УТВЕРЖДАЮ

Директор/ИПАО «АМИКО»

Н.Н. Филинов

« 14 »

2018



# ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Комплекс рентгеновский диагностический стационарный  
«МЕДИКС-Р-АМИКО»



Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «МЕДИКС-Р-АМИКО», в составе:


Исполнение 1:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP – X 850 HF, модель TOP – X 850 HF с принадлежностями: пульт управления TXFAC1, производства Innomed Medical Zrt., Венгрия






или устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч-«АЗРТ», производства ЗАО «АЗРТ»

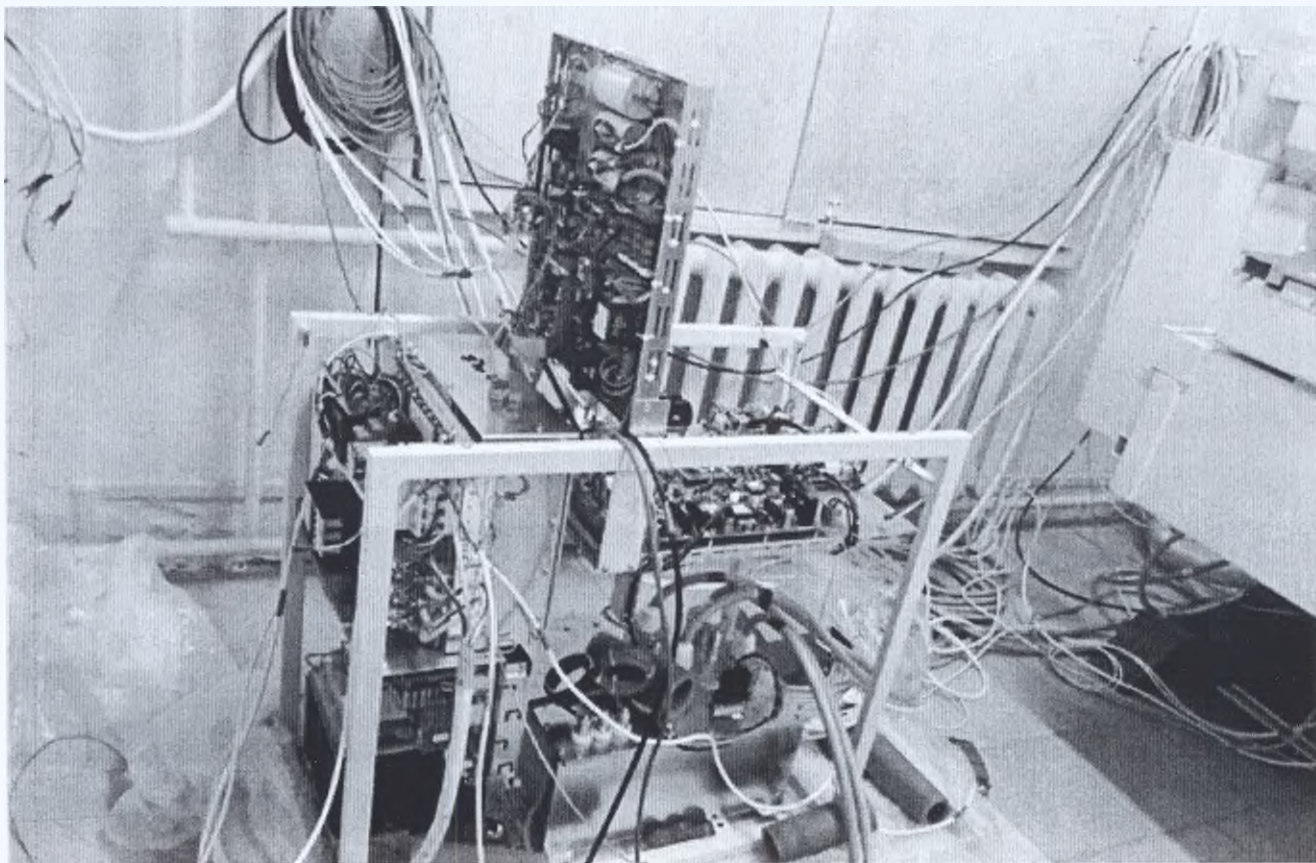


2. Стол рентгеновский поворотный, модель BIO Score, производства BMI S.r.l., Италия

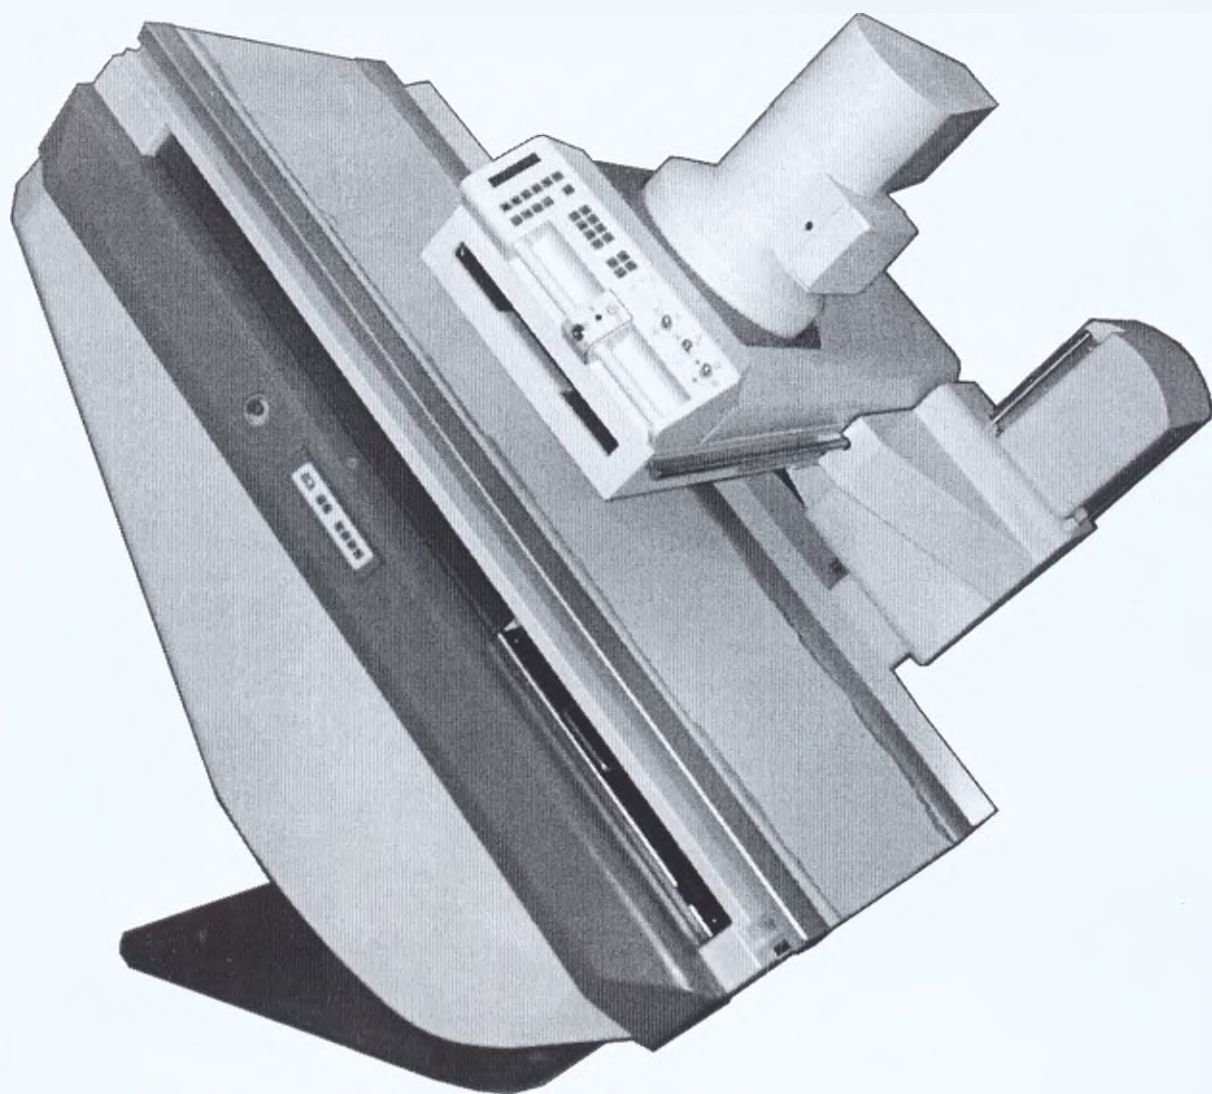




3. Усилитель яркости рентгеновского изображения УРИ/230 «Аметист», производства ООО «Рентген-Комплект», РФ

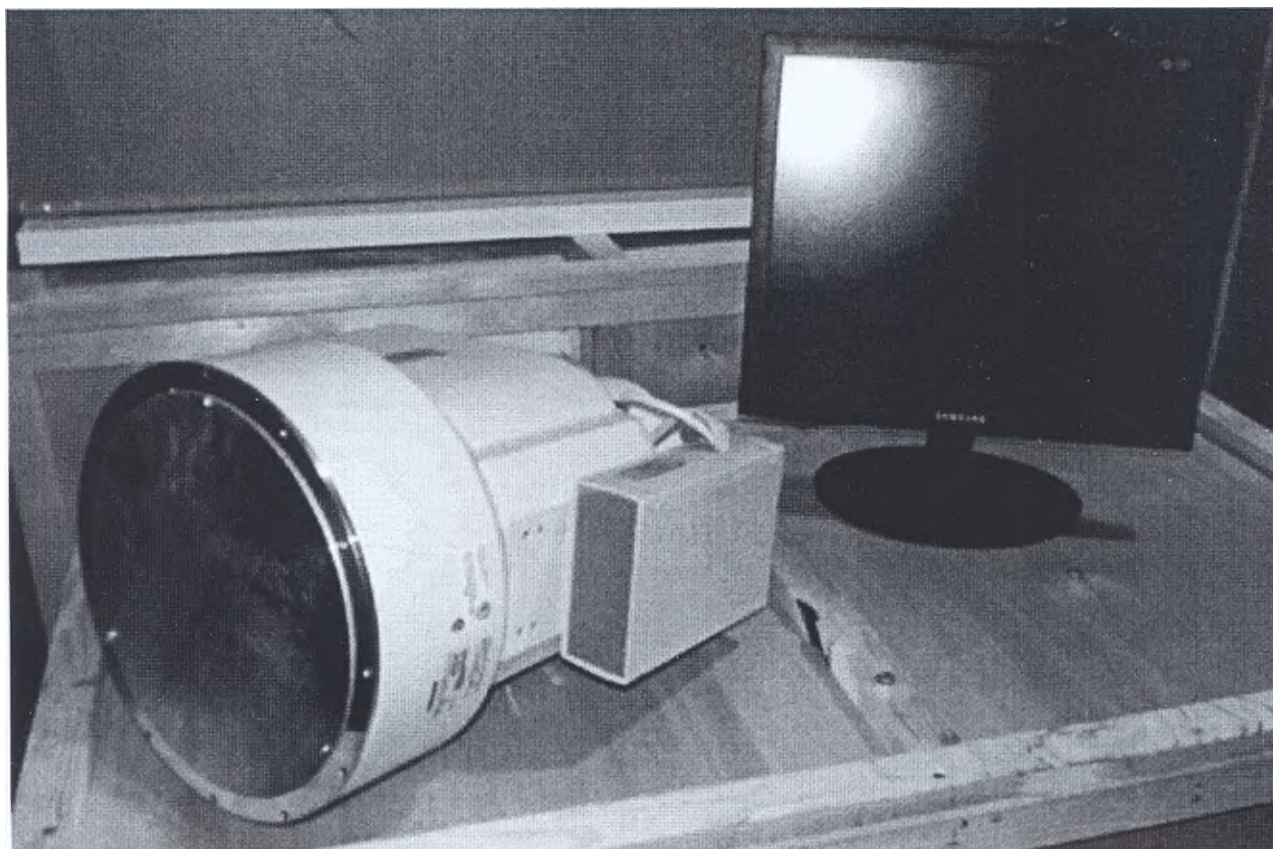




или Усилитель яркости рентгеновского изображения цифровой для формирования и визуализации рентгеновского изображения в режимах рентгеноскопии и импульсной цифровой рентгенографии УРИ/300 «Аметист», производства ООО «Рентген-Комплект», РФ

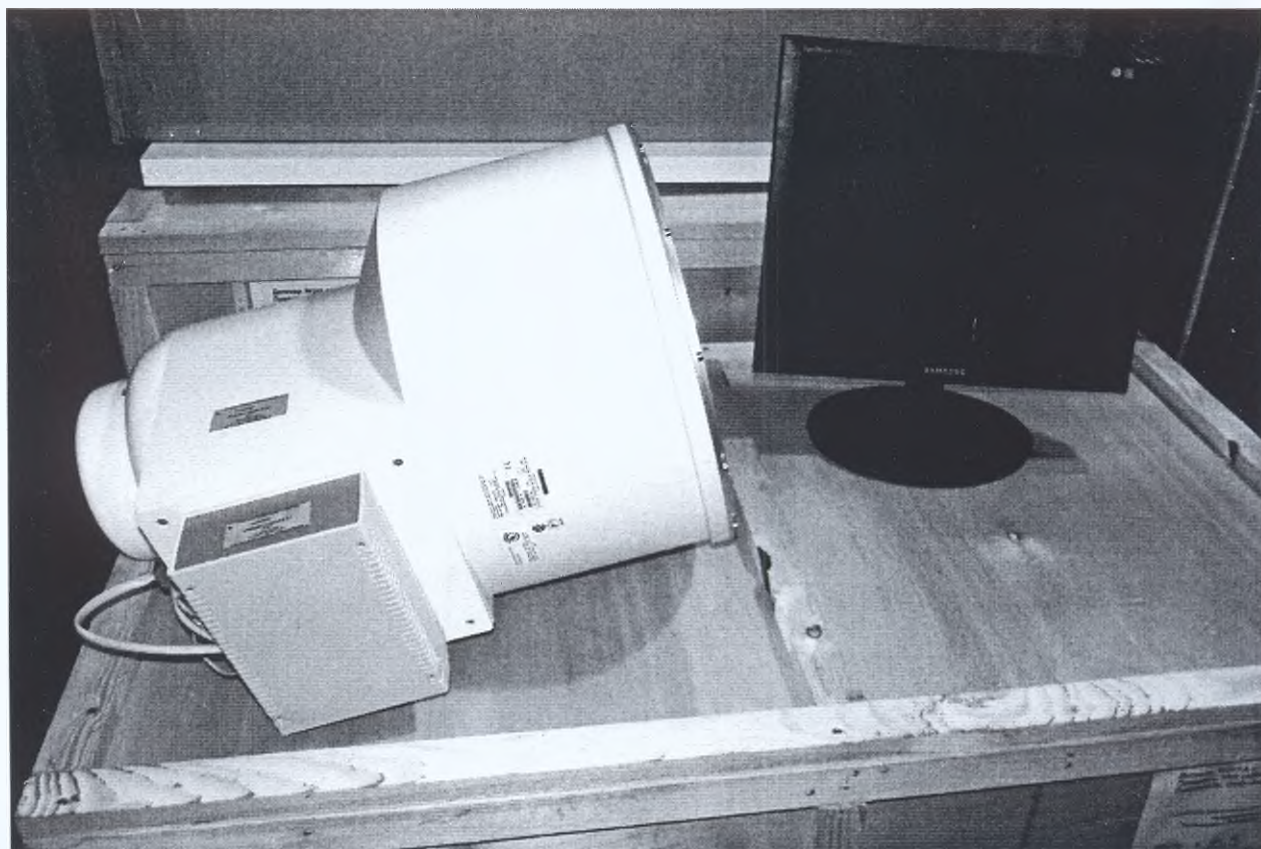

ания и  
льсн  
плект»,

4. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД», производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ

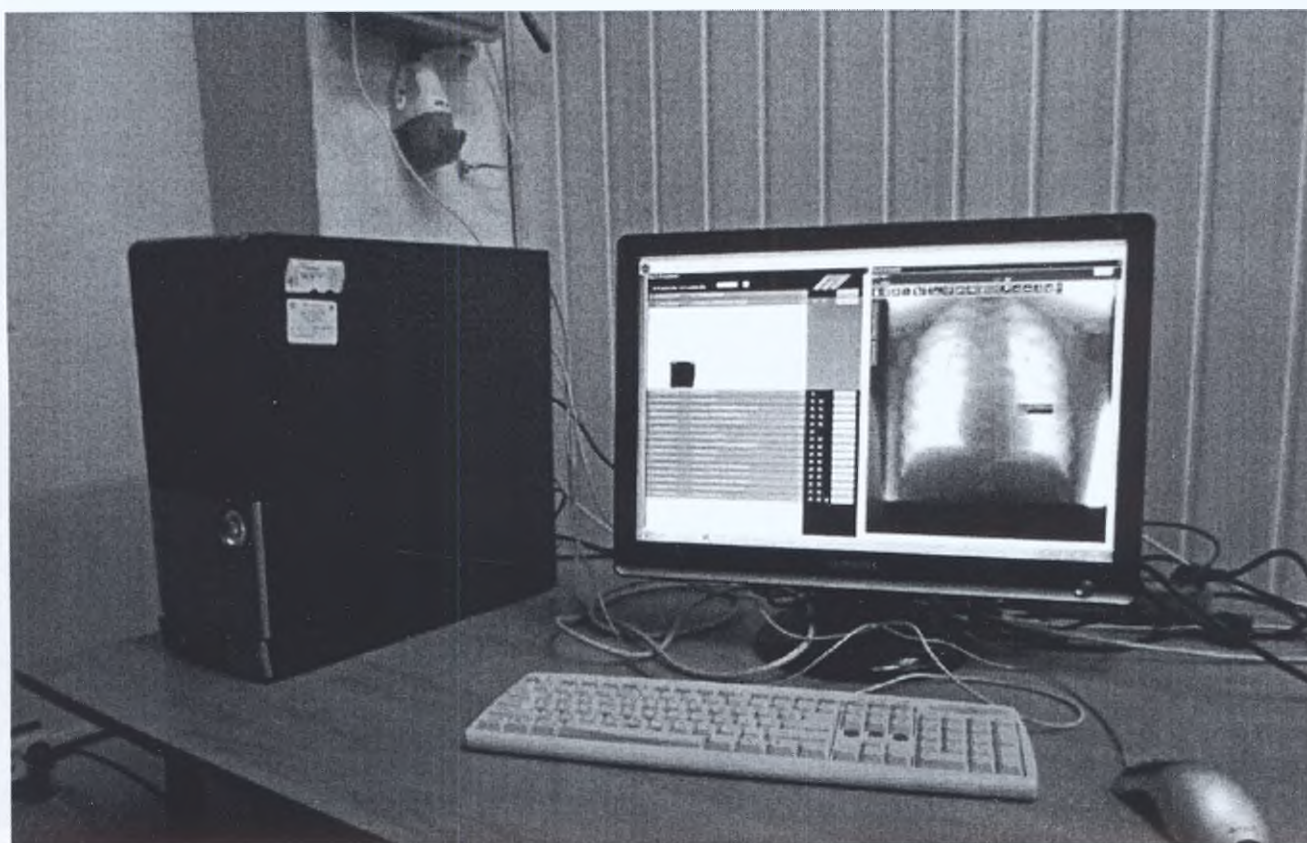




5. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, производства ООО НПП «Доза»






«Доза»

или Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО НПП «Доза»

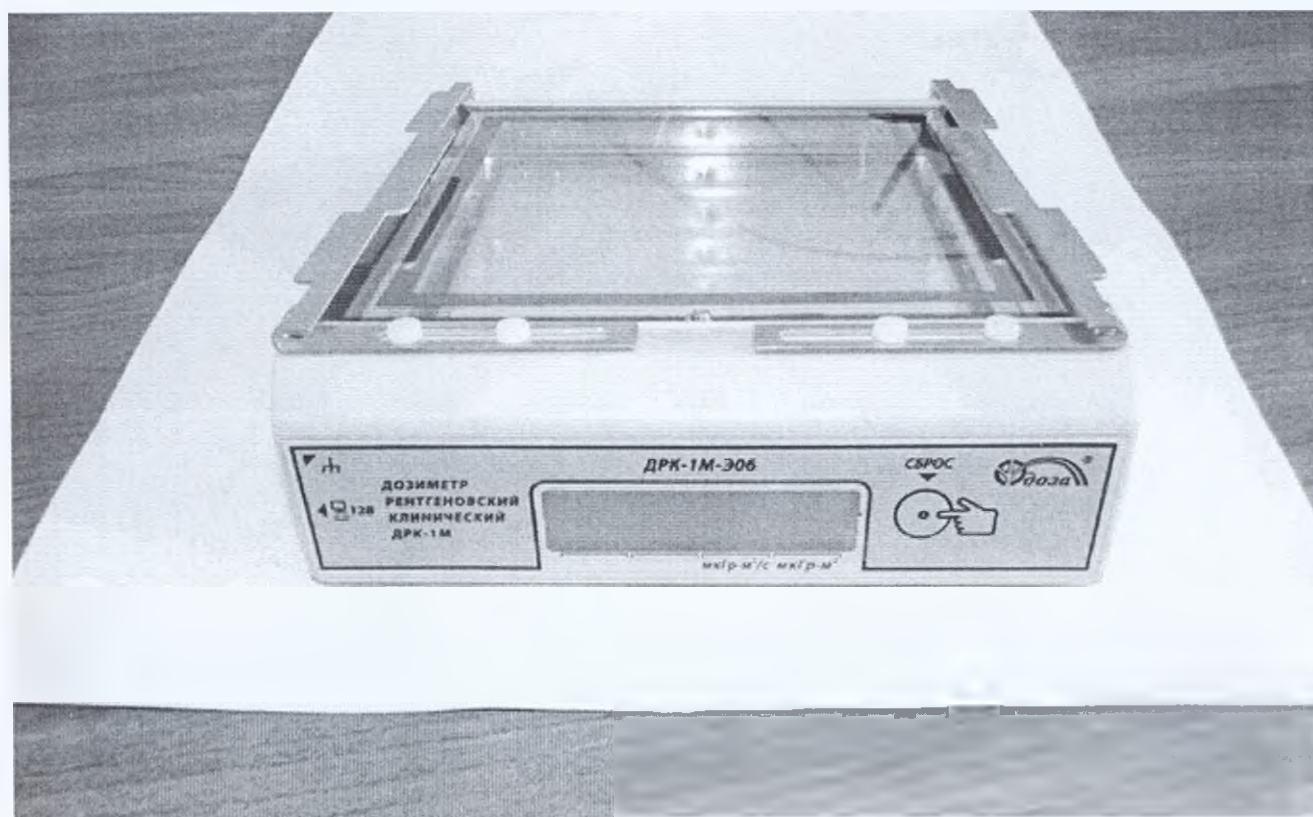


6. Излучатель рентгеновский E7242X производства Toshiba Electron Tubes & Devices Co., Ltd. или Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

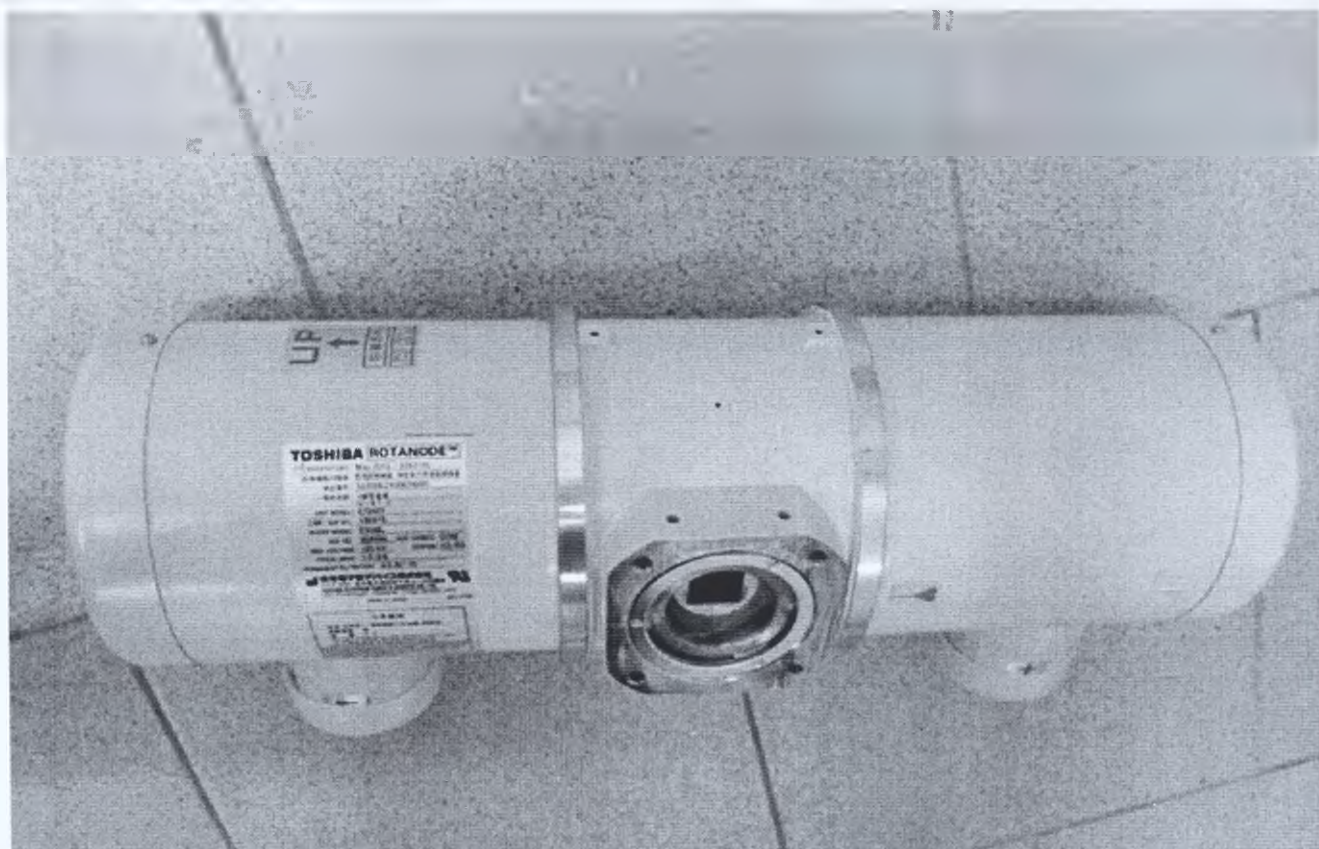




или Излучатель с трубкой рентгеновской RAY-12\_1, RAY-12\_3, RAY-12S\_1, RAY-12S\_3,  
RAY-14\_1, RAY-14\_3, RAY-14S\_1, RAY-14S\_3, производства Siemens  
X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi, Китай

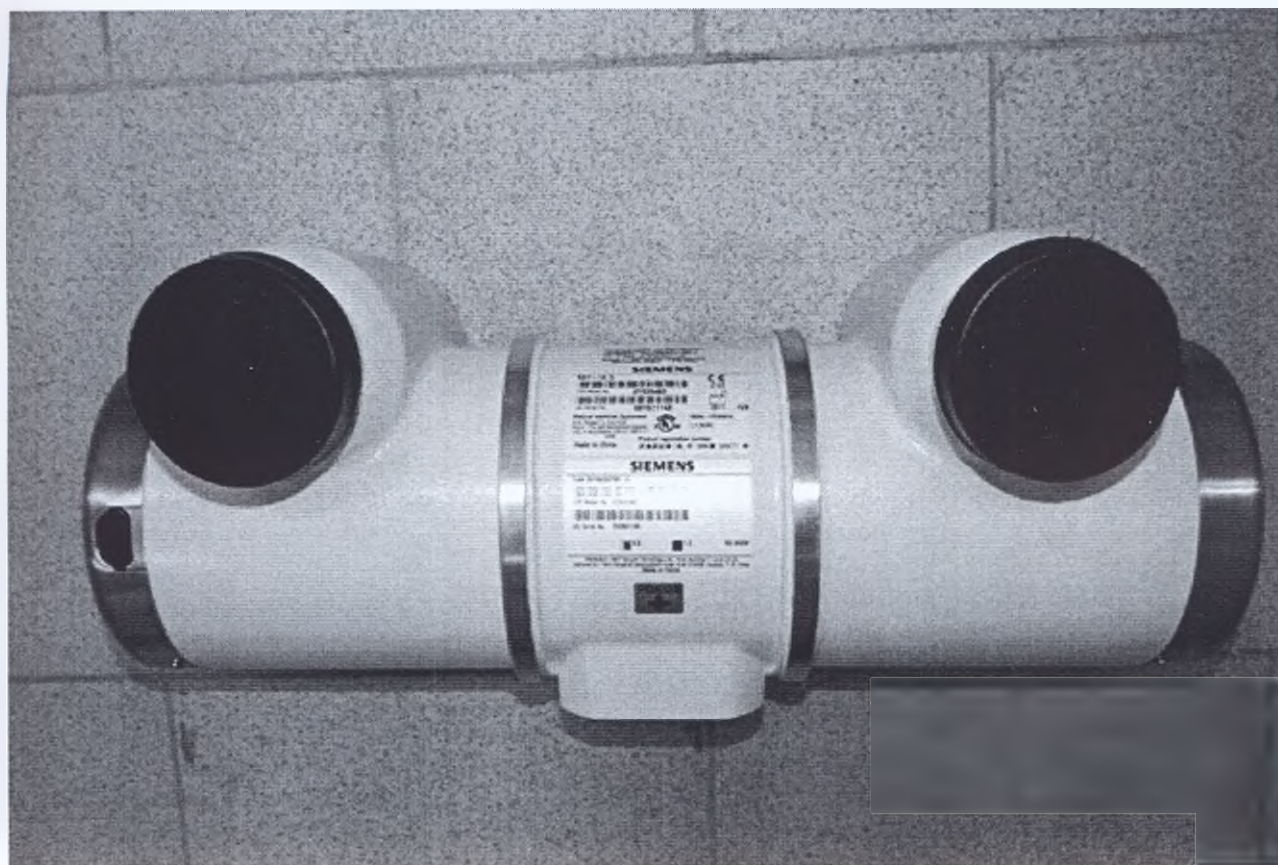




или Излучатель с трубкой рентгеновской Optilix 154/30/50R-101S, производства Siemens Healthcare GmbH., Германия 7.

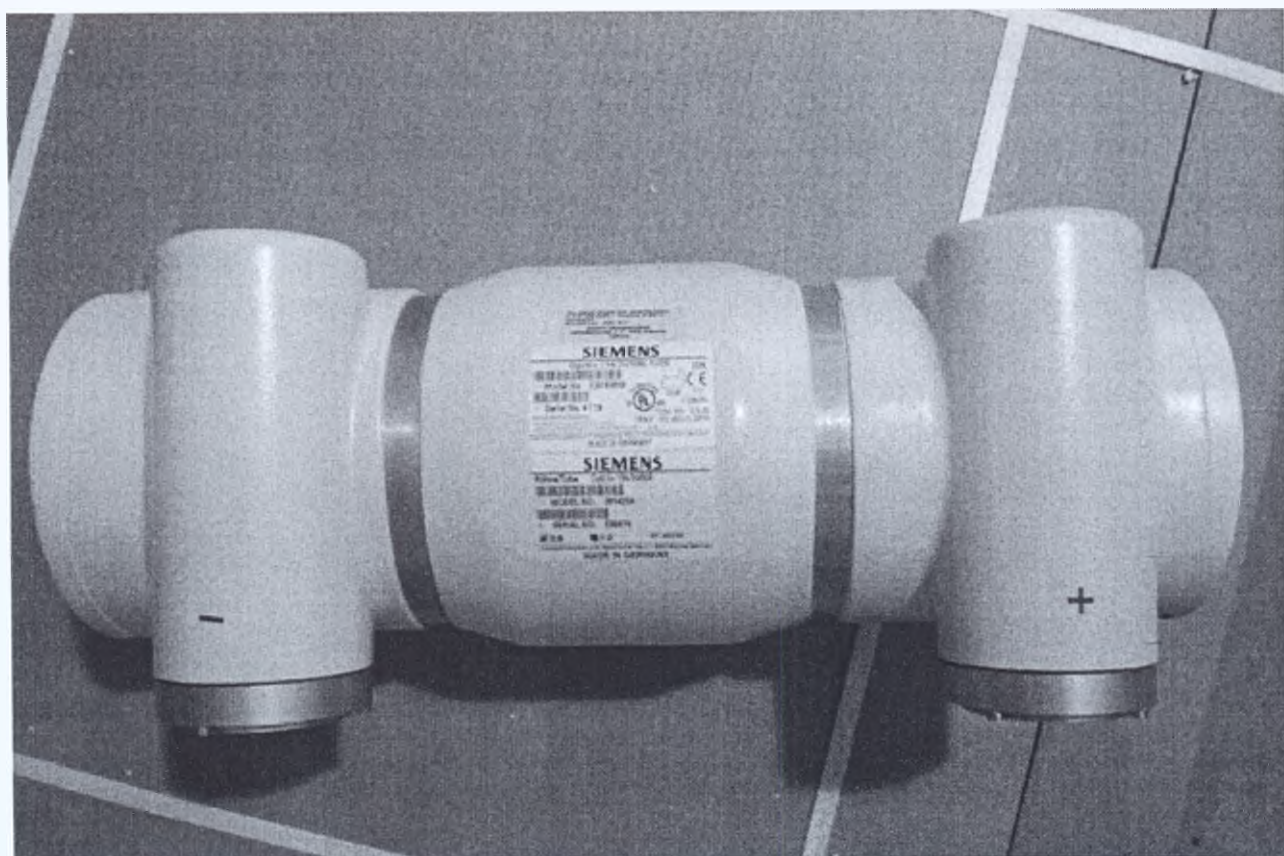

Ширмы резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» в следующих исполнениях: фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К», с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К», с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К», с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К», производства ООО «Рентген-Комплект» или Ширмы рентгенозащитные в следующих исполнениях: резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К», резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» в следующих исполнениях: фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К», с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К», с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К», с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К», производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР».



8. Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-АМИКО», производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

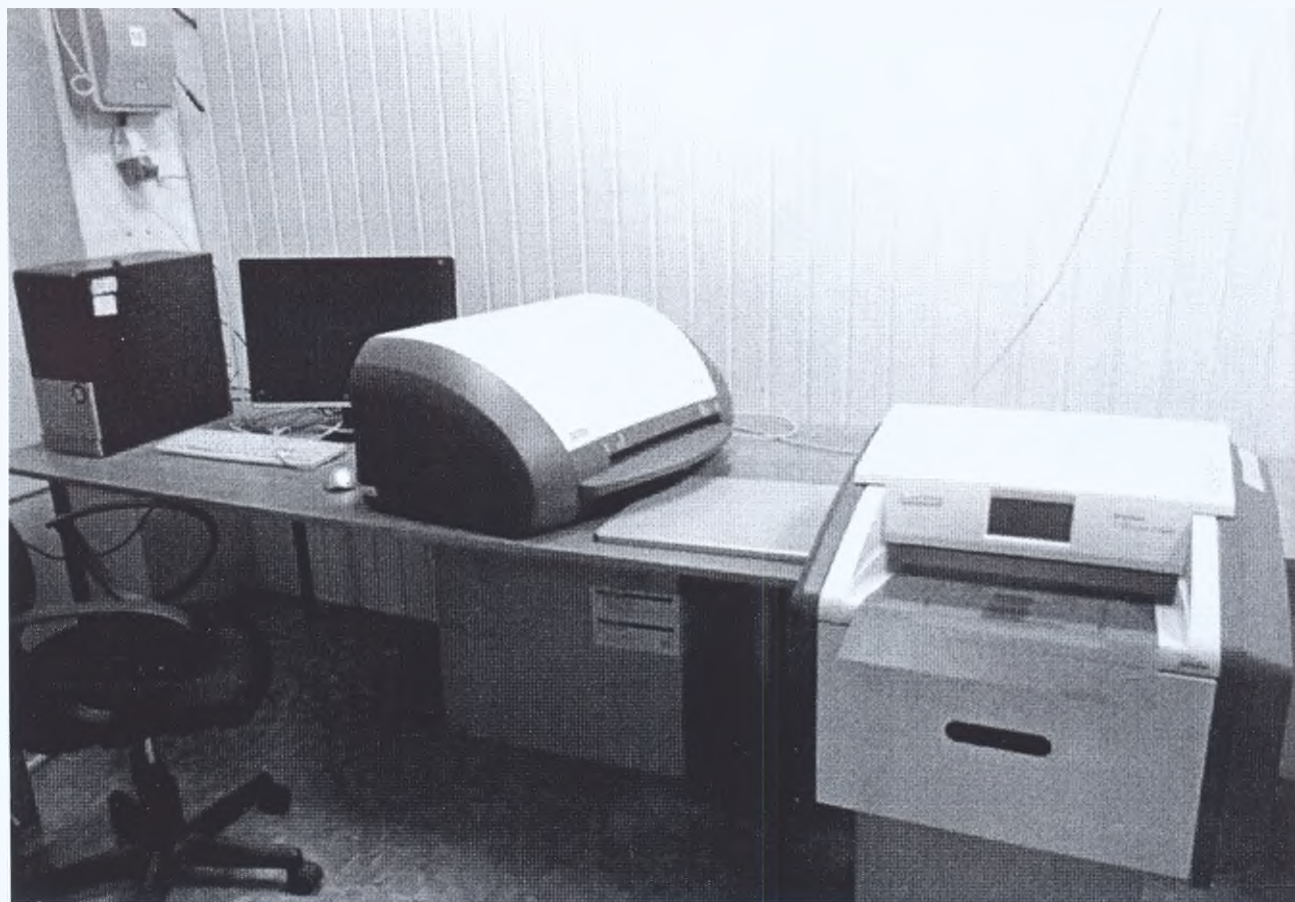



Или

Комплекс цифровой CR для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений с принадлежностями, исполнения CR10-X, CR30-Xm, производства Agfa N.V., Бельгия



или Система компьютерной рентгенографии CR в вариантах исполнения с принадлежностями исполнения CR 12-X, 15-X, Agfa N.V., Бельгия



или Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений, с принадлежностями CR30-X, производства Agfa – Health Care N.V., Бельгия



ния с

или Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений с принадлежностями, Цифровой дигитайзер DX-M производства Agfa N.V., Бельгия



ских и  
Agfa -



или Аппарат цифровой радиологии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima T (CR-IR 392) с принадлежностями, производства FUJIFILM Corporation, Япония




ров FCR  
пония


или Аппарат цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров,  
исполнения: FCR Profect One Plus (CR-IR 368), с принадлежностями;  
FCR Profect Cs Plus (CR-IR 363), с принадлежностями, производства FUJIFILM  
Corporation, Япония



или Система цифровой радиологии Vita с принадлежностями, исполнений: VitaFlex CR System или Vita SE CR System или Vita LE CR System, производства Carestream Health, Inc. 10.  
США

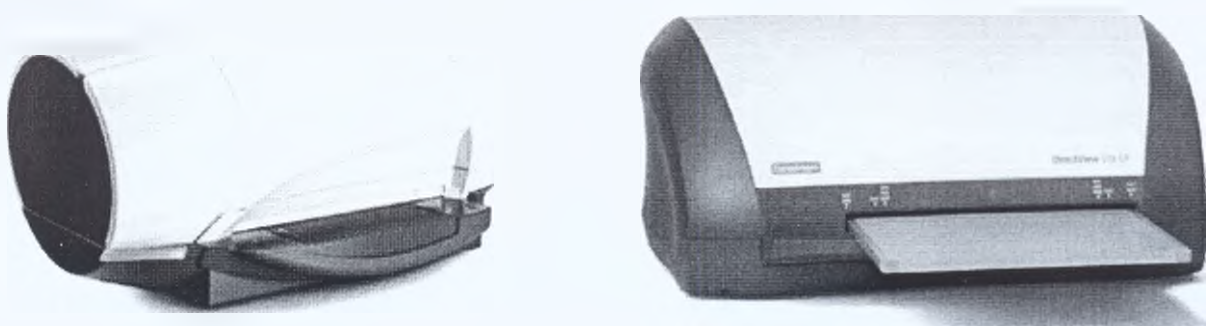

9. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

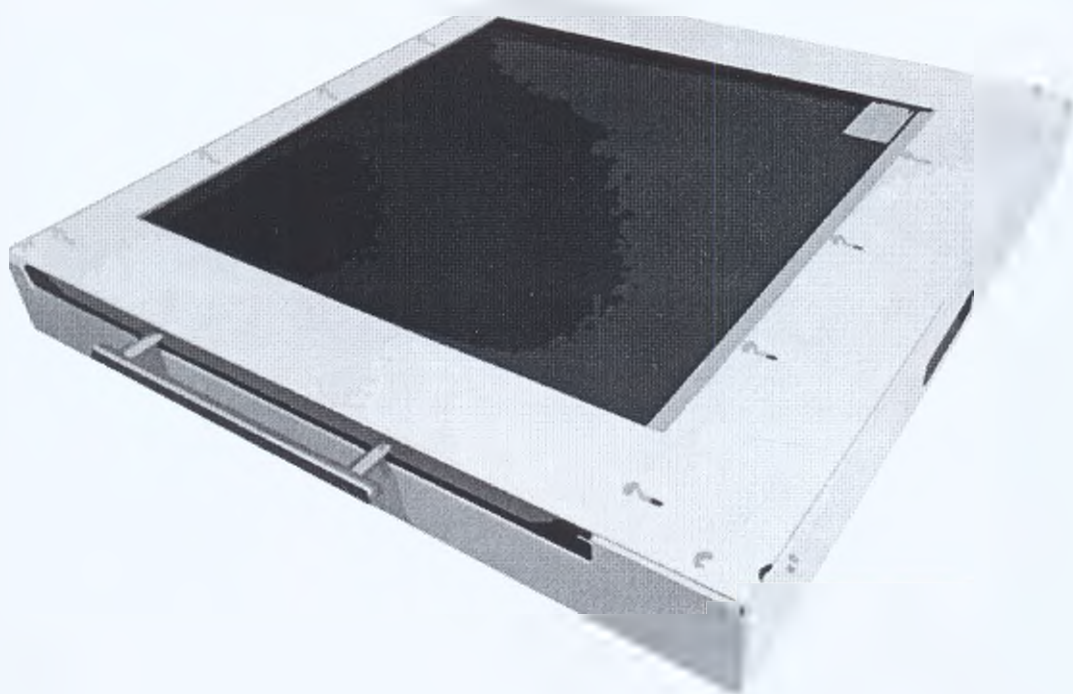




10. Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО», производства НПАО «АМИКО»



водства




11. Растр рентгеновский отсеивающий JPI, Тип AAS, ACS, AAC, ACC, производства «JPI Healthcare Co., Ltd.», Республика Корея 13.

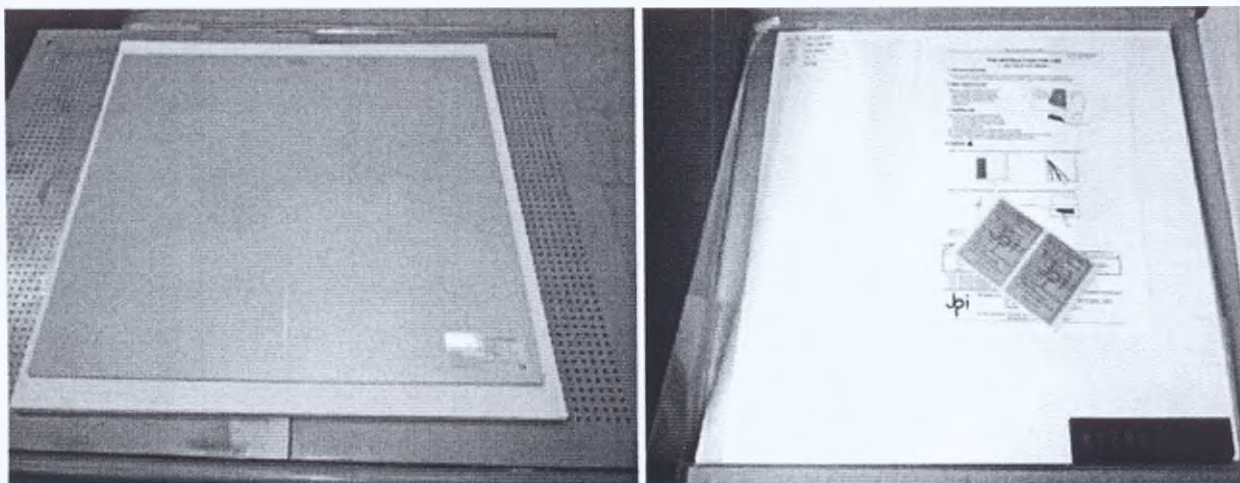

12. Переговорное устройство, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»




13. Кассеты медицинские рентгенографические, форматы 13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 35x35, 35x43, производства PROTEC GmbH & Co.KG, Германия или Кассеты рентгеновские с экранами рентгеновскими в сборе, производства Carestream Health Inc., США или Кассеты пластиковые рентгенографические «РЕНЕКС-КРП» с усиливающими экранами, форматы 13x18, 15x30, 18x24, 18x43, 20x40, 24x30, 30x40, 35x35, 35x43 см, производства ЗАО «РЕНЕКС»

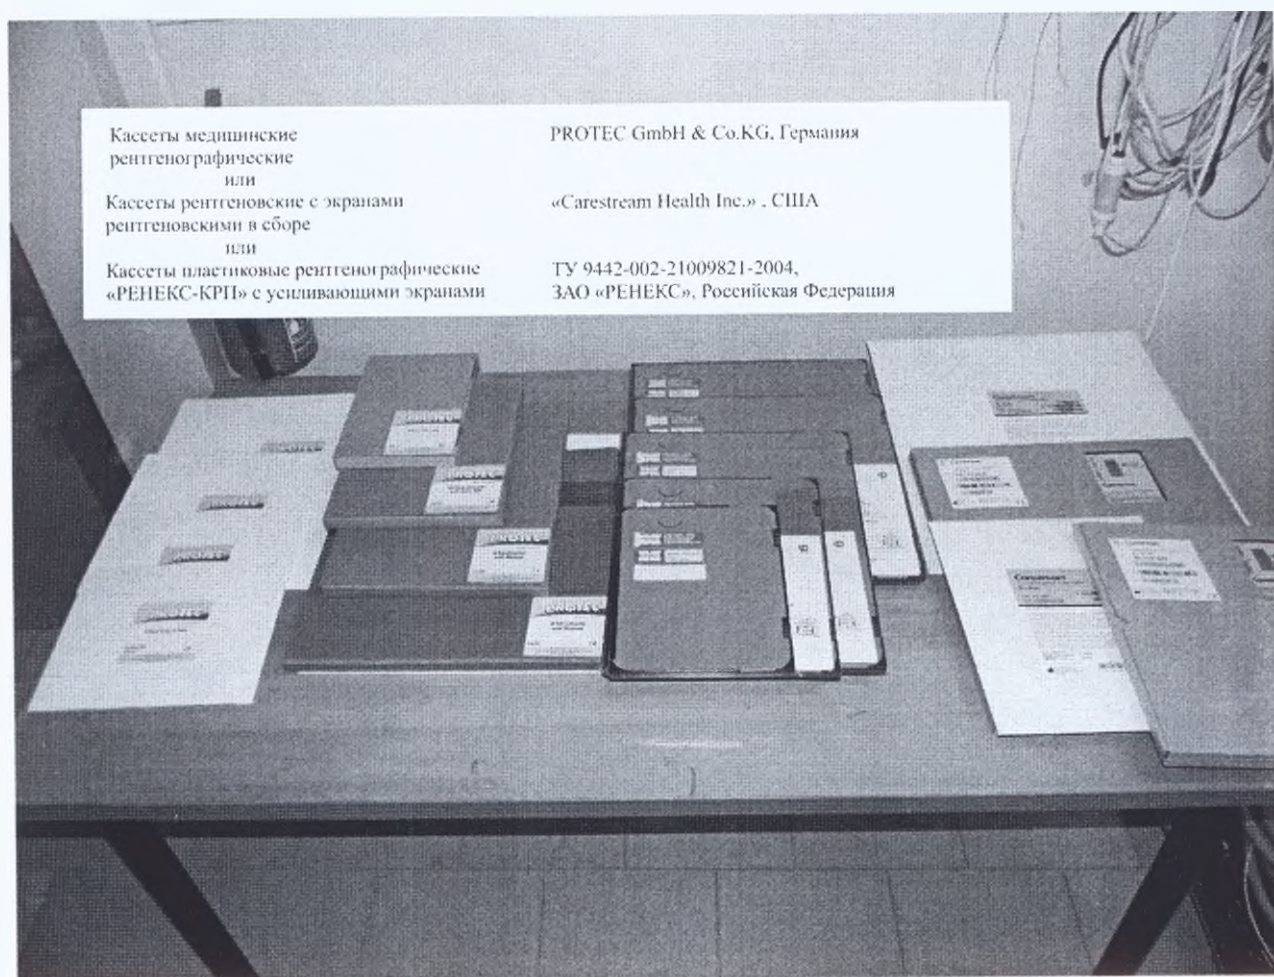




14. Экраны усиливающие для рентгеновских аппаратов, форматы 13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 35x35, 35x43см, производства PROTEC GmbH & Co.KG, Германия

15

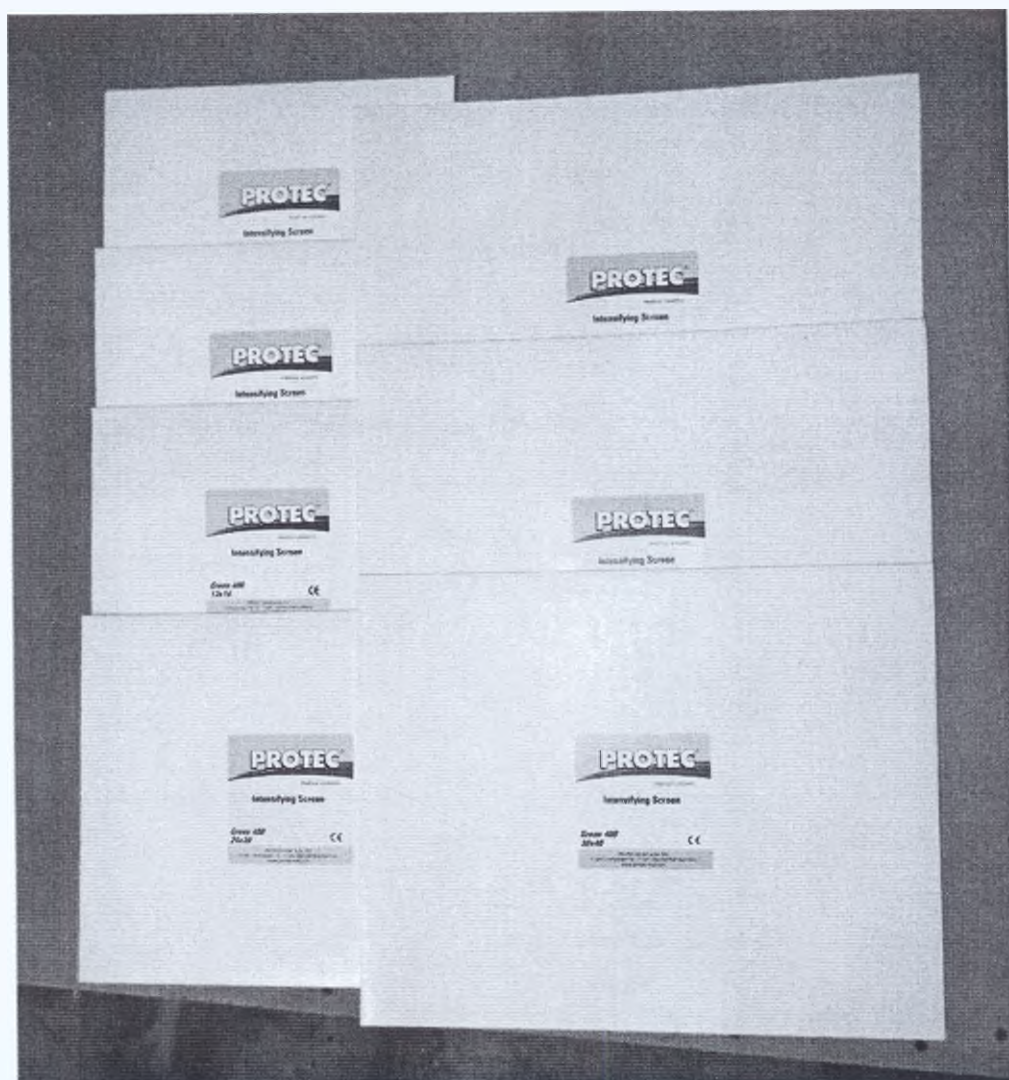


15. Система дистанционного видеонаблюдения, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

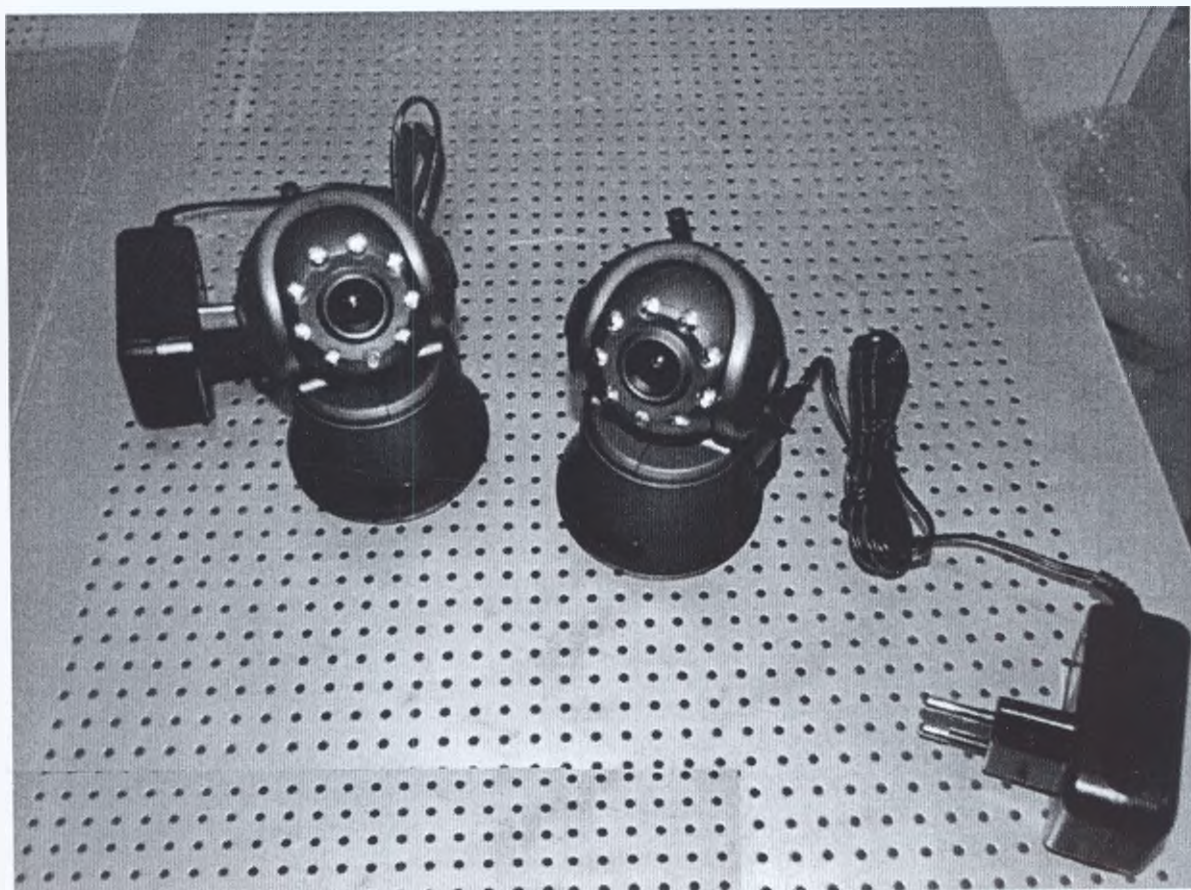



16. Комплект фотолaborаторный, производства НПО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

17.

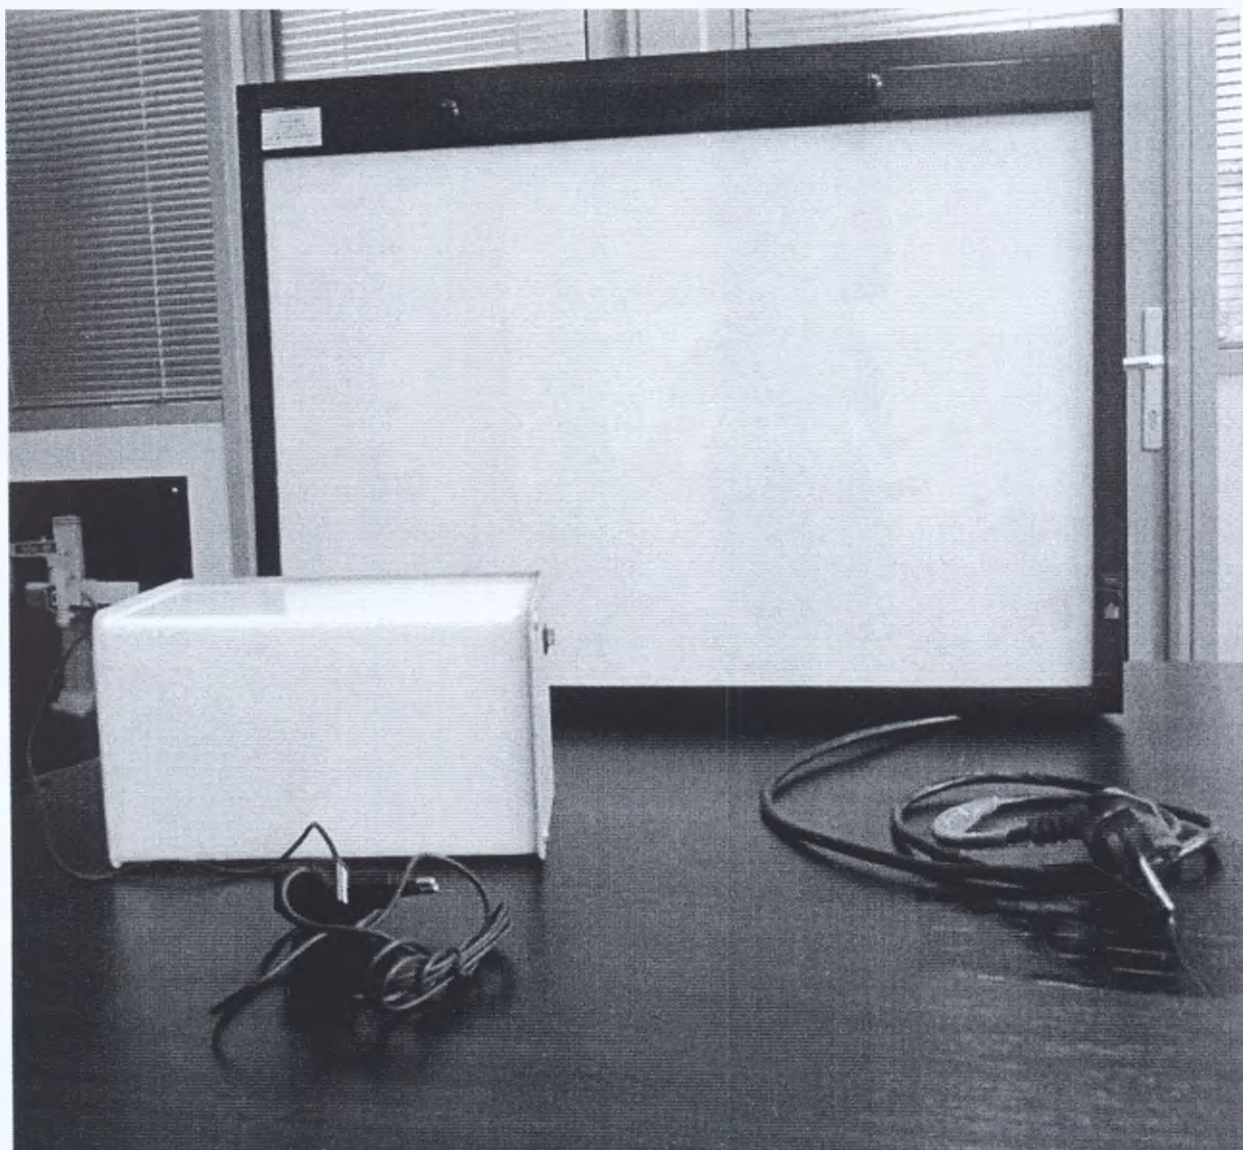





17. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К», воротник защитный ВРЗ-«Р-К», пелерина защитная ПЛРЗ-«Р-К», юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К», юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»; передник для защиты гонад легкий ПРЗГл- «Р-К»; передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт- «Р-К»; комплект защитных пластин из четырех элементов КПРЗ4-«Р-К»; комплект защитных пластин из семи элементов КПРЗ7-«Р-К»; перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»; очки защитные (без диоптрий) ОРЗ- «Р-К»; фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл-«Р-К»; фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К»; фартук защитный двусторонний ФРЗД-«Р-К»; шапочка защитная ШПРЗ-«Р-К», производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», ООО «Рентген-Комплект» или Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС»: фартук односторонний, фартук двухсторонний, халат, жилет, фартук стоматологический, юбка, передник (полufартук), накидка (пелерина), воротник (защита щитовидной железы), шапочка, фартук детский, юбка детская, воротник детский, накидка (пелерина) детская, передник (полufартук) детский, набор рентгенозащитных пластин (4 предмета), пластина рентгенозащитная, производства ЗАО «РЕНЕКС»



18. Окна защитные смотровые ОЗС, ОЗС-1 и ОЗС-2, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР» или Окна рентгенозащитные РЕНЕКС ОСЗР, производства ЗАО «РЕНЕКС»

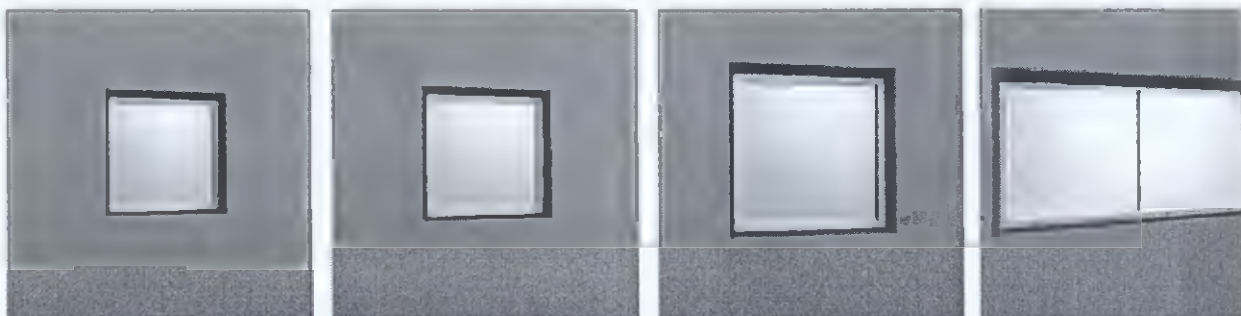

19. Комплект сменных устройств, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»:  
- Пояс компрессионный,

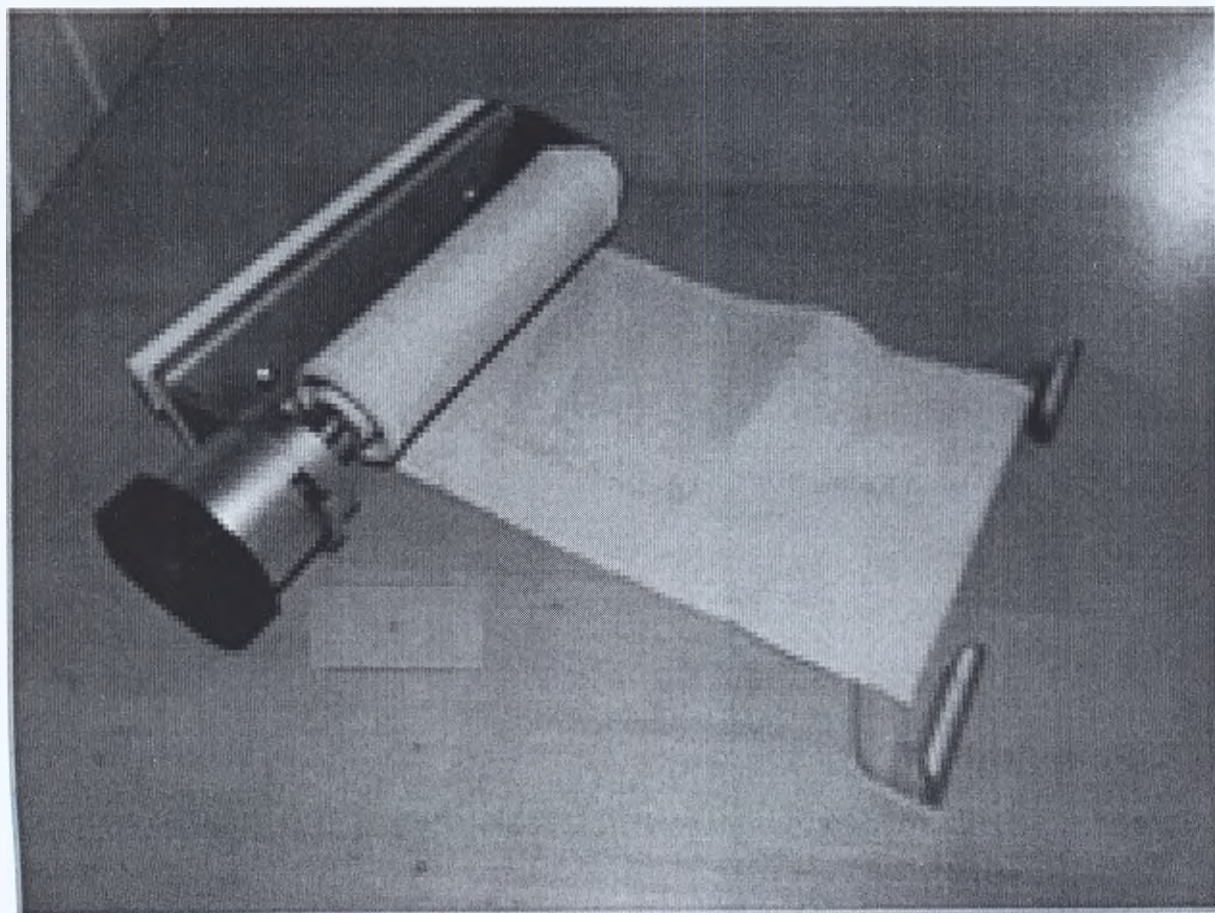



20. Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER», модель PS90W-30 (PS30000W – 3шт.), PS100SQ, производства ООО «Псковский завод электронной техники»,

или Стабилизатор напряжения серии «Сатурн», модель СНЭ-Т-90, СНЭ-Т-100, производства НΠΑΟ «ПФ«Созвездие»

или Стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль, модель R81000-3, R100K-3, R100K-3P, производства ООО «Тэнси-Техно»






Исполнение 2:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP – X 850 HF, модель TOP – X 850 HF с принадлежностями: пульт управления TXFAC1, производства Innomed Medical Zrt., Венгрия



или


Устройство рентгеновское питающее высокочастотное TOP – X 100 LC, модель TOP – X 100 LC с принадлежностями: пульт управления LCDTC1, производства Innomed Medical Zrt., Венгрия

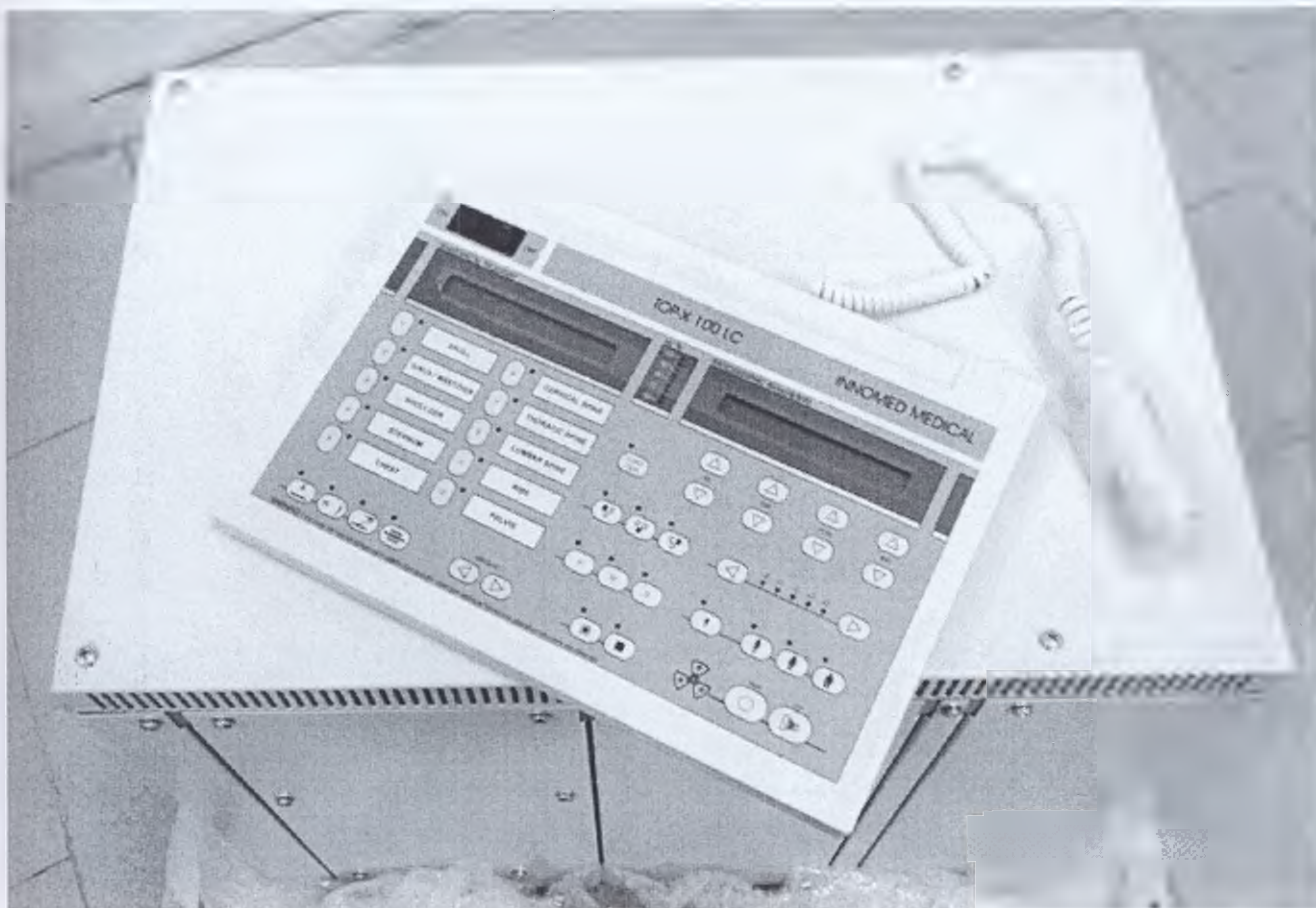




или

устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч-«АЗРТ», производства ЗАО «АЗРТ»

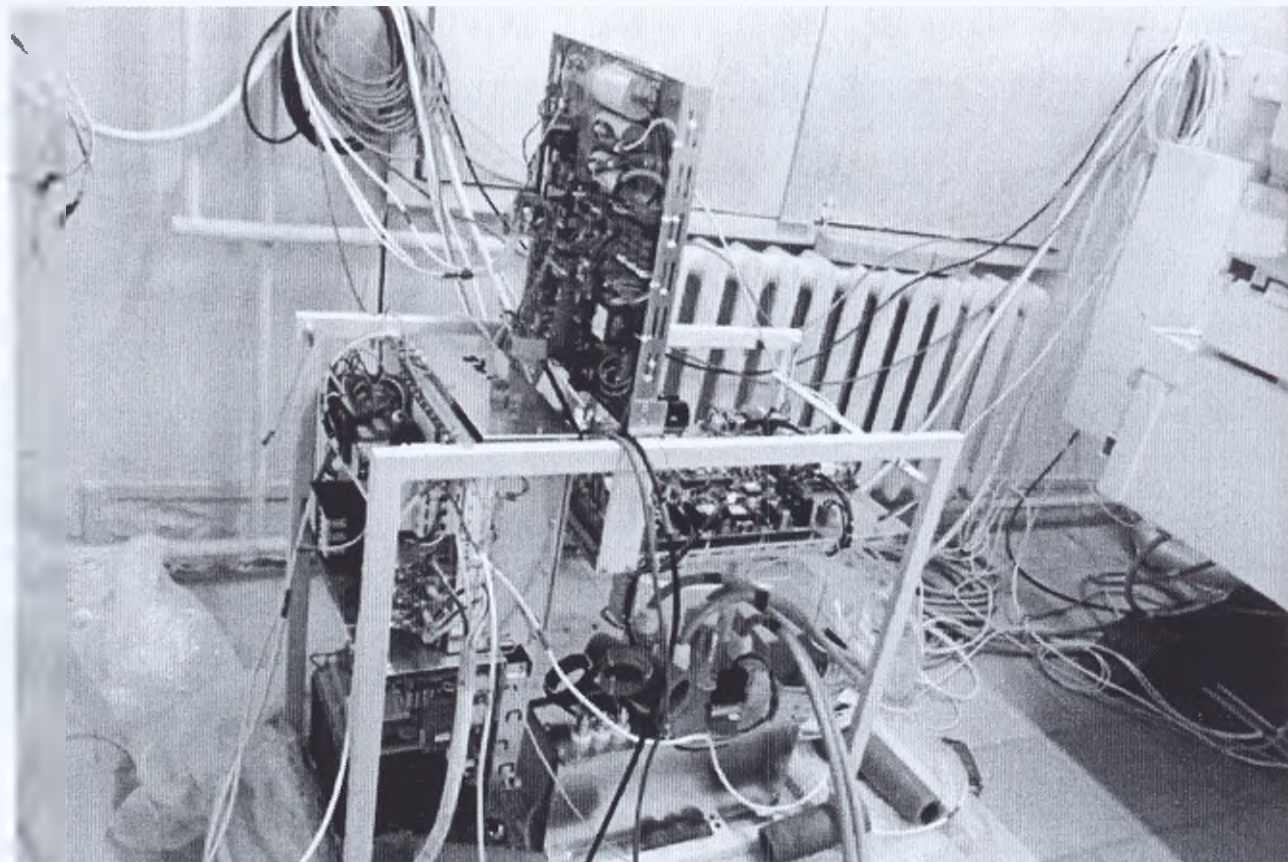




2. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД», производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ

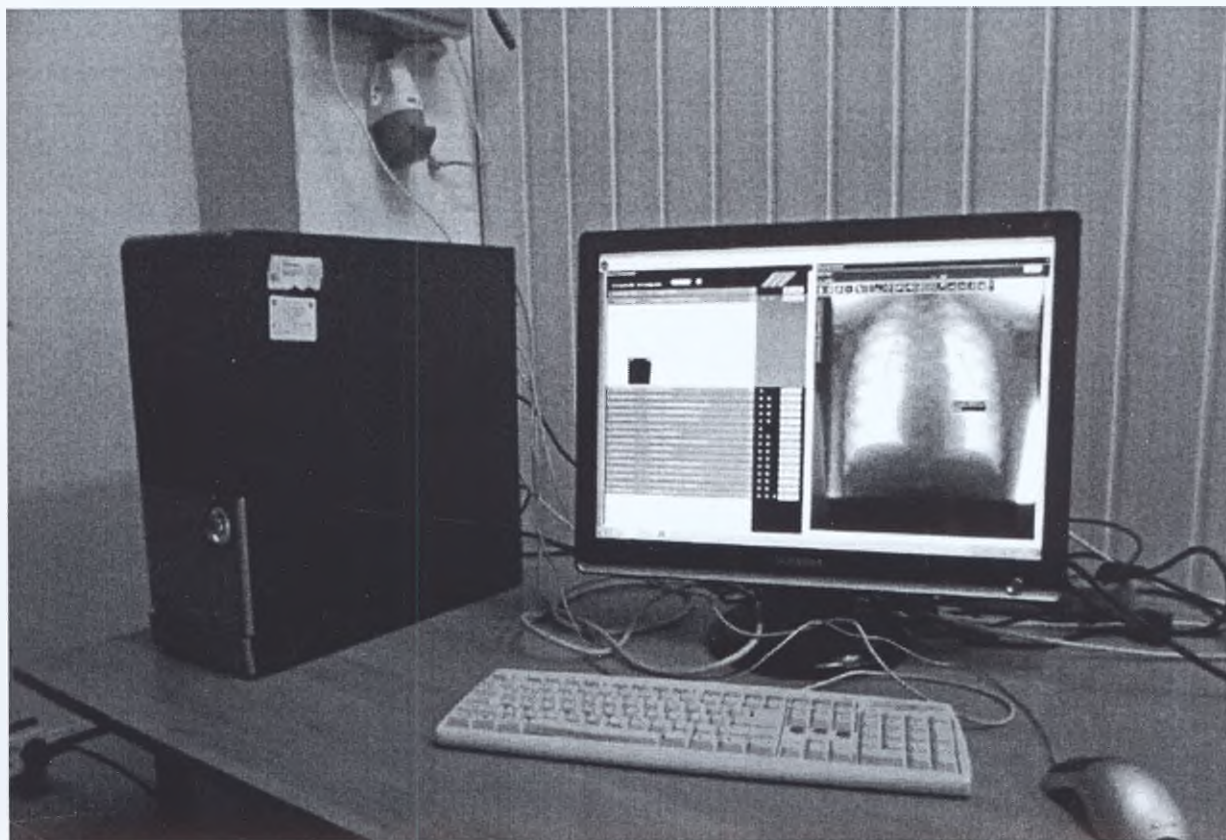

3. Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ», производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

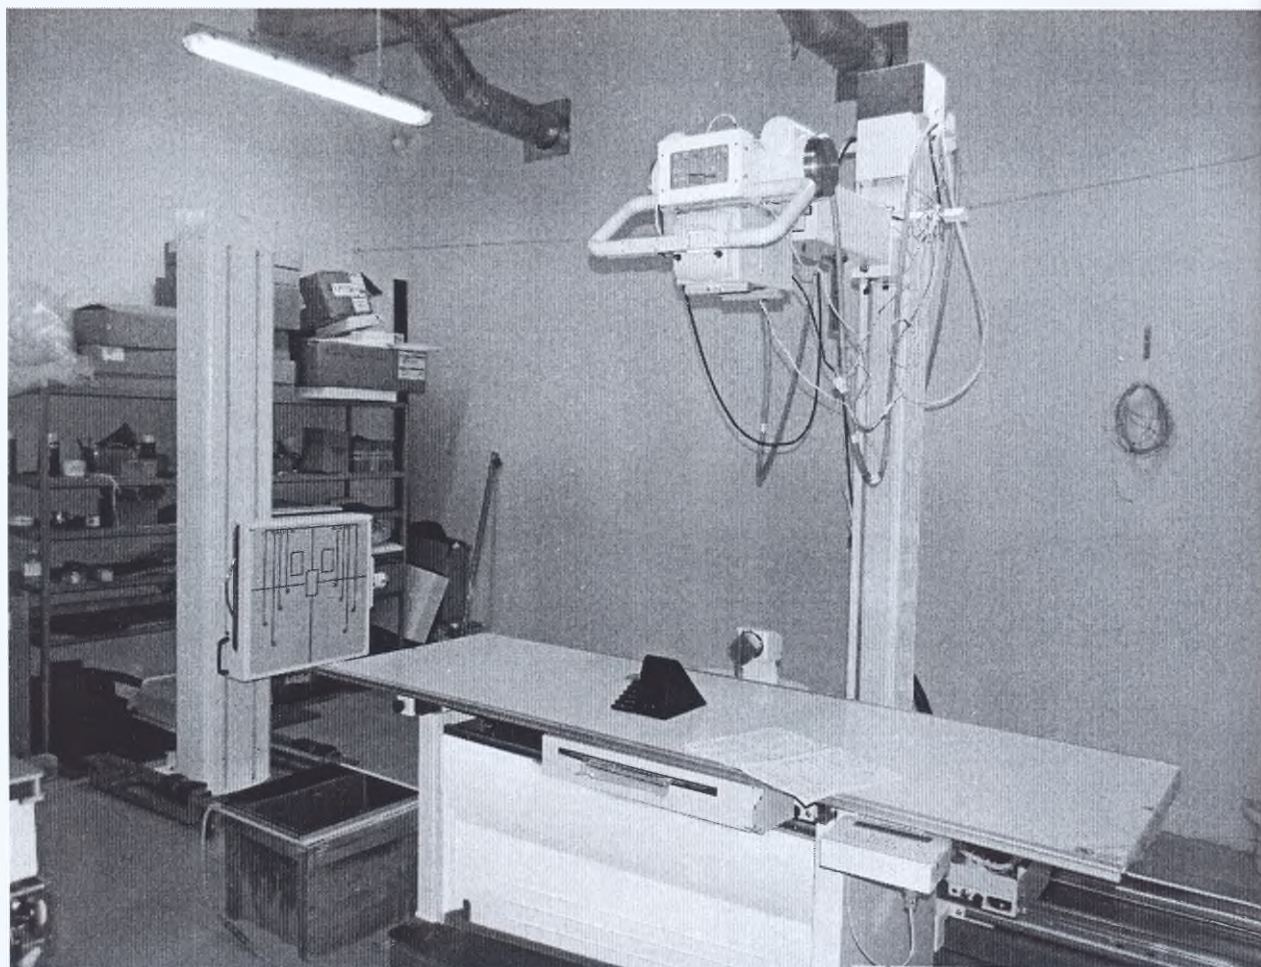




4. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, производства ООО НПП «Доза»





или Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО НПП «Доза»

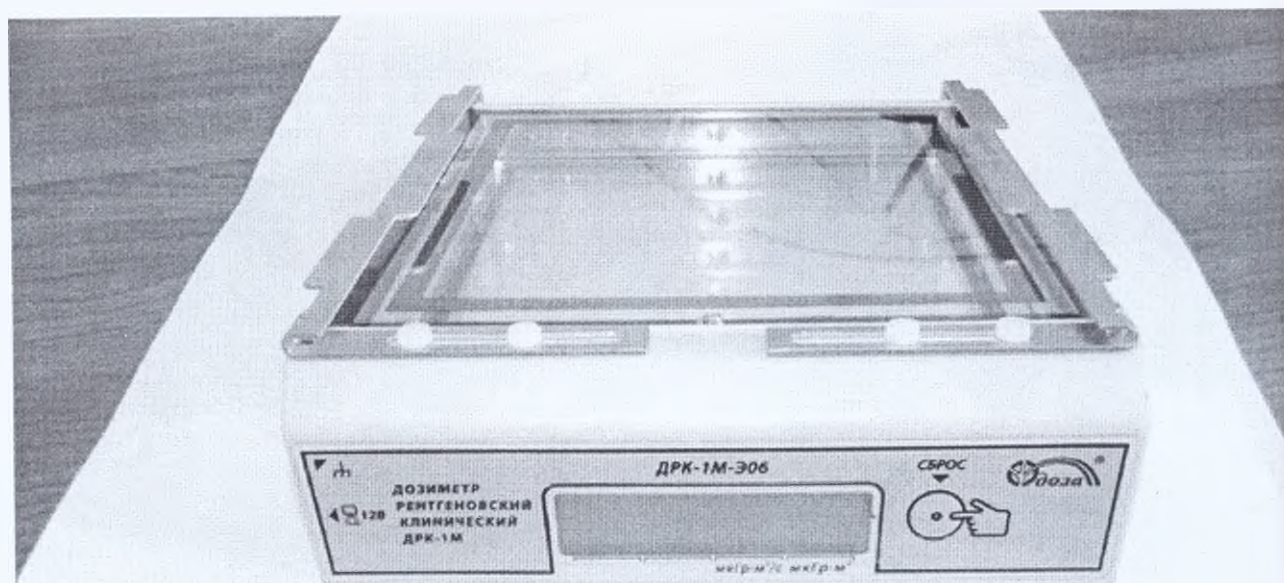


5. Излучатель рентгеновский E7242X, производства Toshiba Electron Tubes & Devices Co., Ltd. или Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония






или Излучатель с трубкой рентгеновской RAY-12\_1, RAY-12\_3, RAY-12S\_1, RAY-12S\_3, RAY-14\_1, RAY-14\_3, RAY-14S\_1, RAY-14S\_3, производства Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi, Китай

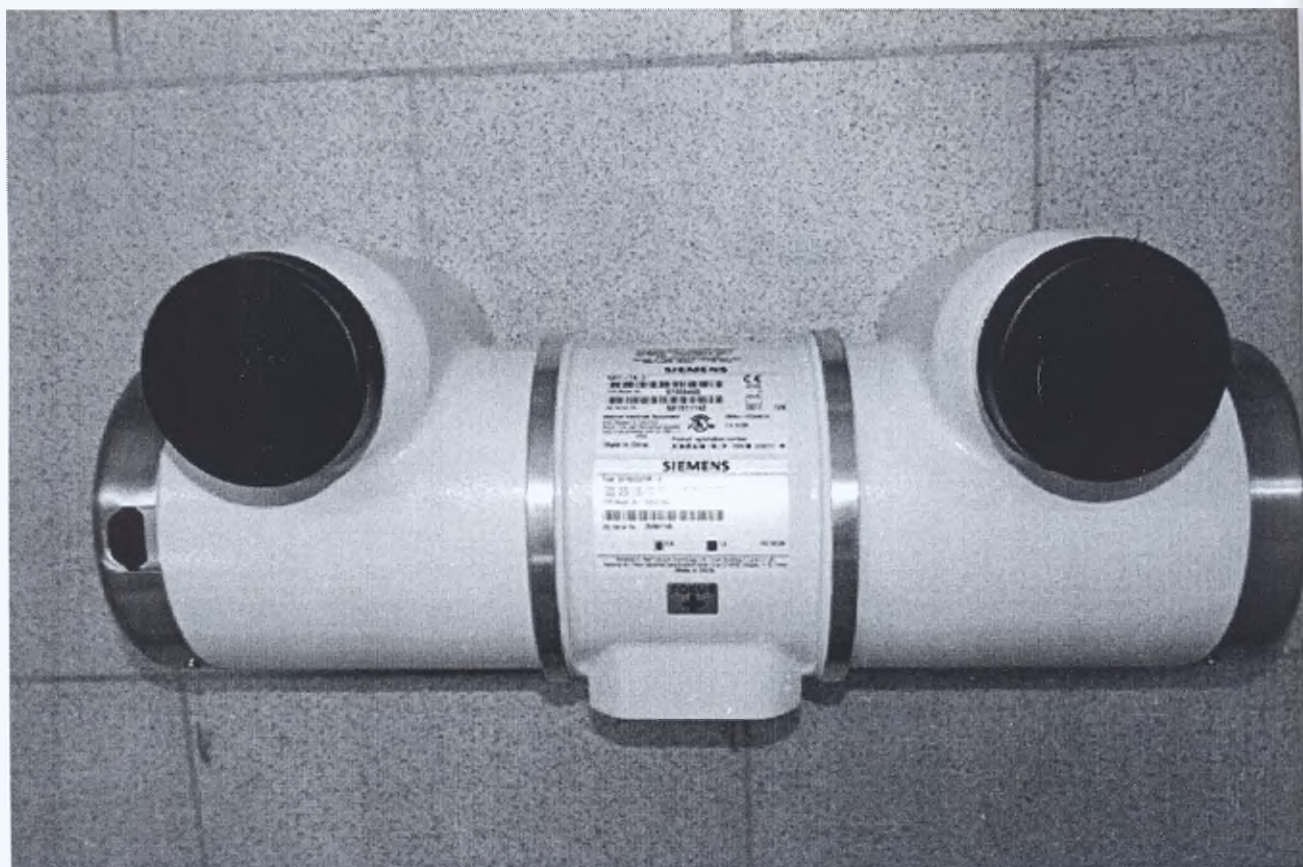


или Излучатель с трубкой рентгеновской Optilix 154/30/50R-101S, производства Siemens  
Healthcare GmbH., Германия

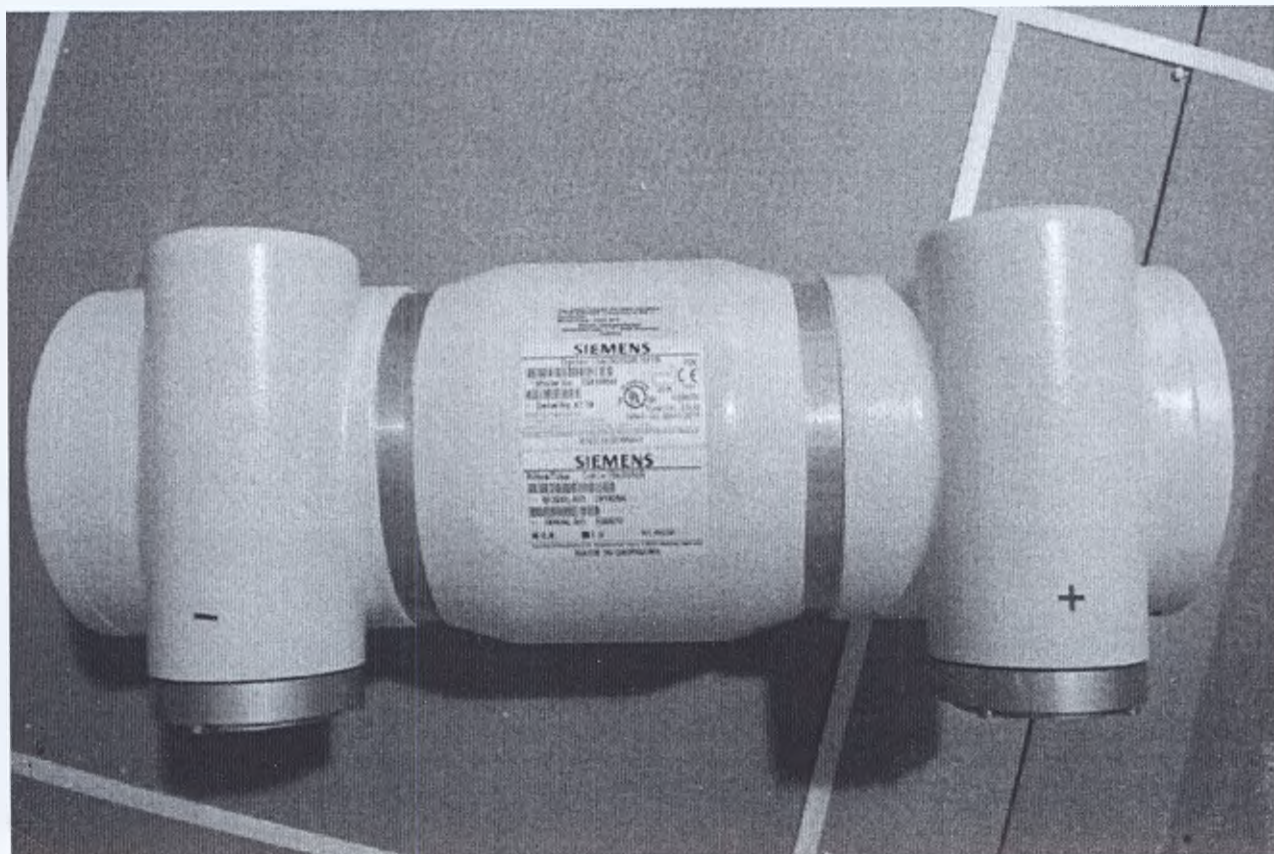



6. Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-АМИКО», производства НПО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

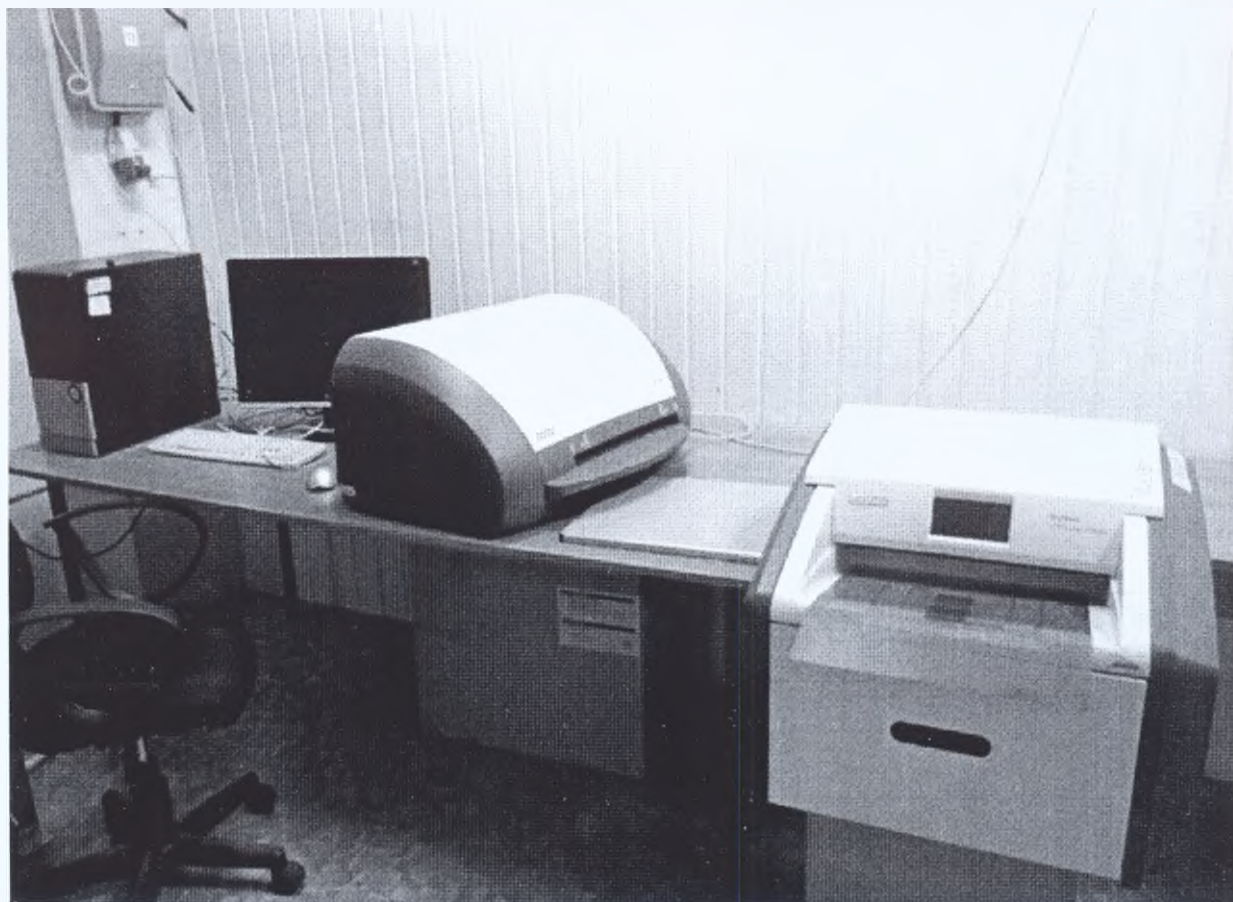

или Комплекс цифровой CR для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений с принадлежностями, исполнения CR 10-X, CR 30-Xm, производства Agfa – N.V., Бельгия





или Система компьютерной рентгенографии CR в вариантах исполнения с принадлежностями  
исполнения CR 12-X, 15-X, Agfa N.V., Бельгия



или Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений, с принадлежностями CR30-X, производства Agfa – Health Care N.V., Бельгия



или Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений с принадлежностями, Цифровой дигитайзер DX-M производства Agfa N.V., Бельгия






или Аппарат цифровой радиографии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima T (CR-IR 392) с принадлежностями, производства FUJIFILM Corporation, Япония




или Аппарат цифровой радиологии на основе фотостимулируемых люминофоров, исполнений: FCR Profect One Plus (CR-IR 368), с принадлежностями;  
FCR Profect Cs Plus (CR-IR 363), с принадлежностями, производства FUJIFILM Corporation, Япония

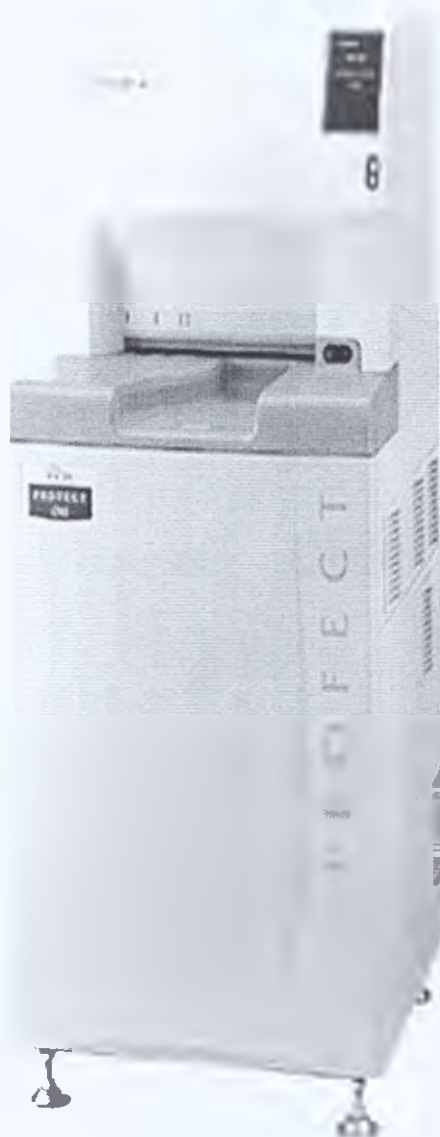




или Система цифровой радиологии Vita с принадлежностями, исполнений: Vita Flex CR System или Vita SE CR System или Vita LE CR System, производства Carestream Health, Inc. США

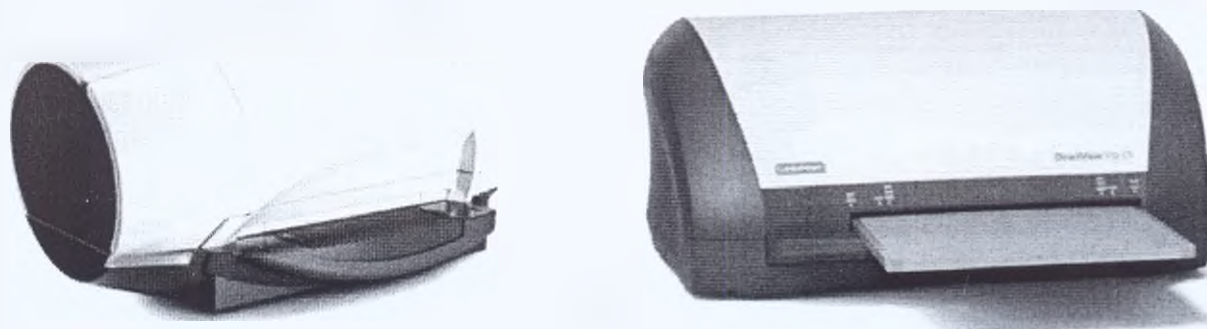

7. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

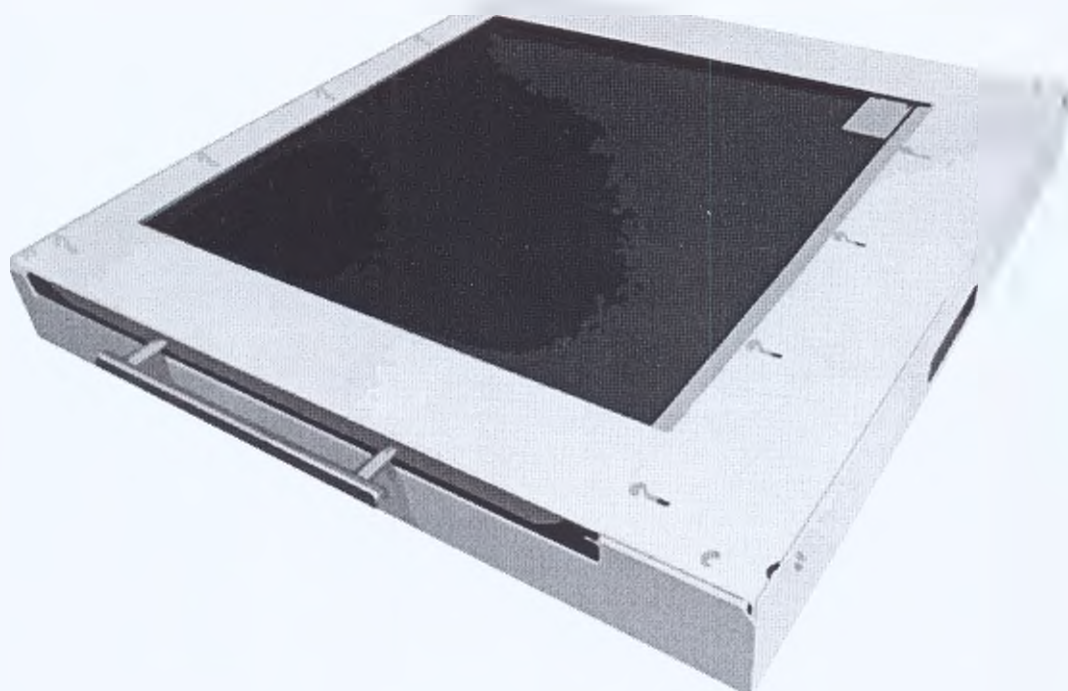


- Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО», производства НПАО «АМИКО»





9. Растр рентгеновский отсеивающий JPI, Тип AAS, ACS, AAC, ACC, производства «JPI Healthcare Co., Ltd.», Республика Корея

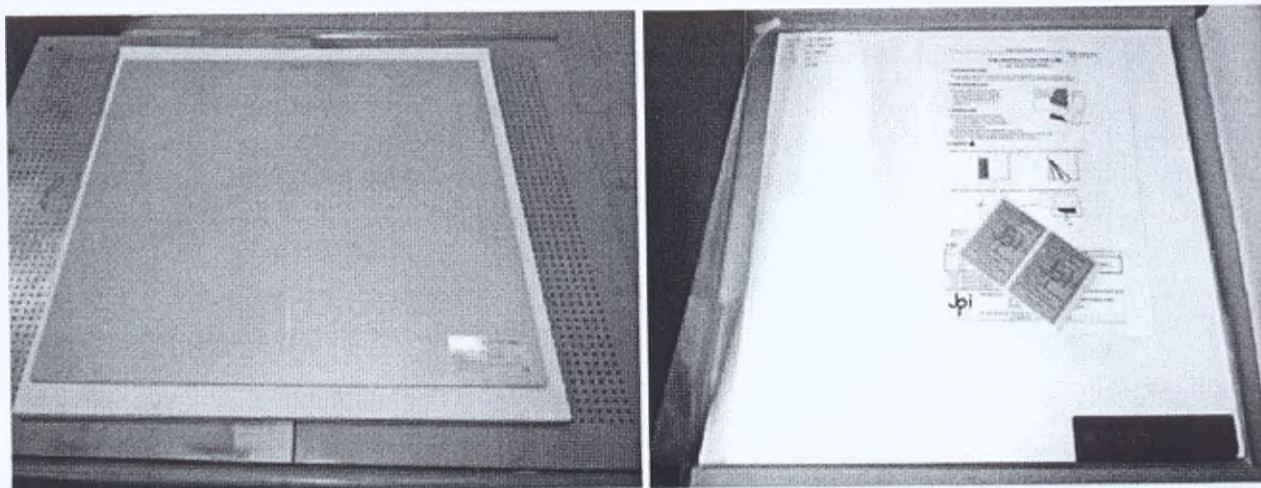


10. Переговорное устройство, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»






11. Кассеты медицинские рентгенографические, форматы 13х18, 18х24, 24х30, 30х40, 35х35, 35х43, производства PROTEC GmbH & Co.KG, Германия или Кассеты рентгеновские с экранами рентгеновыми в сборе, производства Carestream Health Inc., США или Кассеты пластиковые рентгенографические «РЕНЕКС-КРП» с усиливающими экранами, форматы 13х18, 15х30, 18х24, 18х43, 20х40, 24х30, 30х40, 35х35, 35х43 см, производства ЗАО «РЕНЕКС»

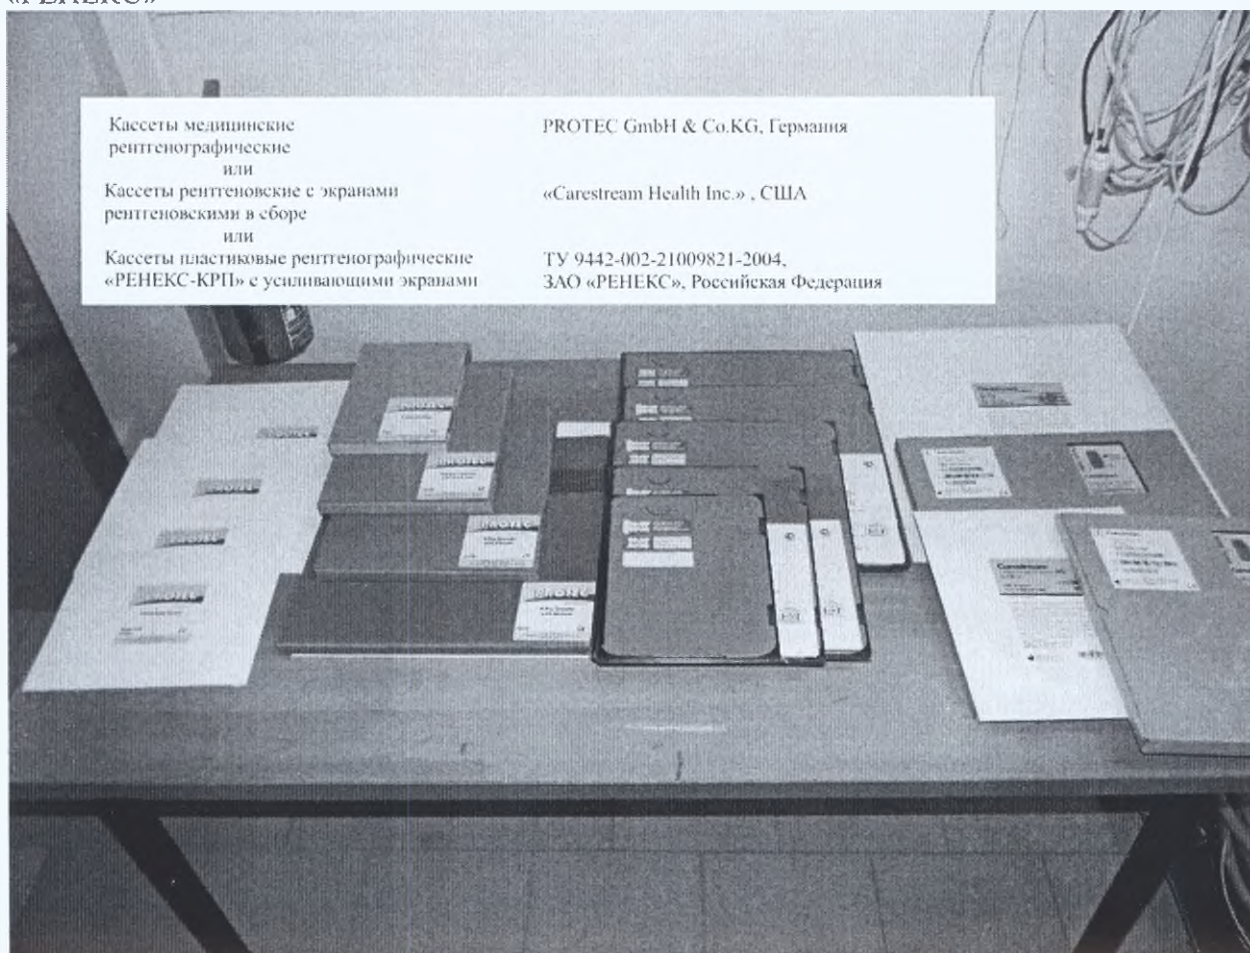


12. Экраны усиливающие для рентгеновских аппаратов, форматы 13х18, 18х24, 24х30, 30х40, 35х35, 35х43см, производства PROTEC GmbH & Co.KG, Германия

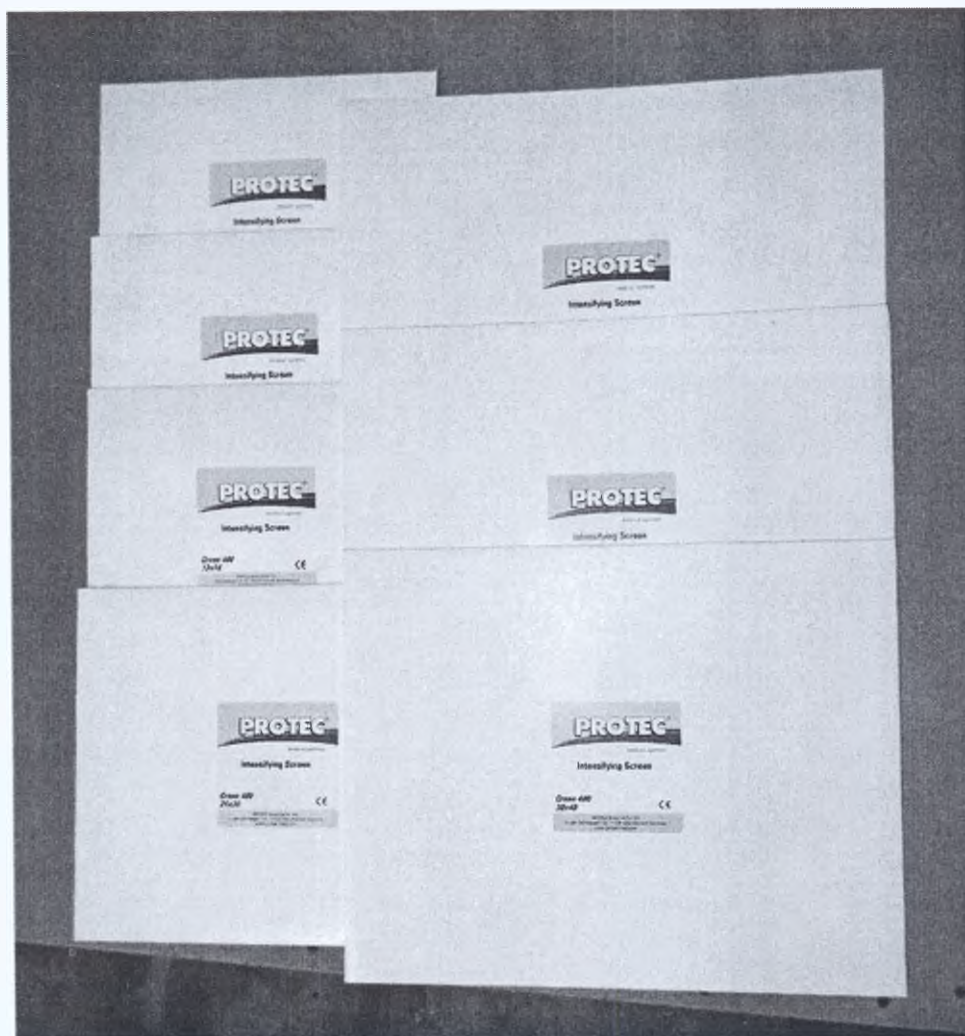




13. Система дистанционного видеонаблюдения, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

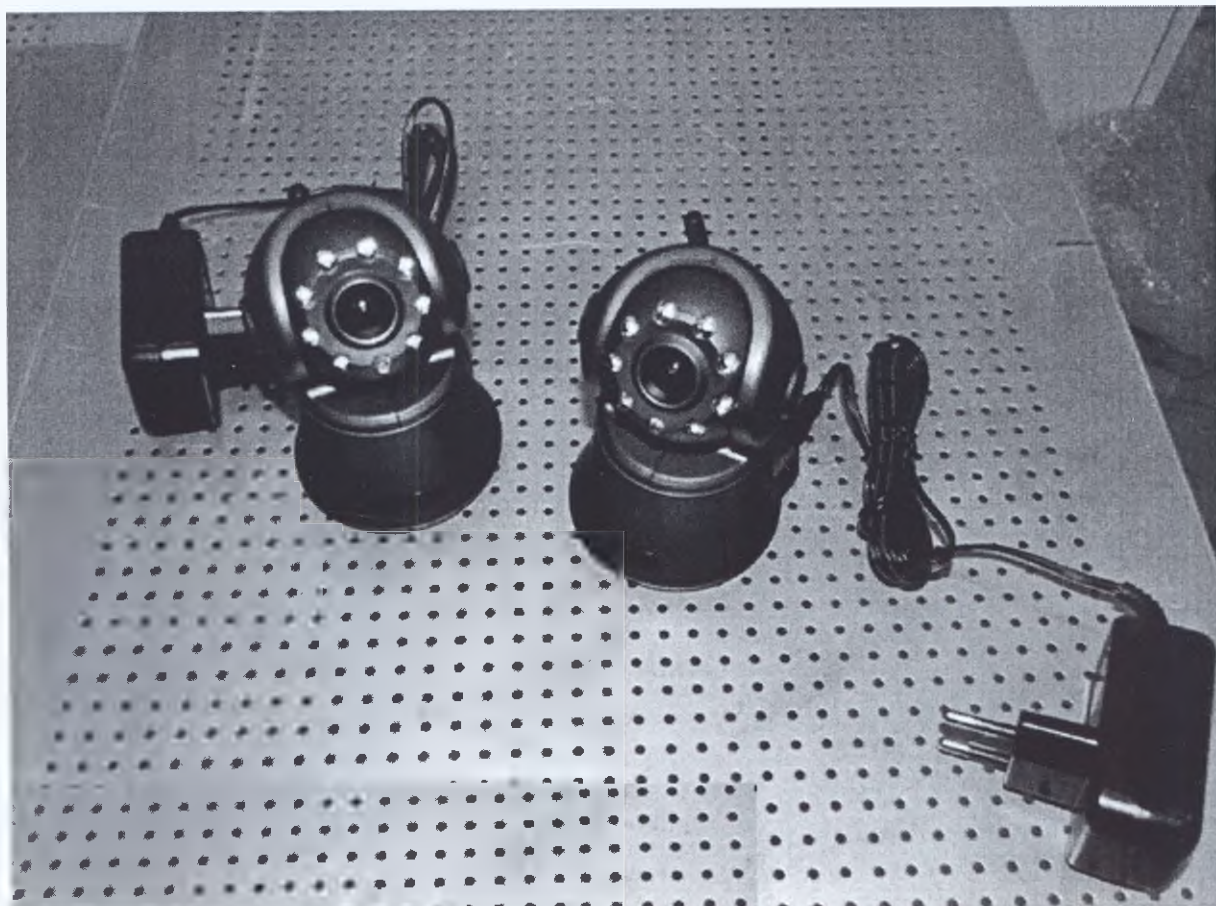

14. Комплект фотолaborаторный, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРГ»

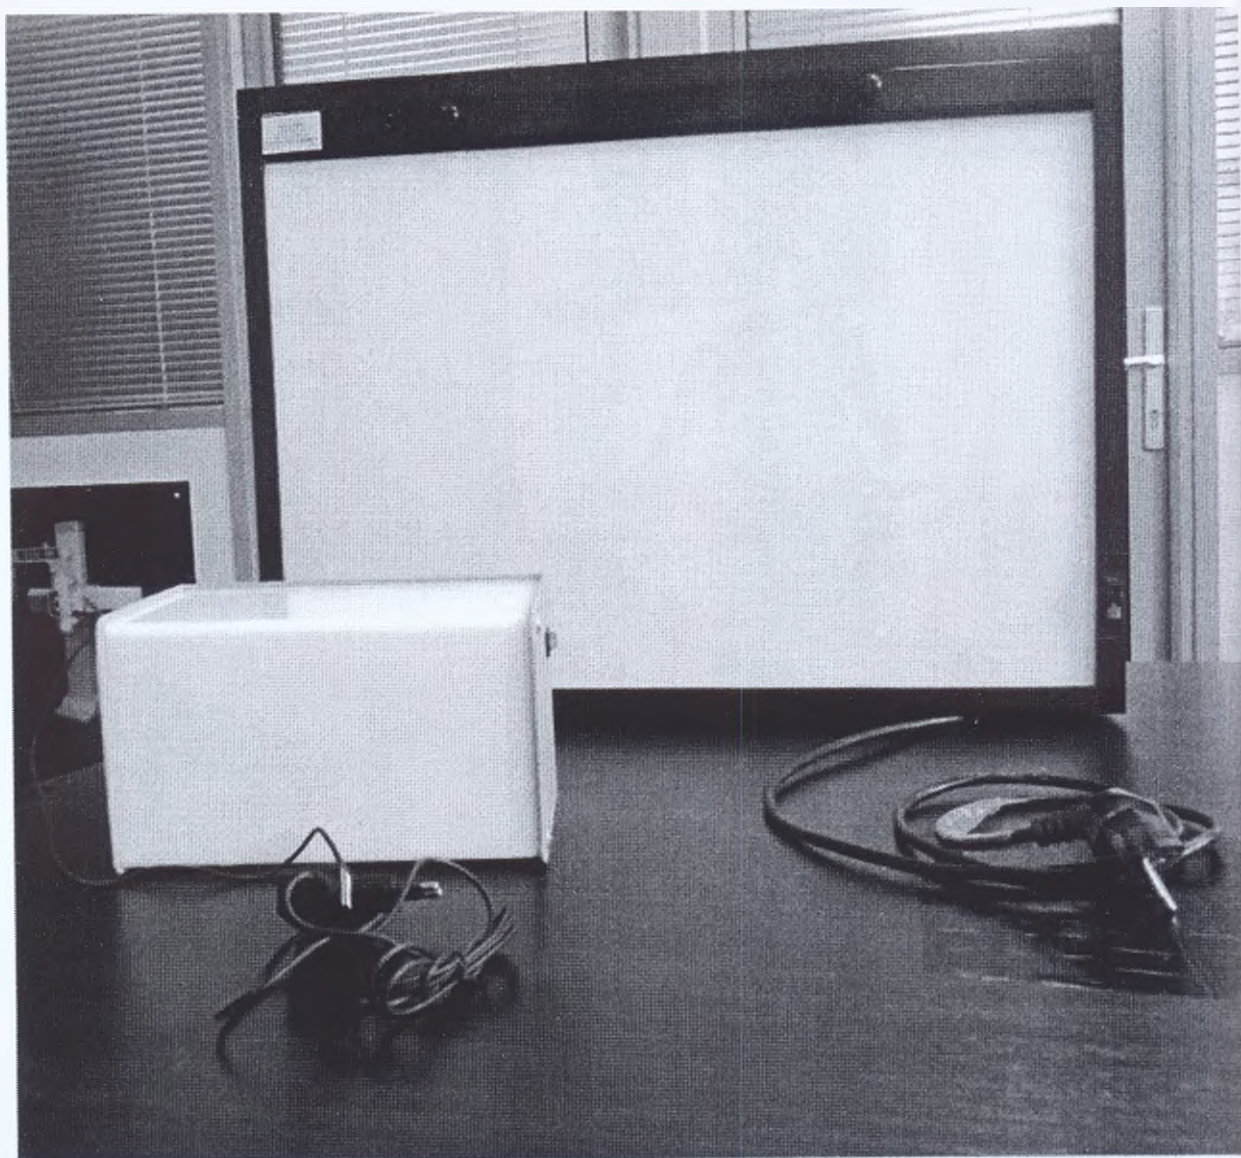


15.



15. Каталка рентгенографическая, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»




16. Устройство фиксации детей для рентгенографии, производства ЗАО «АЗРТ»

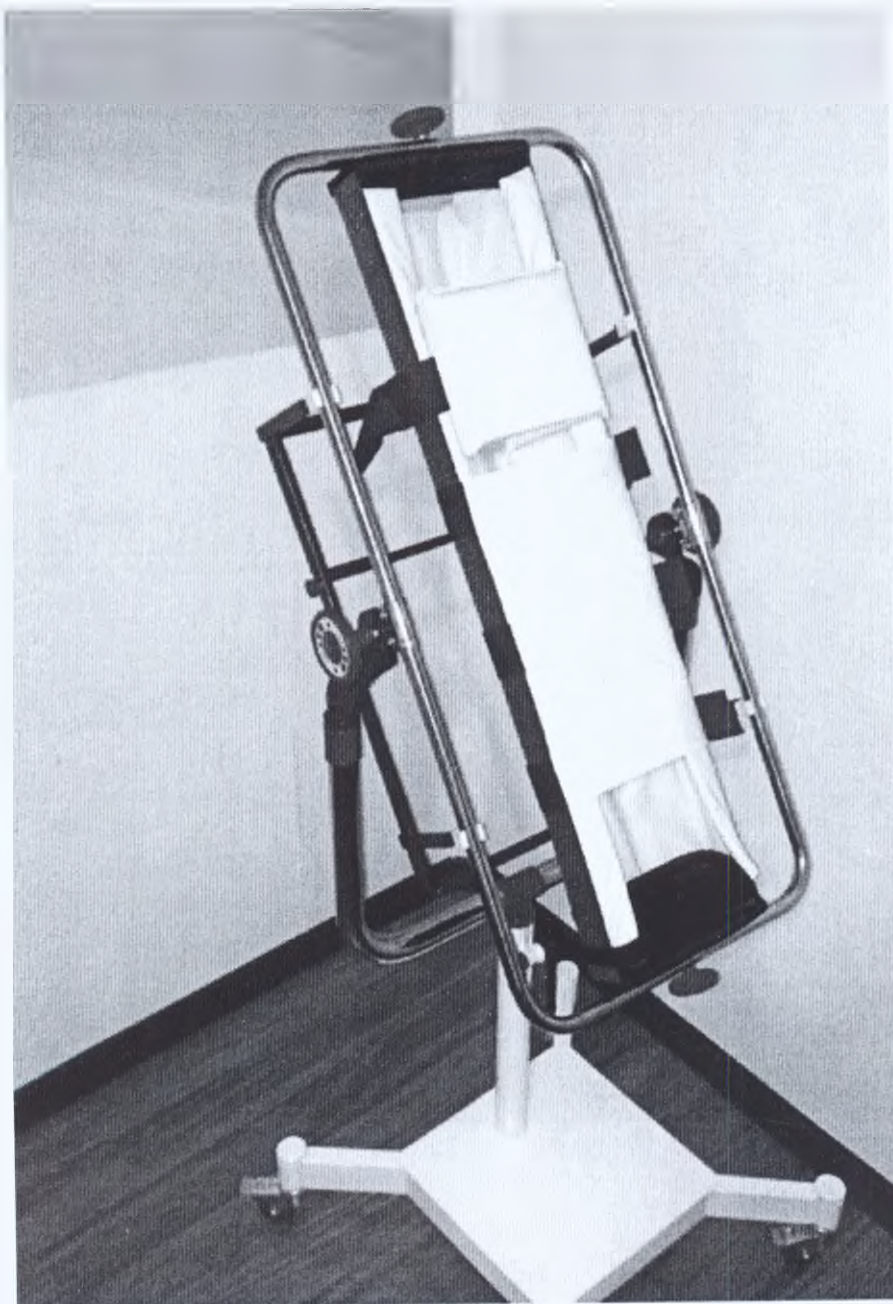




17. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К», воротник защитный ВРЗ-«Р-К», пелерина защитная ПЛРЗ-«Р-К», юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К», юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»; передник для защиты гонад легкий ПРЗГл- «Р-К»; передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт- «Р-К»; комплект защитных пластин из четырех элементов КПРЗ4-«Р-К»; комплект защитных пластин из семи элементов КПРЗ7-«Р-К»; перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»; очки защитные (без диоптрий) ОРЗ- «Р-К»; фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл-«Р-К»; фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К»; фартук защитный двусторонний ФРЗД-«Р-К»; шапочка защитная ШПРЗ-«Р-К», производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», ООО «Рентген-Комплект»

или Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС»: фартук односторонний, фартук двухсторонний, халат, жилет, фартук стоматологический, юбка, передник (полуфартук), накидка (пелерина), воротник (защита щитовидной железы), шапочка, фартук детский, юбка детская, воротник детский, накидка (пелерина) детская, передник (полуфартук) детский, набор рентгенозащитных пластин (4 предмета), пластина рентгенозащитная, производства ЗАО «РЕНЕКС»

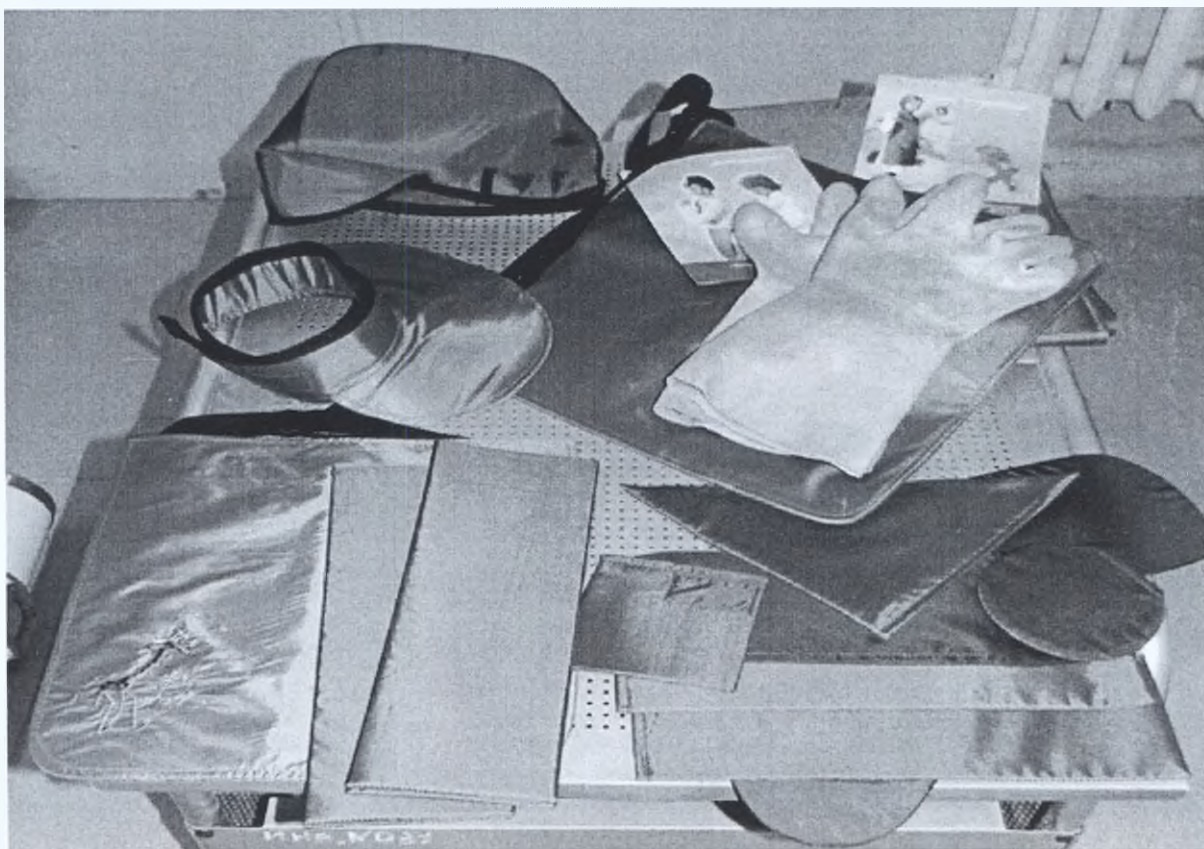


18. Окна защитные смотровые ОЗС, ОЗС-1 и ОЗС-2, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР» или Окна рентгенозащитные РЕНЕКС ОСЗР, производства ЗАО «РЕНЕКС»

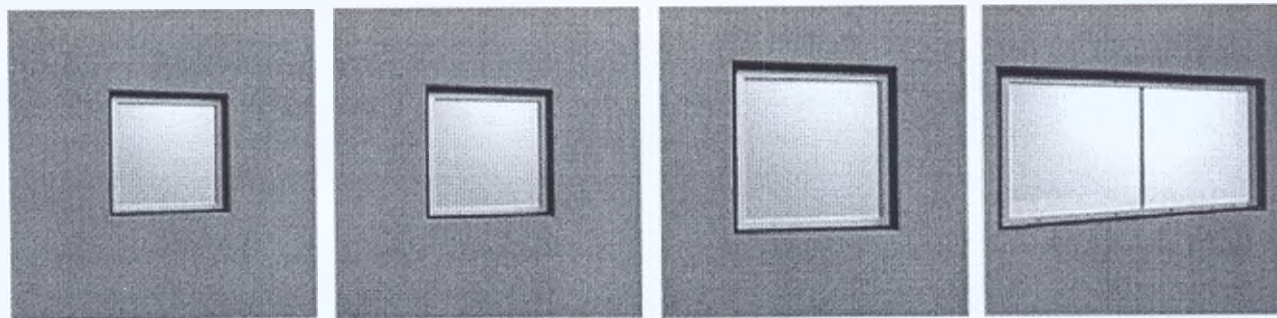

19. Комплект сменных устройств, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»:

- Пояс компрессионный,
- Рамка – кассетодержатель,
- Полка для латерографии.

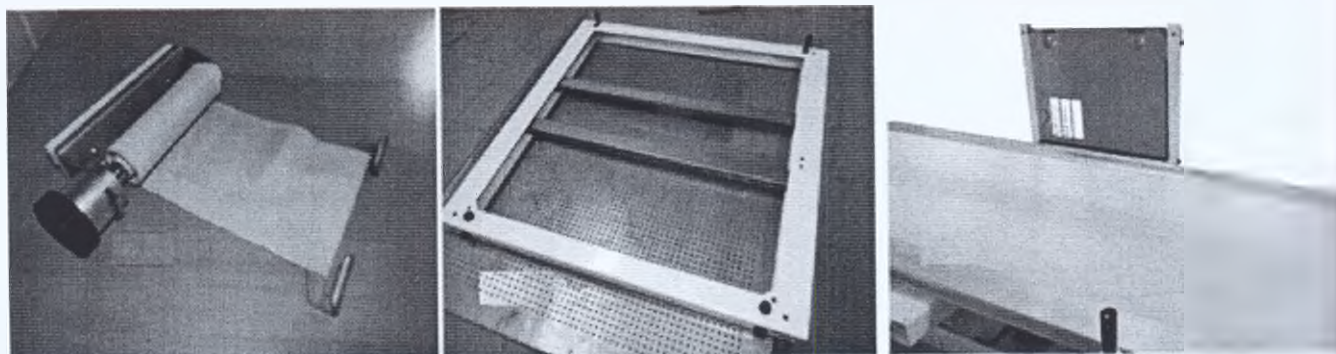


20. Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER», модель PS90W-30 (PS30000W – 3шт.), PS100SQ, производства ООО «Псковский завод электронной техники», или

Стабилизатор напряжения серии «Сатурн», модель СНЭ-Т-90, СНЭ-Т-100, производства НПАО «ПФ«Созвездие»

или

Стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль, модель R81000-3, R100K-3, R100K-3P, производства ООО «Тэнси-Техно»

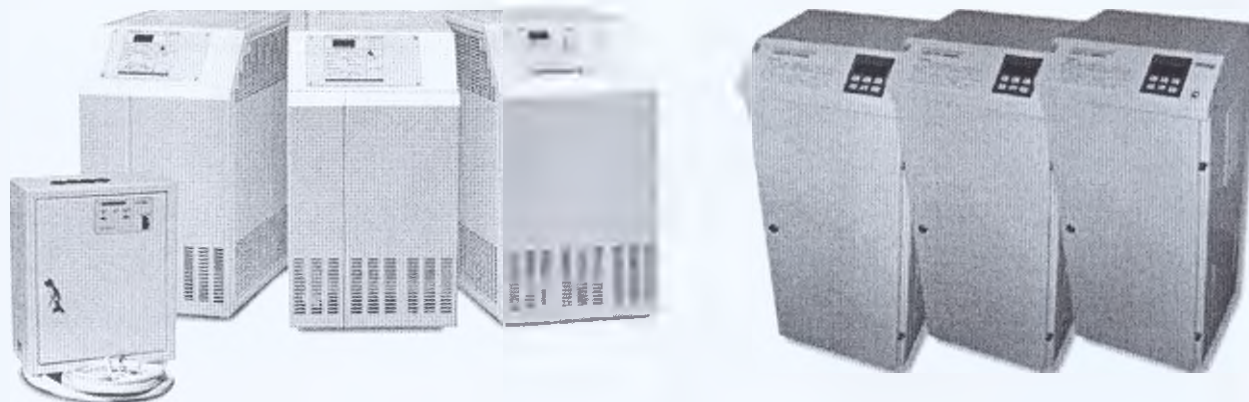




## Исполнение 3:

Устройство рентгеновское питающее высокочастотное ГОР – X 850 HF, модель TOP – X 850 HF с принадлежностями: пульт управления TXFAC1, производства Innomed Medical Zrt., Венгрия






или устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч-«АЗРТ», производства ЗАО «АЗРТ»

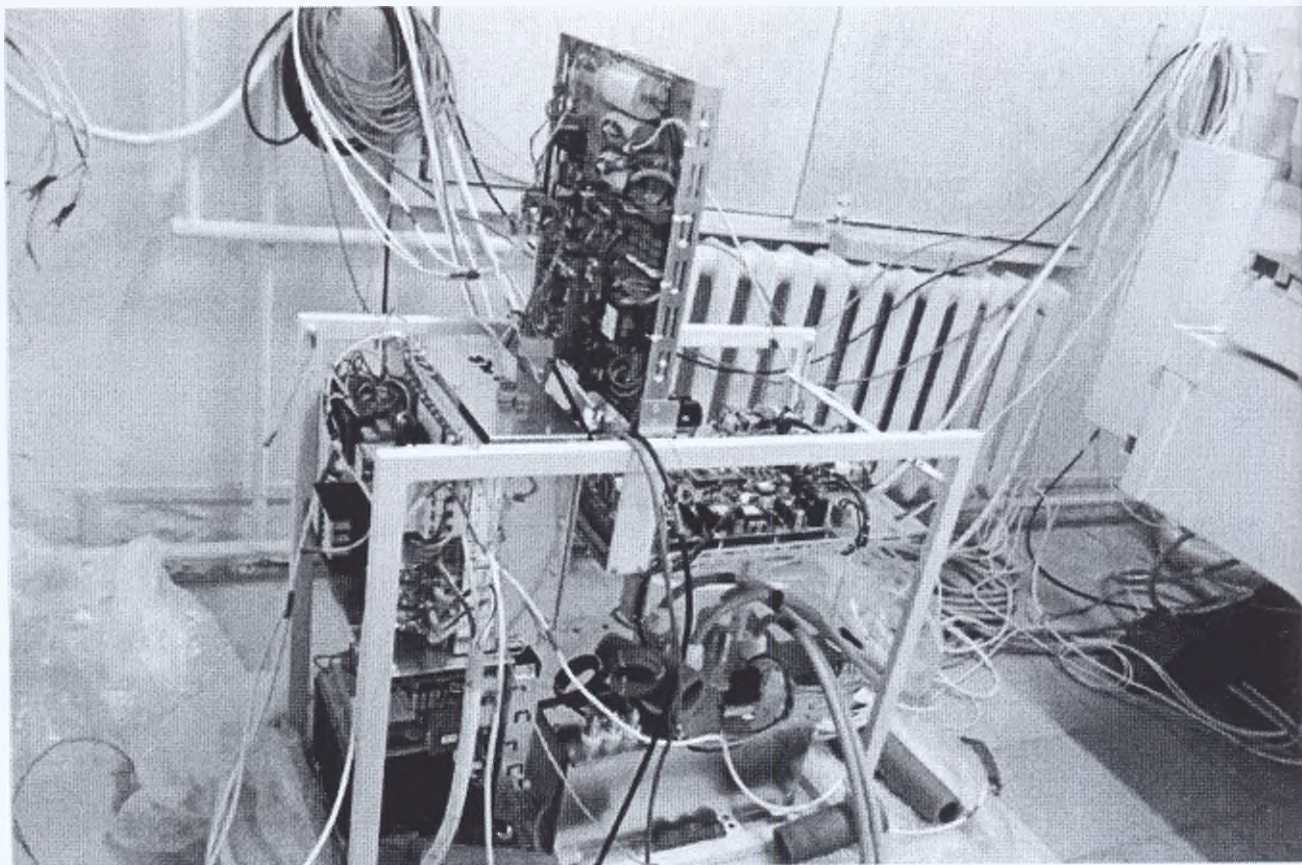




2. Стол рентгеновский поворотный, модель BIO Score, производства BMI S.r.l., Италия

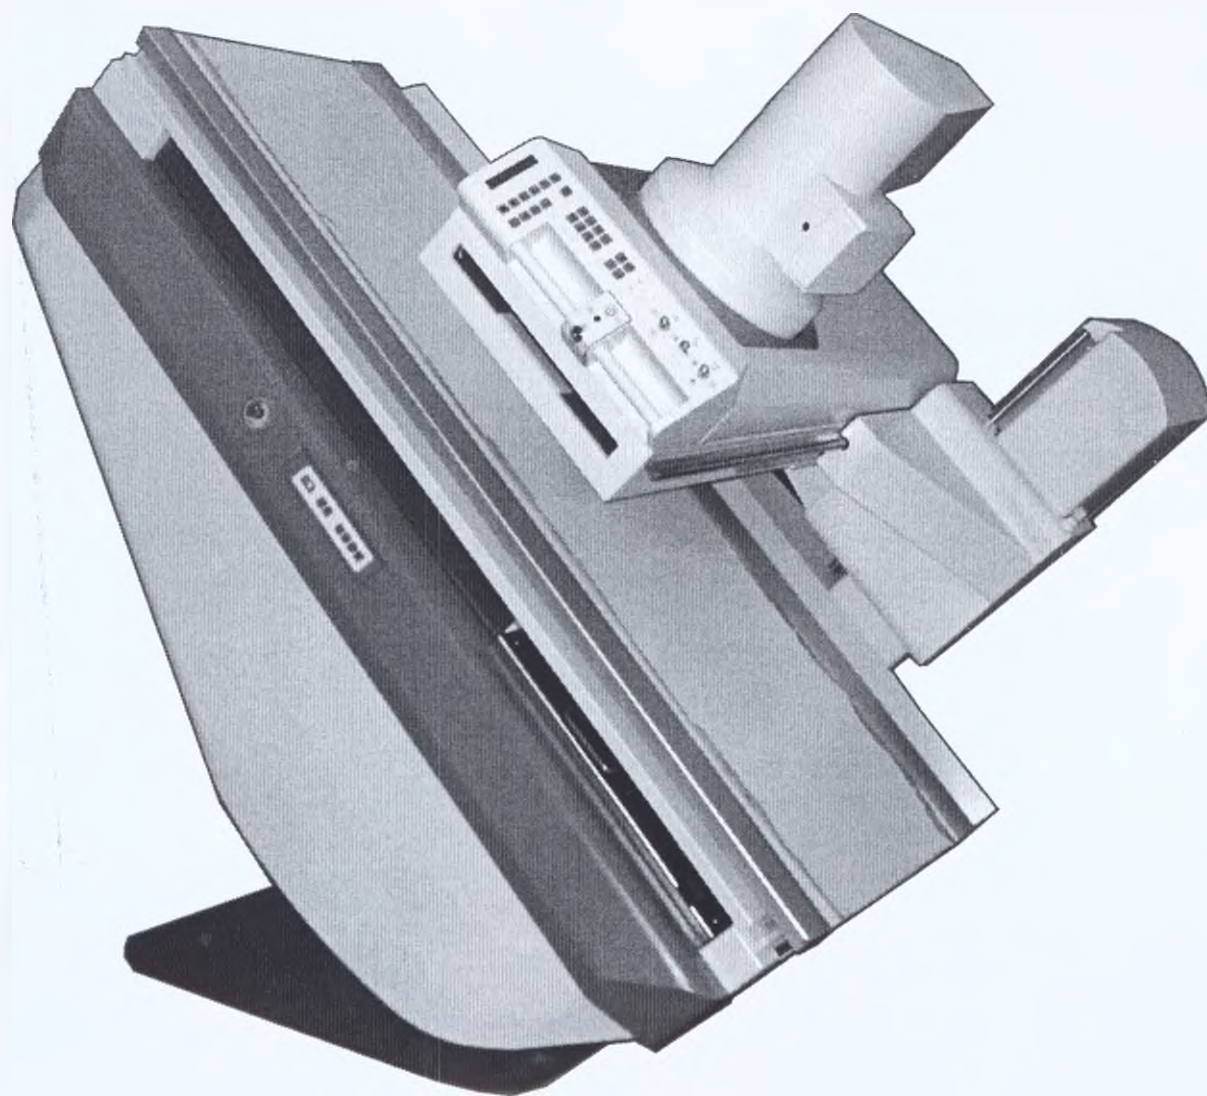


3. Усилитель яркости рентгеновского изображения УРИ/230 «Аметист», производства ООО «Рентген-Комплект», РФ

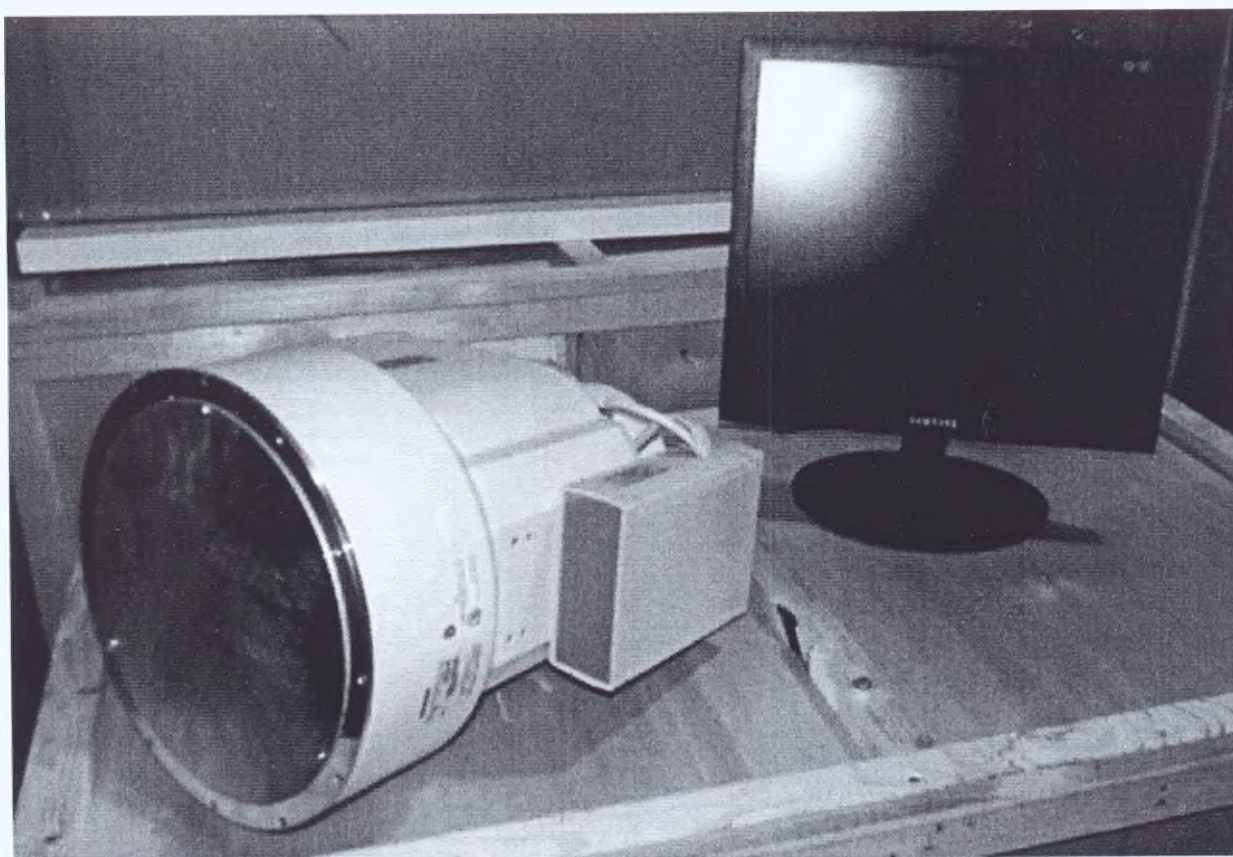




или Усилитель яркости рентгеновского изображения цифровой для формирования и визуализации рентгеновского изображения в режимах рентгеноскопии и импульсной цифровой рентгенографии УРИ/300 «Аметист», производства ООО «Рентген-Комплект», РФ

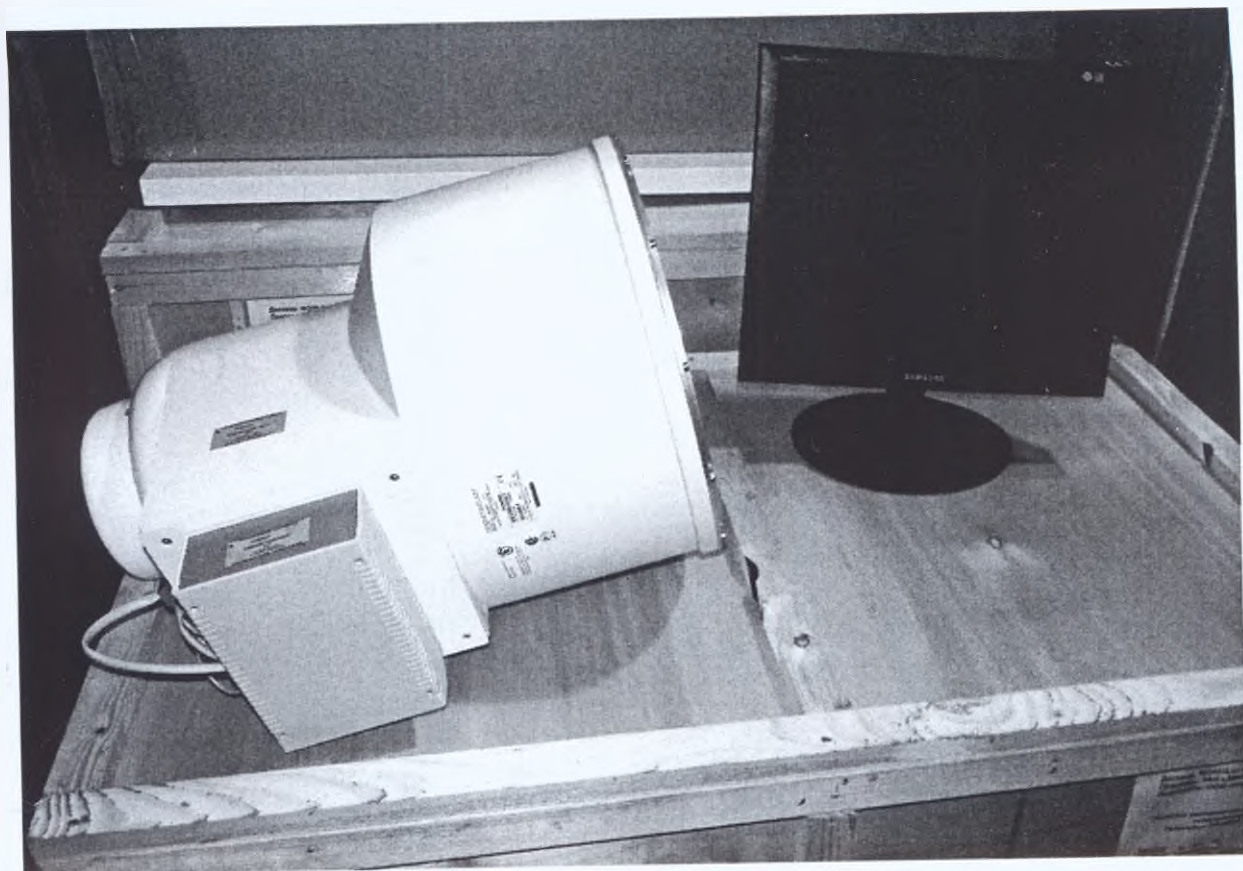


4. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД», производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ 5. К И

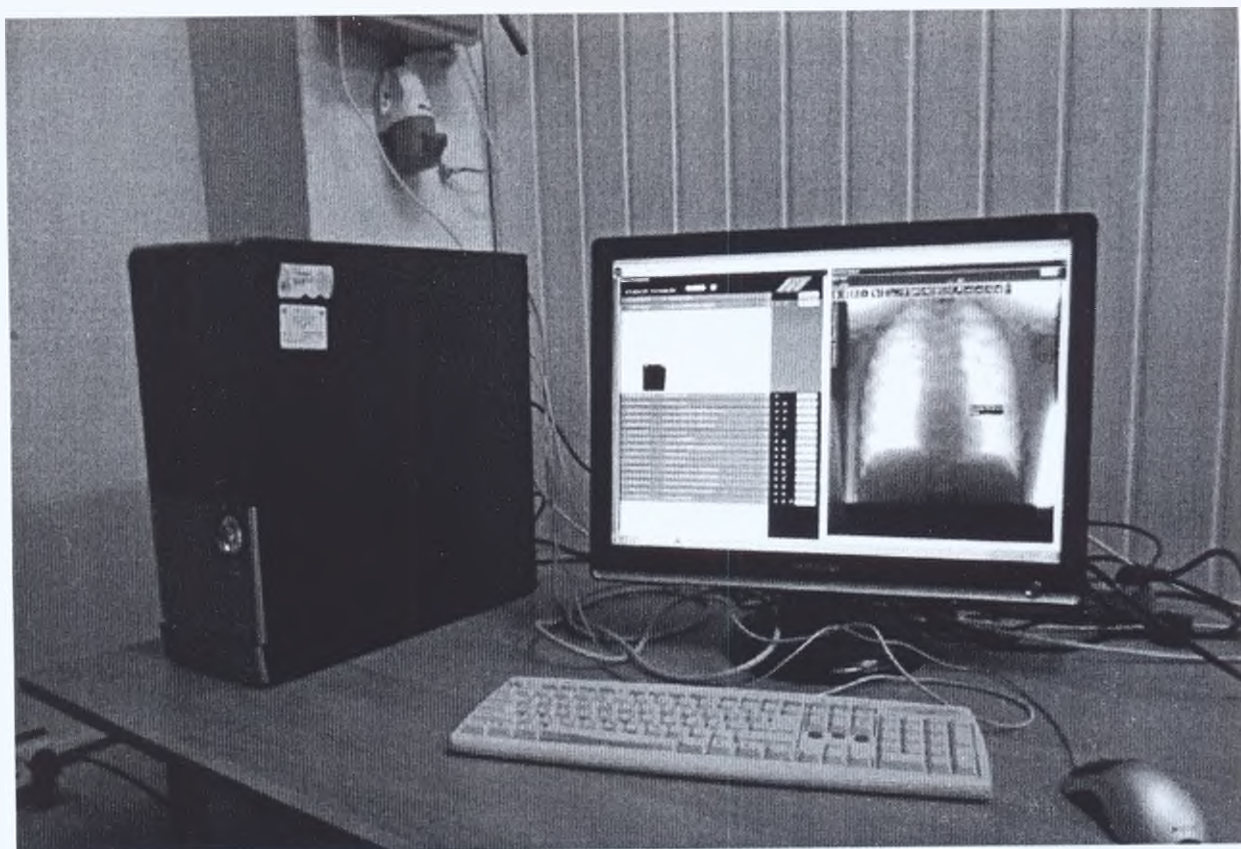



Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ»,  
Исполнение 1, 2, 3, производства НПО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

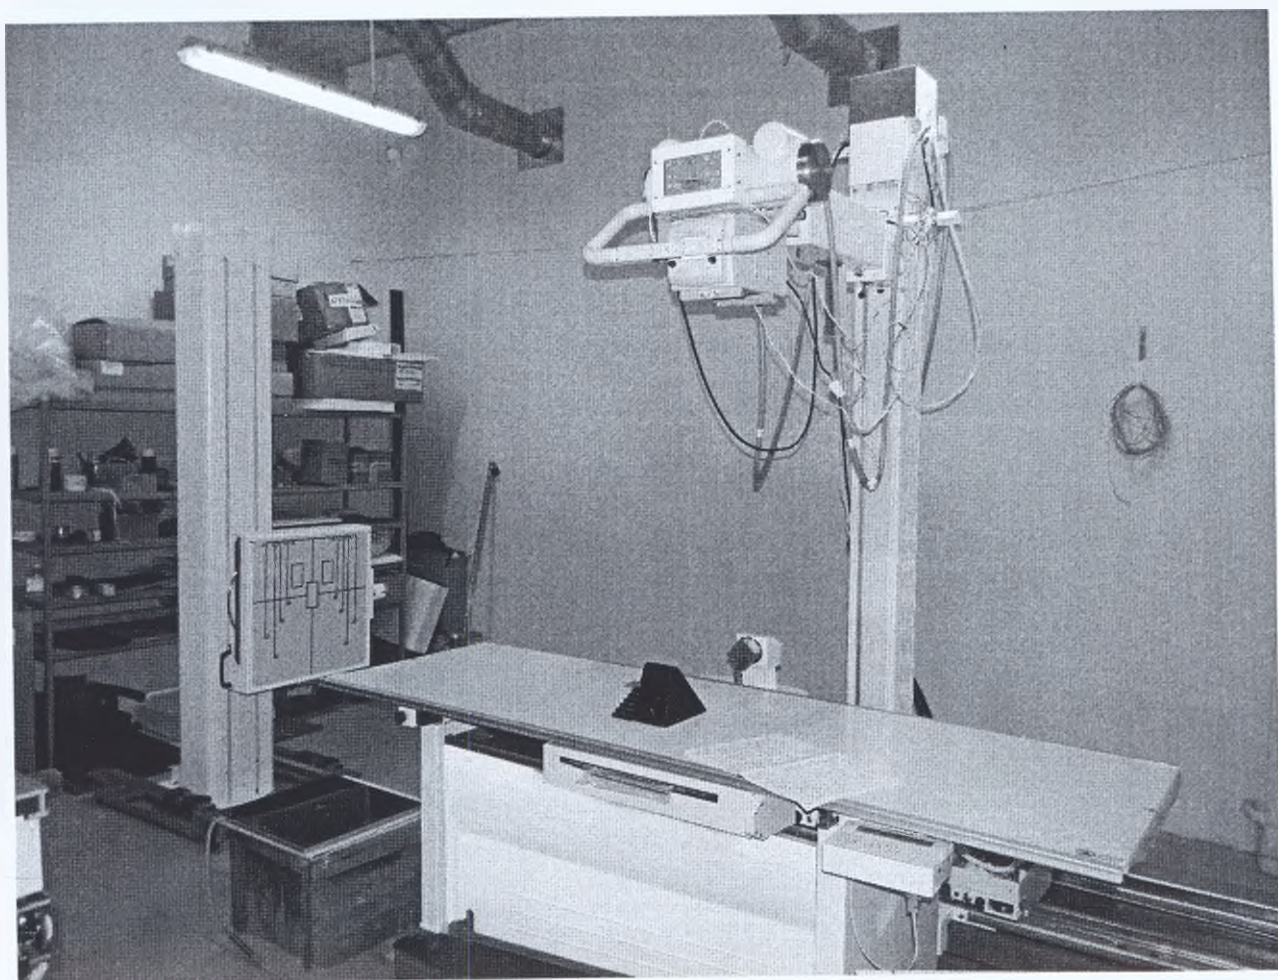



6. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1, производства ООО НПП «Доза»






или Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО НПП «Доза»




7. Излучатель рентгеновский E7242X, производства Toshiba Electron Tubes & Devices Co. Ltd. или Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония

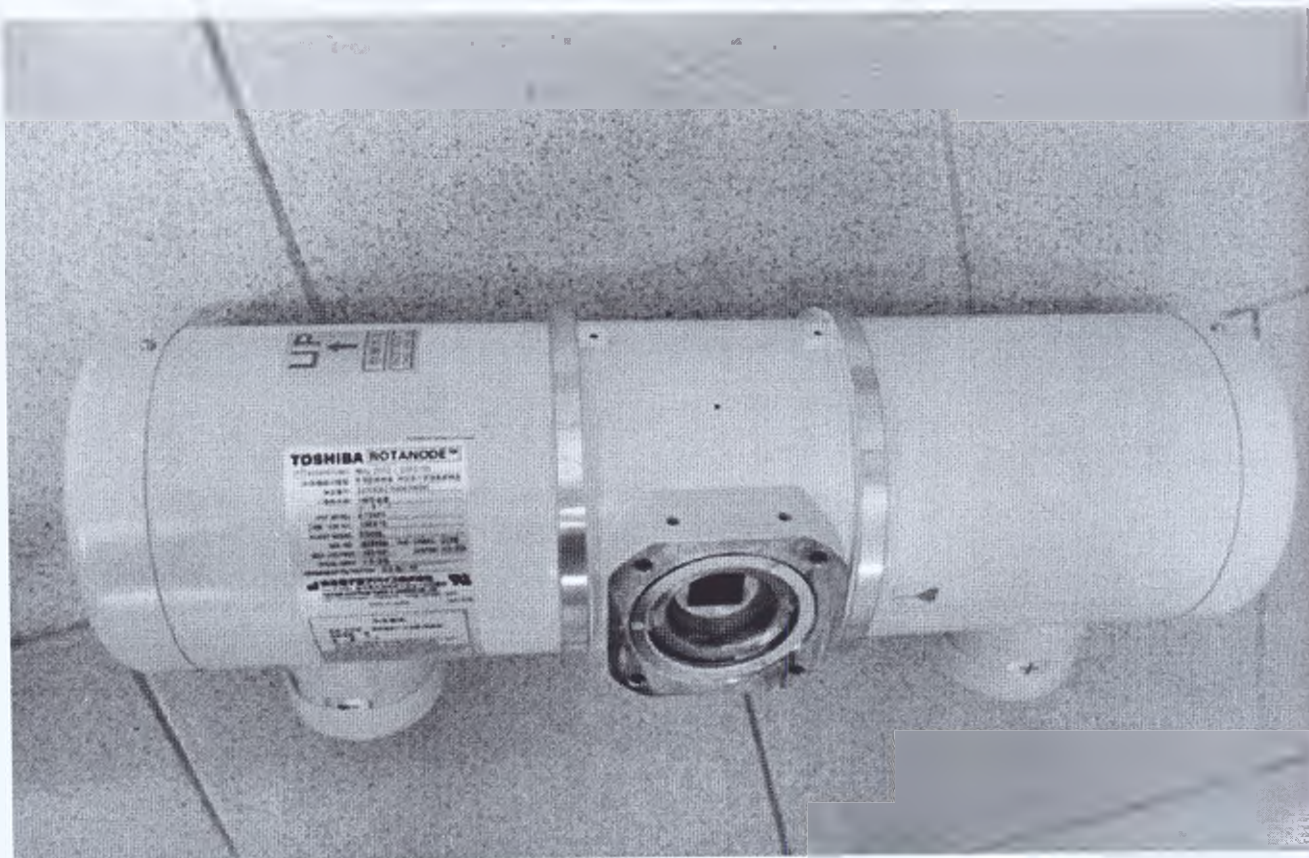



или Излучатель с трубкой рентгеновской RAY-12\_1, RAY-12\_3, RAY-12S\_1, RAY-12S\_3, RAY-14\_1, RAY-14\_3, RAY-14S\_1, RAY-14S\_3, производства Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi, Китай

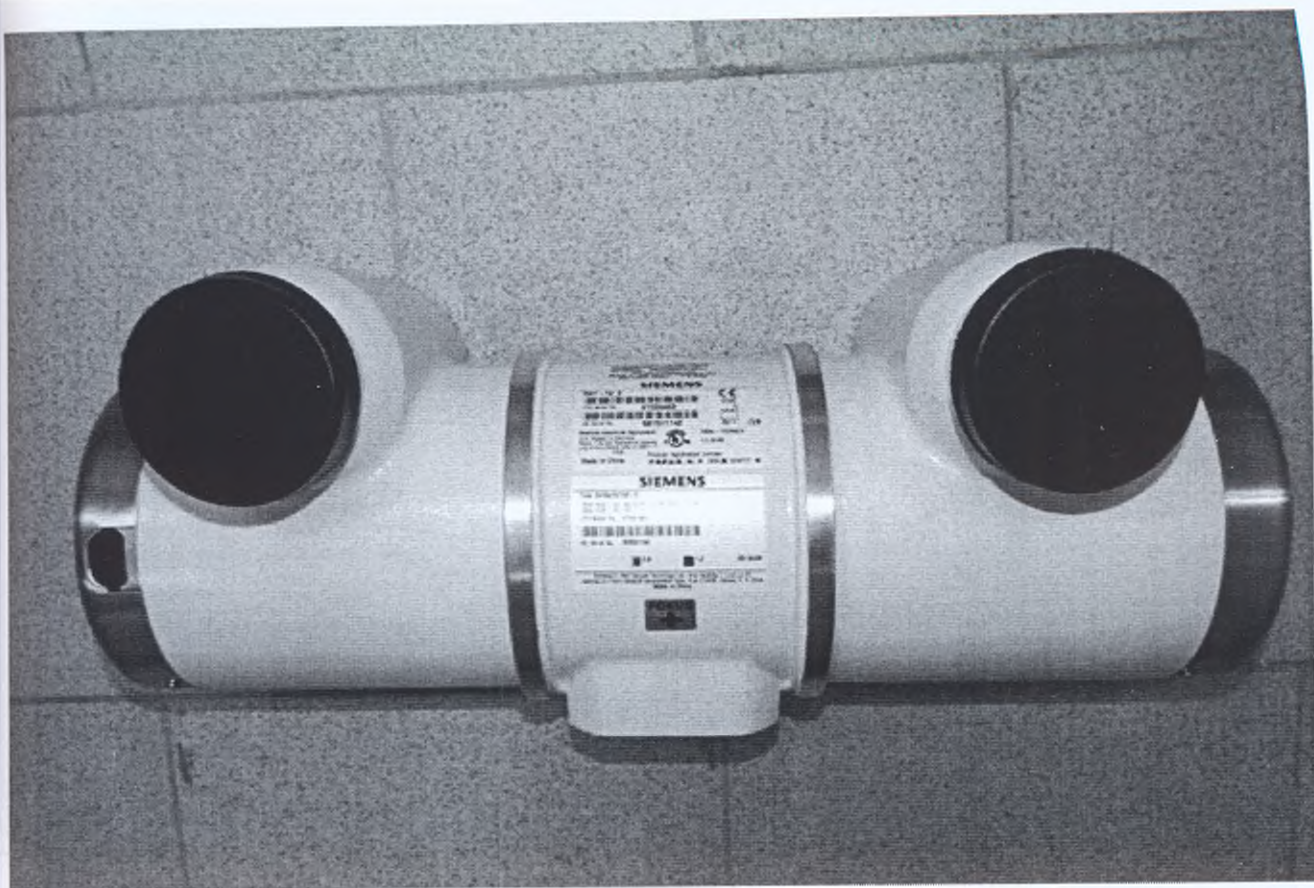

или Излучатель с трубкой рентгеновской Optilix 154/30/50R-101S, производства Siemens Healthcare GmbH, Германия






## 8. Ширма резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К»

Ширмы резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» в следующих исполнениях: фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К», с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К», с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К», с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К», производства ООО «Рентген-Комплект» или Ширмы рентгенозащитные в следующих исполнениях: резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К», резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-«Р-К» в следующих исполнениях: фронтальная ШРЗпб-Ф-«Р-К», с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-«Р-К», с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-«Р-К», с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-«Р-К», производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР».



9. Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-АМИКО», производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

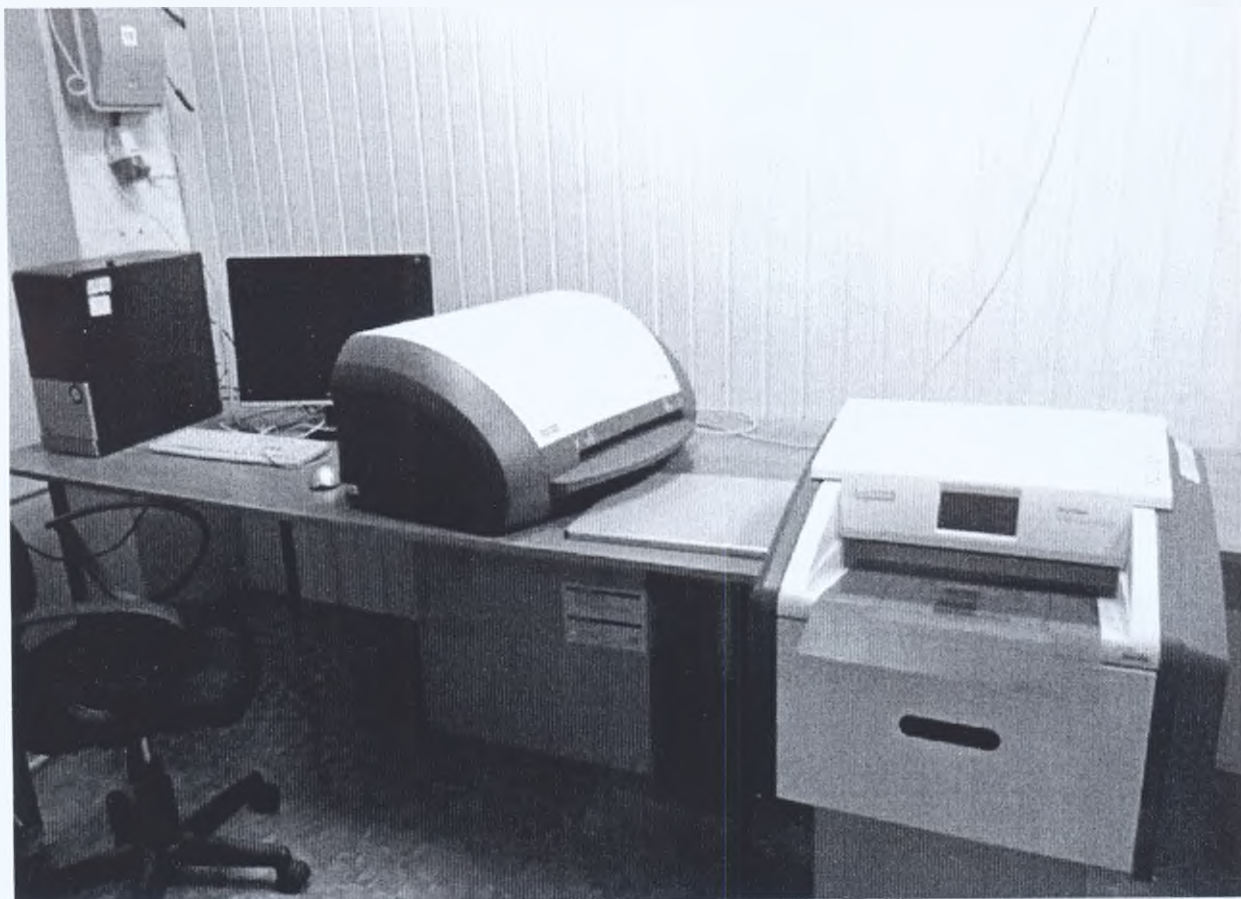



или Комплекс цифровой CR для получения и архивирования медицинских рентгеновских изображений с принадлежностями, исполнения CR 10-X, CR 30-Xm, производства Agfa N.V., Бельгия



или Система компьютерной рентгенографии CR в вариантах исполнения с принадлежностями  
исполнения CR 12-X, 15-X, Agfa N.V., Бельгия



или Аппарат цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений, с принадлежностями CR30-X, производства Agfa — Health Care N.V., Бельгия





или Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских рентгеновских и маммографических изображений с принадлежностями, Цифровой дигитайзер DX-M производства Agfa N.V., Бельгия



или Аппарат цифровой радиологии на основе восстанавливаемых люминофоров FCR Prima T (CR-IR 392) с принадлежностями, производства FUJIFILM Corporation, Япония







или Аппарат цифровой радиографии на основе фотостимулируемых люминофоров, исполнений: FCR Profect One Plus (CR-IR 368), с принадлежностями;  
FCR Profect Cs Plus (CR-IR 363), с принадлежностями, производства FUJIFILM Corporation, Япония



или Система цифровой радиологии Vita с принадлежностями, исполнений: VitaFlex CR System или Vita SE CR System или Vita LE CR System, производства Carestream Health, Inc. США

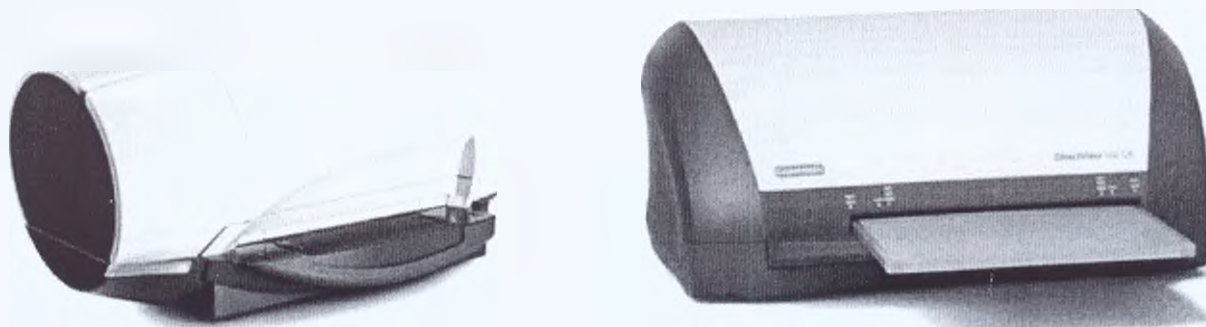

10. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

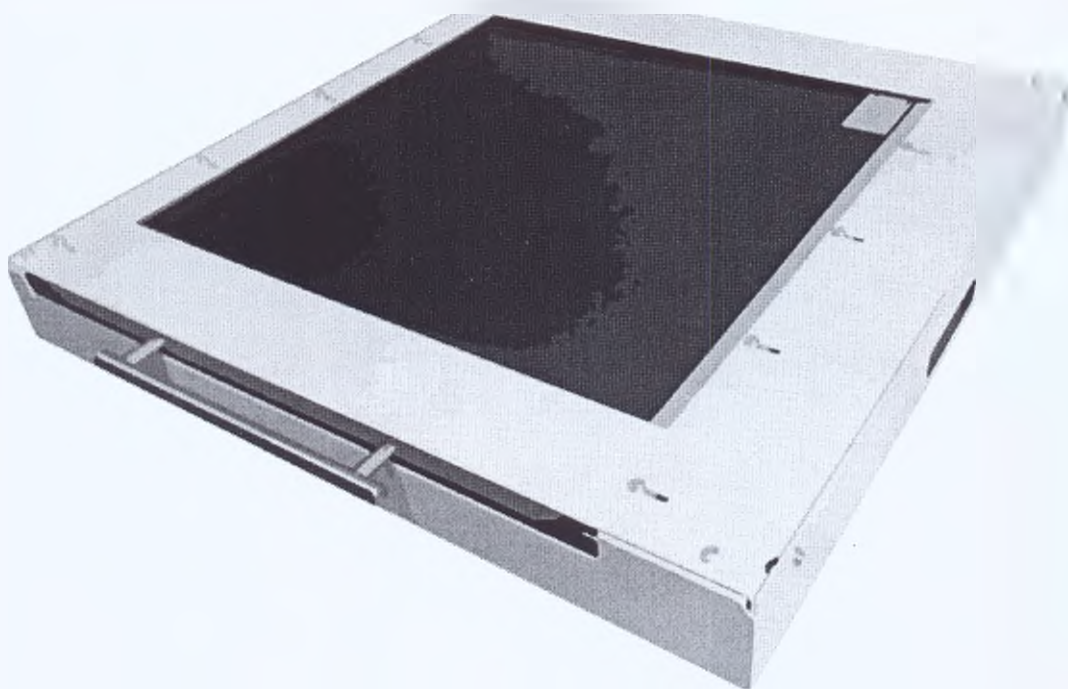




11. Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «ОПТИМАКС-АМИКО», производства НПО «АМИКО»





12. Растр рентгеновский отсеивающий JPI, Тип AAS, ACS, AAC, ACC, производства «JPI Healthcare Co., Ltd.», Республика Корея

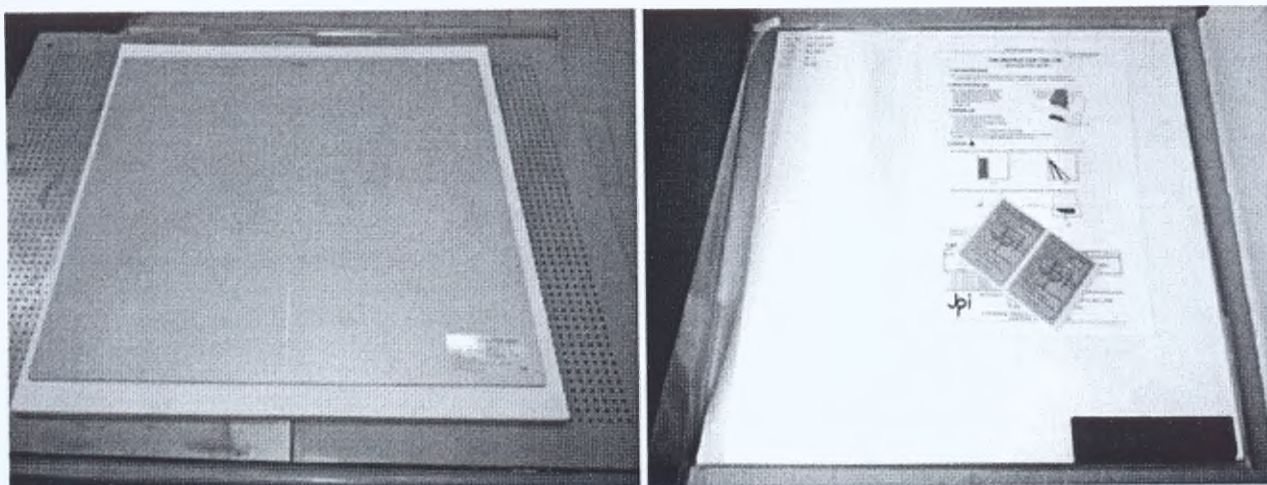


13. Переговорное устройство, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»






- 14 Кассеты медицинские рентгенографические, форматы 13х18, 18х24, 24х30, 30х40, 35х35, 35х43, производства PROTEC GmbH & Co.KG, Германия или Кассеты рентгеновские с экранами рентгеновскими в сборе, производства Carestream Health Inc., США или Кассеты пластиковые рентгенографические «РЕНЕКС-КРП» с усиливающими экранами, форматы 13х18, 15х30, 18х24, 18х43, 20х40, 24х30, 30х40, 35х35, 35х43 см, производства ЗАО «РЕНЕКС»

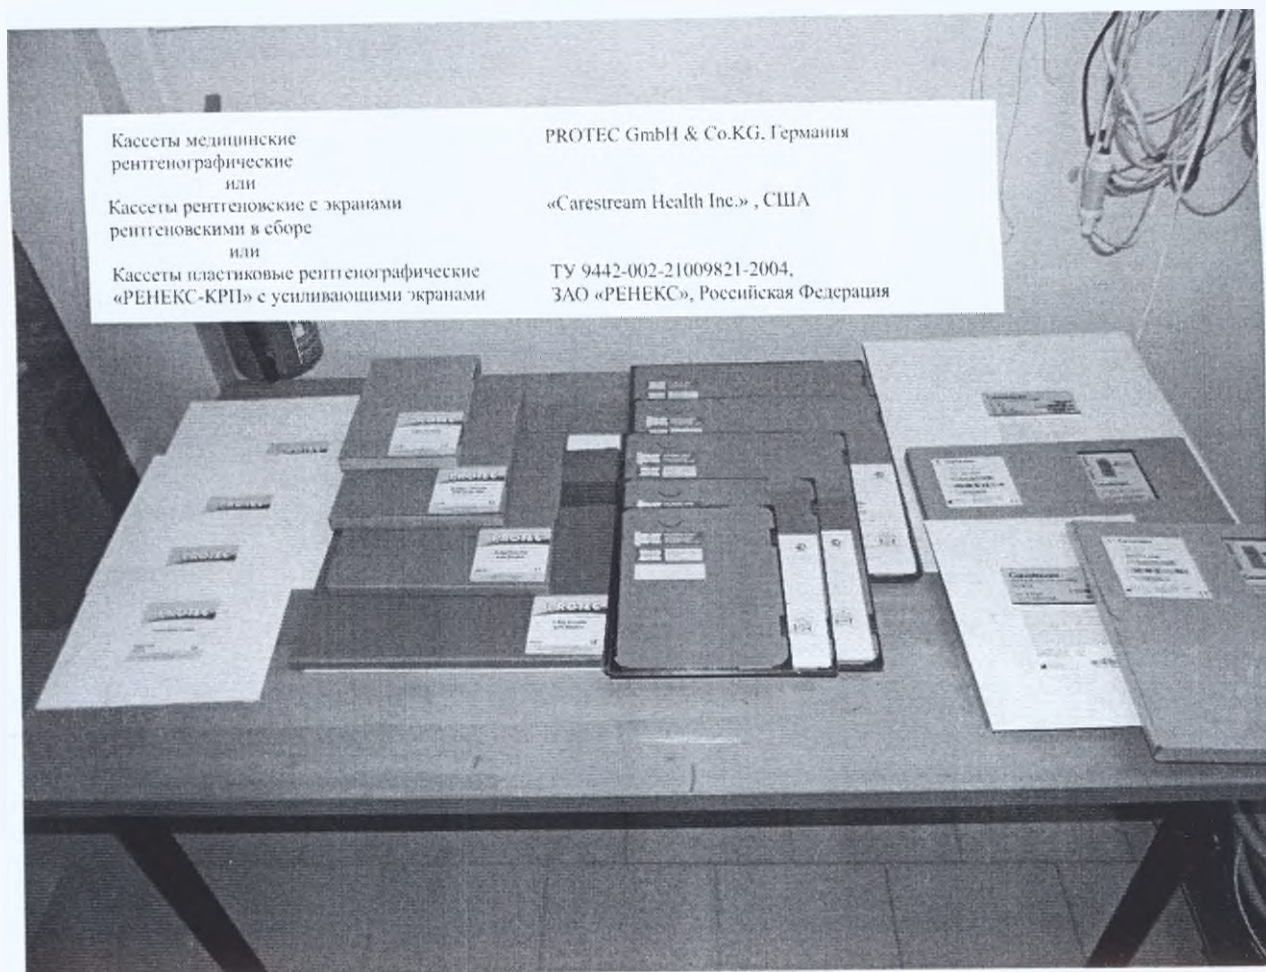


15. Экраны усиливающие для рентгеновских аппаратов, форматы 13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 35x35, 35x43см, производства PROTEC GmbH & Co.KG, Германия

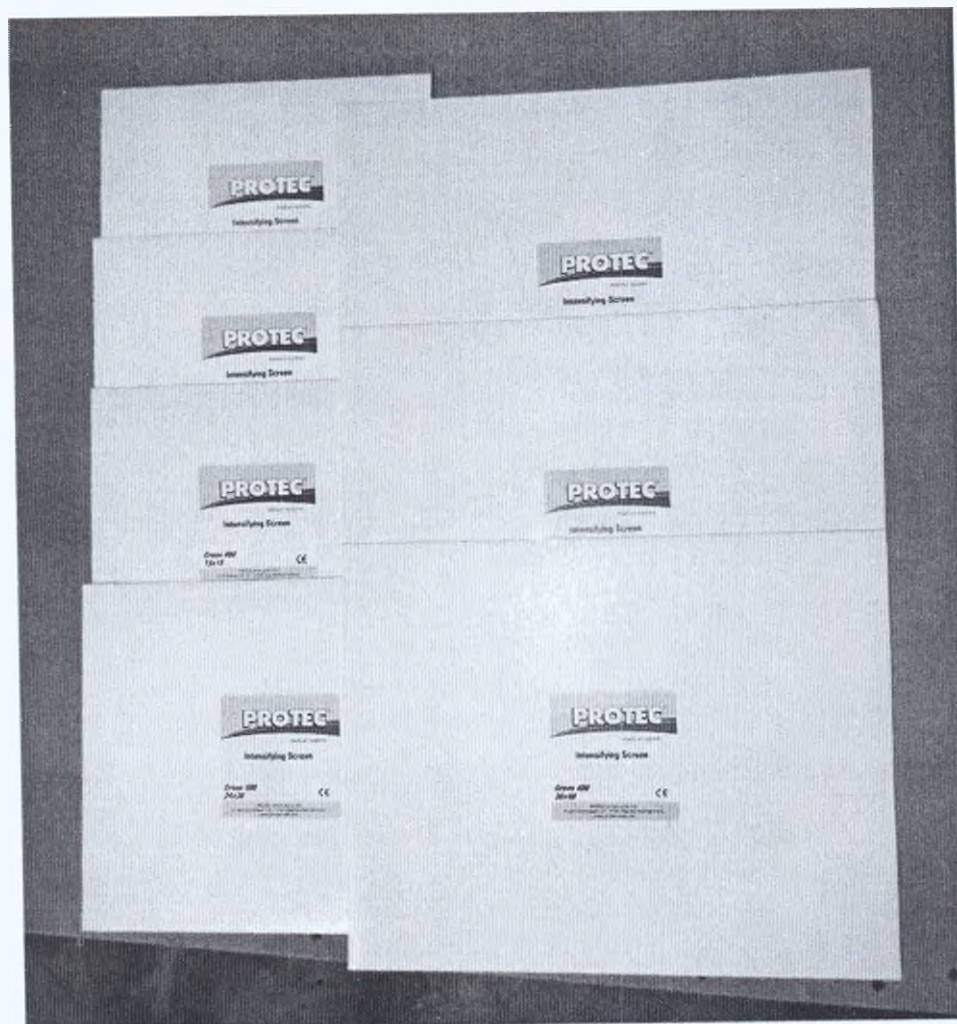




16. Система дистанционного видеонаблюдения, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»

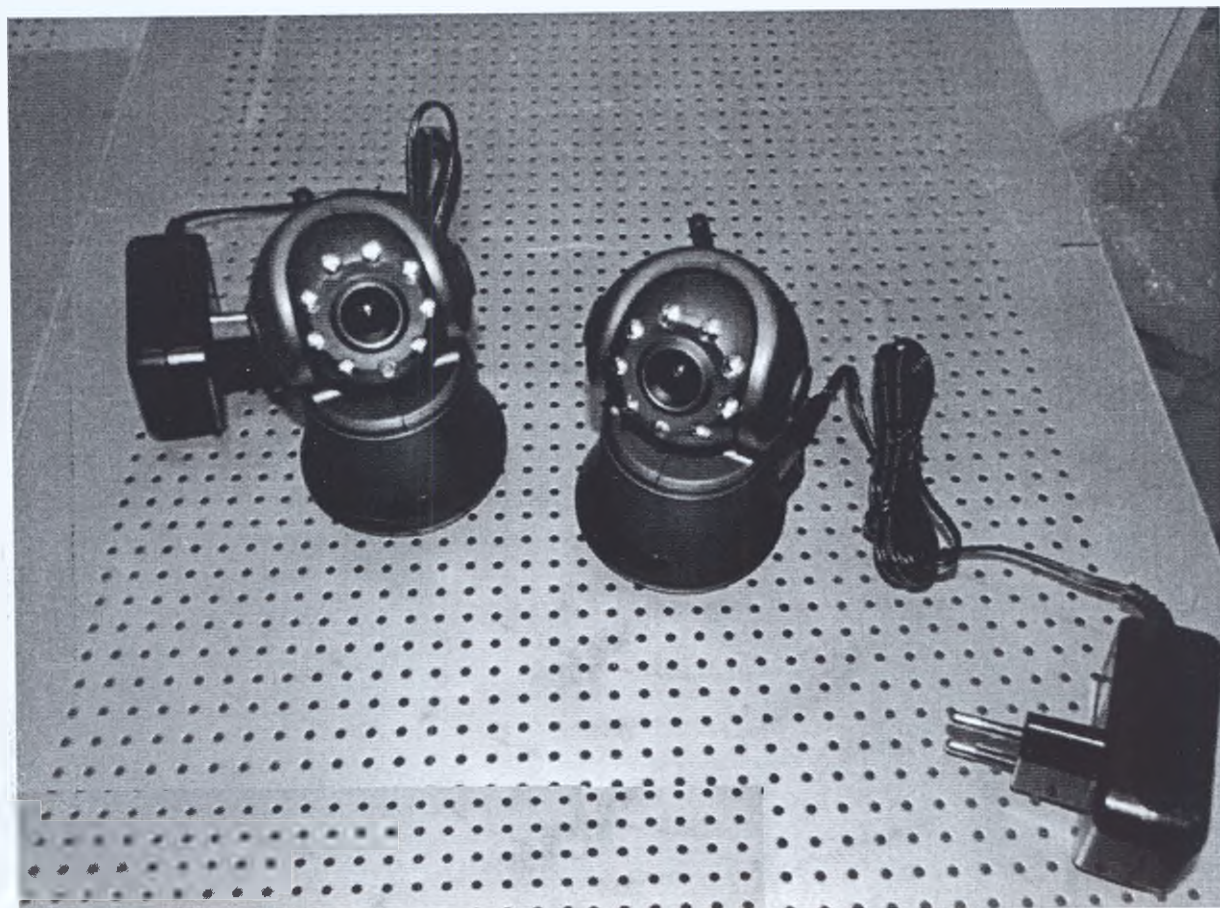

17. Комплект фотолaborаторный, производства НПО «АМИКО» или ЗАО «АЗРГ»

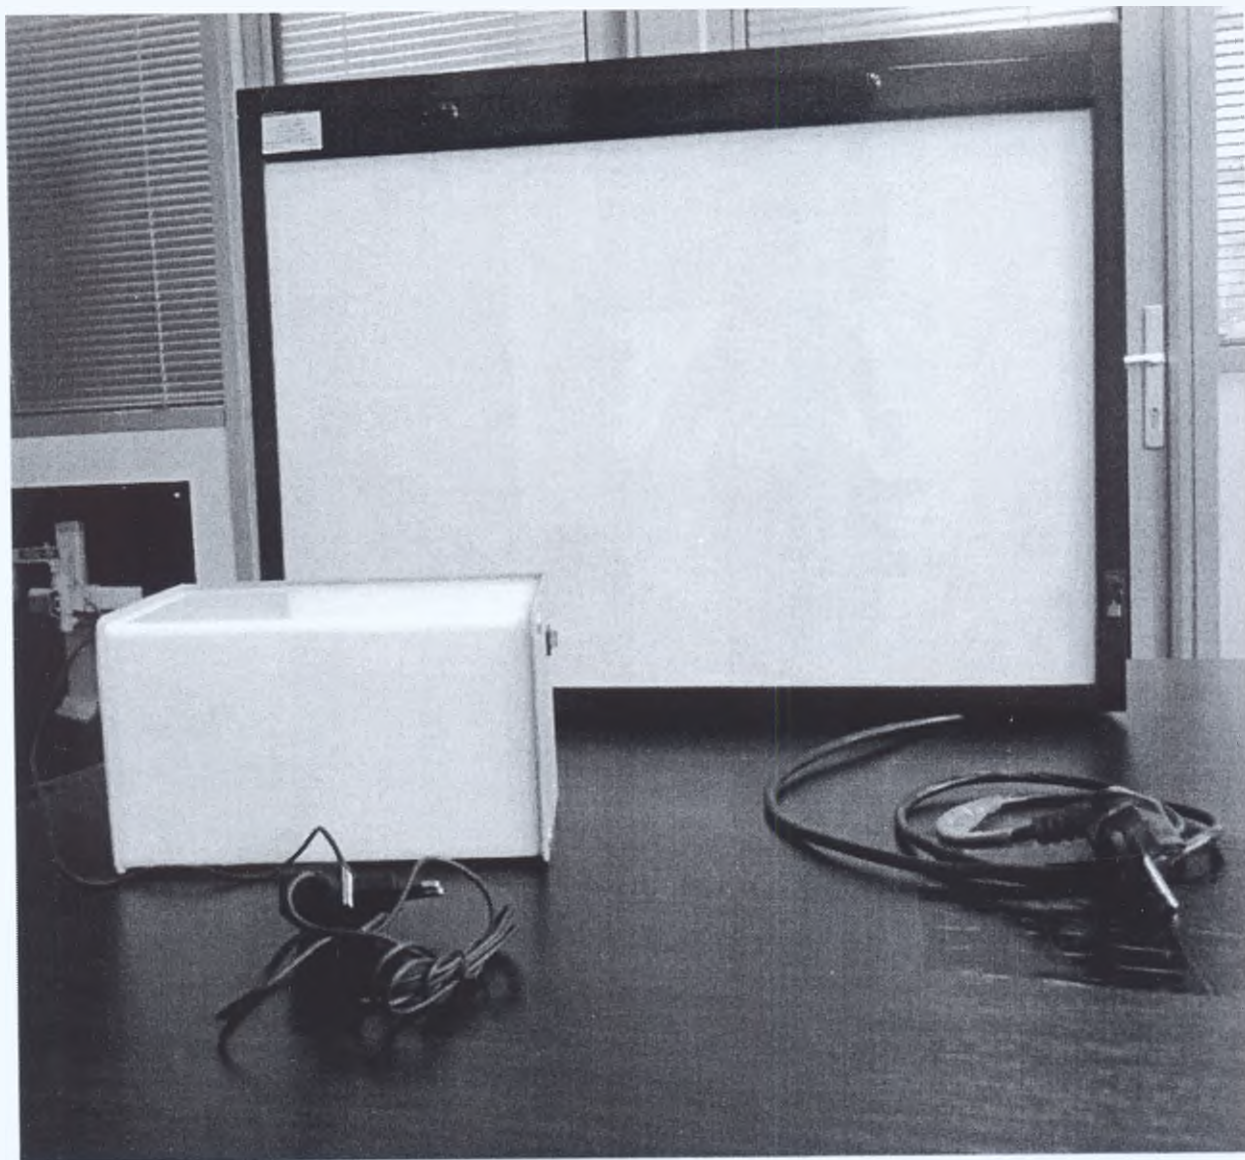




18. Каталка рентгенографическая, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»



19. Устройство фиксации детей для рентгенографии, производства ЗАО «АЗРТ»

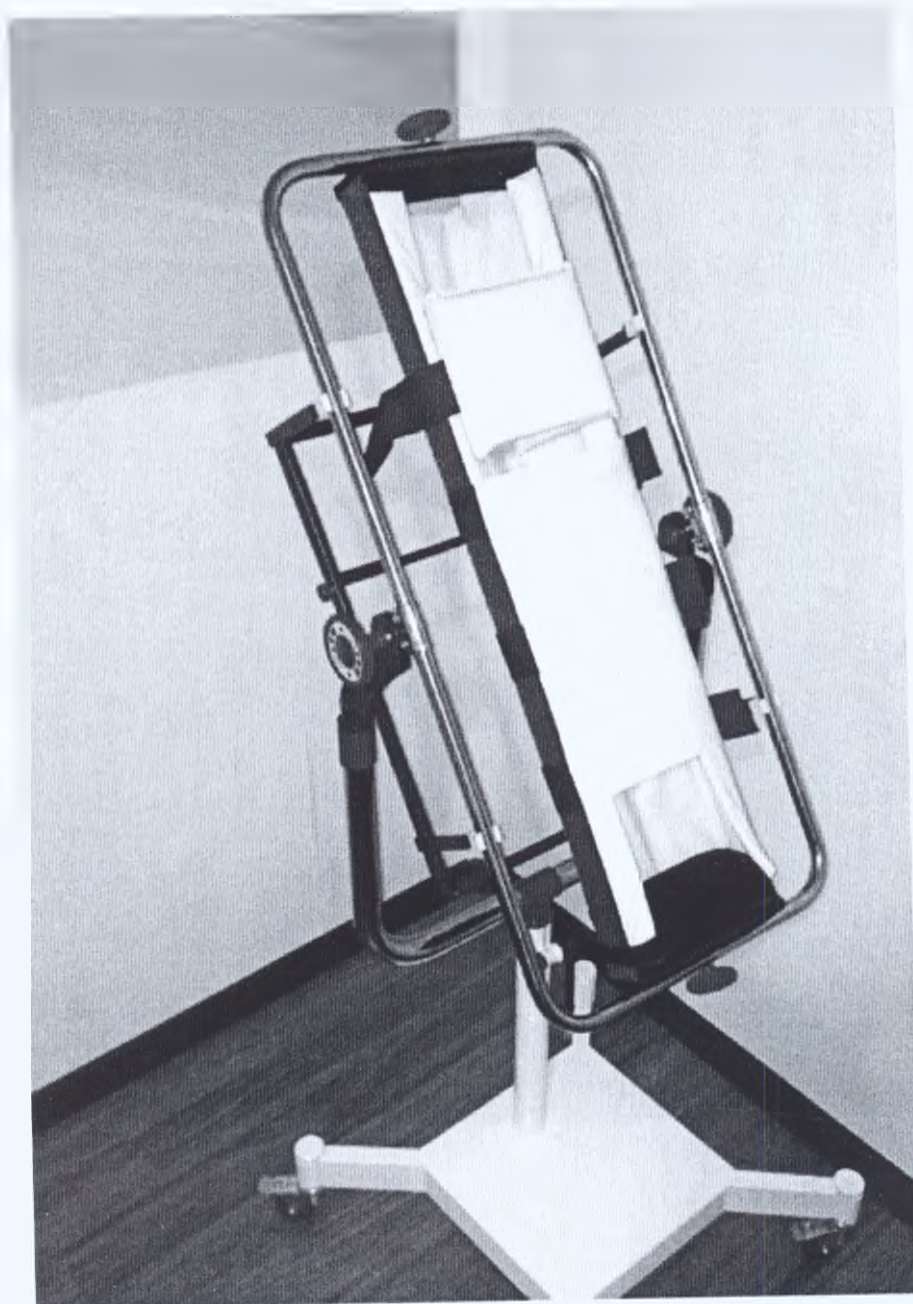




20. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты КИРЗИ – «Р-К», воротник защитный ВРЗ-«Р-К», пелерина защитная ПЛРЗ-«Р-К», юбка защитная легкая ЮРЗл-«Р-К», юбка защитная тяжелая ЮРЗт-«Р-К»; передник для защиты гонад легкий ПРЗГл-«Р-К»; передник для защиты гонад тяжелый ПРЗГт-«Р-К»; комплект защитных пластин из четырех элементов КПРЗ4-«Р-К»; комплект защитных пластин из семи элементов КПРЗ7-«Р-К»; перчатки защитные ПРЗ-«Р-К»; очки защитные (без диоптрий) ОРЗ-«Р-К»; фартук защитный односторонний легкий ФРЗОл-«Р-К»; фартук защитный односторонний тяжелый ФРЗОт-«Р-К»; фартук защитный двусторонний ФРЗД-«Р-К»; шапочка защитная ШПРЗ-«Р-К», производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», ООО «Рентген-Комплект»

или Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС»: фартук односторонний, фартук двухсторонний, халат, жилет, фартук стоматологический, юбка, передник (полуфартук), накидка (пелерина), воротник (защита щитовидной железы), шапочка, фартук детский, юбка детская, воротник детский, накидка (пелерина) детская, передник (полуфартук) детский, набор рентгенозащитных пластин (4 предмета), пластина рентгенозащитная, производства ЗАО «РЕНЕКС»




21. Окна защитные смотровые ОЗС, ОЗС-1 и ОЗС-2, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР» или Окна рентгенозащитные РЕНЕКС ОСЗР, производства ЗАО «РЕНЕКС»

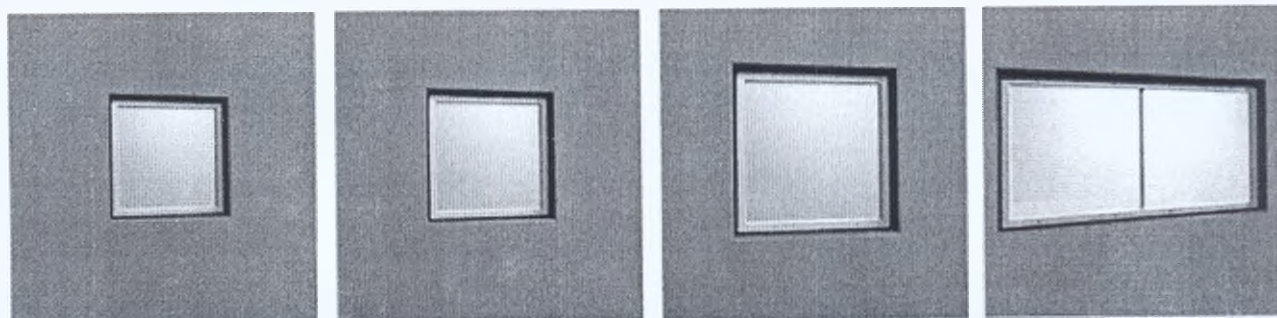

22. Комплект сменных устройств, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ»:

- Пояс компрессионный,
- Рамка – кассетодержатель,
- Полка для латерографии.

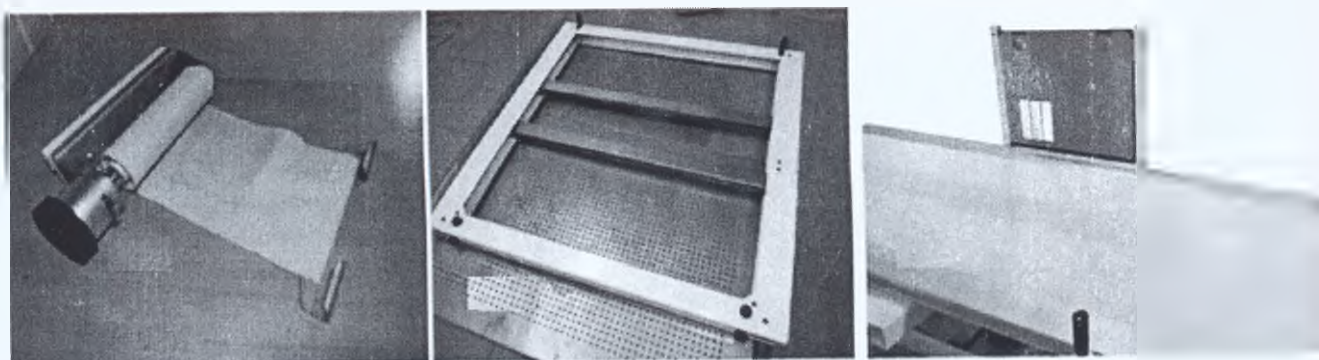

23. Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER», модель PS90W-30 (PS30000W – 3шт.), PS100SQ, производства ООО «Псковский завод электронной техники», или

Стабилизатор напряжения серии «Сатурн», модель СНЭ-Т-90, СНЭ-Т-100, производства НПАО «ПФ«Созвездие»

или

Стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль, модель R81000-3, R100K-3, R100K-3P, производства ООО «Тэнси-Техно»





ОО  
АО

V-30  
ки»,

ства

00K-

72 (70) (74) ЛИСТОВ

\_\_\_\_\_ / Никитин С.В. /





УТВЕРЖДАЮ

Директор ИΠΑΟ «АМИКО»

\_\_\_\_\_ И.И. Блинов

« 24 » \_\_\_\_\_



## МАРКИРОВОЧНЫЕ ТАБЛИЧКИ

Комплекс рентгеновский диагностический стационарный  
«МЕДИКС-Р-АМИКО»




В составе:

1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРПвч-«АЗРТ», производства ЗАО «АЗРТ», РФ





2. Стол рентгеновский поворотный, модель BIO Scope, производства BMI S.r.l., Италия

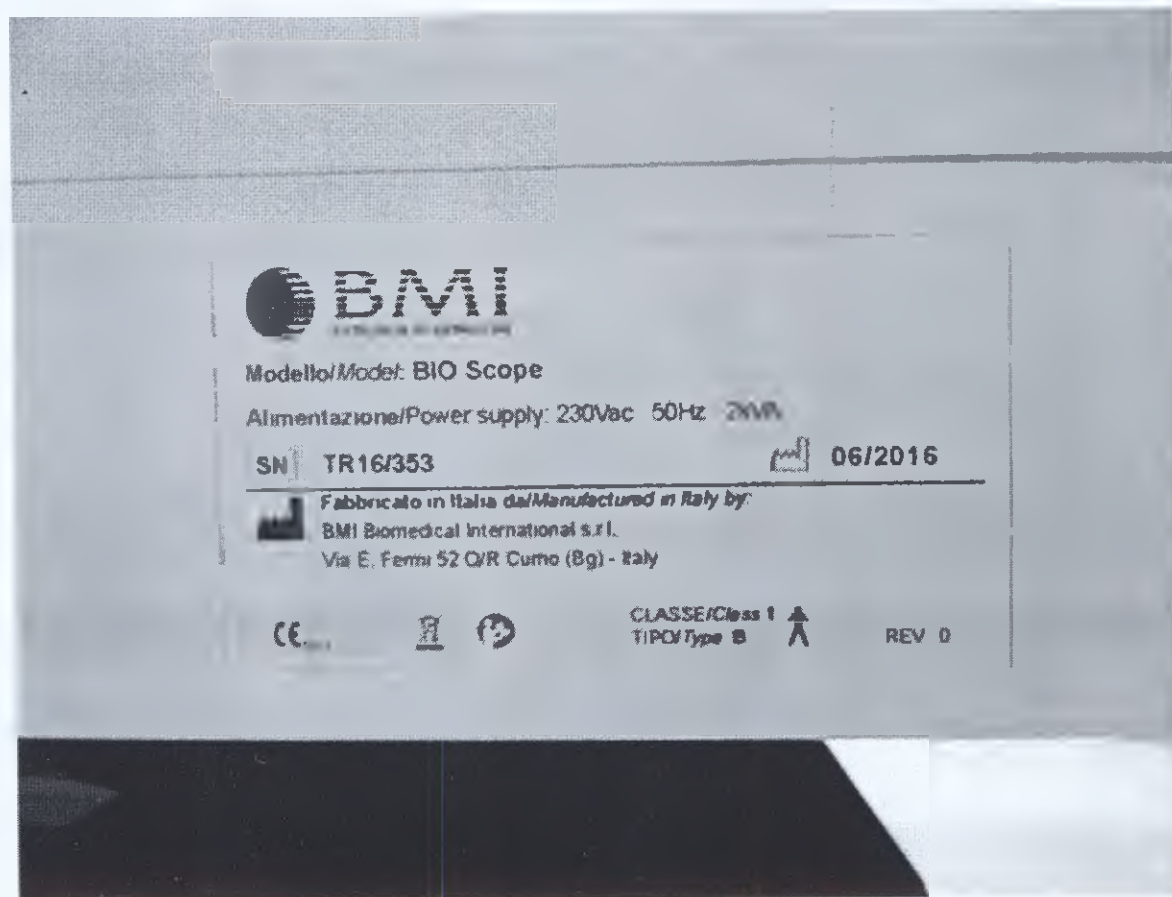


ва ЗАС

3. Усилитель яркости рентгеновского изображения цифровой для формирования и визуализации рентгеновского изображения в режимах рентгеноскопии и импульсной цифровой рентгенографии УРИ/300 «Аметист», производства ООО «Рентген-Комплект», РФ



4. Устройство для цифровой обработки, визуализации и архивирования медицинских изображений УЦОИ-«АККОРД», производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ

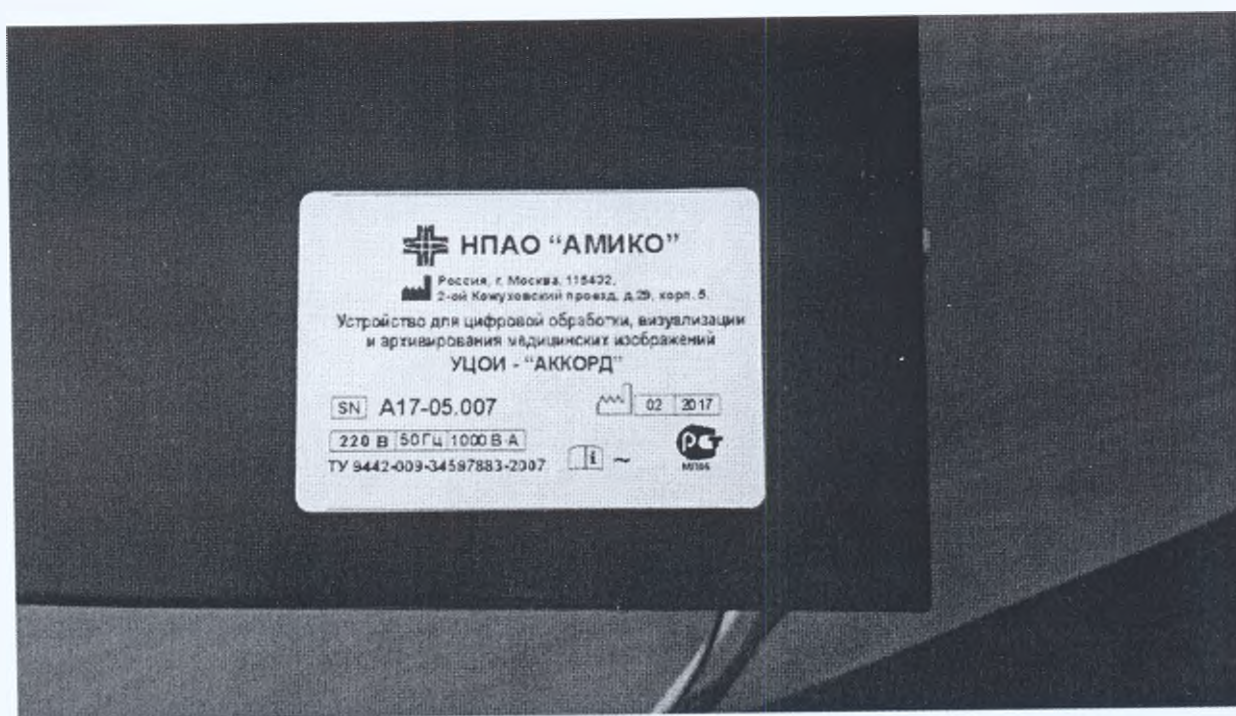




изации  
фровой

5. Комплект штативных устройств для рентгенографии и томографии «АМИГРАФ», производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ




динский  
Ф

6. Дозиметр рентгеновского излучения клинический, исполнение ДРК-1, производства ООО «НПП «ДОЗА», РФ

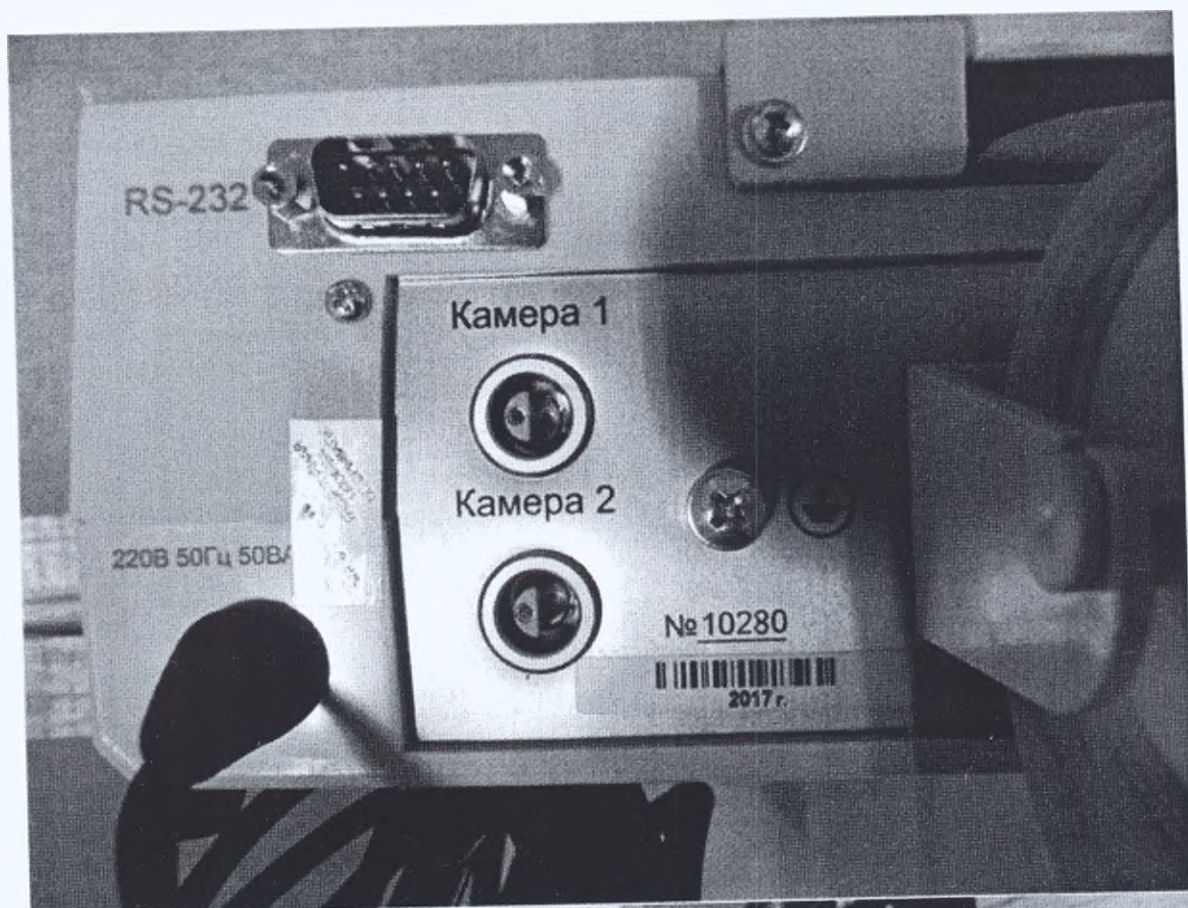




000 7. Излучатель рентгеновский, E7242X, производства Toshiba Electron Tubes & Devices Co., Ltd.

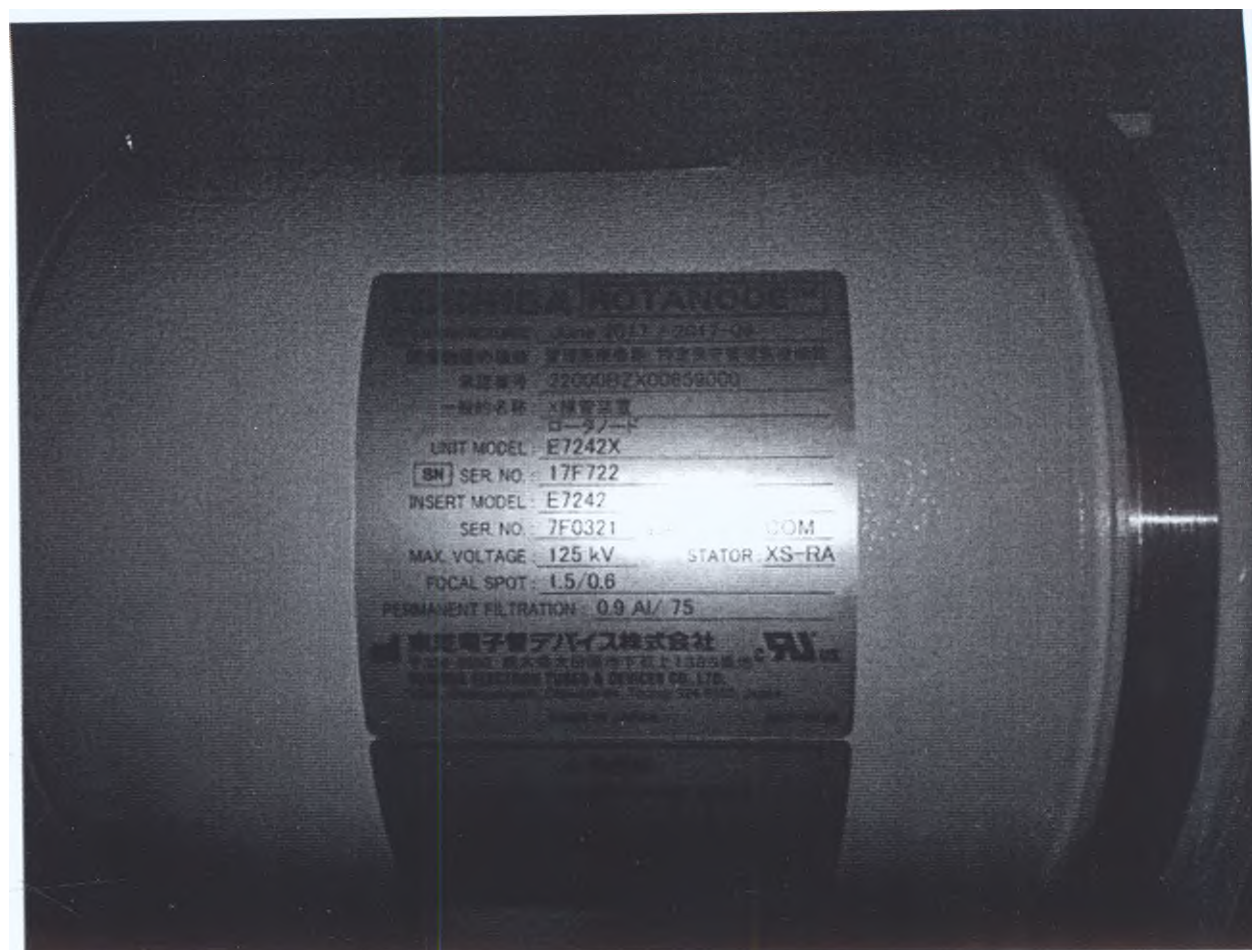

и Излучатель с трубкой рентгеновской, RAY-12S\_1, производства Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi, Китай

8.  
про

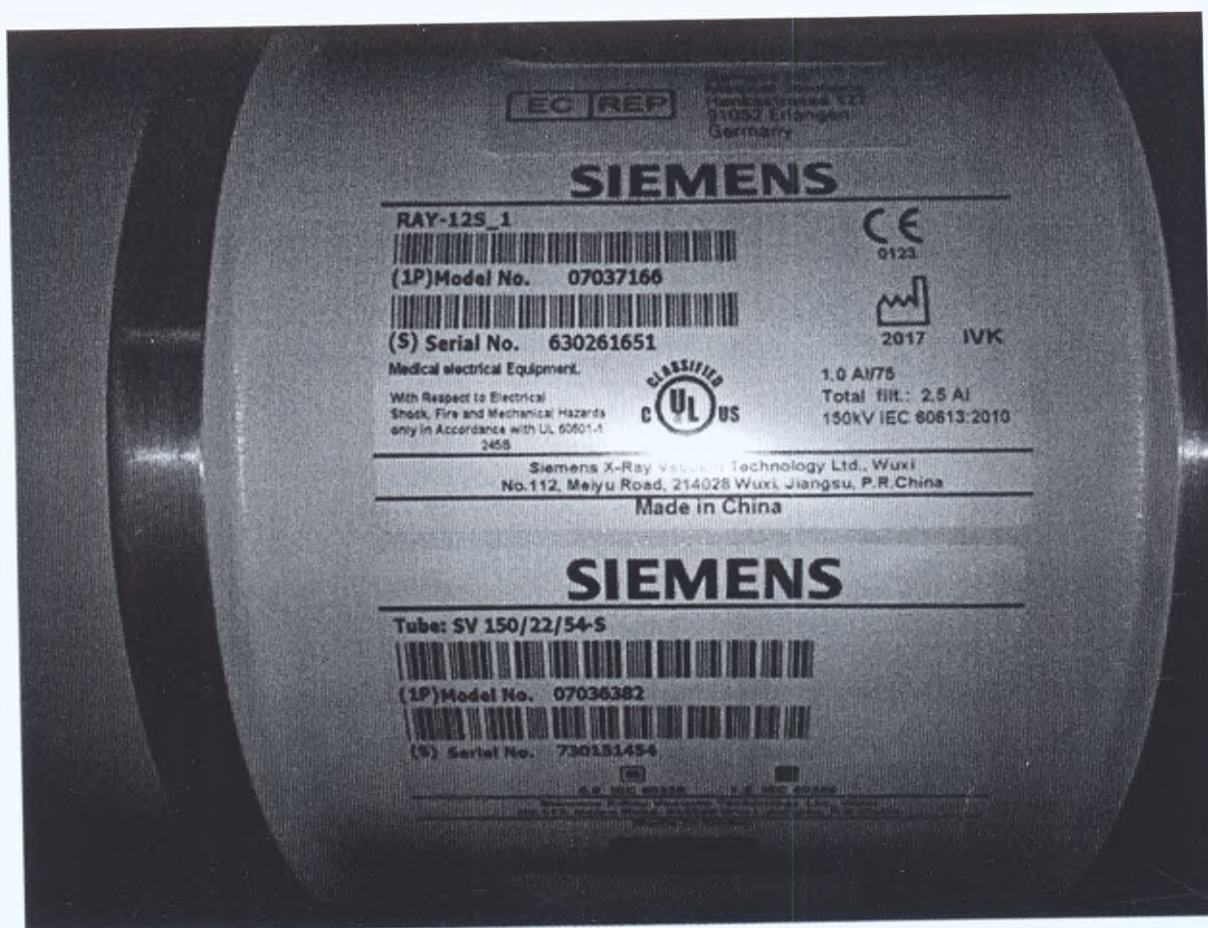




8. Ширма рентгенозащитная резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-«Р-К» производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», РФ.




9. Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптический АМИКО», производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ

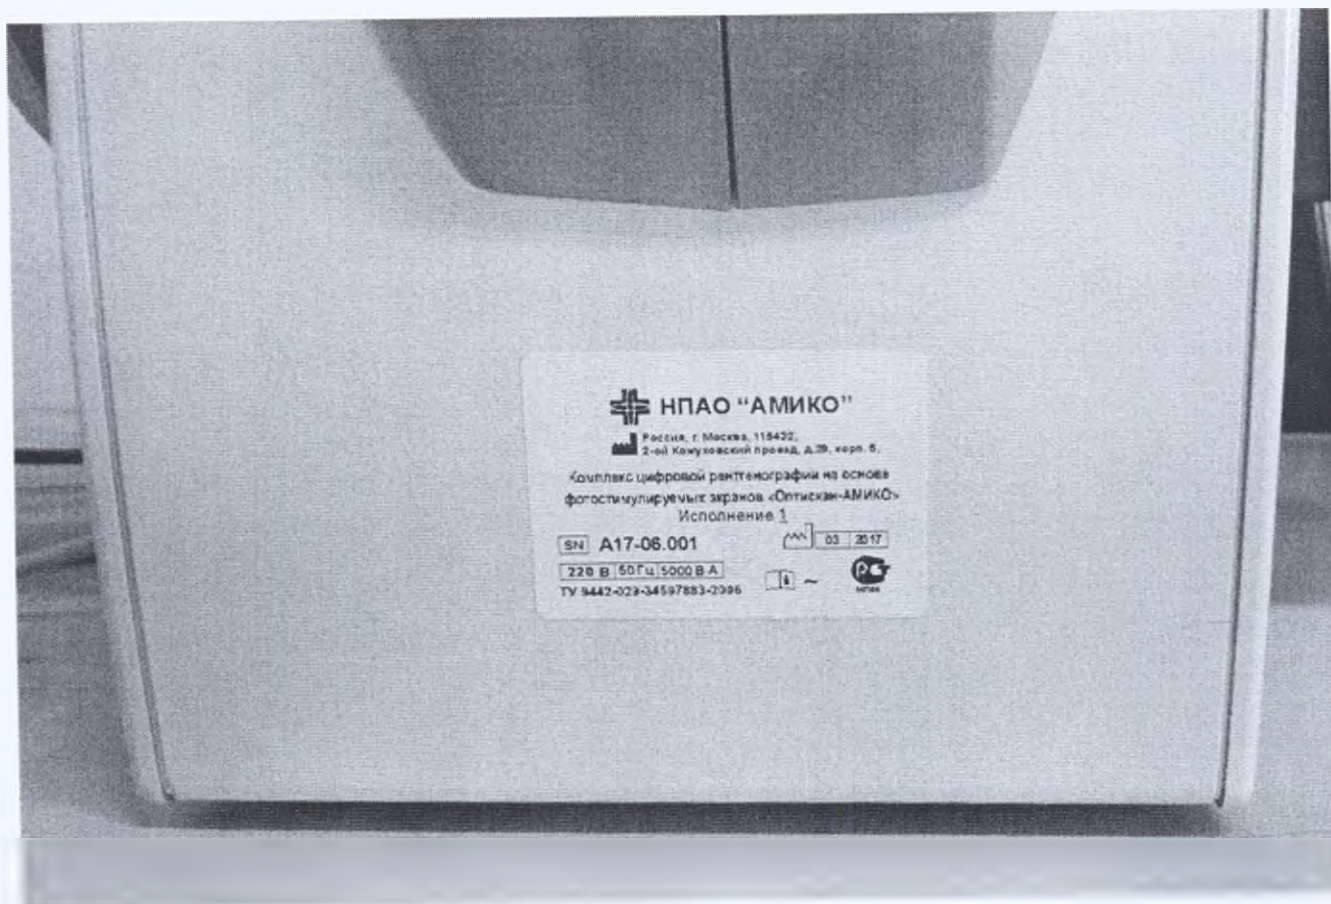



10. Устройство для цифрового преобразования рентгеновского излучения, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ

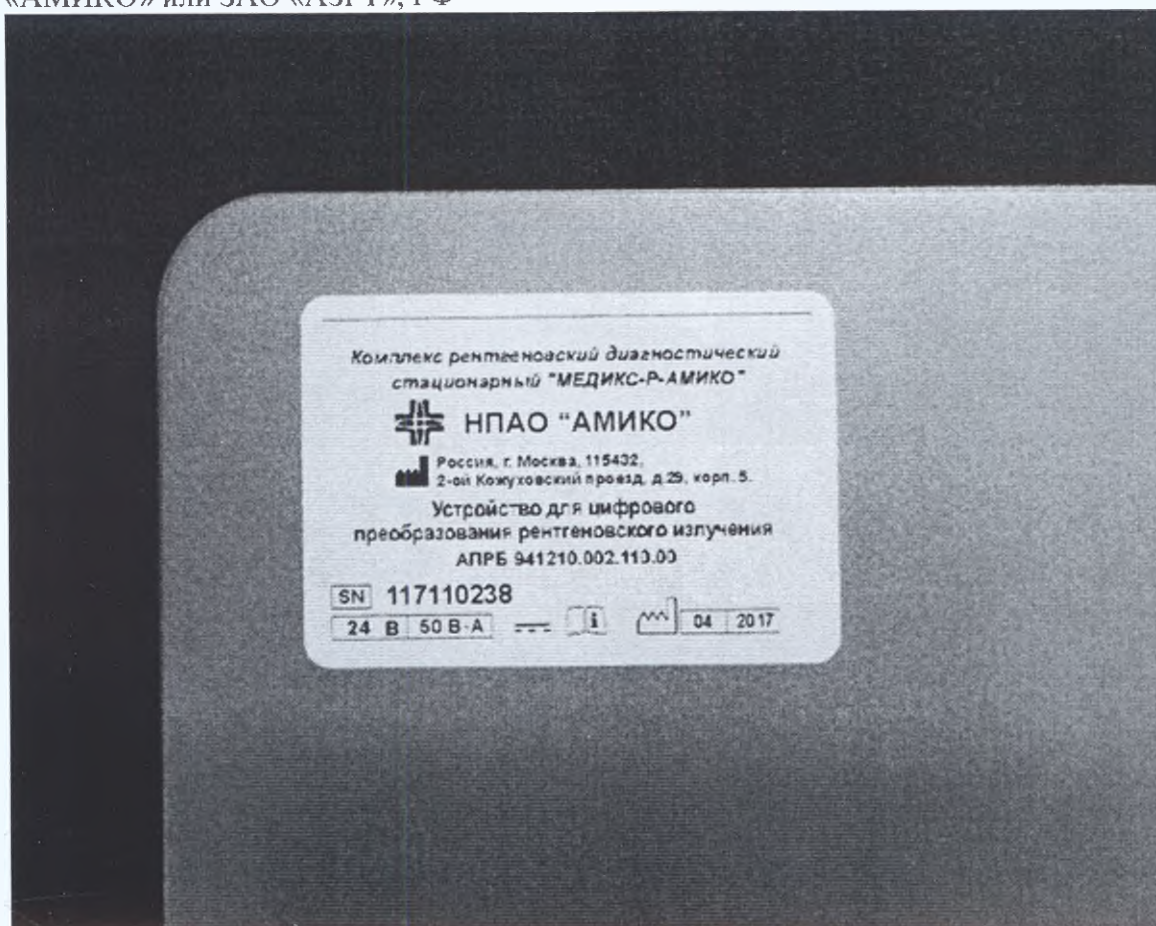

11. Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок  
«ОПТИМАКС-АМИКО», производства НПАО «АМИКО», РФ

12.






пленок 12. Растр рентгеновский отсеивающий JPI, тип AAS, производства «JPI Healthcare Co., Ltd.», Республика Корея




13. Переговорное устройство, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ

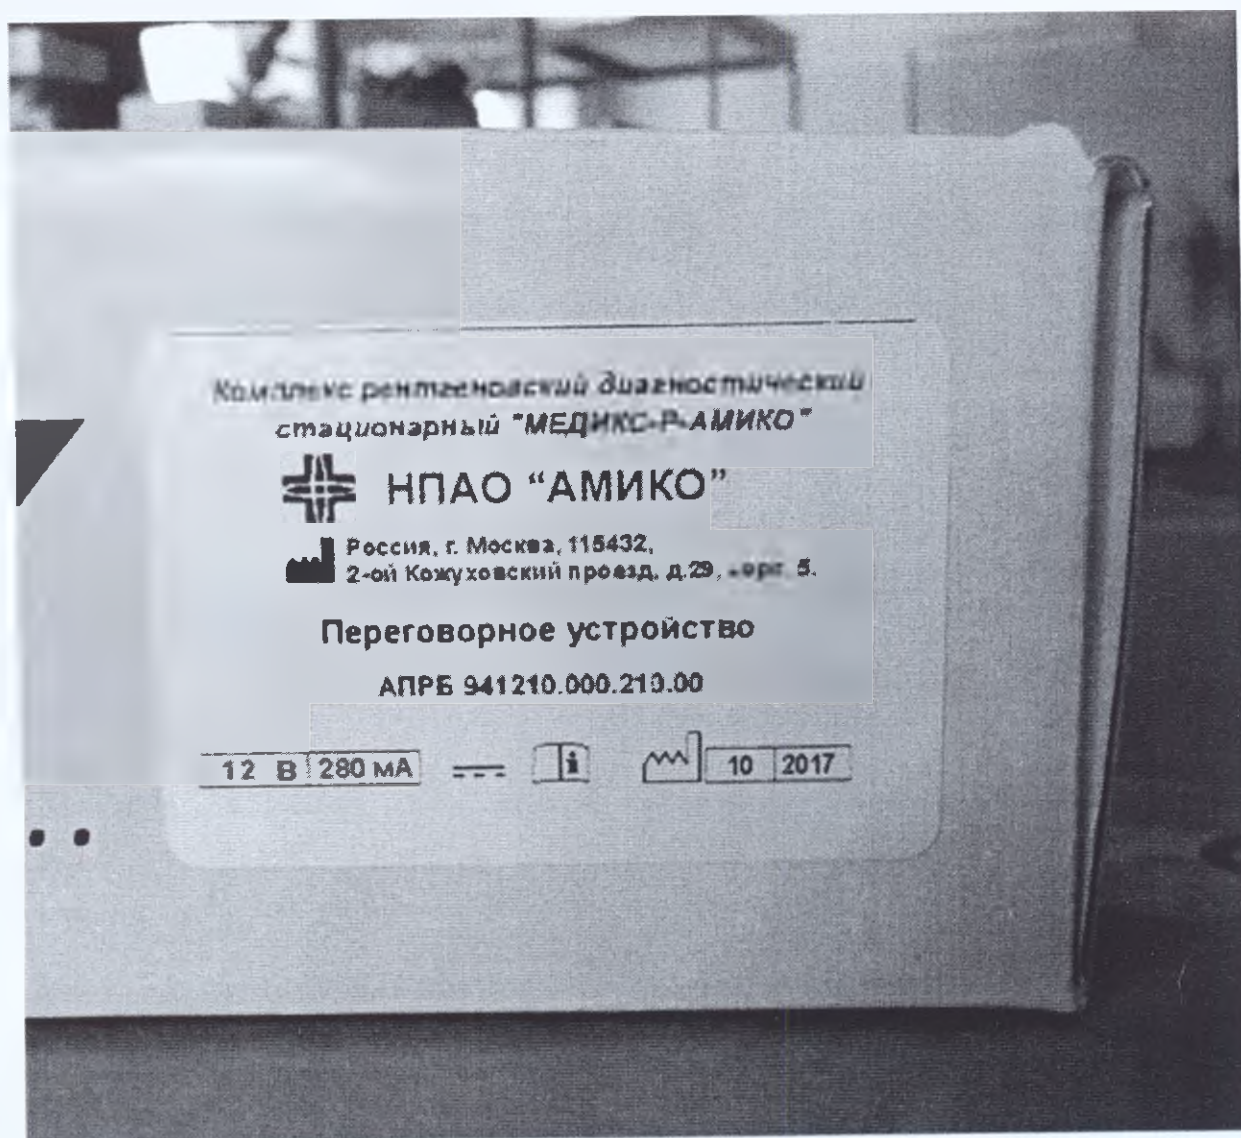




14. Кассеты пластиковые рентгенографические «РЕНЕКС-КРП» с усиливающими экранами, производства ЗАО «РЕНЕКС», РФ.

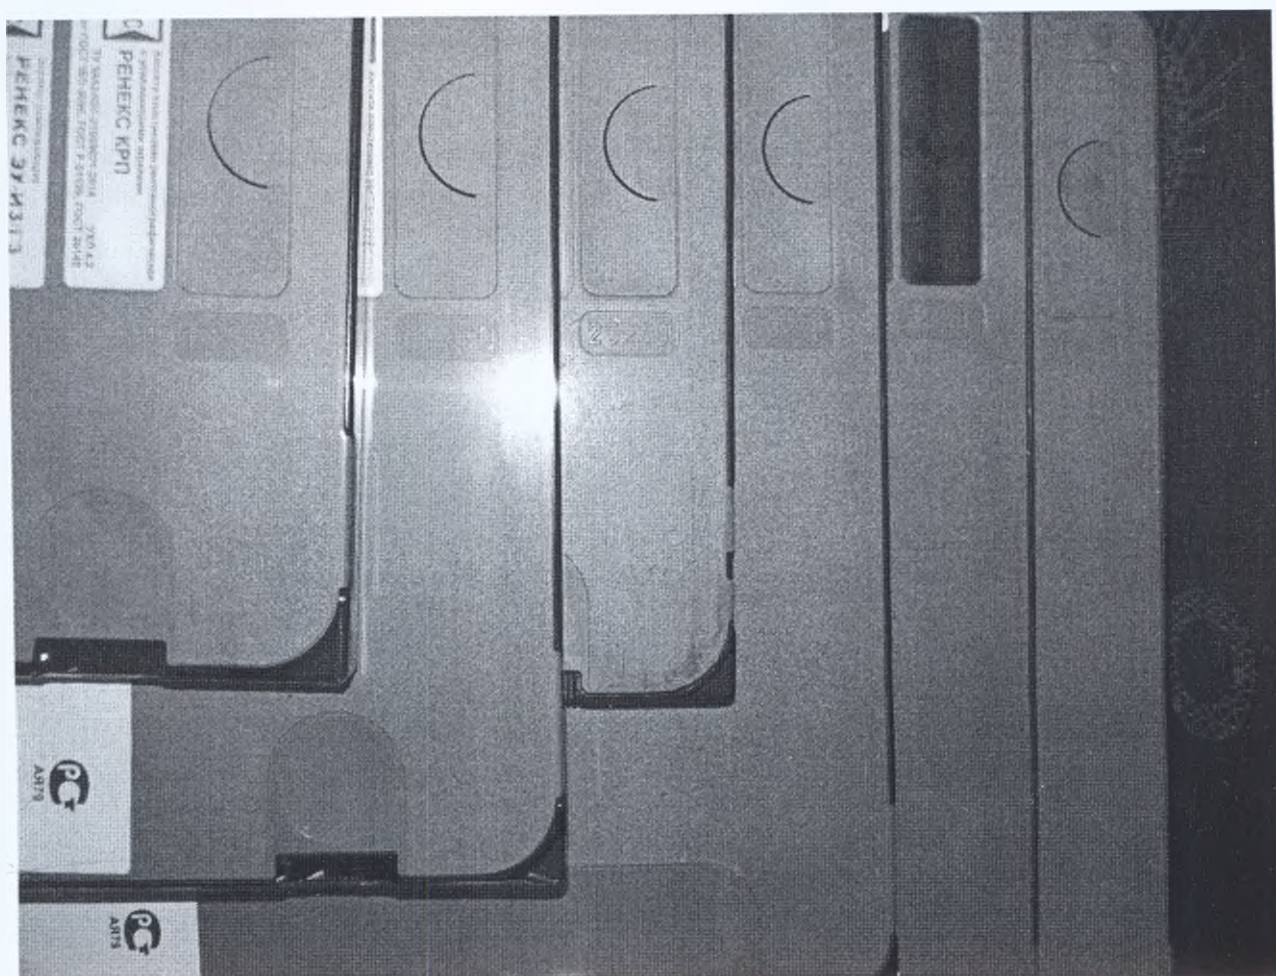


15. Экраны усиливающие для рентгеновских аппаратов, производства PROTEC GmbH Co.KG, Германия

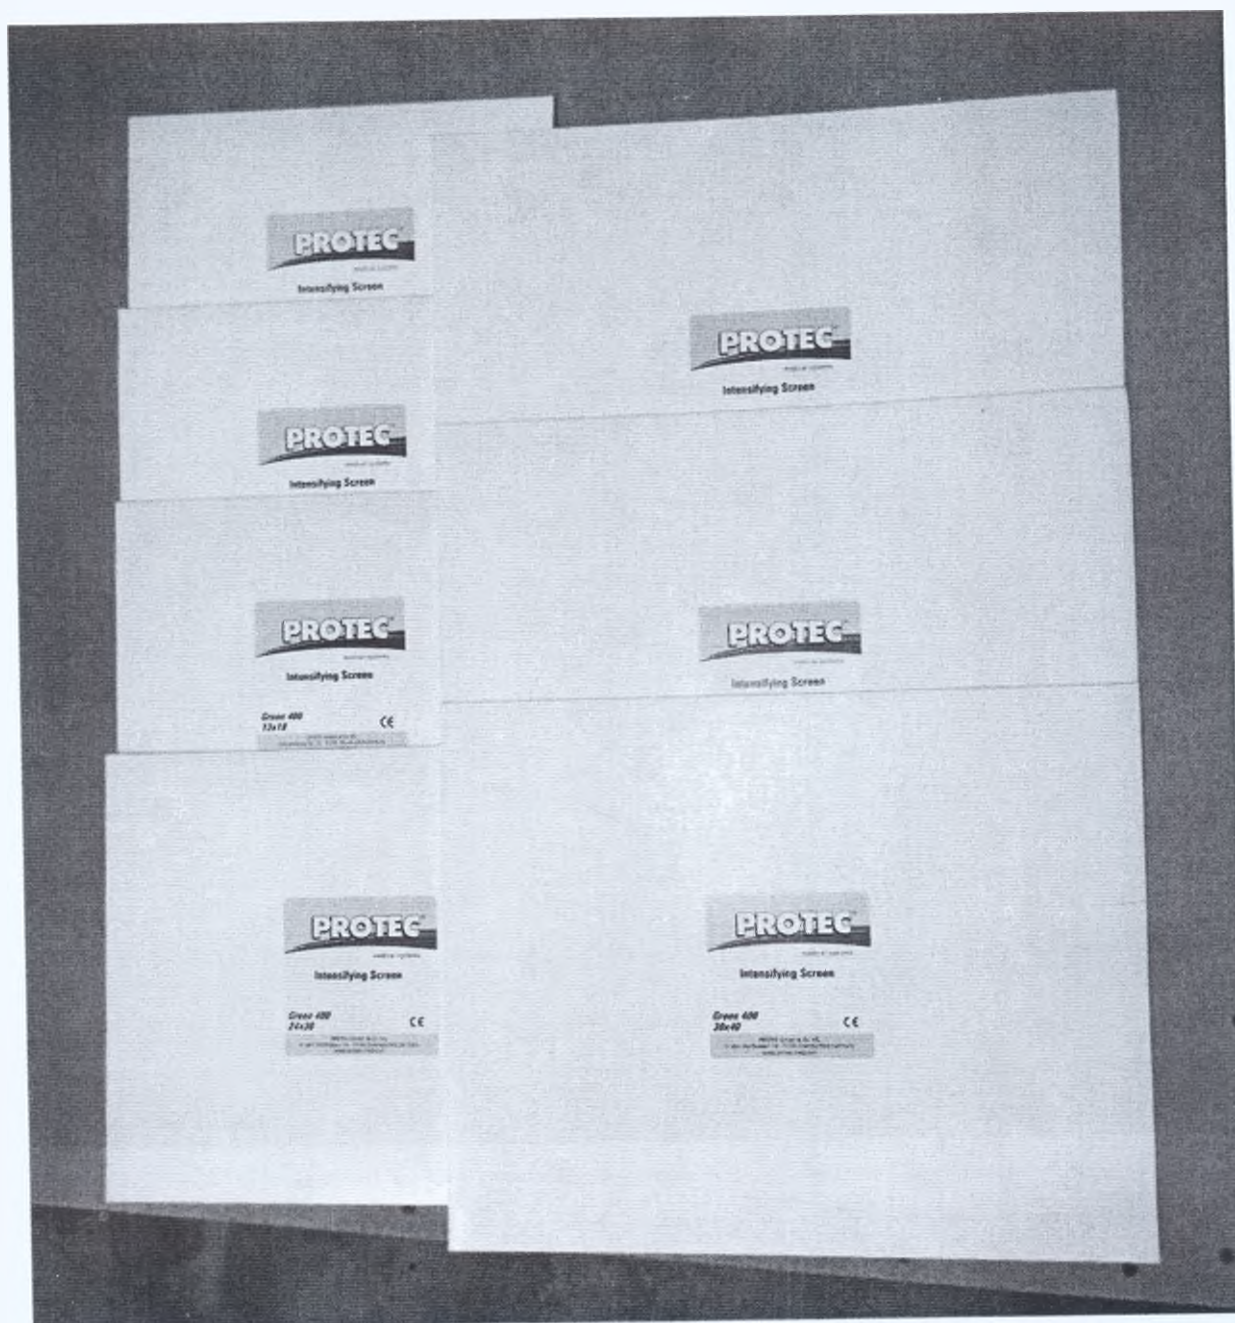




16. Система дистанционного видеонаблюдения, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ

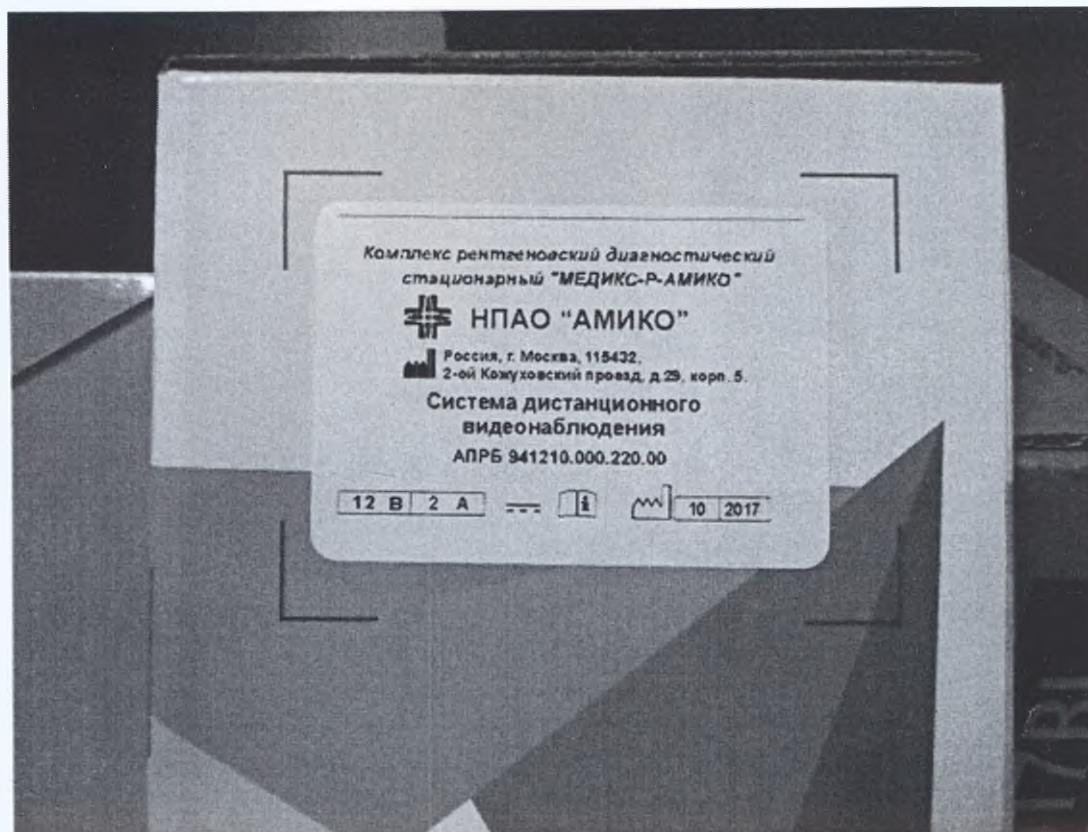

17. Комплект фотолaborаторный, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ

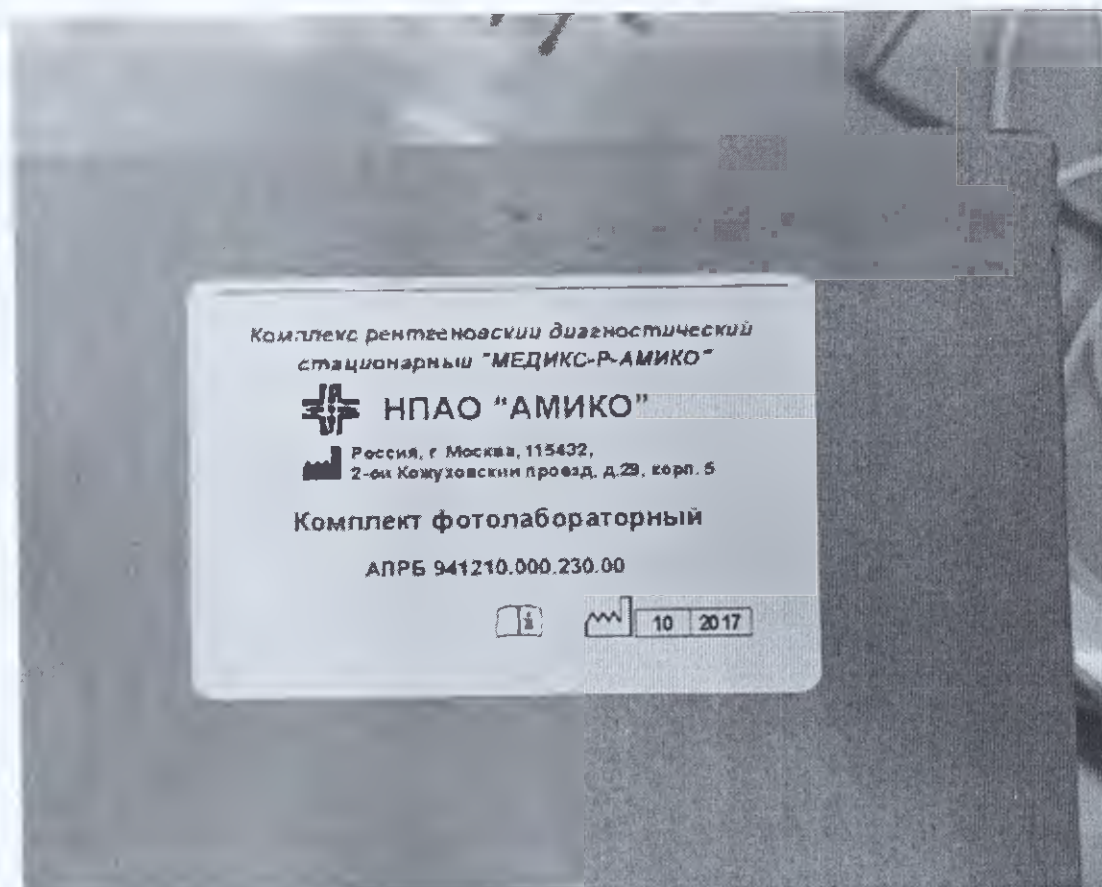


18. Кaтaлкa рентгeнoгpaфичeскaя, пpoизвoдствa НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ







19. Устройство фиксации детей для рентгенографии, производства ЗАО «АЗРТ», РФ

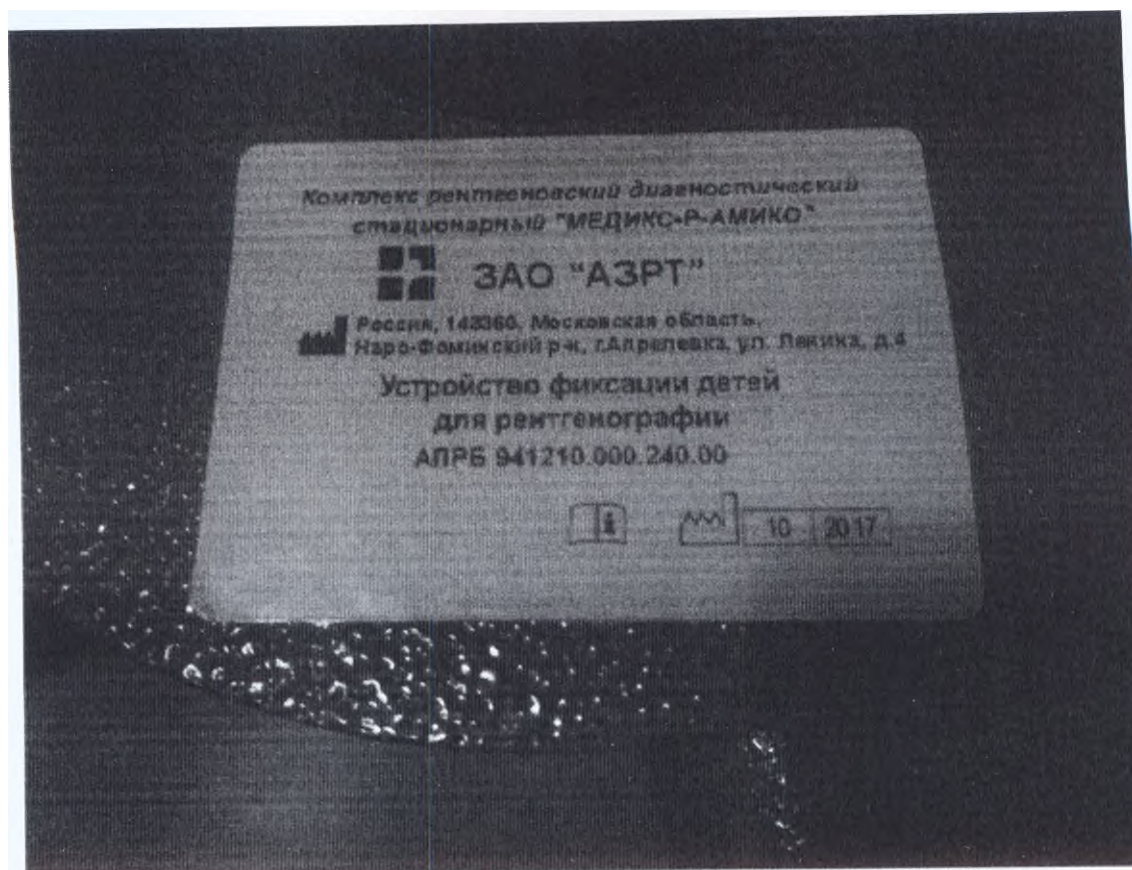


20. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ – «Р-К», производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР» или ООО «Рентген-Комплект», РФ

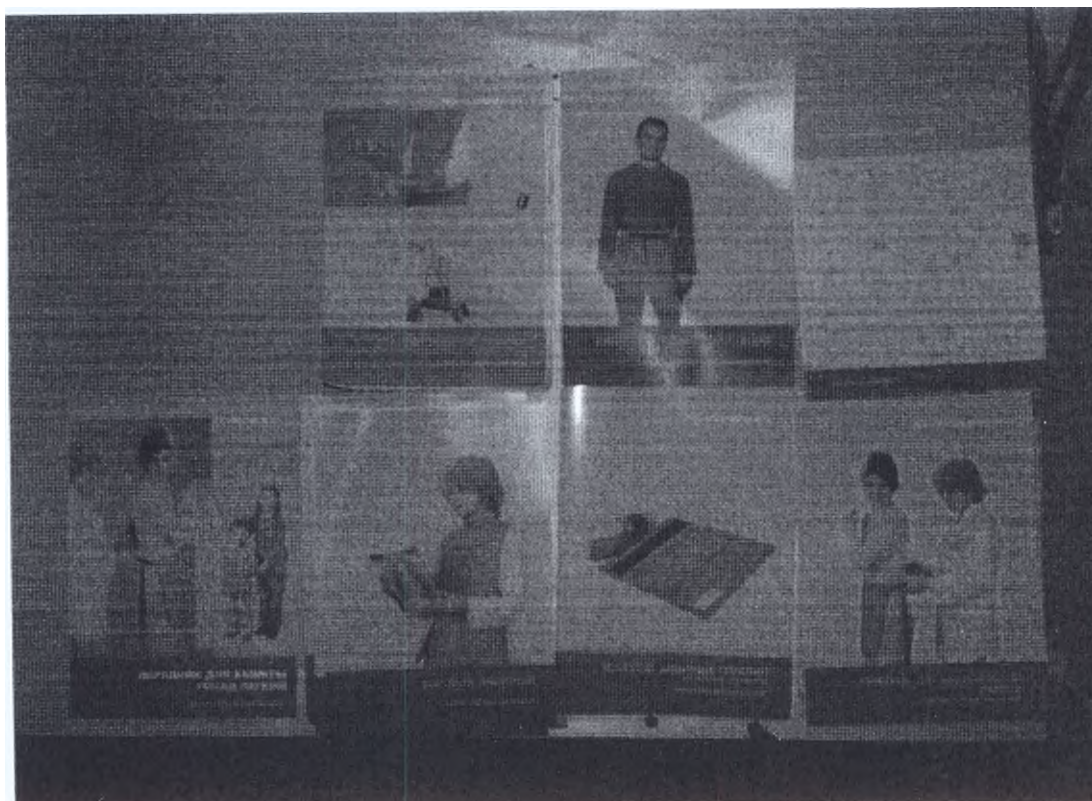

21. Окна защитные смотровые ОЗС, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР» или Окна рентгенозащитные РЕНЕКС ОСЗР, производства ЗАО «РЕНЕКС», РФ

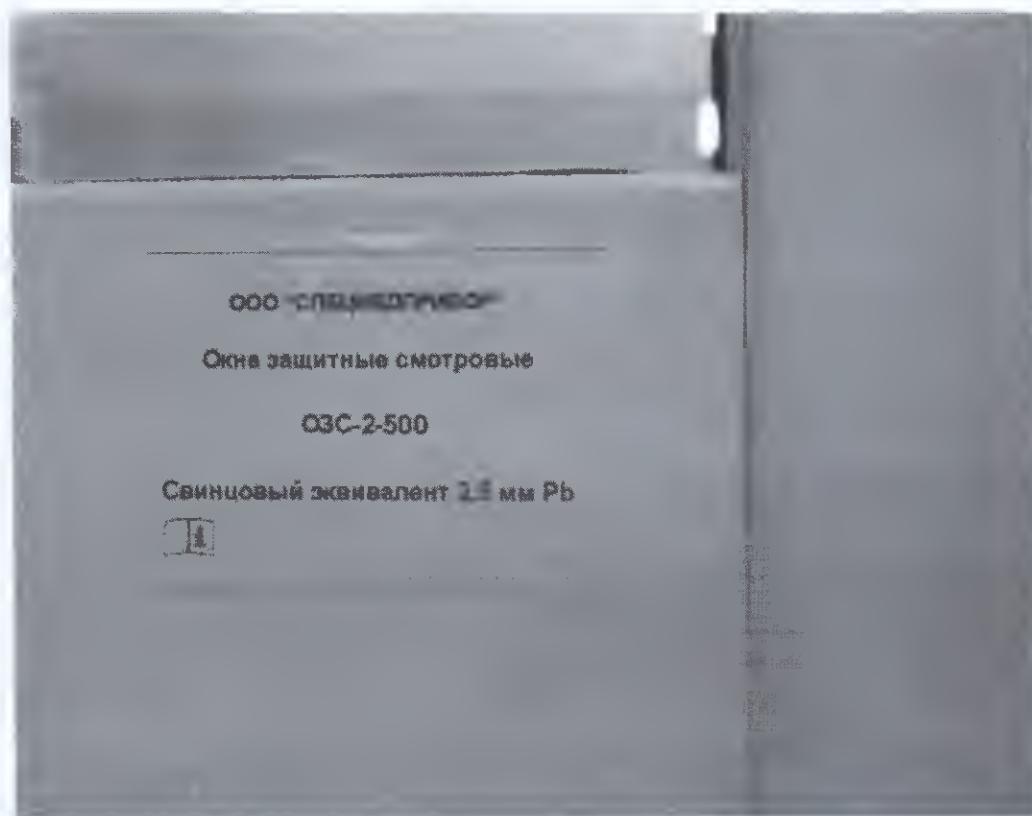


22. Комплект сменных устройств, производства НПАО «АМИКО» или ЗАО «АЗРТ», РФ:
- Пояс компрессионный,
  - Рамка – кассетодержатель,
  - Полка для латерографии.

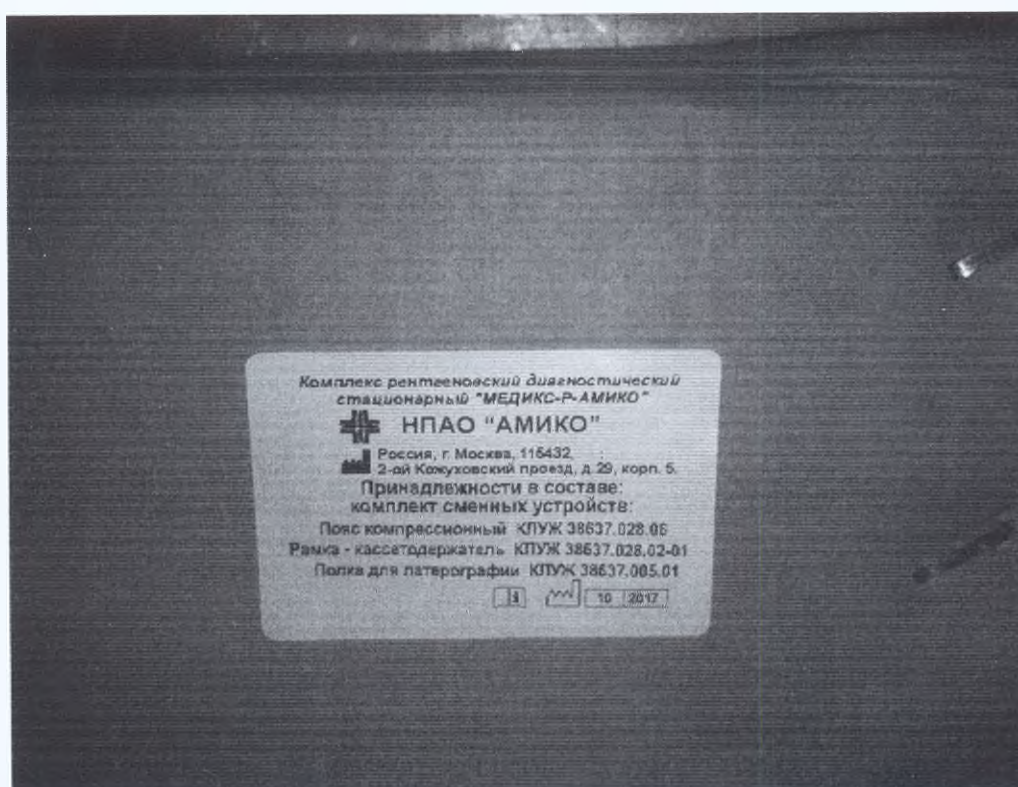



Окн

23. Стабилизатор напряжения переменного тока, марка «LIDER», ООО «Псковский завод электронной техники»  
или Стабилизатор напряжения серии «САТУРН», производства НΠΑΟ «ΠΦ «Созвездие»  
или Стабилизатор переменного напряжения трехфазный, марка Штиль, производства  
ООО «Тэнси-Техно», РФ

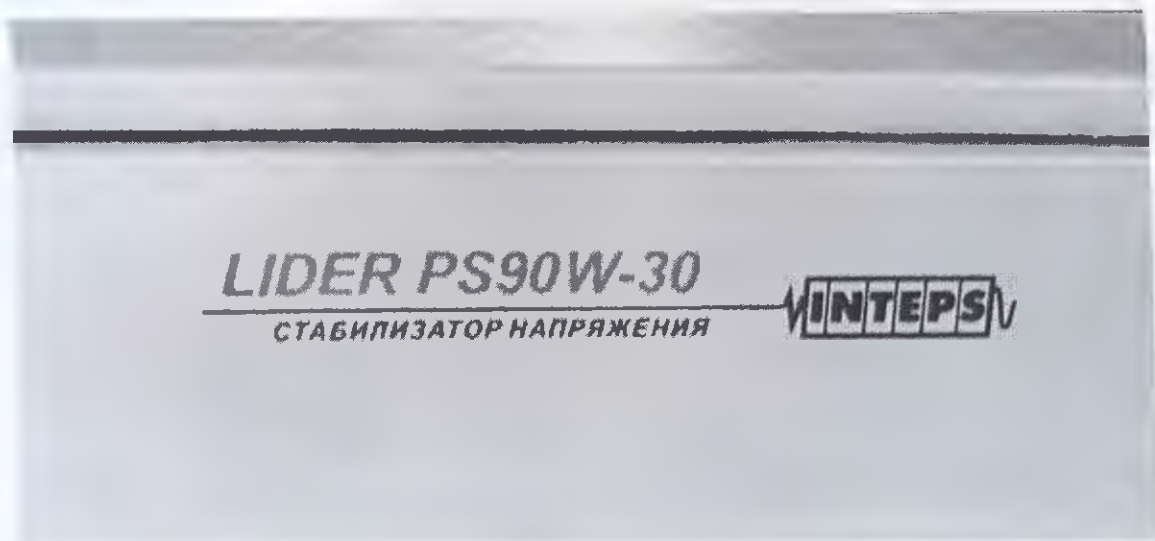

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью.

11 (одиннадцать) листов

Зам. директора по качеству

А.Н. /Никитушкин С.В./

