

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Аппарат "ВИТ" для лечения ран отрицательным
давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018***

Производства

ООО "ВИТ МЕДИКАЛ"

123458, Россия, Москва, ул. Твардовского, д. 8,
стр. 1, пом. 1 комн. 3


info@vit-medical.com




Аппарат "ВИТ" для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018 в вариантах исполнения:


4

1. Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018, в составе: 1.1. Аппарат «ВИТ Мобил» - 1 шт. (вид спереди)

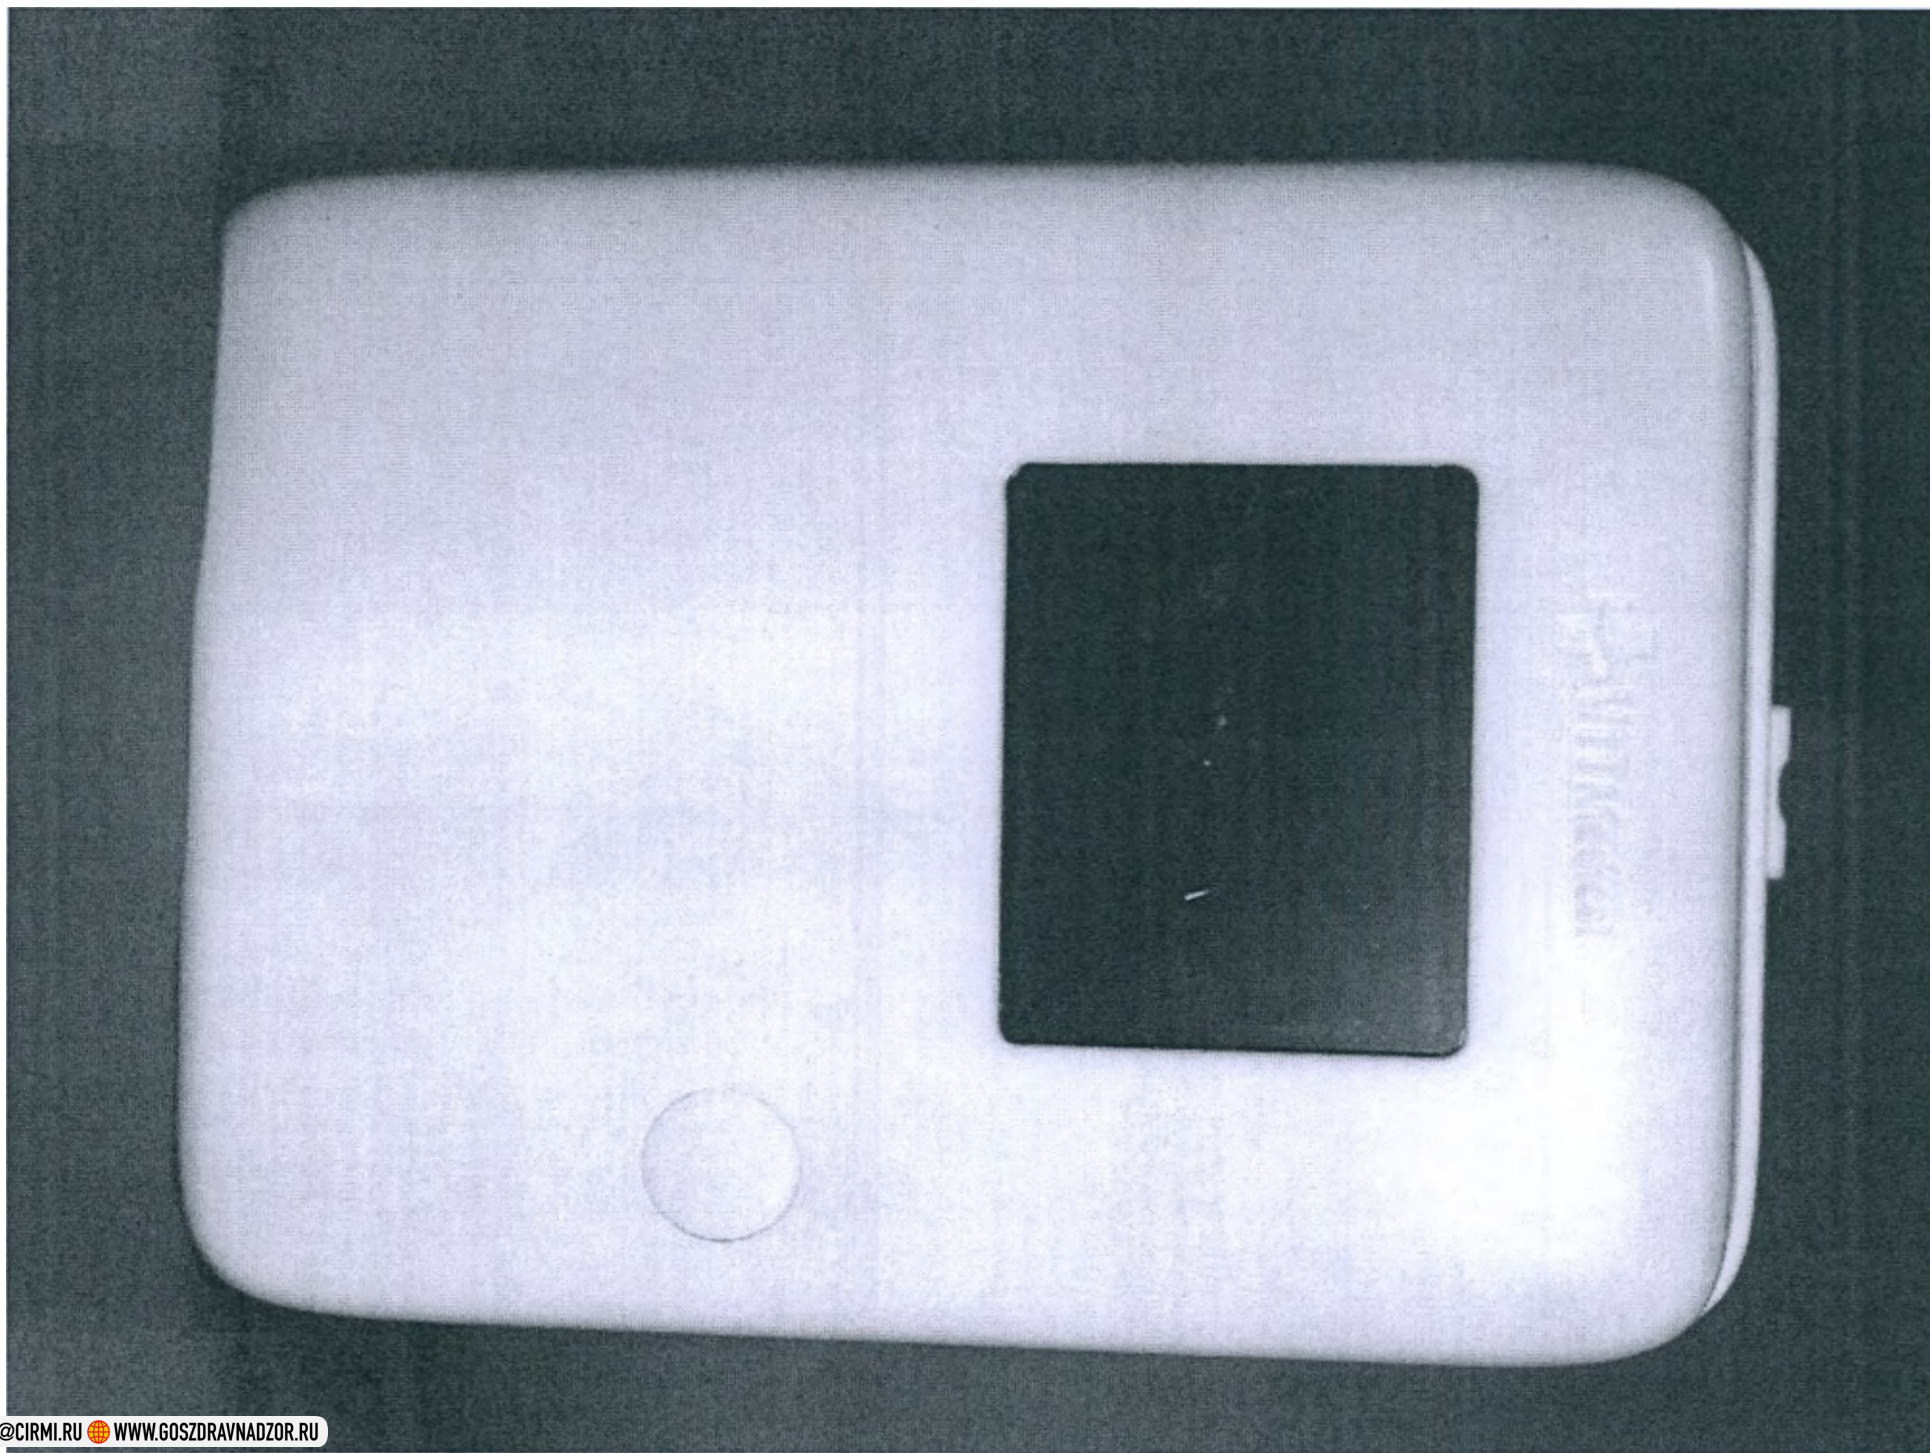

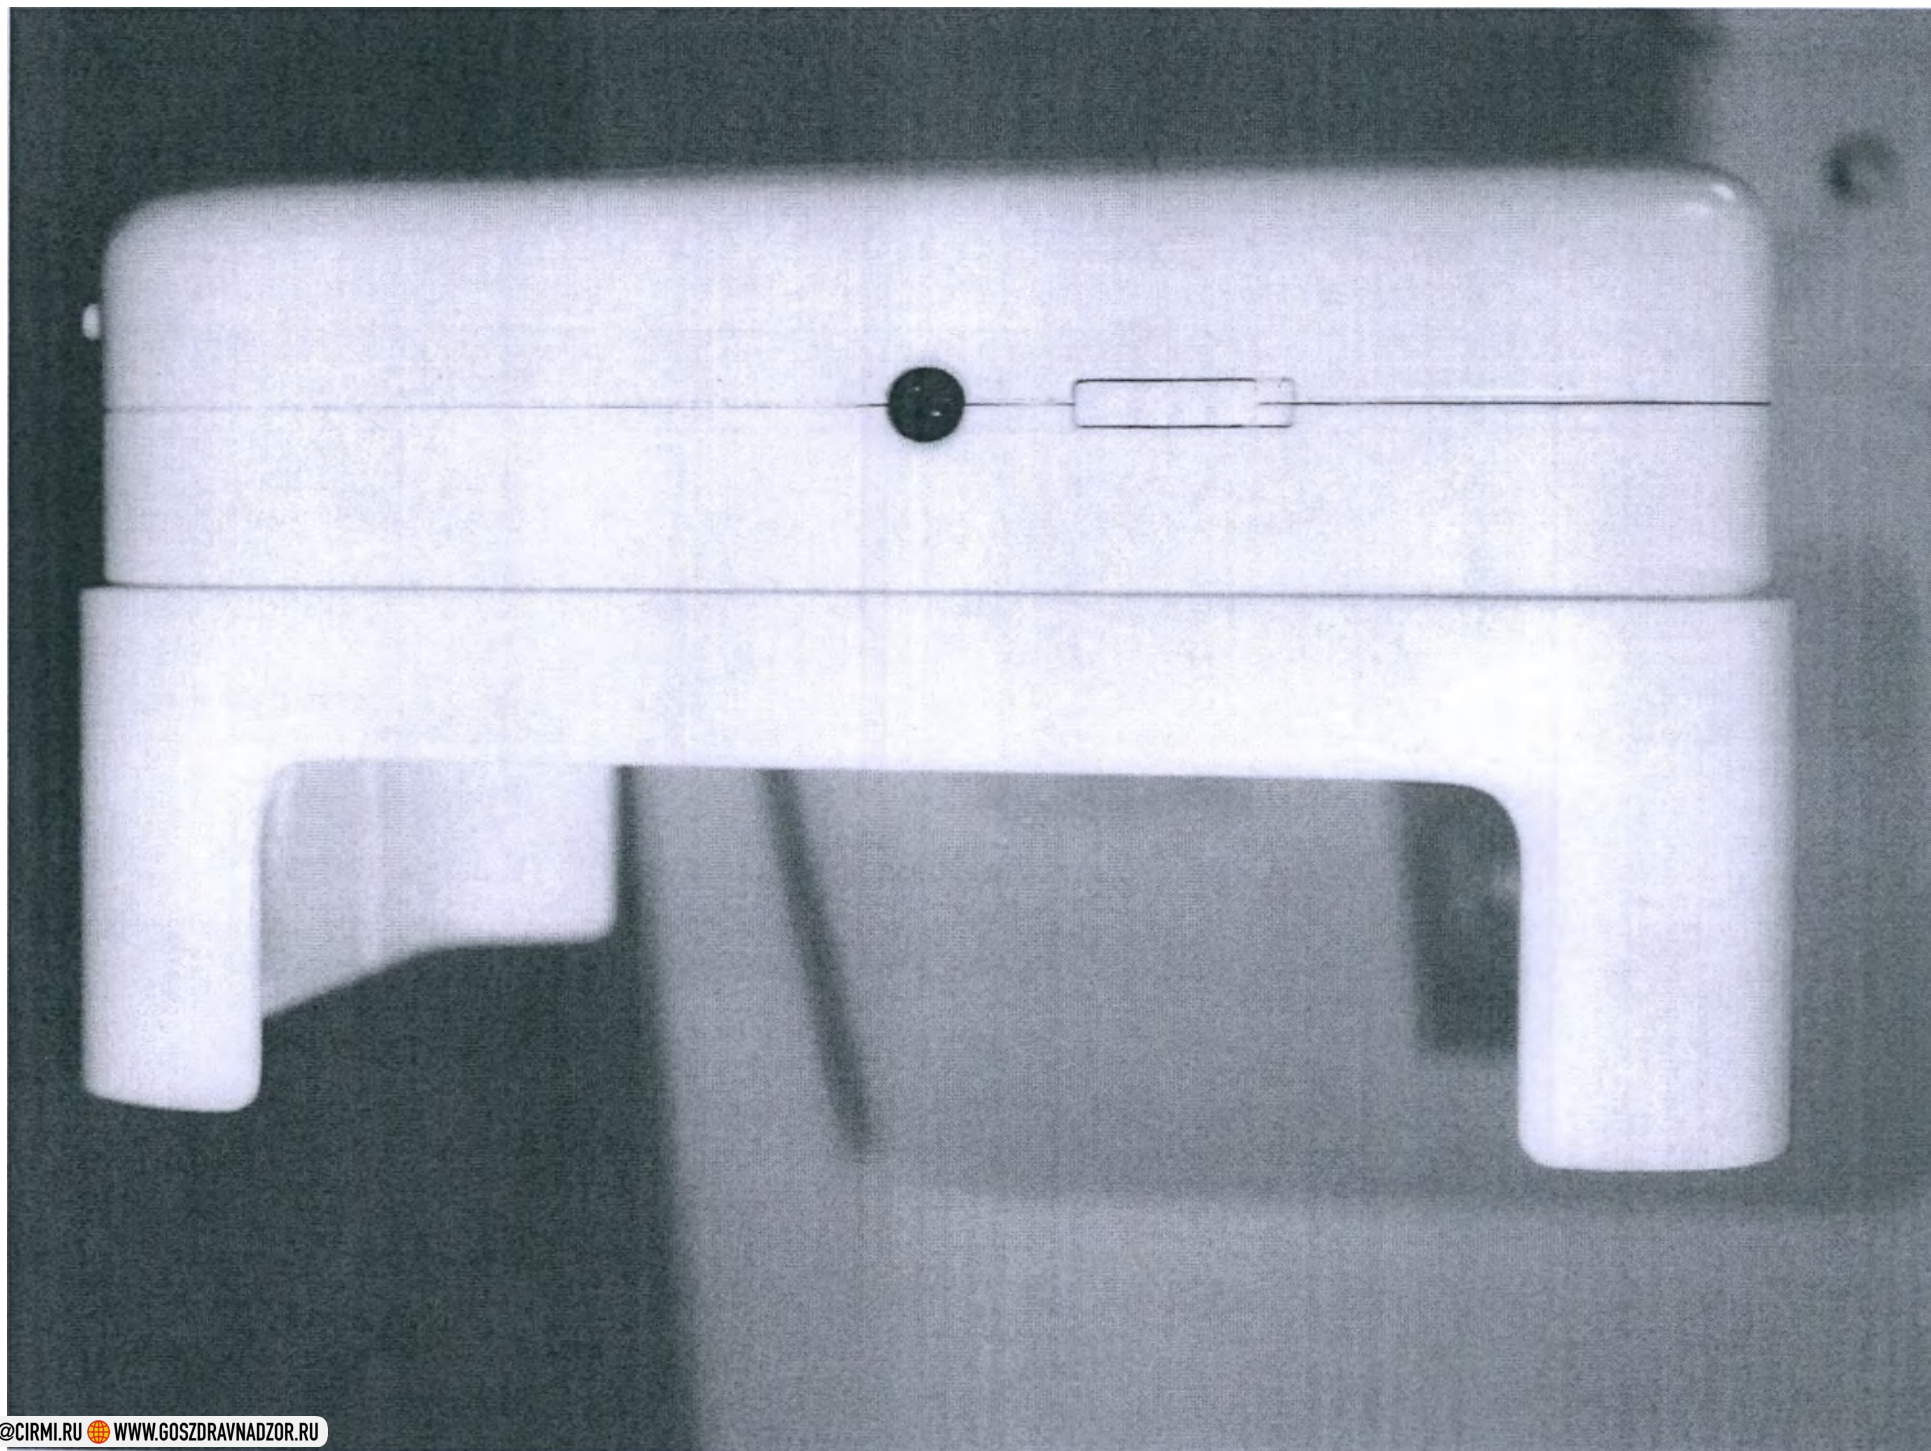

1.2. Зарядное устройство - 1 шт.

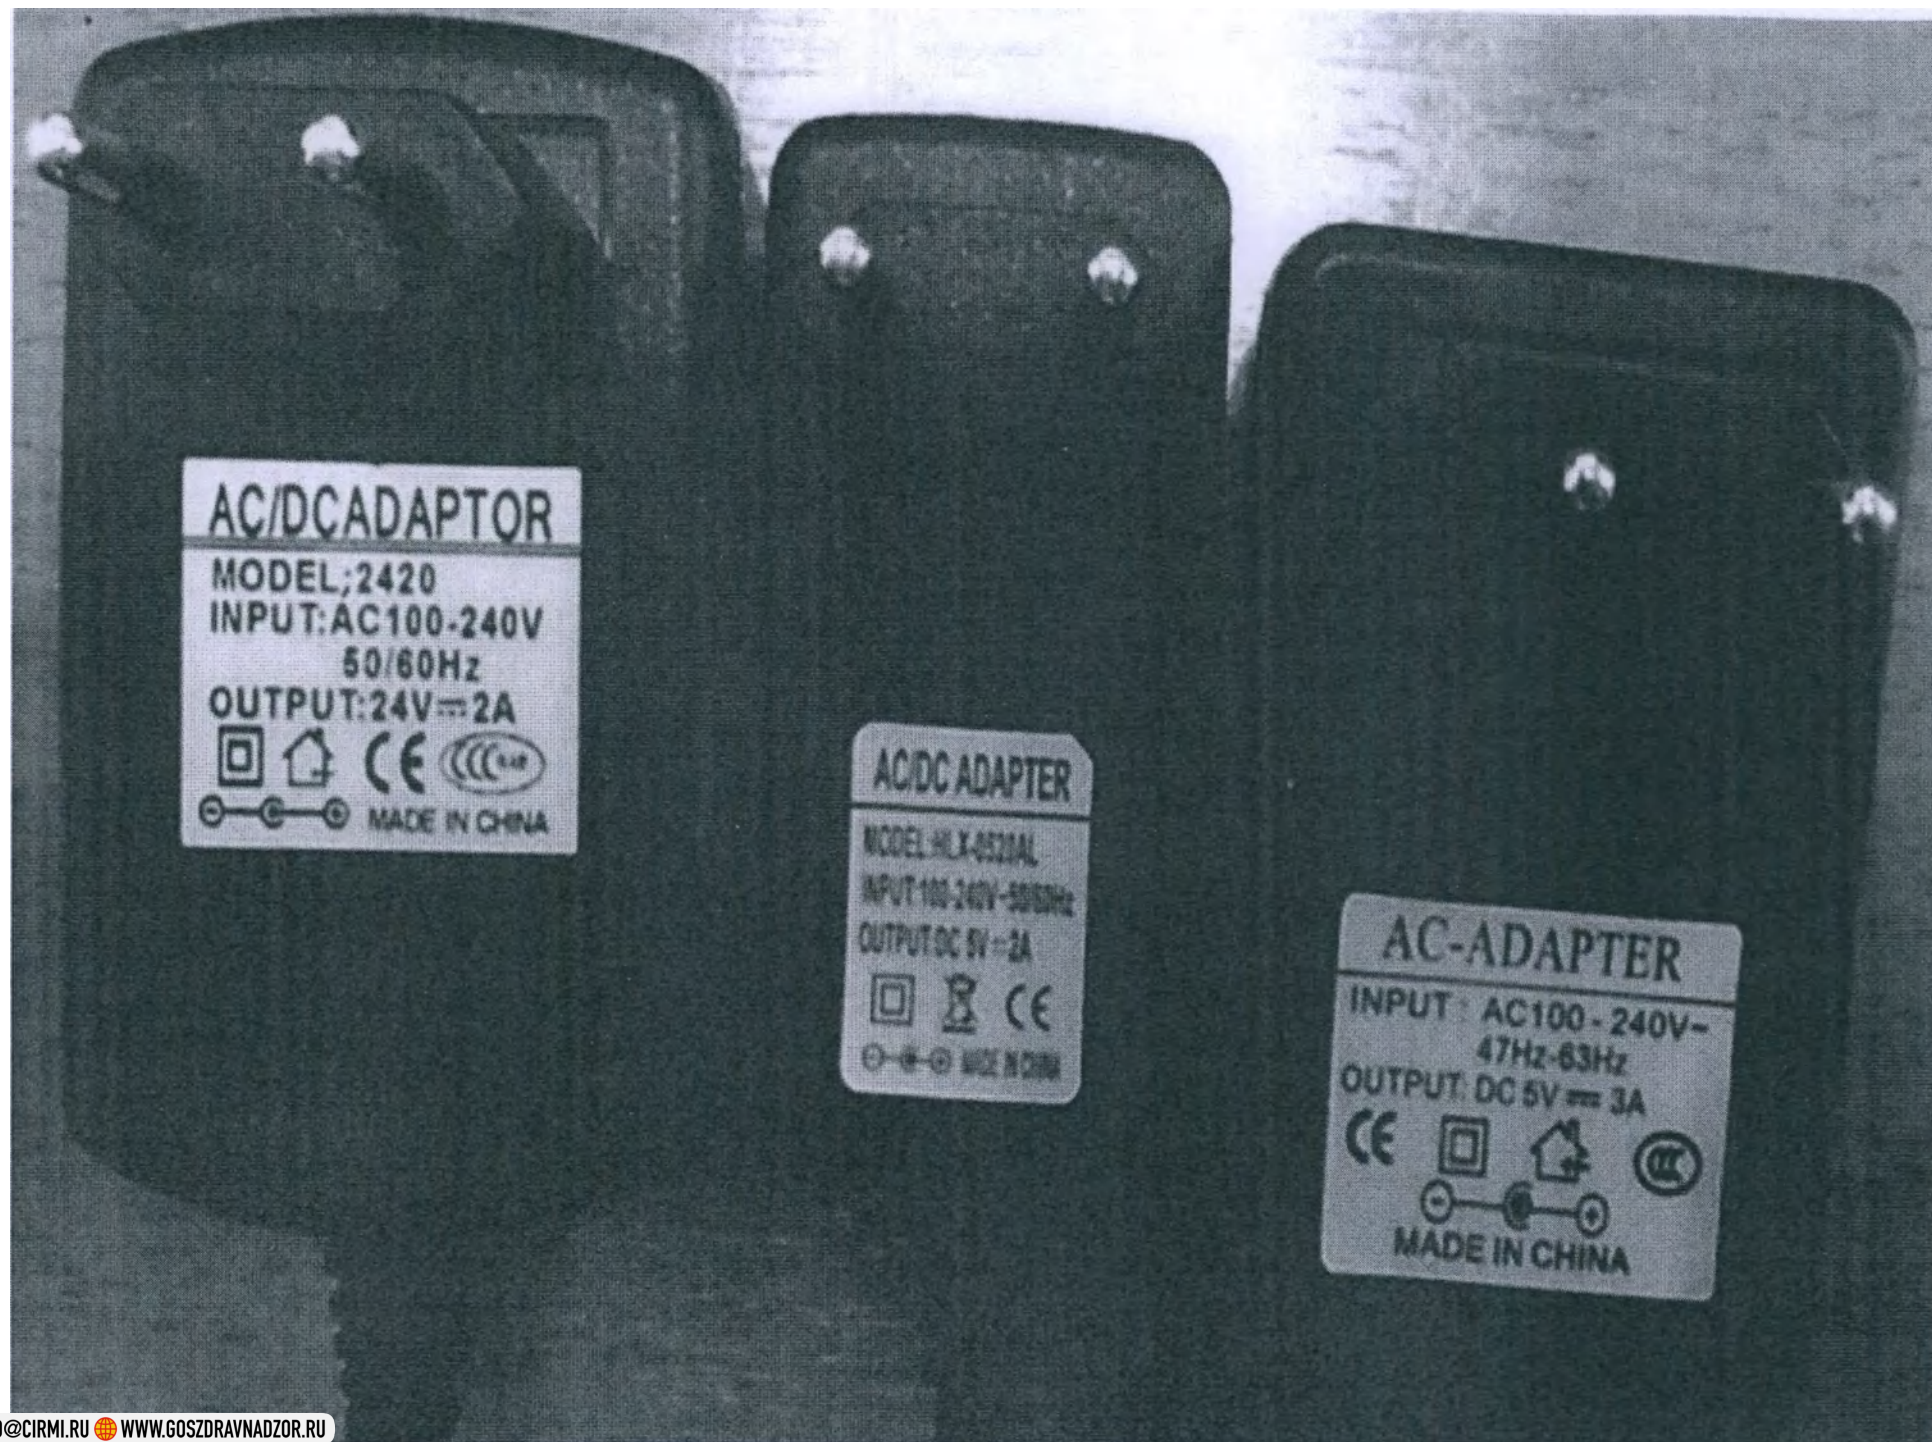

1.3. Емкость для сбора экссудата, объем 700 мл - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка, упаковка)

Емкость для сбора экссудата

Применяется с:

Размер

V	700
	400
	200

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT

Партия №

SN

№

 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»),
Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458
Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации


Нестерильно. Нетоксично. Апиrogenно.



1.3. Емкость для сбора экссудата, объем 700 мл - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка, упаковка)



1.3. Емкость для сбора экссудата, объем 700 мл - не более 200 шт. (при необходимости).

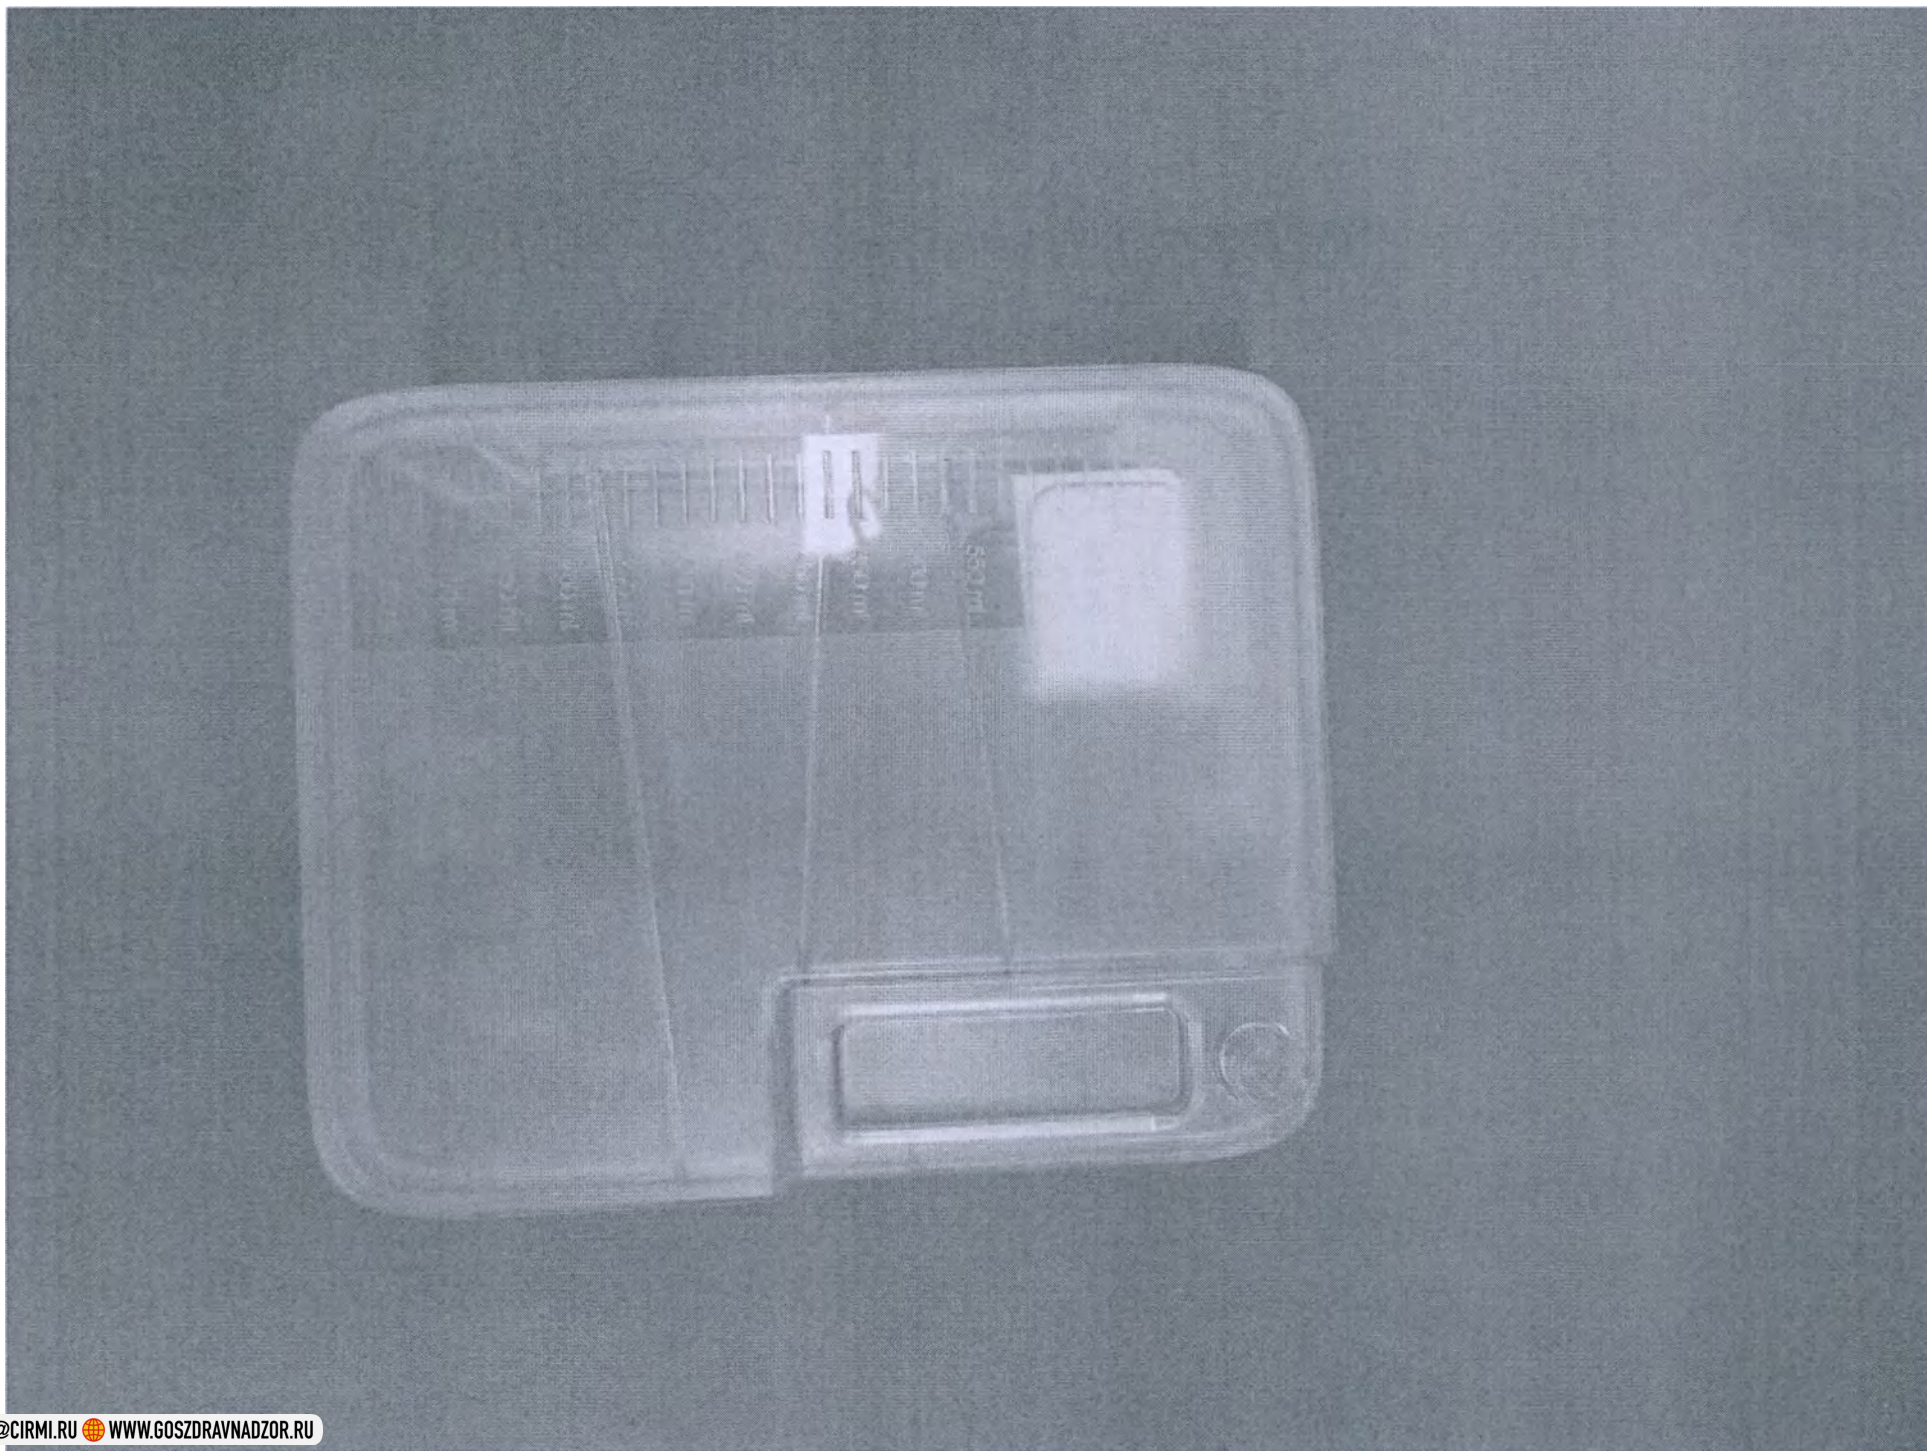

1.4. Емкость для сбора экссудата, объем 400 мл - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Емкость для сбора экссудата

Применяется с:

Размер

	700
V	400
	200

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT

Партия №

SN

№

 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»),
Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458
Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40


Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации


Нестерильно. Нетоксично. Апиrogenно.



1.4. Емкость для сбора экссудата, объем 400 мл - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

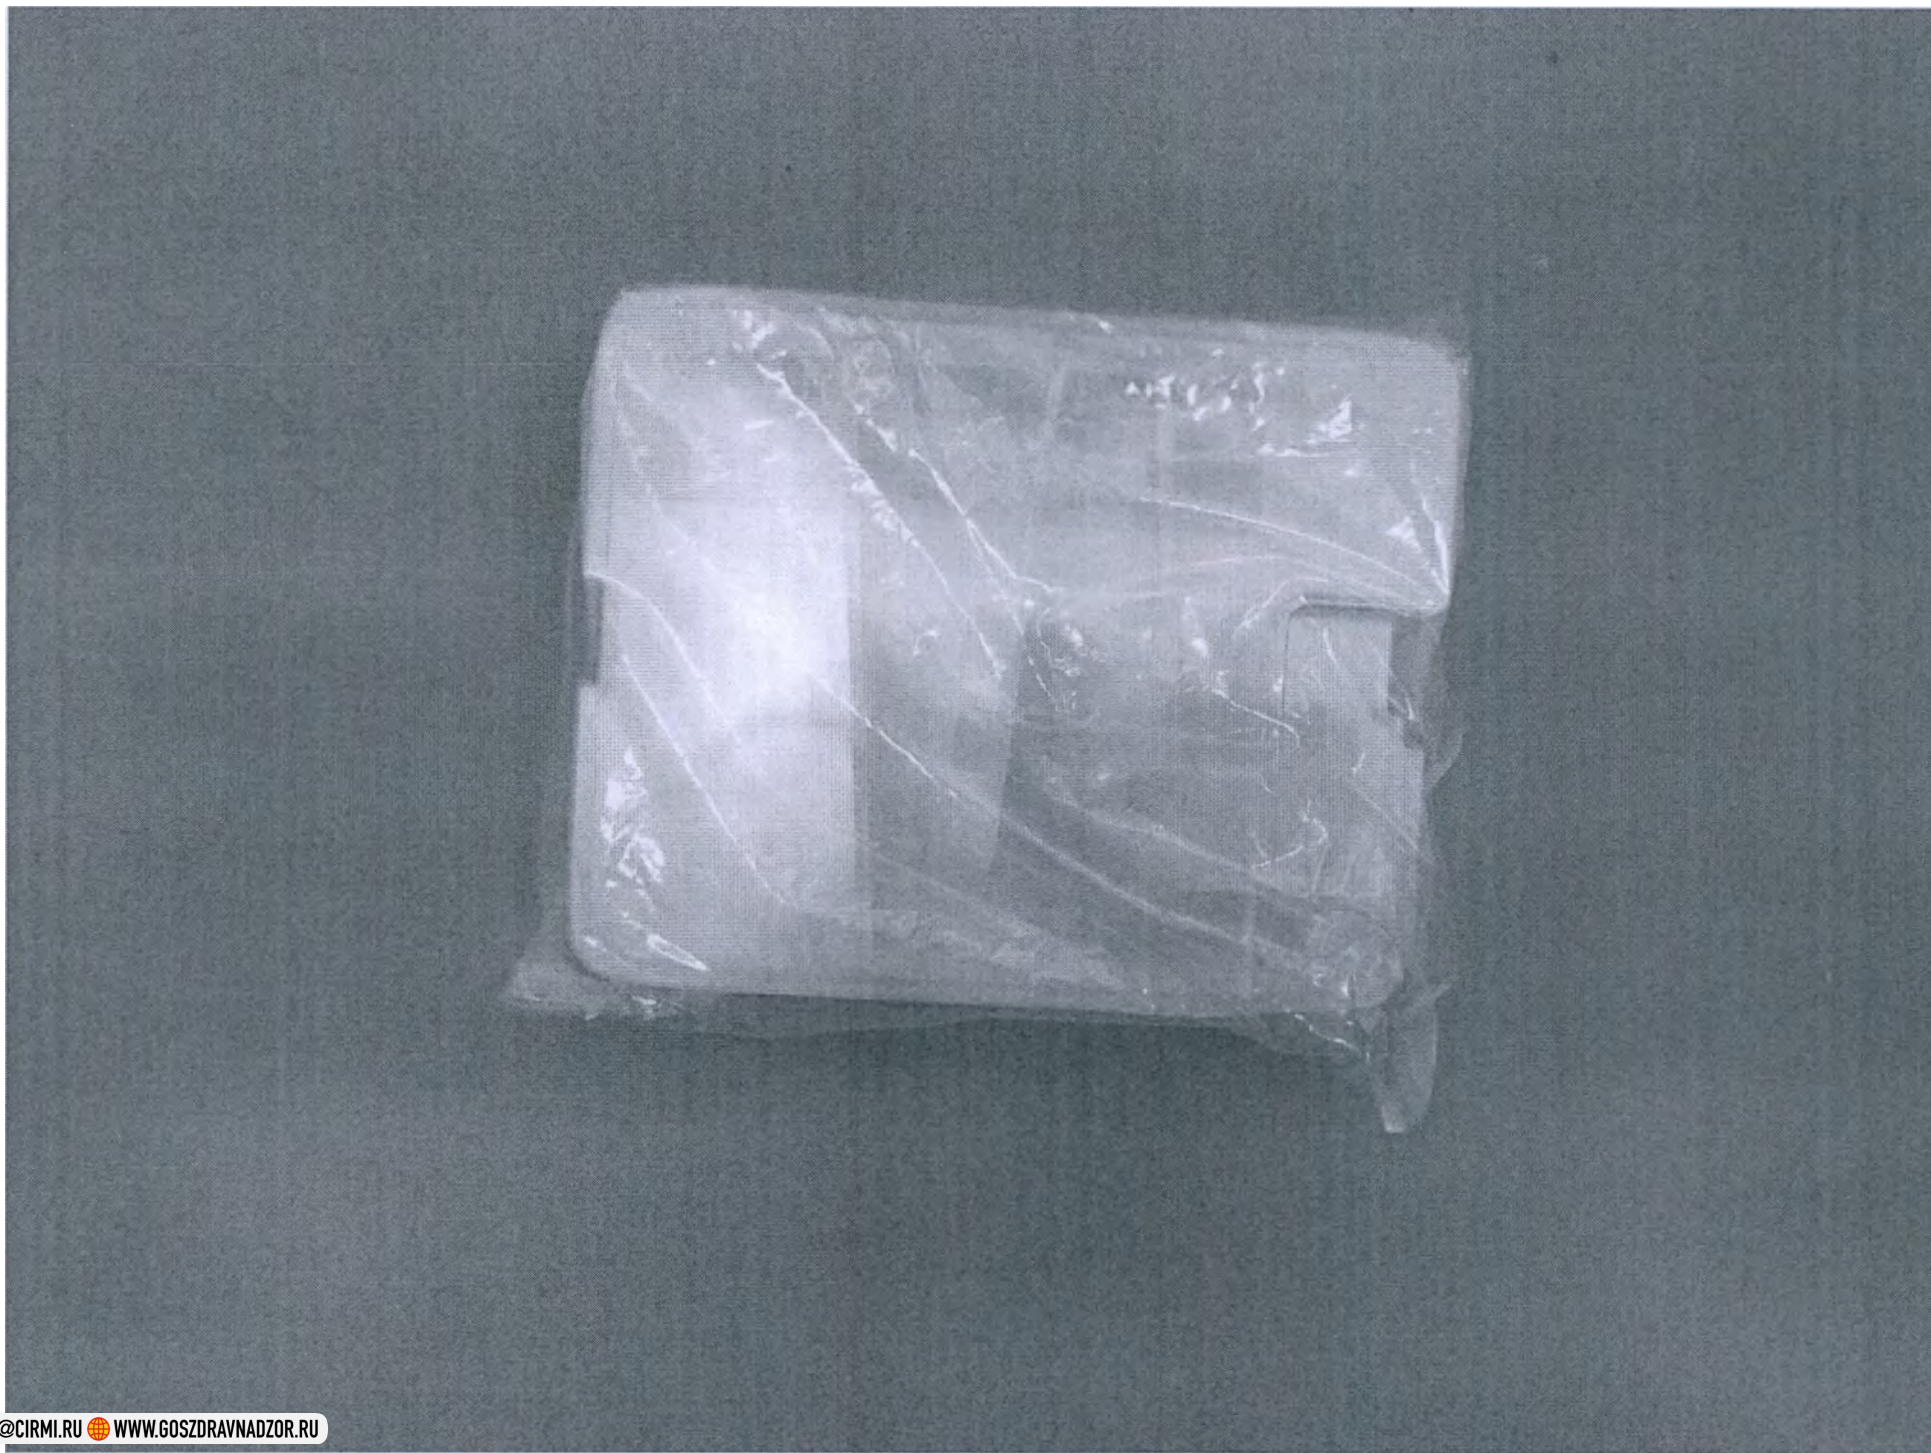

1.4. Емкость для сбора экссудата, объем 400 мл - не более 200 шт. (при необходимости).

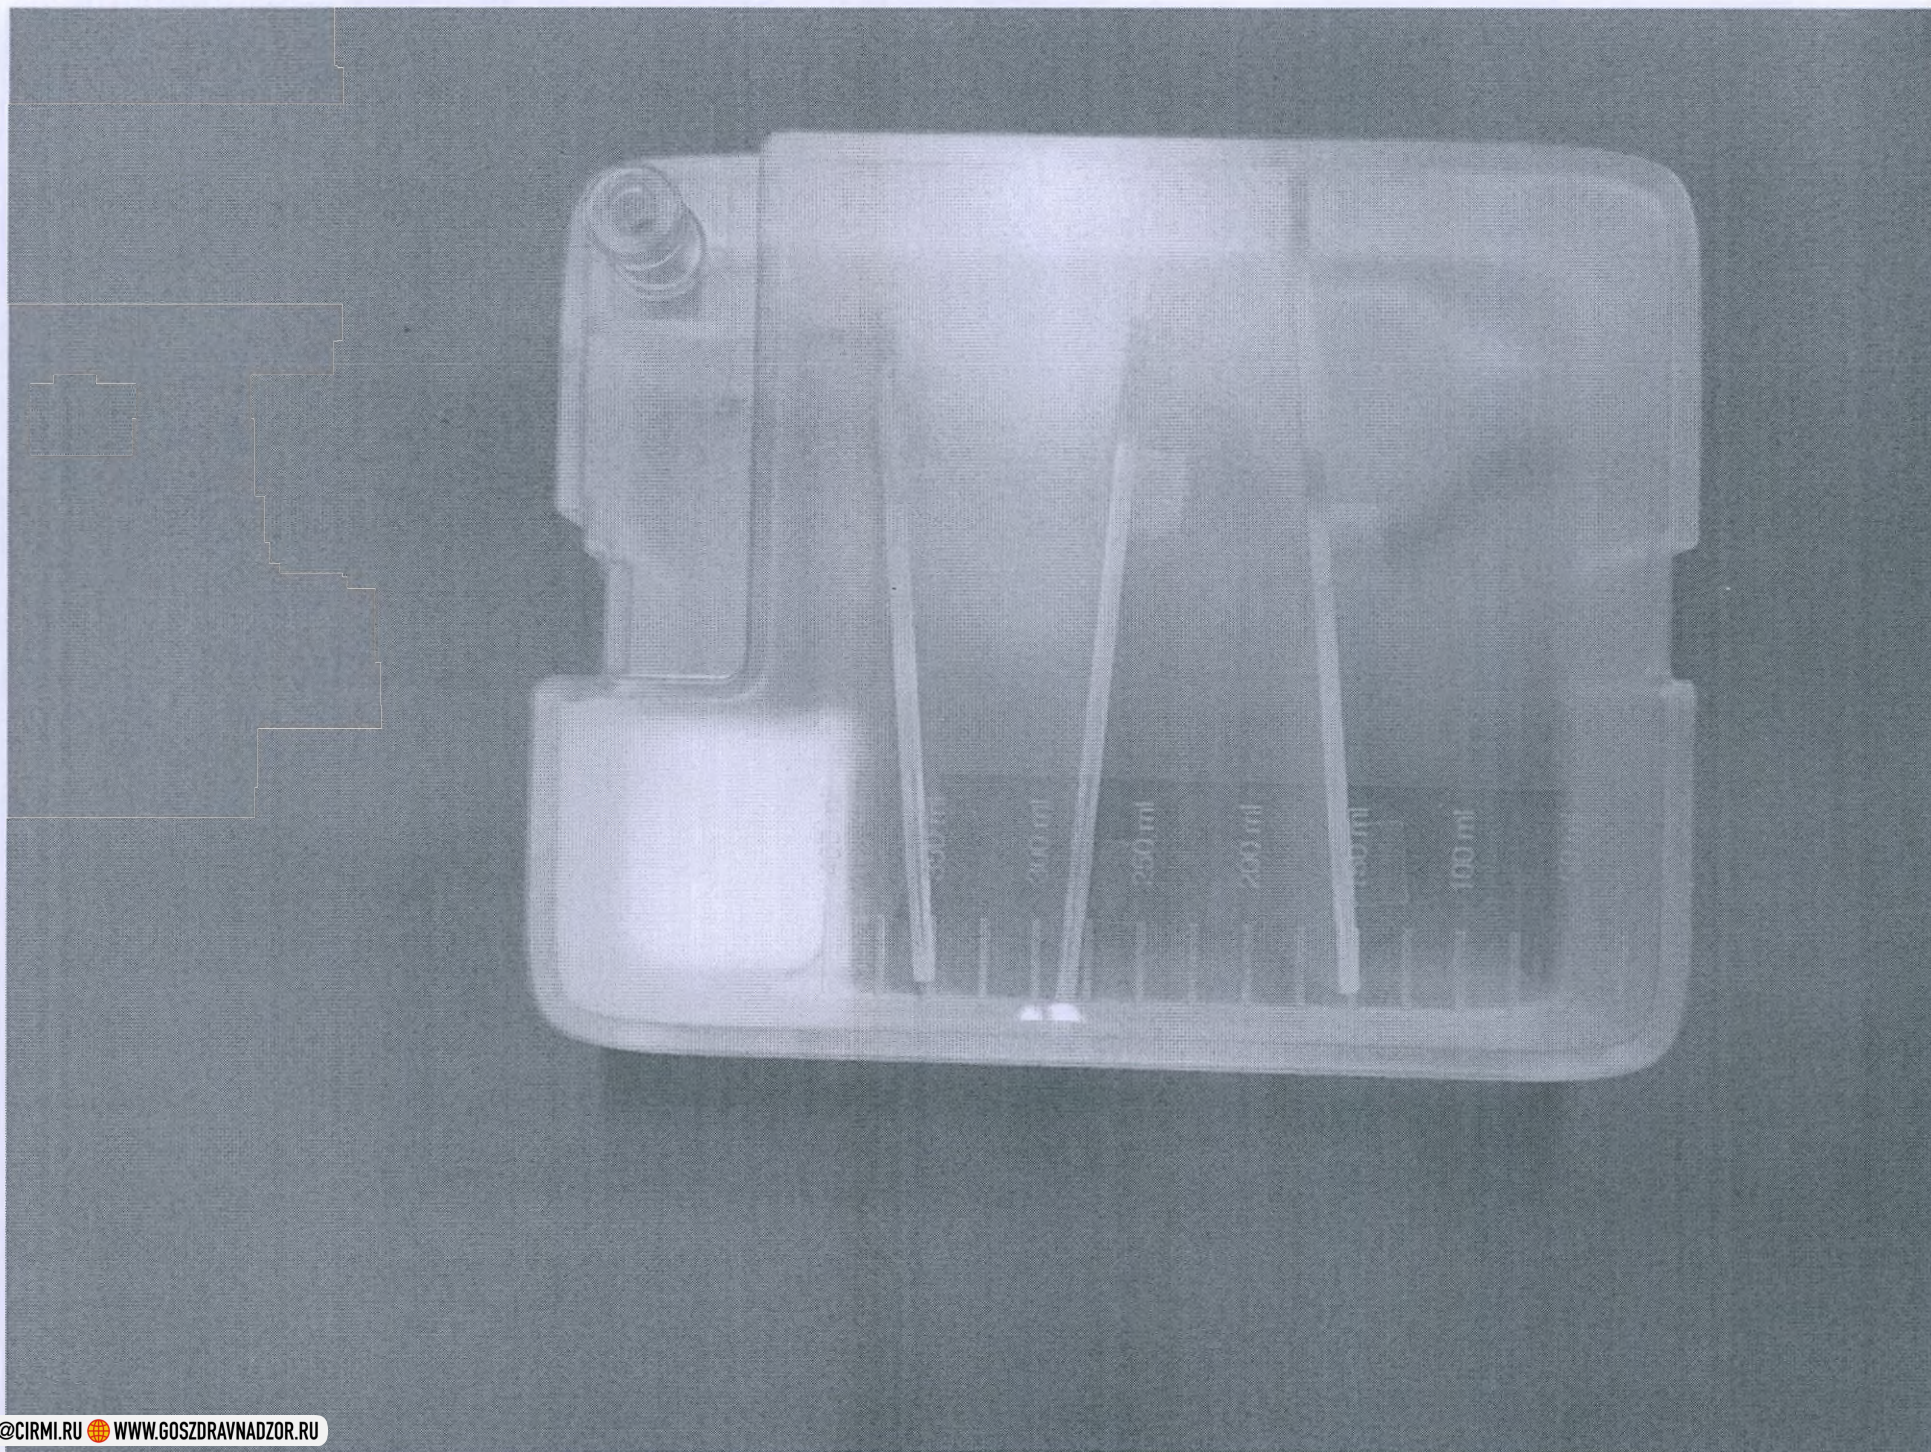

1.5. Повязка-губка для ран, размеры S - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Повязка-губка для ран

Применяется с:

Размер

V	S
	M
	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT

Партия №

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3,123458)

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.



STERILE R

1.5. Повязка-губка для ран, размеры S - не более 200 шт. (при необходимости). (Упаковка)

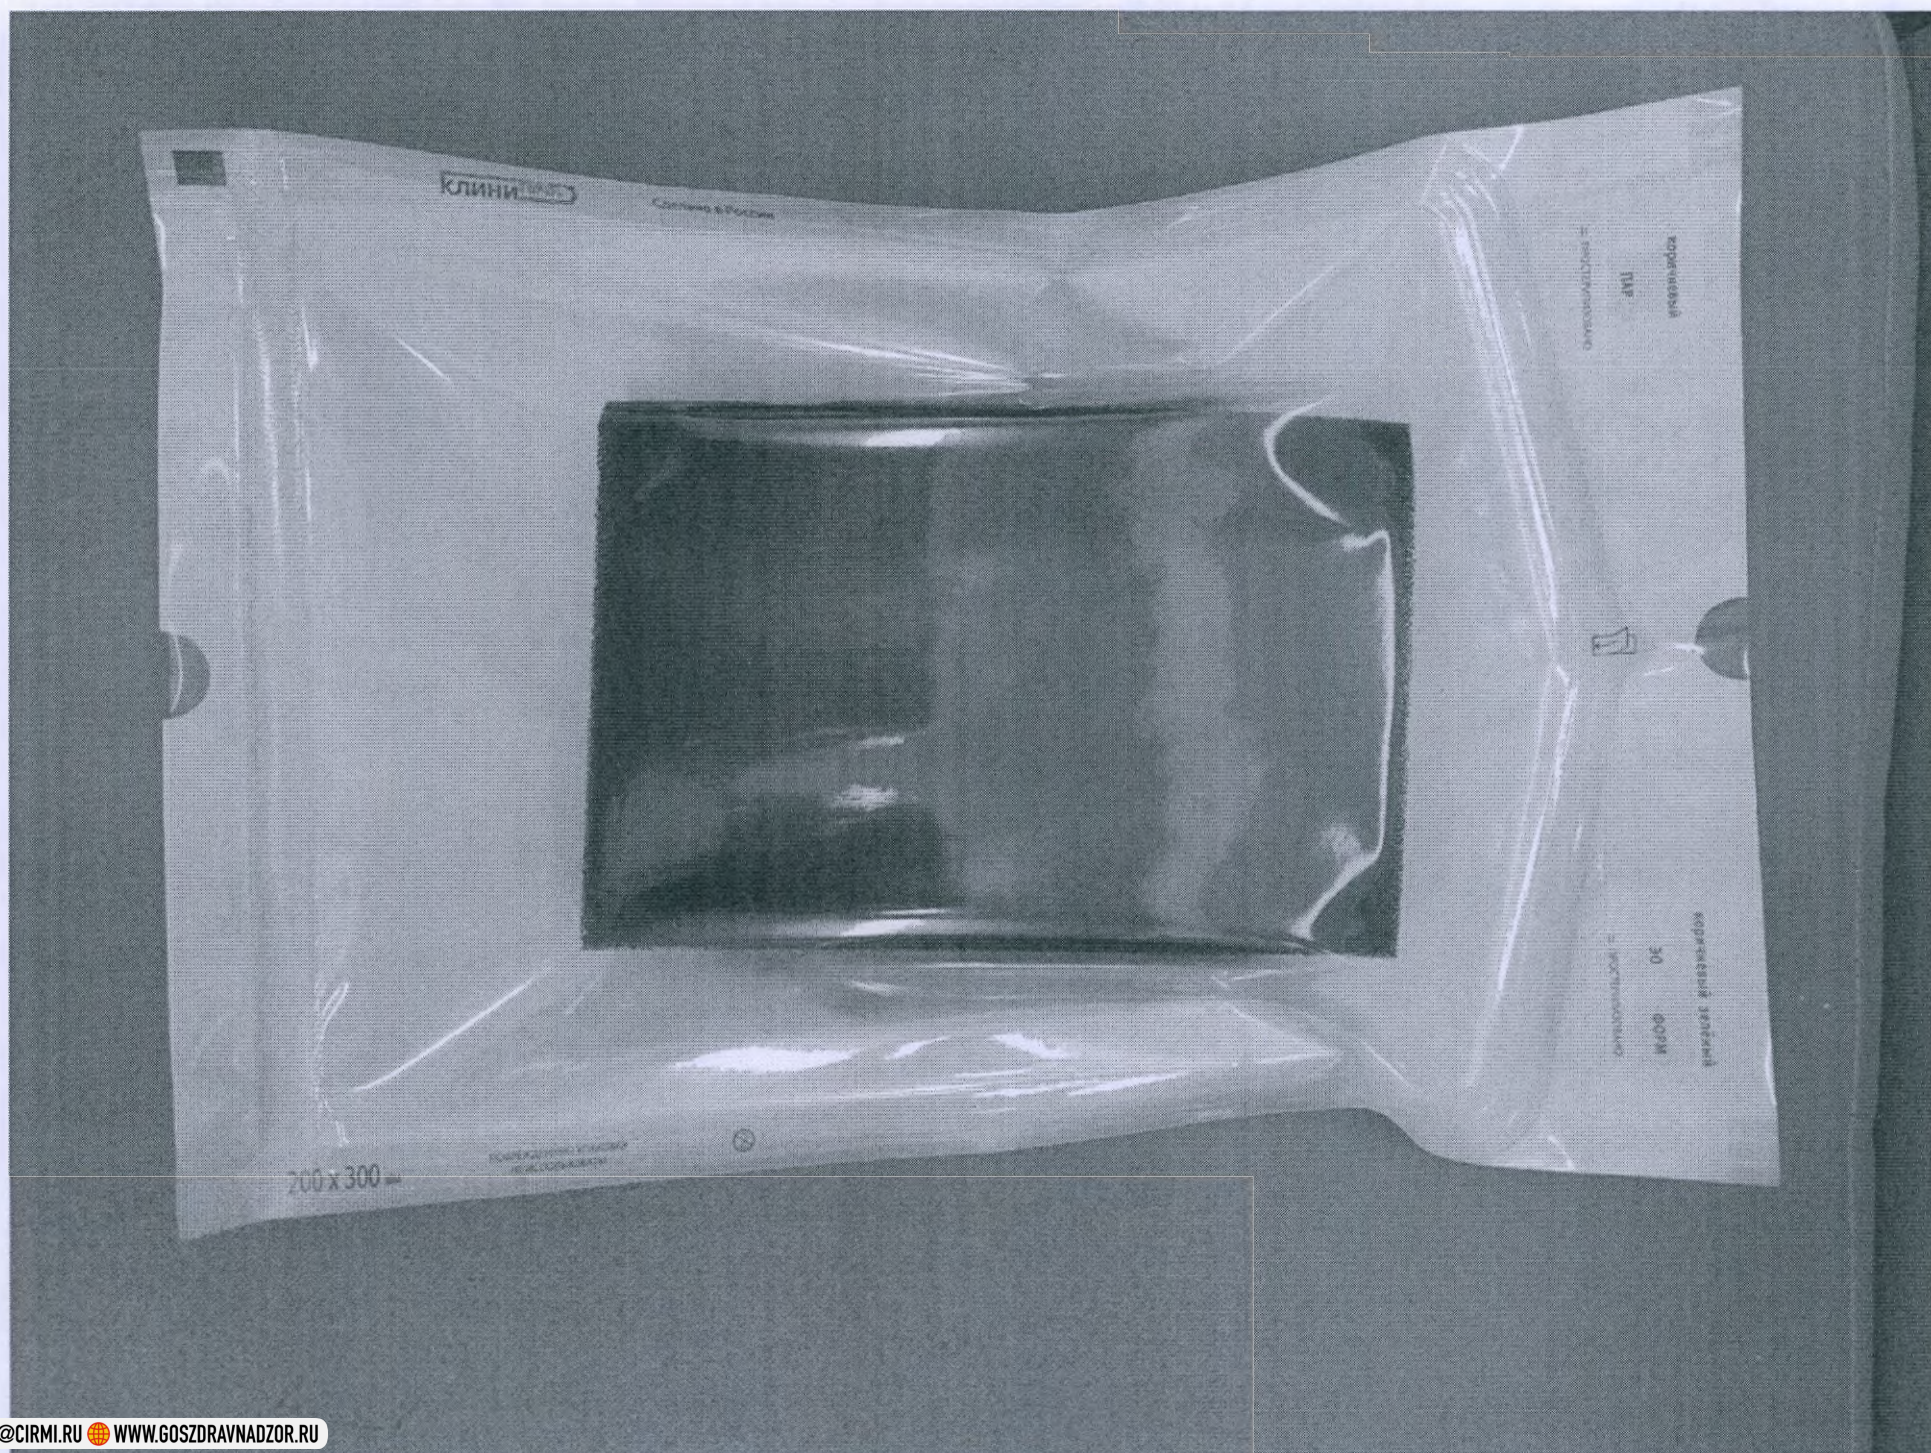

1.5. Повязка-губка для ран, размеры S - не более 200 шт. (при необходимости).



1.6. Повязка-губка для ран, размер М - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Повязка-губка для ран

Применяется с:

Размер

	S
V	M
	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT

Партия №

SN

№

 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

1.6. Повязка-губка для ран, размер М - не более 200 шт. (при необходимости). (Упаковка)



1.6. Повязка-губка для ран, размер М - не более 200 шт. (при необходимости).

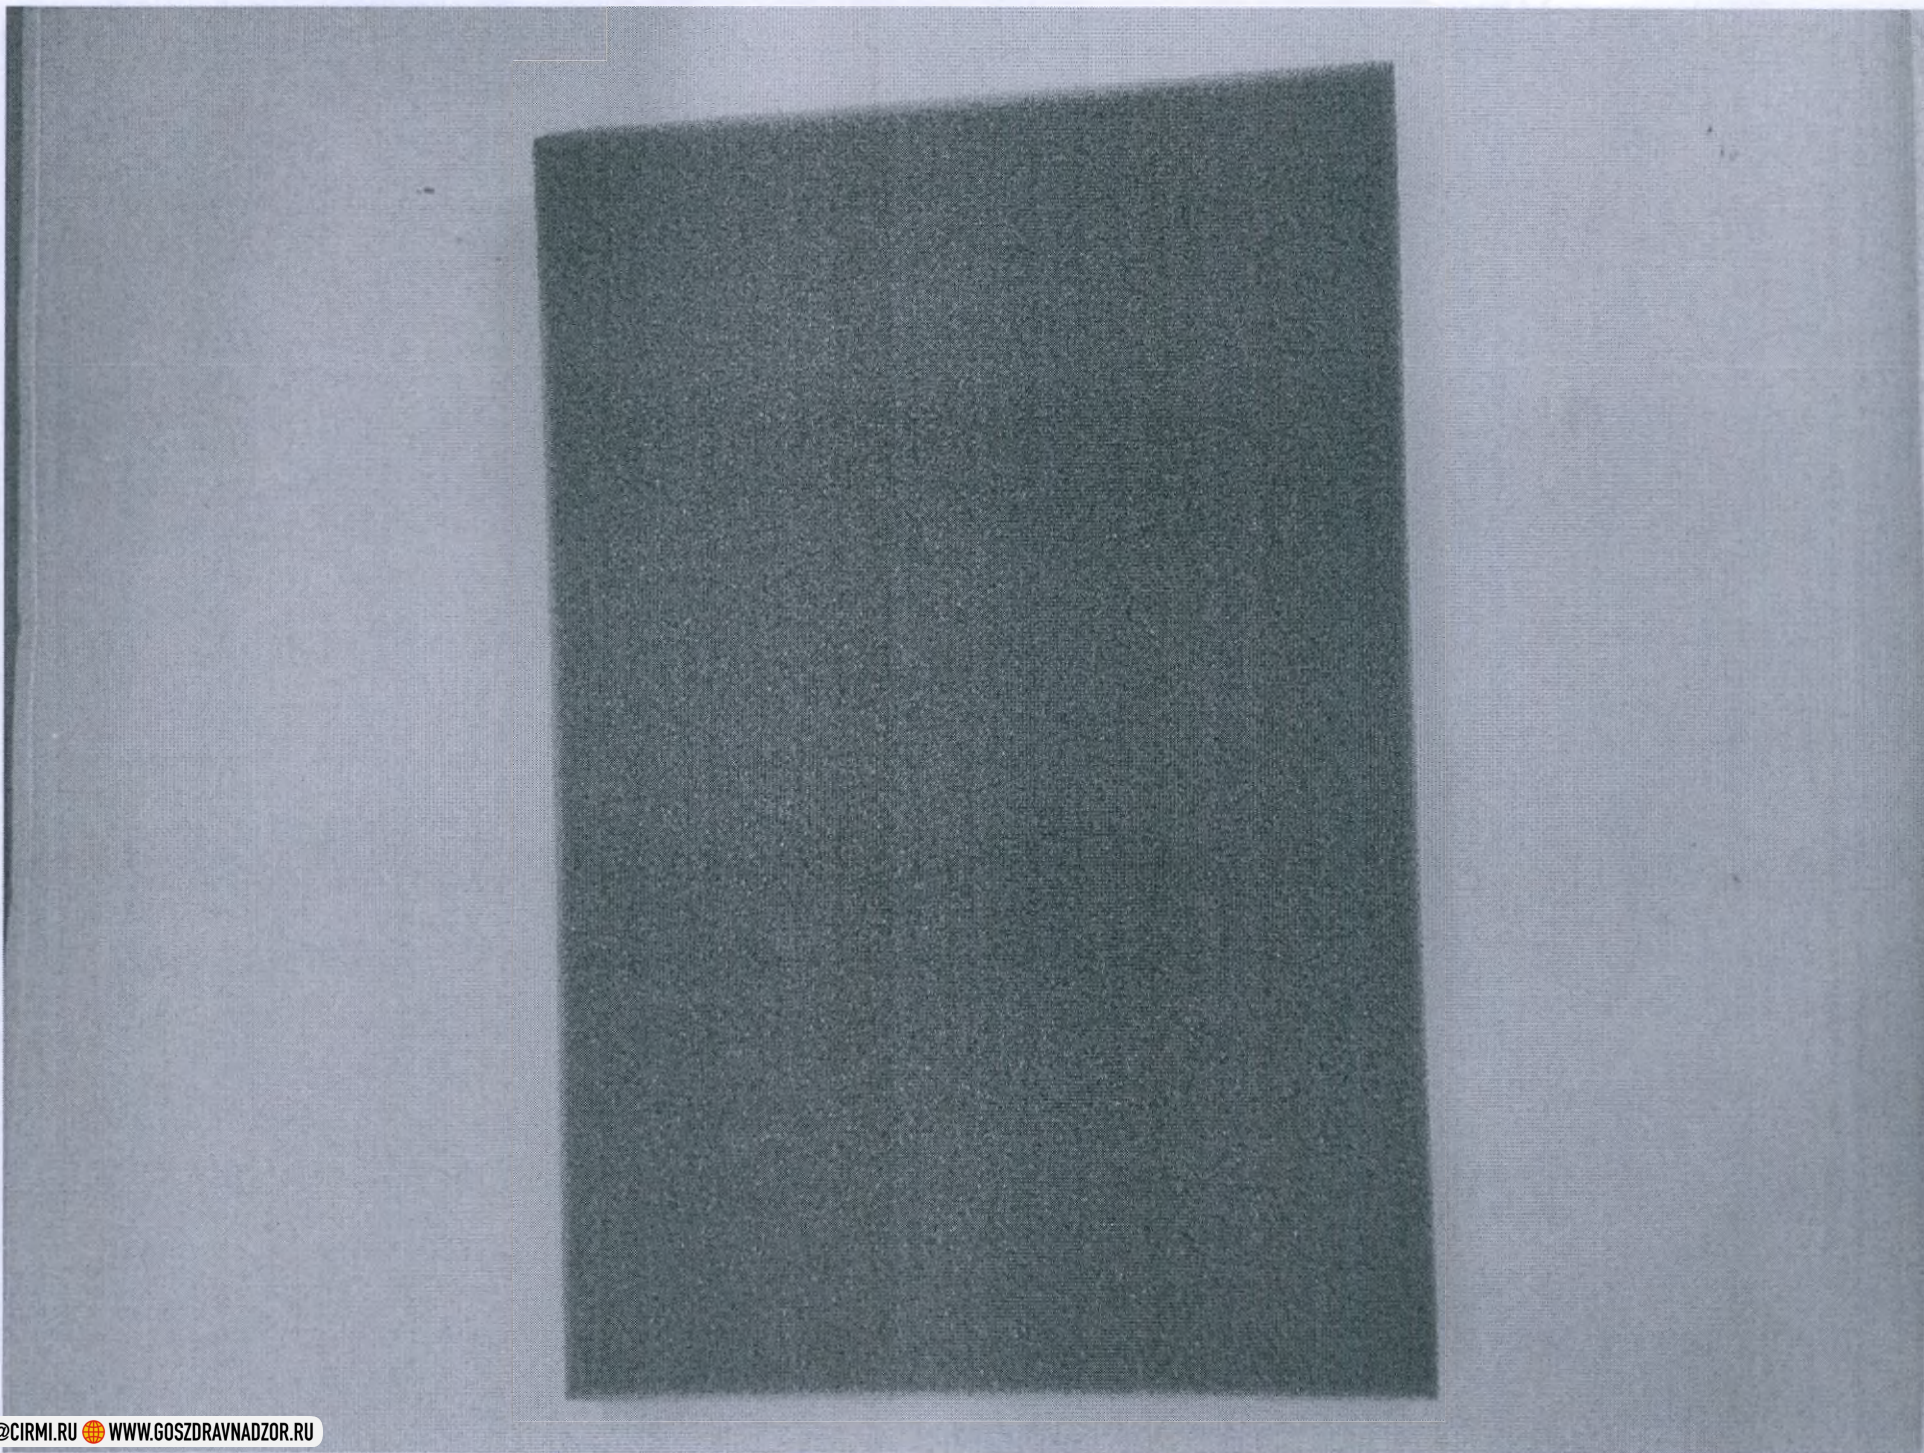

1.7. Повязка-губка для ран, размеры L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Повязка-губка для ран

Применяется с:

Размер	
☐	S
☐	M
☐	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT

Партия №

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апирогенно.




STERILE R

1.7. Повязка-губка для ран, размеры L - не более 200 шт. (при необходимости). (Упаковка)

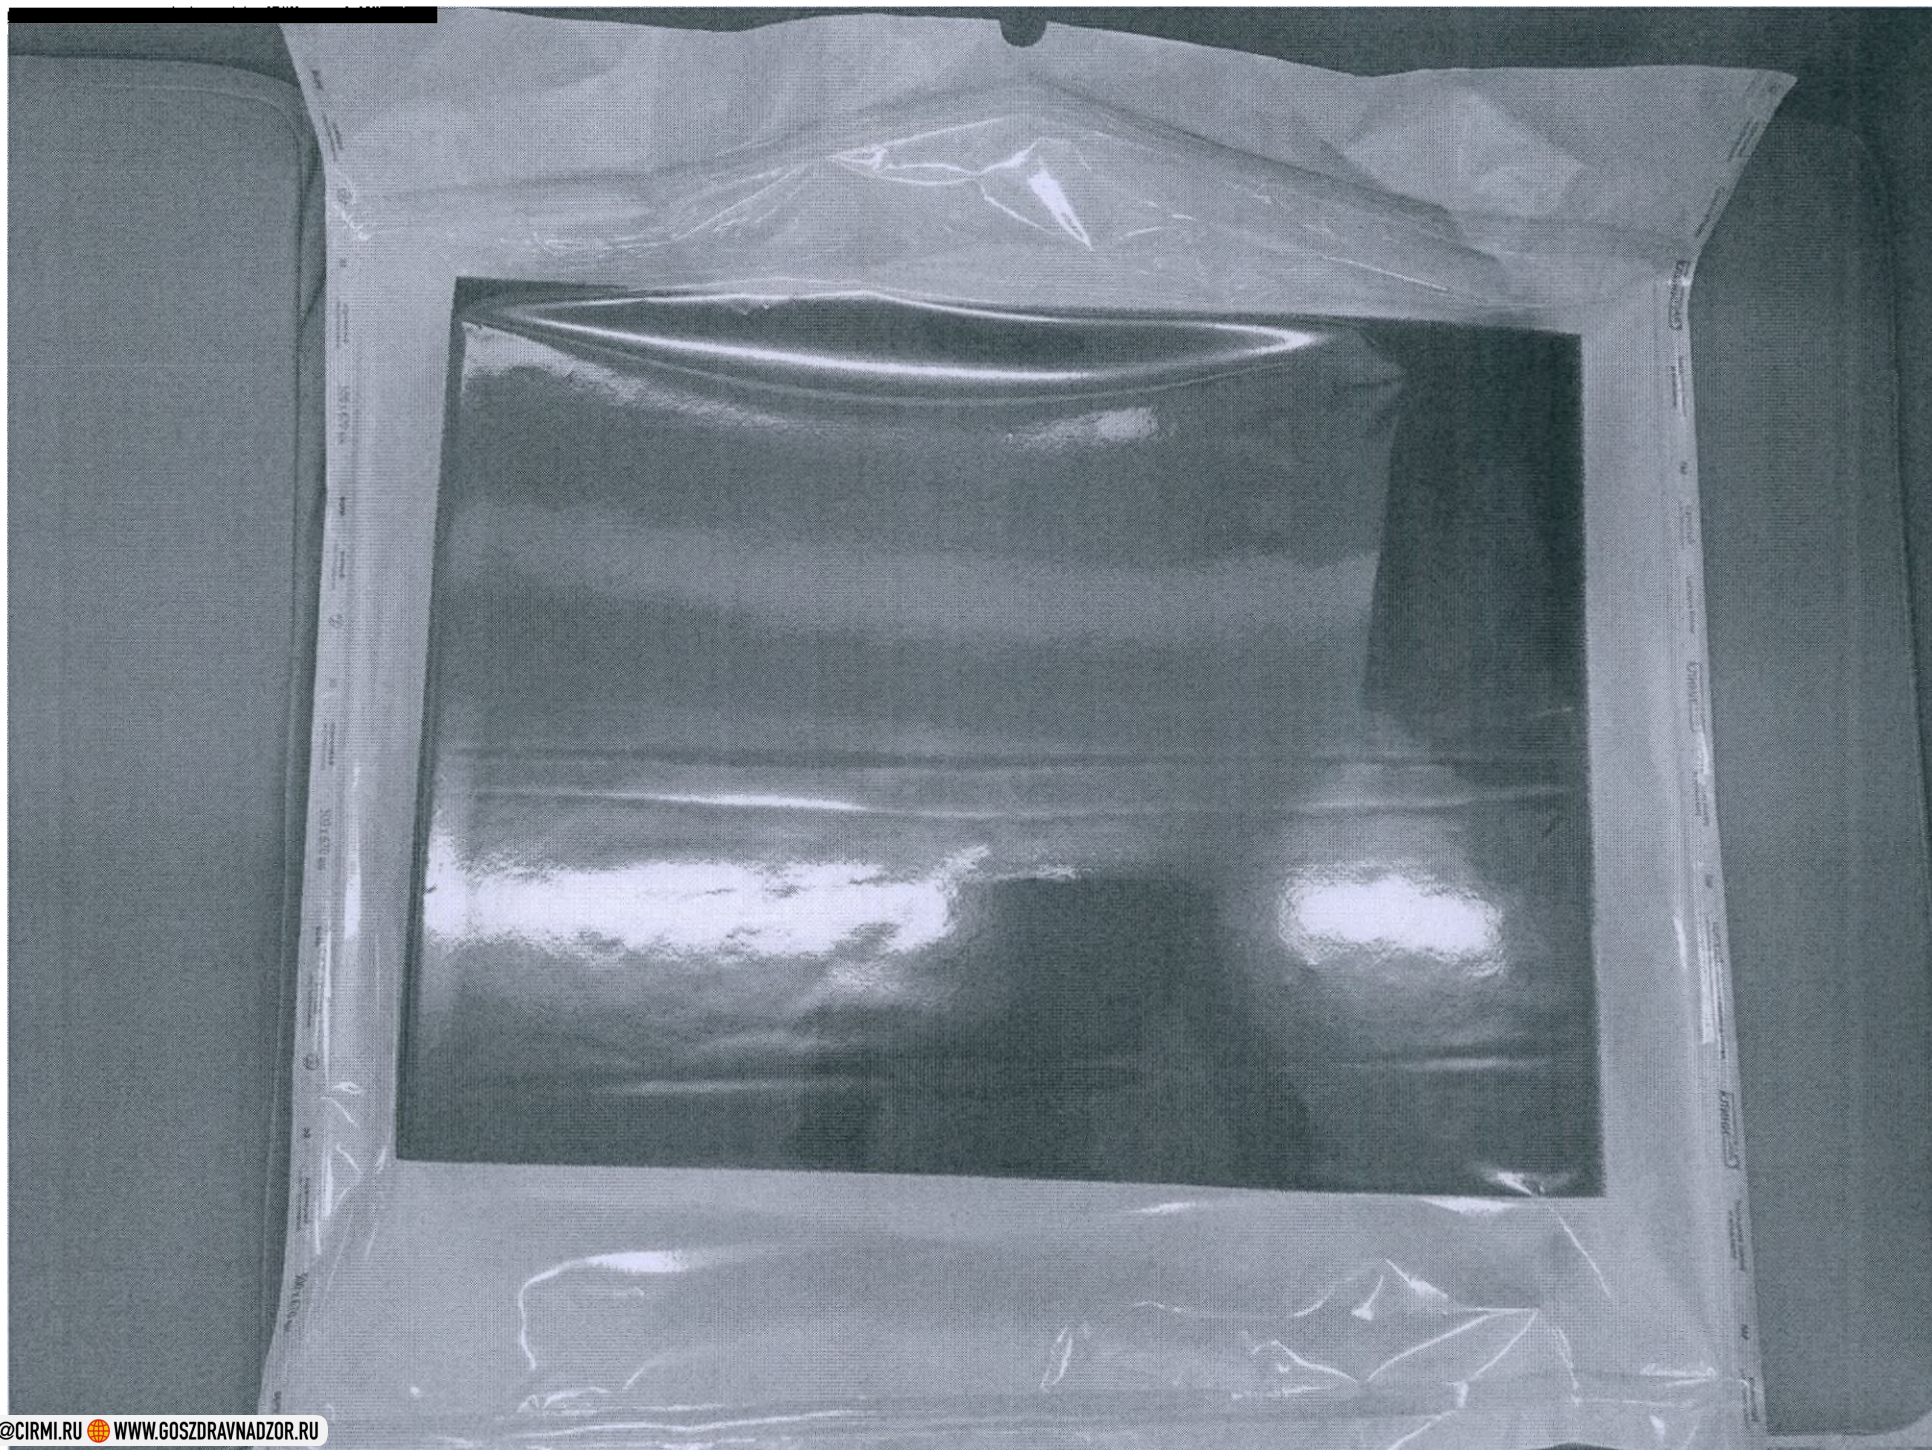

1.7. Повязка-губка для ран, размеры L - не более 200 шт. (при необходимости).

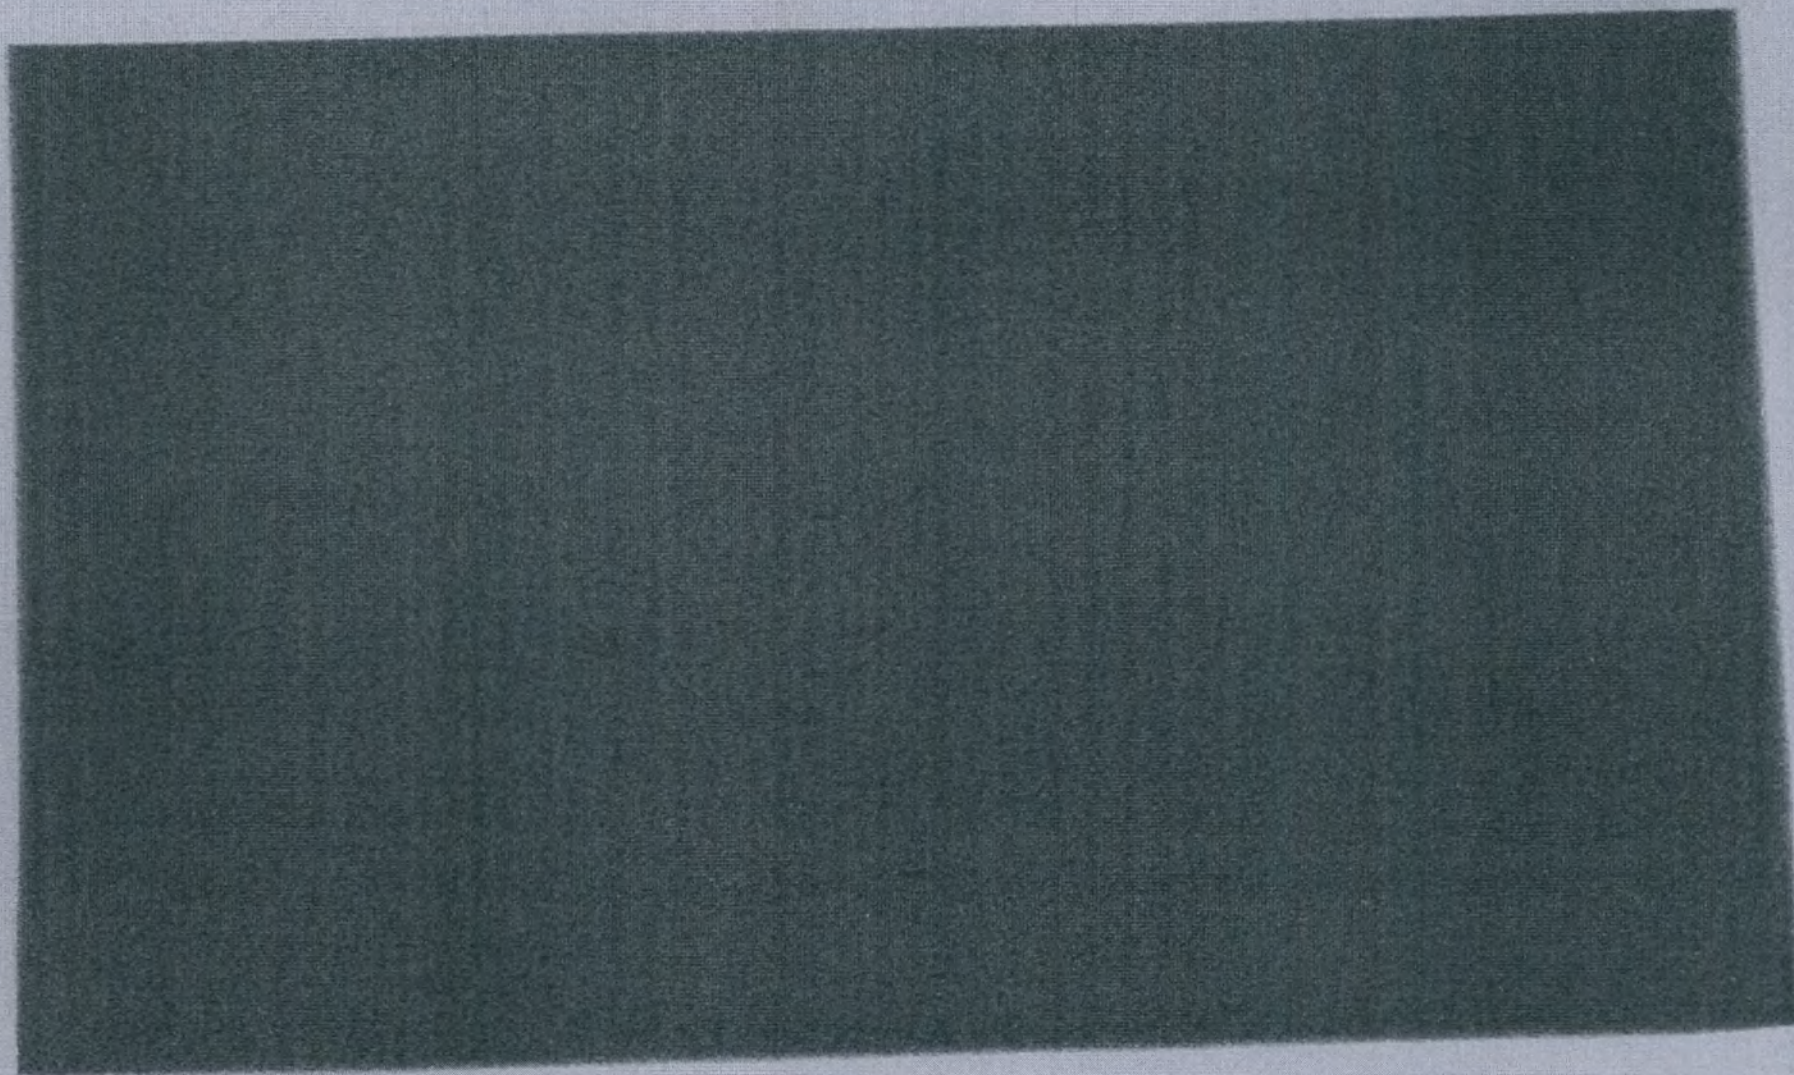

1.8. Порт дренажный - не более 200шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3,123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

1.8. Порт дренажный - не более 200шт. (при необходимости). (Упаковка)

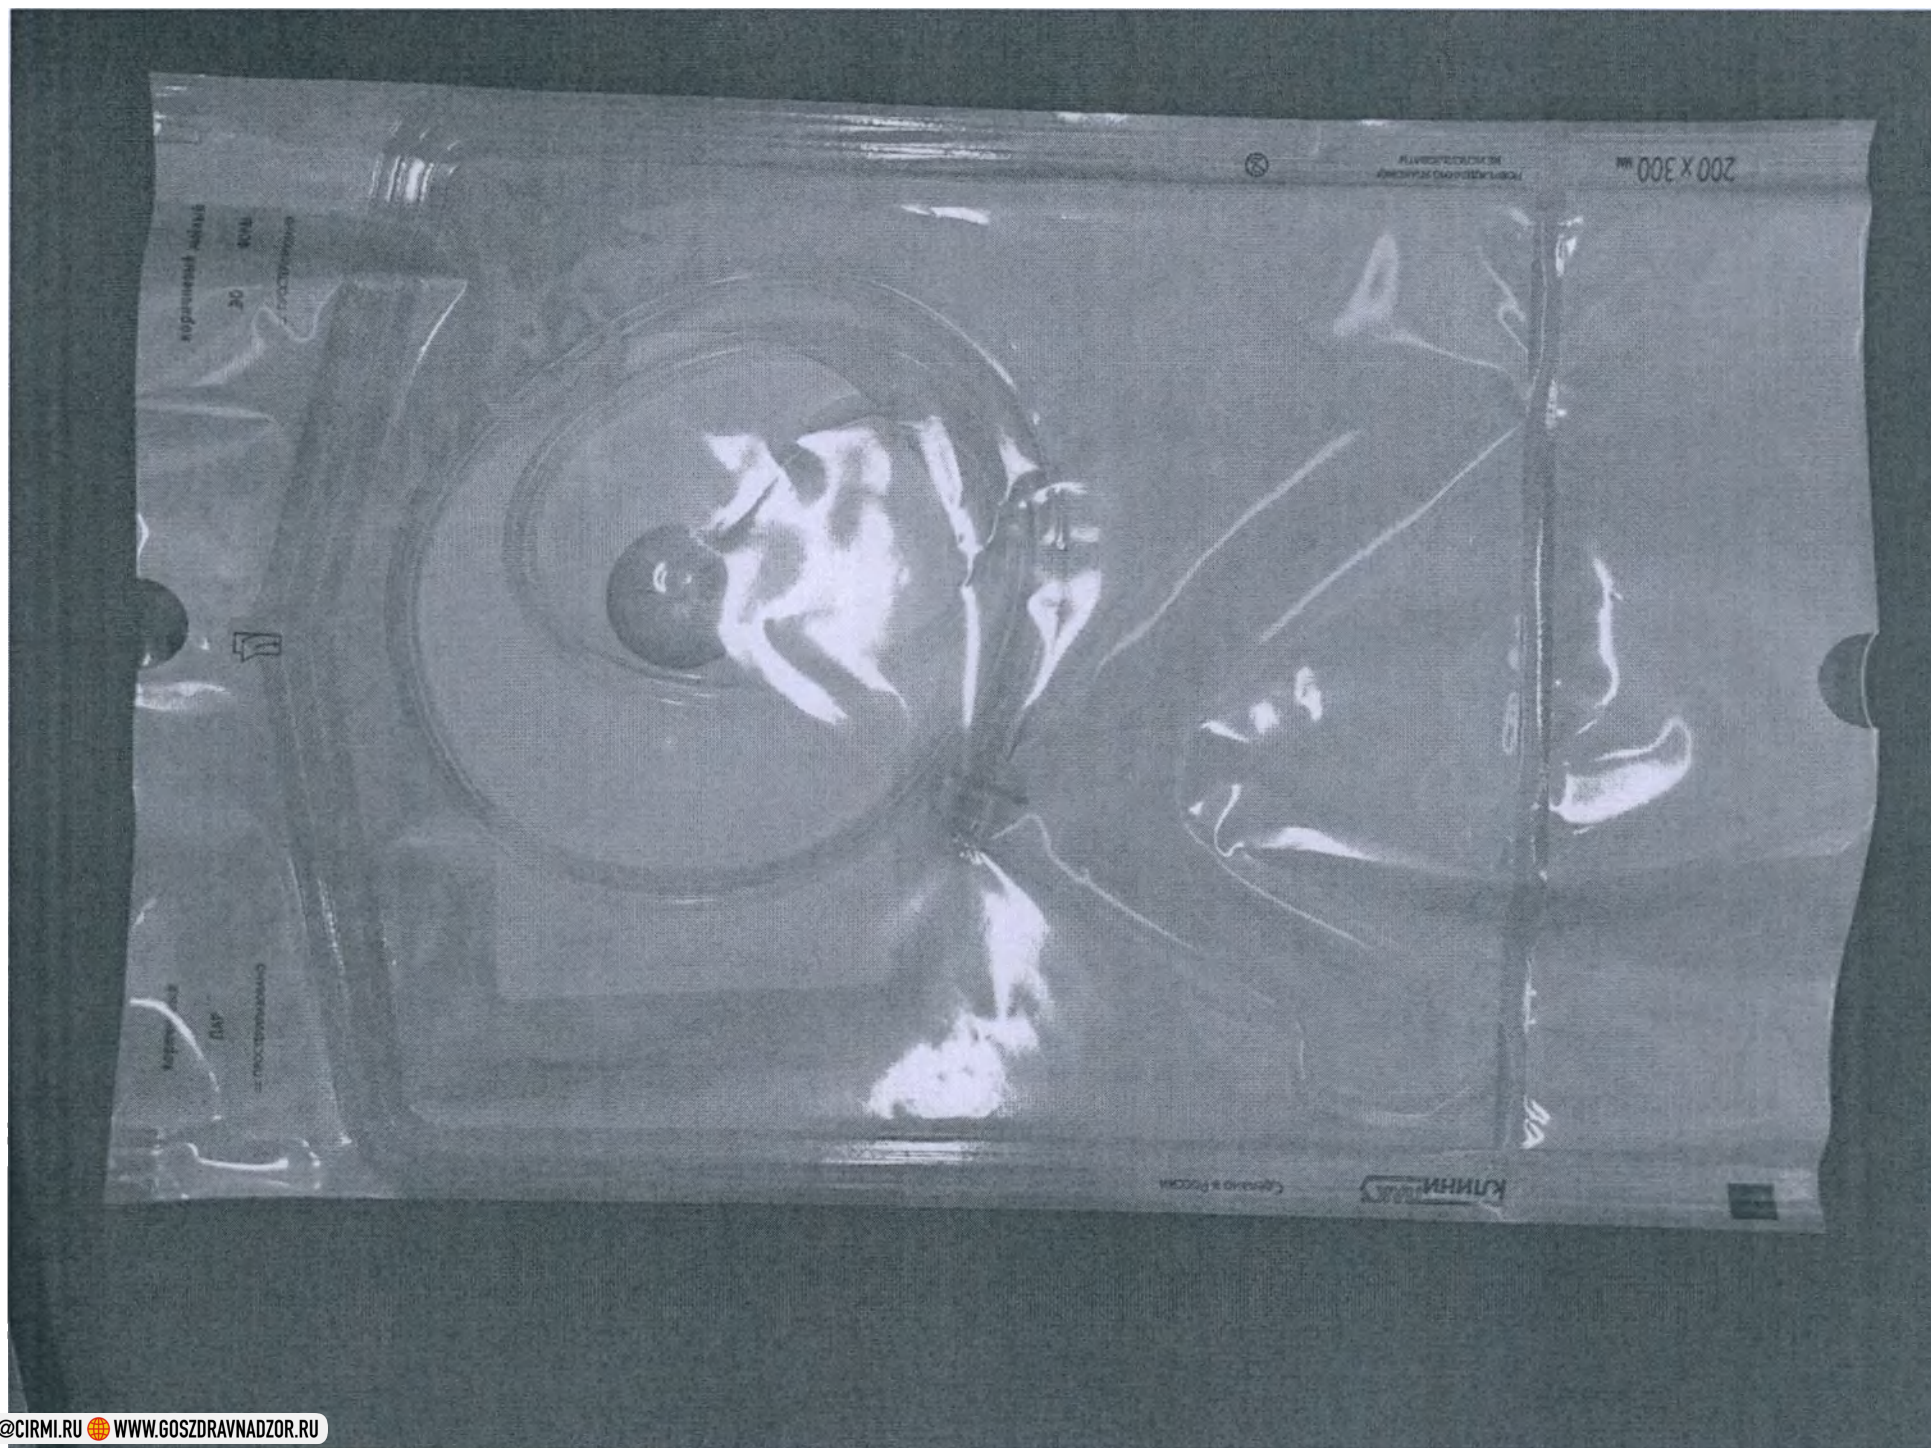

1.8. Порт дренажный - не более 200шт. (при необходимости).

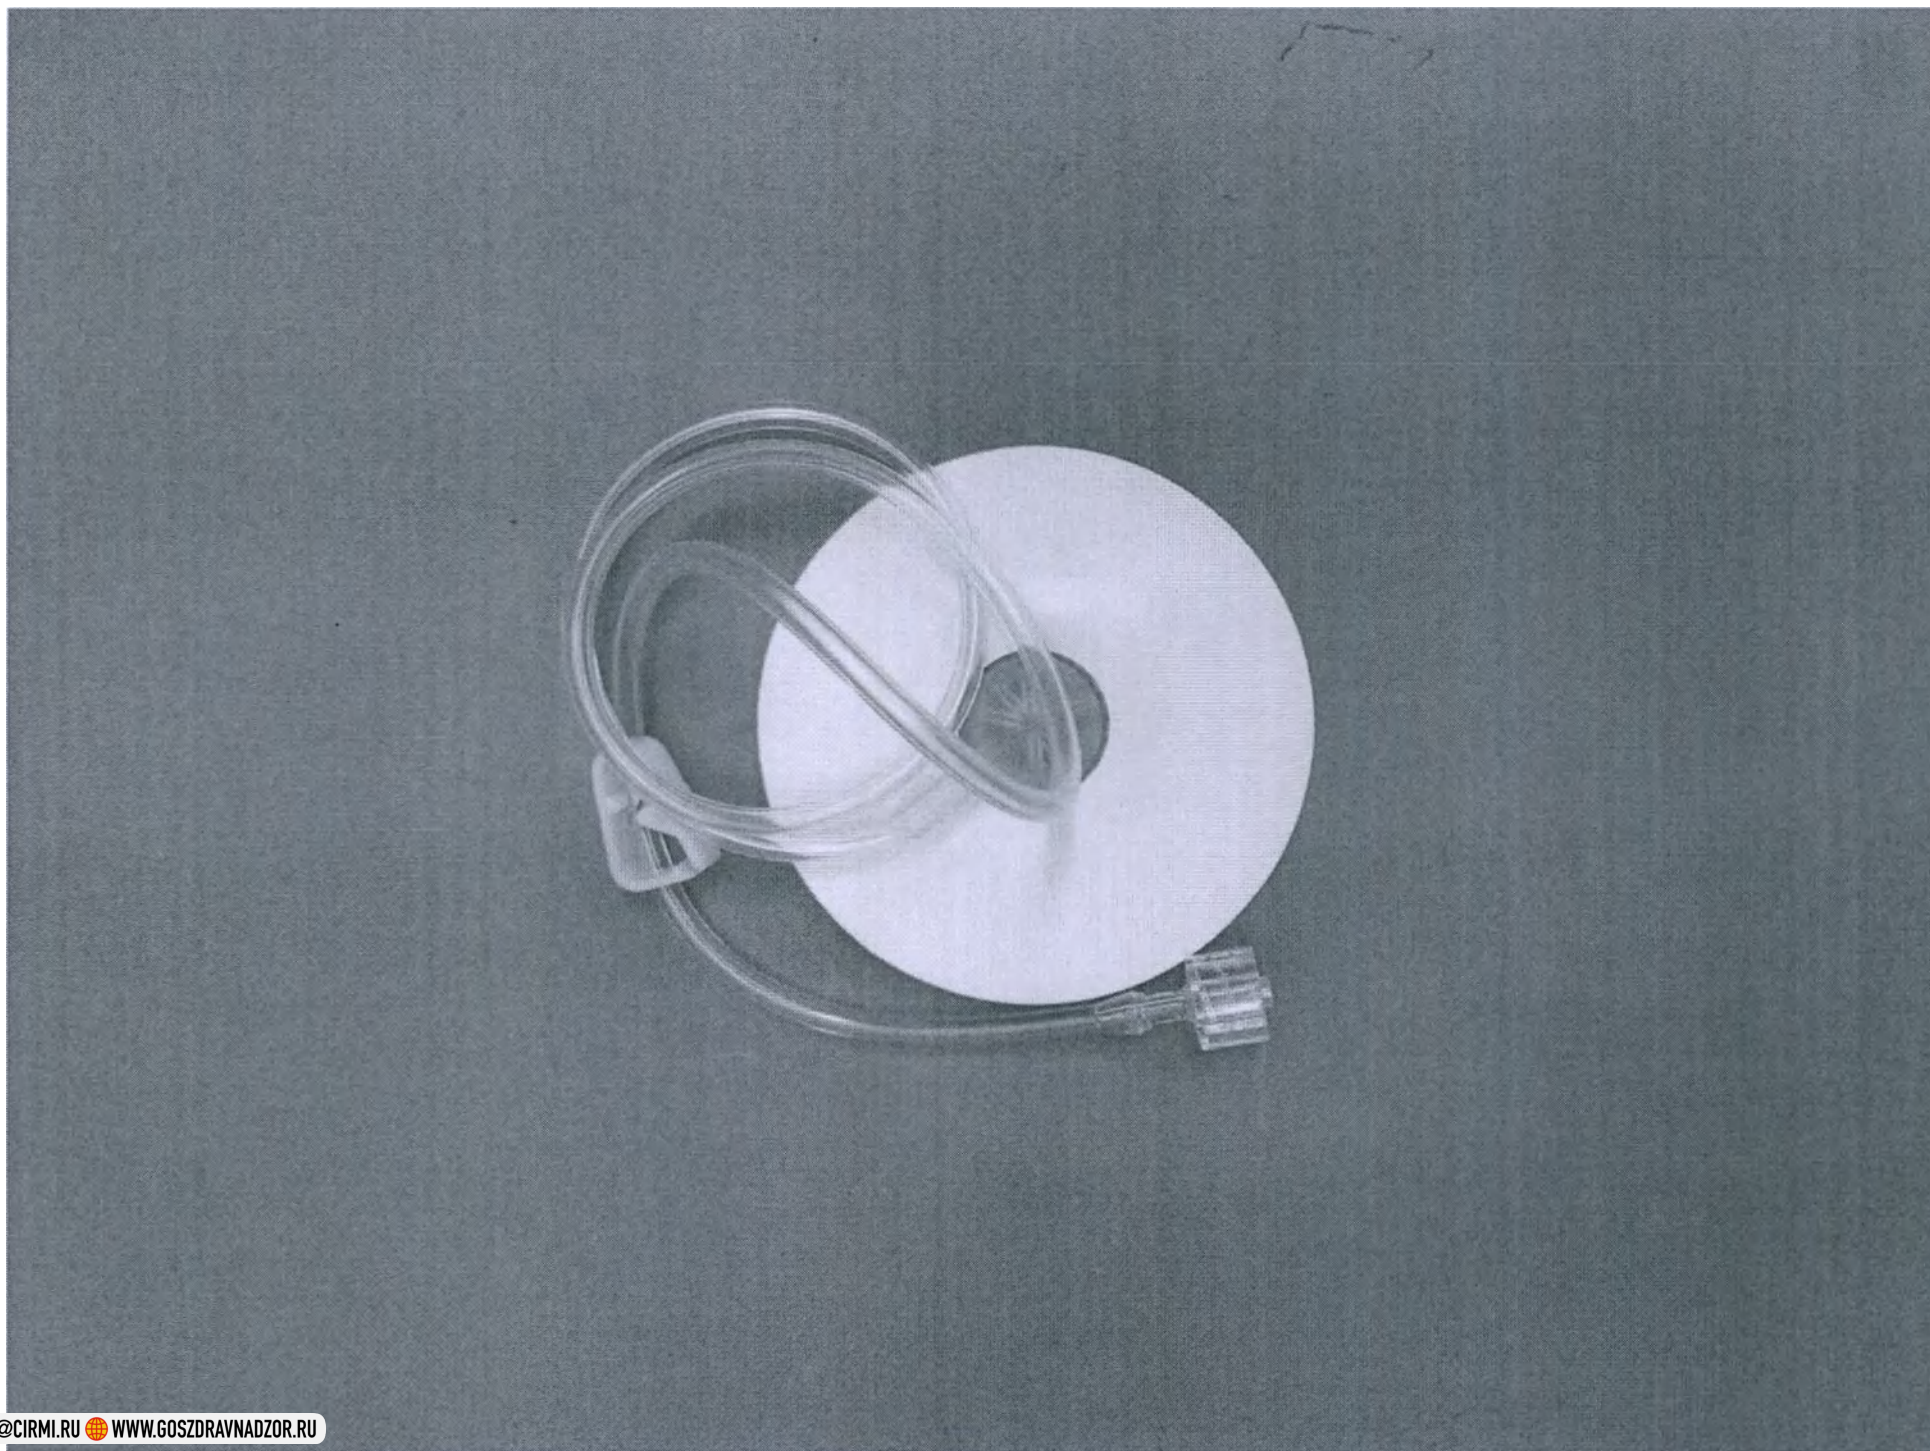

1.9. Порт дренажный мягкий - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный мягкий

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

1.9. Порт дренажный мягкий - не более 200 шт. (при необходимости). (Упаковка)

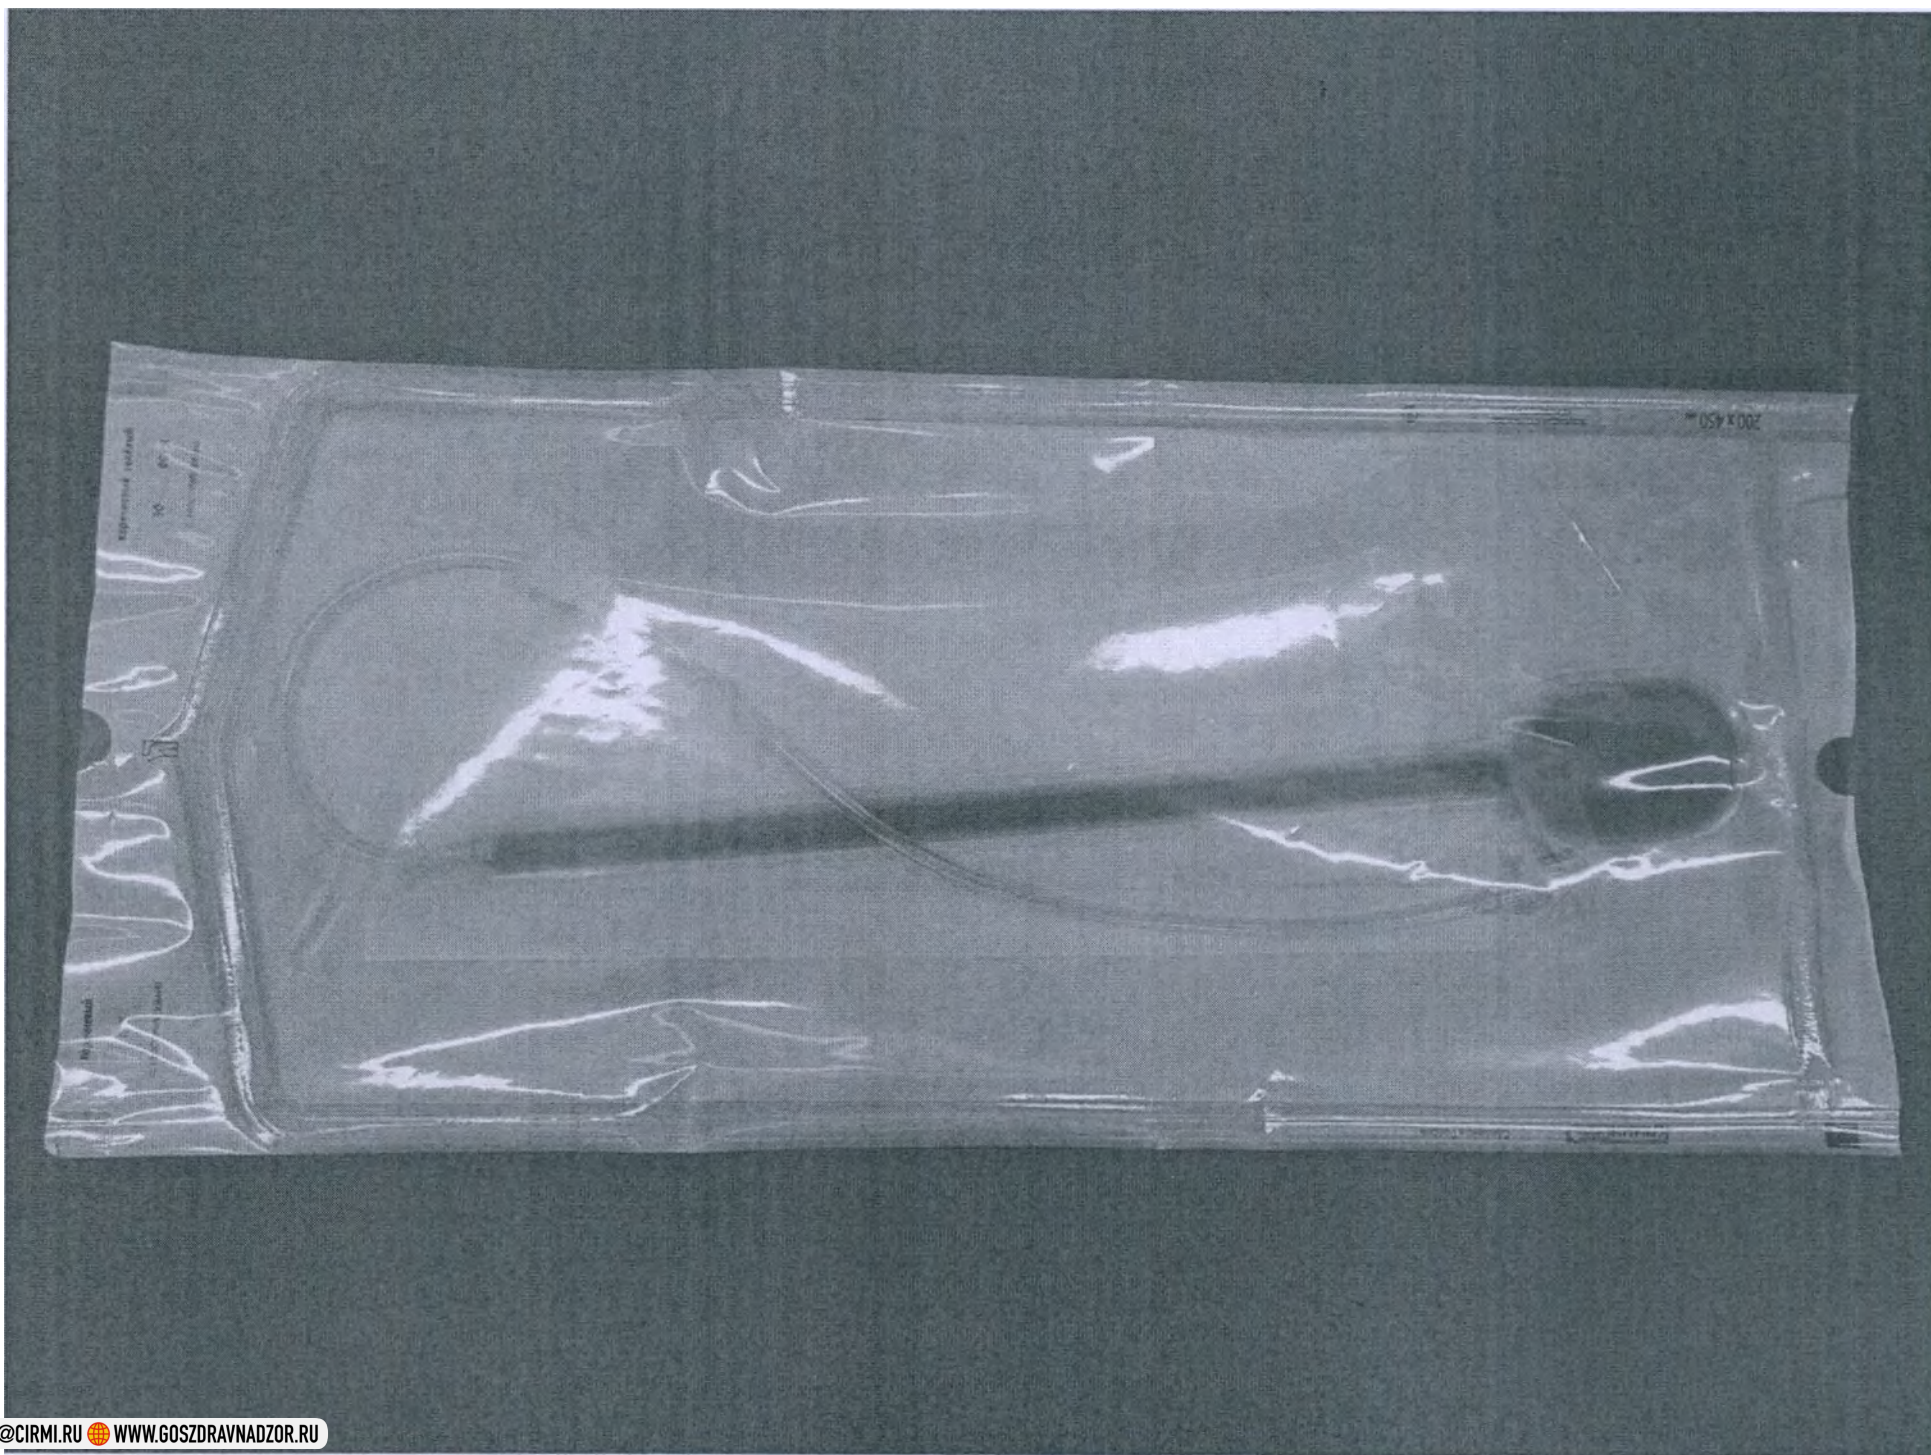

1.9. Порт дренажный мягкий - не более 200 шт. (при необходимости).

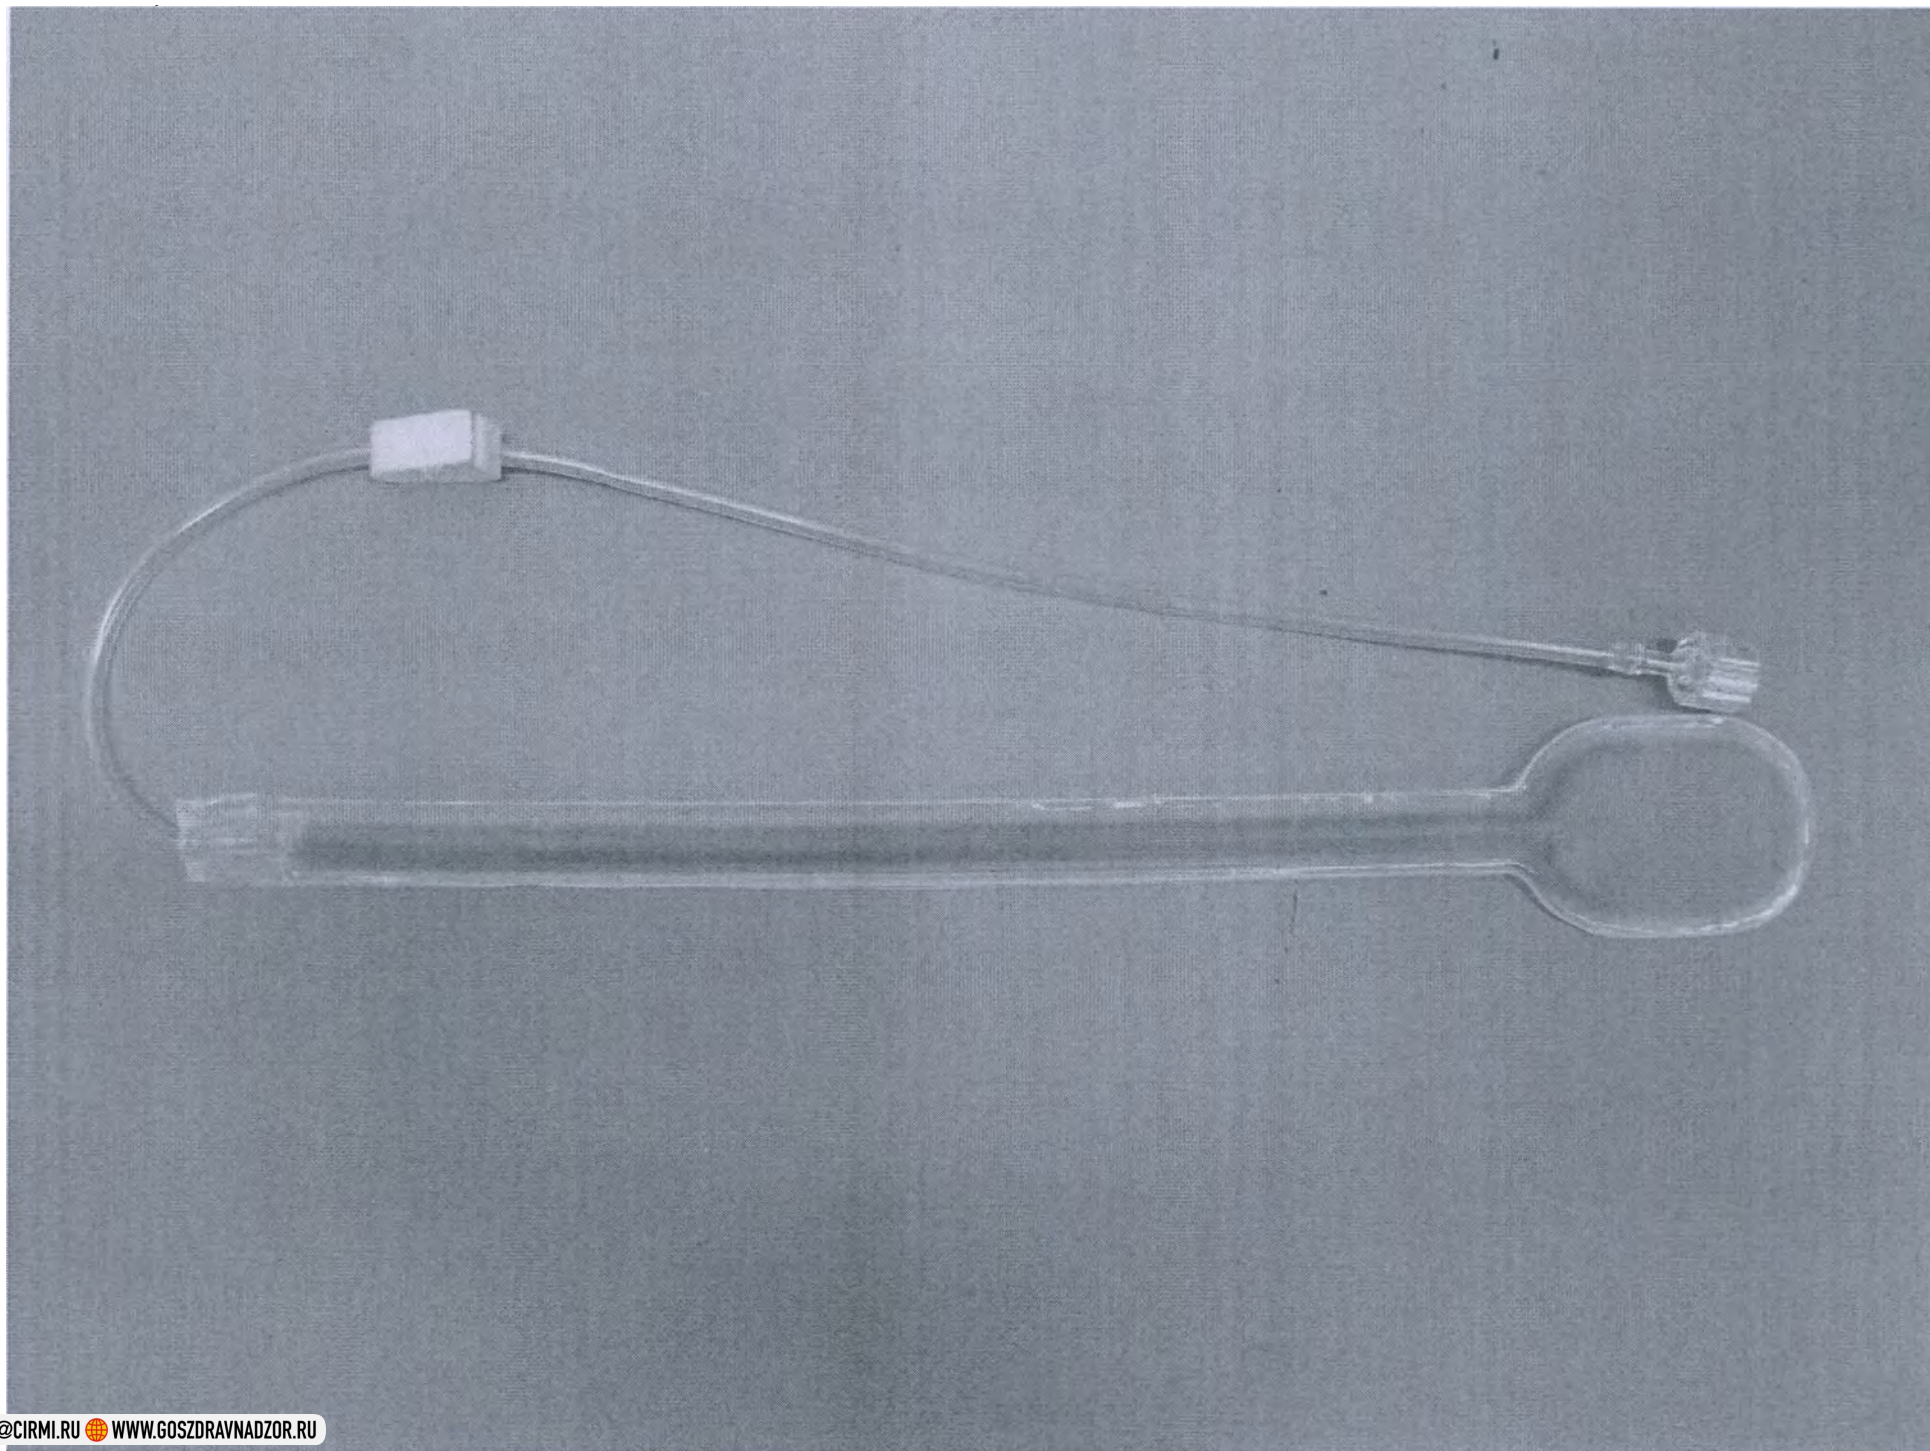

1.10. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный впитывающий

Применяется с:

Размер

V	S
	M
	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

1.10. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).

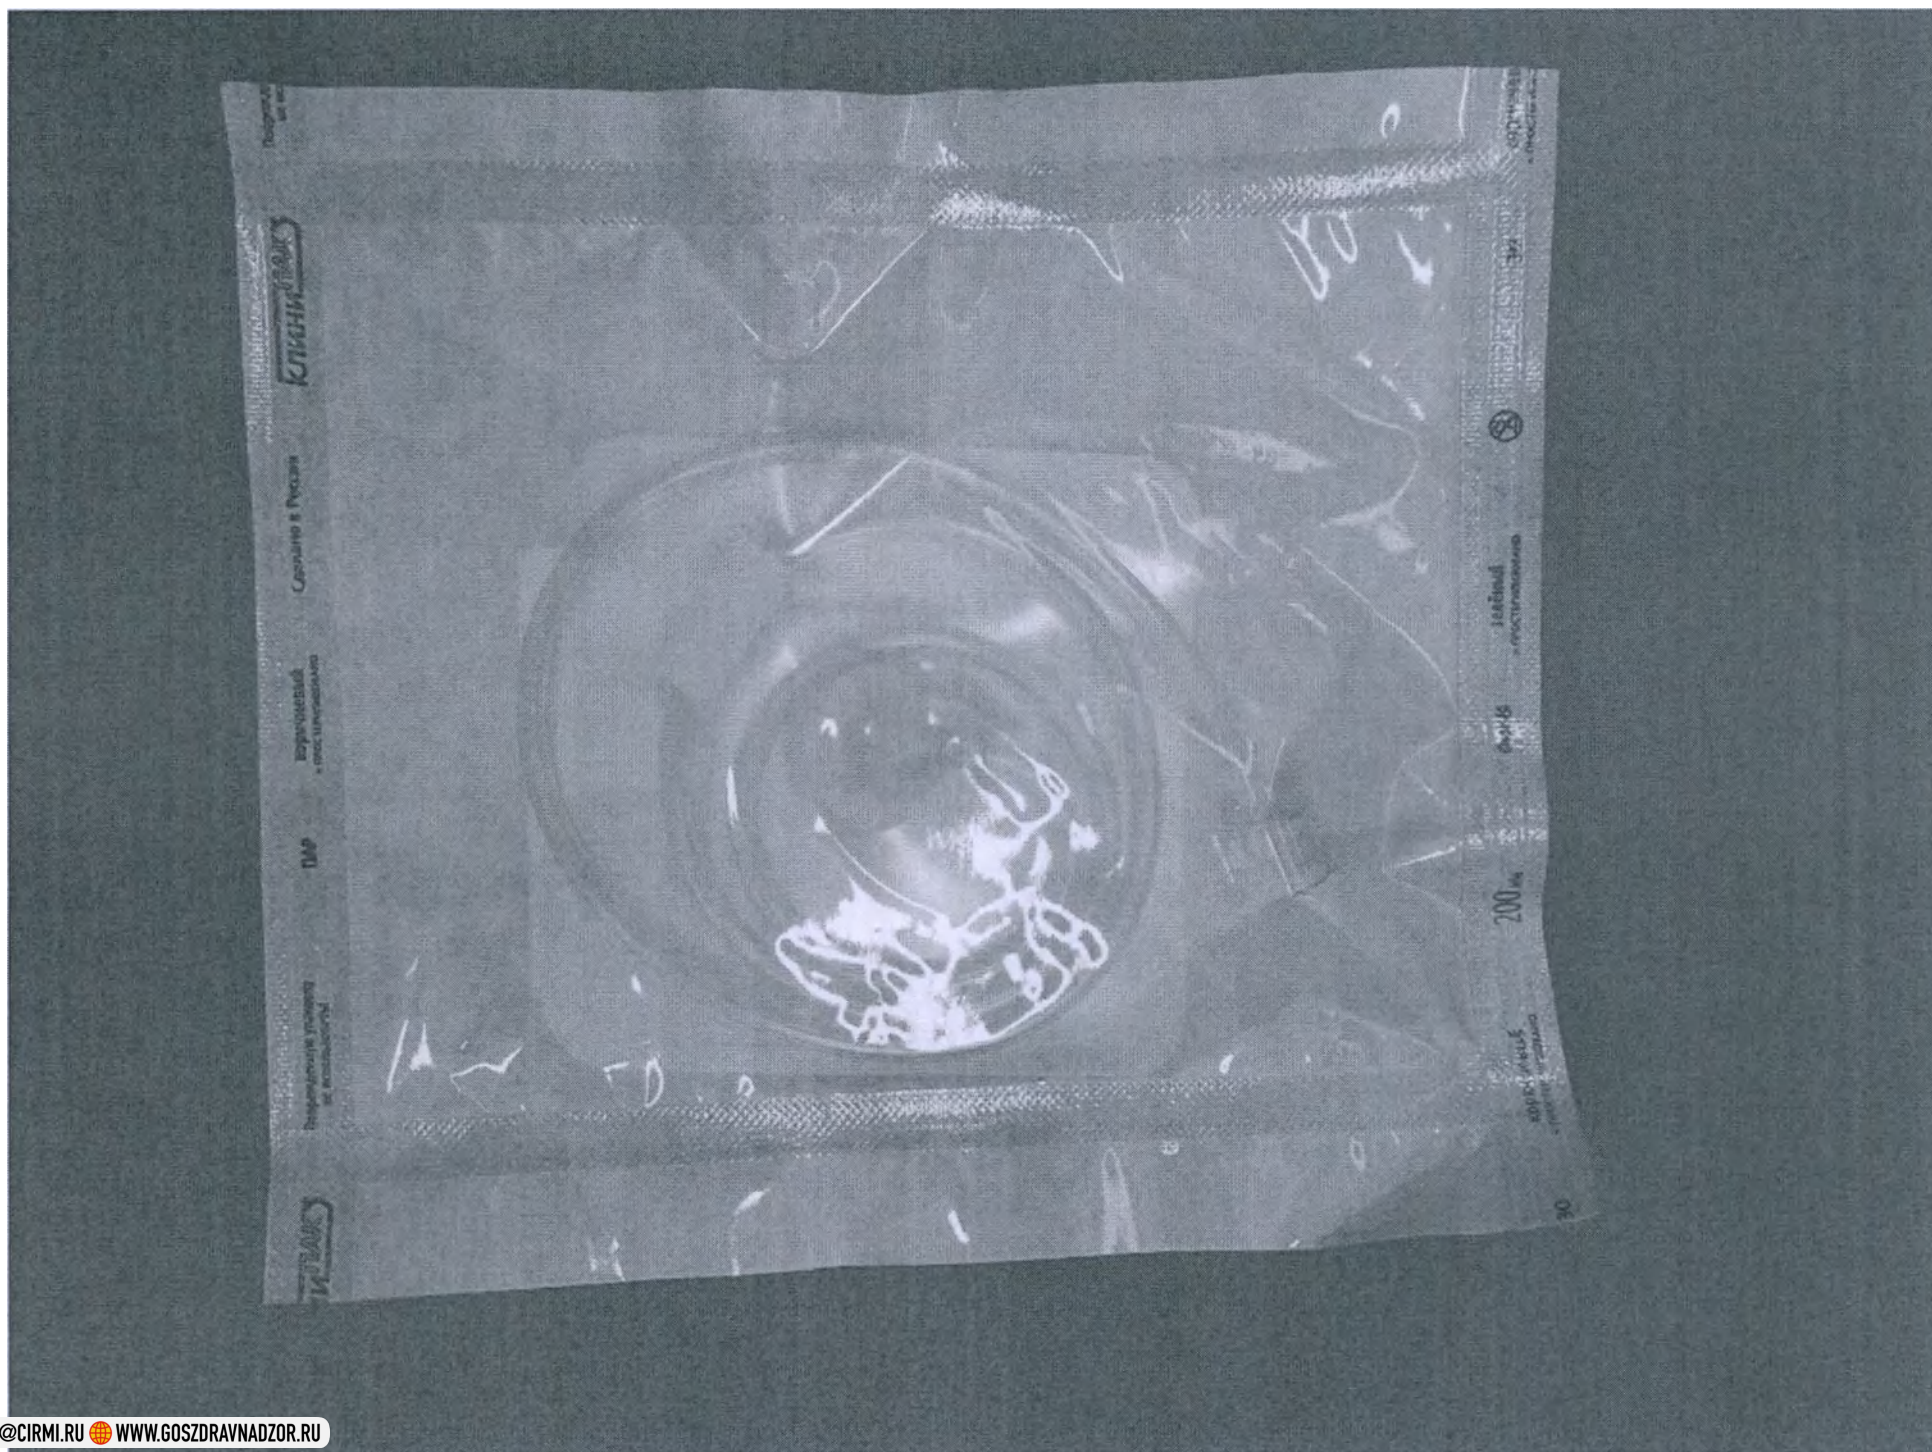

1.10. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).

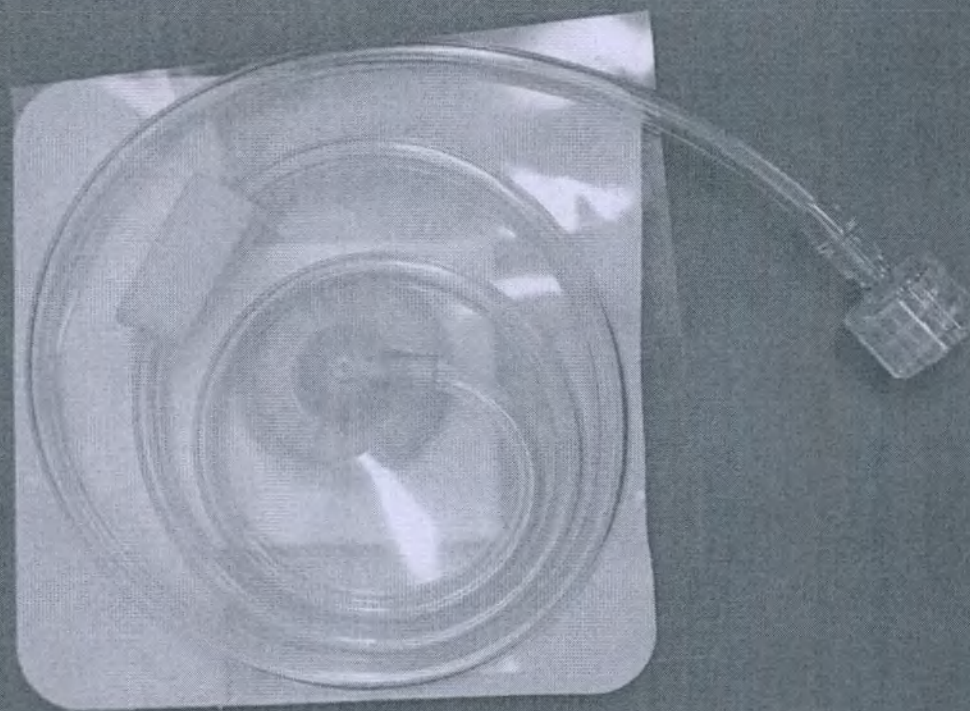

1.10. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный впитывающий

Применяется с:

Размер

	S
V	M
	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT

Партия №

SN

№

 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

1.10. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).



1.10. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).

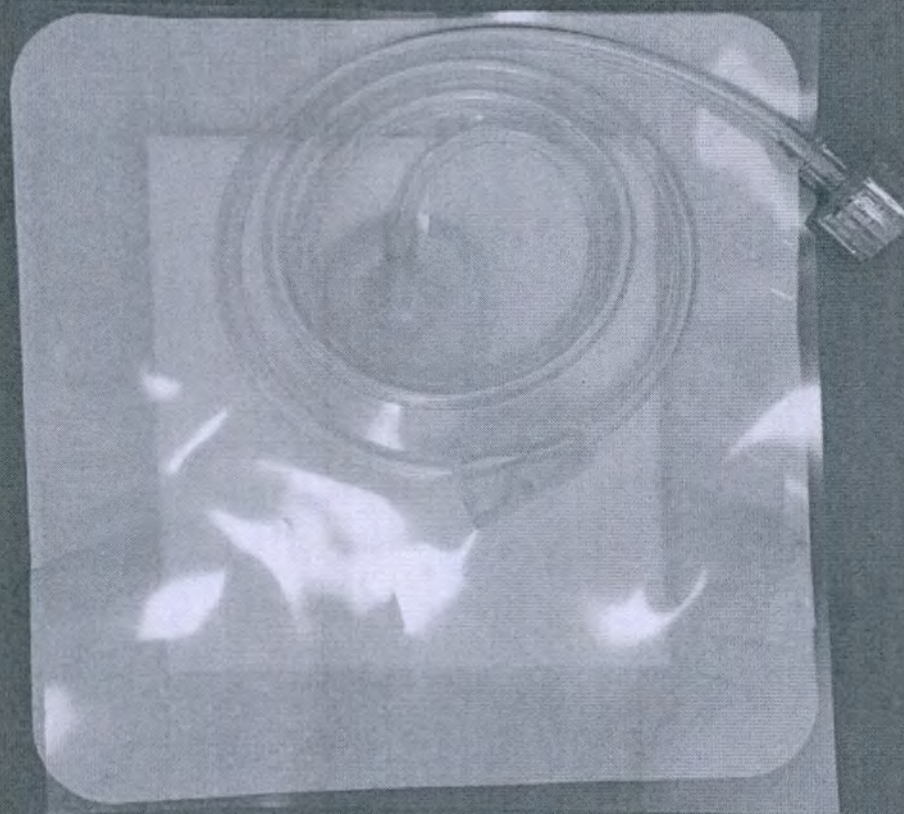

1.10. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный впитывающий

Применяется с:

Размер

☐	S
☐	M
☒	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT

Партия №

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

1.10. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Упаковка)

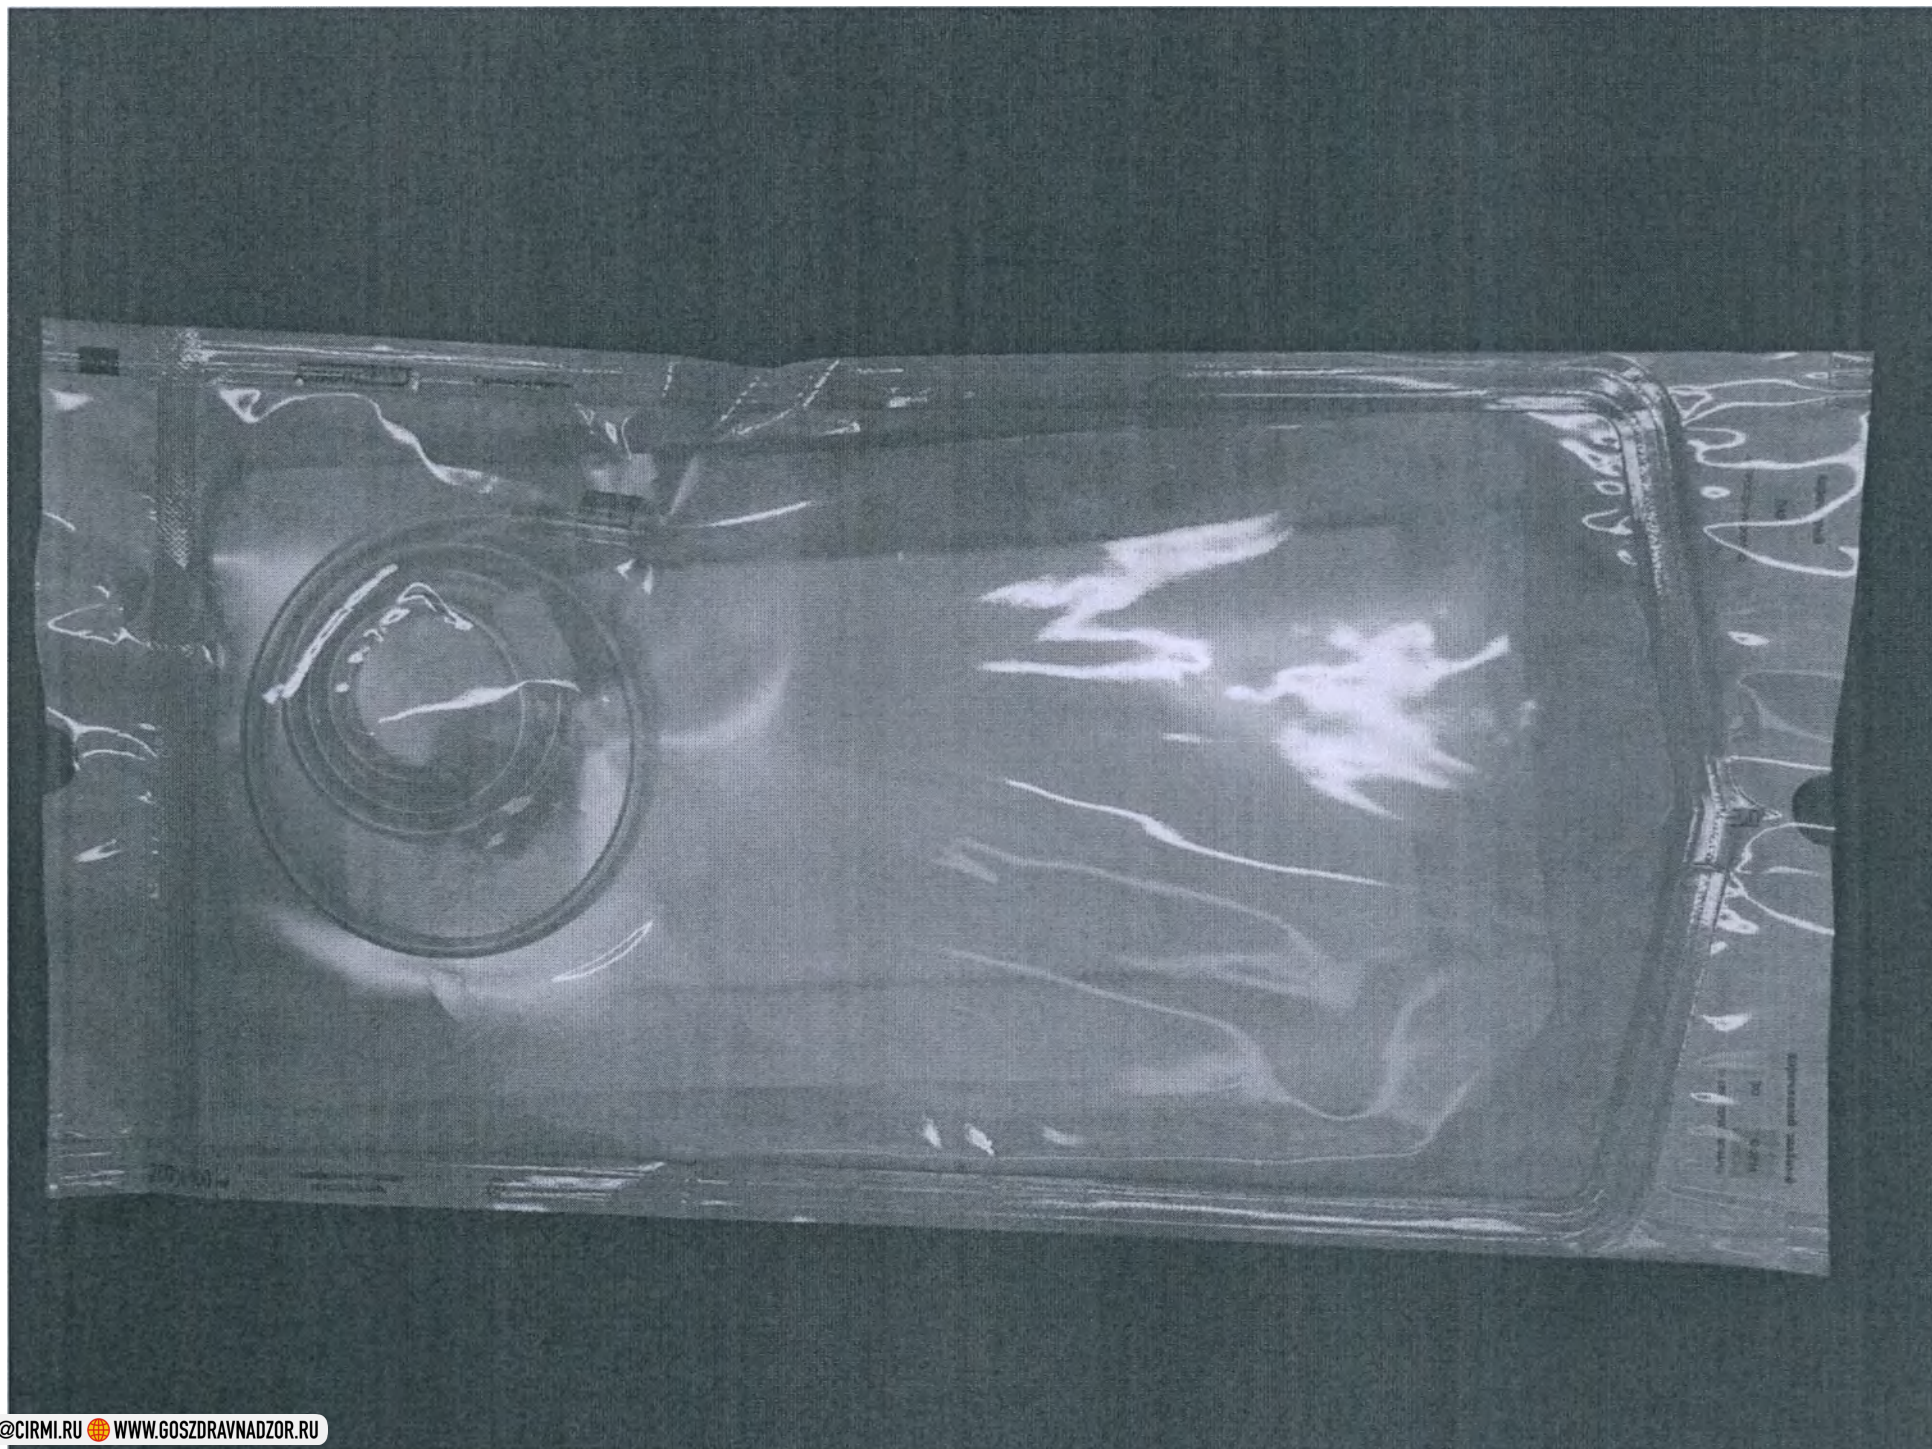

1.10. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Упаковка)

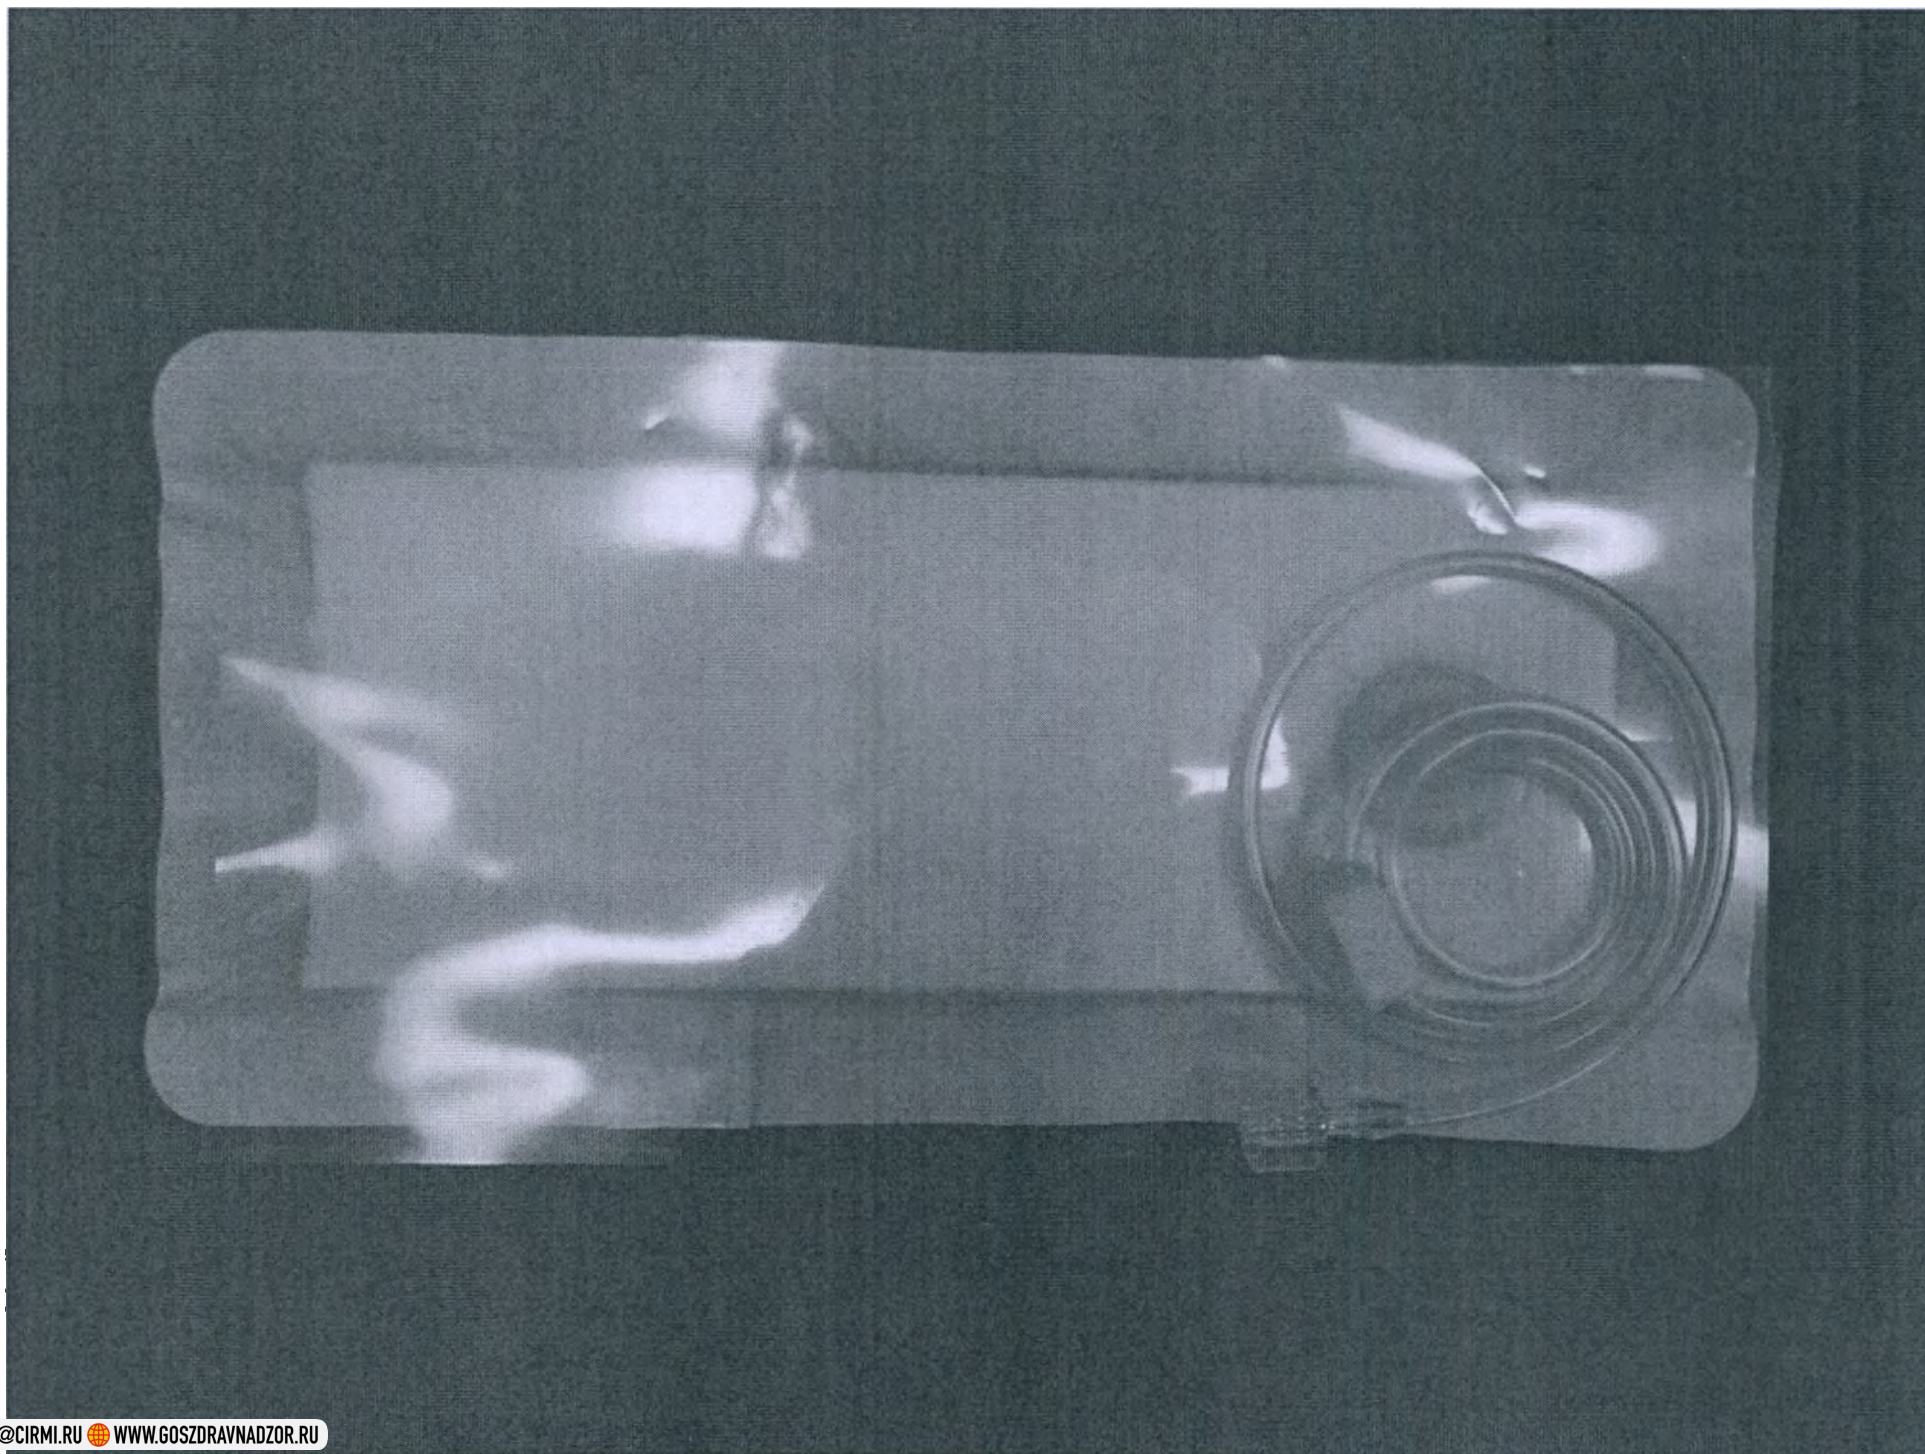

1.11. Пленка инцизная - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Пленка инцизная

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№

 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

1.11. Пленка инцизная - не более 200 шт. (при необходимости). (Упаковка)

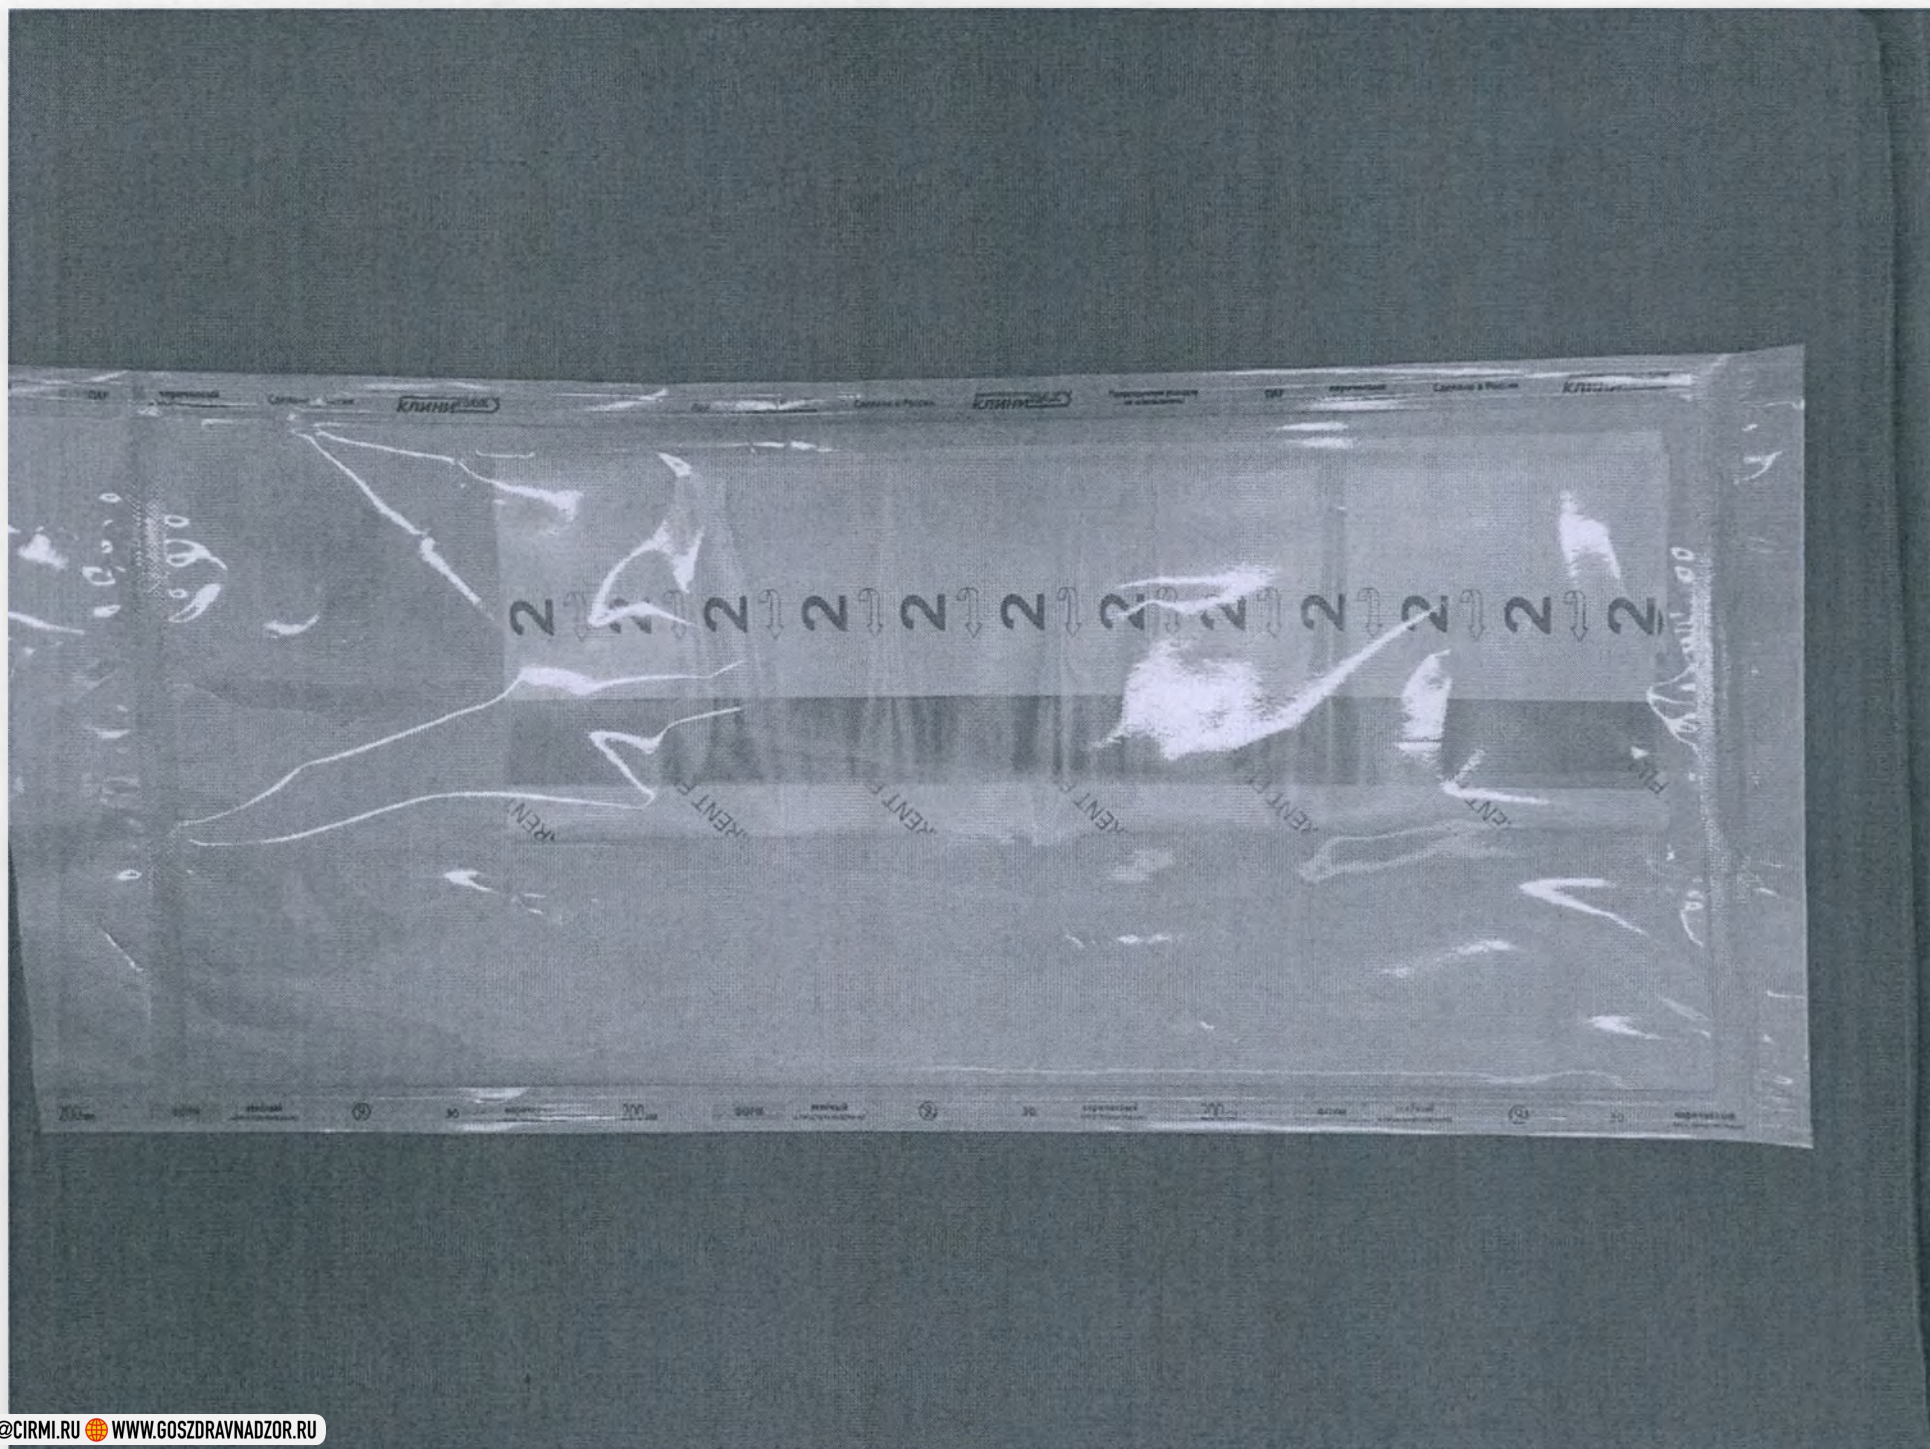

1.11. Пленка инцизная - не более 200 шт. (при необходимости).

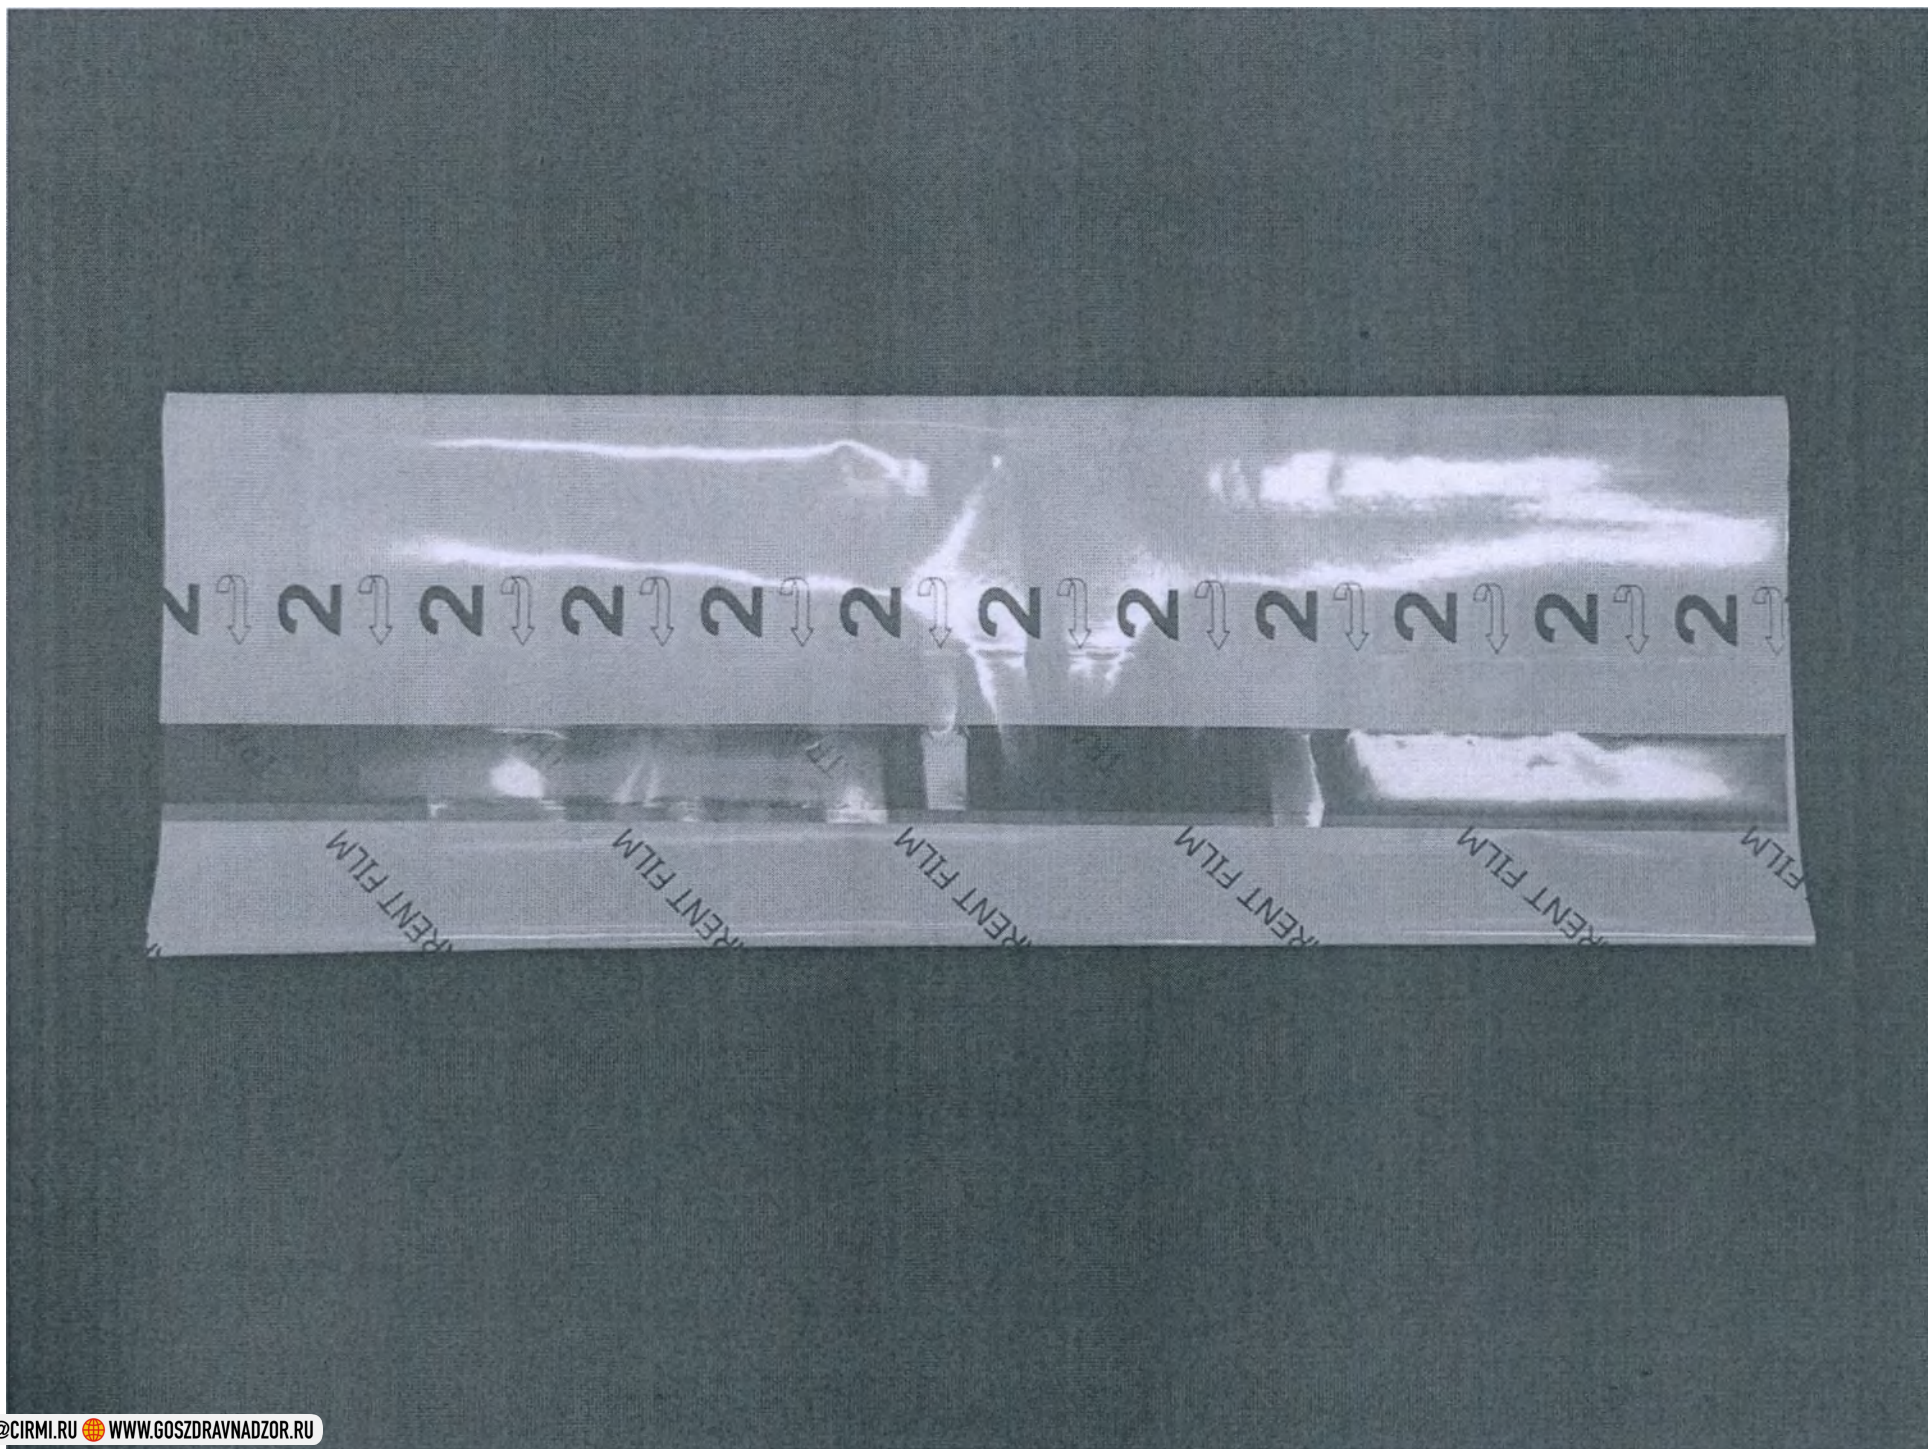

1.12. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Пленка инцизная в рулоне

Применяется с:

Размер

V	M
	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№

 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3,123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апирогенно.




STERILE R

1.12. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости).

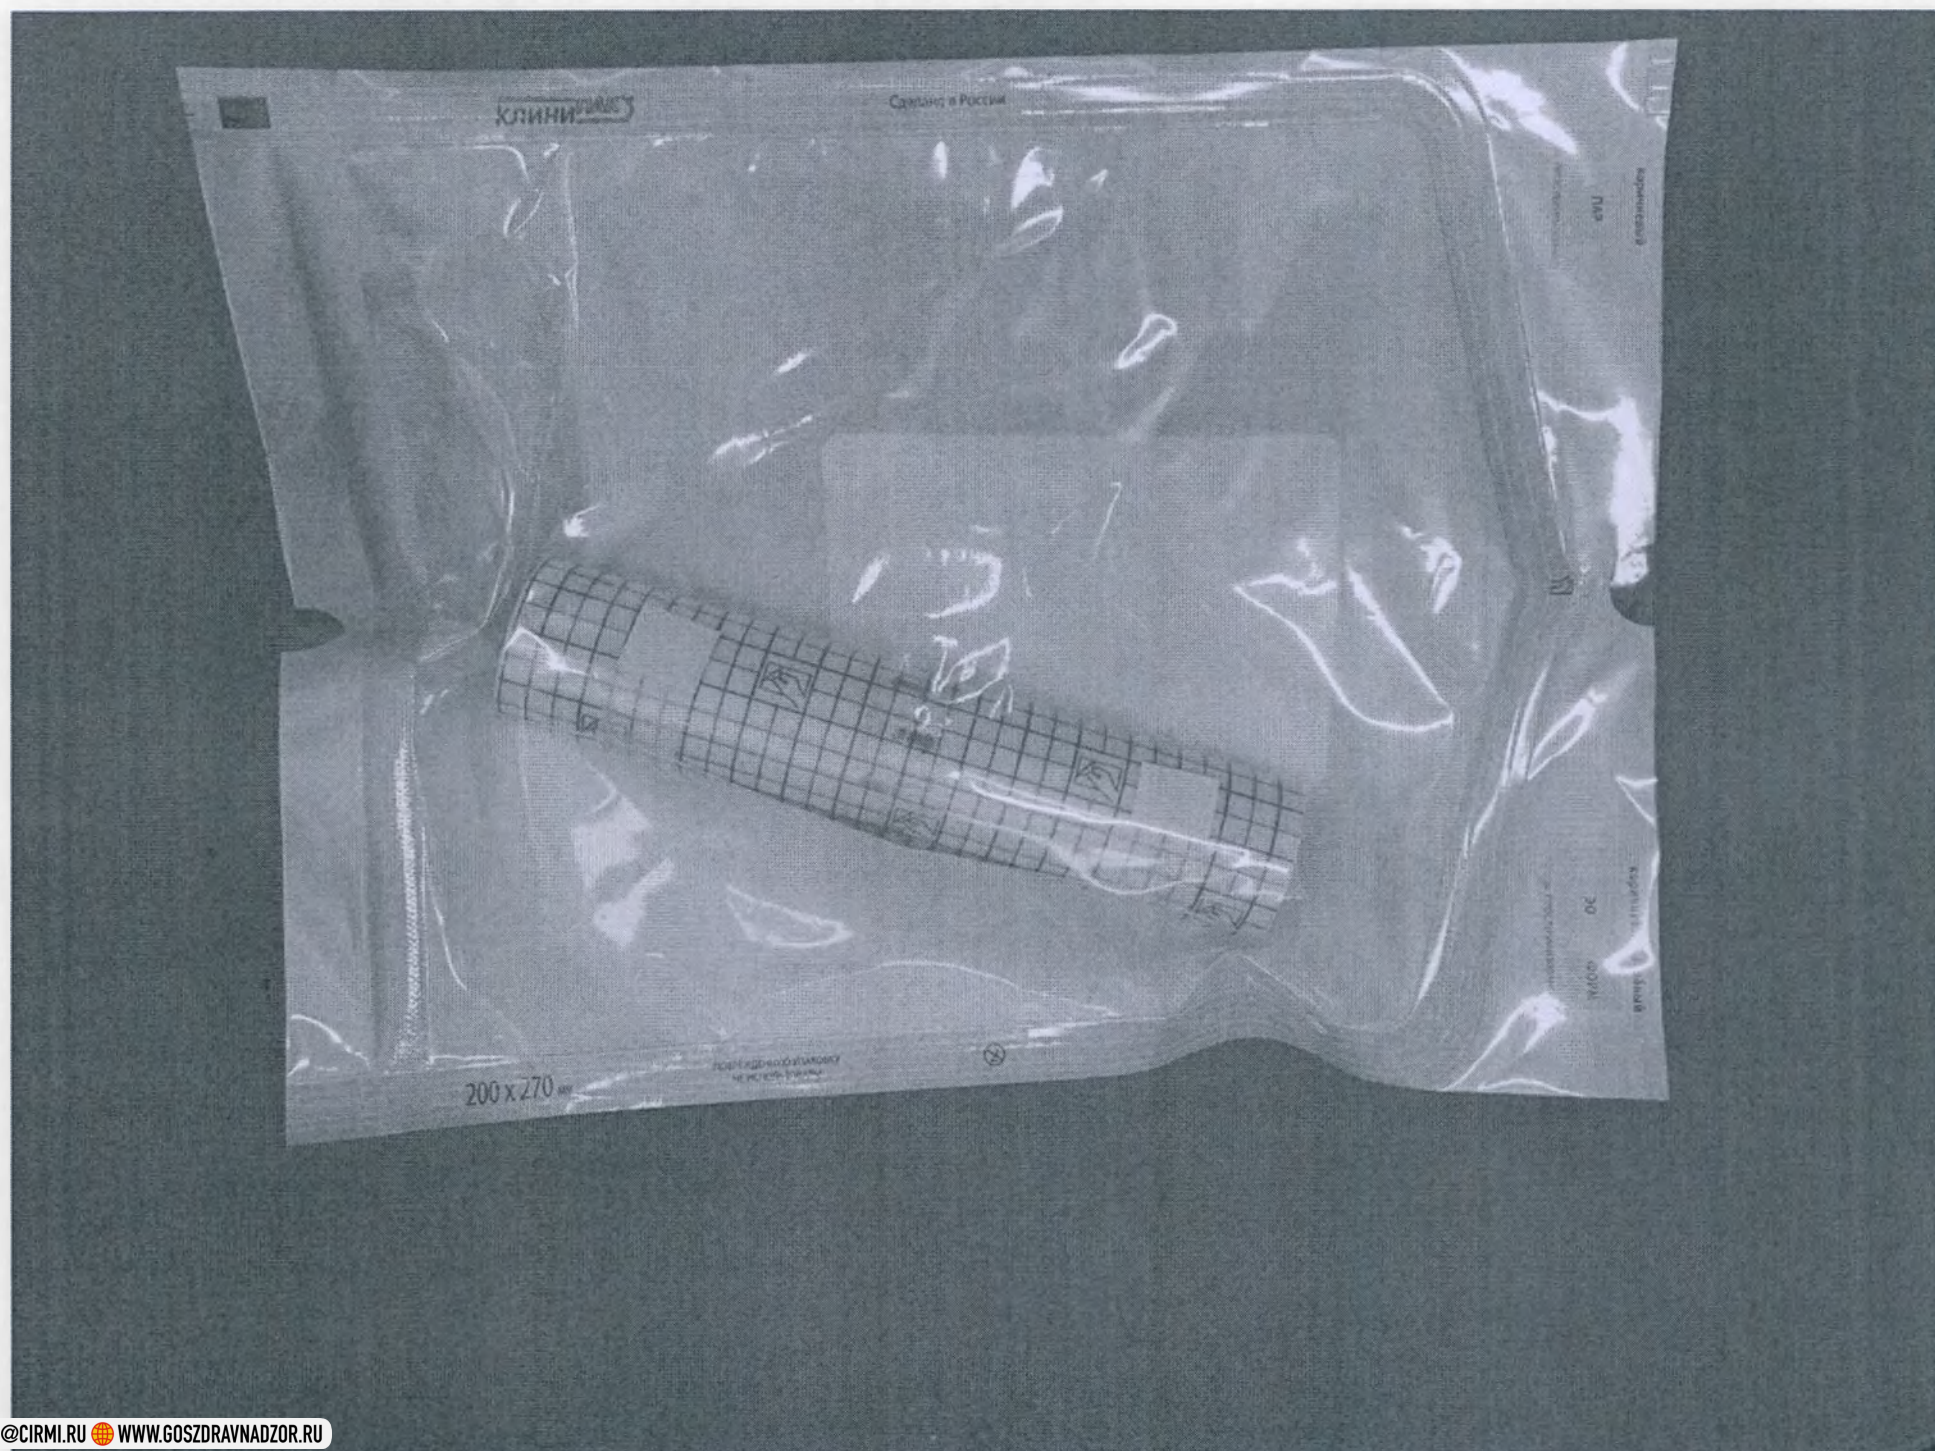

1.12. Пленка индизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости).

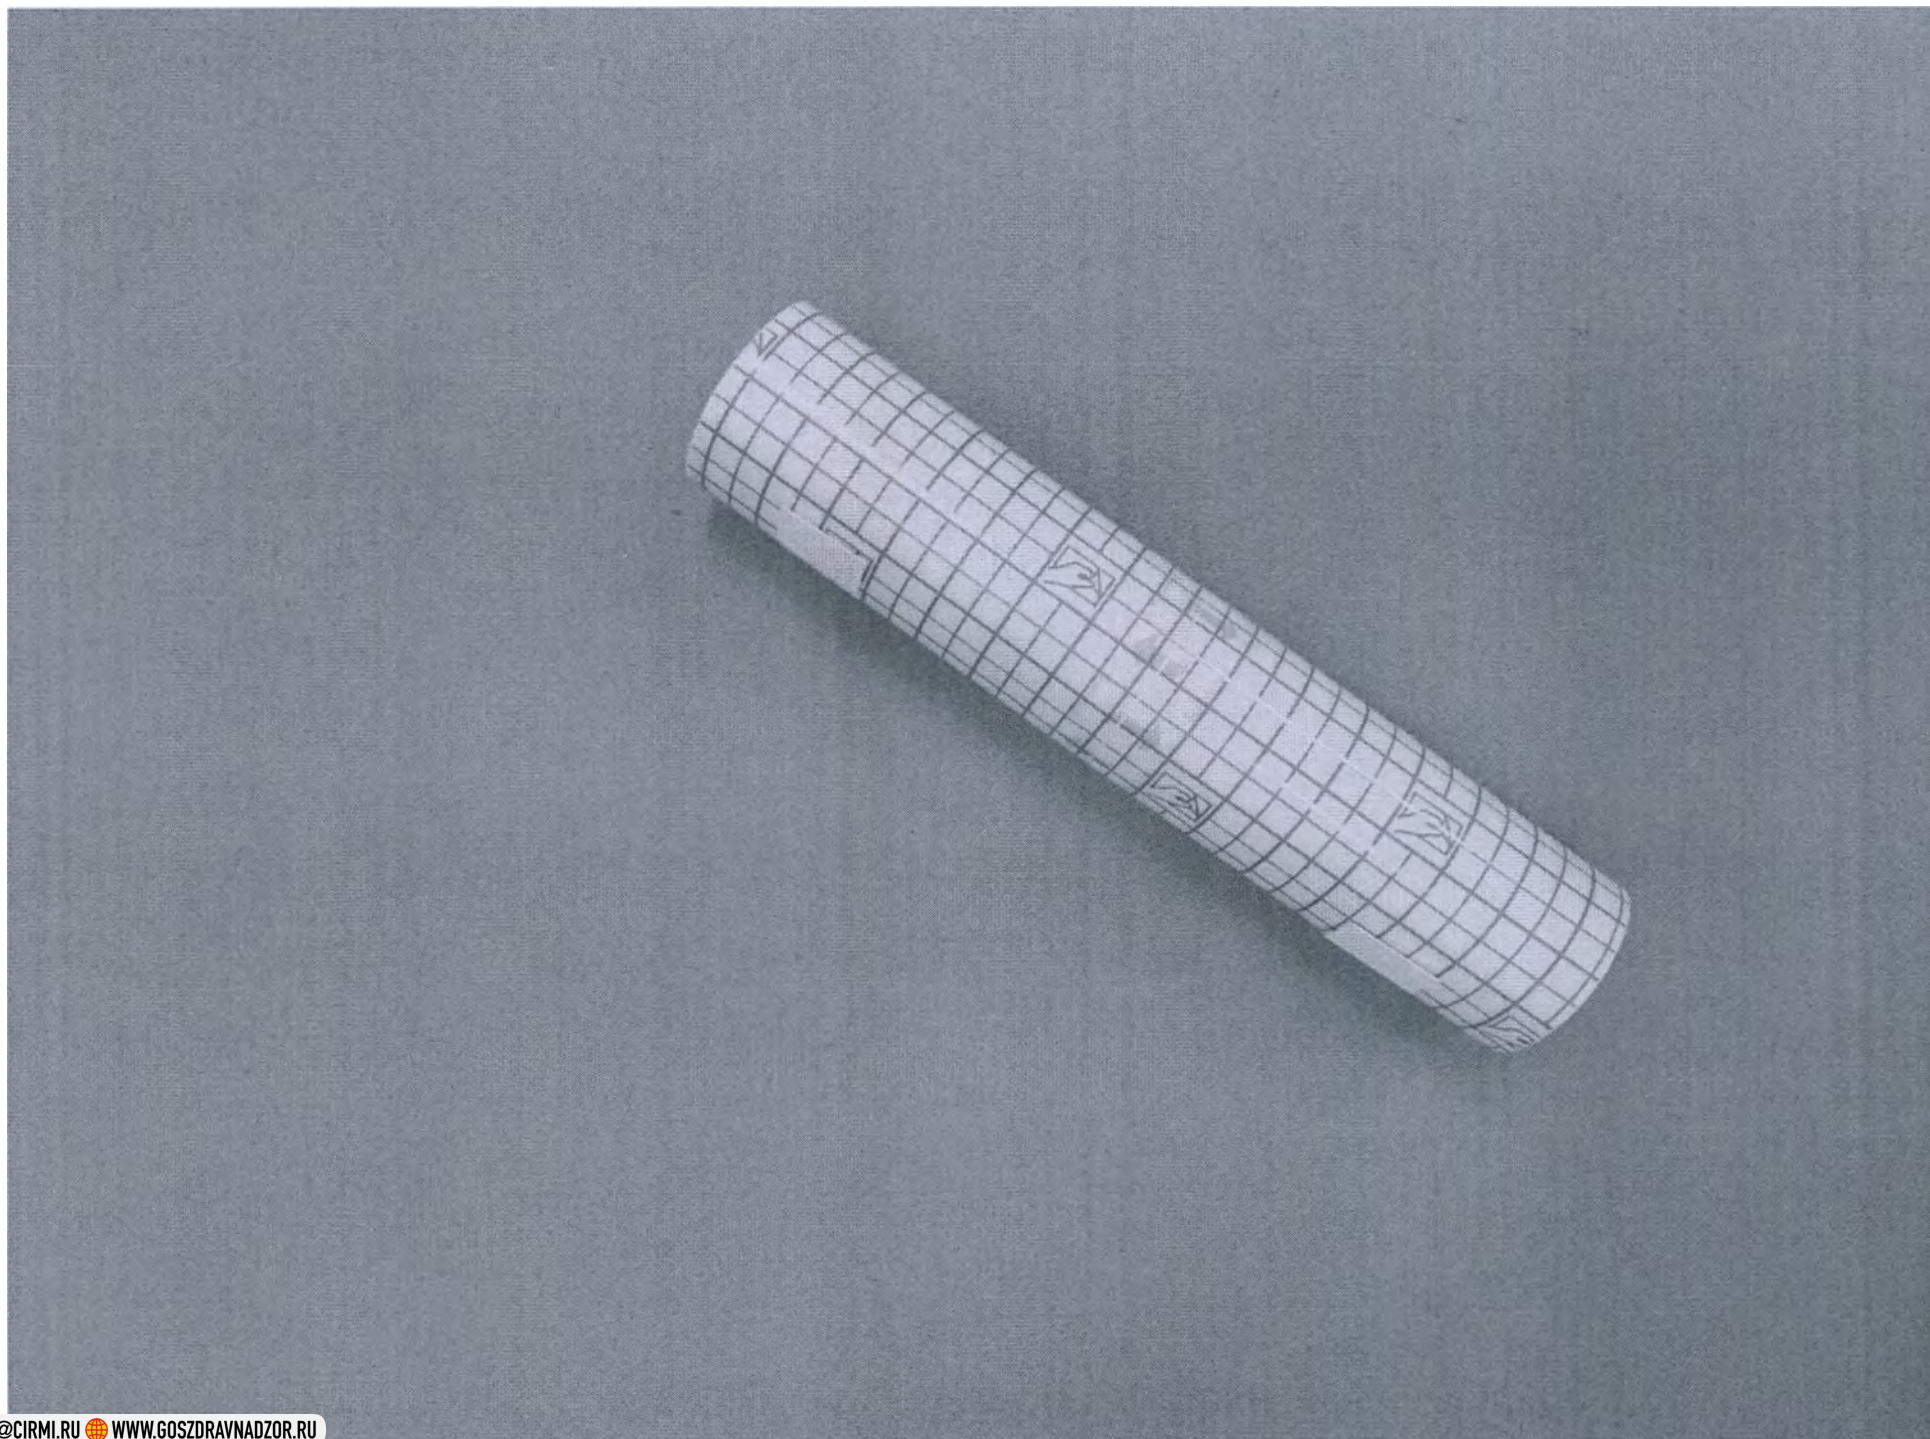

1.12. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Пленка инцизная в рулоне

Применяется с:

Размер

	M
V	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Партия №

Использовать до:

№

 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3,123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40


Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации


Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.



1.12. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости).

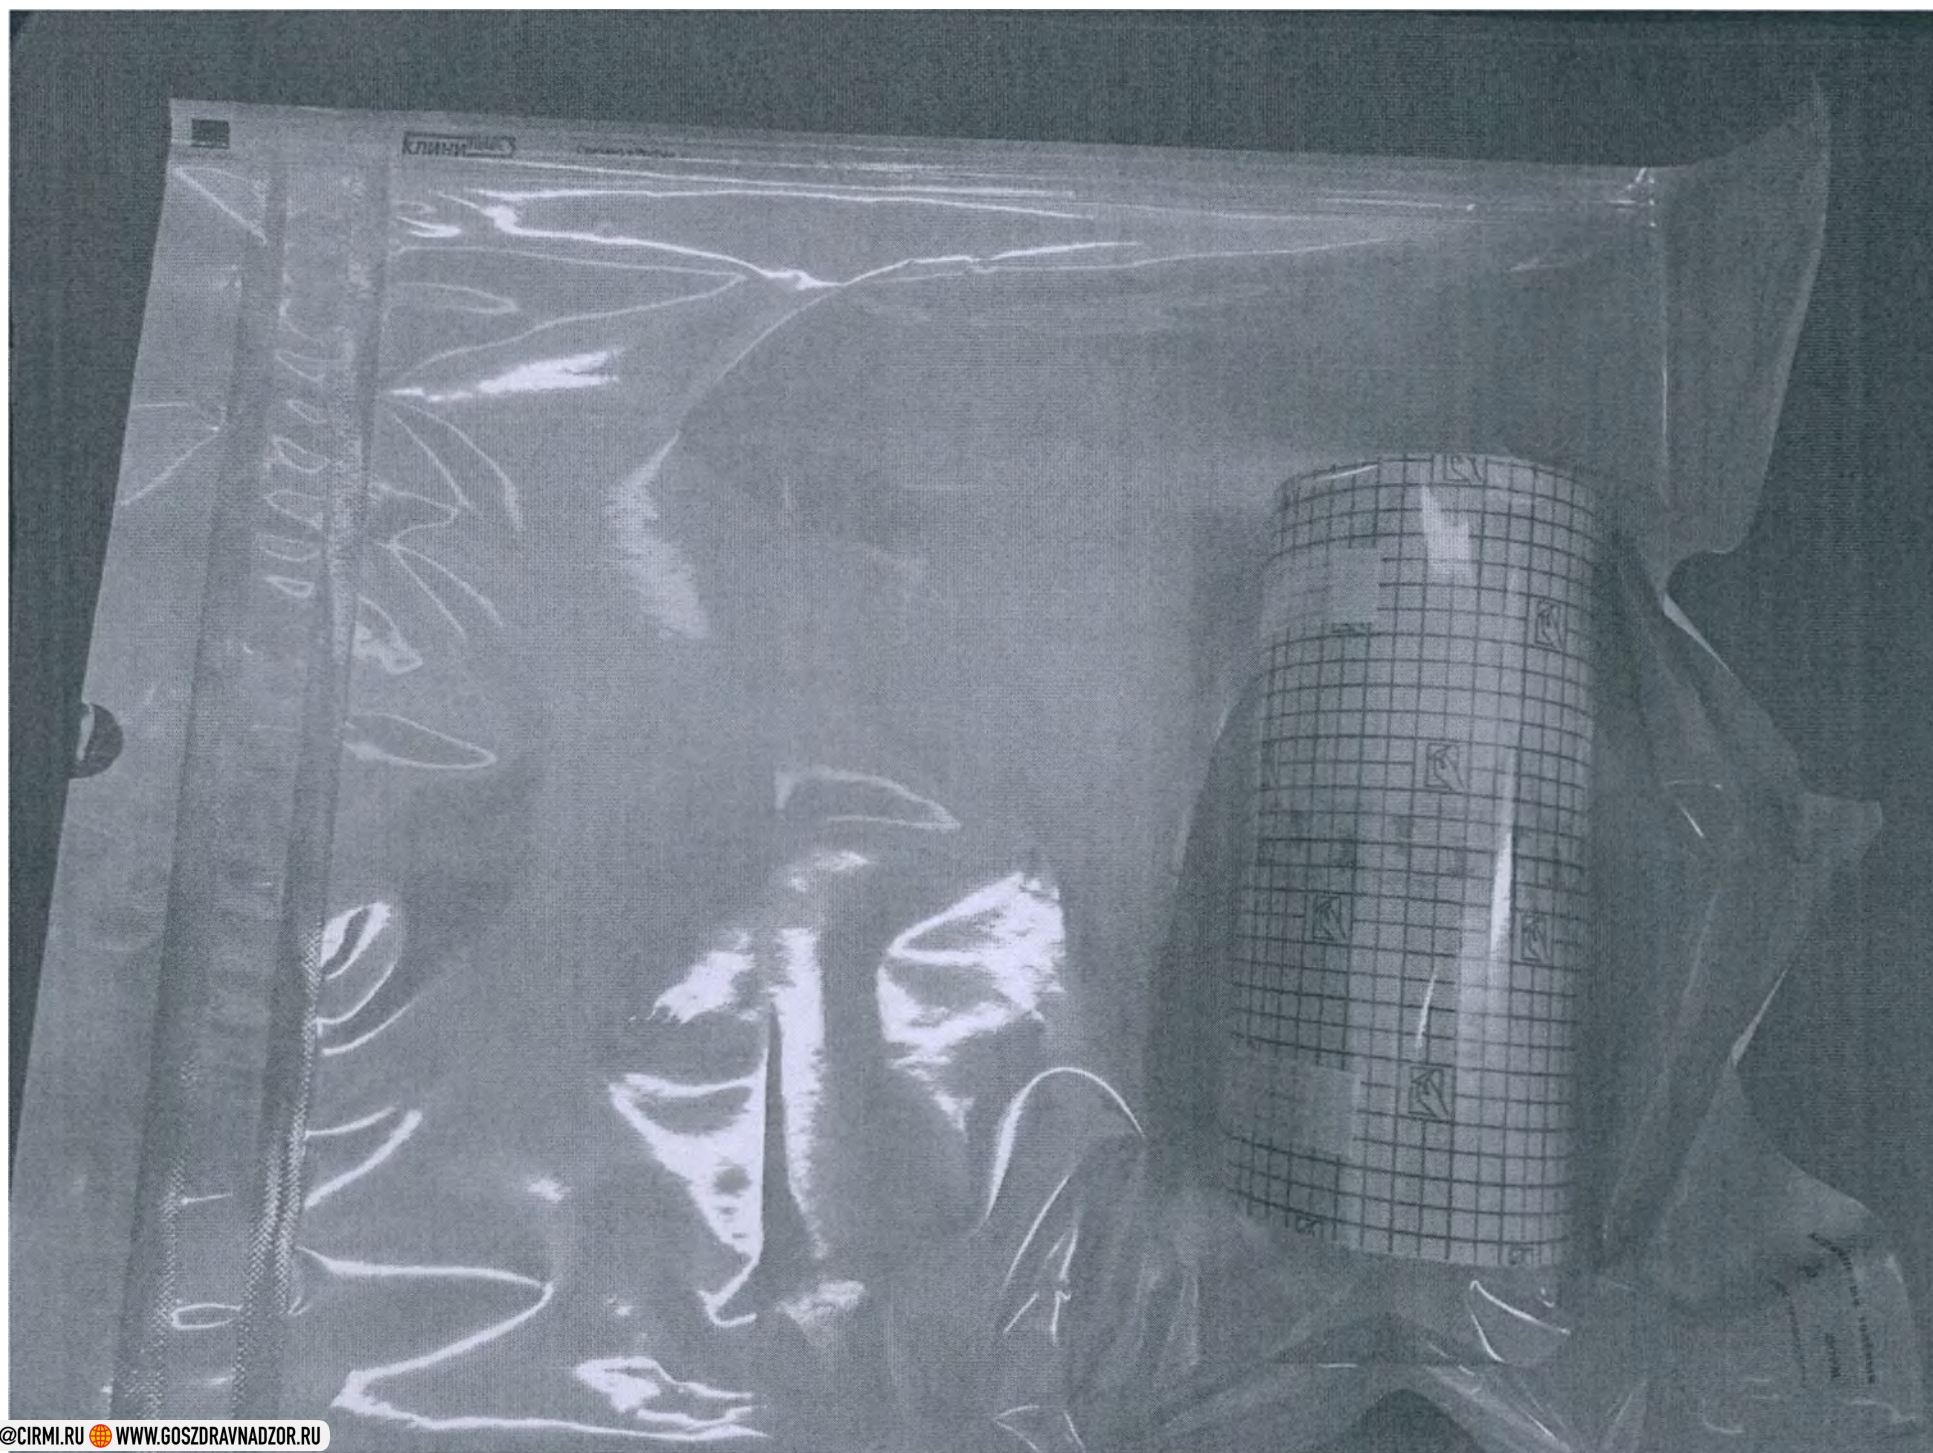

1.12. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости).

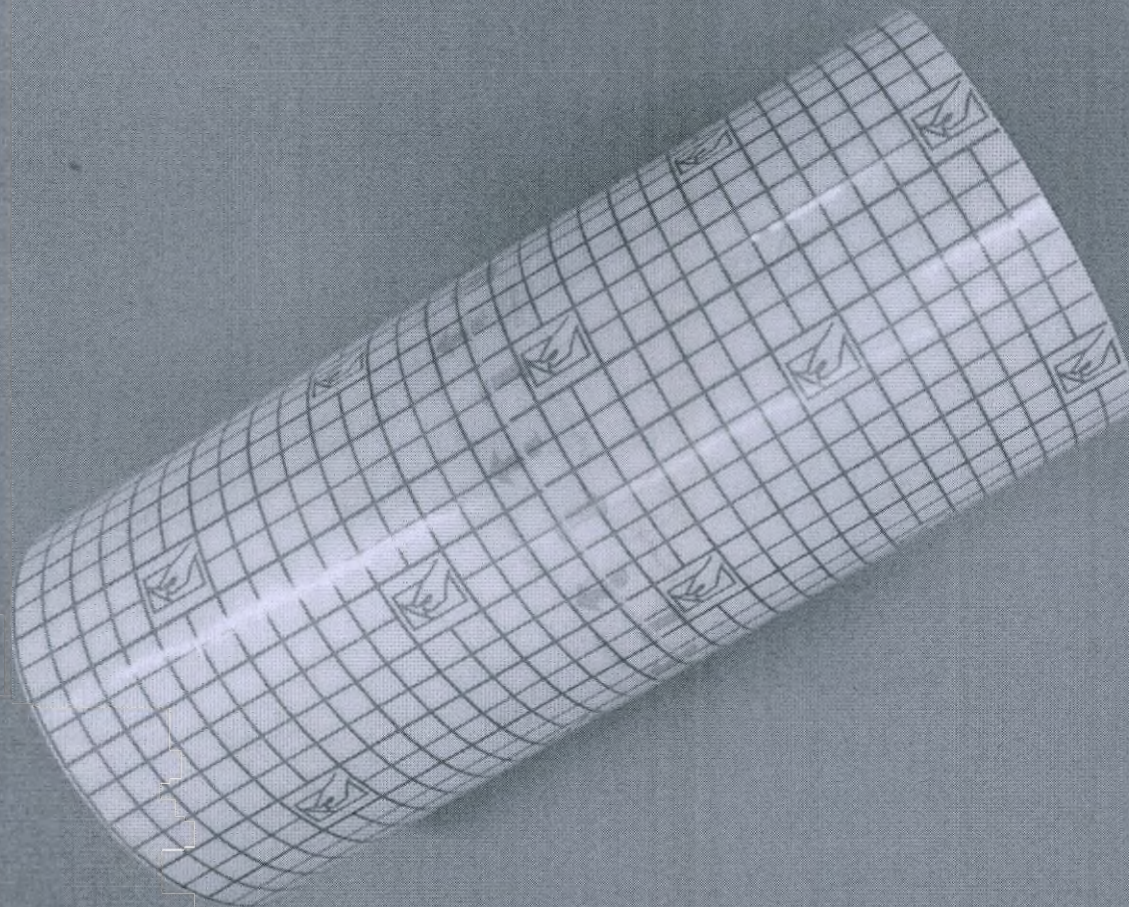

1.13. Покрывные асептические, размеры S, M - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Покрывные асептические

Применяется с:

Размер

	M
V	S

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

1.13. Покрывало аэрозольное, размеры S, M - не более 200 шт. (при необходимости).

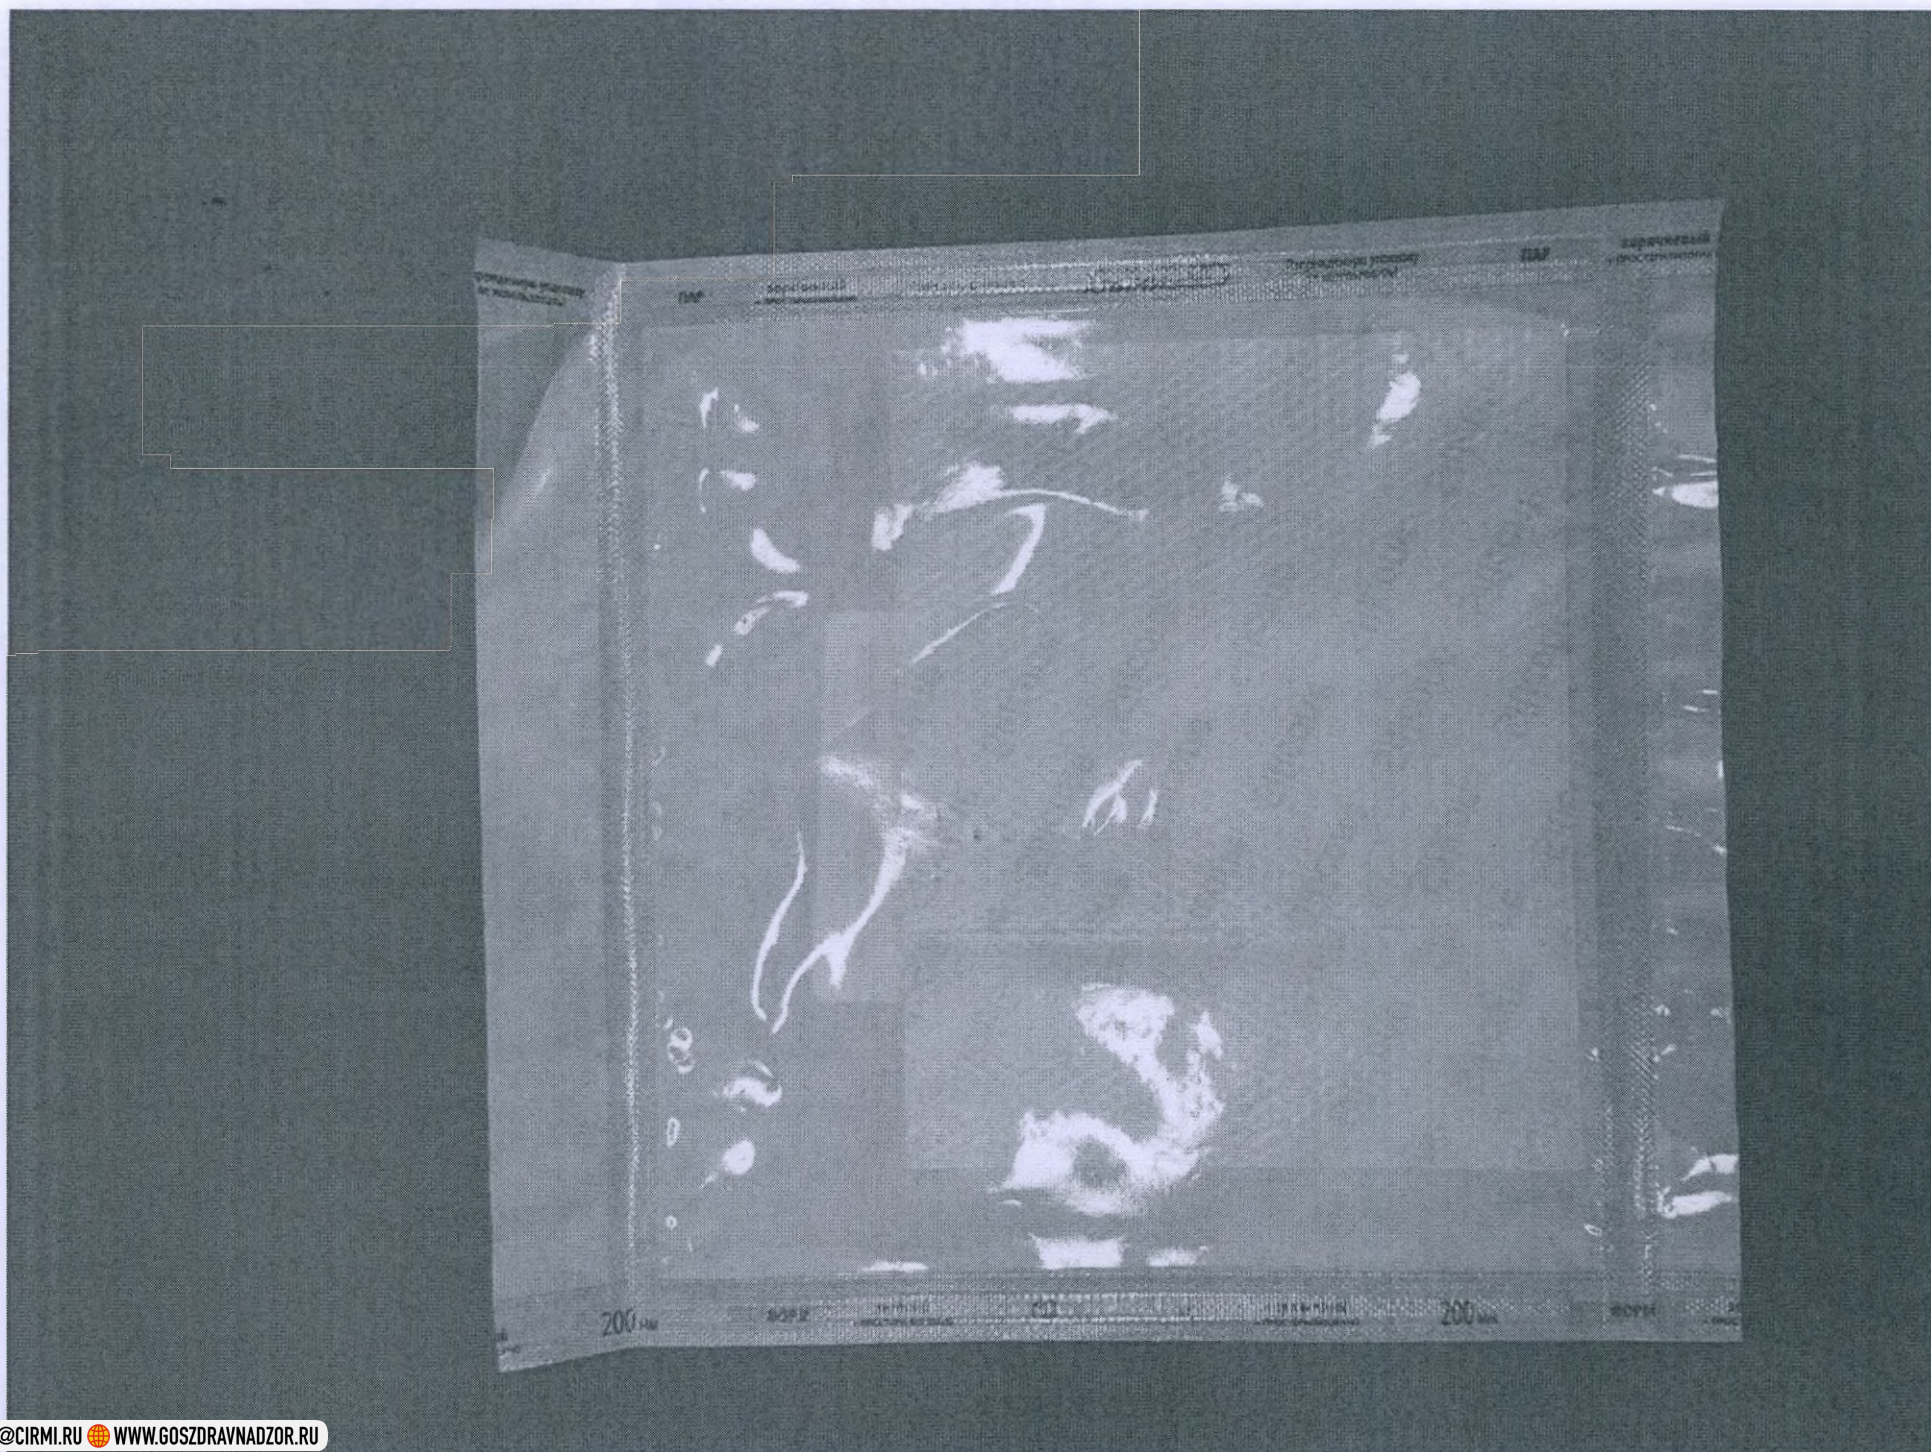

1.13. Покрытие атравматическое, размеры S, M - не более 200 шт. (при необходимости).

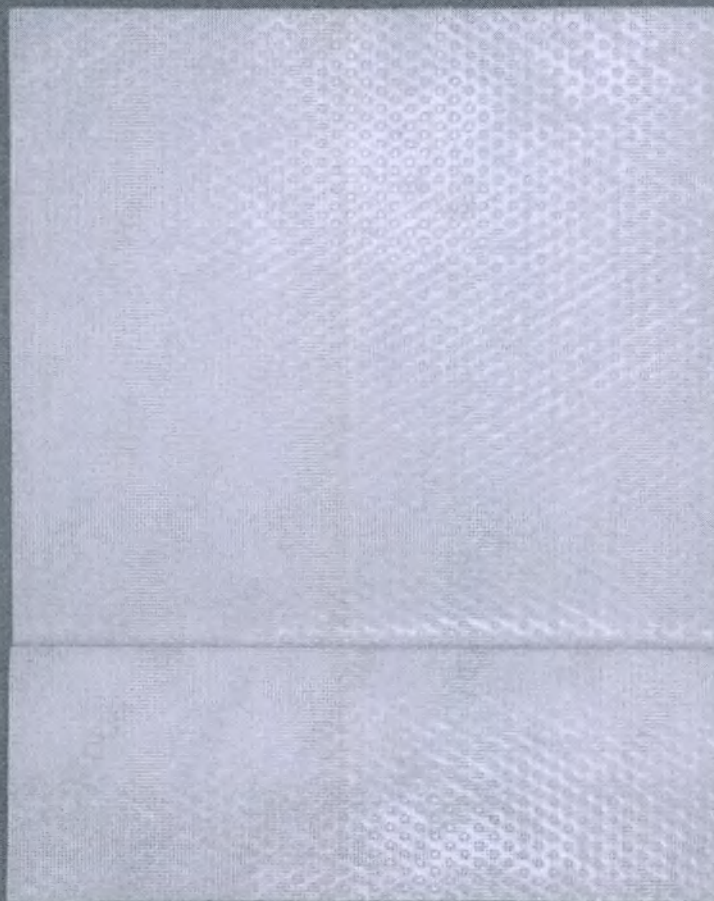

1.13. Покрывные аэравматическое, размеры S, M - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Покрывные аэравматическое

Применяется с:

Размер

V	M
	S

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3,123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

1.13. Покрывало аэрозольное, размеры S, M - не более 200 шт. (при необходимости).

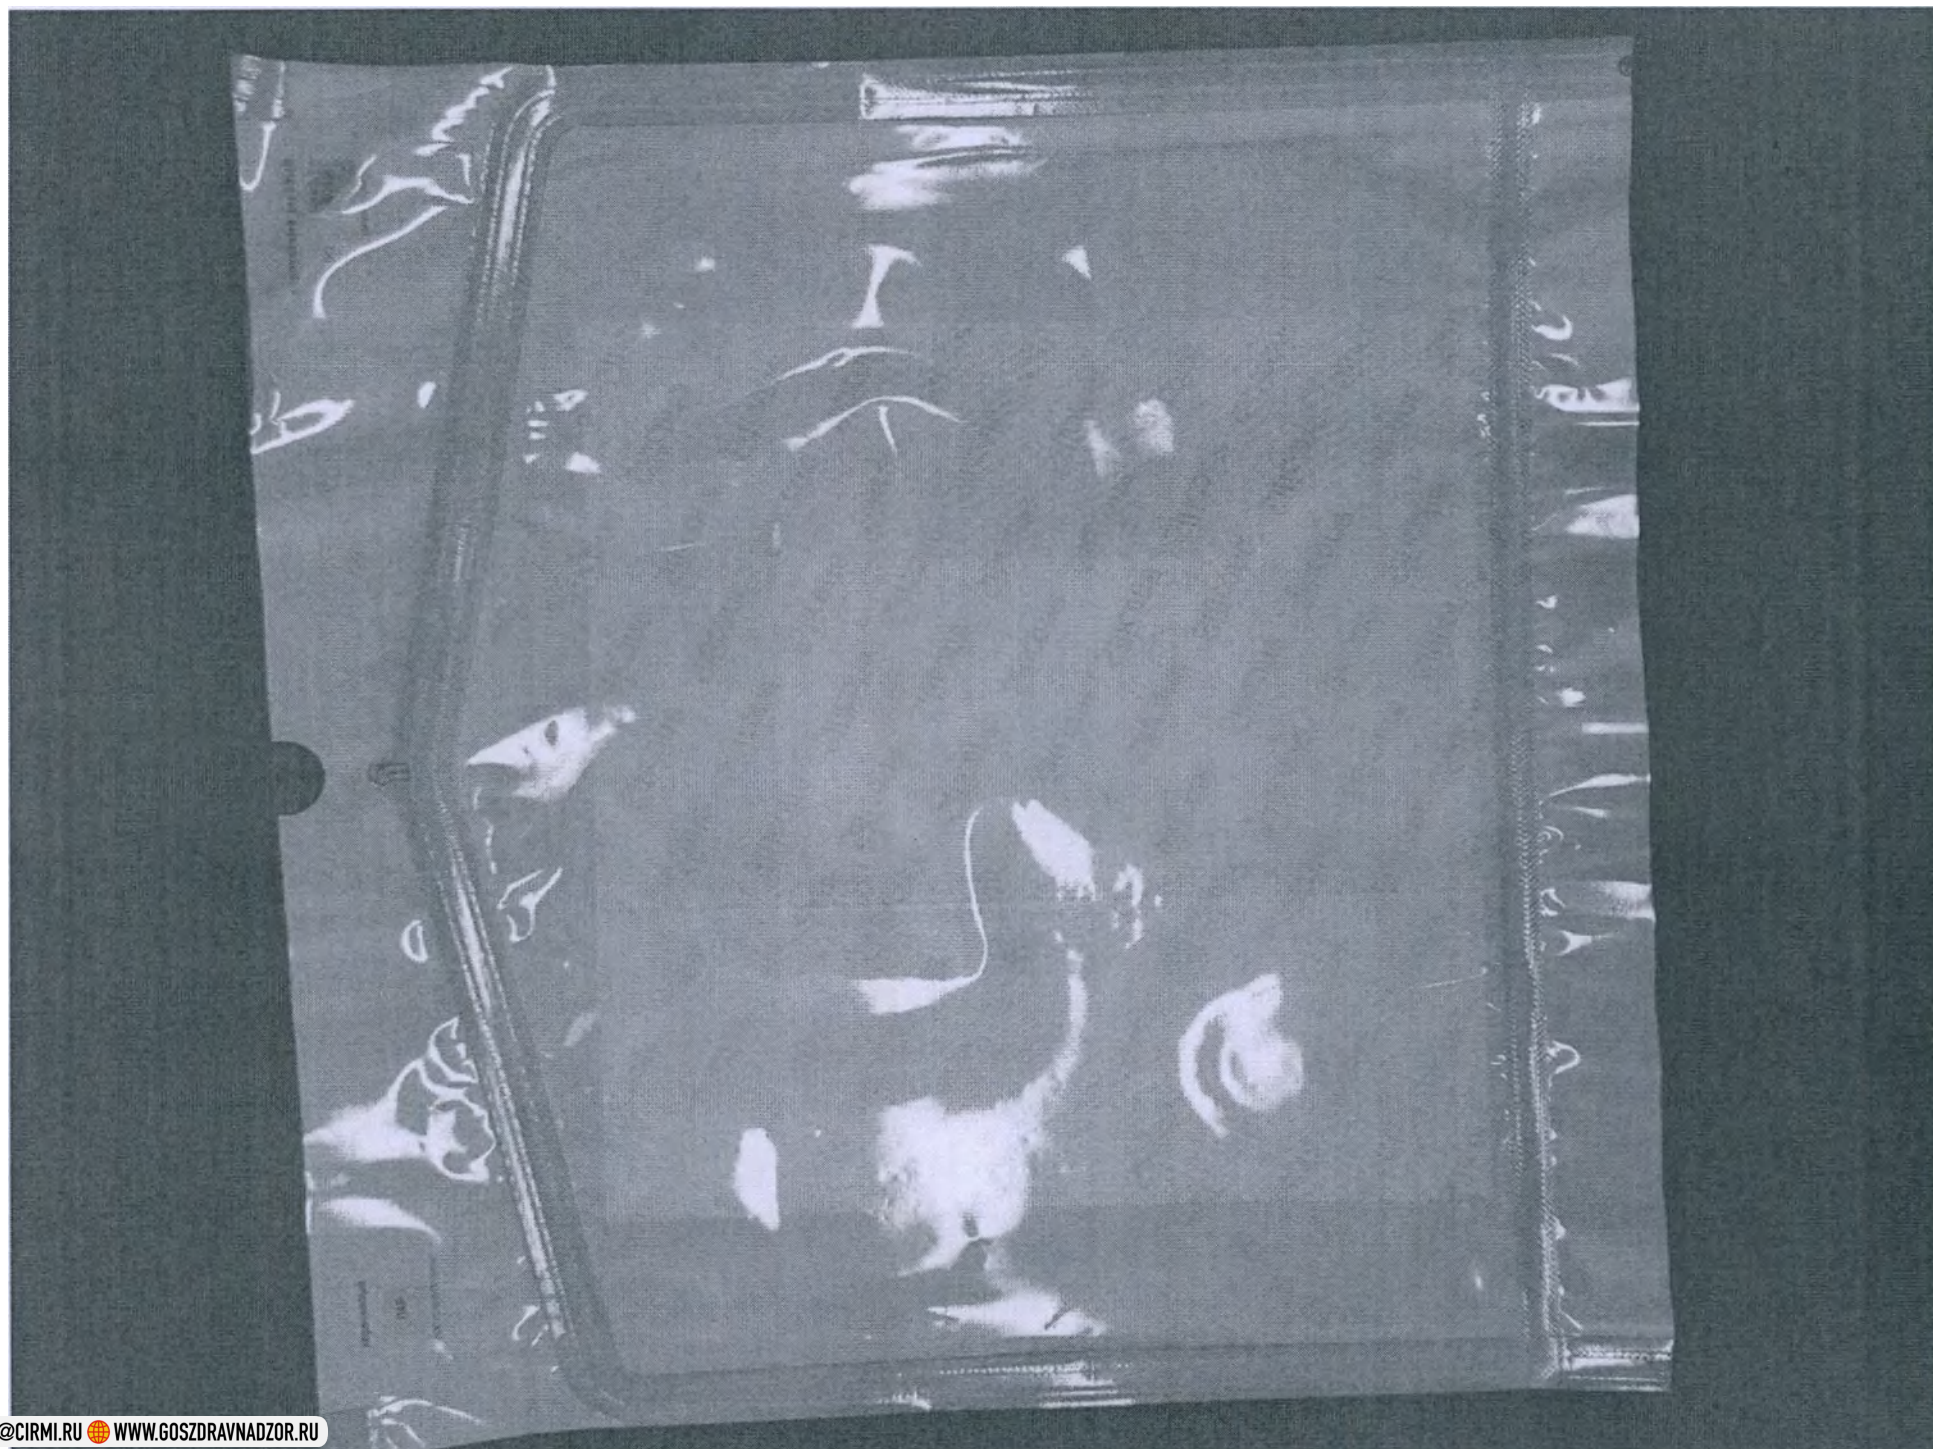

1.13. Покрытие атравматическое, размеры S, М - не более 200 шт. (при необходимости).

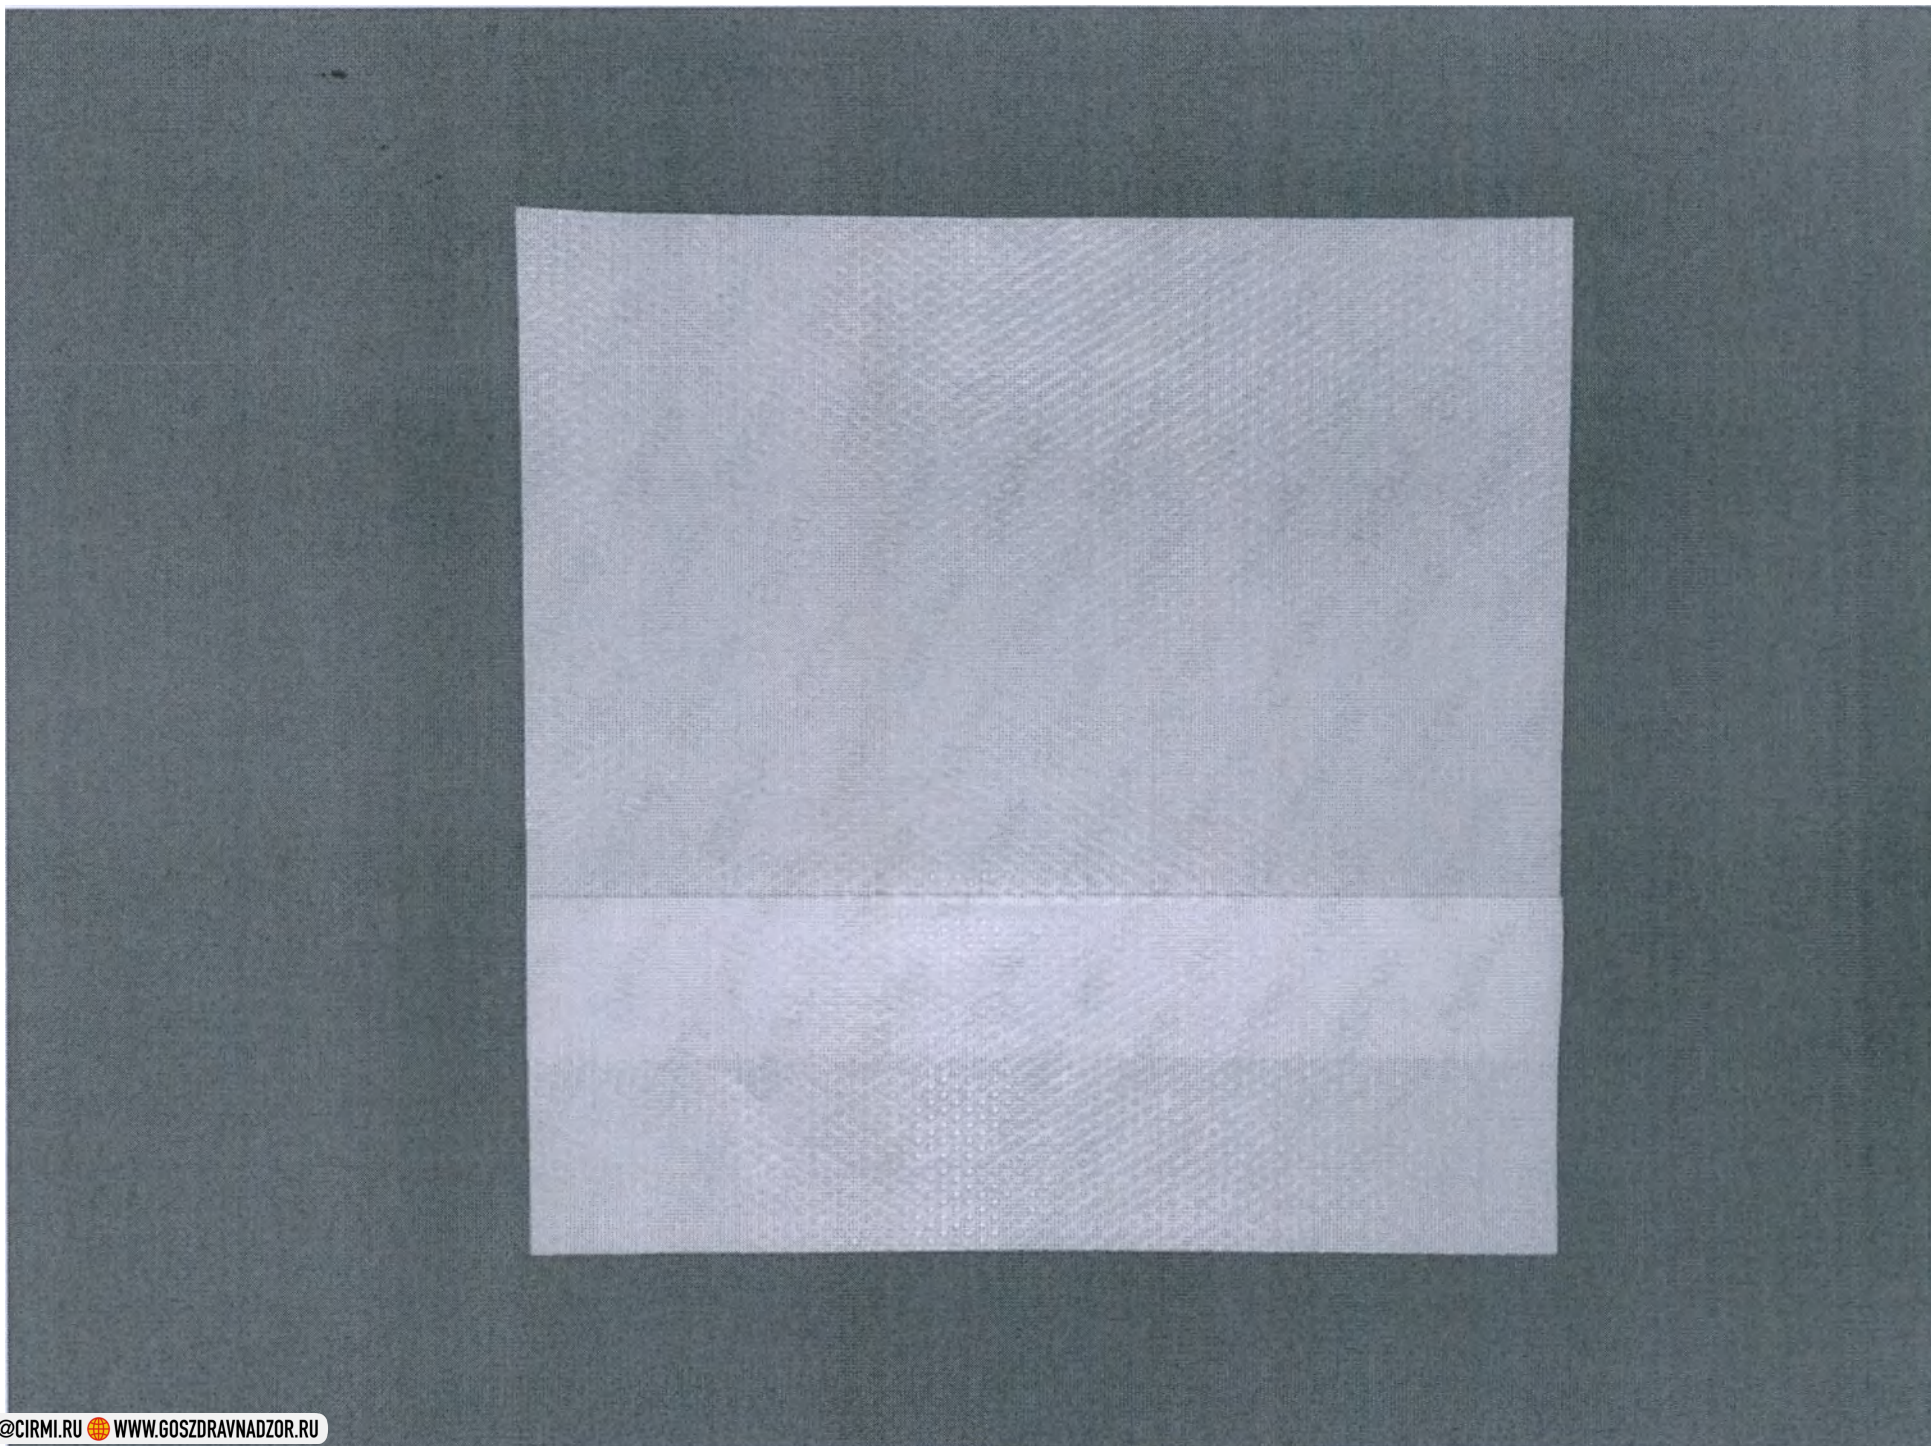

1.14. Переходники (вход/выход) - не более 200 шт. (при необходимости).

Переходники (вход/выход)

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018»
 «Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018»
 «Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»
 «Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-05722086-2018»

Дата стерилизации: 2018.08.15


Использовать до: 2019.07

Партия № _____
 № П-0000001-АА


Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»),
 Москва г, ул Твардовского, д.8, с.1, пом.1 ком. 3, этаж 3, 123458
 Место производства: Москва г, 1-я Кураевская улица, д. 34 стр. 3, 109235
 Электронная почта: sp.vitmedical@gmail.com, Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90 %.
 Подробнее см руководство по эксплуатации.


Стерильно. Нетоксично. Асептично.

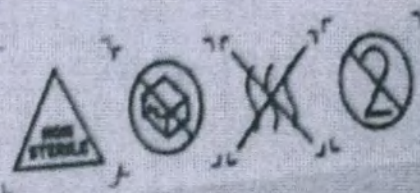

1.14. Переходники (вход/выход) - не более 200 шт. (при необходимости).

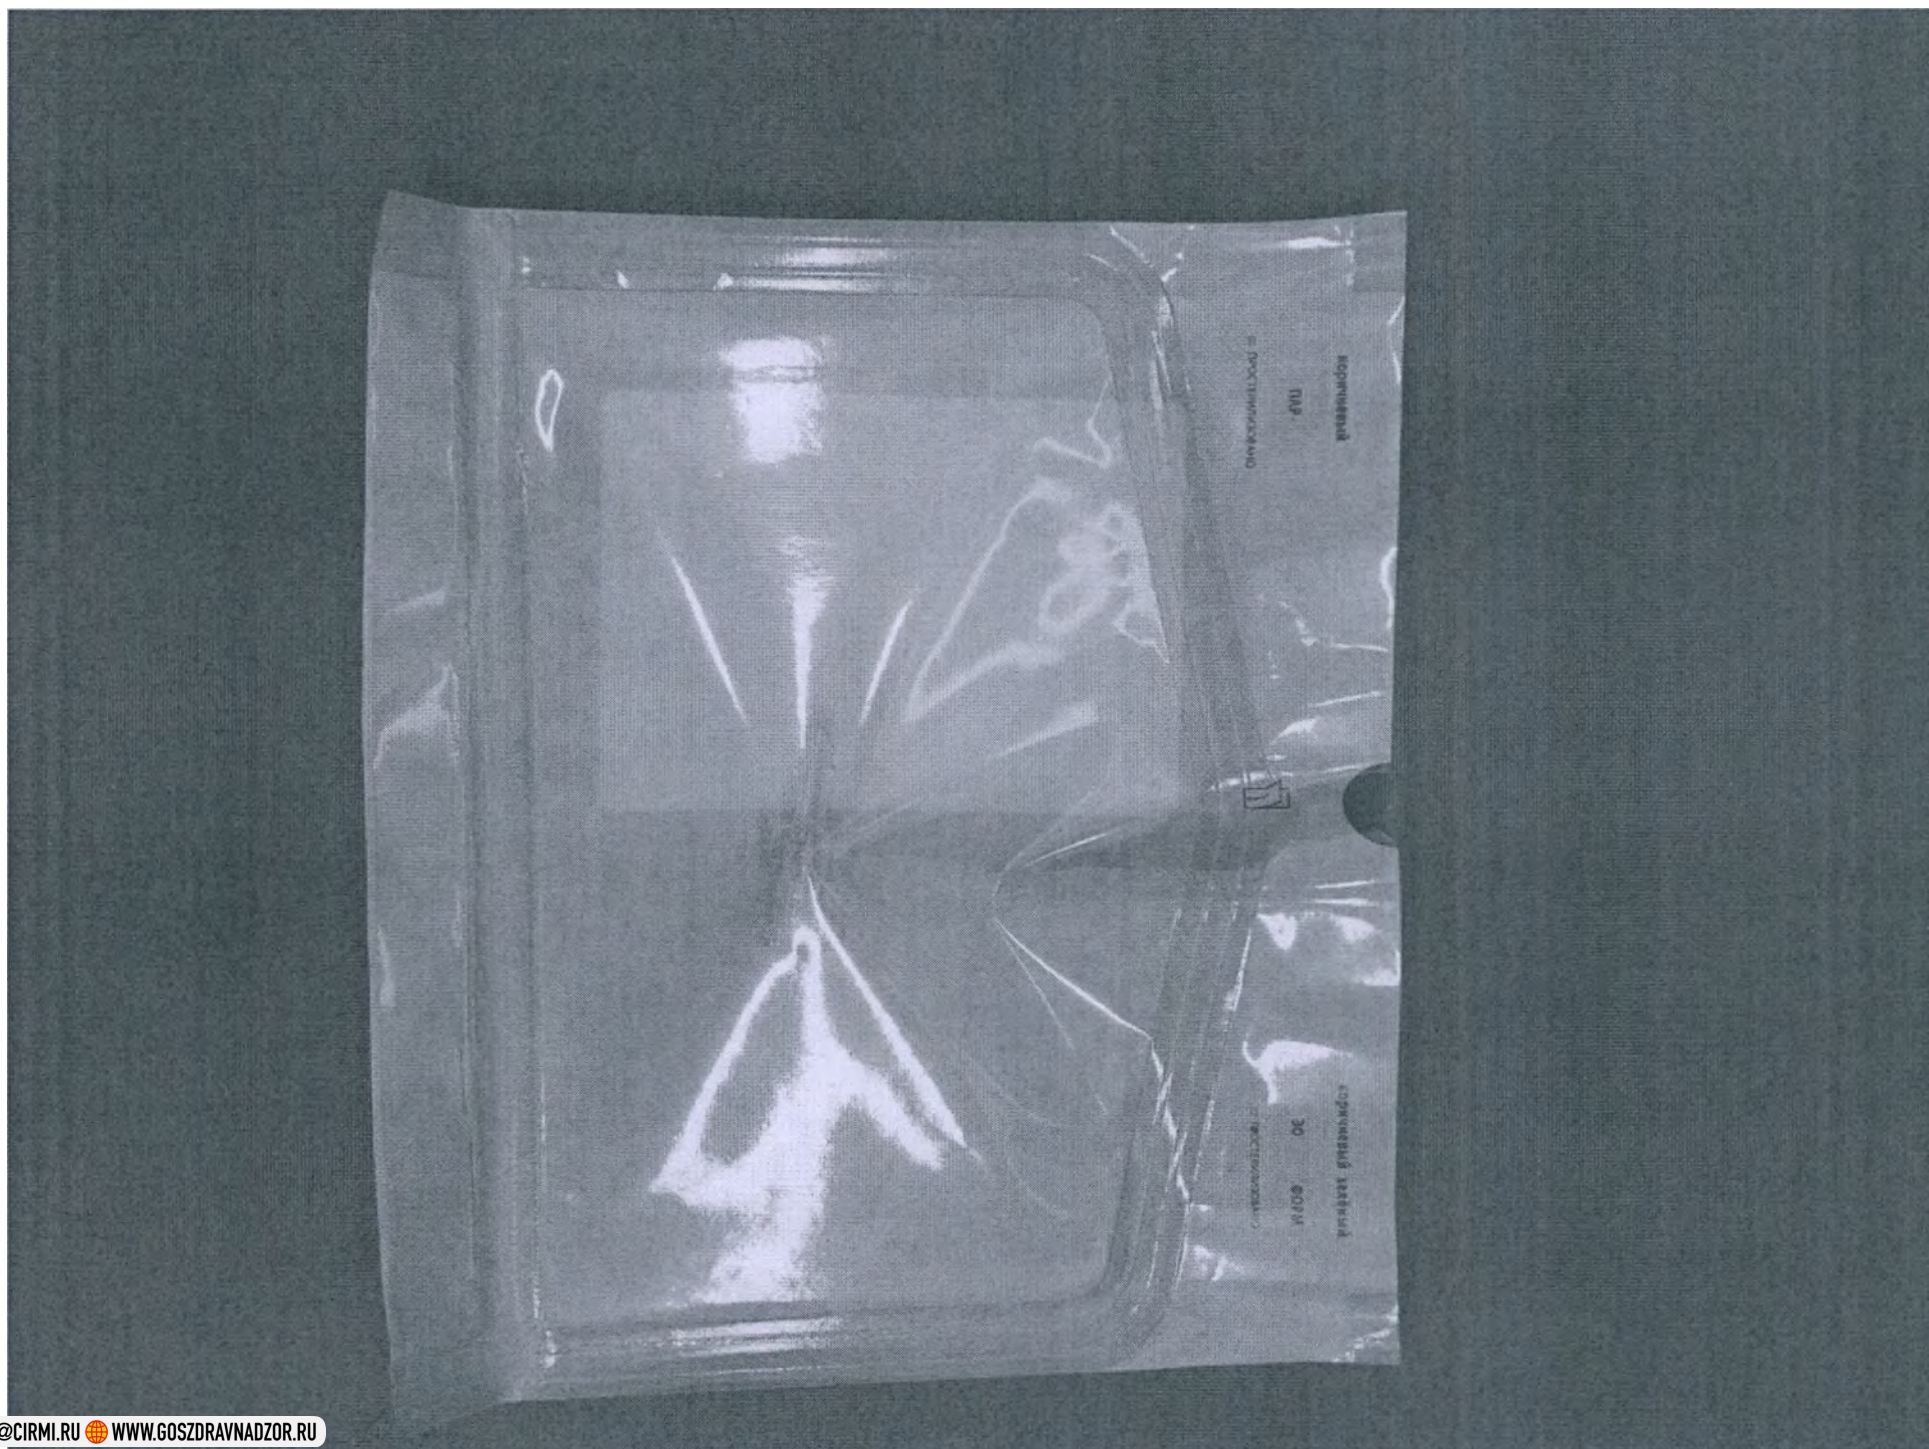

1.14. Переходники (вход/выход) - не более 200 шт. (при необходимости).

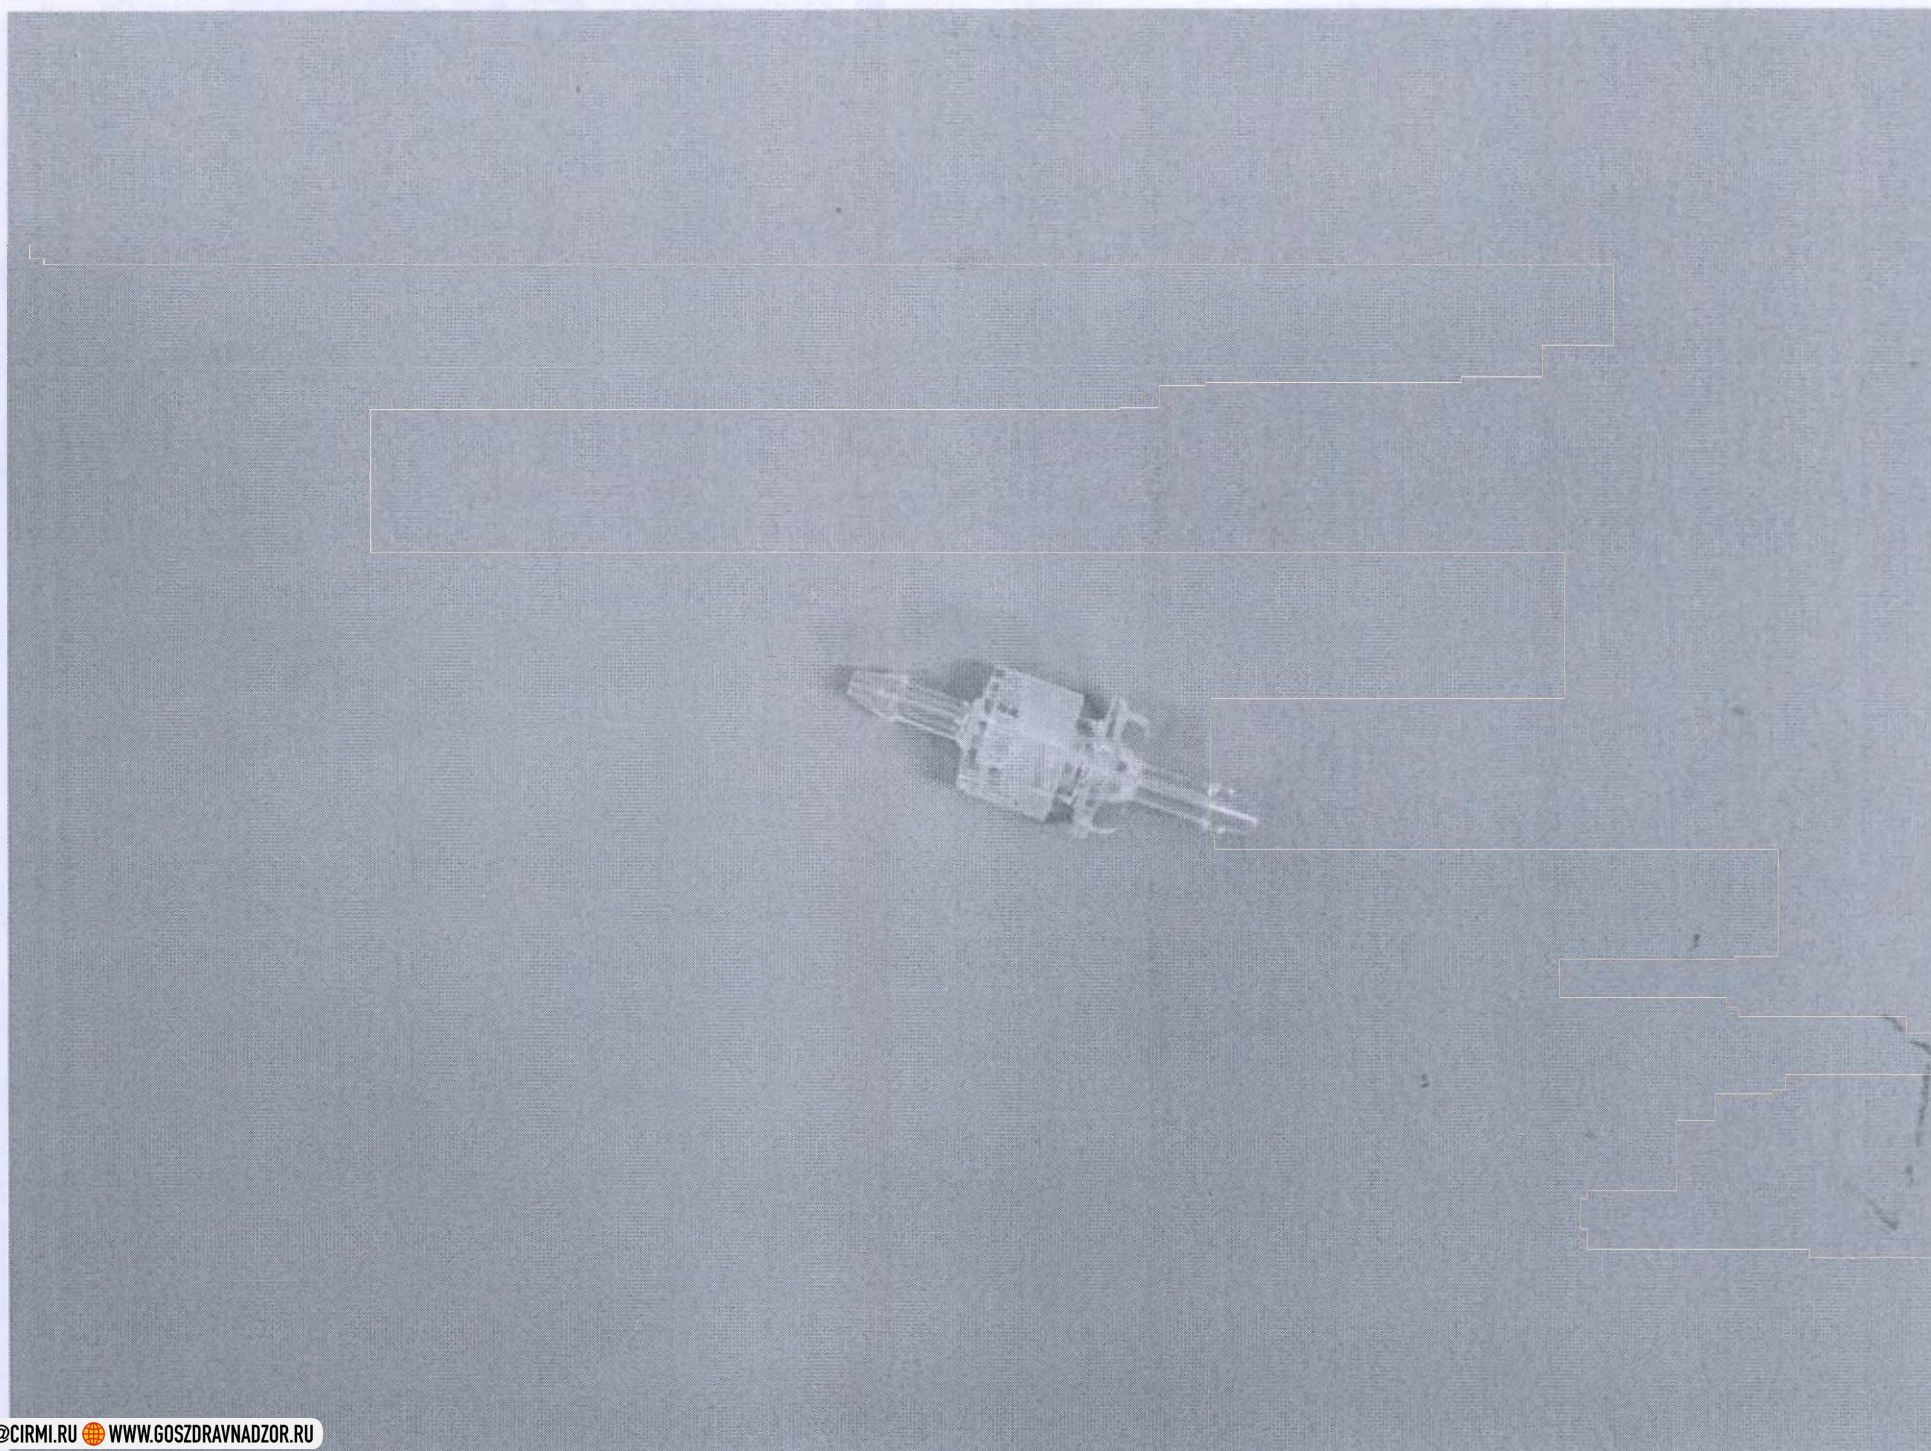

1.15. Сумка для ношения - 1 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Аппарат не пригоден для использования при температуре ниже плюс 1 или выше плюс 41°C.

Судно для перевозки

CONCLUSIONS

* Авторский «ВНТ Модерн» под № 32.30.50.002.05722036.2018»

Информация о работе и деятельности организации
«Амнестия» БНТ является ее собственностью и
не должна использоваться для каких-либо целей
и в каких-либо СМИ без предварительного
письменного согласия «Амнестия» БНТ.
Тел: +375 29 50 50 002, 05722036-2018»

[illegible][illegible]

Илгит №
№ C-0000001-AA

Дата поступления 2018.02.15

Исполнитель. Обществу с ограниченной ответственностью «ВНТ Матрикс»
г. Москва, ул. Тургеневская, д. 8, к. 1, пом. 1 к/о 3, этаж 3, 123458
ИНН Матрикс», Москва, ул. Тургеневская, д. 34 стр. 3, 109235


(ООО «ВЭТ-Медиа»), Москва, ул. 34 стр. 3
 (ООО «ВЭТ-Медиа»), Москва, ул. 34 стр. 3
 (ООО «ВЭТ-Медиа»), Москва, ул. 34 стр. 3

[illegible]

Amalgam in upper and lower 50 and lower 50°C in orthodontic band with metal in the

Характерные особенности

1.15. Сумка для ношения - 1 шт. (при необходимости).

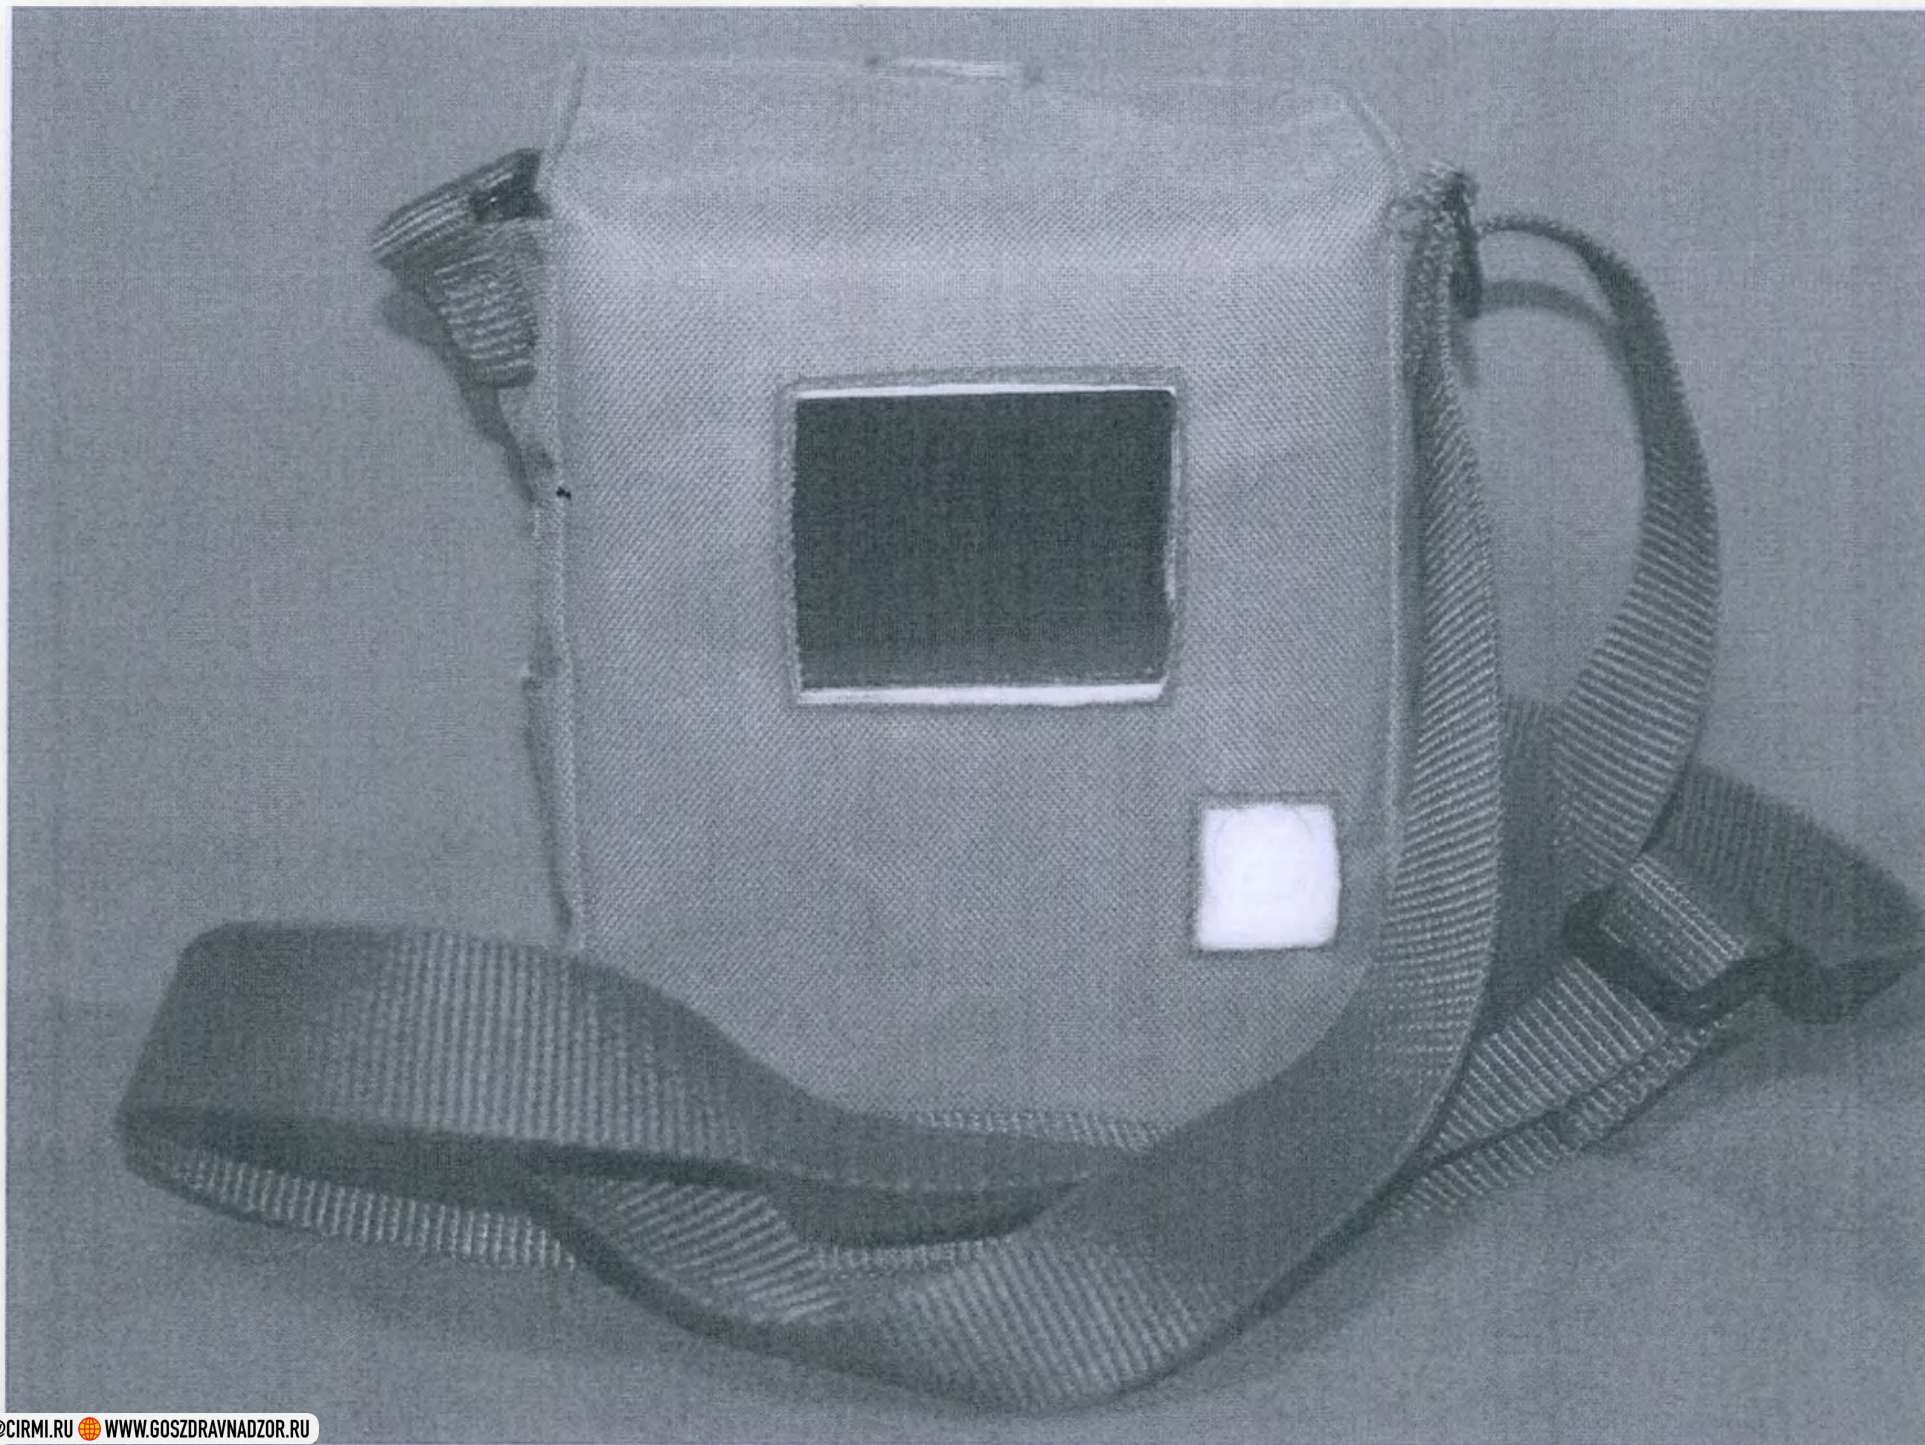


1.16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

АППАРАТ «ВИТ»
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
ПО ТУ 32.50.50-002-05722086-2018


2. Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018, в составе:

2.1. Аппарат «ВИТ Мини» - 1 шт. (Упаковка)

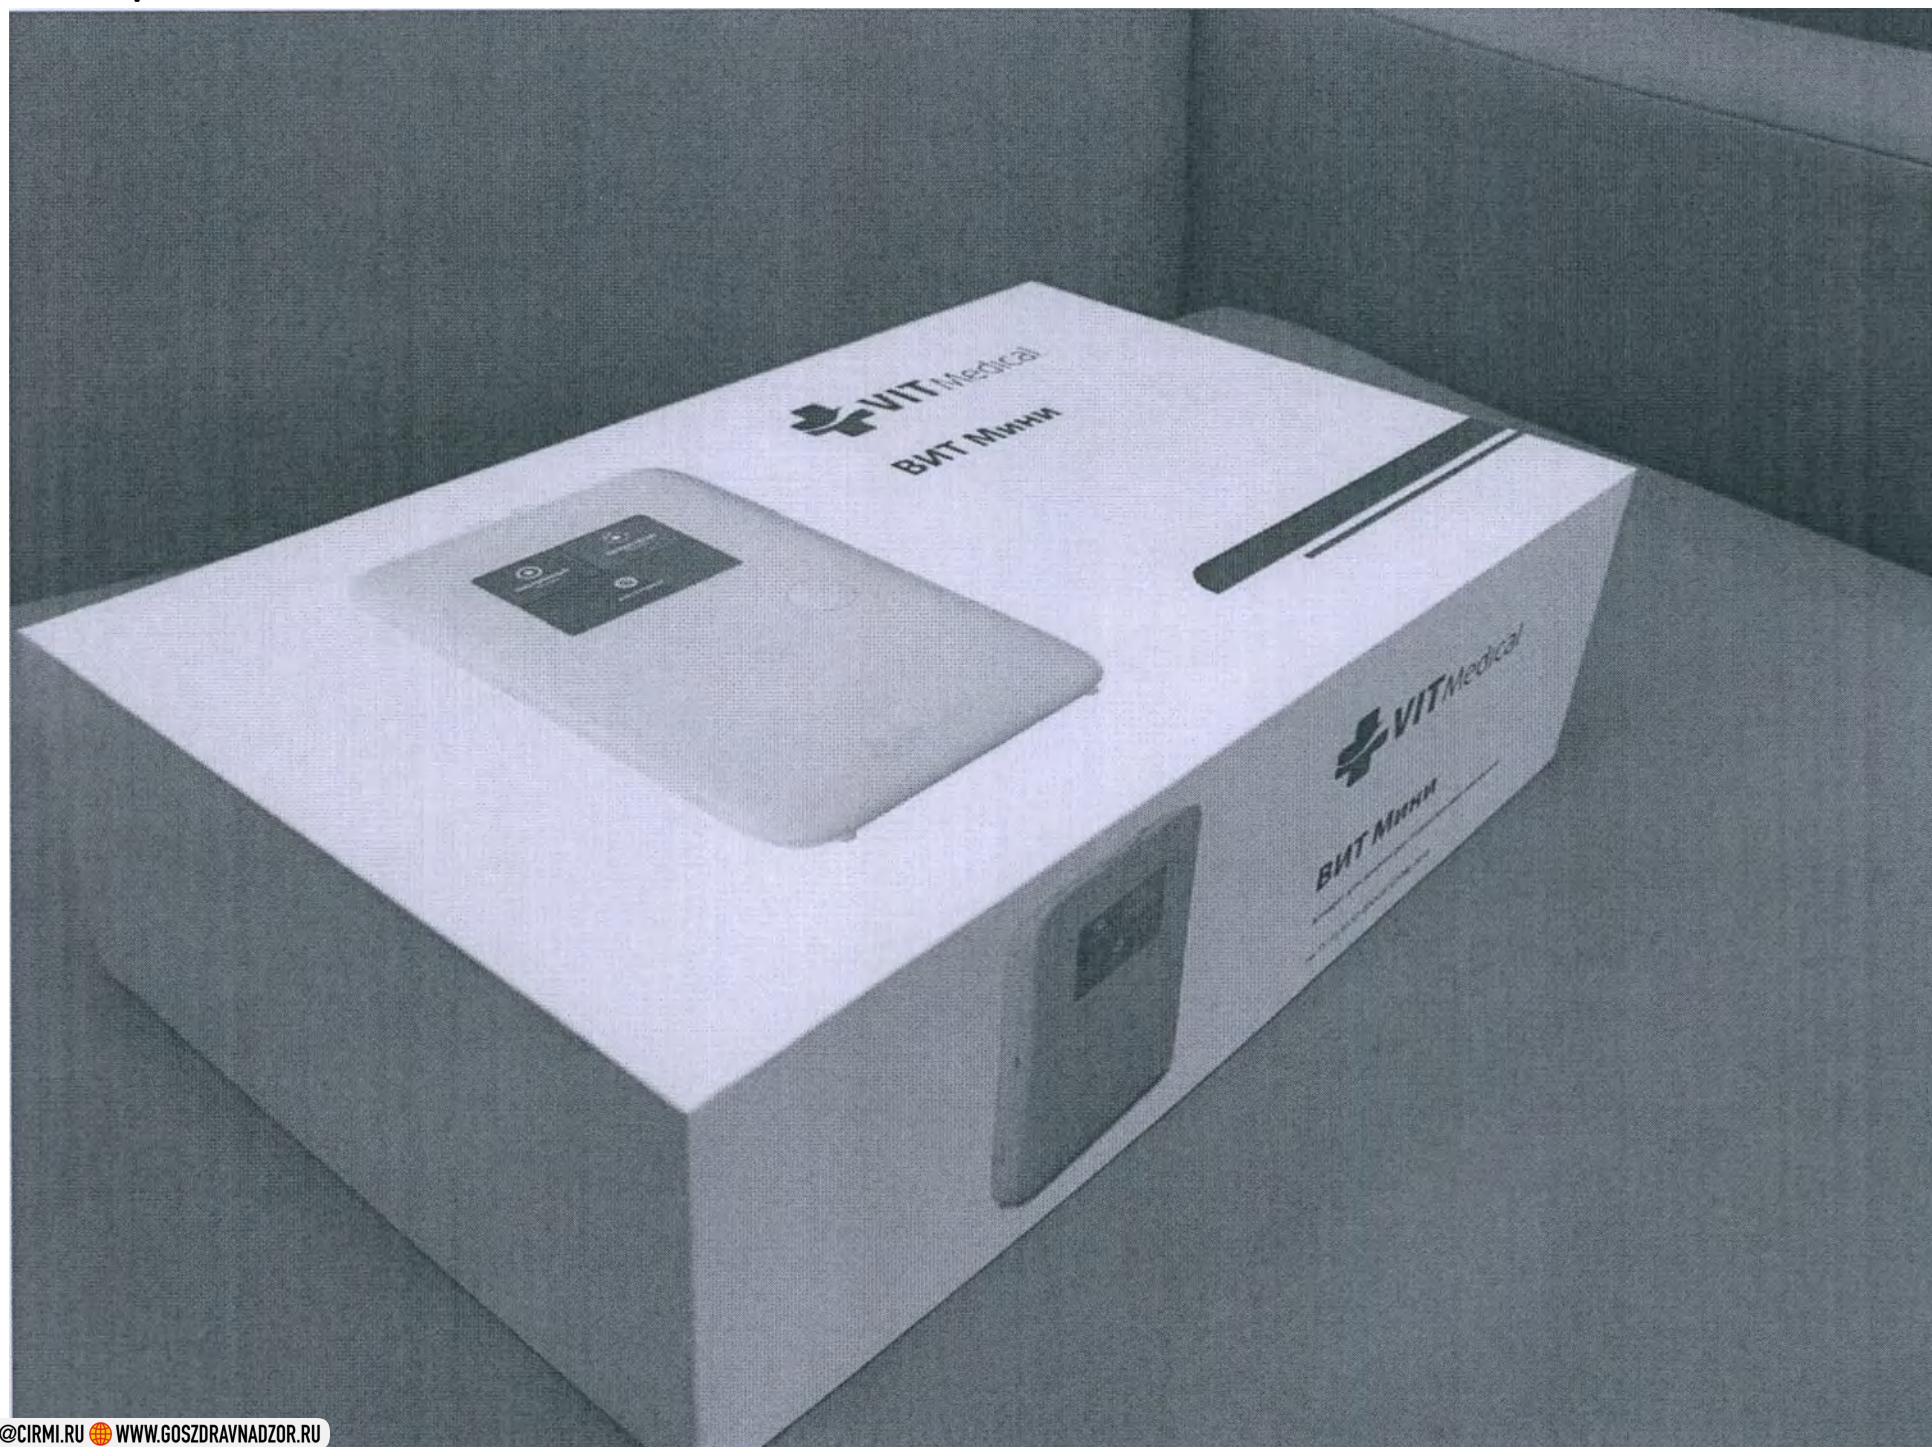

2. Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018, в составе:

2.1. Аппарат «ВИТ Мини» - 1 шт. (Маркировка)

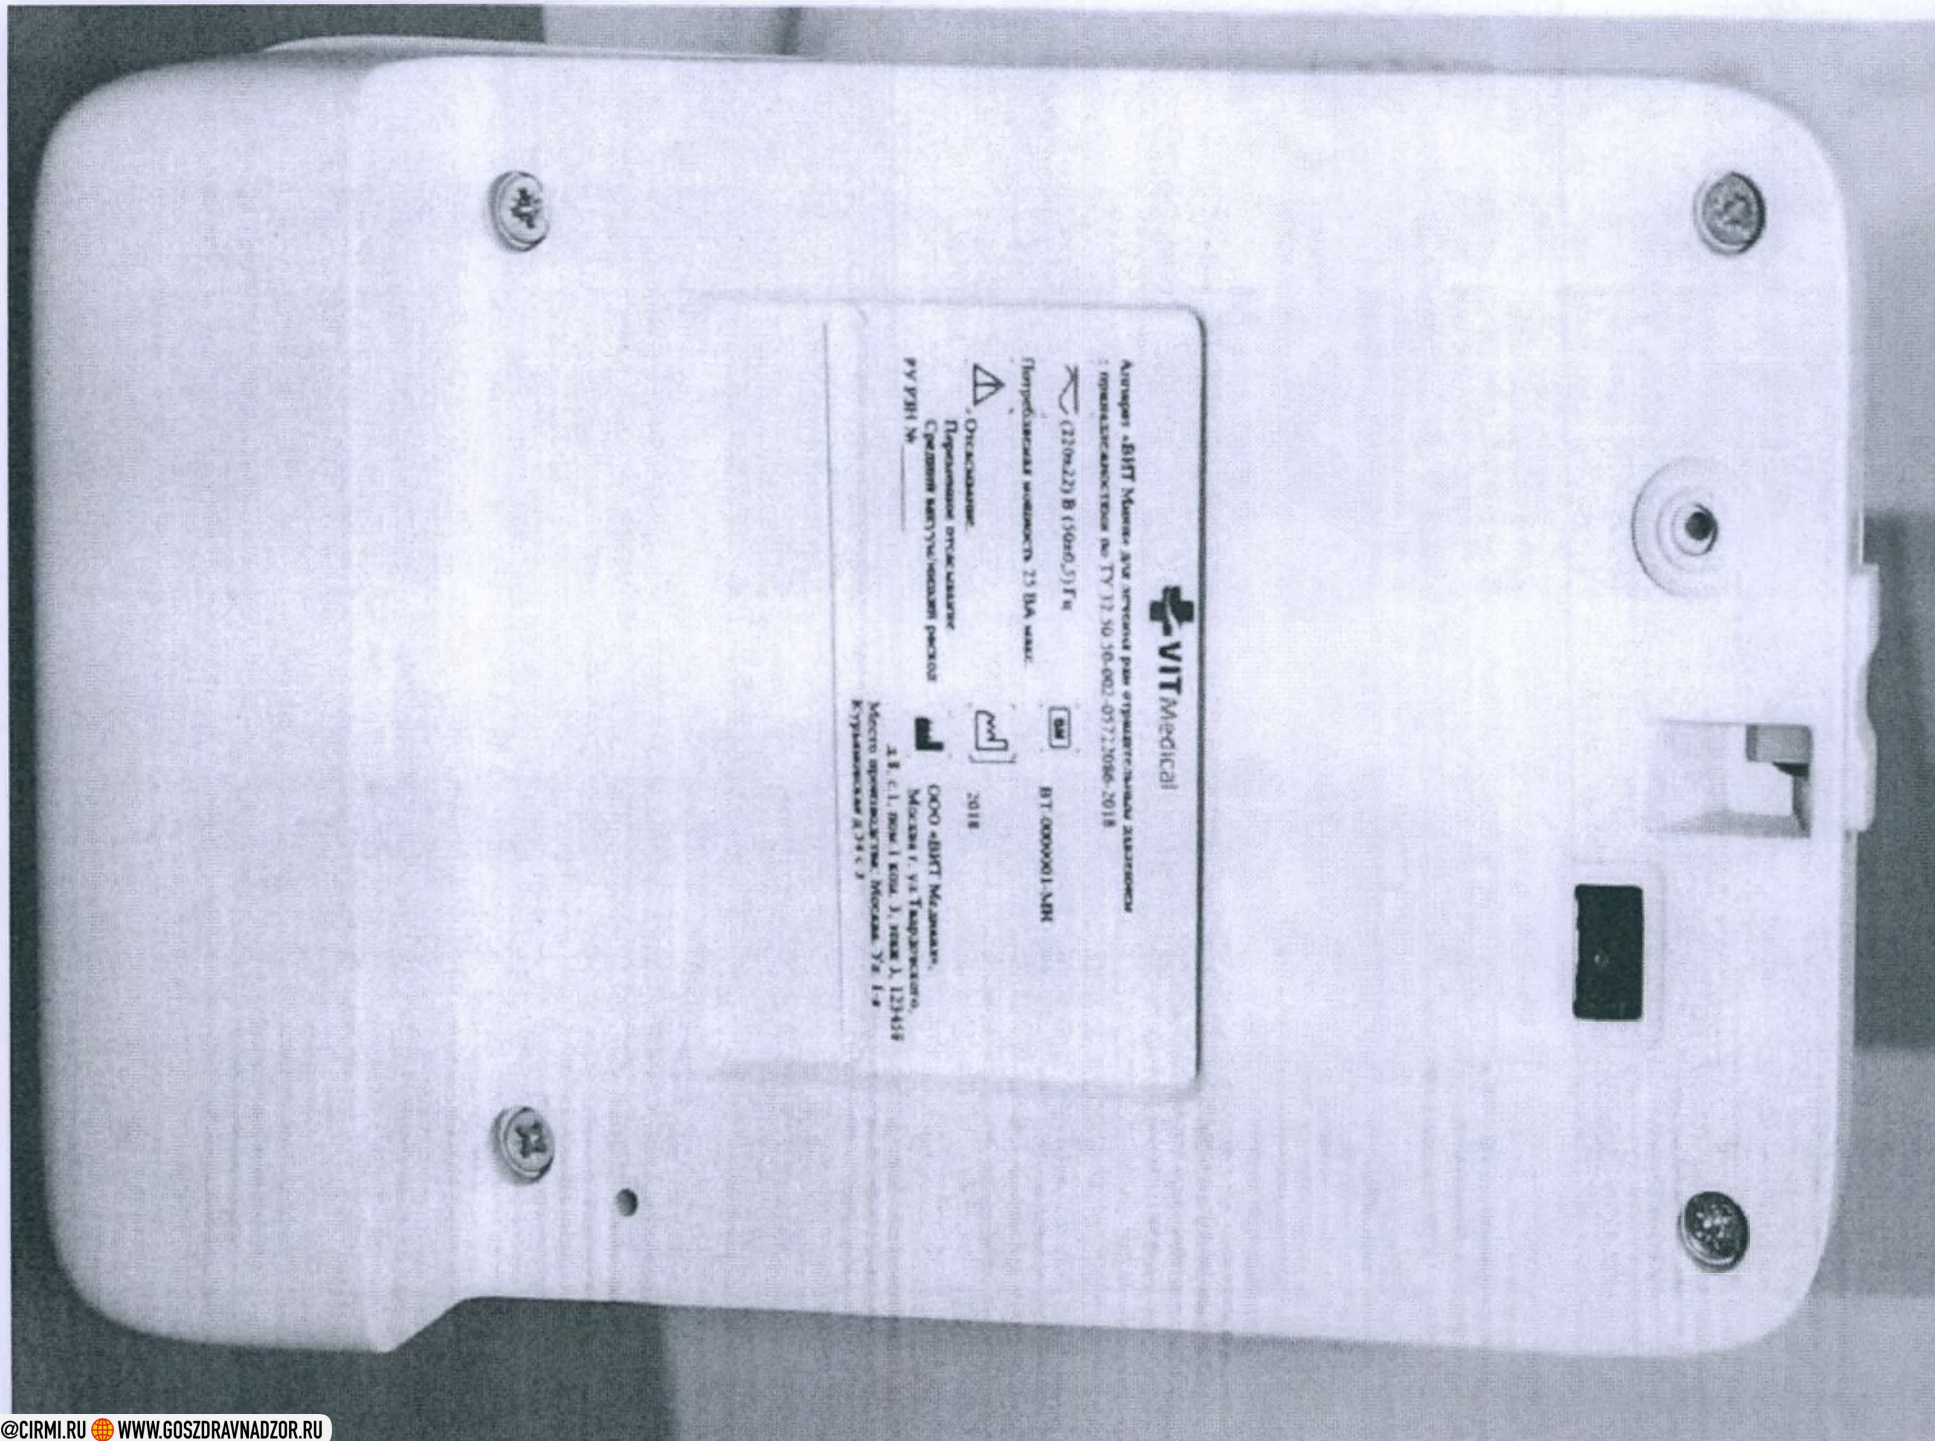


2. Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением по ТУ 32.50.50-002-05722086-2018, в составе:

60

2.1. Аппарат «ВИТ Мини» - 1 шт.



2.2. Зарядное устройство - 1 шт.

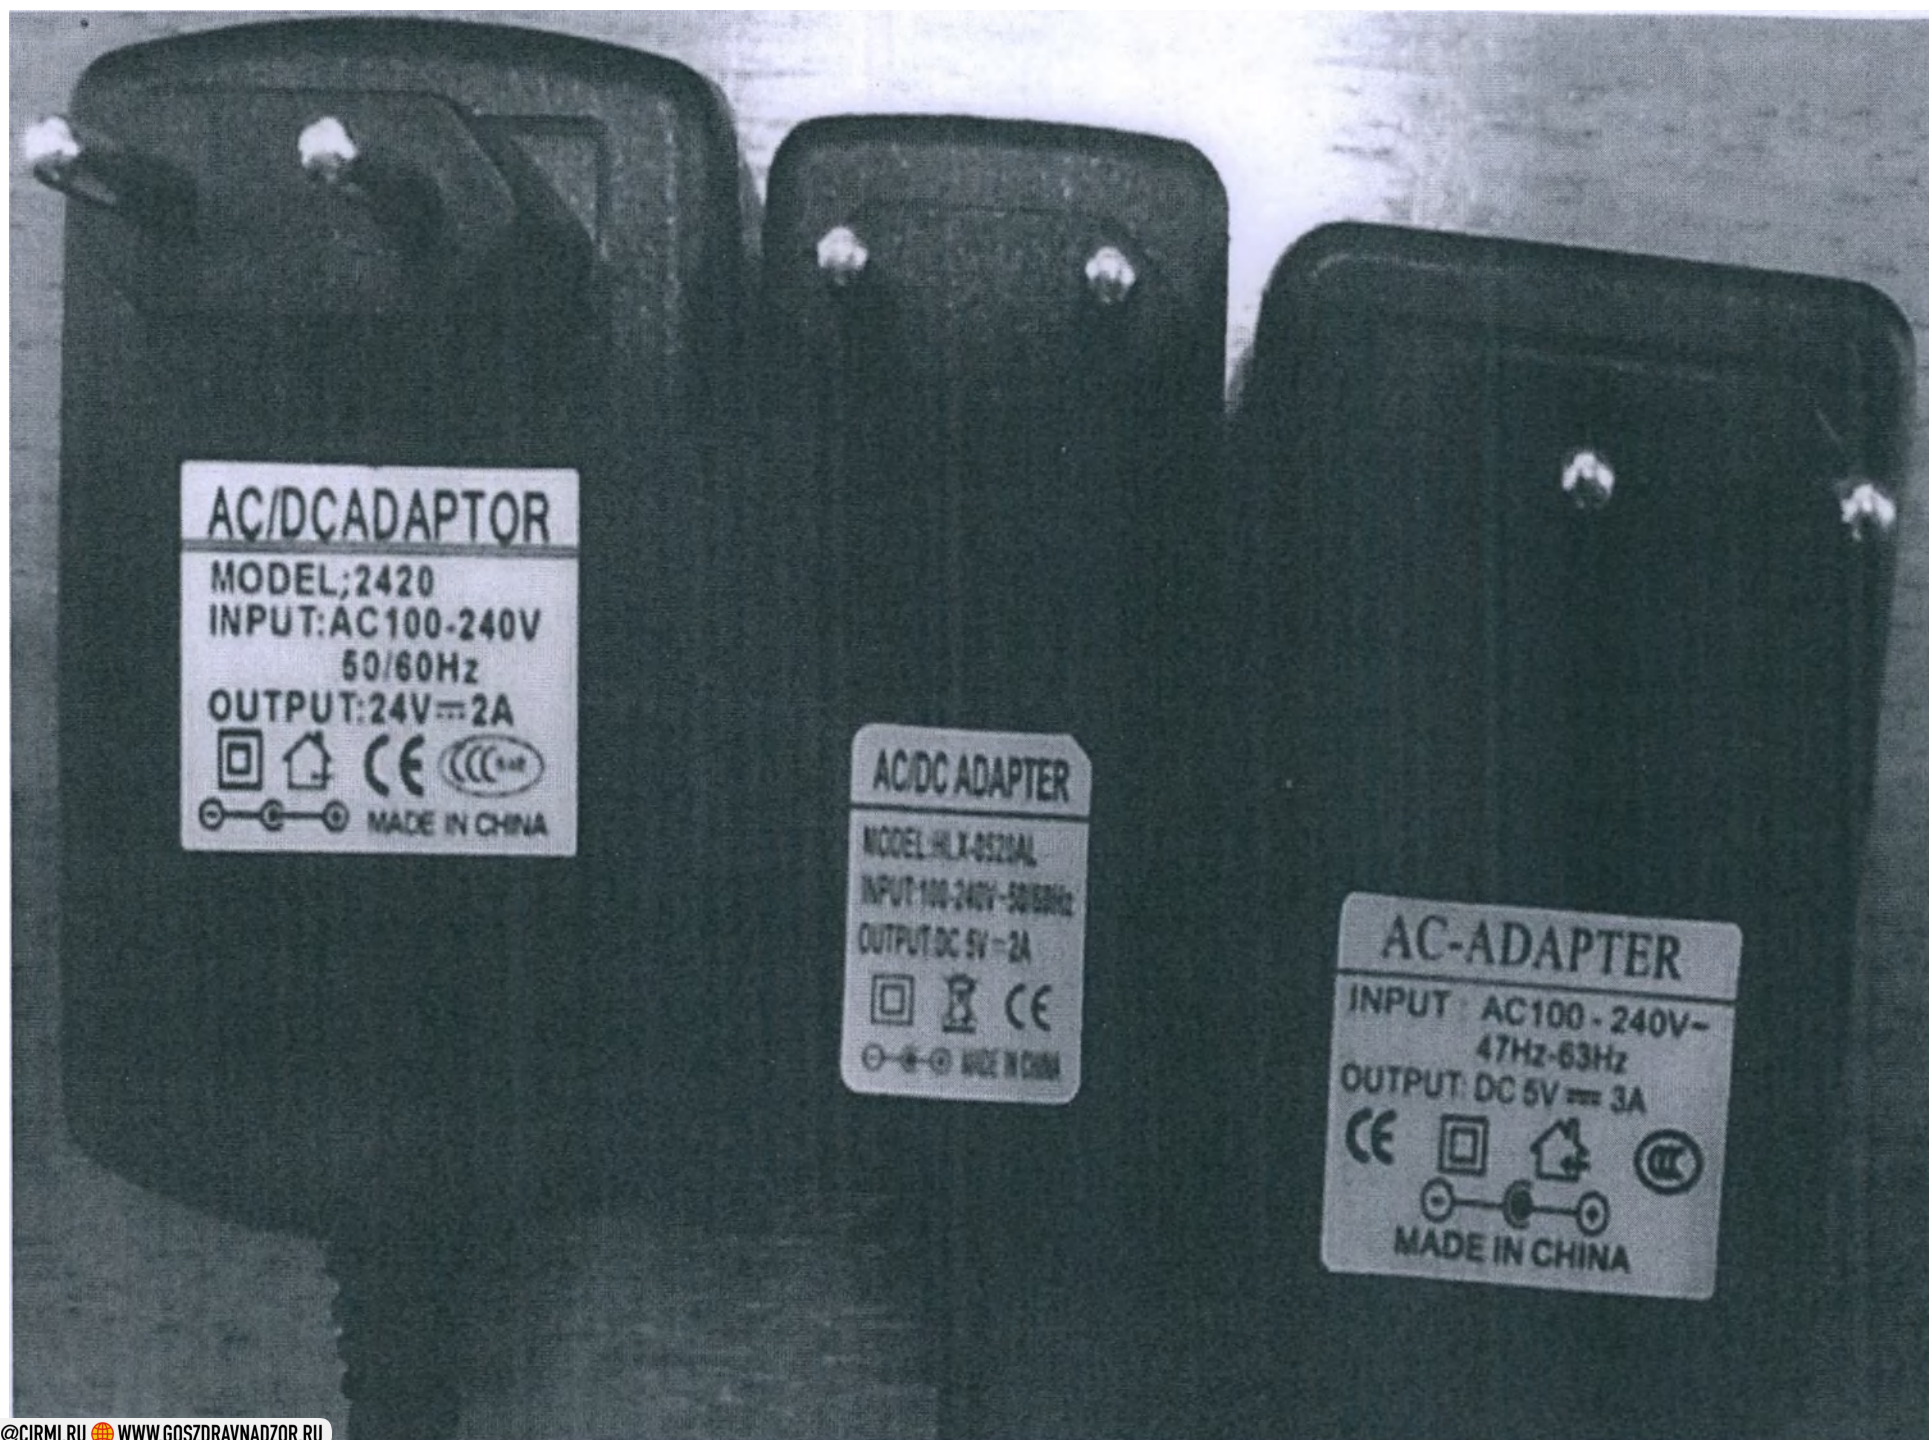

2.3. Емкость для сбора экссудата 200 мл - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Емкость для сбора экссудата

Применяется с:

Размер

	700
	400
V	200

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»),
Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458
Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации


Нестерильно. Нетоксично. Апиrogenно.



2.3. Емкость для сбора экссудата 200 мл - не более 200 шт. (при необходимости).



2.3. Емкость для сбора экссудата 200 мл - не более 200 шт. (при необходимости).

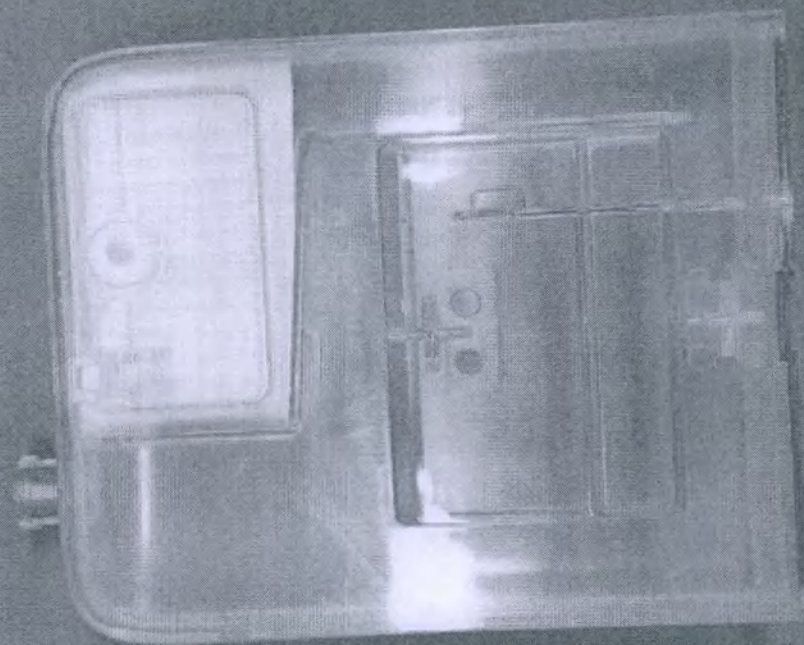

2.4. Повязка-губка для ран, размер S - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Повязка-губка для ран

Применяется с:

Размер

V	S
	M
	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT

Партия №

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458)

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.



STERILE R

2.4. Повязка-губка для ран, размер S - не более 200 шт. (при необходимости).

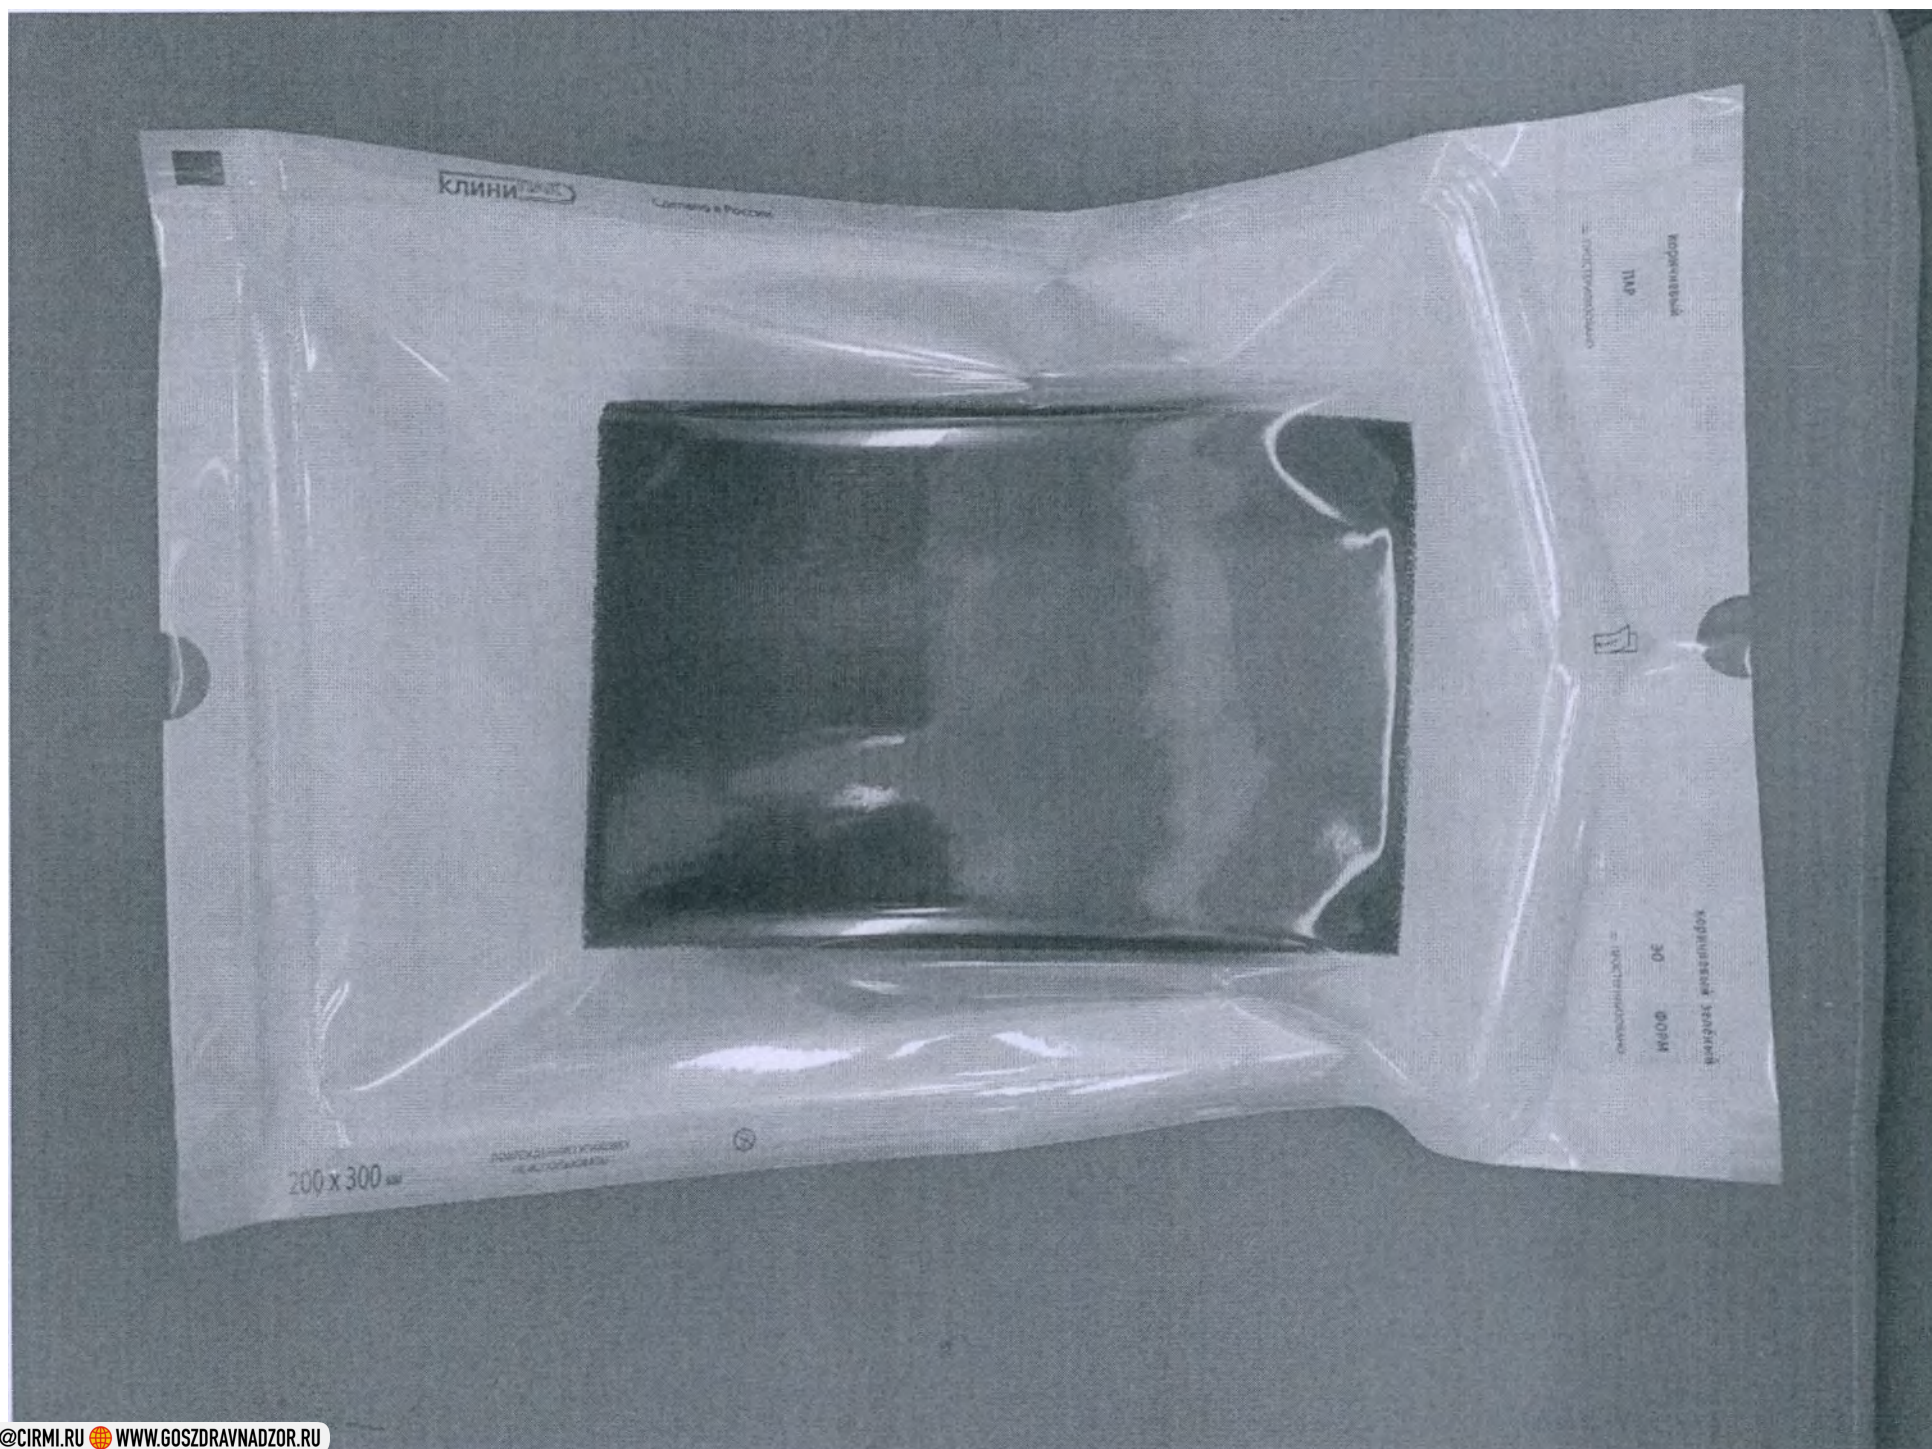

2.4. Повязка-губка для ран, размер S - не более 200 шт. (при необходимости).



2.5. Повязка-губка для ран, размер М - не более 200шт. (при необходимости). (Маркировка)

Повязка-губка для ран

Применяется с:

Размер	
☐	S
☒ V	M
☐	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT	Партия №
SN	№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458


Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации


Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.



2.5. Повязка-губка для ран, размер М - не более 200шт. (при необходимости).



2.5. Повязка-губка для ран, размер М - не более 200шт. (при необходимости).

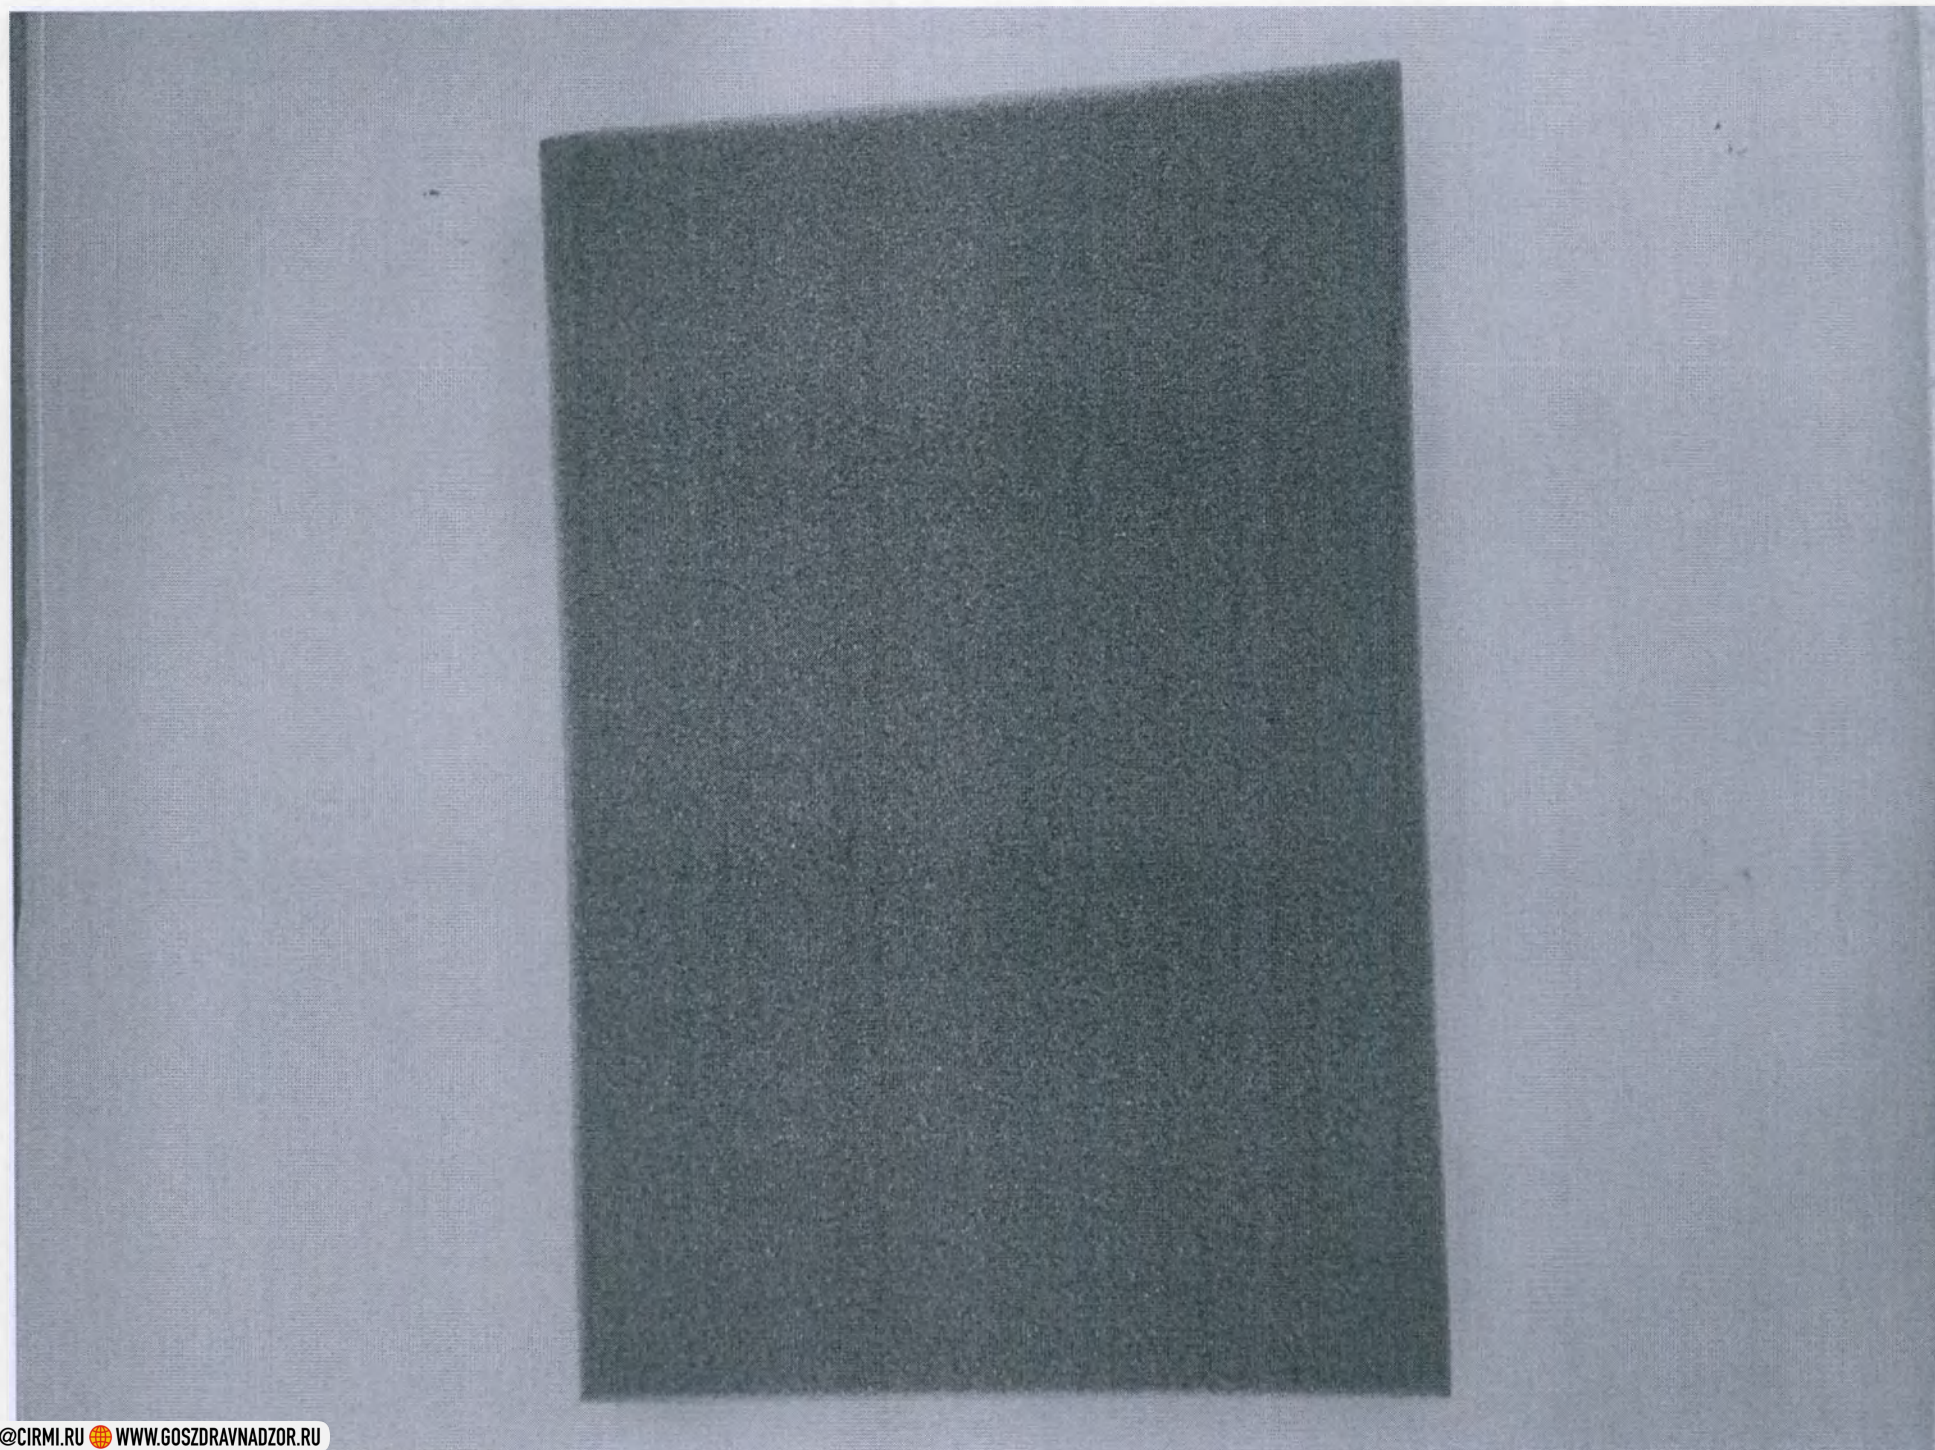

2.6. Повязка-губка для ран, размер L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Повязка-губка для ран

Применяется с:

	Размер
☐	S
☐	M
☐	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

Партия №

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

2.6. Повязка-губка для ран, размер L - не более 200 шт. (при необходимости).

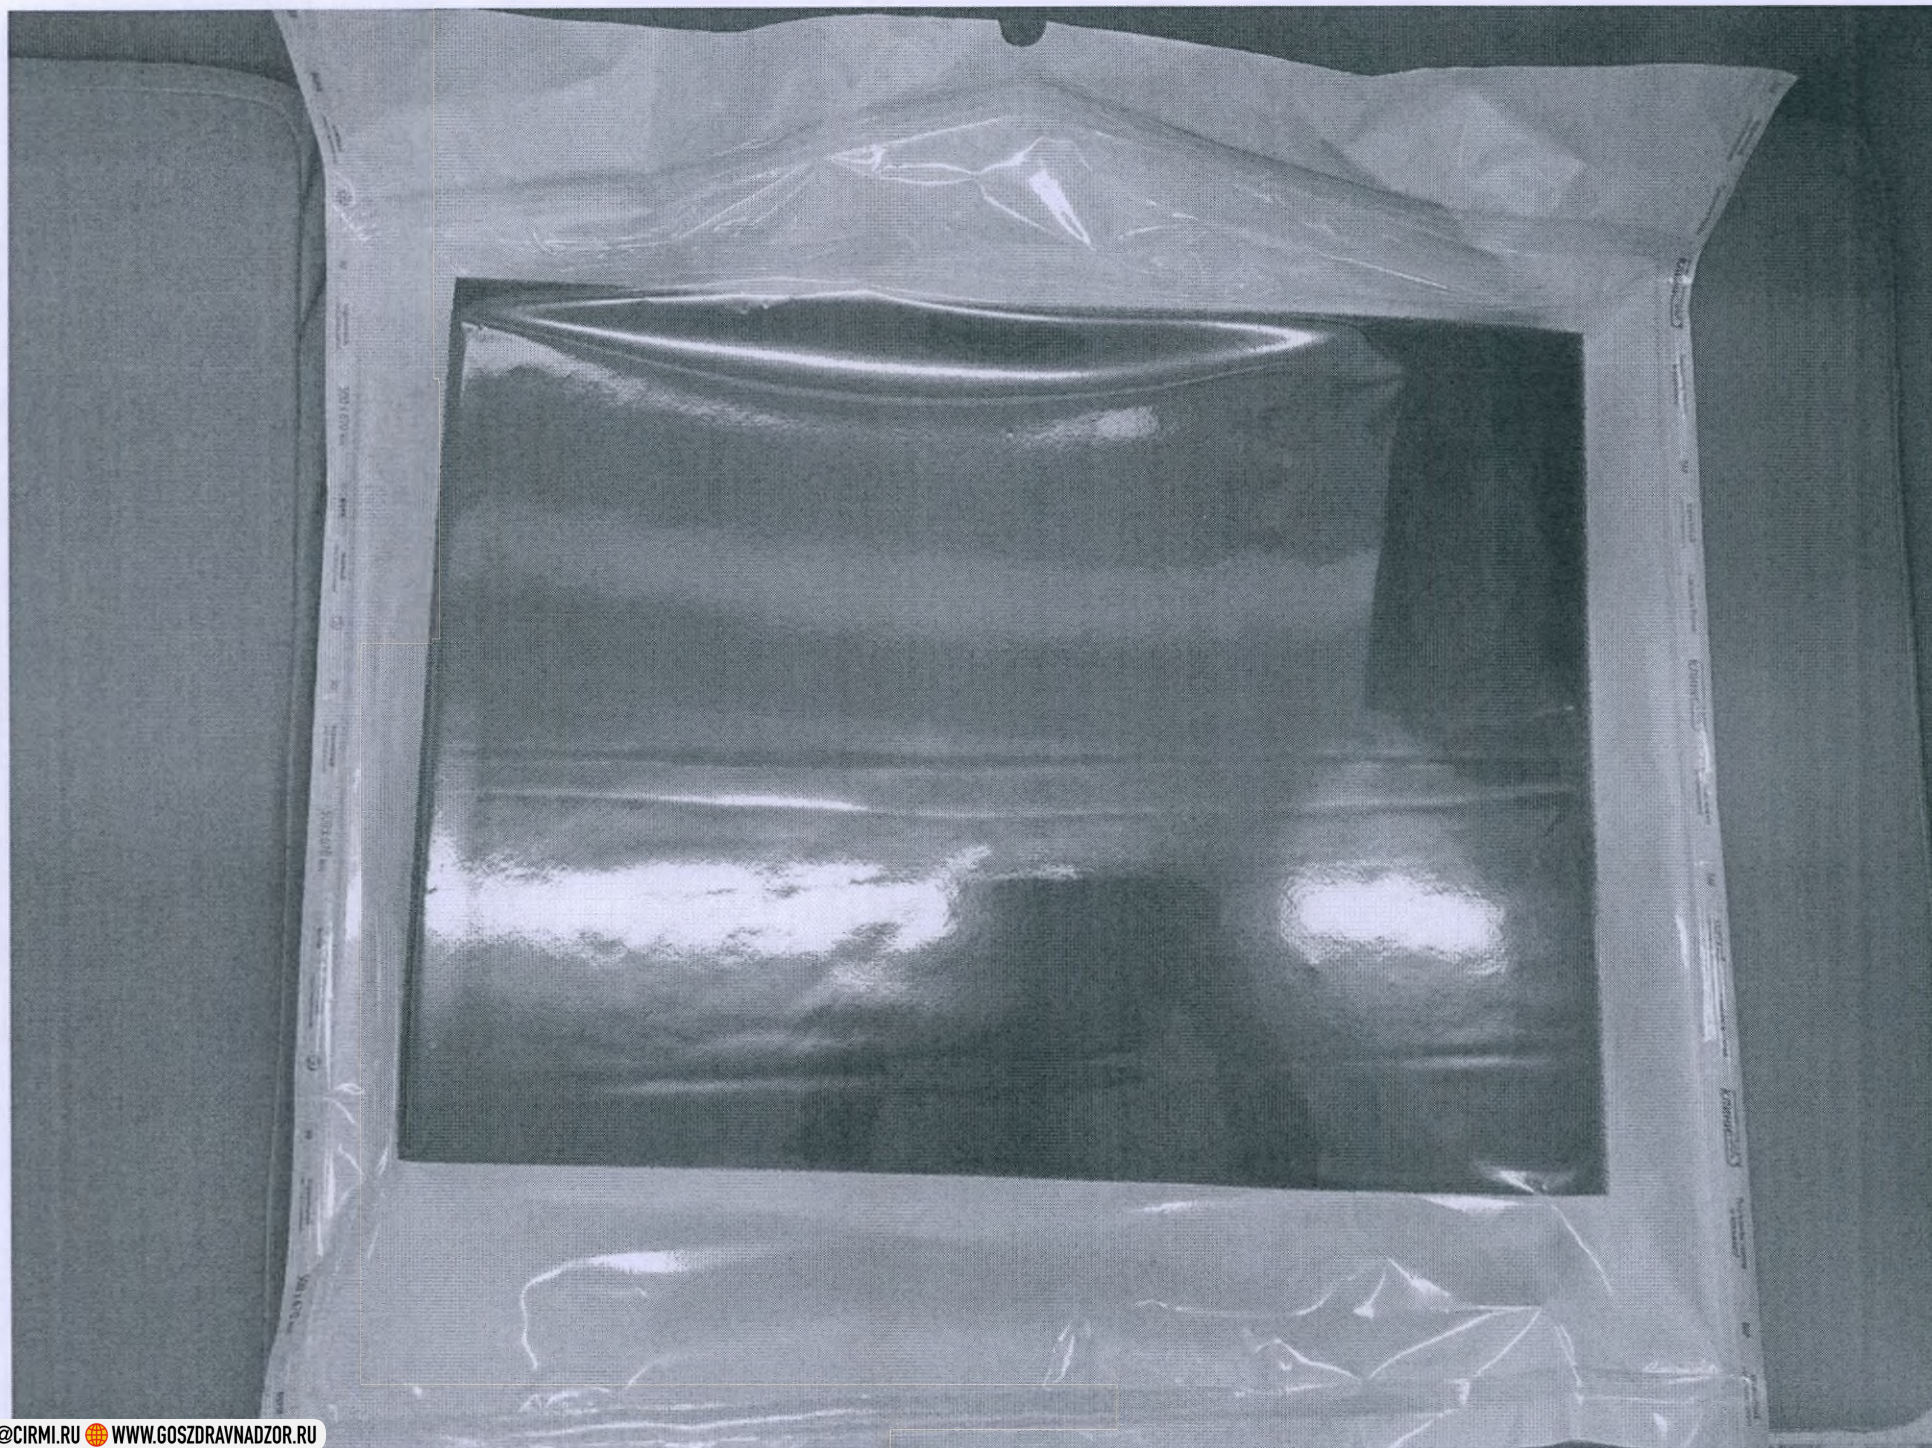

2.6. Повязка-губка для ран, размер L - не более 200 шт. (при необходимости).

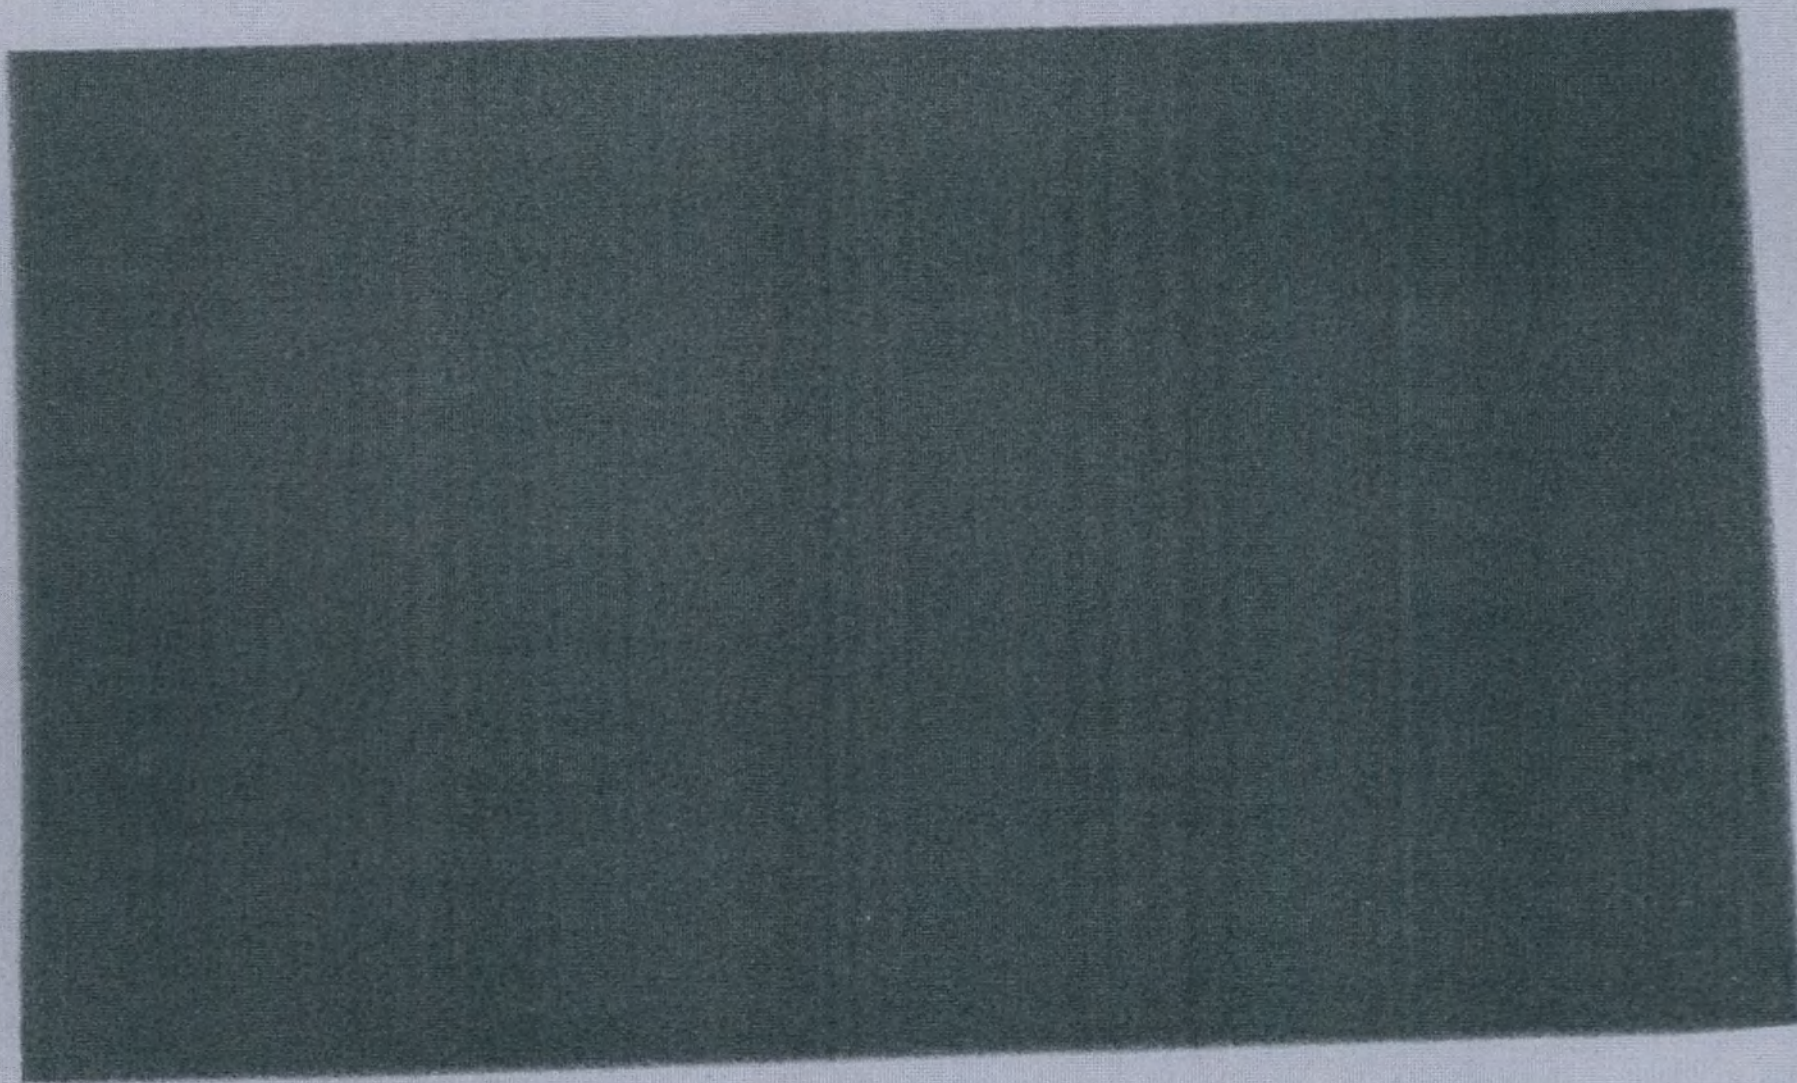

2.7. Порт дренажный - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

2.7. Порт дренажный - не более 200 шт. (при необходимости).



2.7. Порт дренажный - не более 200 шт. (при необходимости).

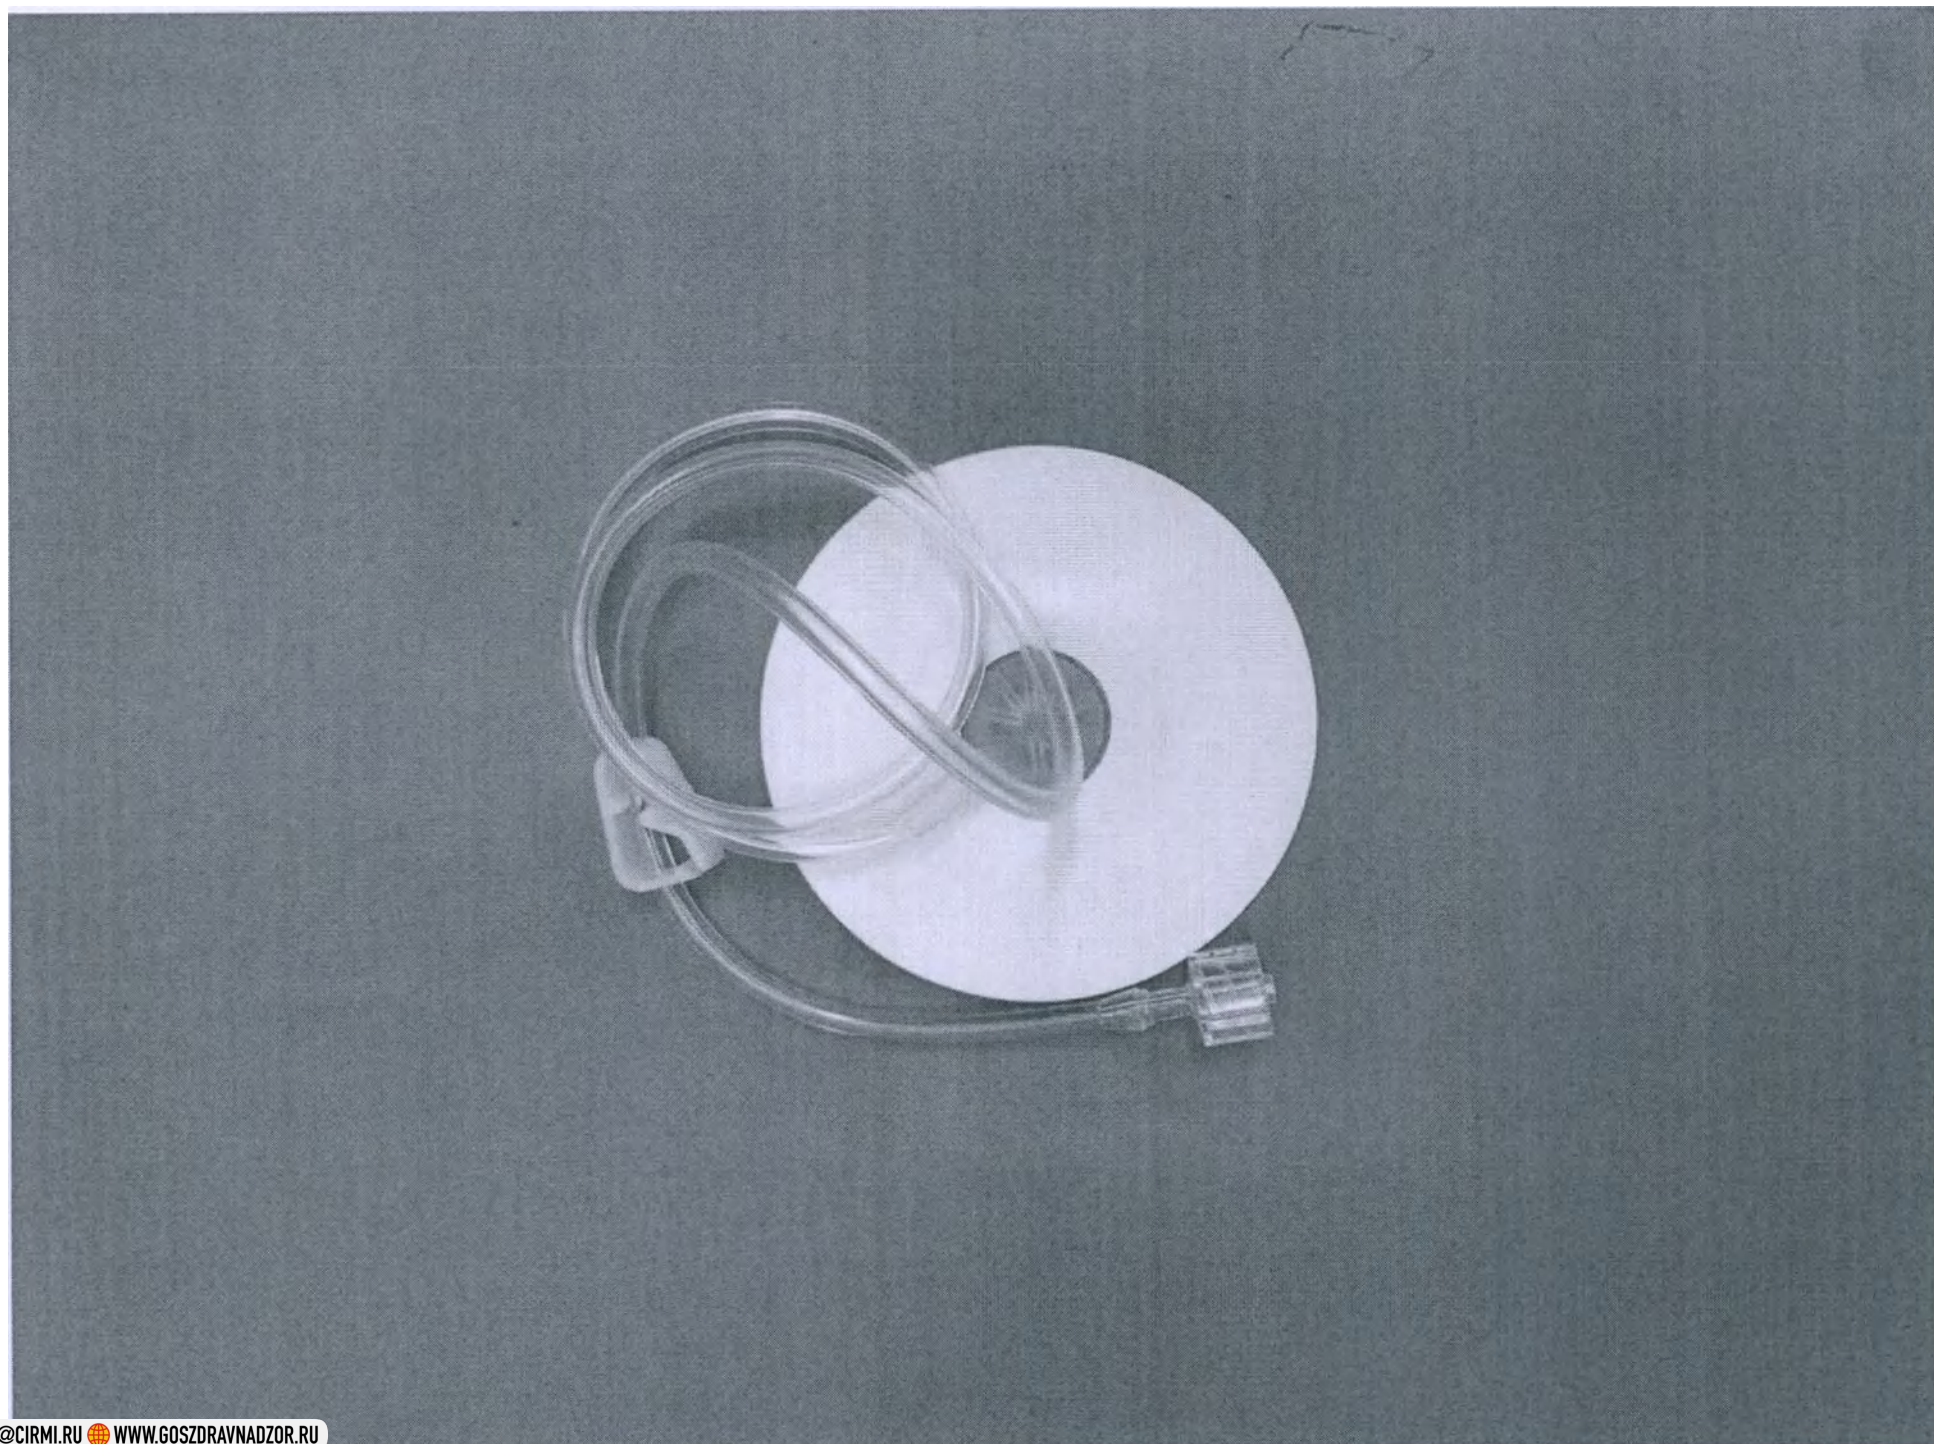

2.8. Порт дренажный мягкий - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный мягкий

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

2.8. Порт дренажный мягкий - не более 200 шт. (при необходимости).

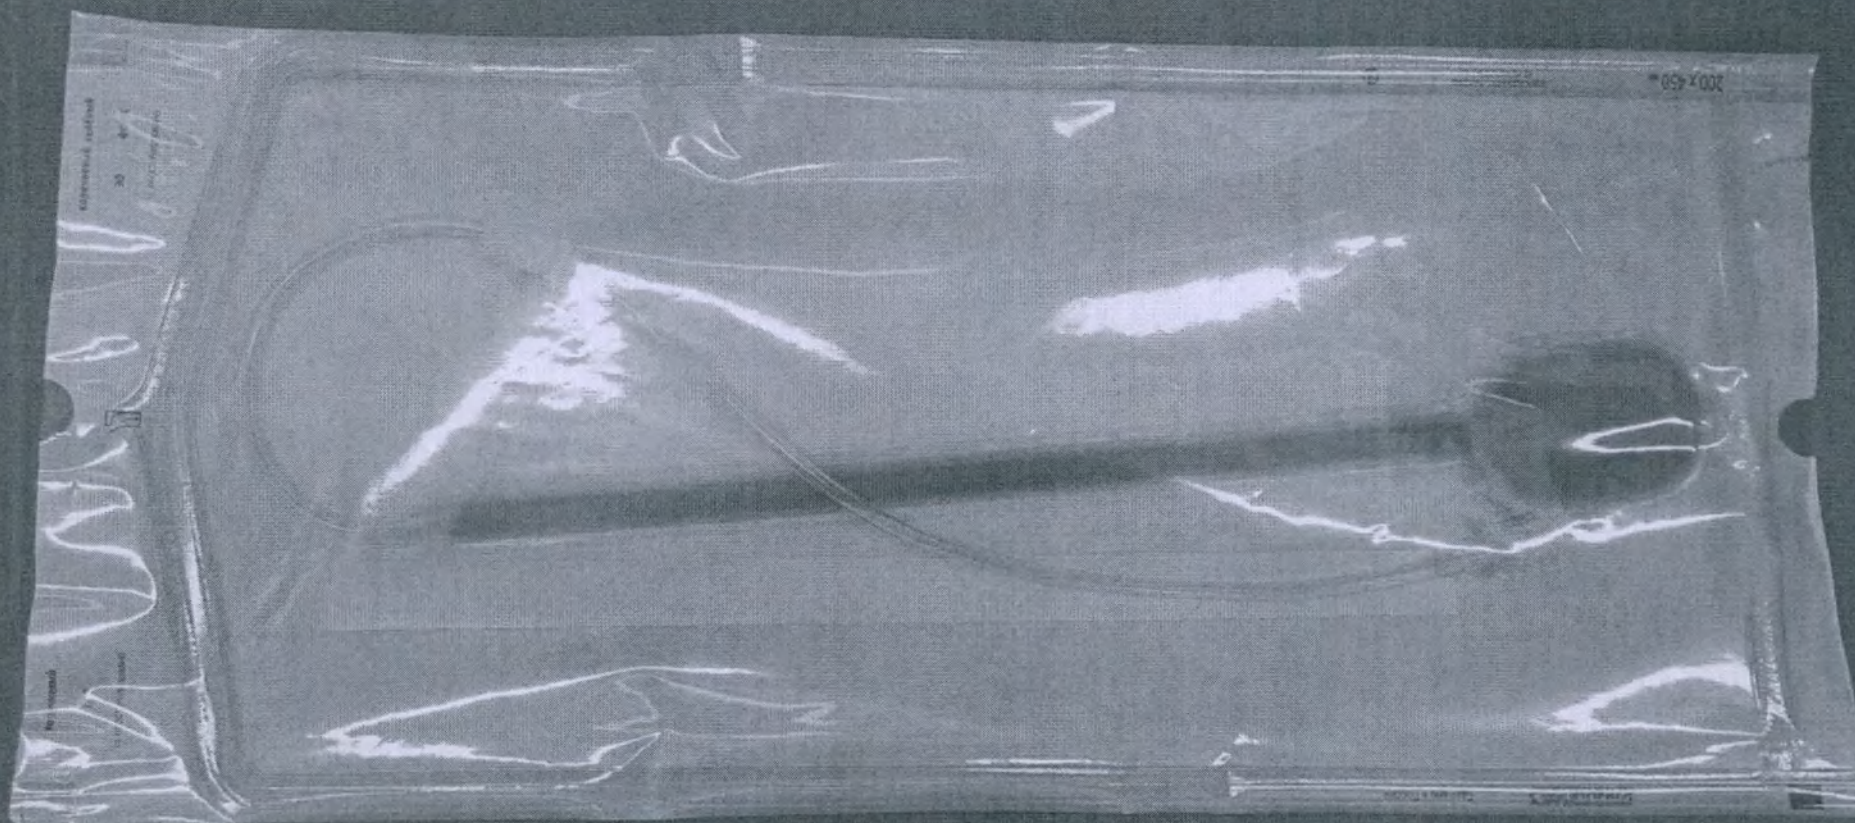

2.8. Порт дренажный мягкий - не более 200 шт. (при необходимости).

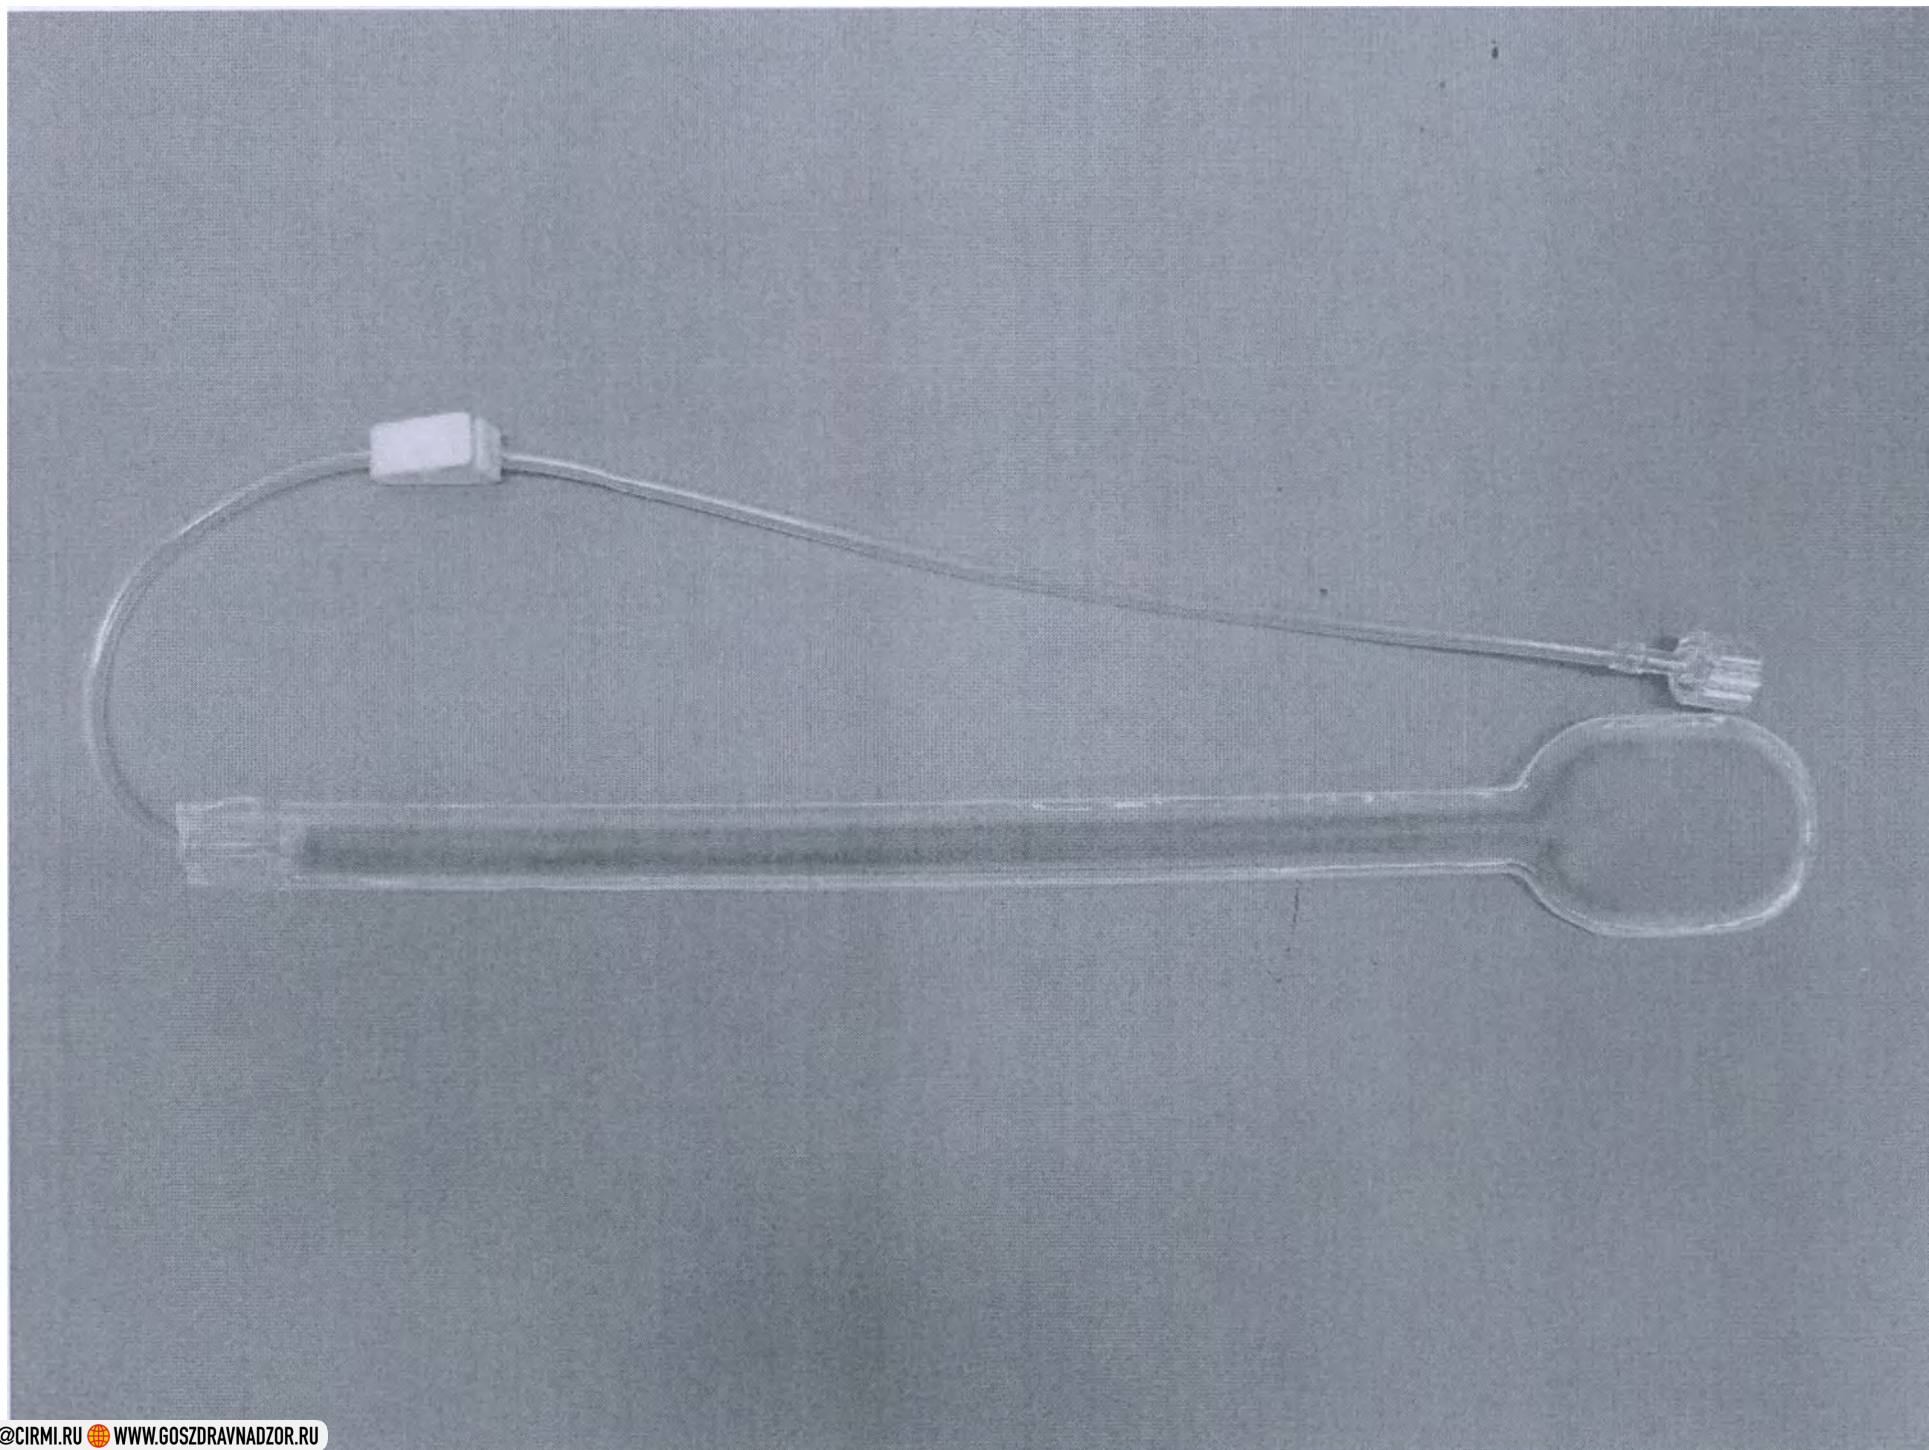

2.9. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный впитывающий

Применяется с:

Размер

V	S
	M
	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE A

2.9. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).



2.9. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).

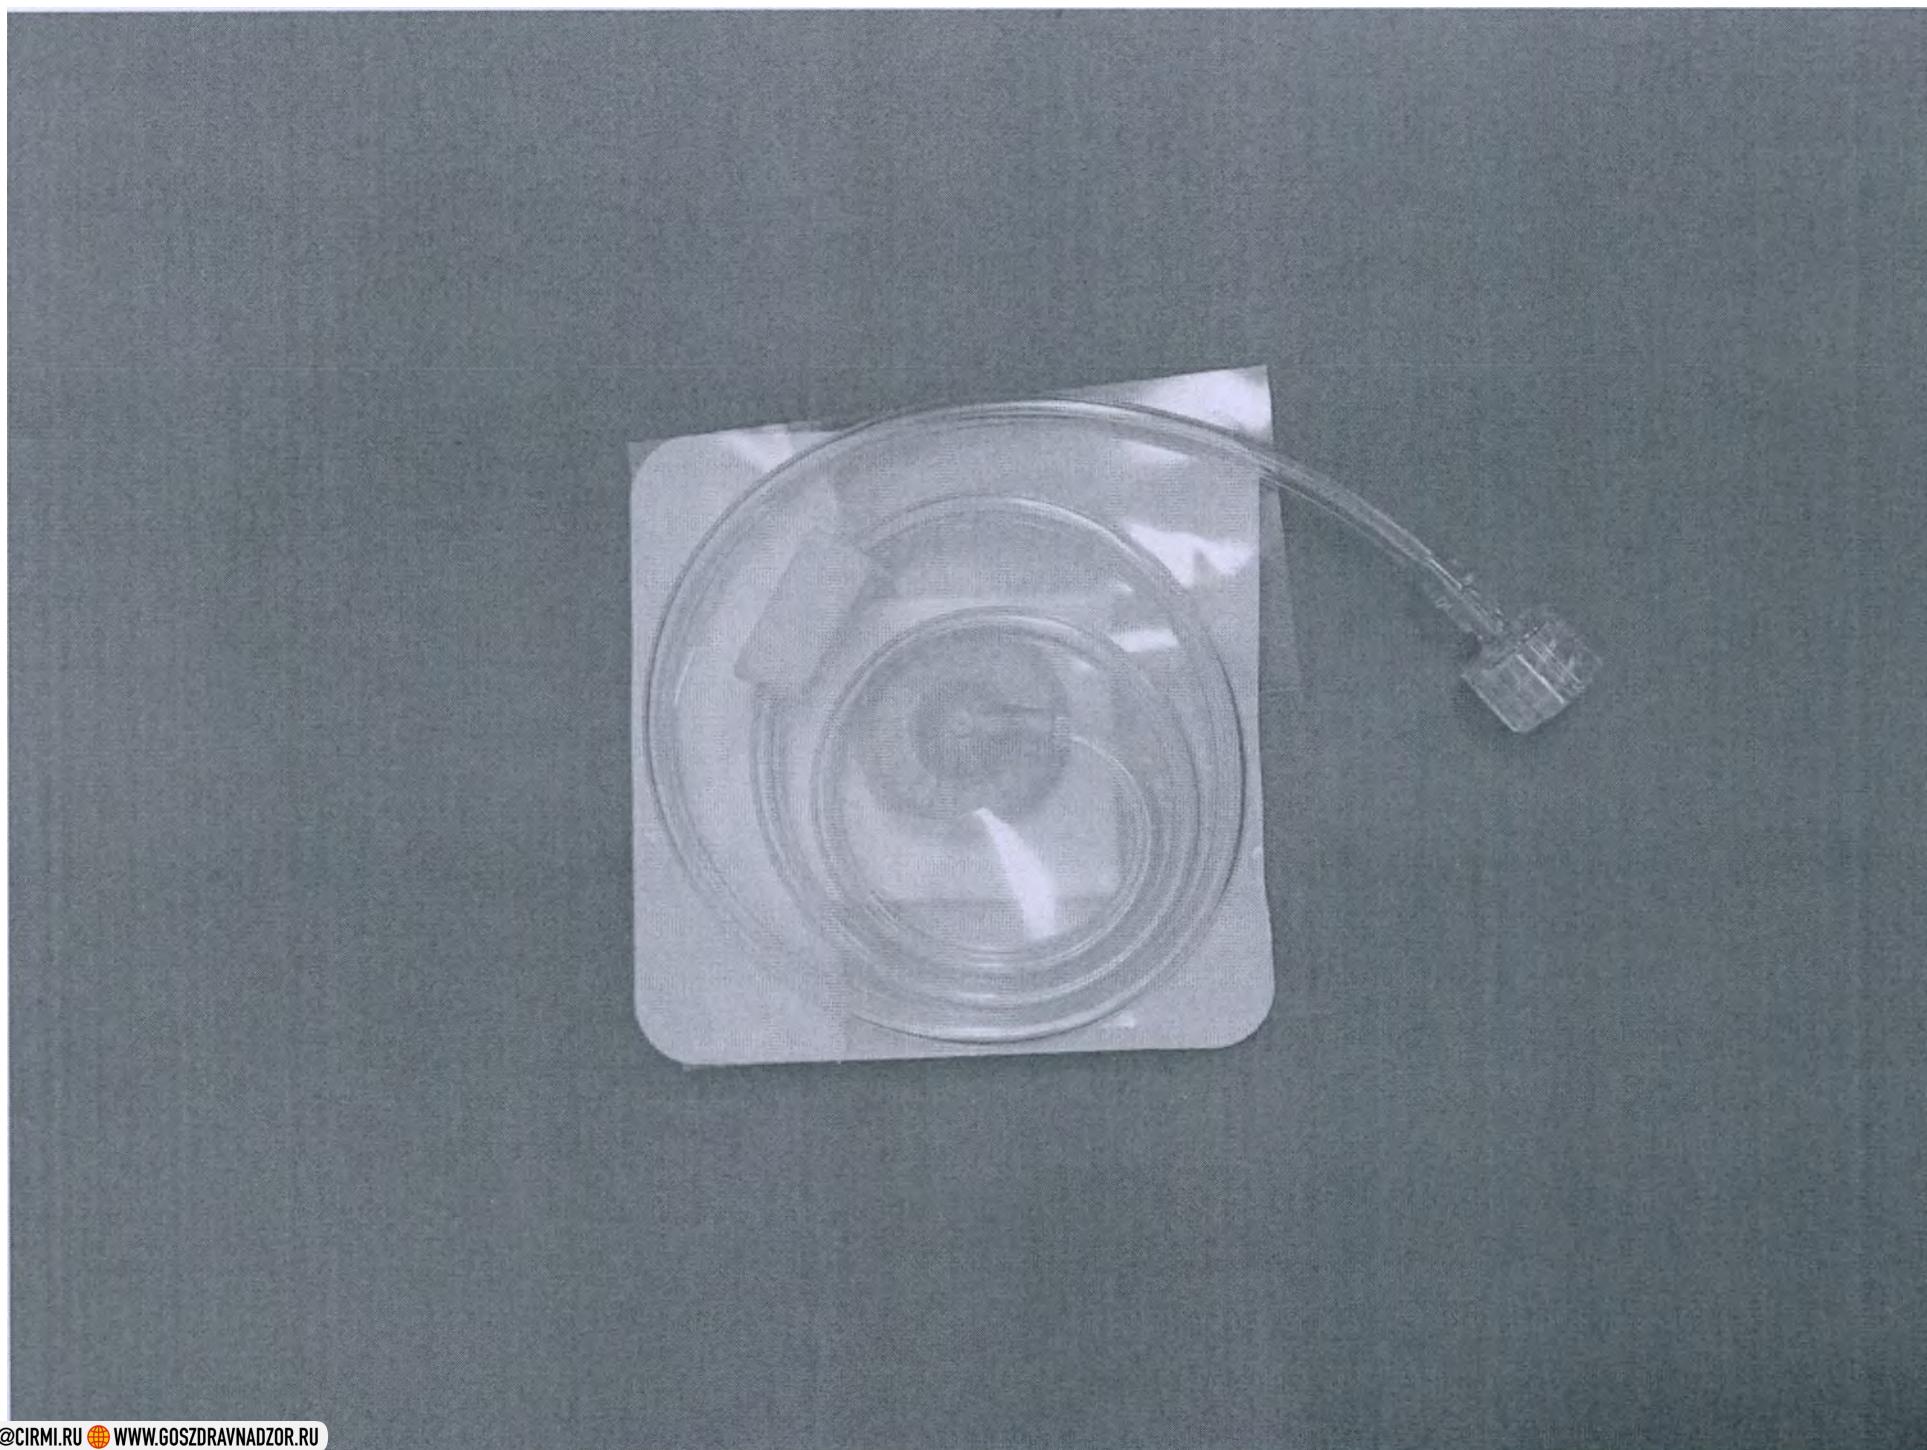

2.9. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный впитывающий

Применяется с:

Размер

☐	S
☒	M
☐	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Использовать до:

LOT

Партия №

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE A

2.9. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).



2.9. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).

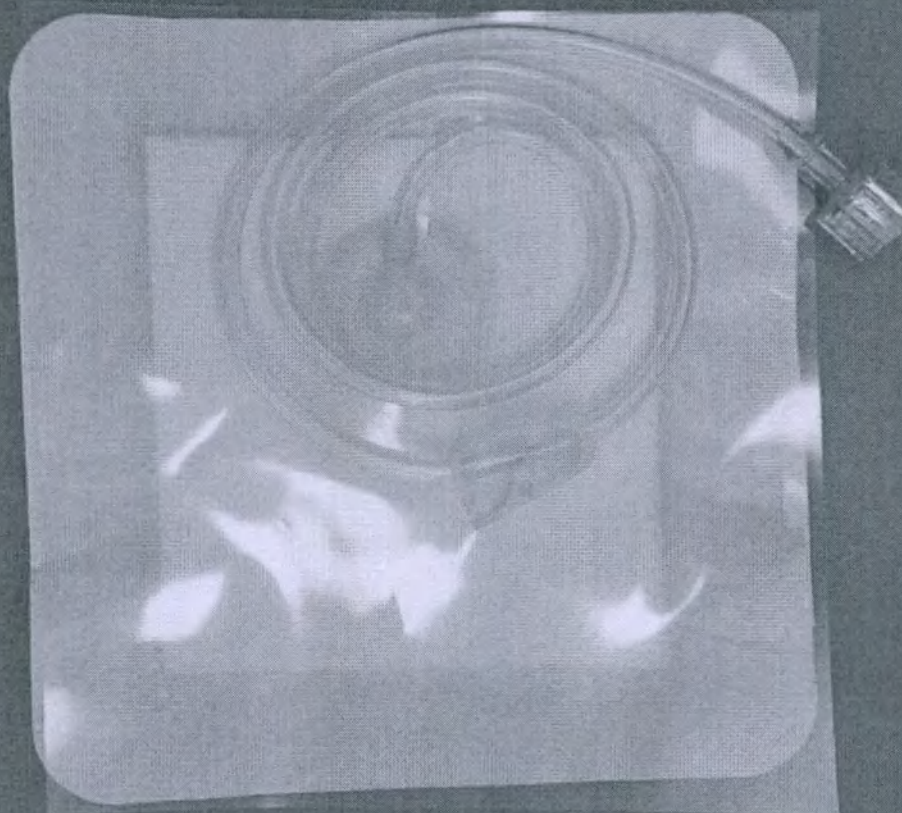

2.9. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Порт дренажный впитывающий

Применяется с:

Размер

☐	S
☐	M
☐	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

2.9. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).



2.9. Порт дренажный впитывающий, размеры S, M, L - не более 200 шт. (при необходимости).

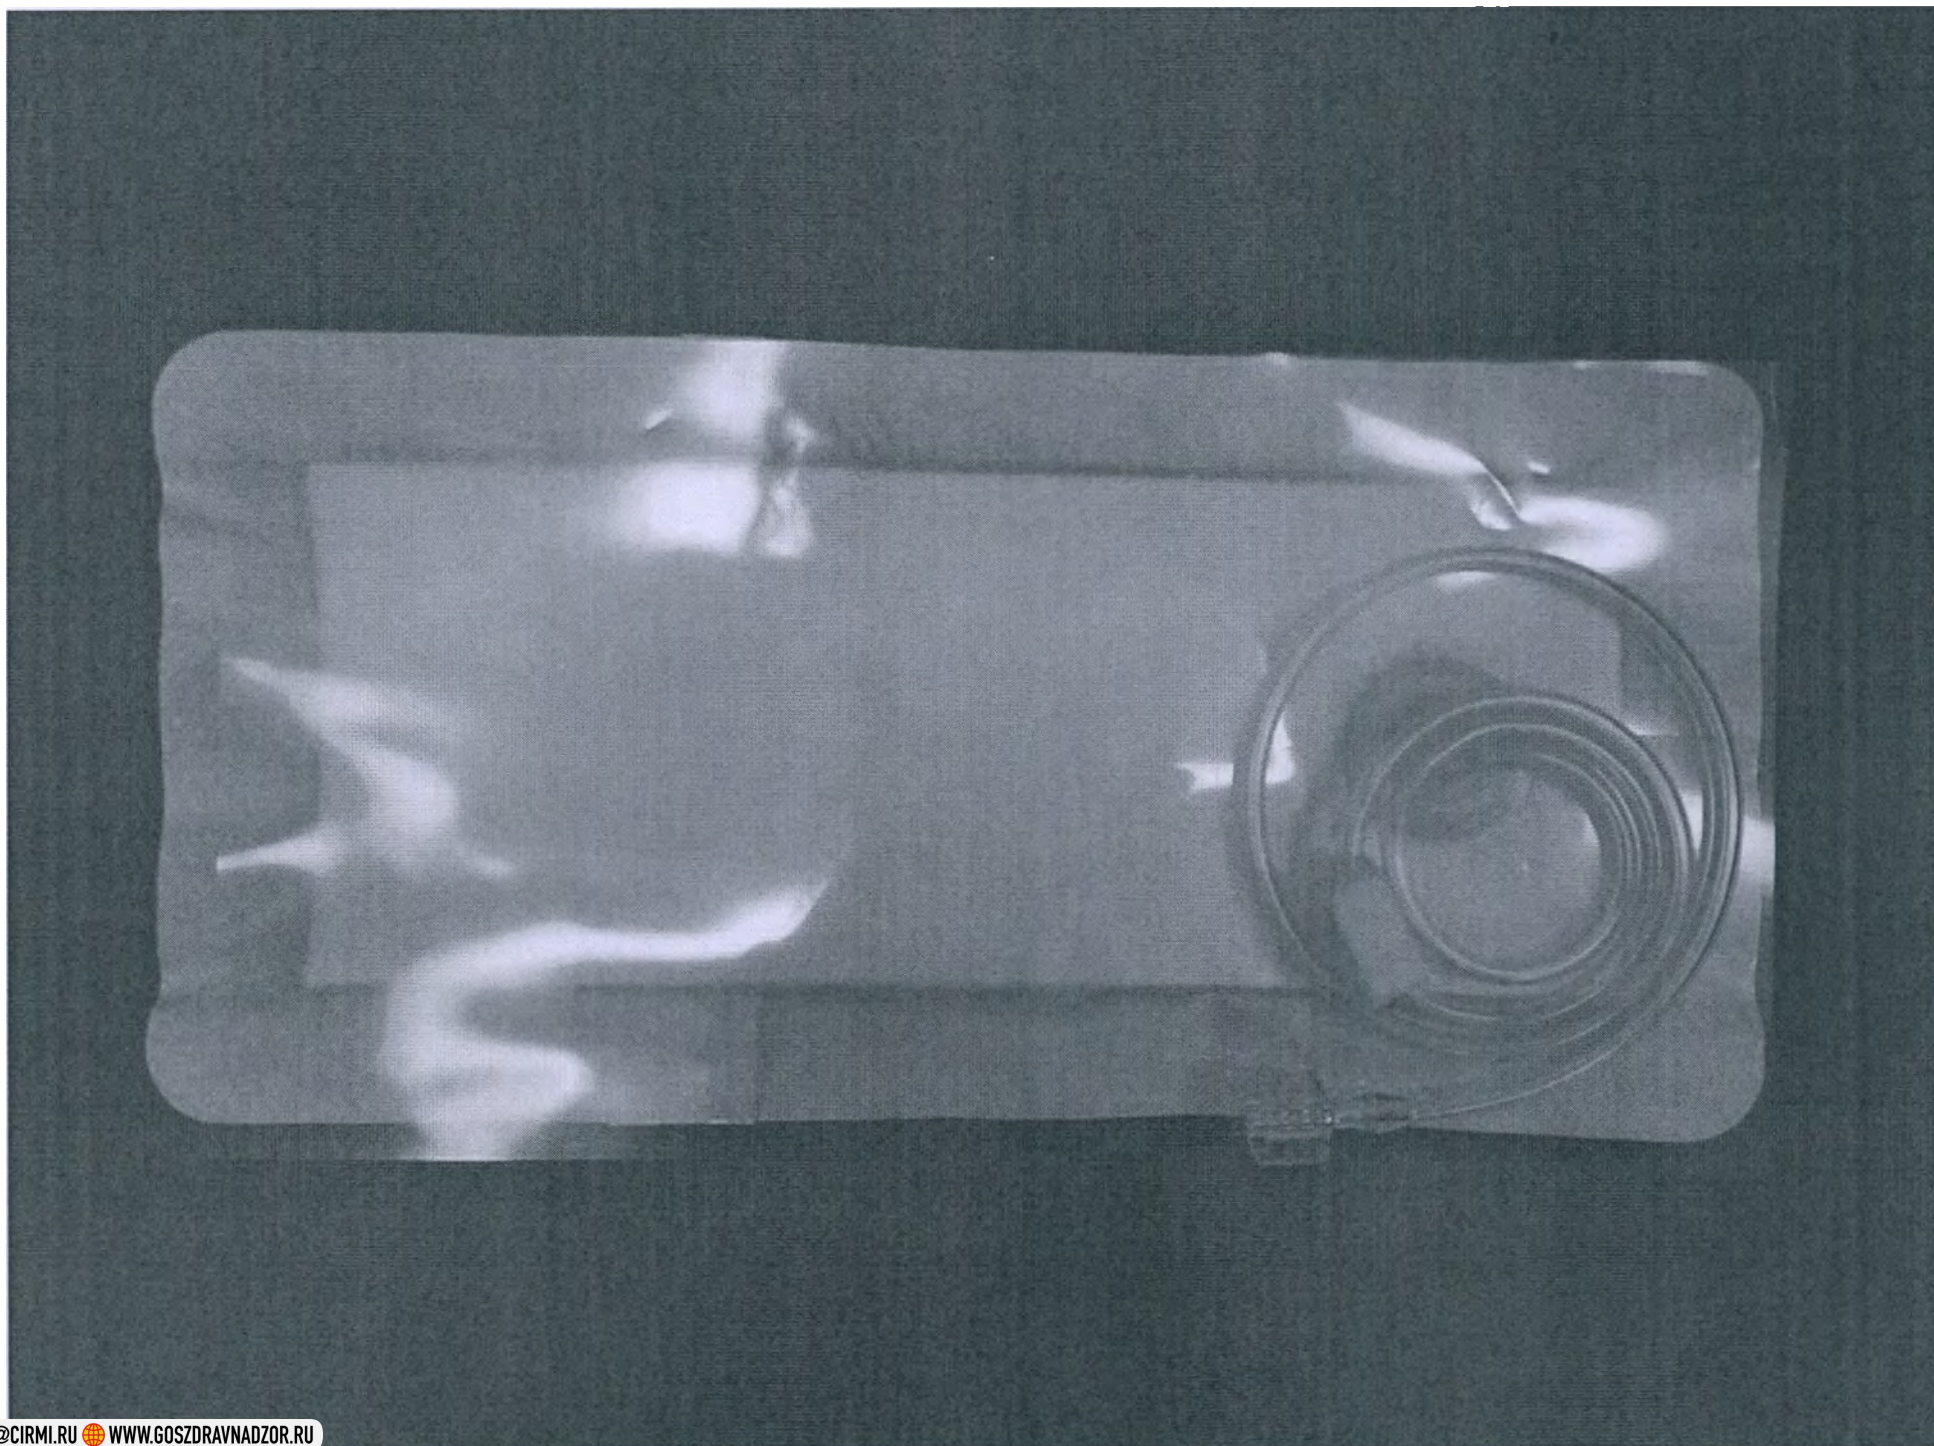

2.10. Пленка инцизная - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Пленка инцизная

Применяется с:

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Негокисно. Апиrogenно.




STERILE R

2.10. Пленка инцизная - не более 200 шт. (при необходимости).

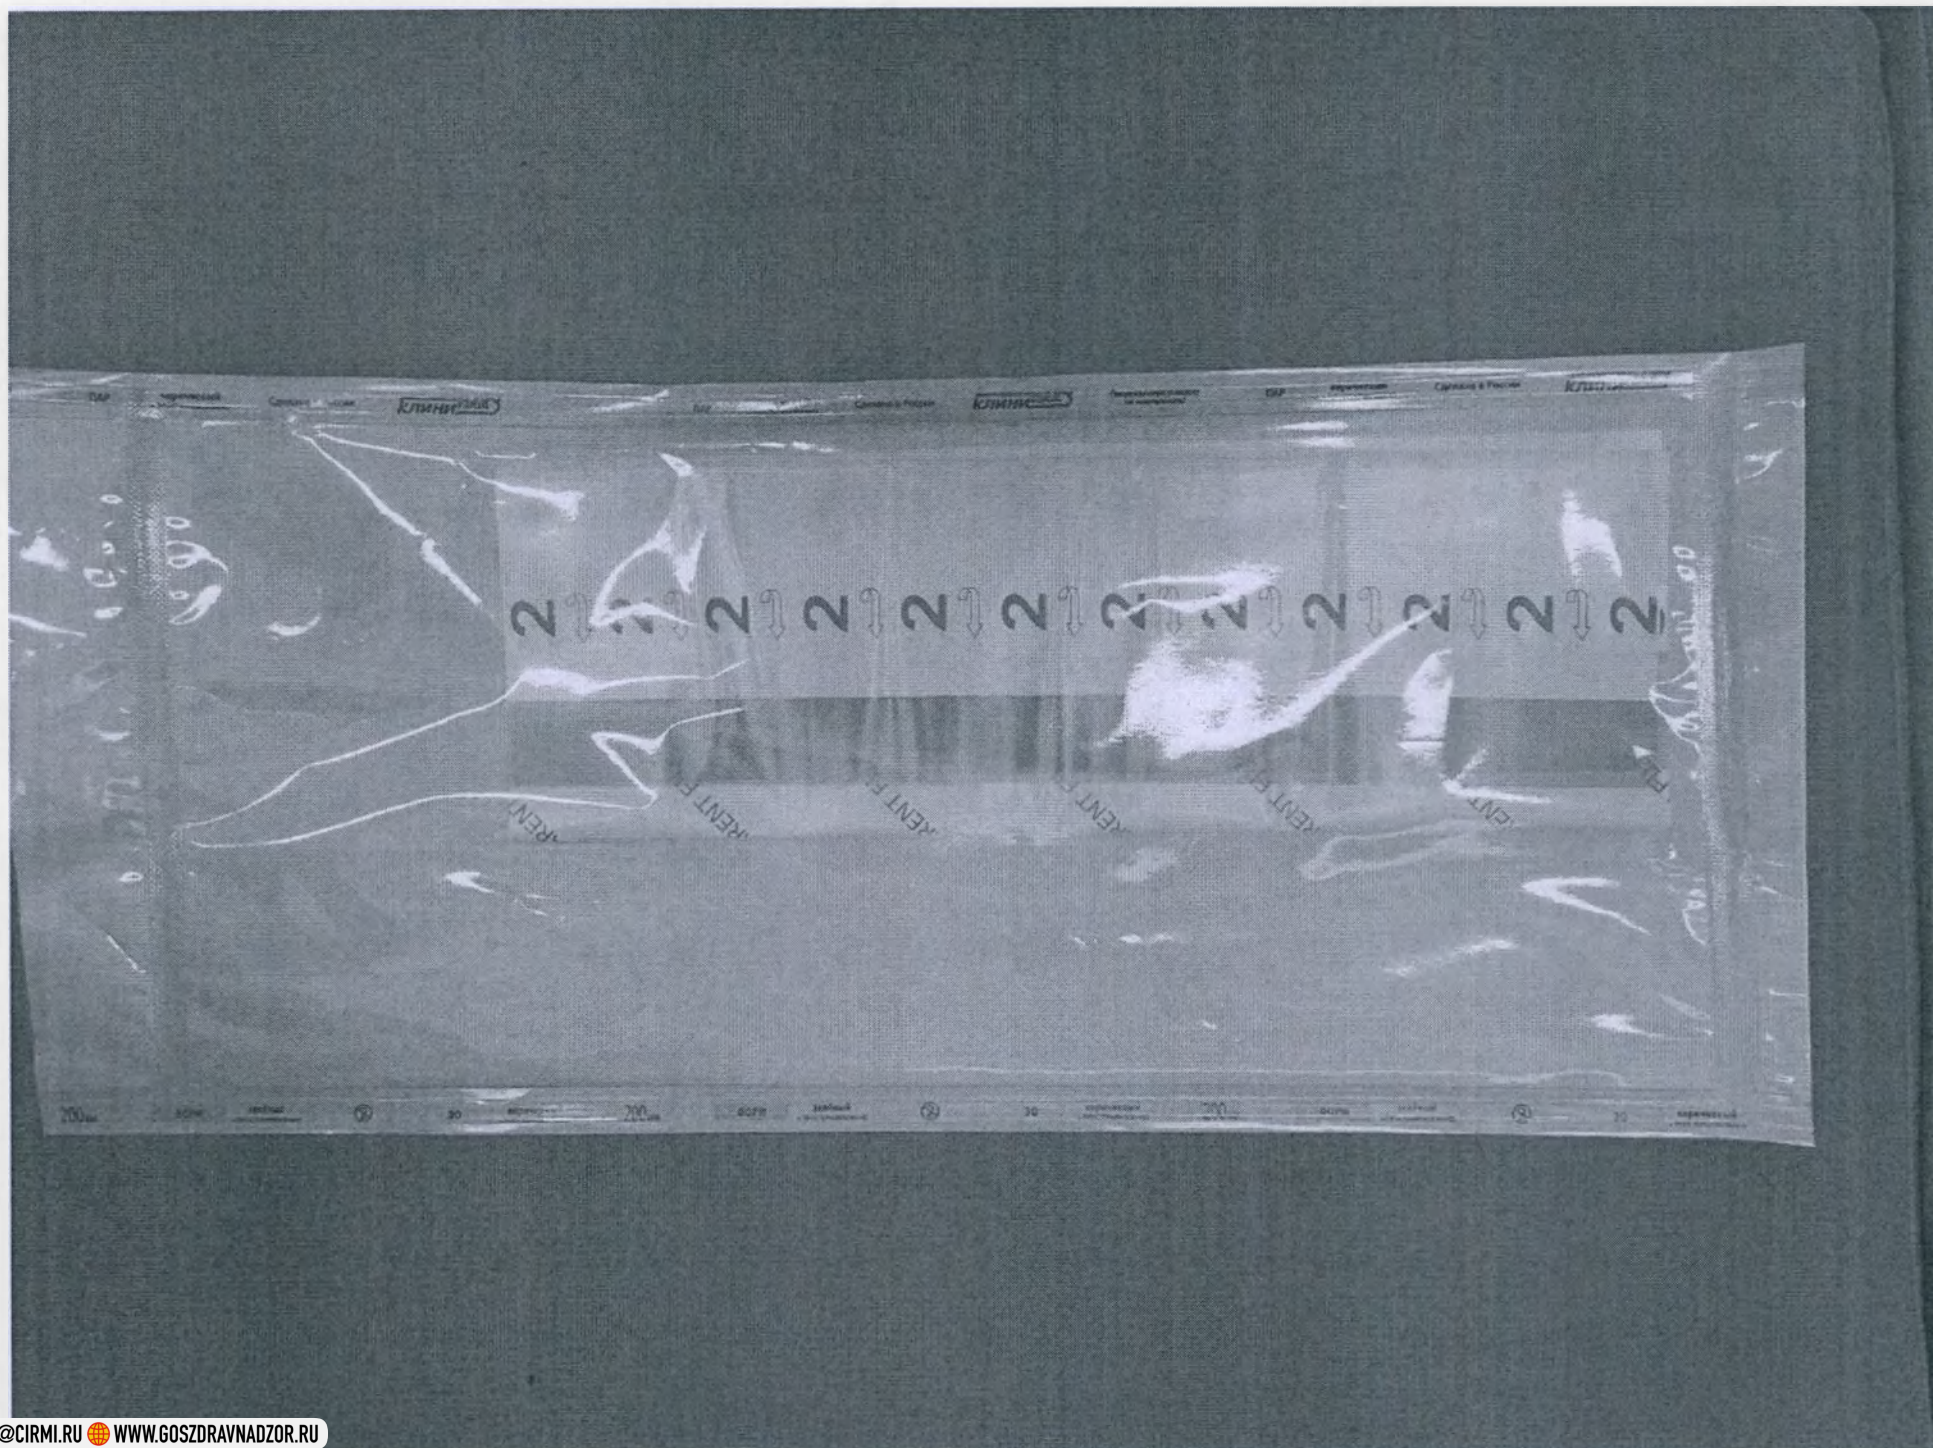

2.10. Пленка индизная - не более 200 шт. (при необходимости).

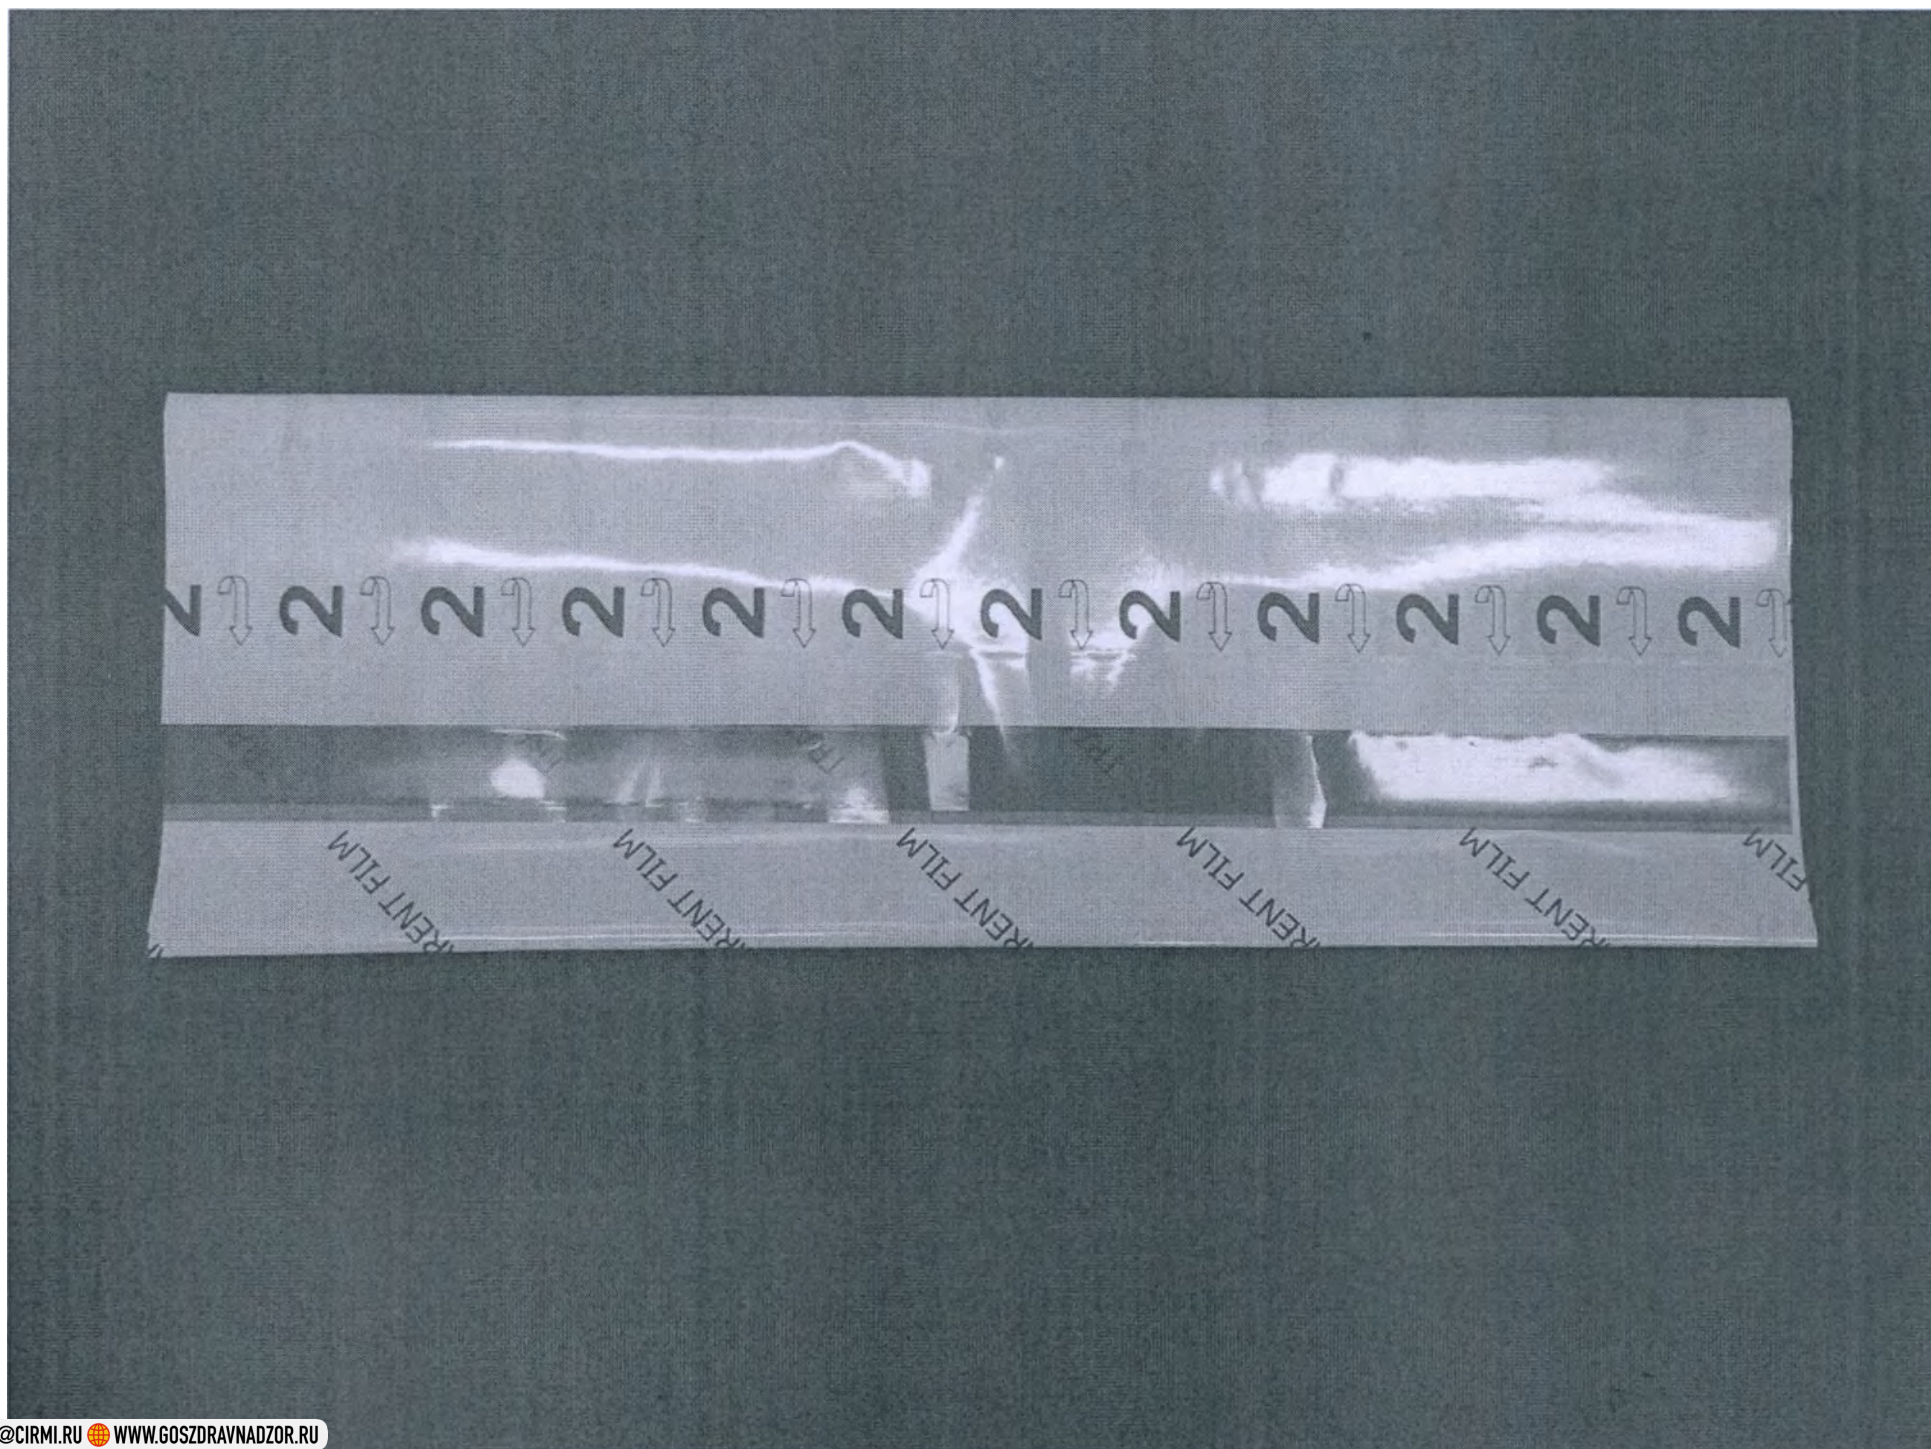

2.11. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости).

Пленка инцизная в рулоне

Применяется с:

Размер

V	M
	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

Партия №

Использовать до:

№

 Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апирогенно.




STERILE R

2.11. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости).

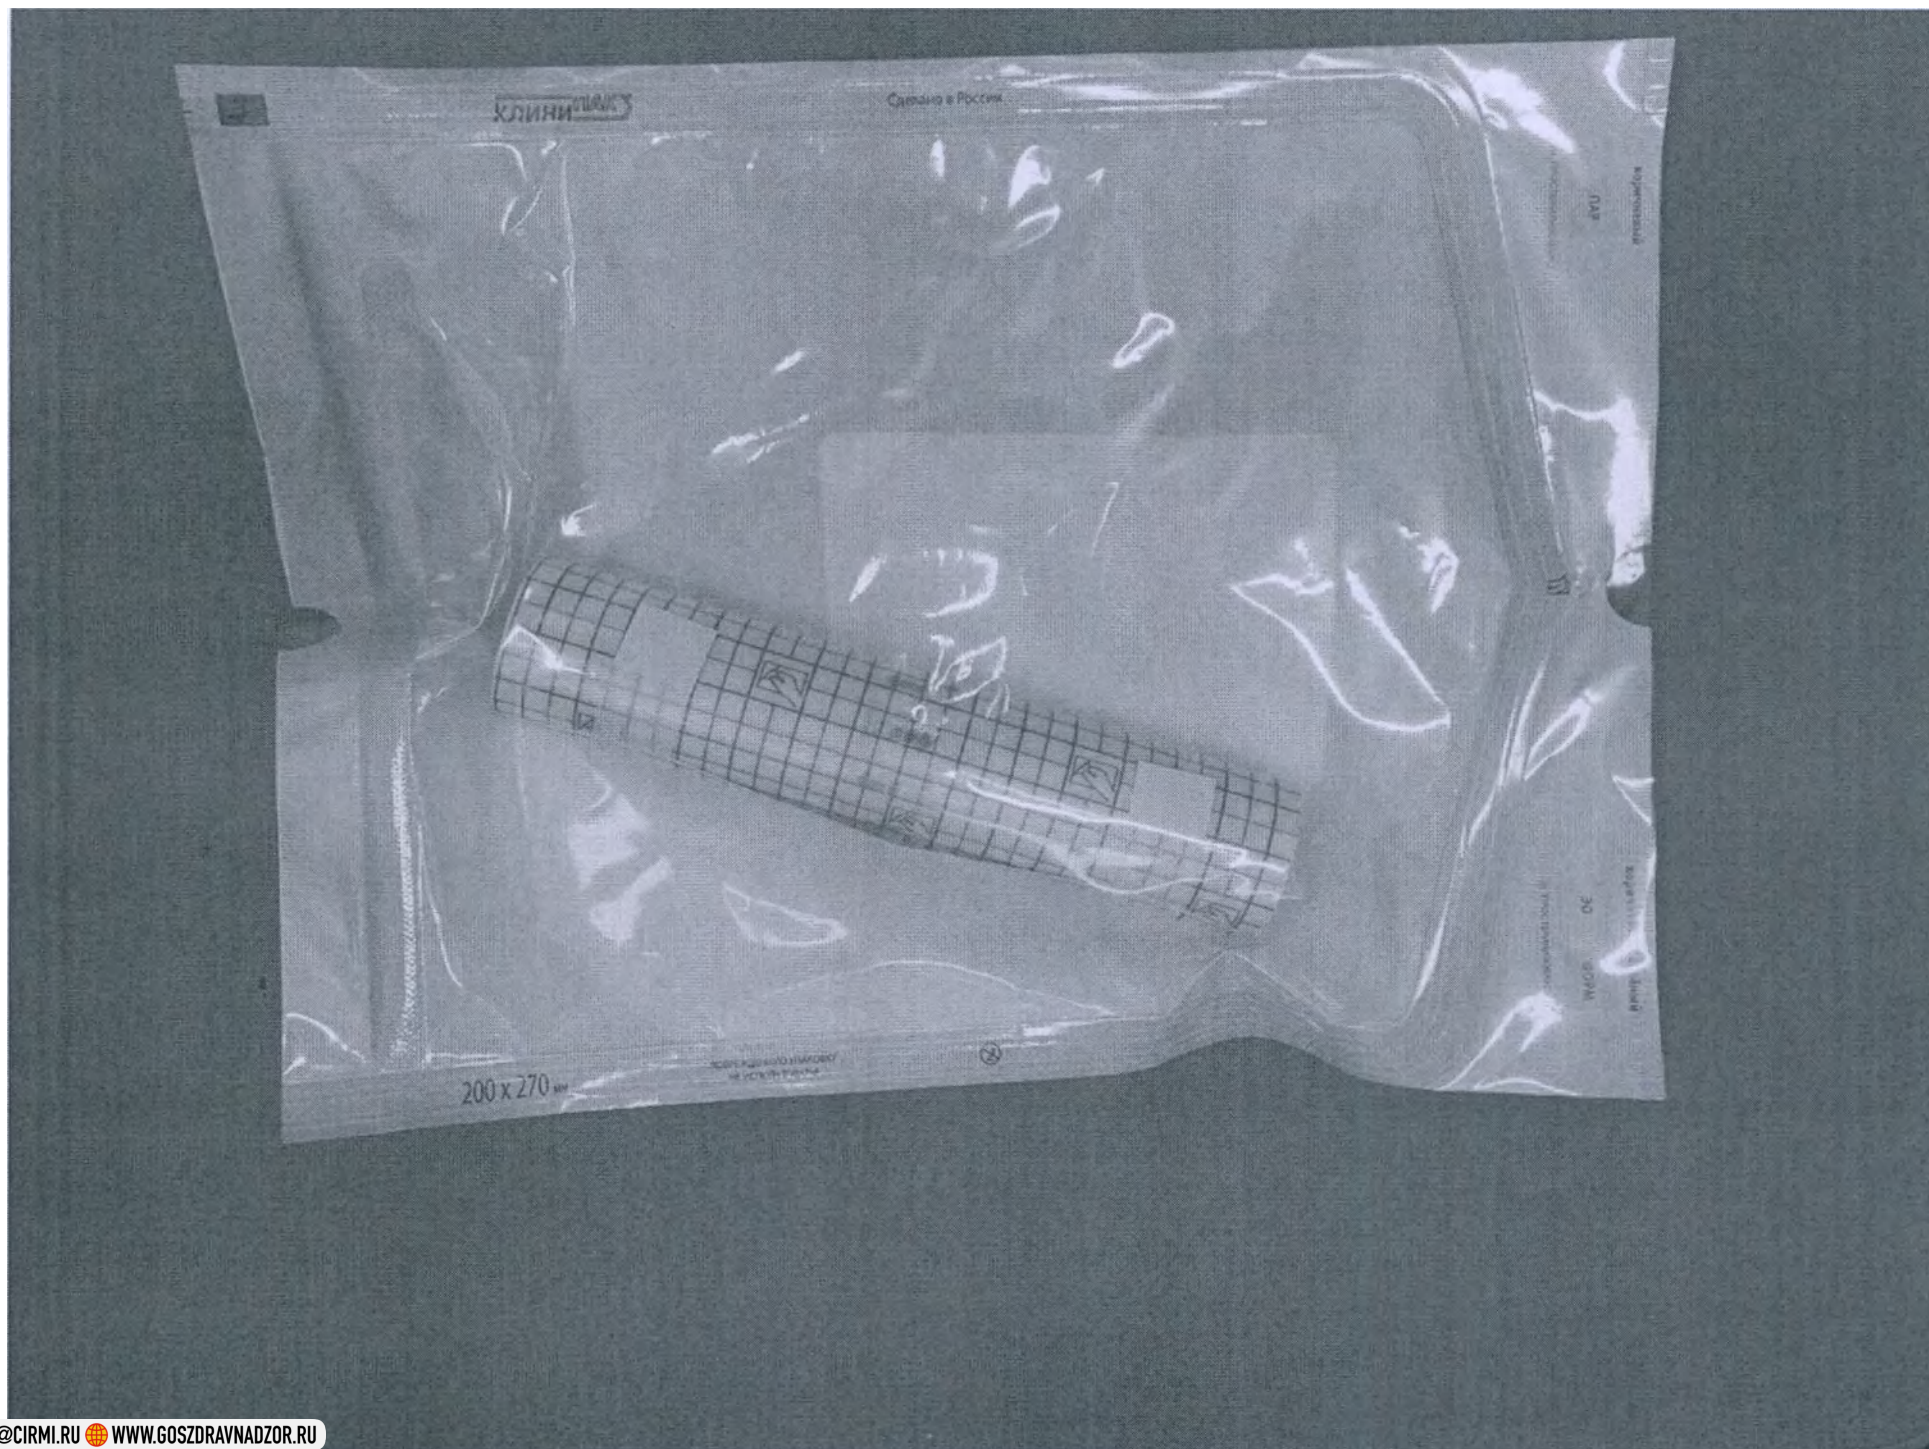

2.11. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости).

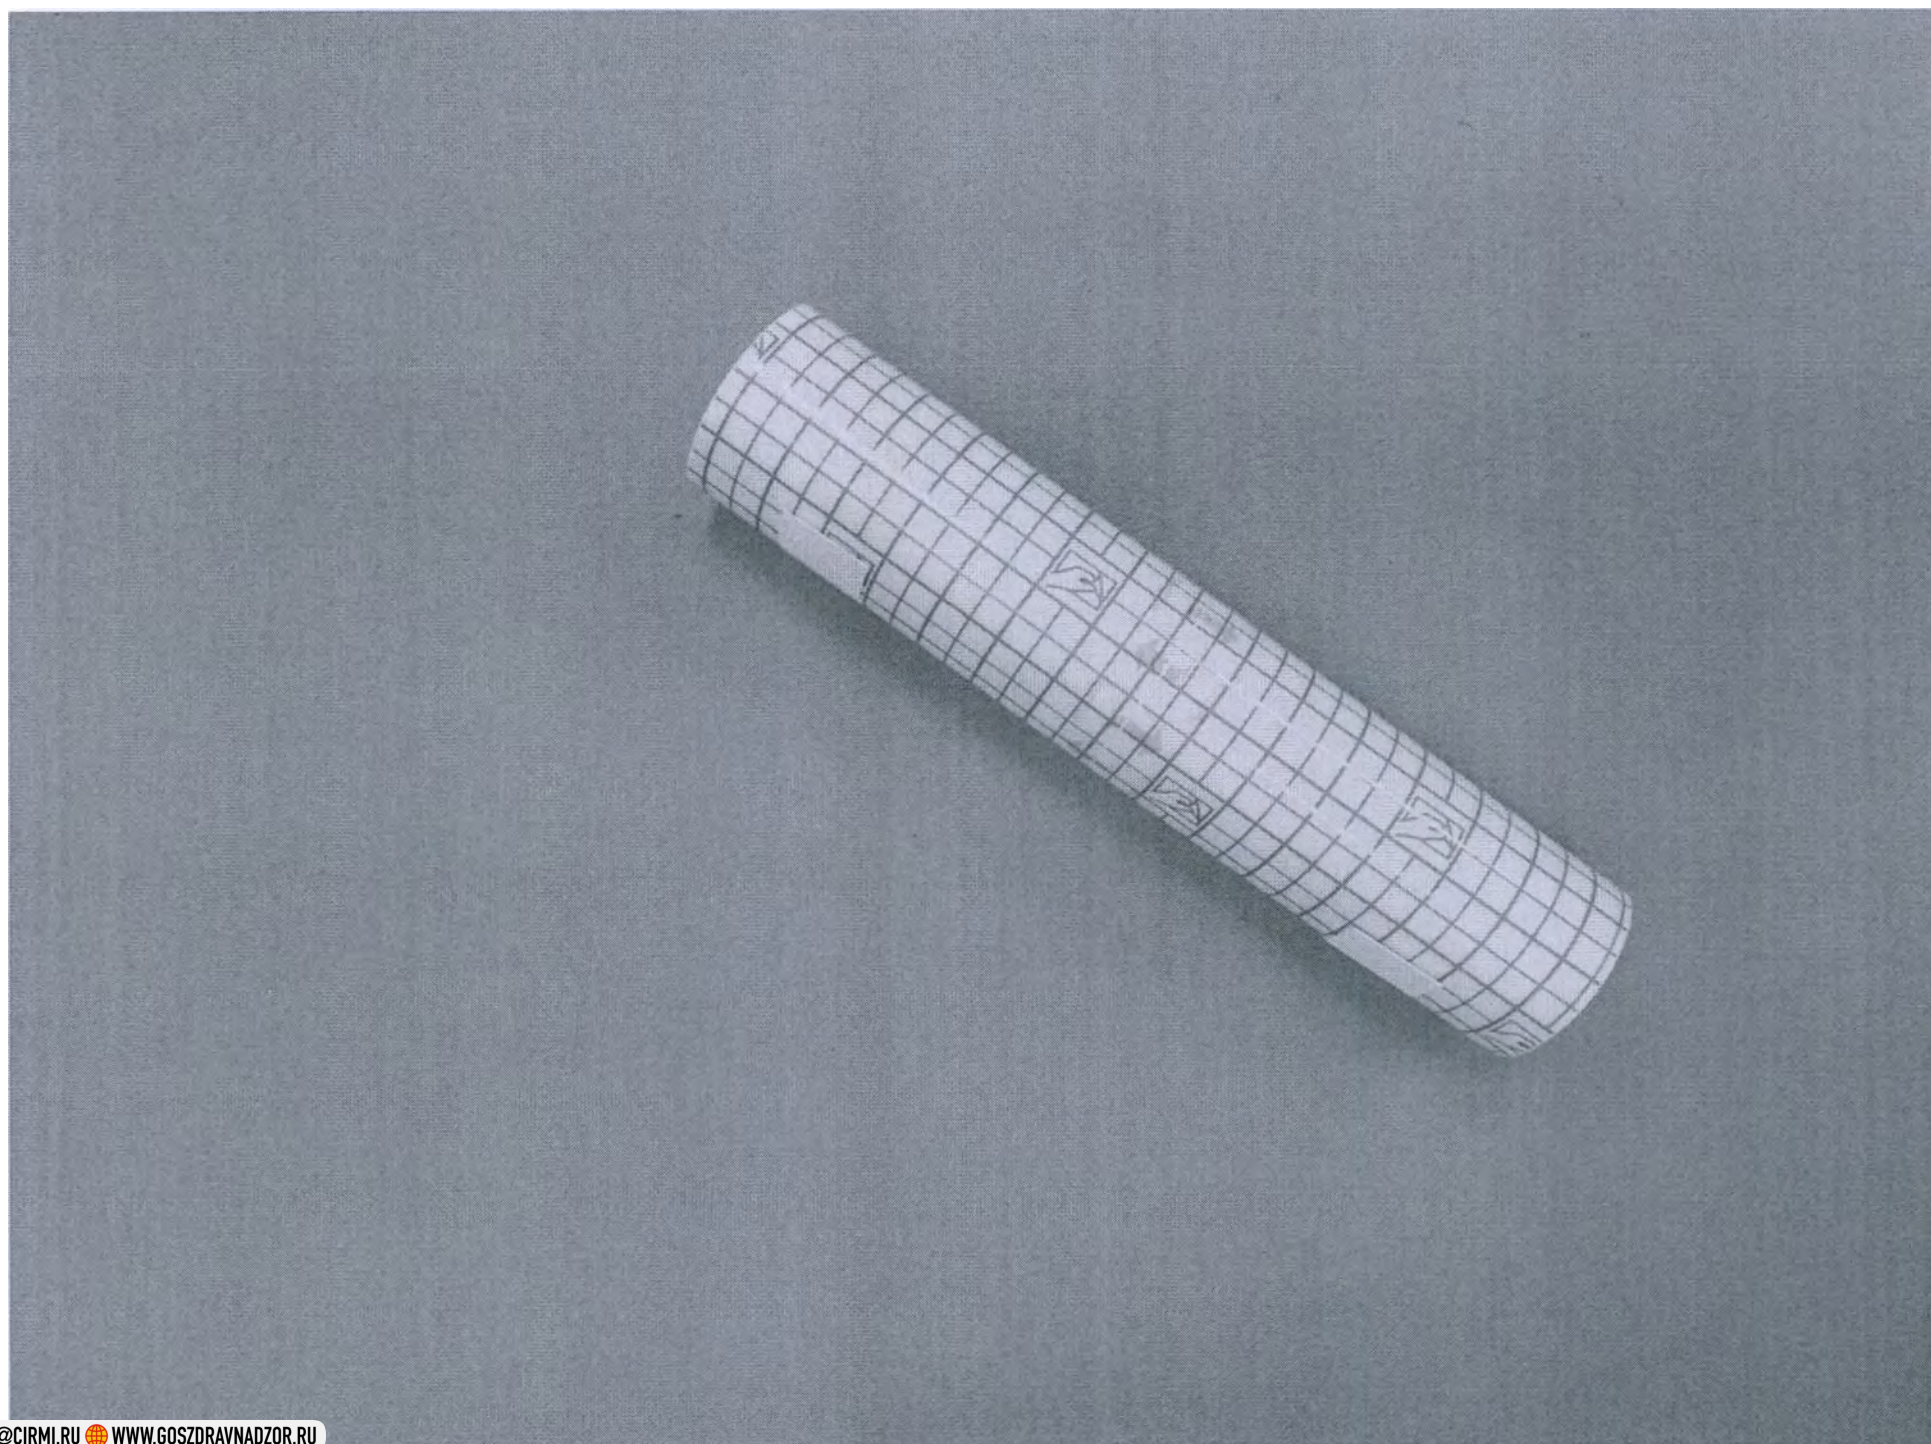

2.11. Пленка инцизная в рулоне, размеры M, L - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Пленка инцизная в рулоне

Применяется с:

Размер

	M
V	L

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3,123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%


Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апирогенно.




STERILE A

2.11. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости).

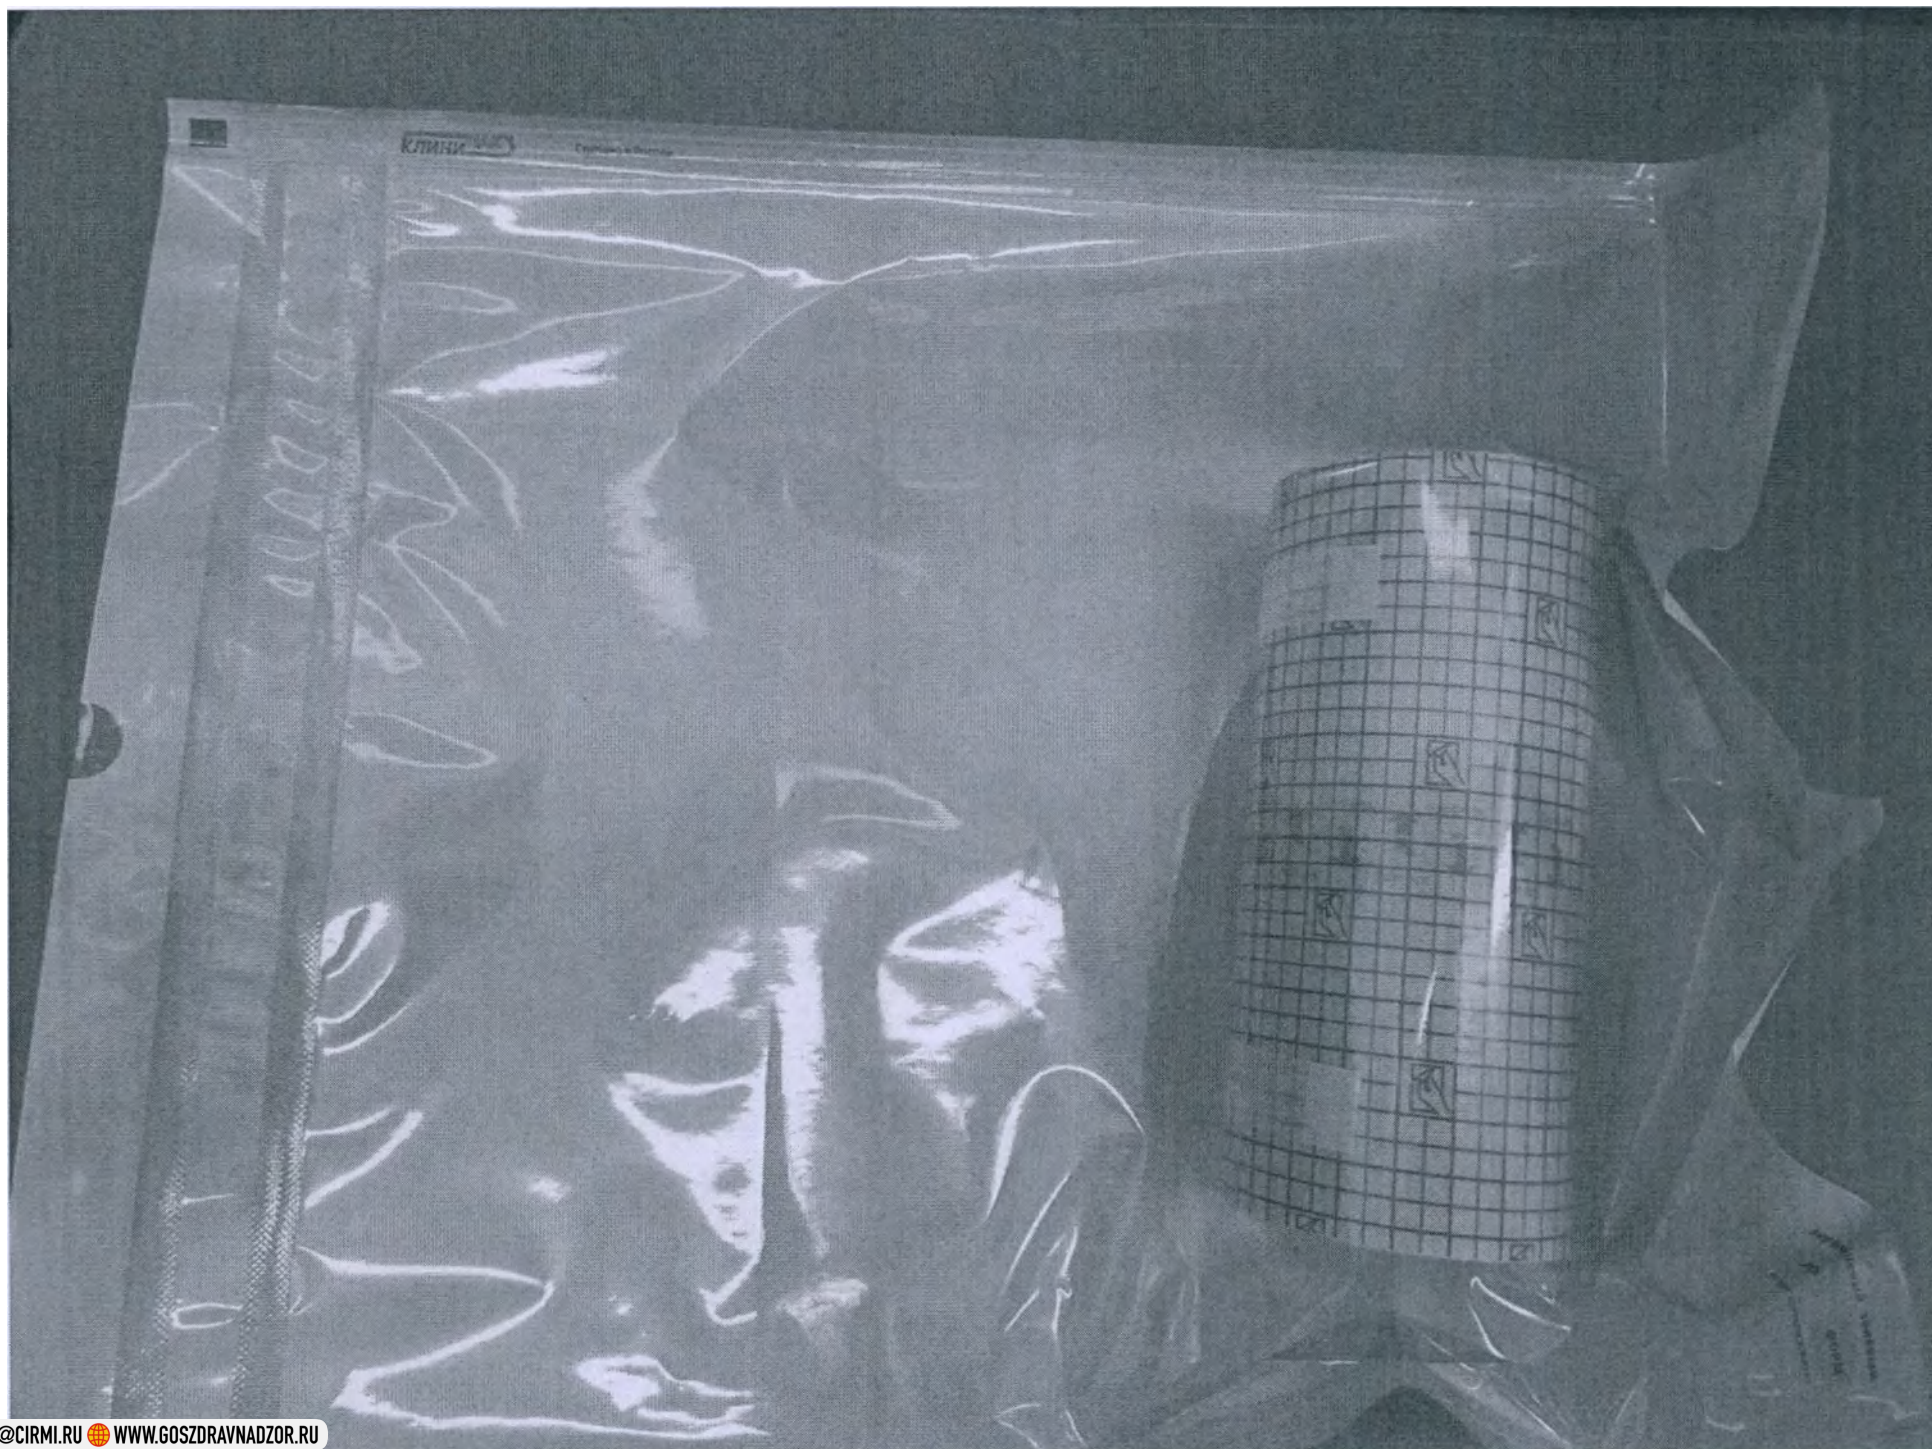

2.11. Пленка инцизная в рулоне, размеры М, L - не более 200 шт. (при необходимости).

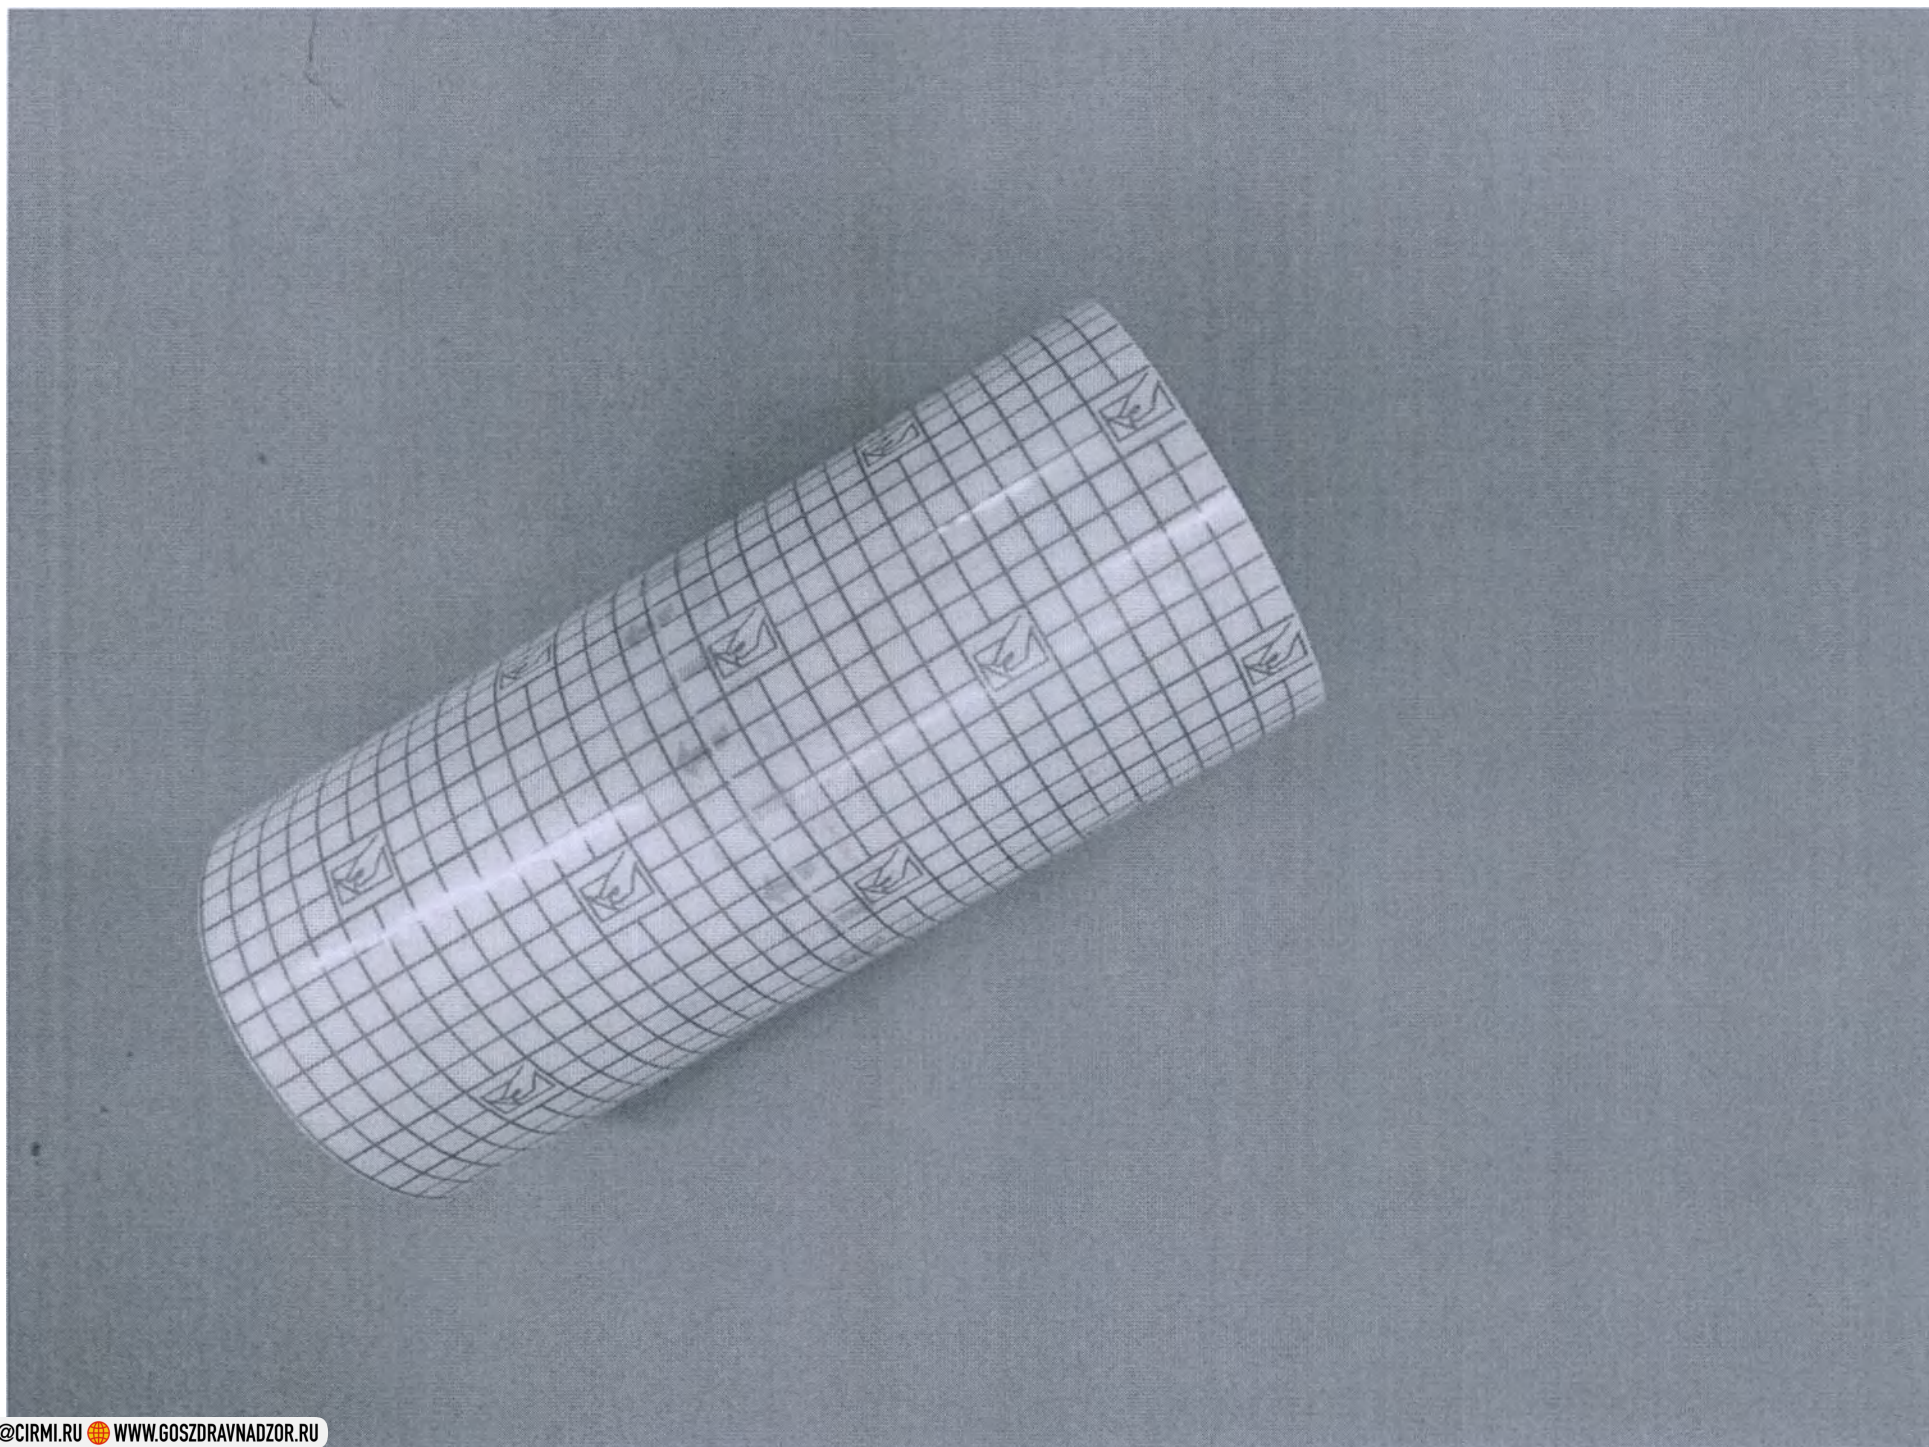

2.12. Покрывные асептические, размеры S, M - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Покрывные асептические

Применяется с:

Размер

	M
V	S

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3, 123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R

2.12. Покрытие атраватическое, размеры S, M - не более 200 шт. (при необходимости).



2.12. Покрытие атравматическое, размеры S, M - не более 200 шт. (при необходимости).

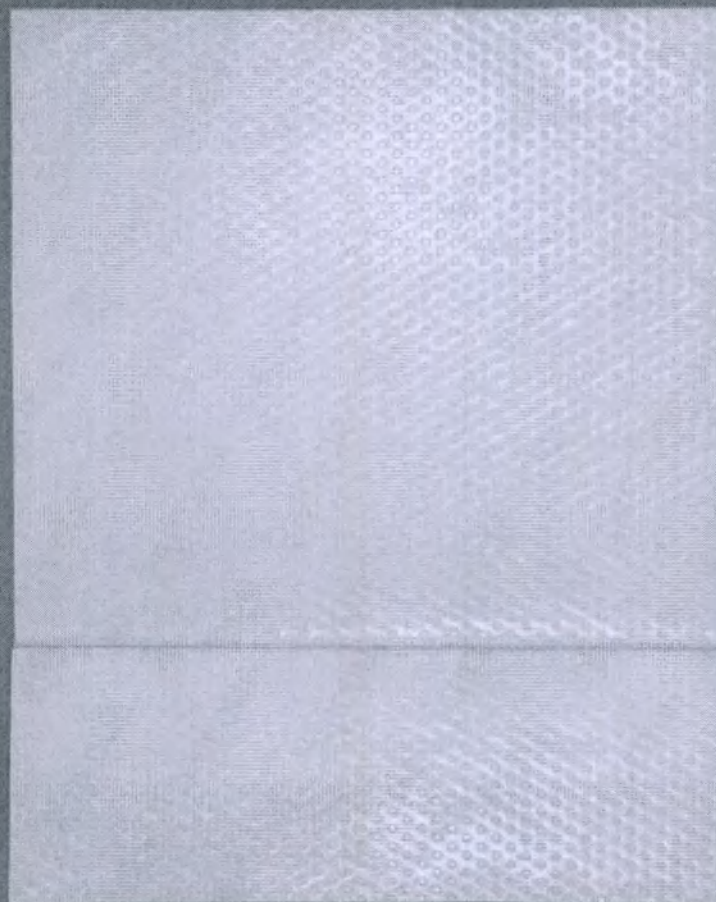

2.12. Покрывные асептические, размеры S, M - не более 200 шт. (при необходимости). (Маркировка)

Покрывные асептические

Применяется с:

Размер

V	M
	S

«Аппарат «ВИТ Мобил» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Мини» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-002-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ Ультра» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

«Аппарат «ВИТ МобилПлюс» для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-057222086-2018»

Дата производства:

LOT

Партия №

Использовать до:

SN

№



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ Медикал» (ООО «ВИТ Медикал»)

Москва г, ул. Твардовского, д.8, с.1, пом. 1 ком.3, этаж 3,123458

Место производства: Москва г, 1-я Курьяновская улица, д.34 стр.3, 109235

Рекламации направлять: fp.vitmedical@gmail.com. Тел: +7 926 888 77 40

Хранить при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности не более 90%

Подробнее см. руководство по эксплуатации

Стерильно. Нетоксично. Апиrogenно.




STERILE R


2.12. Покрывало аэрозольное, размеры S, М - не более 200 шт. (при необходимости).



2.12. Покрытие атравматическое, размеры S, М - не более 200 шт. (при необходимости).

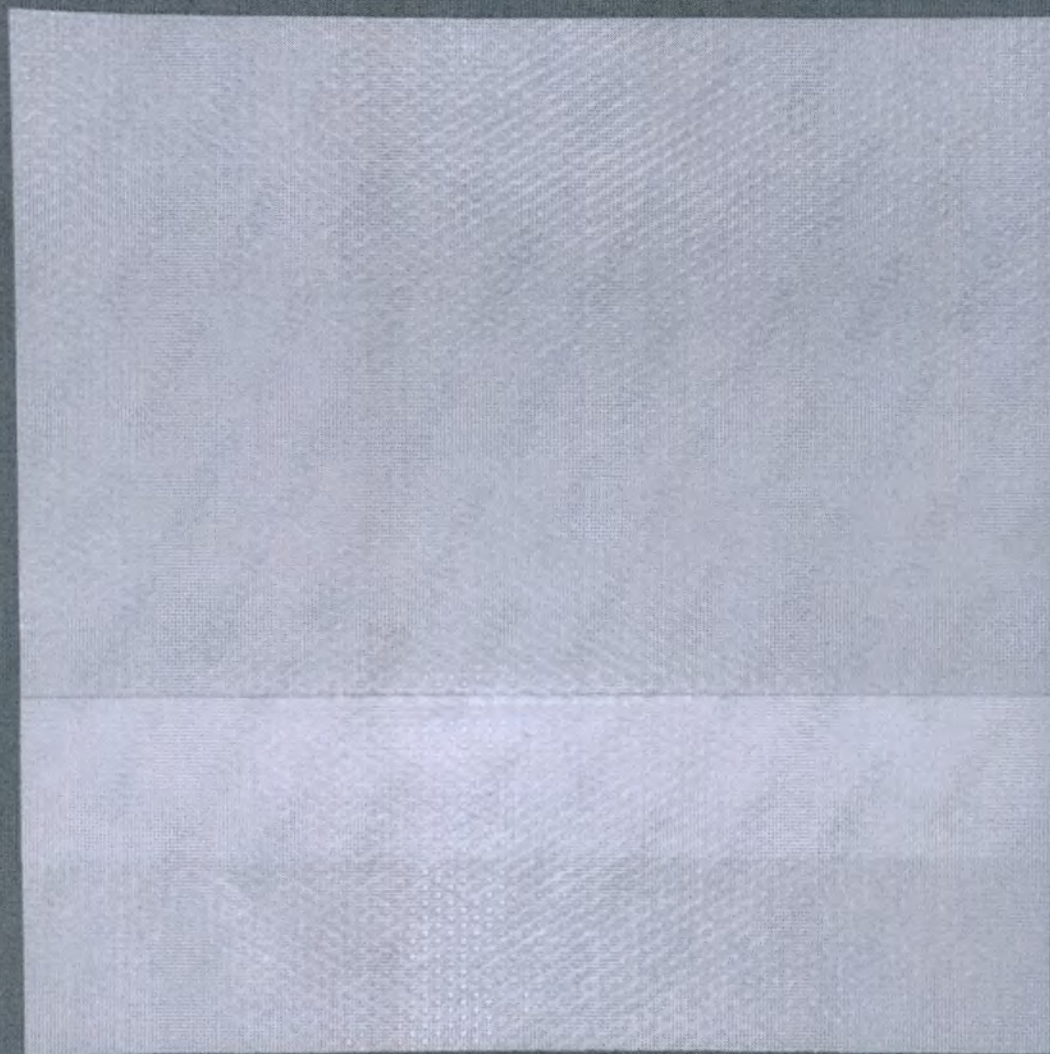


2.13. Переходники (вход/выход) - не более 200 шт. (при необходимости).

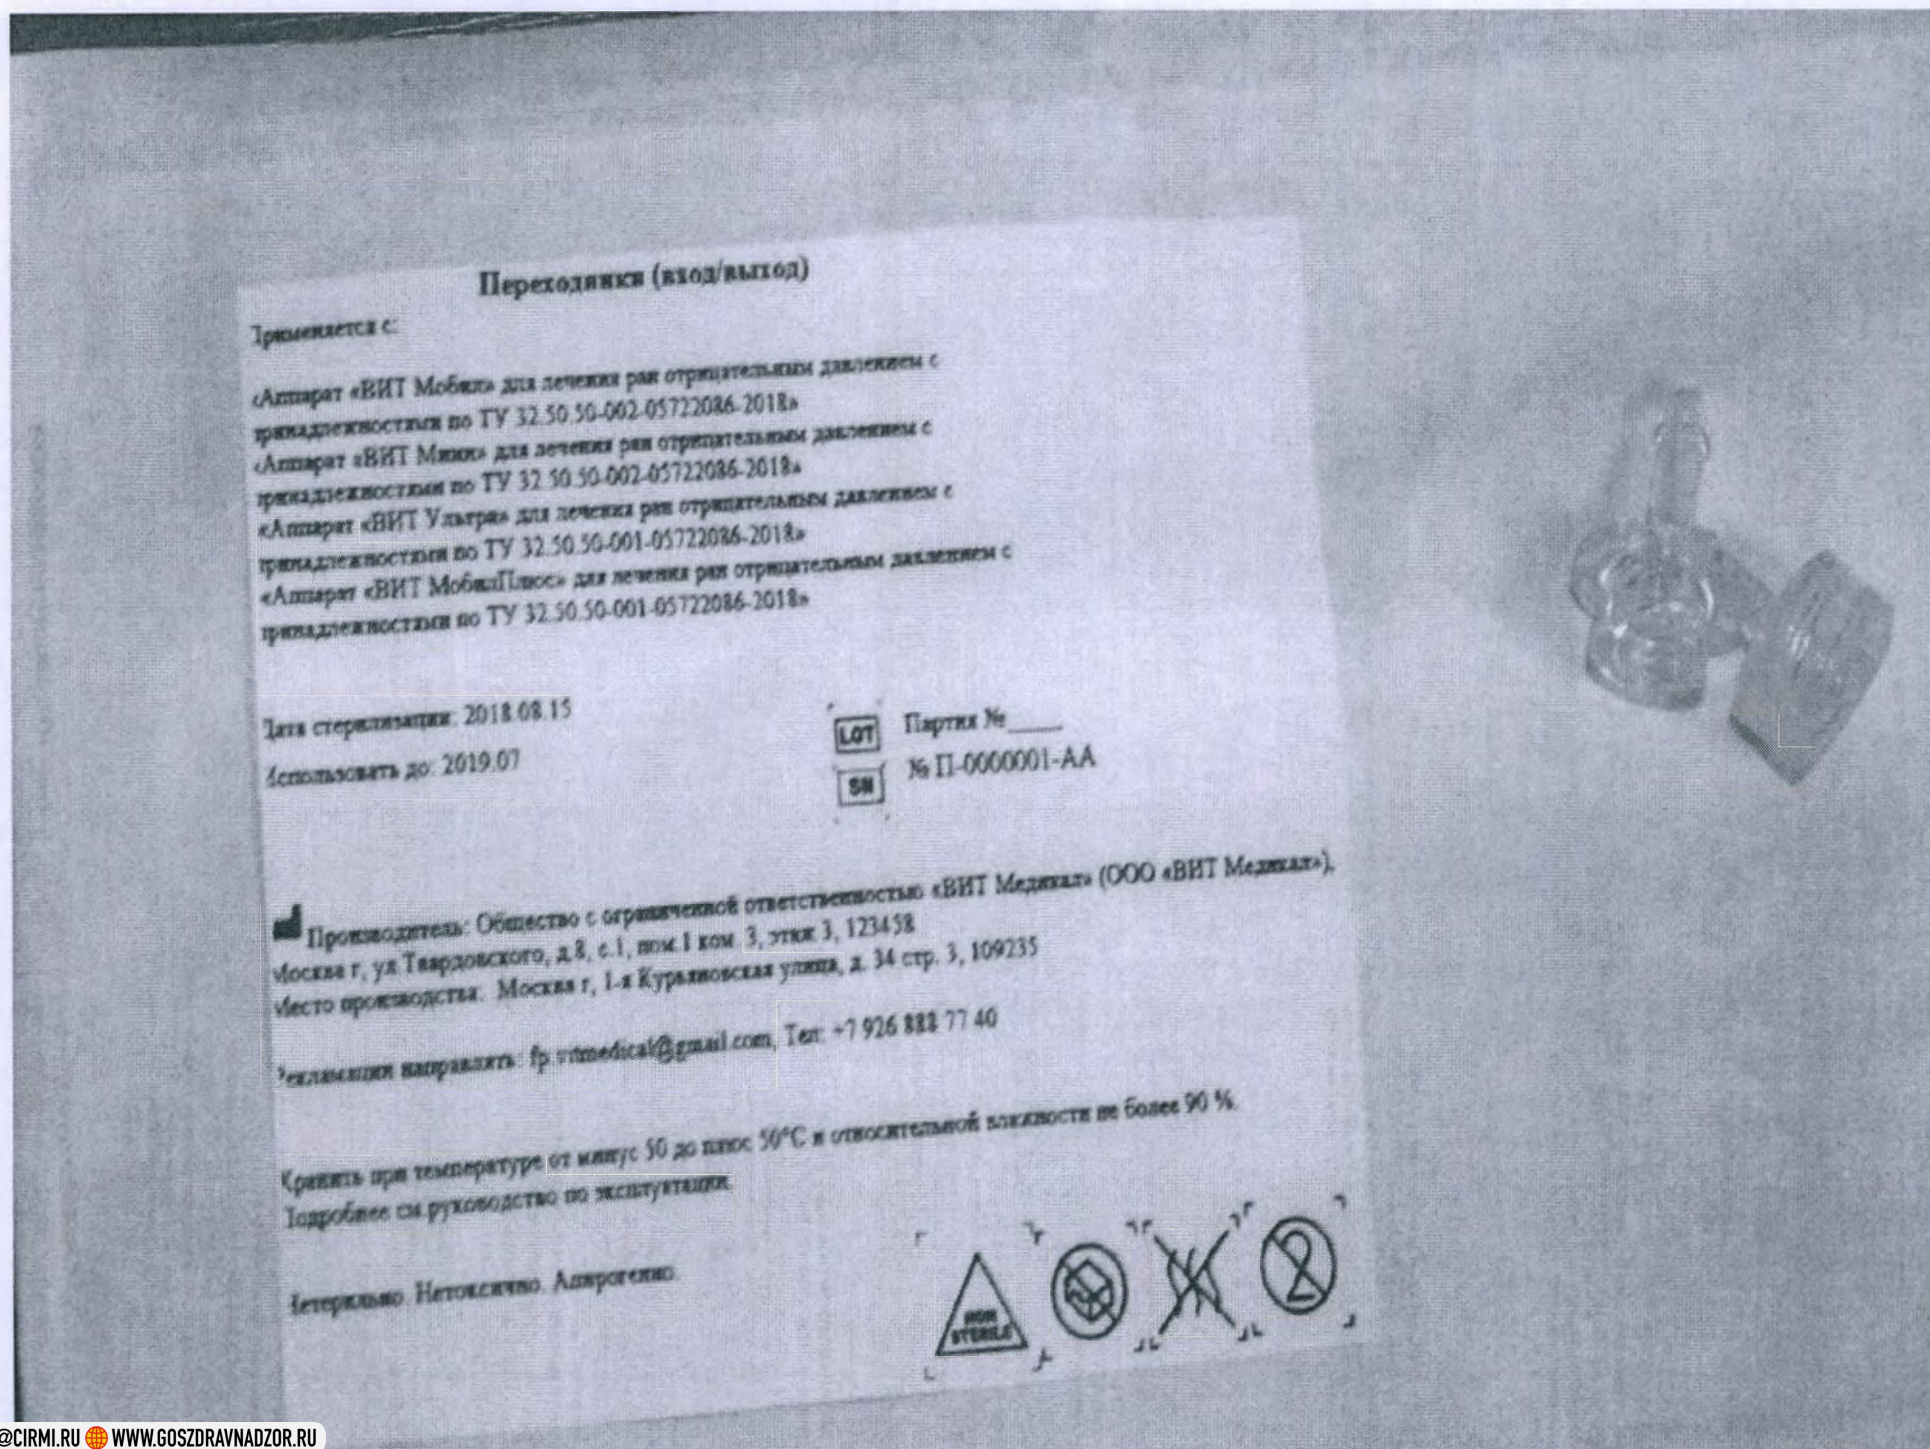


2.13. Переходники (вход/выход) - не более 200 шт. (при необходимости).




2.13. Переходники (вход/выход) - не более 200 шт. (при необходимости).

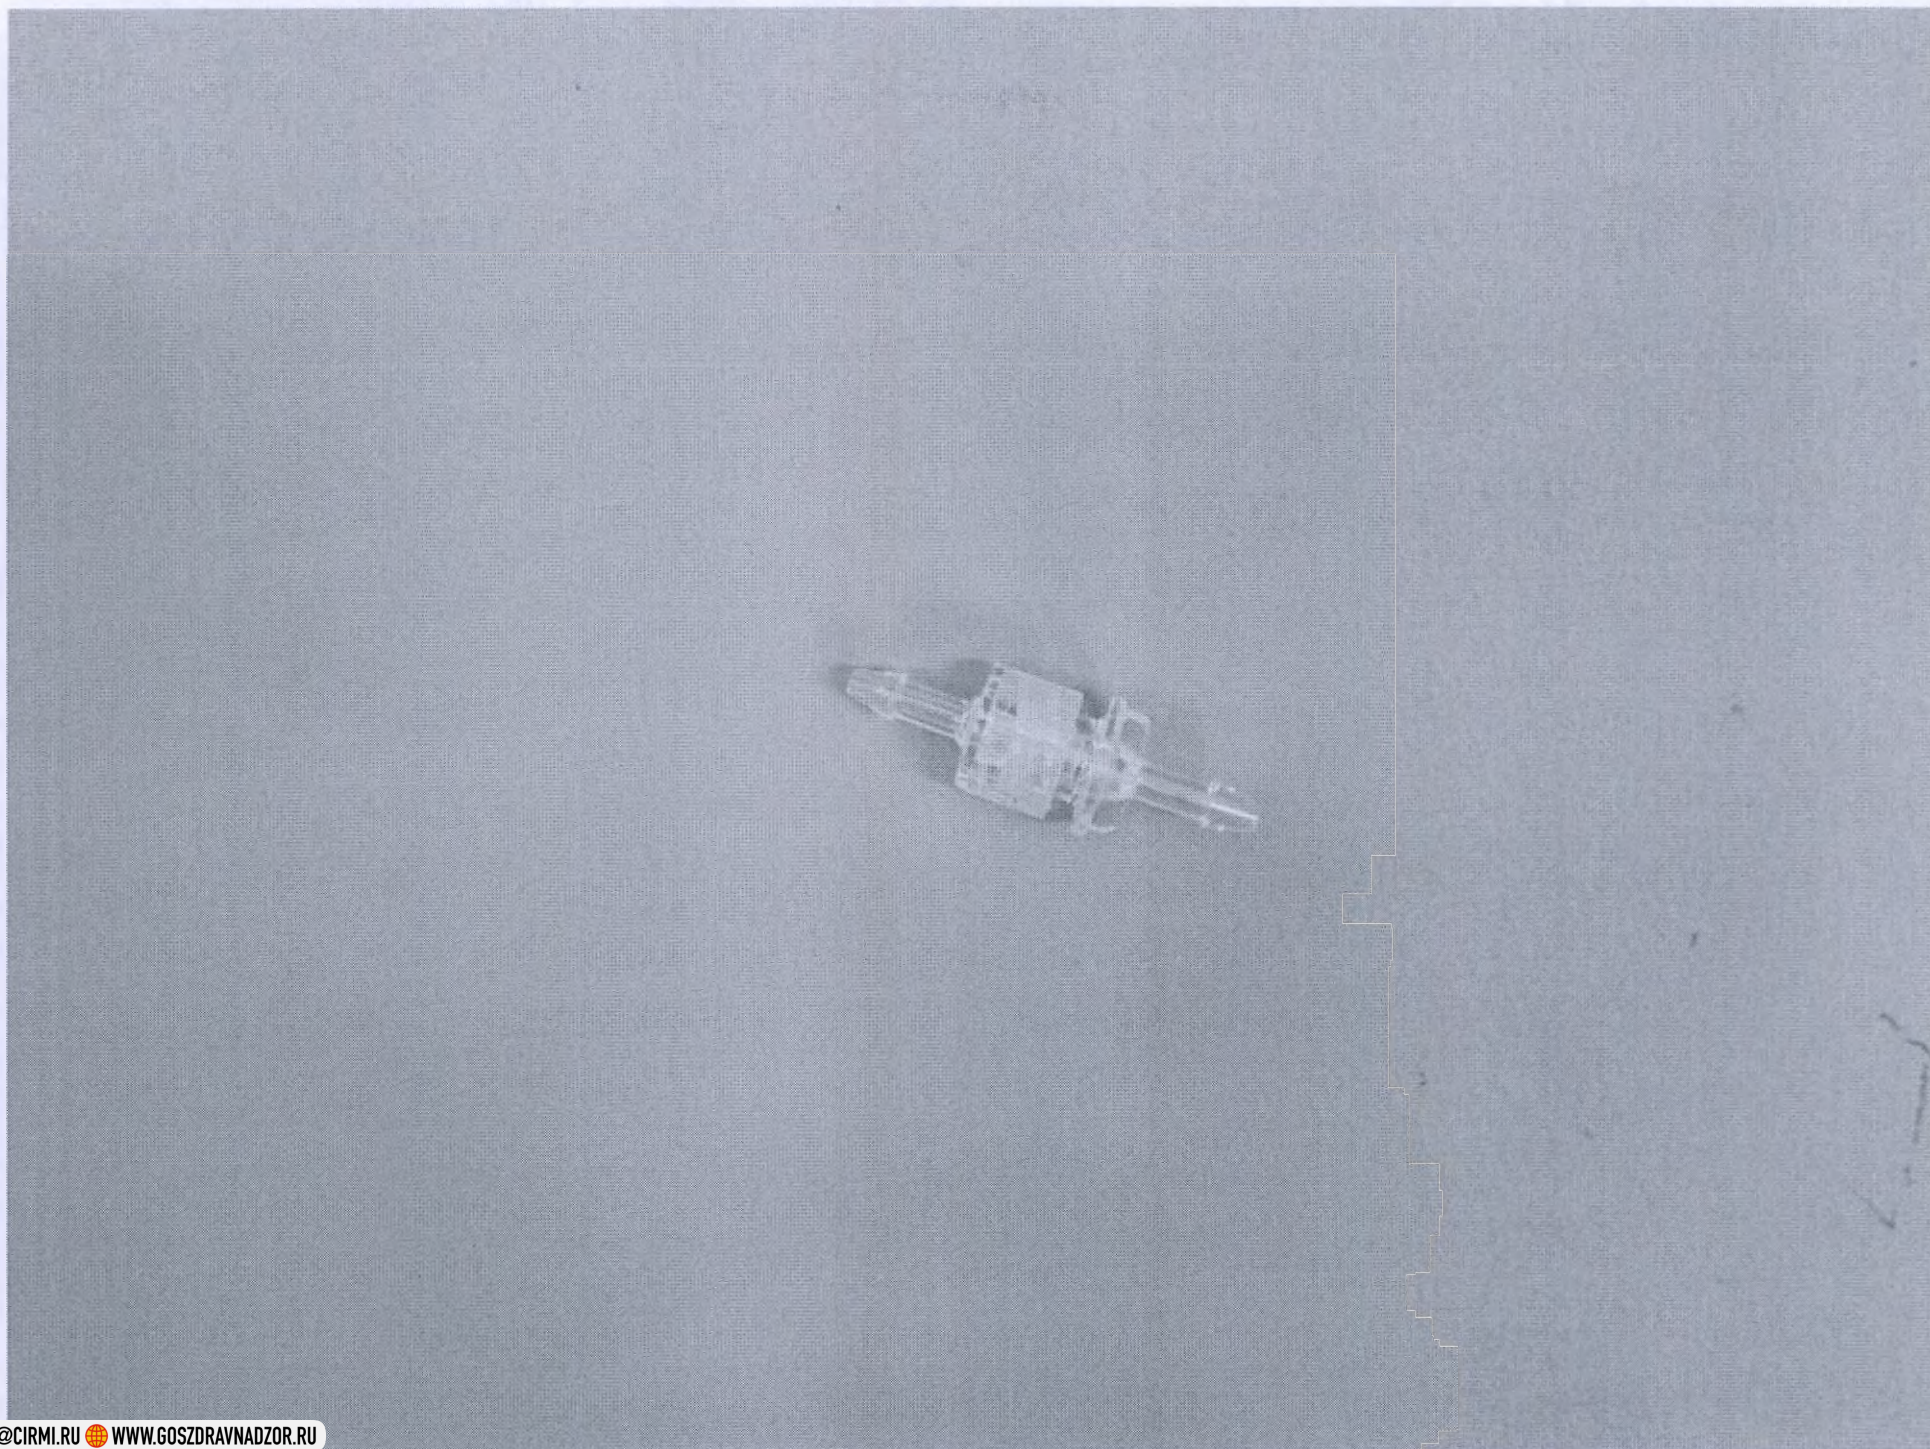

2.14. Сумка для ношения - 1 шт. (при необходимости). (Маркировка)

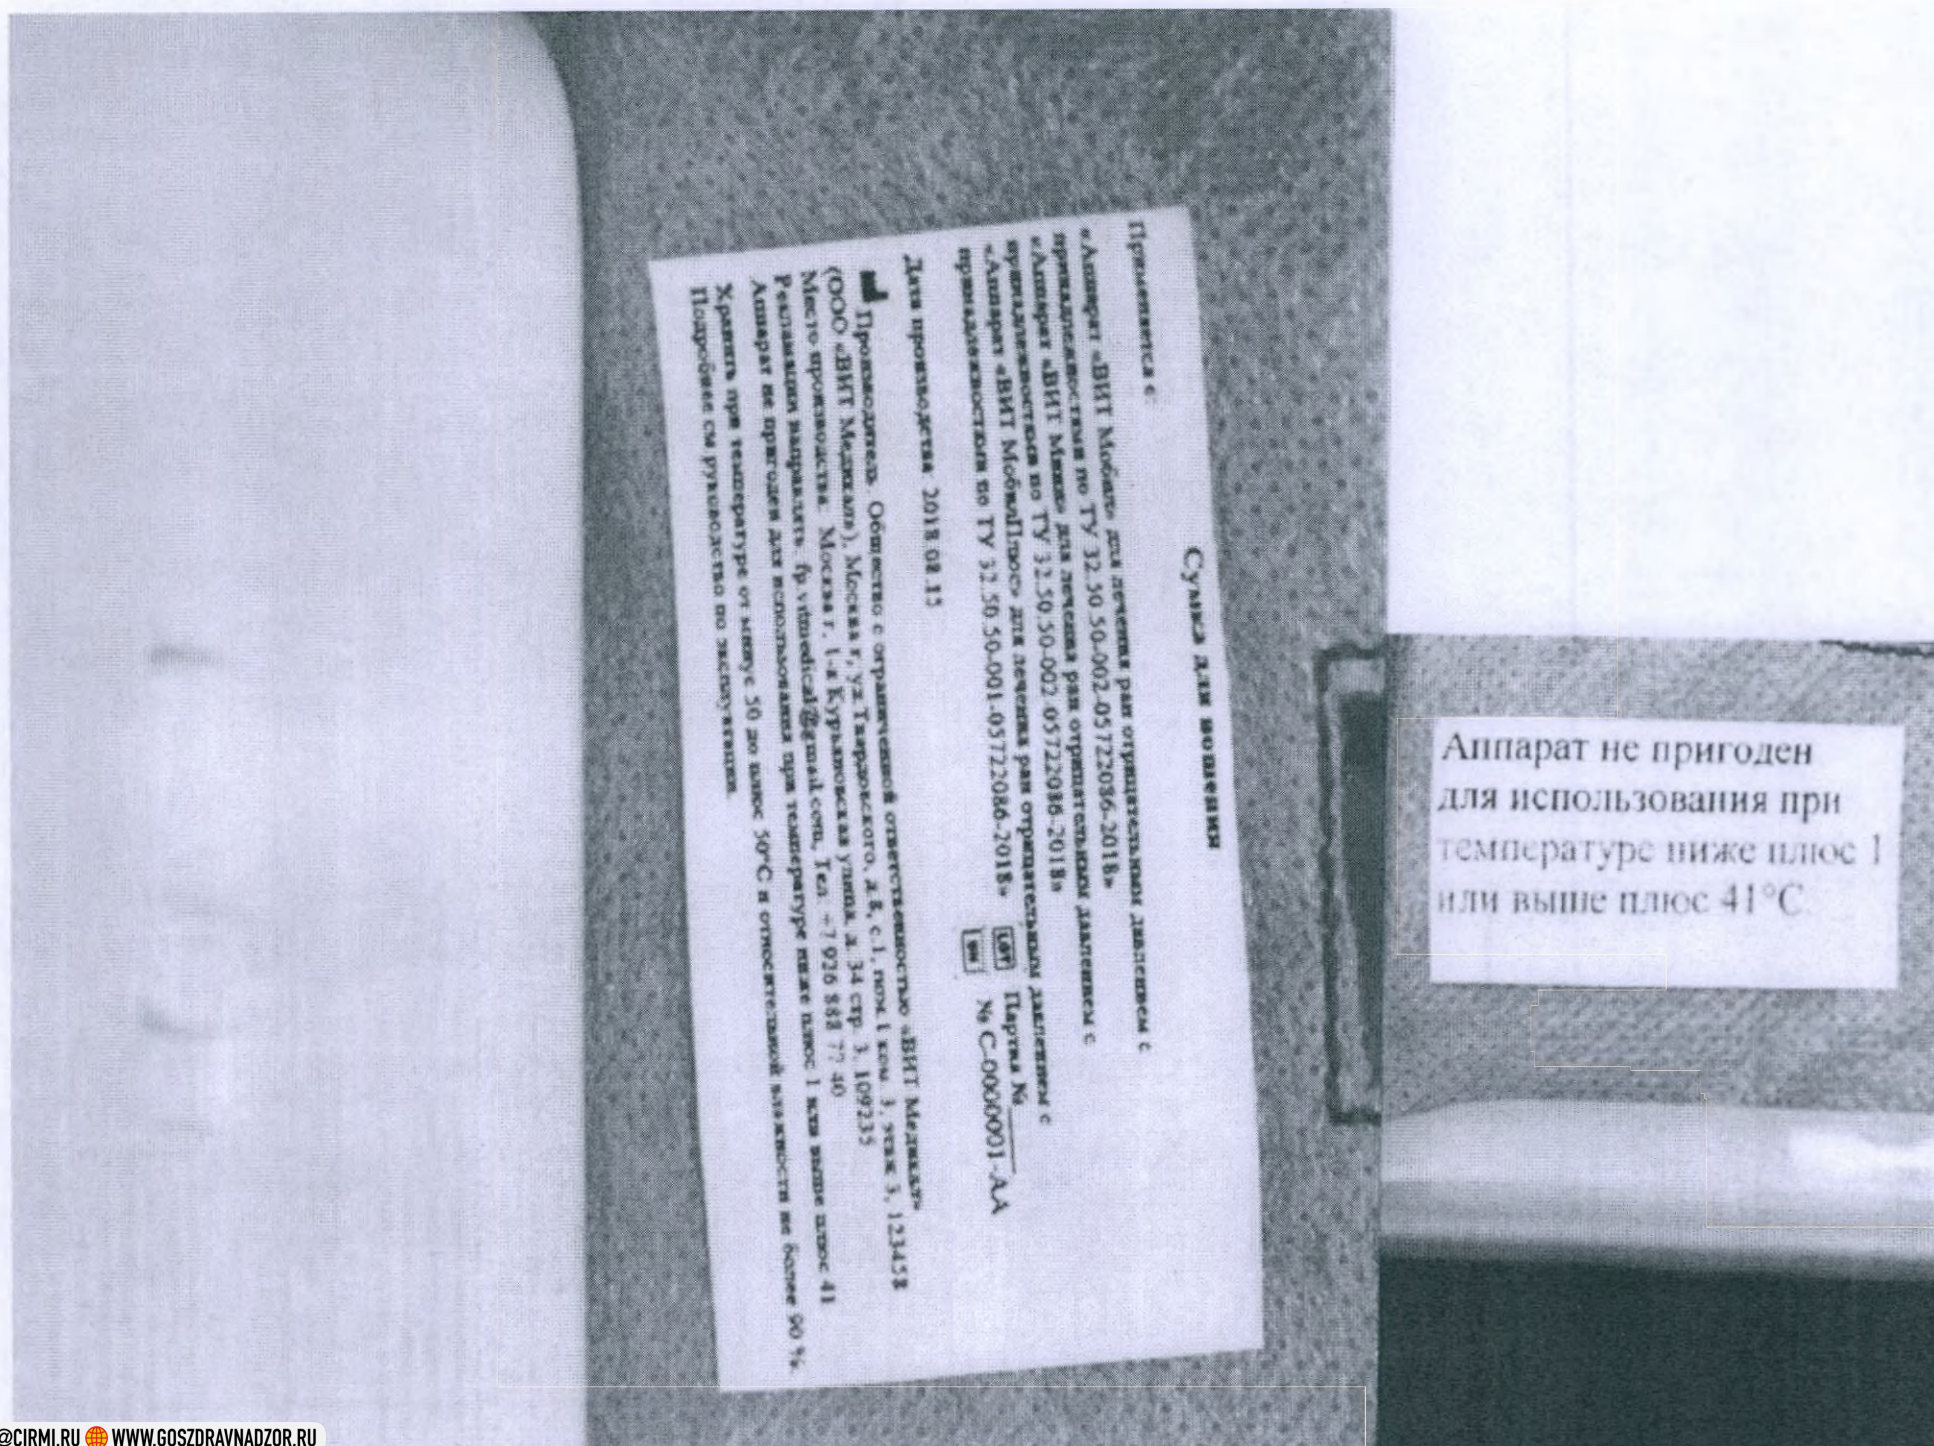

2.14. Сумка для ношения - 1 шт. (при необходимости).

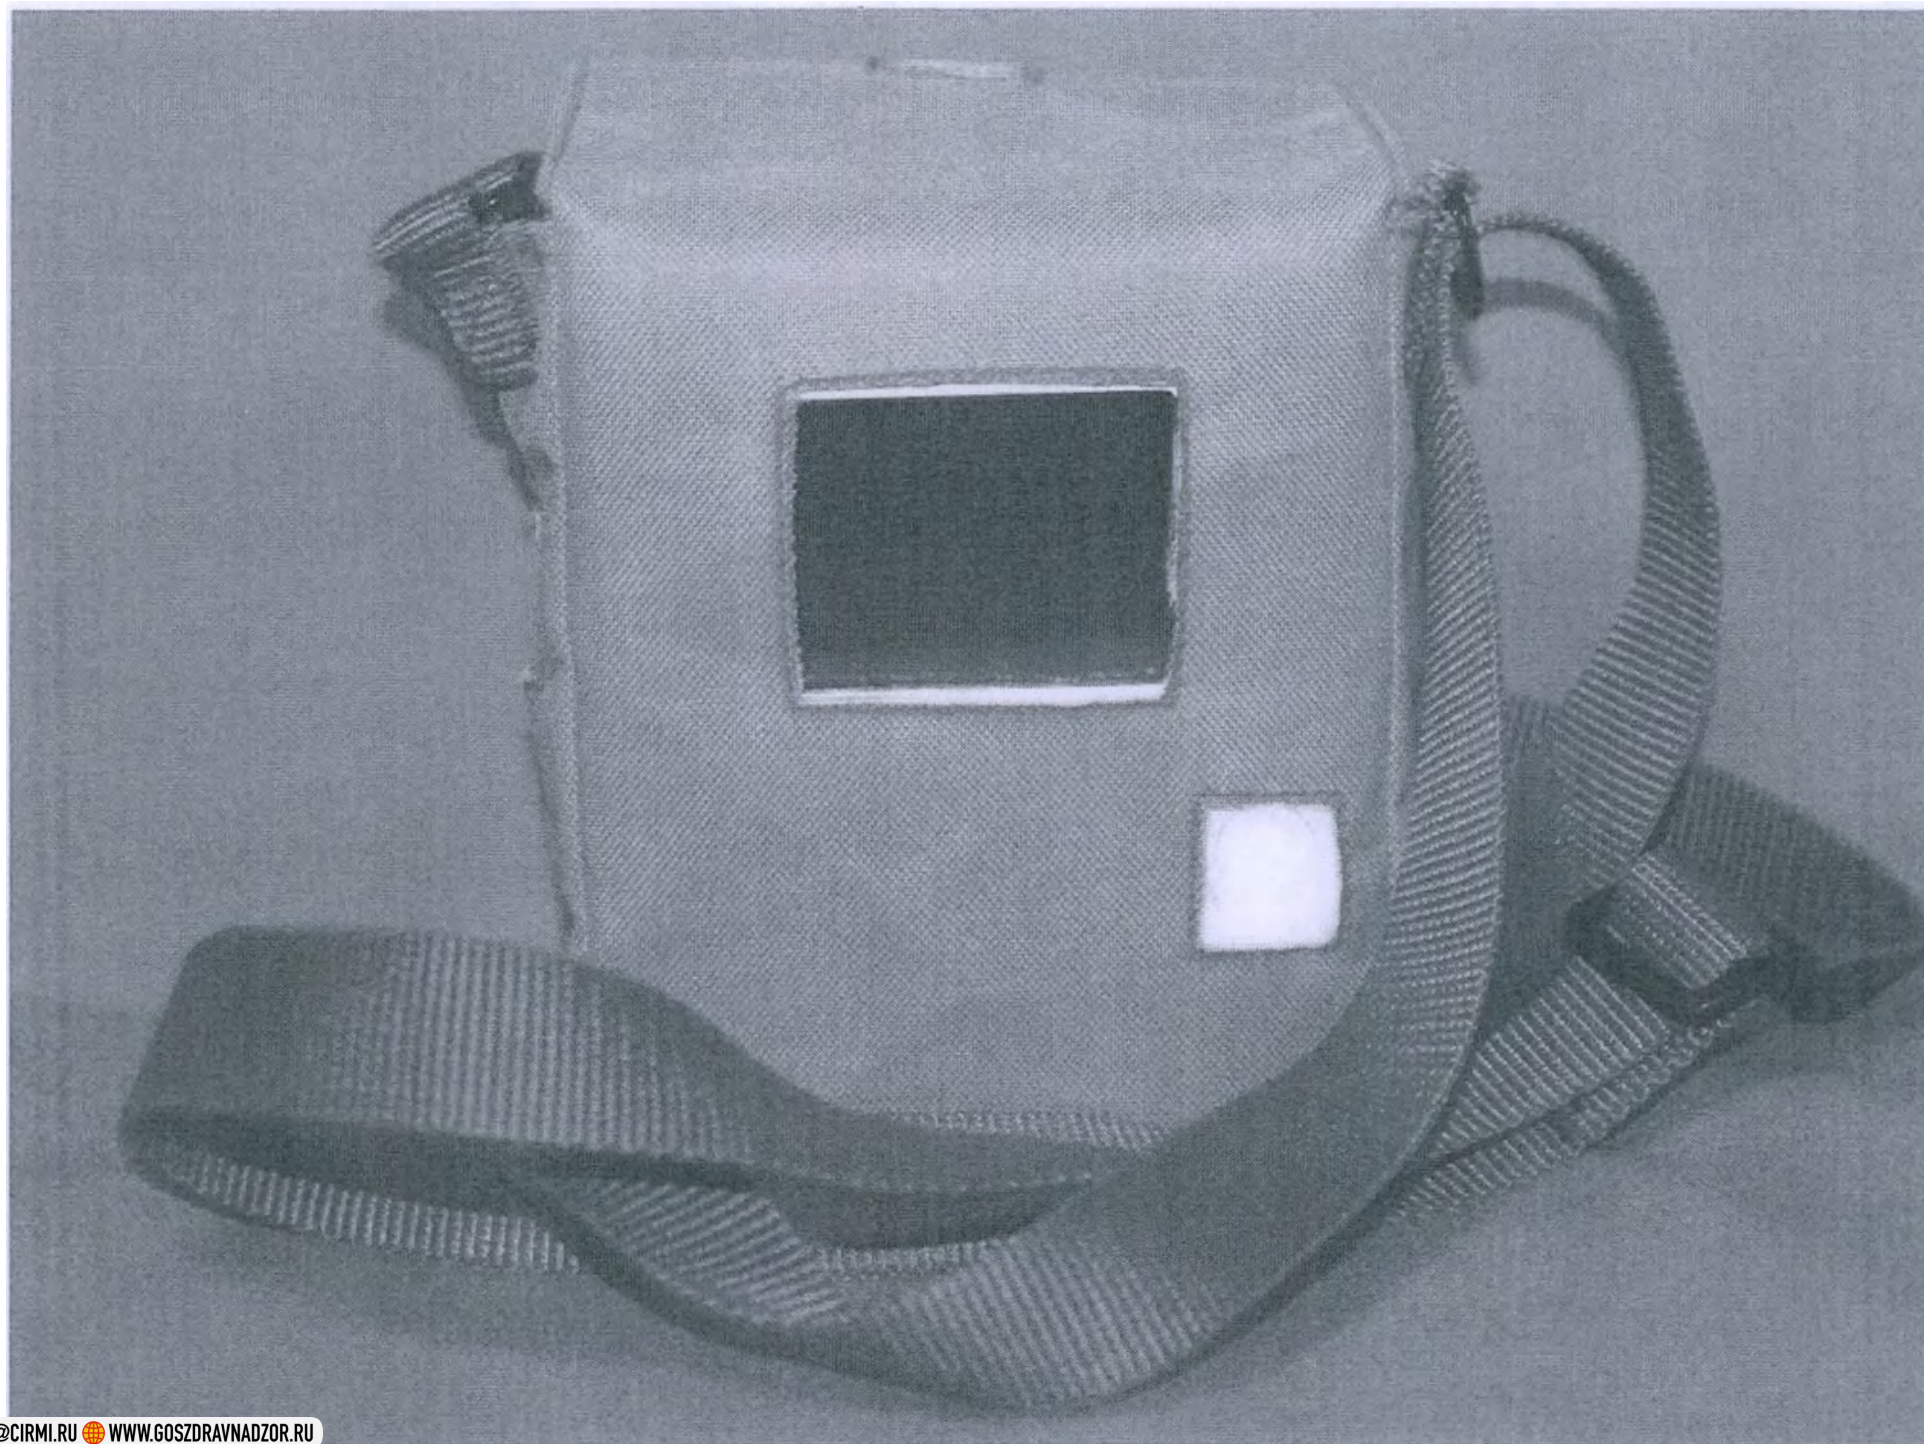

2.15. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

АППАРАТ «ВИТ»
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
ПО ТУ 32.50.50-002-05722086-2018

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____

109

_____ листах

