




**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу
краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT
"ARCHITECT IgM антитела к вирусу краснухи контроли (ARCHITECT
Rubella IgM Controls)"**

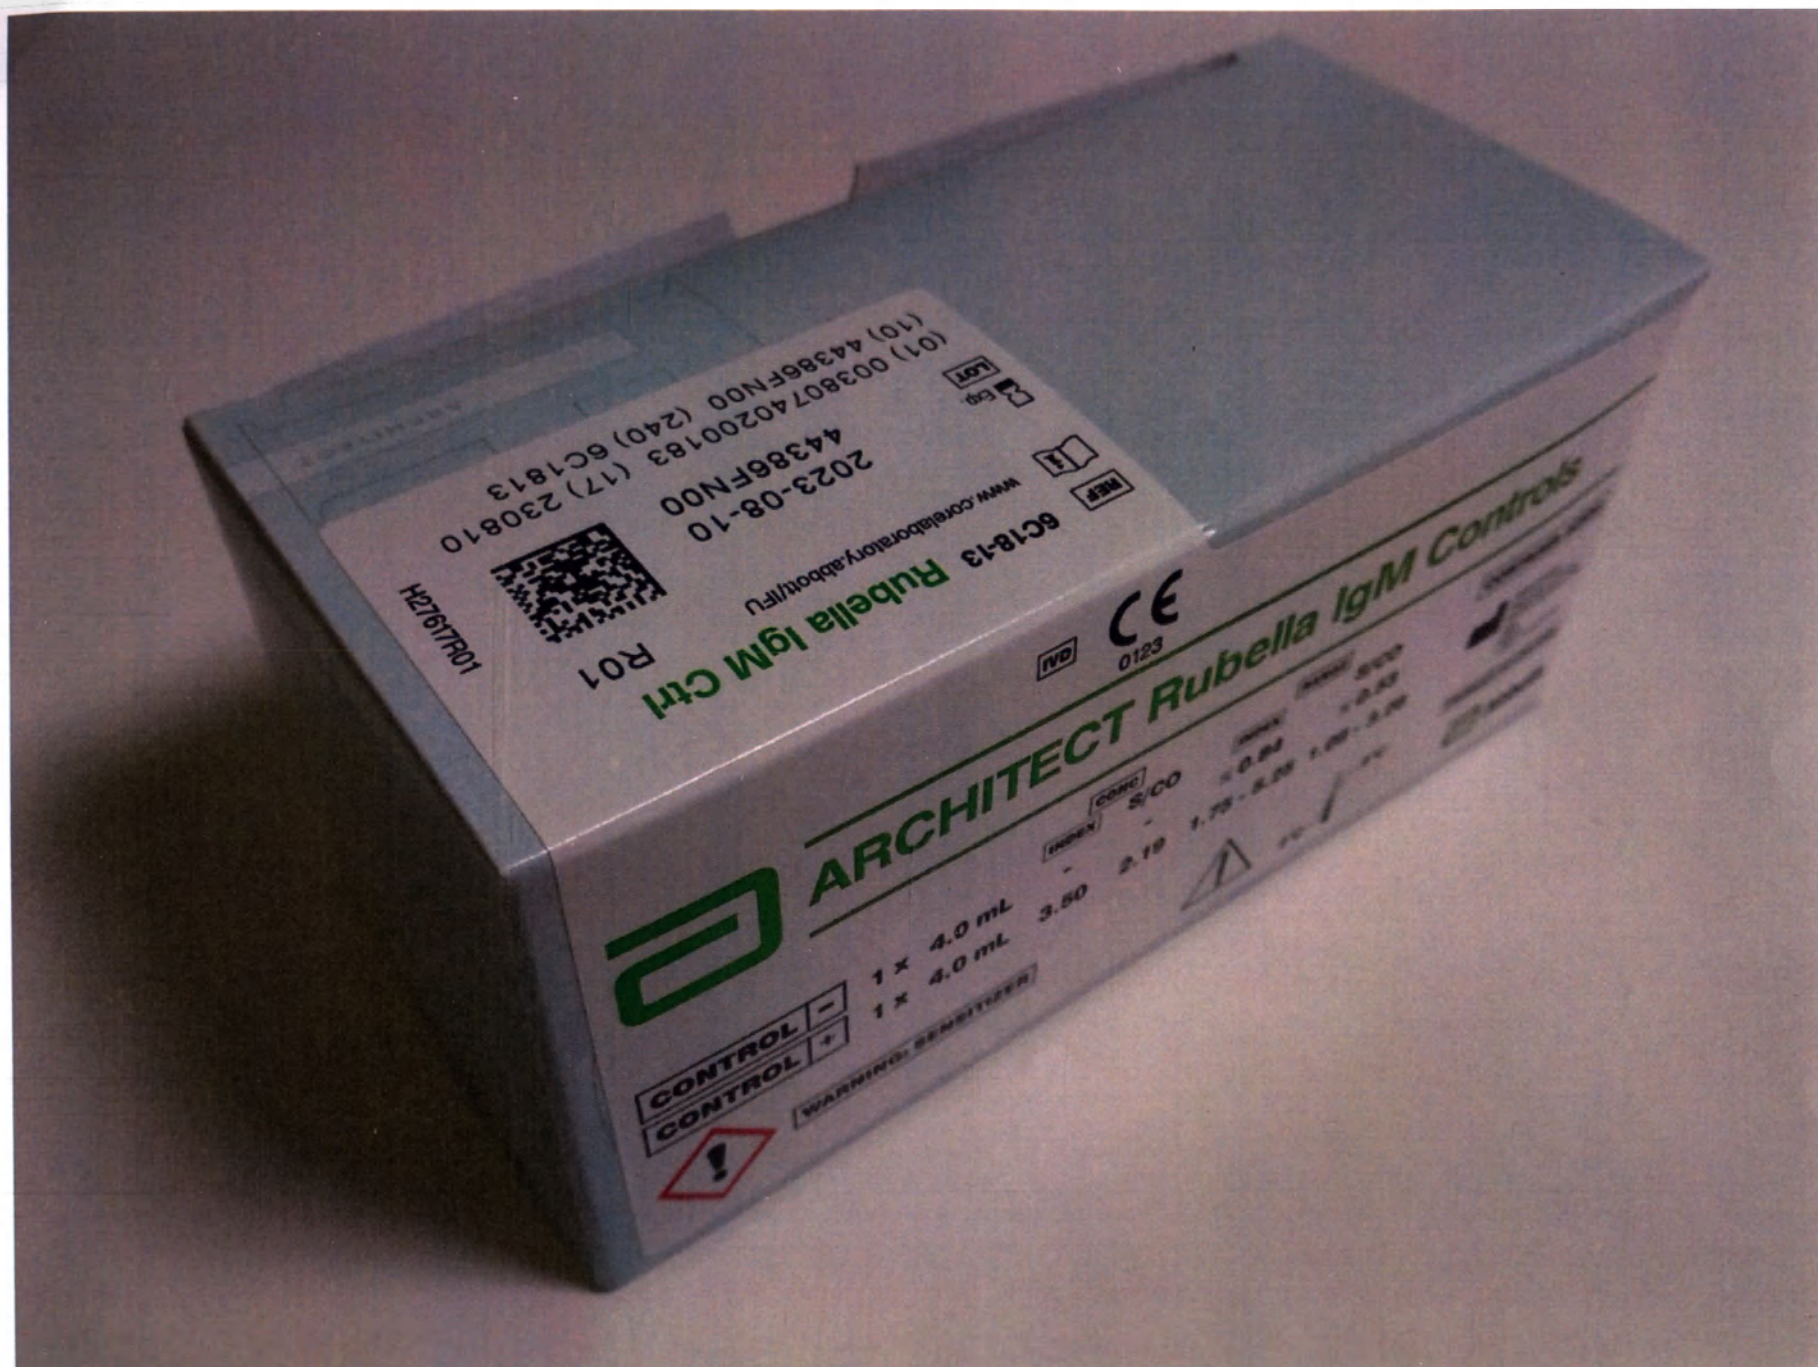

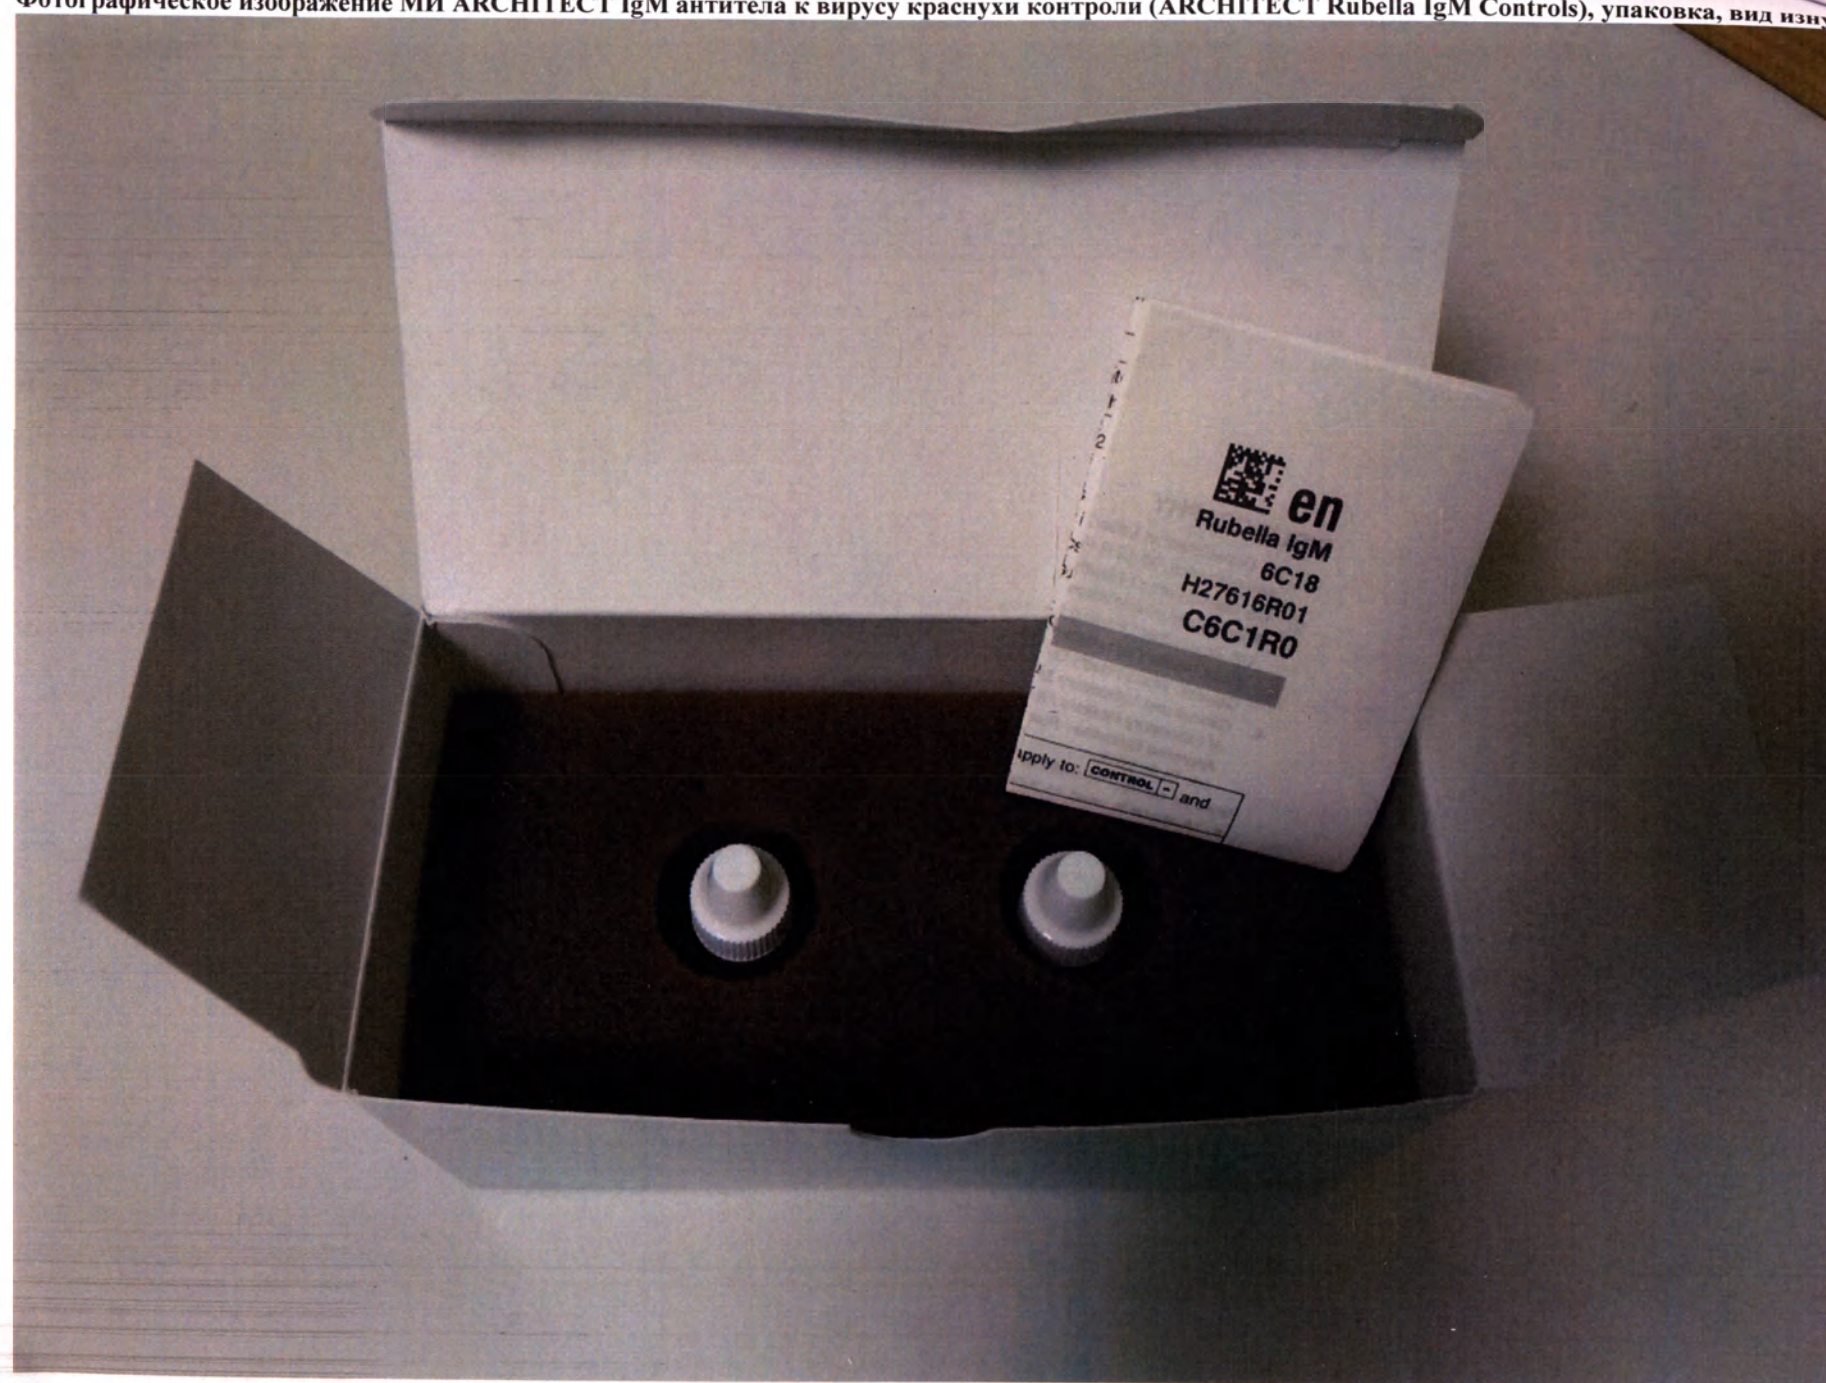

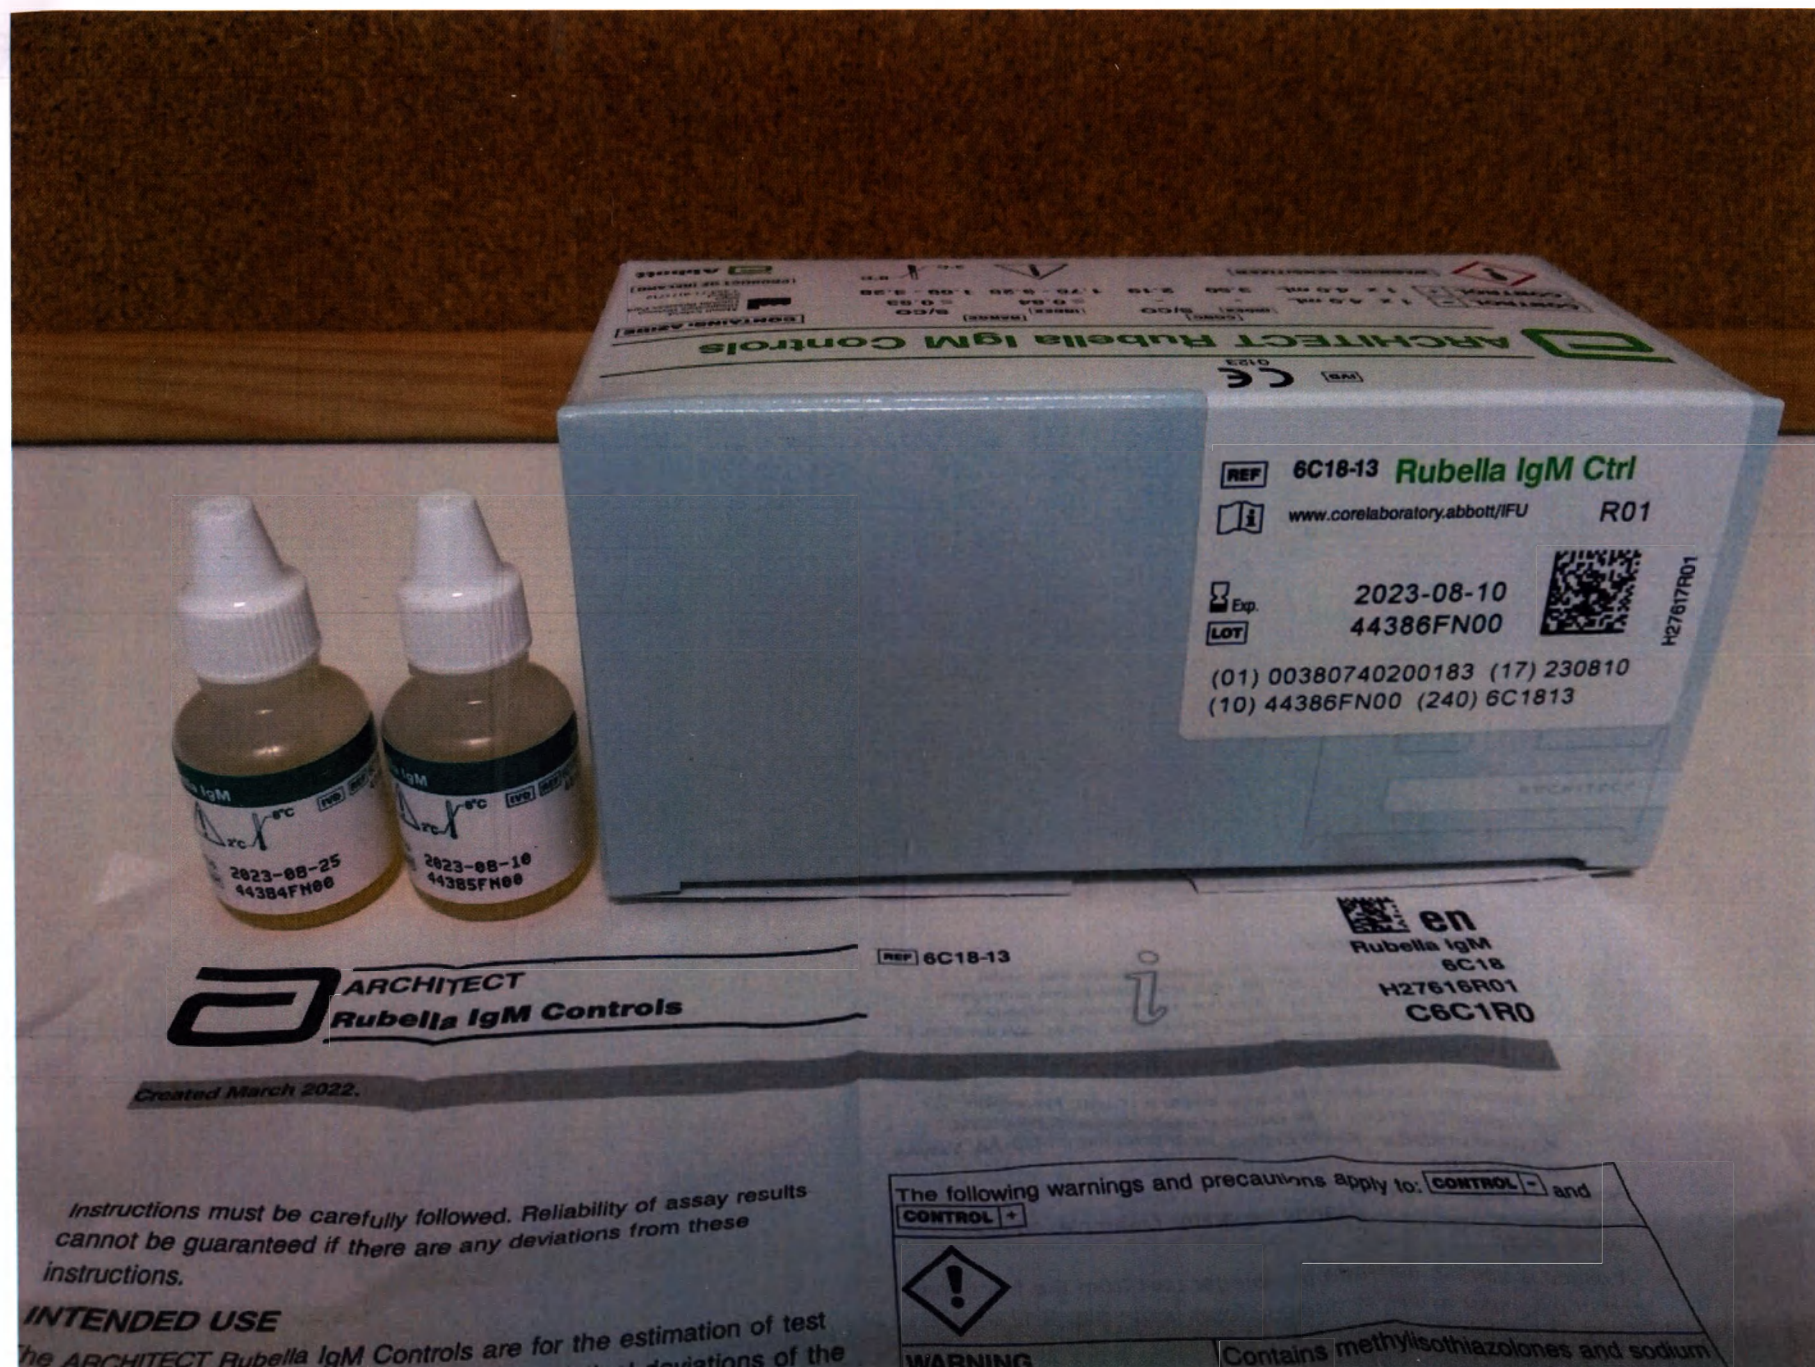





Подпись

[Handwritten signature]



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу
краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT "ARCHITECT
IgM антитела к вирусу краснухи контроли (ARCHITECT Rubella IgM
Controls)"**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



6C1813



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах ARCHITECT «ARCHITECT IgM антитела к вирусу
краснухи контроля (ARCHITECT Rubella IgM Controls)»

В составе: Контроль - (ARCHITECT Rubella IgM Control-) - 1 флакон х 4,0 мл; Контроль «+»
(ARCHITECT Rubella IgM Control+) - 1 флакон х 4,0 мл; Инструкция по применению/

Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics
Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Эбботт Ирландия,
Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park,
Sligo, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция
по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott / IFU / Серия, использовать до,
условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в
инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные
компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия ARCHITECT "ARCHITECT IgM антитела к вирусу краснухи контроли (ARCHITECT Rubella IgM Controls)

REF

6C18-13 Rubella IgM Ctrl

www.corelaboratory.abbott/IRU

LOT

0123

EXP

01/23

IVD

CE

0123

ARCHITECT Rubella IgM Controls

	CONC	INDEX	RANGE	S/CO
CONTROL -	1 x 4.0 mL	-	≤ 0.84	≤ 0.53
CONTROL +	1 x 4.0 mL	3.50	2.19 - 1.75 - 5.25	1.09 - 3.28

WARNING: SENSITIZER

2°C

8°C

CONTAINS: AZIDE

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finskin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712


PRODUCT OF IRELAND

Abbott


Rubella IgM Ctrl

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль «-» (ARCHITECT Rubella IgM Control -)

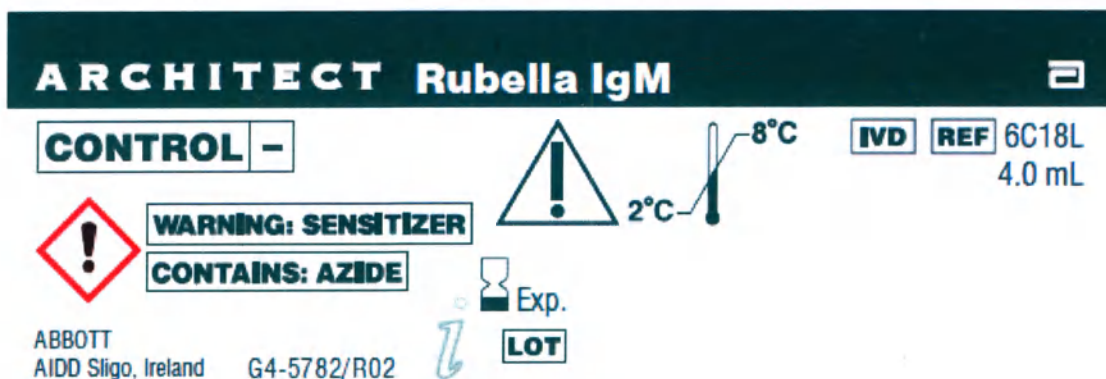

- Контроль «+» (ARCHITECT Rubella IgM Control +)

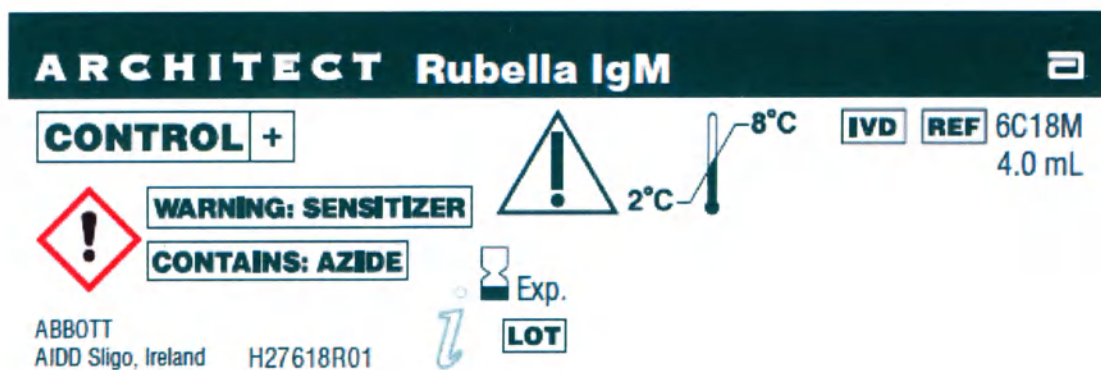

Подпись

Лифу

