



Фотография изделия



Комплекс изотопной диагностики КИД, ТУ 9442-036-11150760-2012 в составе по приложению А к протоколу № 2012-90, производства ЗАО «НИПК «Электрон», Россия.

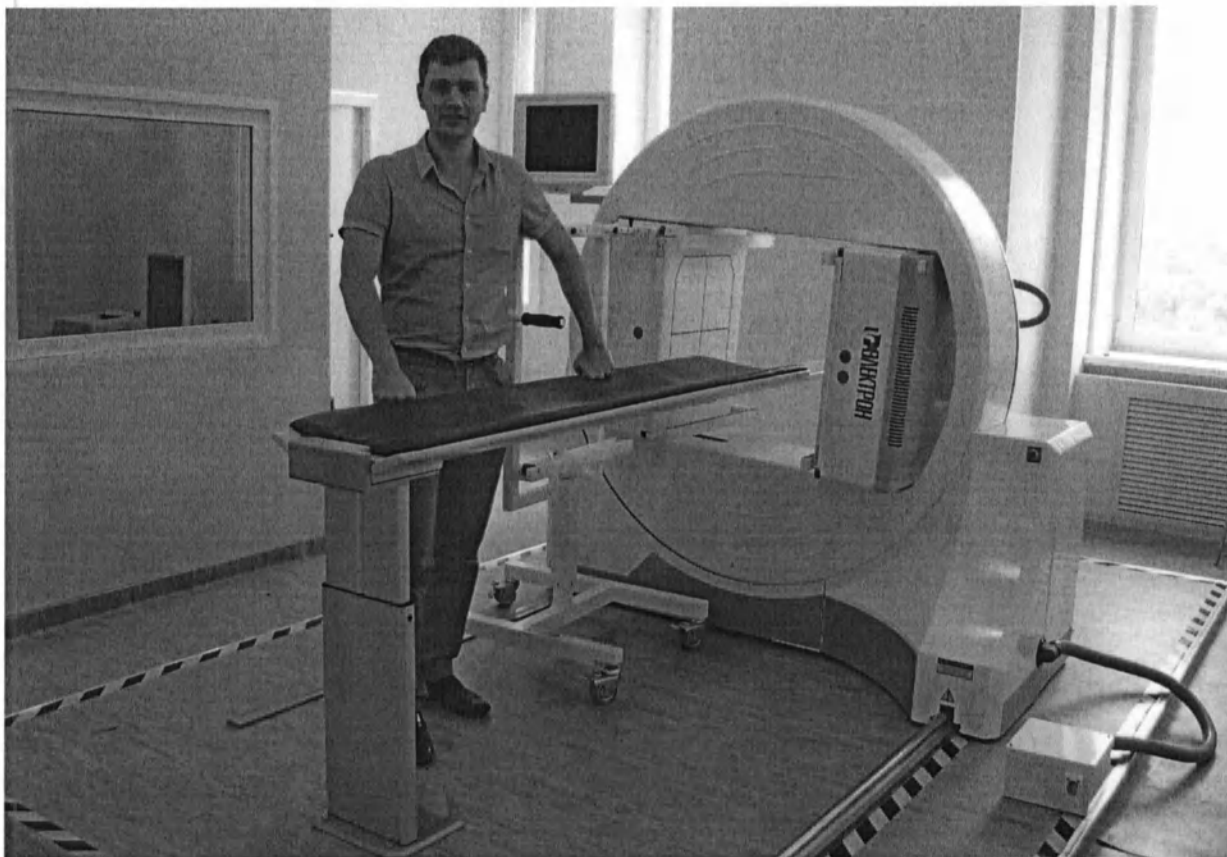

Маркировка аппарата

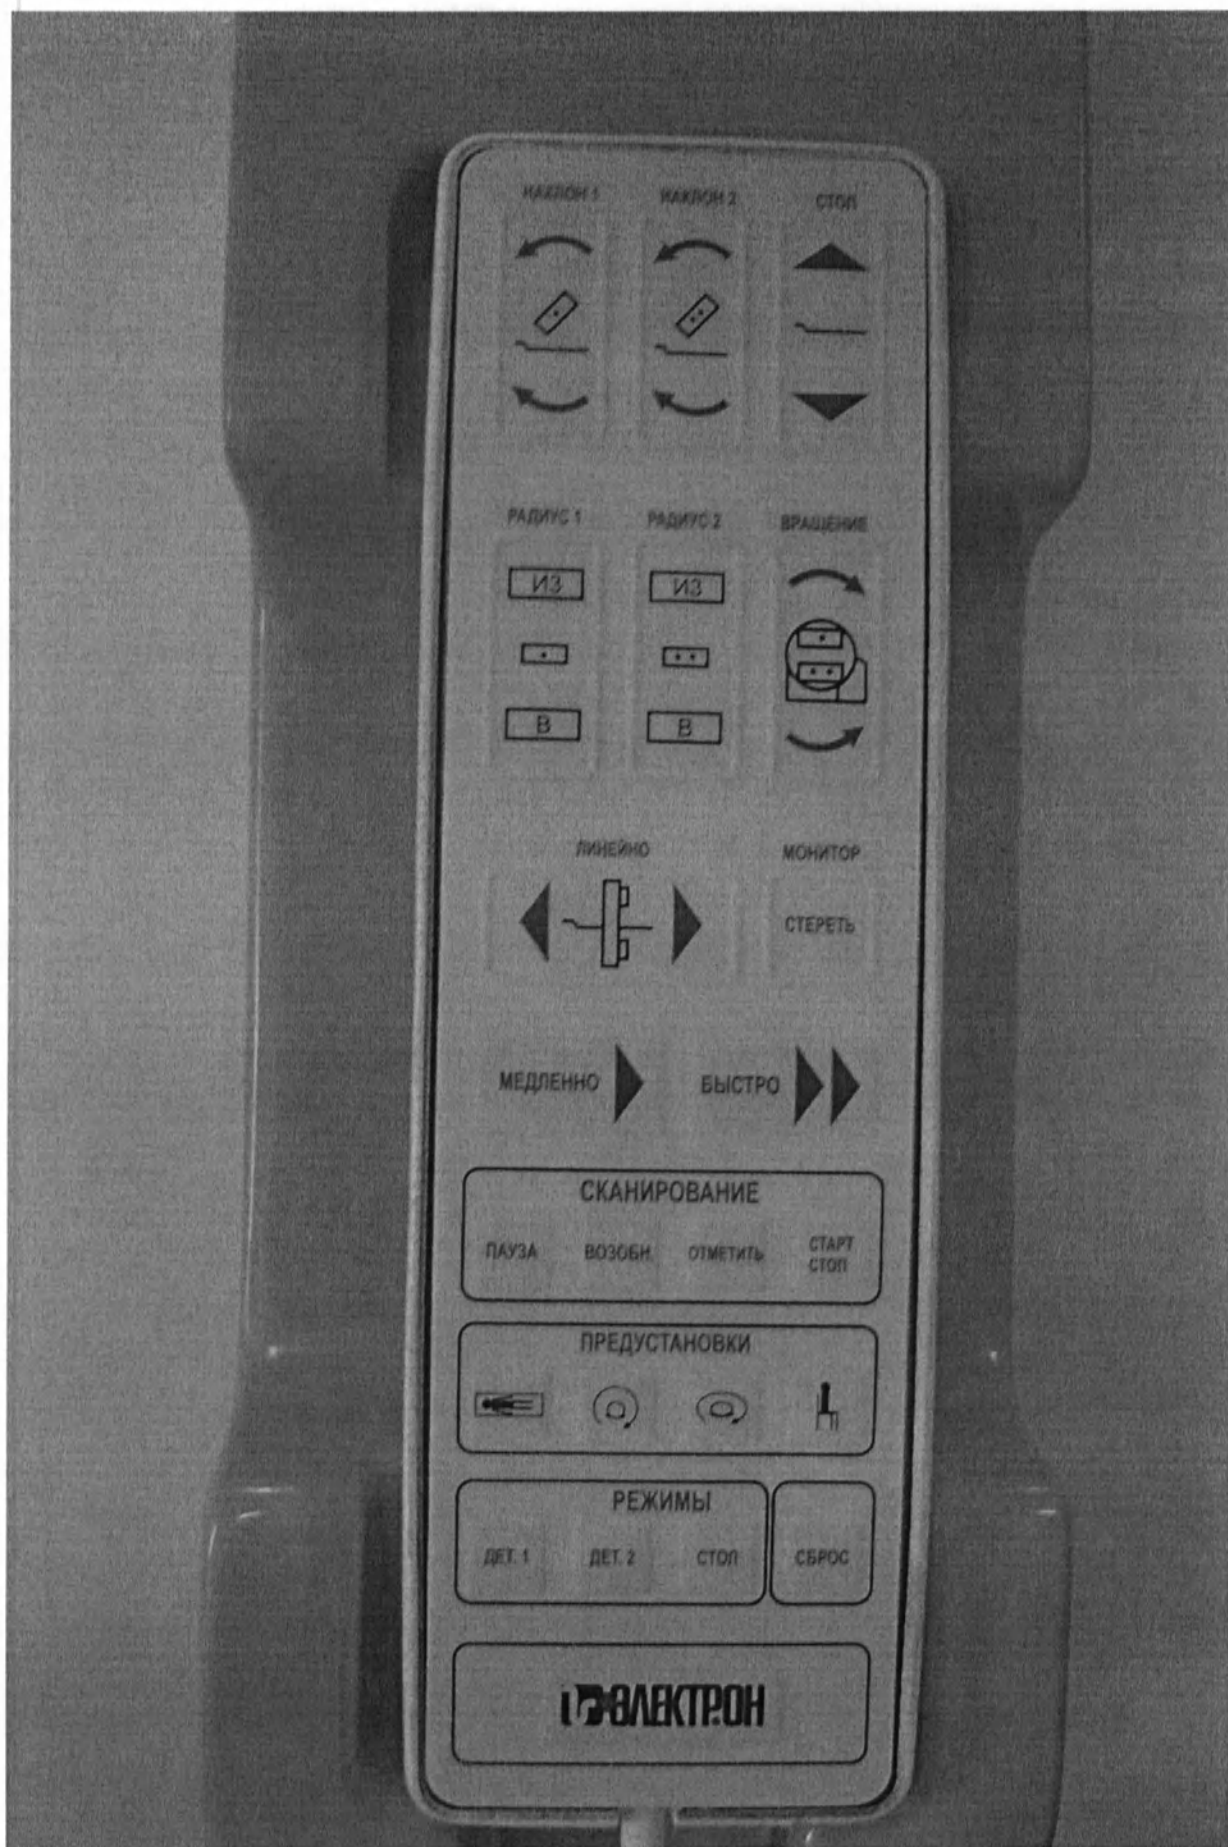

Пульт управления аппаратом