


Фотографические изображения изделия

**Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «ReaTerra Плюс» по
ТУ 32.50.50-021-68709709-2022**

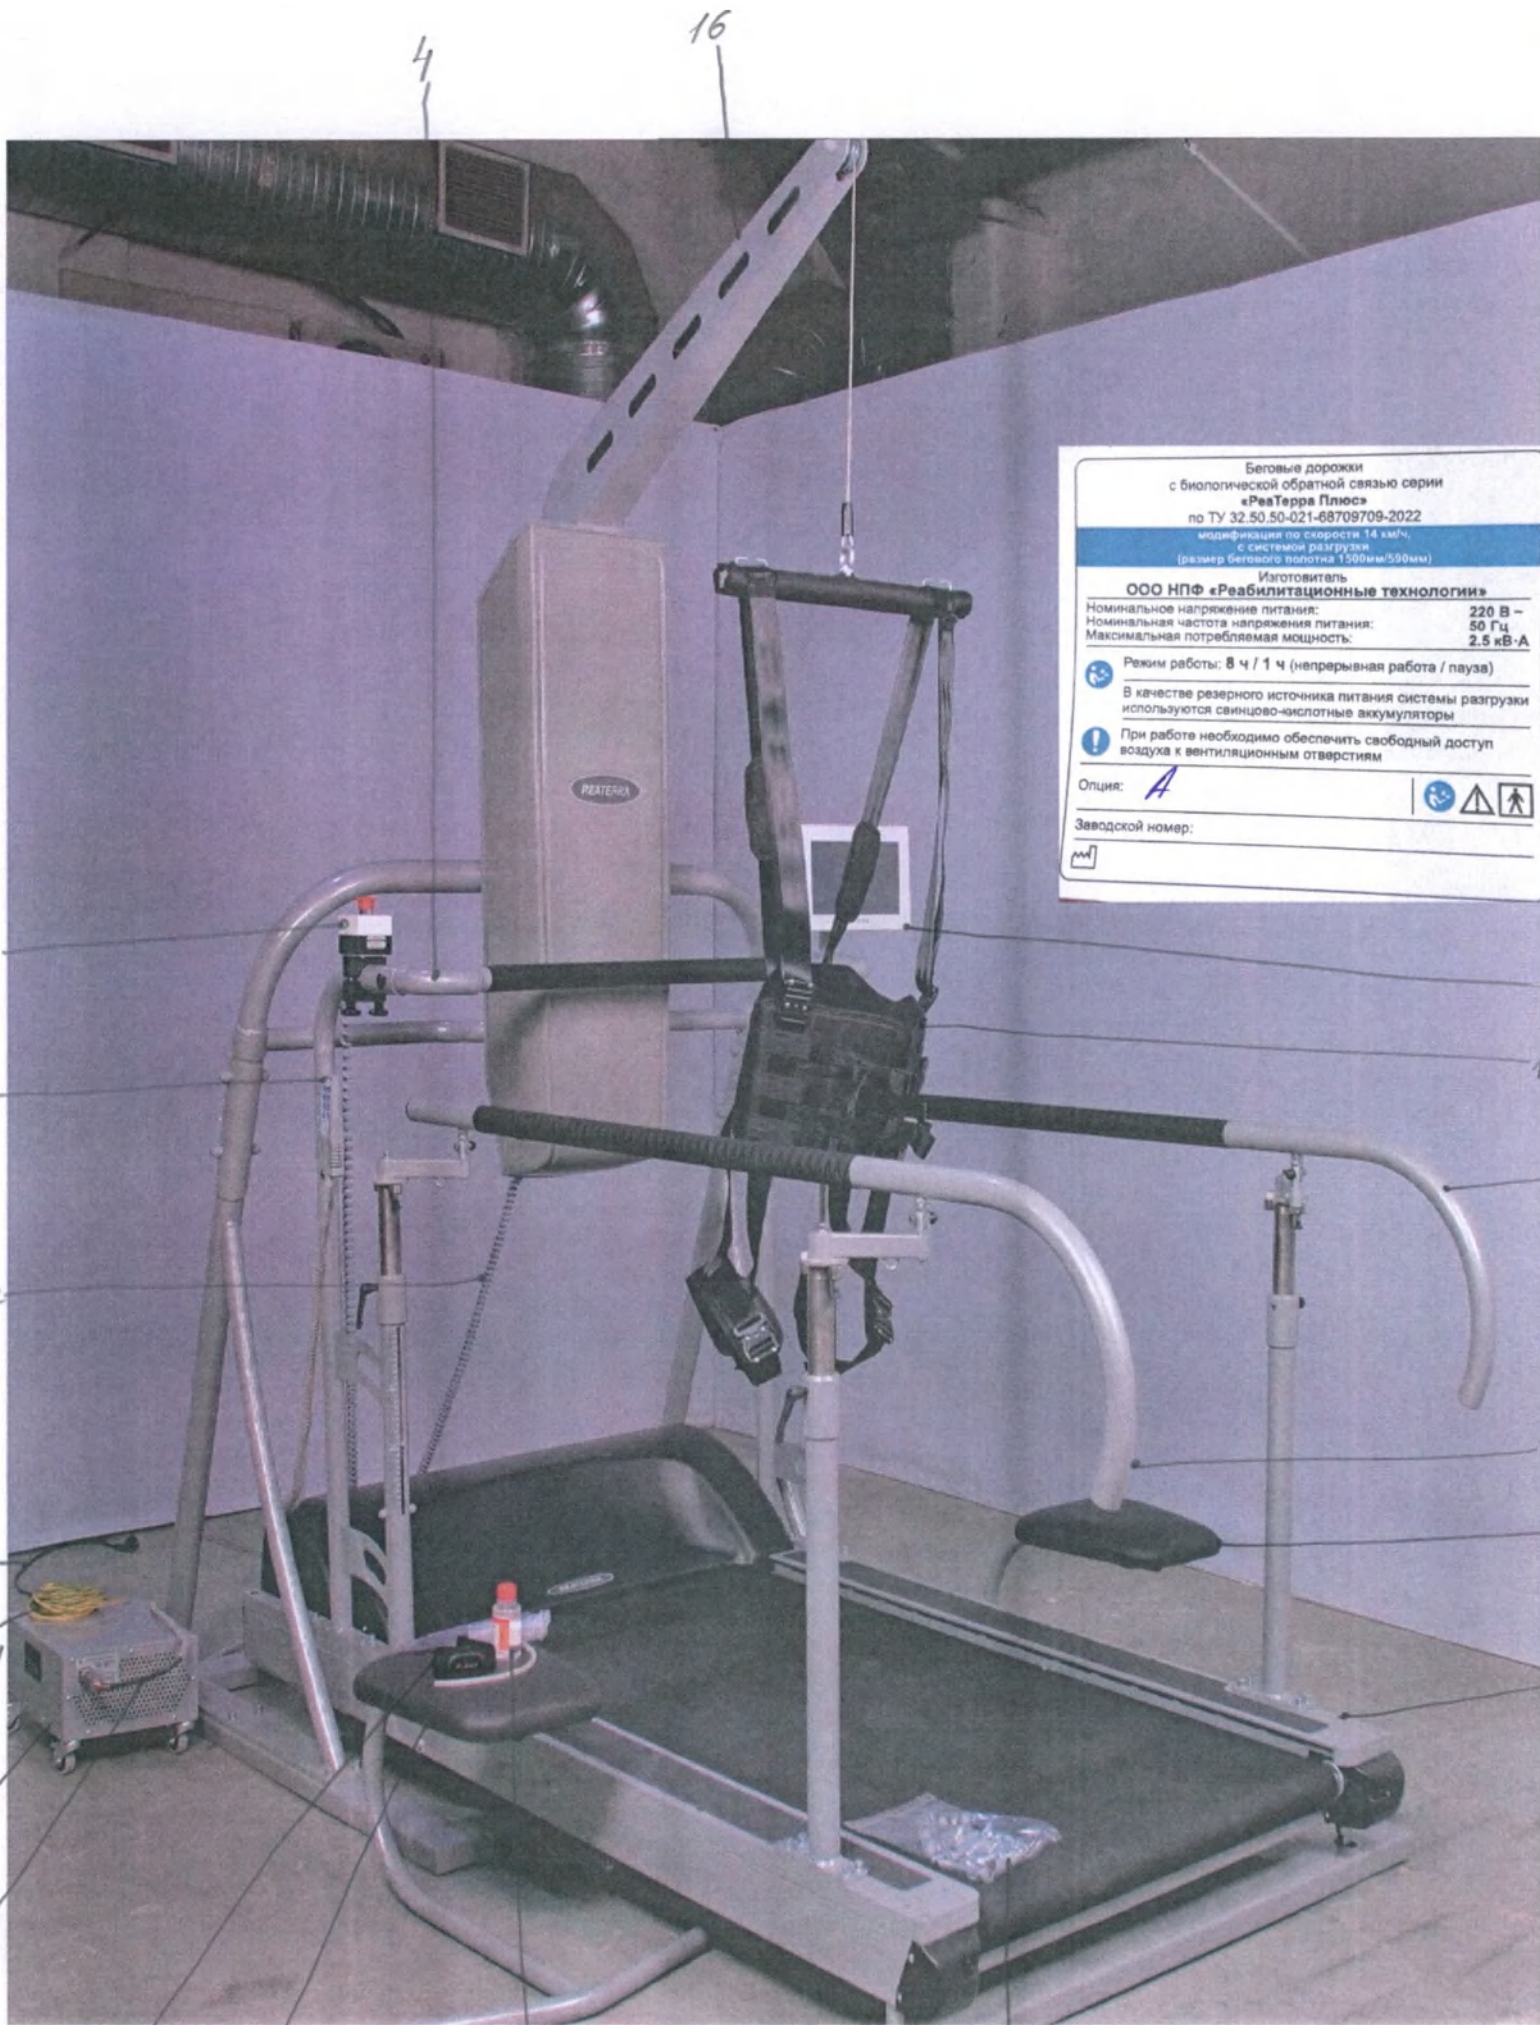

Беговые дорожки с биологической обратной связью серии «РеаТерра Плюс» по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022	
модификация по скорости 14 км/ч, с системой разгрузки (размер бегового полотна 1500мм/590мм)	
Изготовитель ООО НПФ «Реабилитационные технологии»	
Номинальное напряжение питания:	220 В
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт
Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)	
В качестве резервного источника питания системы разгрузки используются свинцово-кислотные аккумуляторы	
При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям	
Опция:	A
Заводской номер:	

1. Беговая дорожка
2. Регулируемый поручень левый
3. Регулируемый поручень с кронштейном правый
4. Передняя дуга безопасности 590 для регулируемых поручней
5. и 6. Сиденье для медицинского персонала
7. Пульт управления
8. Панель управления
9. Кнопка «Аварийная остановка»
10. Датчик ЧСС. Модель H10, изготовитель Polar
11. Трансформатор разделительный 2,5 кВА
12. Кабель питания беговой дорожки
13. Кабель сетевой
14. Провод защитного заземления
15. Силиконовое масло REXANT, ПМС-1000 (трубка + шприц)
16. Система разгрузки 590
17. Кабель питания системы разгрузки
18. Жилет для поддержания пациента
19. Крепежные изделия для сборки беговых дорожек

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РееТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Модификация по скорости 14 км/ч,
без системы разгрузки
(размер бегового полотна 1500мм/900мм)

Изготовитель
ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям

Опция: *A*

Заводской номер:



1. Беговая дорожка
2. Регулируемый поручень левый
3. Регулируемый поручень с кронштейном правый
4. Пульт управления
5. Панель управления
6. Кнопка «Аварийная остановка»
7. Передняя дуга безопасности 900 для регулируемых поручней
8. Кабель питания беговой дорожки

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-88709709-2022
Модификация по скорости 14 км/ч,
без системы разгрузки
(размер бегового полотна 1500мм/900мм)

Изготовитель:
ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Номинальное напряжение питания: 220 В ~
Номинальная частота напряжения питания: 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 2.5 кВт·А


Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям

Опция: 

Заводской номер: 

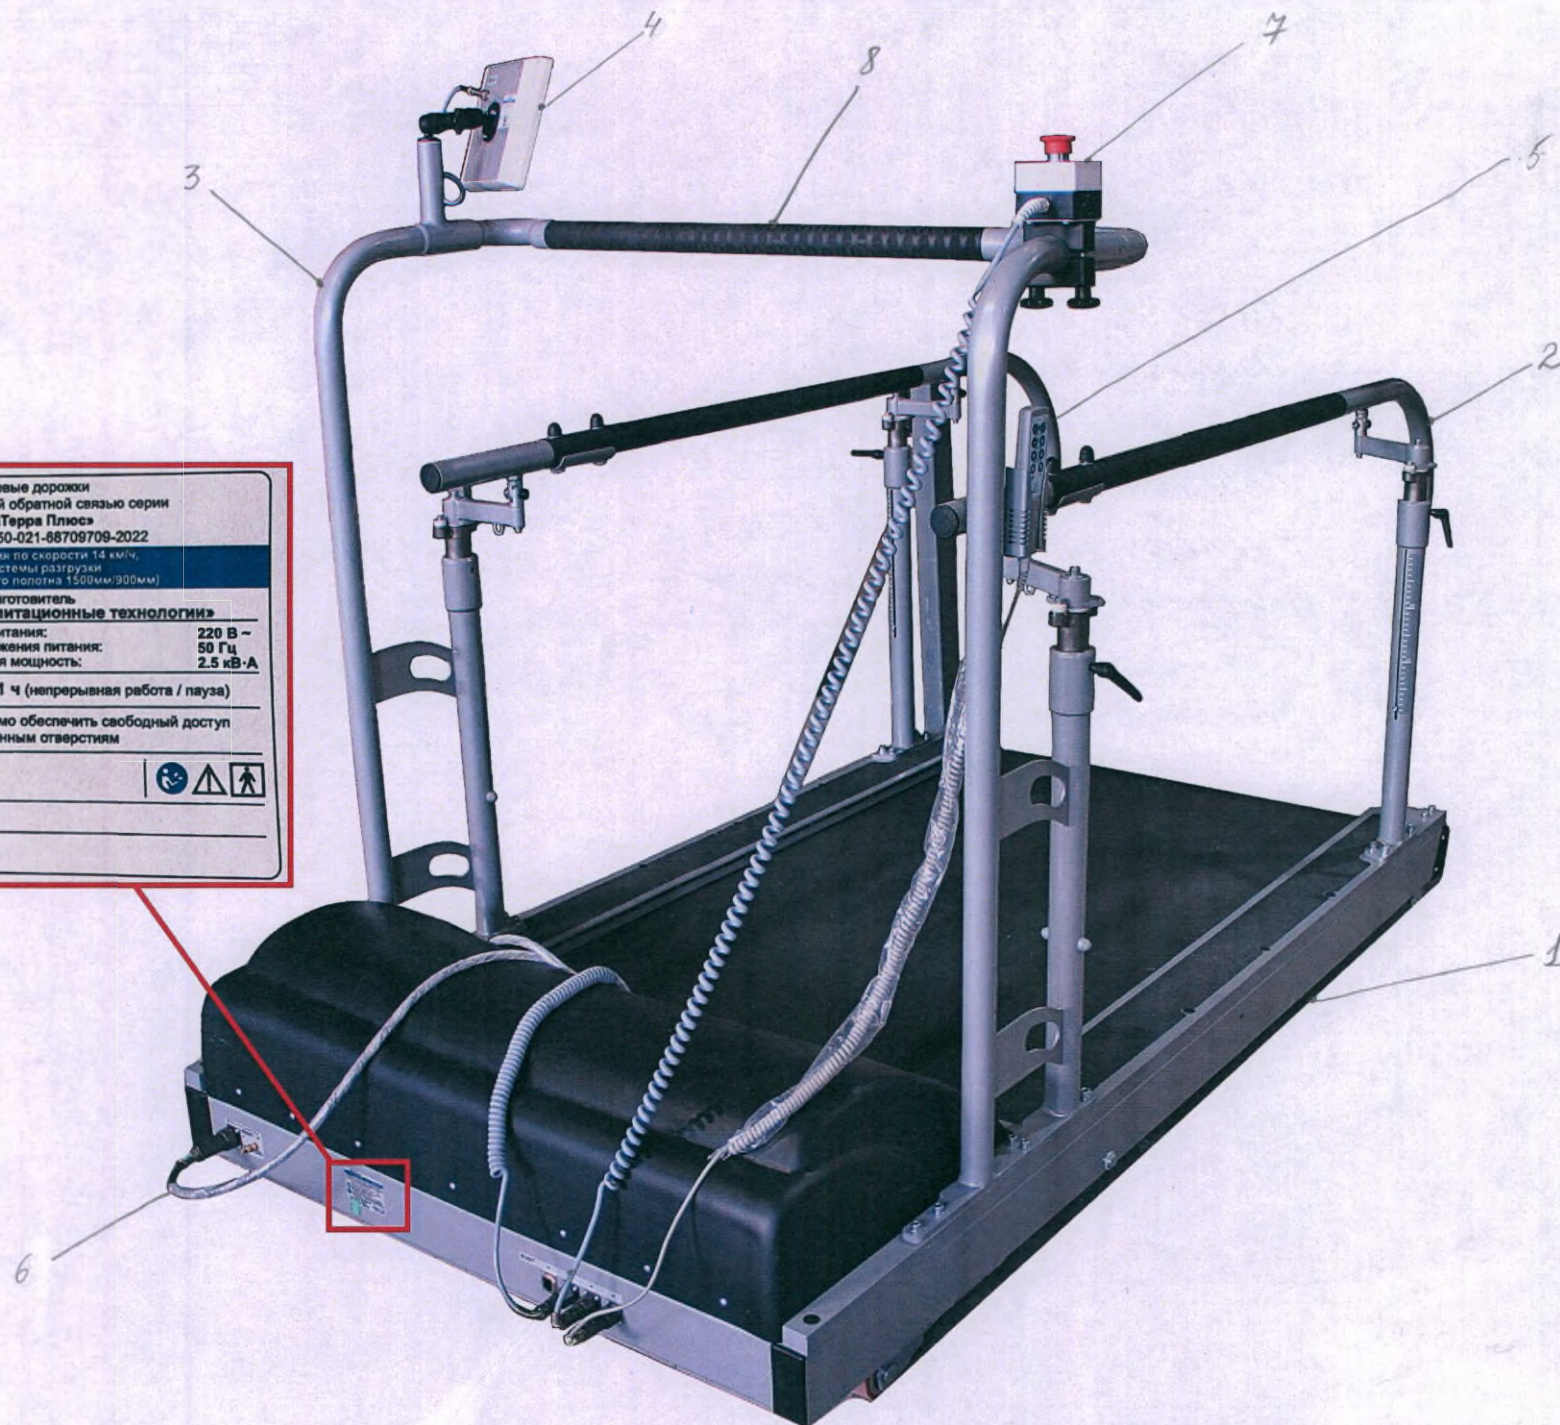

1. Безобая горюшка
2. Реушурешан, поручень лебан
3. Реушурешан, поручень в кроватке
4. Ланень уграбешан
5. Мухом уграбешан
6. Кабень ланянь, безобой горюшка
7. Кюнка "Авгуанан асмаюбка"
8. Первуха юга безобасюшка

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Модификация по скорости 16 км/ч,
без системы разгрузки
(размер бегового полотна 1500мм/500мм)

Изготовитель
ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2,5 кВт

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям


Опция:   

Заводской номер: _____





1. Беловая горюшка
2. Речушечник, поручек и крошечный
3. Речушечник, поручек
4. Речушечник, поручек
5. Кабелюк, поручек
6. Тракторист, поручек
7. Кабелюк, поручек
8. Крошка "Августинская"
9. Речушечник, поручек

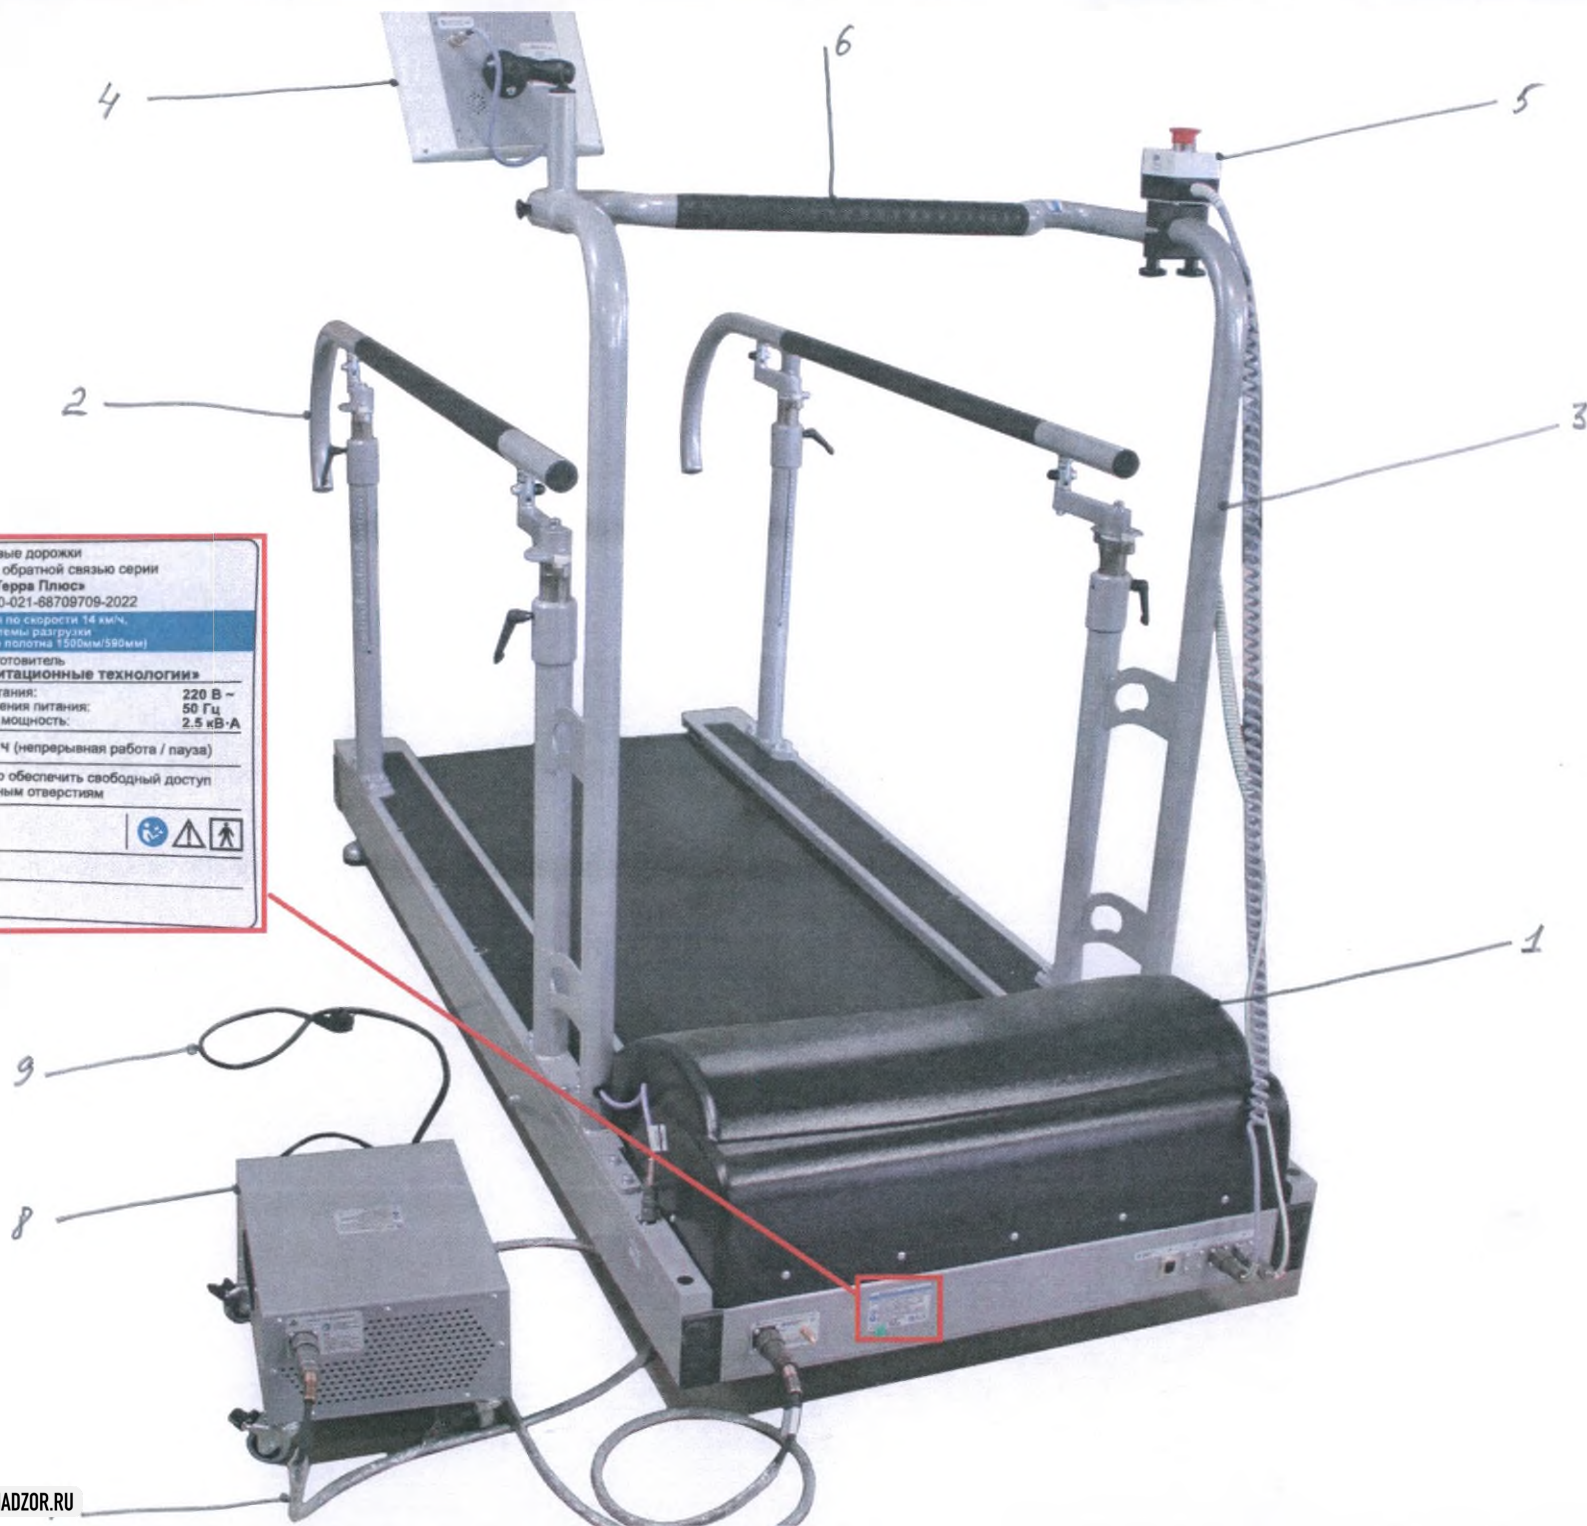

1. Беговая дорожка
2. Регулируемый поручень левый
3. Регулируемый поручень с кронштейном правый
4. Панель управления
5. Кнопка «Аварийная остановка»
6. Передняя дуга безопасности 590 для регулируемых поручней
7. Кабель питания беговой дорожки
8. Трансформатор разделительный 2,5 кВА
9. Кабель сетевой

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РевТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Модификация по скорости 22 км/ч,
без системы разгрузки
(размер бегового полотна: 1500мм/590мм)

Изготовитель:
ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2,5 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)


При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям

Опция:

Заводской номер:



1. Беговая дорожка
2. Регулируемый поручень левый
3. Регулируемый поручень с кронштейном правый
4. Панель управления
5. Кнопка «Аварийная остановка»
6. Передняя дуга безопасности 590 для регулируемых поручней
7. Кабель питания беговой дорожки
8. Трансформатор разделительный 2,5 кВА
9. Кабель сетевой

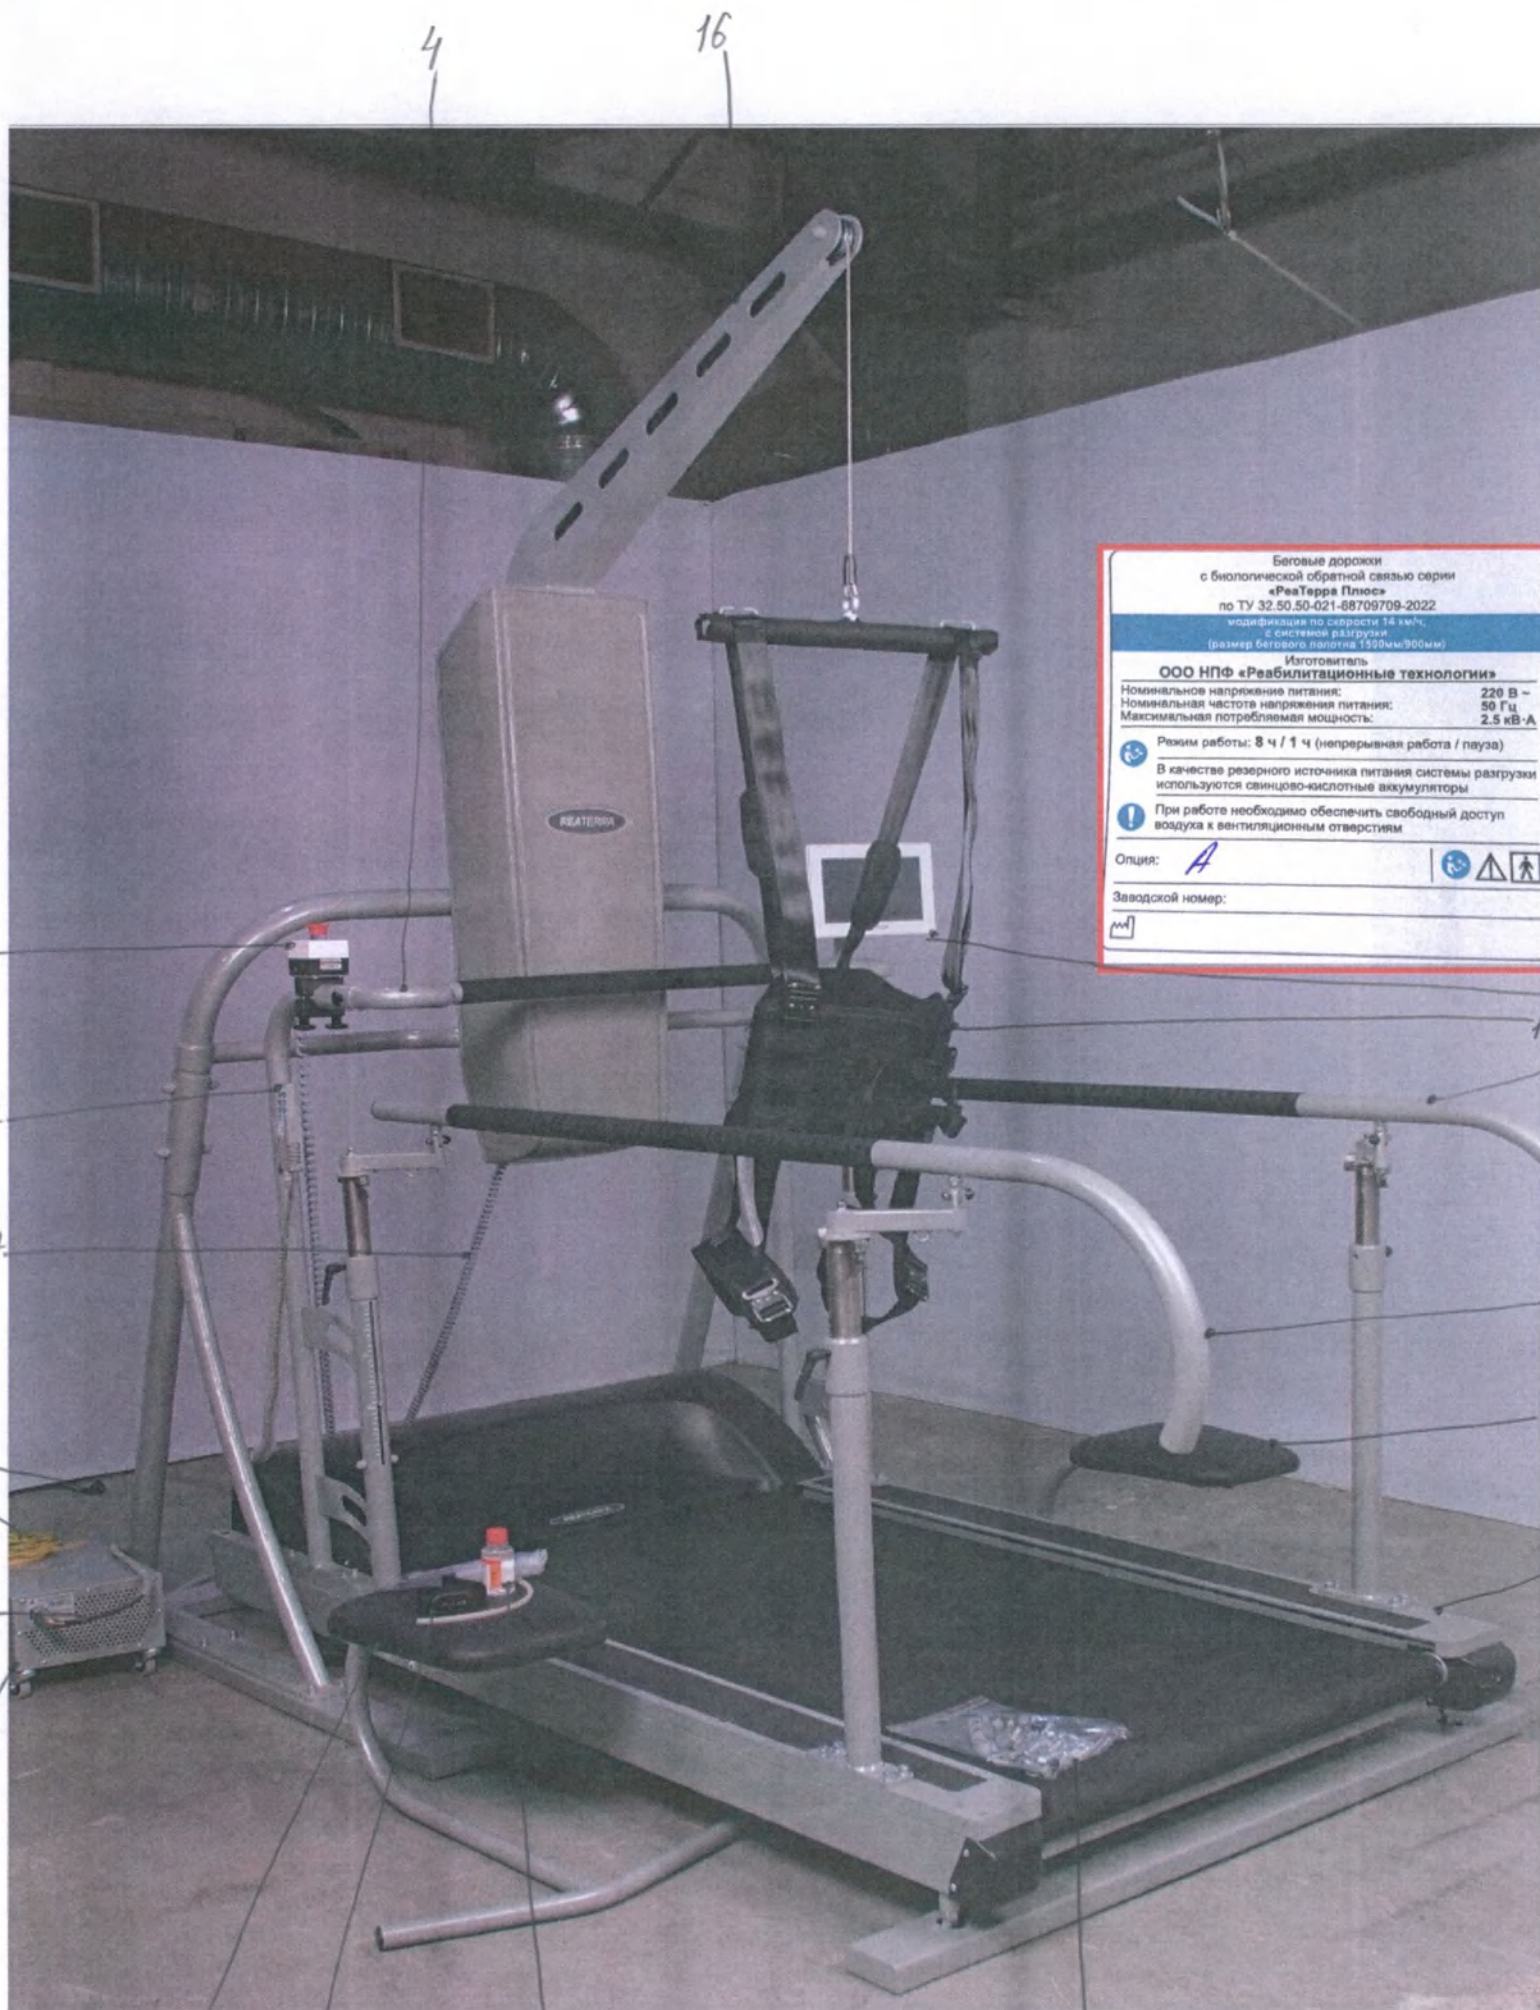

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«ReaTerra Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
модификация по скорости 14 км/ч,
с системой разгрузки
(размер бегового полотна 1500мм/900мм)

Изготовитель
ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

В качестве резервного источника питания системы разгрузки
используются свинцово-кислотные аккумуляторы

При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям

Опция: *A*

Заводской номер: _____

⚠ ⚡ ⚠

1. Беговая дорожка
2. Регулируемый поручень левый
3. Регулируемый поручень с кронштейном правый
4. Передняя дуга безопасности 900 для регулируемых поручней
5. и 6. Сиденье для медицинского персонала
7. Пульт управления
8. Панель управления
9. Кнопка «Аварийная остановка»
10. Датчик ЧСС. Модель H10, изготовитель Polar
11. Трансформатор разделительный 2,5 кВА
12. Кабель питания беговой дорожки
13. Кабель сетевой
14. Провод защитного заземления
15. Силиконовое масло REXANT, ПМС-1000 (трубка + шприц)
16. Система разгрузки 900
17. Кабель питания системы разгрузки
18. Жилет для поддержания пациента
19. Крепежные изделия для сборки беговых дорожек



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
модификация со скоростью 14 км/ч,
с системой разгрузки
(размер бегового полотна 1500мм/590мм)

Изготовитель
ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2,5 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

В качестве резервного источника питания системы разгрузки
используются свинцово-кислотные аккумуляторы

При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям

Опция: Д

Заводской номер: _____

М

1. Бездарь горюхи
2. Разгнущенный, погнущенный, погнущенный
3. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
4. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
5. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
6. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
7. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
8. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
9. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
10. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
11. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
12. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
13. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
14. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
15. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
- (Грунт + Шпунт)
16. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
17. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
18. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны
19. Разгнущенный, погнущенный с противоположной стороны



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«ReaTerra Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
модификация по скорости 14 км/ч
с сетевой нагрузкой
(размер бегового полотна: 1500мм/900мм)

Изготовитель
ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2,5 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

В качестве резервного источника питания системы разгрузки используются свинцово-кислотные аккумуляторы

При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

Опции:

Заводской номер:

1. Бесобас поромек
 2. Регуруецим, поручек небом
 3. Регуруецим, поручек с крошечными правли
 4. Переход зима безопасности 900 для регуруецим поручек
 5. 6. Сурекс для щепильного персонала
 7. Пушик грабильных
 8. Равекс грабильных
 9. Транка "Абдуриас семанодка"
 10. Дамрук все. Шорек Н10, удостоверение Polar
 11. Пробой заварного гравельных
 12. Кабас нуманус бесобас поромек
 13. Кабас семобас
 14. Трансформатор гравельных
 15. Суринковое шасси REXANT, РМС-1000
- (Трубка + шорук)
16. Суринекс разгукен 900
 17. Кабас нуманус естествен разгукен
 18. Милуем для поручек и лавина
 19. Креничирек шорек для сборки бесобас поромек



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РееТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
модификация по скорости 22 км/ч,
с системой разгрузки
(размер бегового полотна 1500мм*590мм)

Изготовитель
ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Номинальное напряжение питания:	220 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт-А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

В качестве резервного источника питания системы разгрузки
используются свинцово-кислотные аккумуляторы

При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям

Опция:

Заводской номер:

1. Бесобая горюшка
2. Регулируемый, поручень небой
3. Регулируемая, поручень с тронимыйной правый
- 4 и 5. Сурень для асигуанского персонал
6. Парень управленец
7. Парень управленец 8 кн.
8. Кнопка "Аварийная остановка"
9. Парень УСС. Модель Н10, изомодельная 101а
10. Транспортировщик регулируемый 2,5 кВ А
11. Кабель нулевой, бесобая горюшка
12. Кабель осветов
13. Провод заземного заземления
14. Газовое масло KEXANT, РДС-1000
(Грунт + Шипы)
15. Сумма регулировки 590
16. Кабель нулевой сумма регулировки
17. Механизм для регулировки нагнетания
18. Крепление сурень для сборки бесобой горюшка
19. Регулируемая бесобойная 590 для регулируемых поручней

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Провод защитного
заземления

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Провод защитного
заземления
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

**ООО НПФ
«Реабилитационные
технологии»**



**Кабель зарядного
устройства**






ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»
Беговые дорожки с биологической
обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Беспроводное
устройство управления






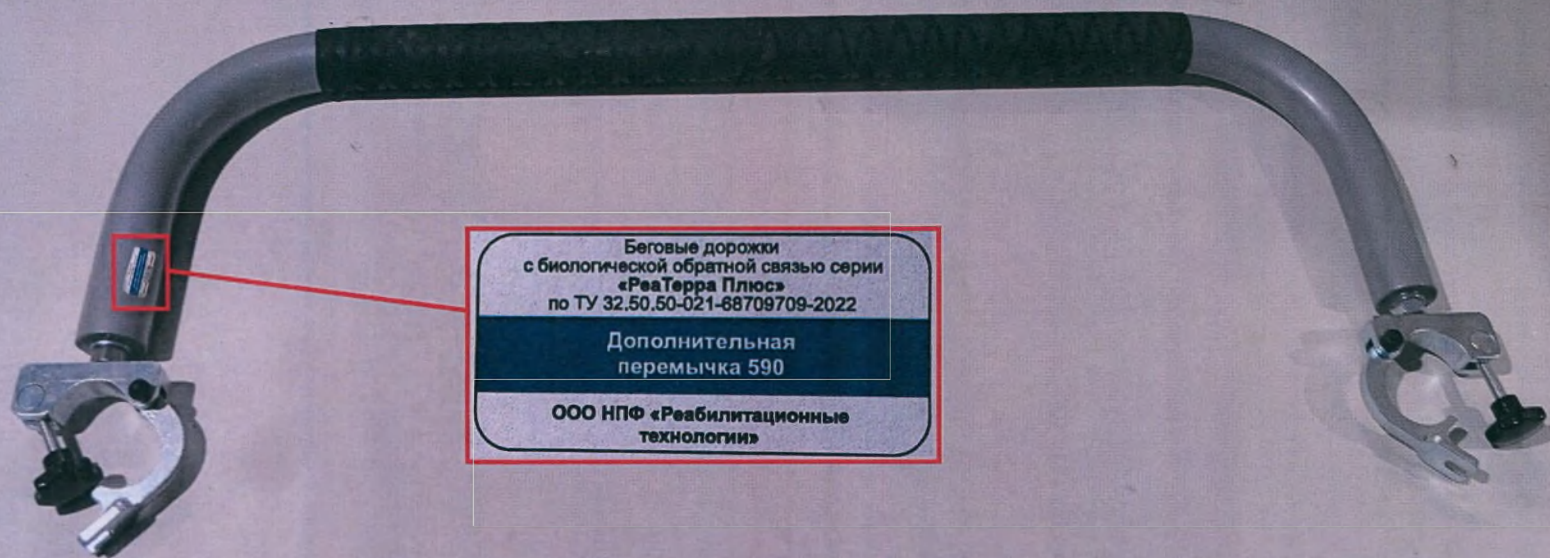

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РееТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Дополнительная
перемычка 590

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

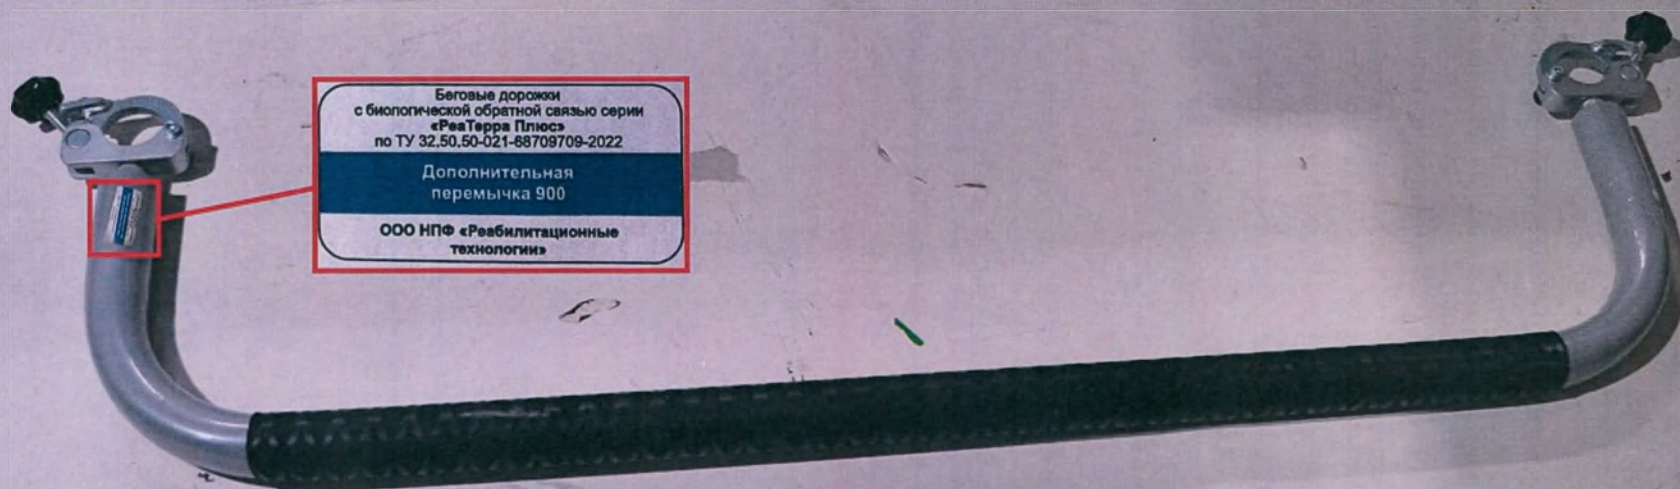

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Дополнительная
перемычка 900

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Беговые дорожки
с биологической обратной связью
серии «РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

**Жилет для поддержания
пациента
(размер взрослый 1)**



стирка с вещами, схожими по цвету



ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

Беговые дорожки
с биологической обратной связью
серии «ReaTerra»
по ТУ 9444-009-68709709-2016

**Жилет для поддержания
пациента**
(размер взрослый 2)



стирка с вещами, схожими по цвету



ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

Беговые дорожки
с биологической обратной связью
серии «РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

**Жилет для поддержания
пациента
(размер детский)**



стирка с вещами, схожими по цвету



ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»
Беговые дорожки
с биологической обратной связью
серии «РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-88709709-2022

**Жилет для поддержания
пациента**
(размер подростковый)

90°
стирка с вещами, схожими по цвету



 ООО НПФ «Реабилитационные технологии»		
 Зарядное устройство 		
Ном. частота напряжения питания 50 Гц	Ном. напряжение питания 220 В ~	Макс. потребляемая мощность 20 В · А



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Кабель питания
беговой дорожки

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»






Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Кабель питания
системы разгрузки

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Кабель питания
системы разгрузки
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

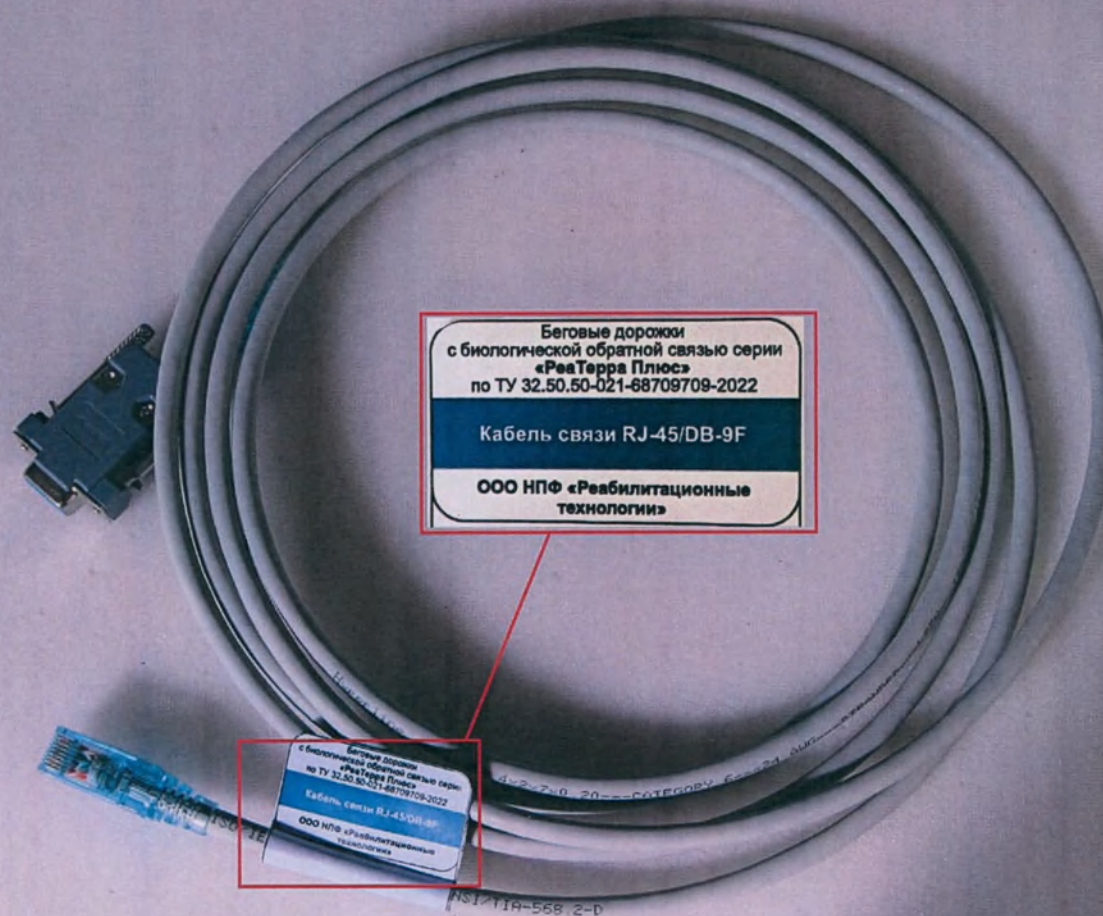

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Кабель связи RJ-45/DB-9F

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022


Кабель связи RJ-45/DB-9F

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Кабель сетевой

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

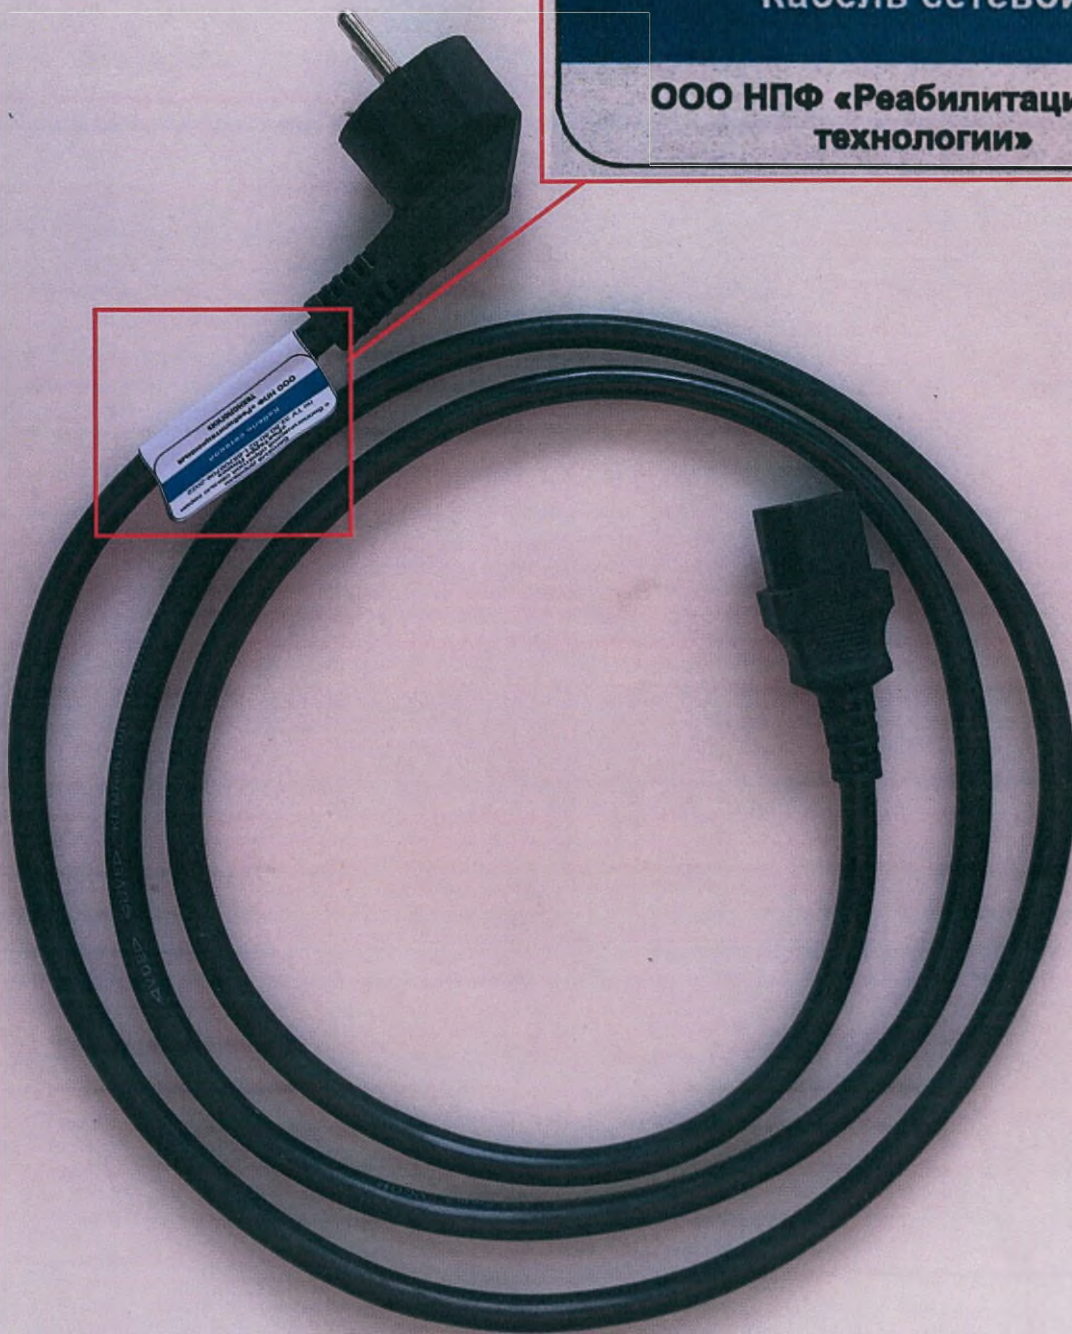

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Кнопка «Аварийная остановка»


ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Кнопка «Аварийная остановка»

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

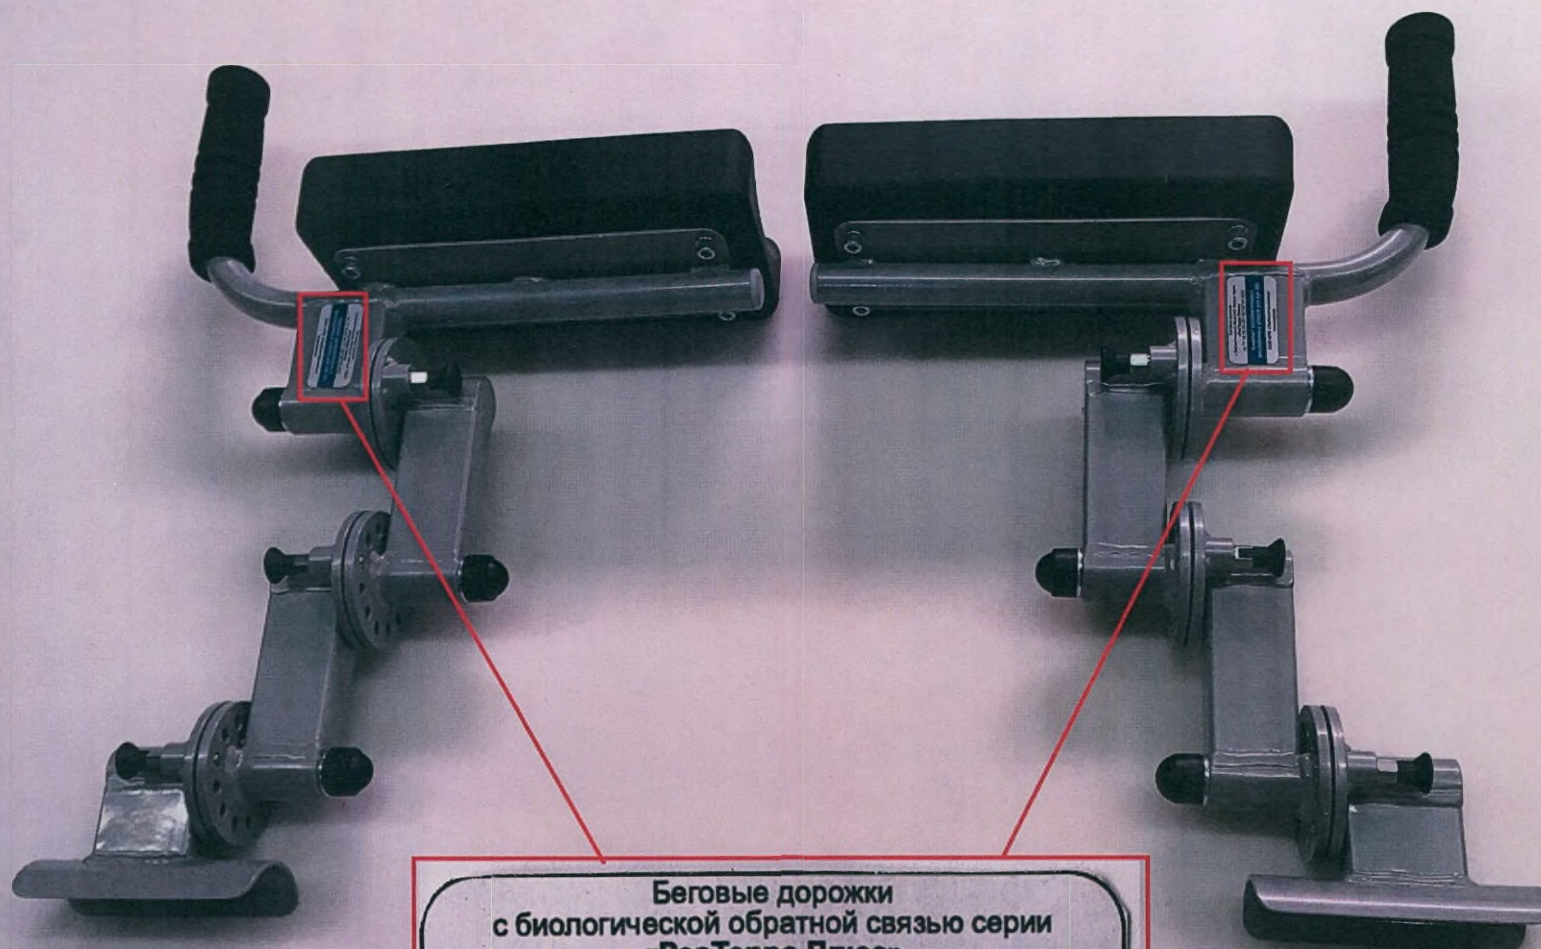

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Комплект дополнительных
регулируемых упоров для рук 590

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Комплект дополнительных
регулируемых упоров для рук 900

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

Беговые дорожки с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Крепежные изделия для сборки беговых дорожек

Для крепления фиксированных больших поручней	
винт М10х30 ГОСТ 11738-84	8 шт.
винт М8х30 ГОСТ 11738-84	8 шт.
шайба 10 ГОСТ 11371-78	8 шт.
шайба 8 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Для крепления фиксированных малых поручней	
винт М8х30 ГОСТ 11738-84	8 шт.
шайба 8 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Для крепления регулируемых поручней	
винт М10х30 ГОСТ 11738-84	12 шт.
винт М8х30 ГОСТ 11738-84	8 шт.
шайба 10 ГОСТ 11371-78	12 шт.
шайба 8 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Для крепления передней дуги безопасности	
рукоятка звездообразная Kipp K0152.4205×15 DIN 6336	2 шт.
Для крепления рамп для въезда инвалидной коляски	
винт М8х30 ГОСТ 11738-84	4 шт.
винт М5х8 ГОСТ 17475-80	4 шт.
Для крепления дополнительных регулируемых упоров для рук	
шайба 10 ГОСТ 11371-78	4 шт.
гайка М10 ГОСТ 5927-70	4 шт.
пластмассовый колпачок на гайку М10 ТРD8	4 шт.
Для крепления элементов конструкции системы разгрузки	
болт М10х85 ГОСТ 7798-70	4 шт.
шайба 10 ГОСТ 11371-78	8 шт.
гайка М10 ГОСТ 5927-70	4 шт.
пластмассовый колпачок на гайку М10 ТРD8	8 шт.
винт М10х30 ГОСТ 11738-84	12 шт.
шайба 10 ГОСТ 6402-70	12 шт.
Для крепления системы разгрузки к полу	
распорный анкер 12х140 ГОСТ Р 56731-2015	2 шт.
пластмассовый колпачок на гайку М8 ТРD8	2 шт.

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»





Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Опора
веревочная

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Опора
веревочная
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

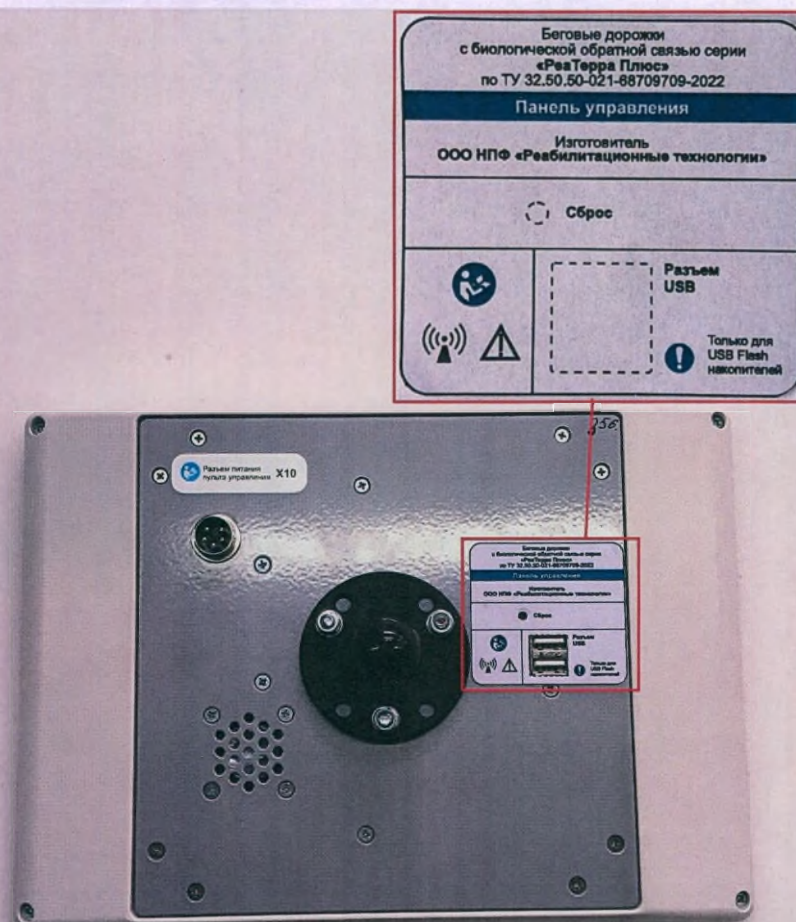

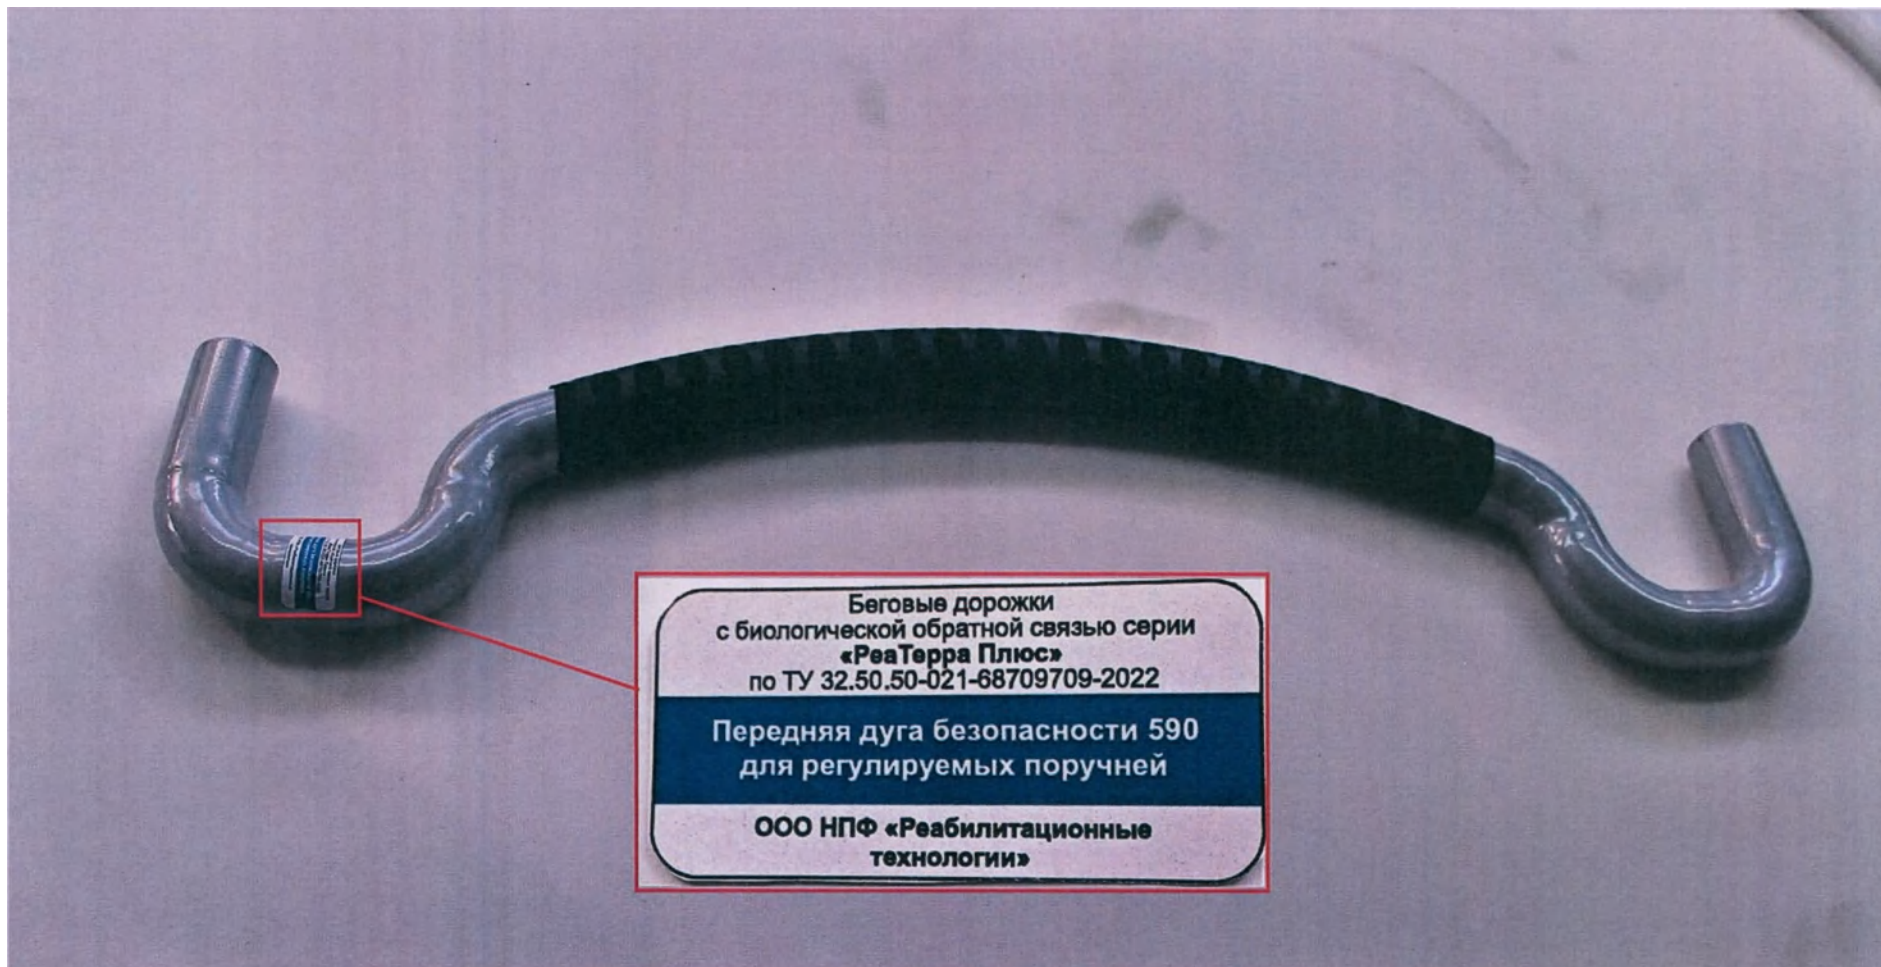





Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Передняя дуга безопасности 900
для регулируемых поручней

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»



Беговые дорожки с
биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Трос страховочный

**ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»**








Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Смазывающая жидкость
для полотна

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

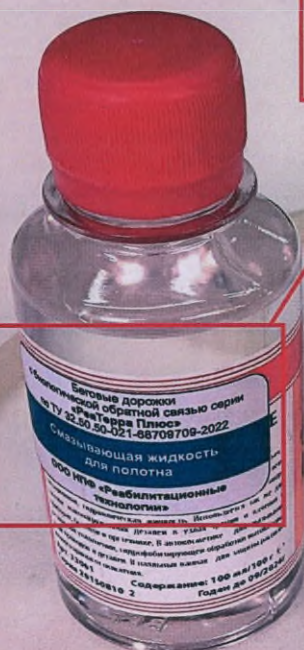

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Сиденье для
медицинского
персонала

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»



Беговые дорожки с
биологической обратной связью серии
«РеаТерра»
по ТУ 9444-009-68709709-2016

Ремень для подвеса
дополнительный


ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

Беговые дорожки с
биологической обратной связью серии
«РеаТерра»
по ТУ 9444-009-68709709-2016
Ремень для подвеса
дополнительный
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»





Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Регулируемый
поручень
Левый
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

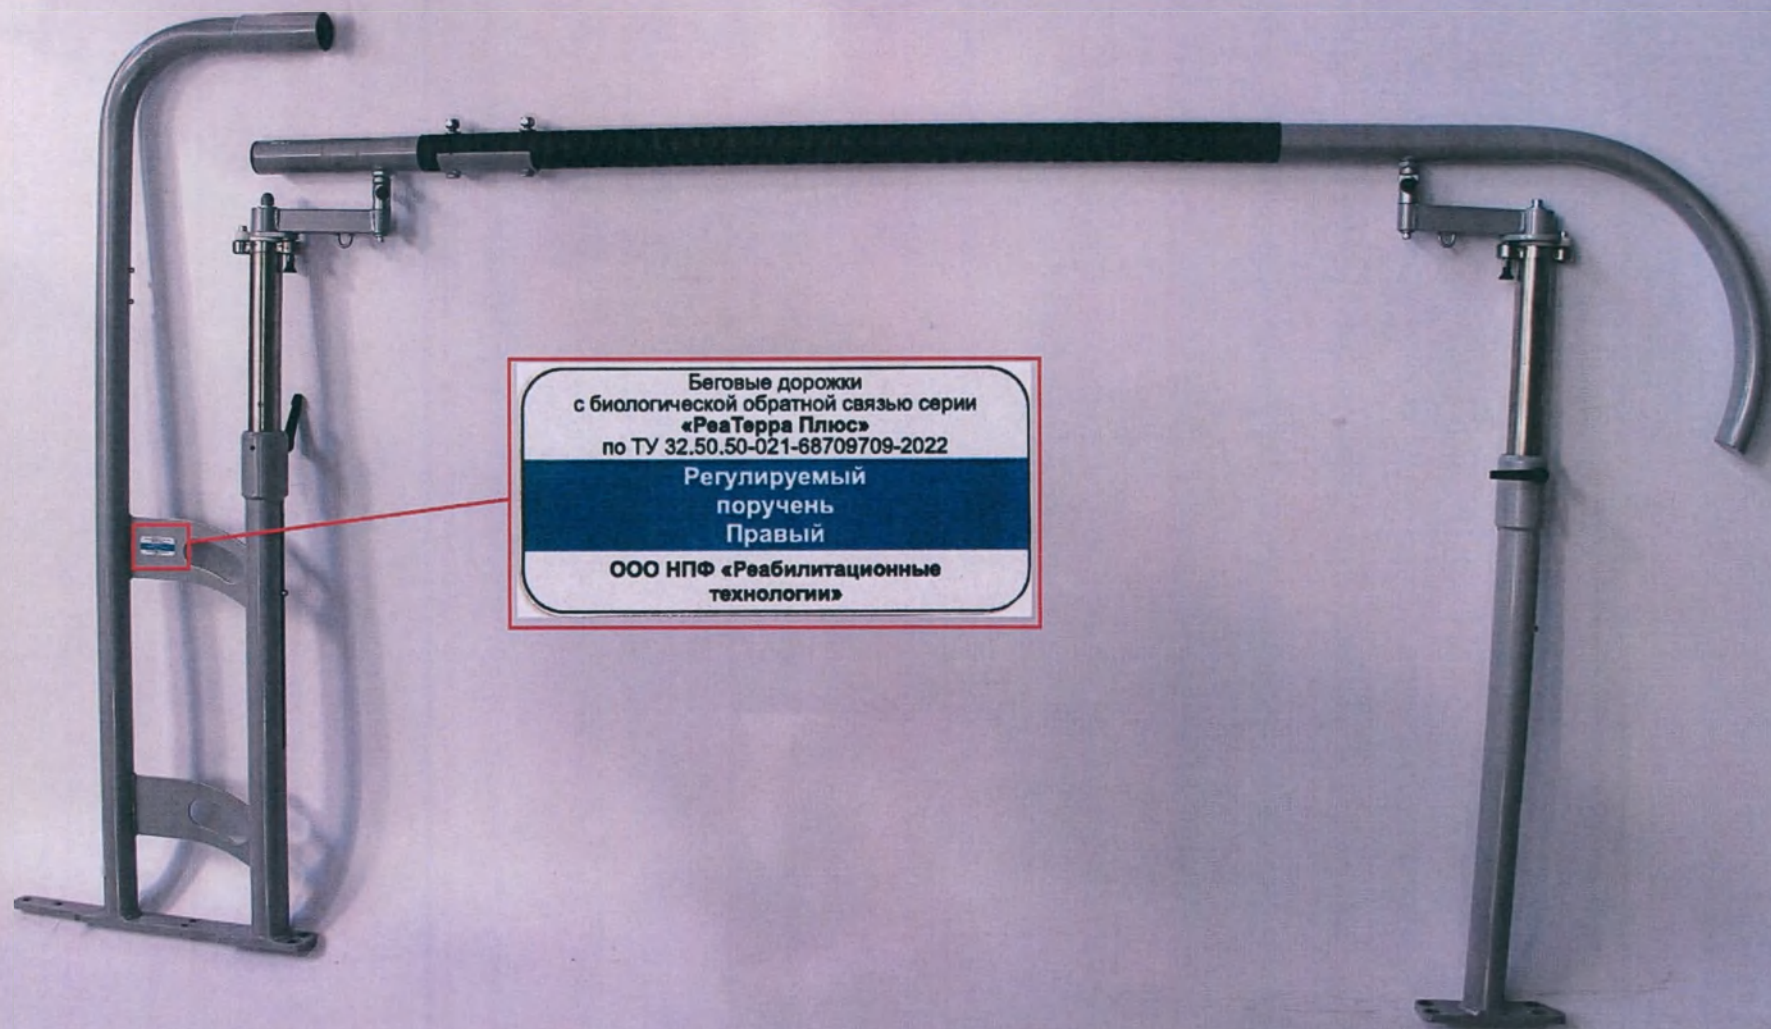

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Регулируемый
поручень
Правый

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»





Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Регулируемый
малый поручень с кронштейном
Правый

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68708709-2022
Регулируемый
малый поручень
Левый
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»






Беговые дорожки с
биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022


Пульт управления
8кн.

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

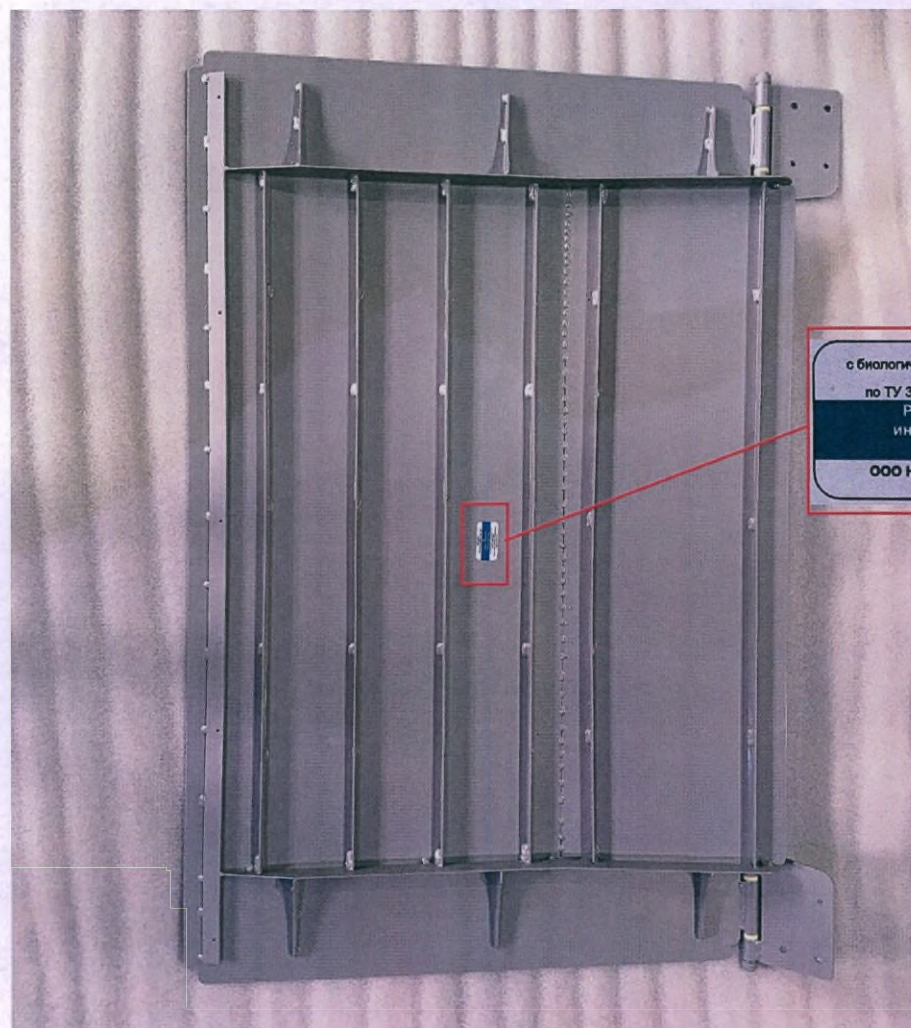


Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Рампа для въезда
инвалидной коляски
590
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»



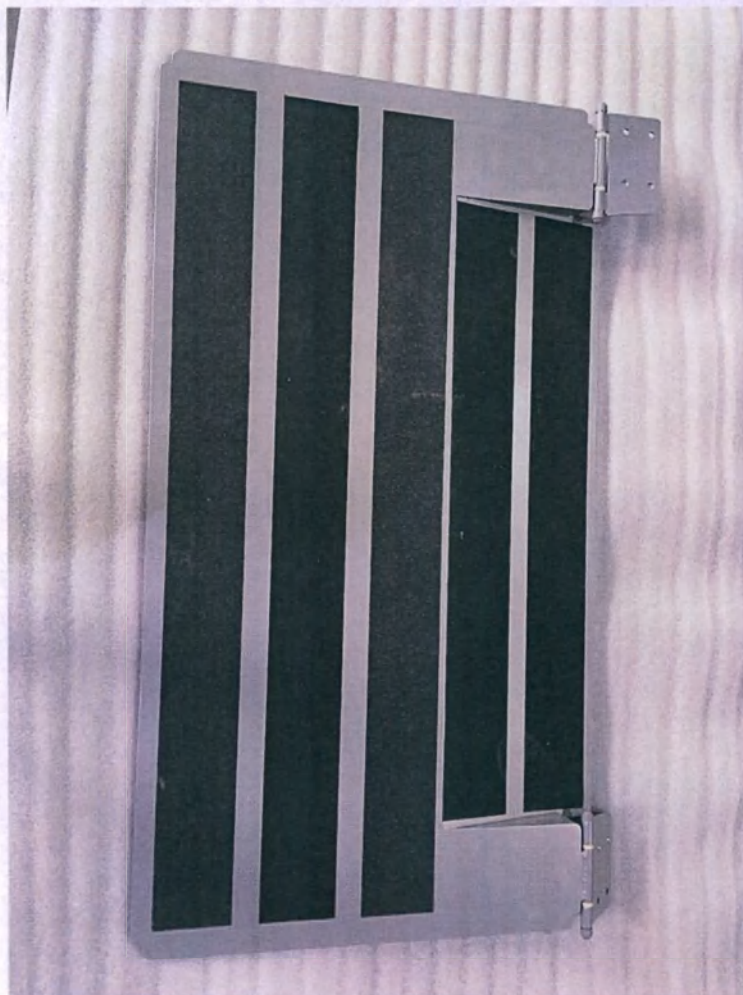


Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Рампа для въезда
инвалидной коляски
900
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

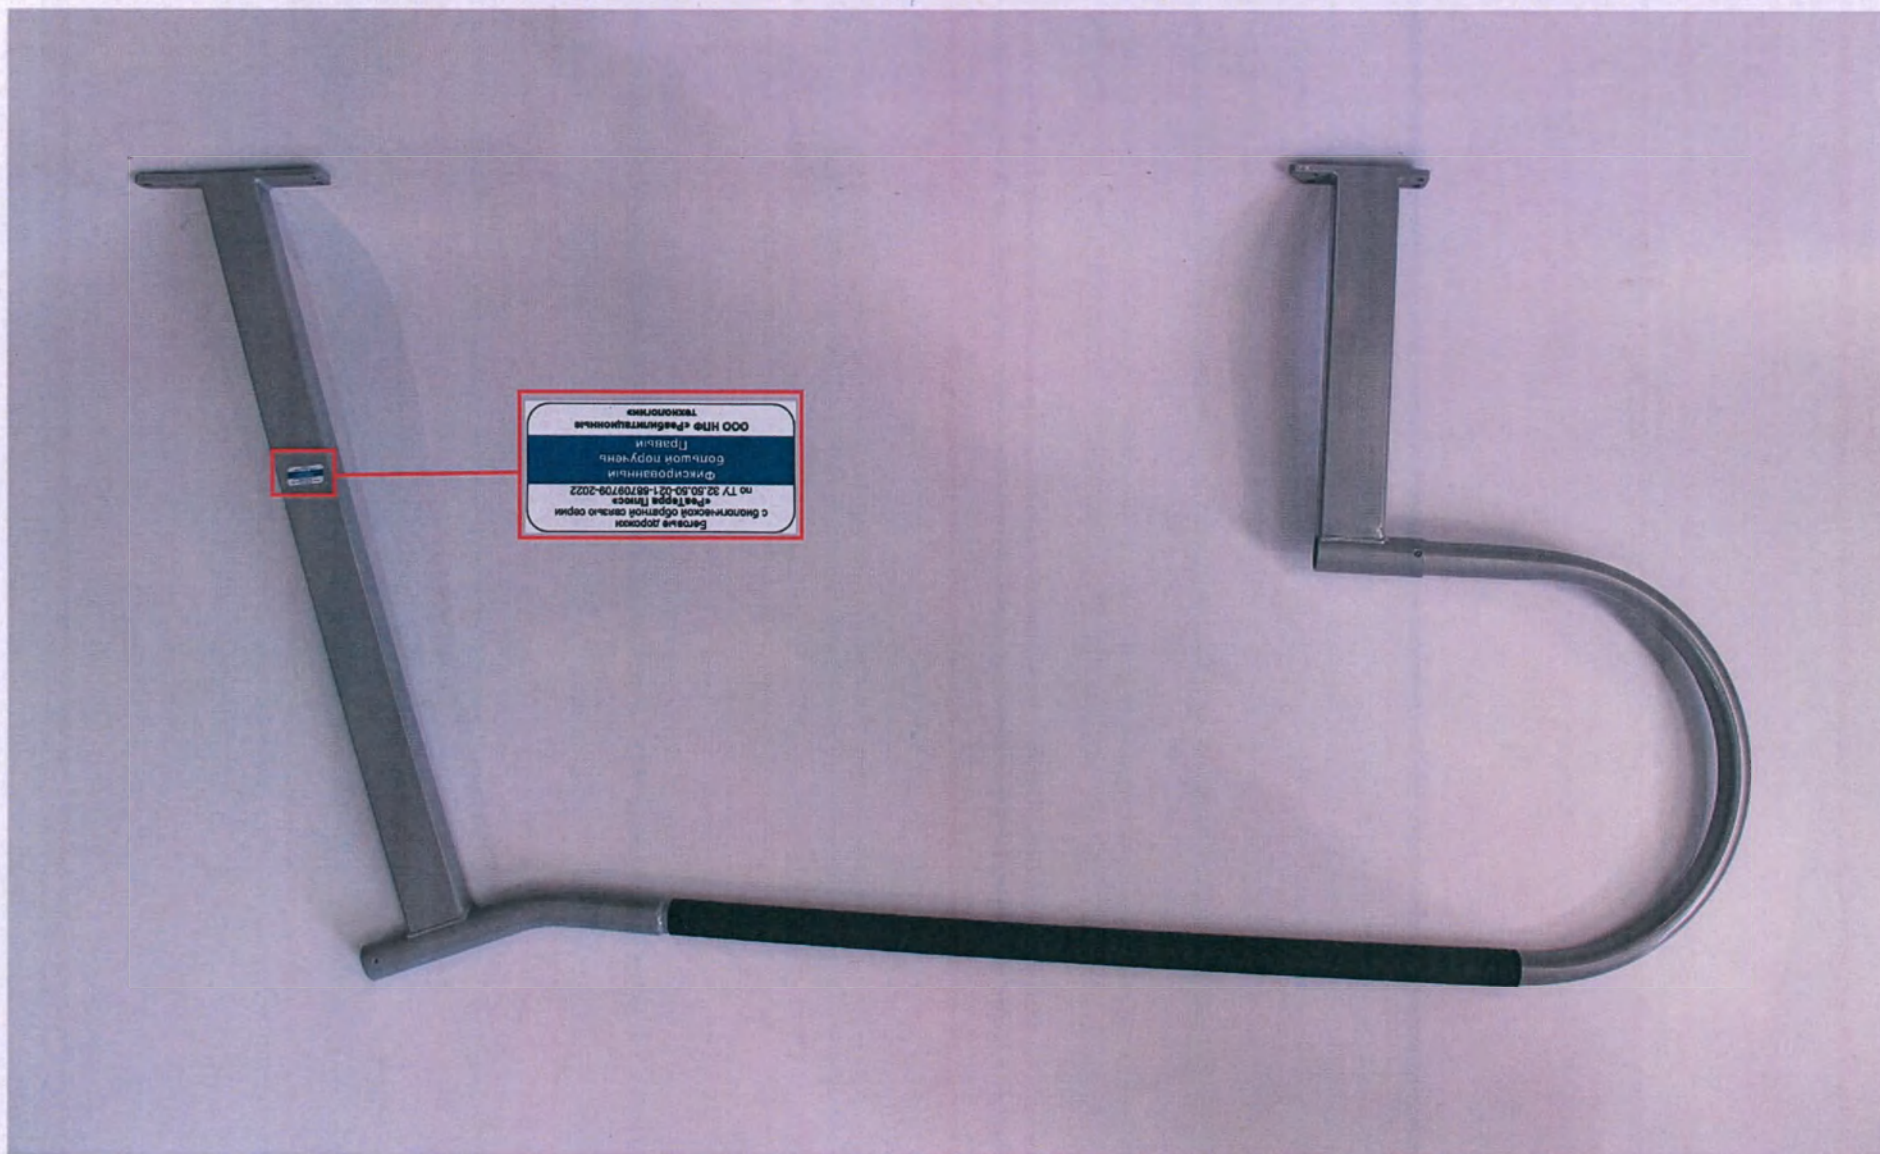



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022
Фиксированный
большой поручень с кронштейном
Правый
ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»




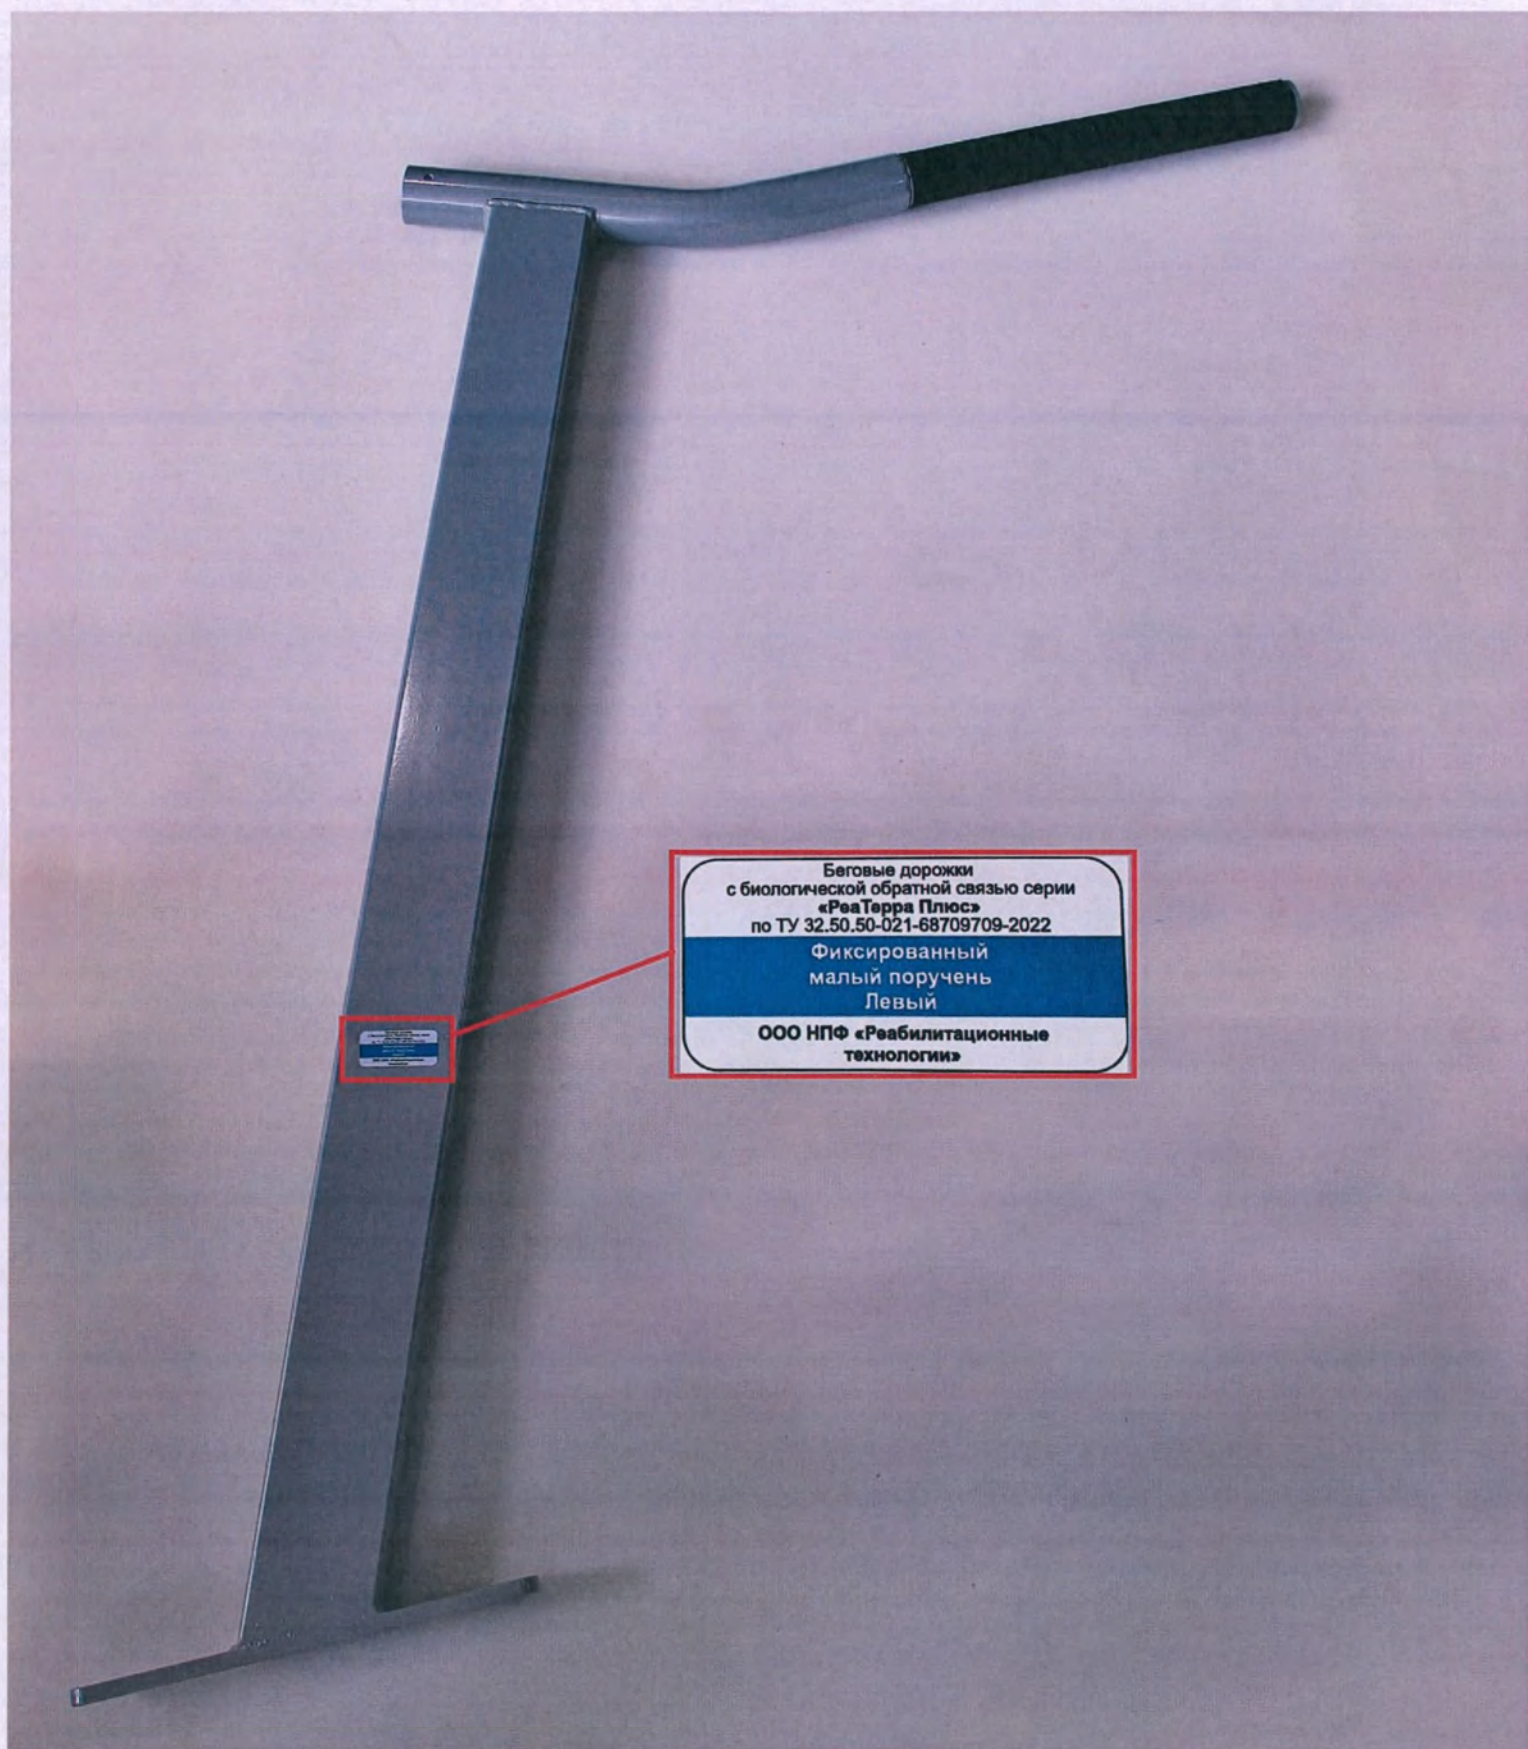

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Фиксированный
малый поручень
Левый

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»

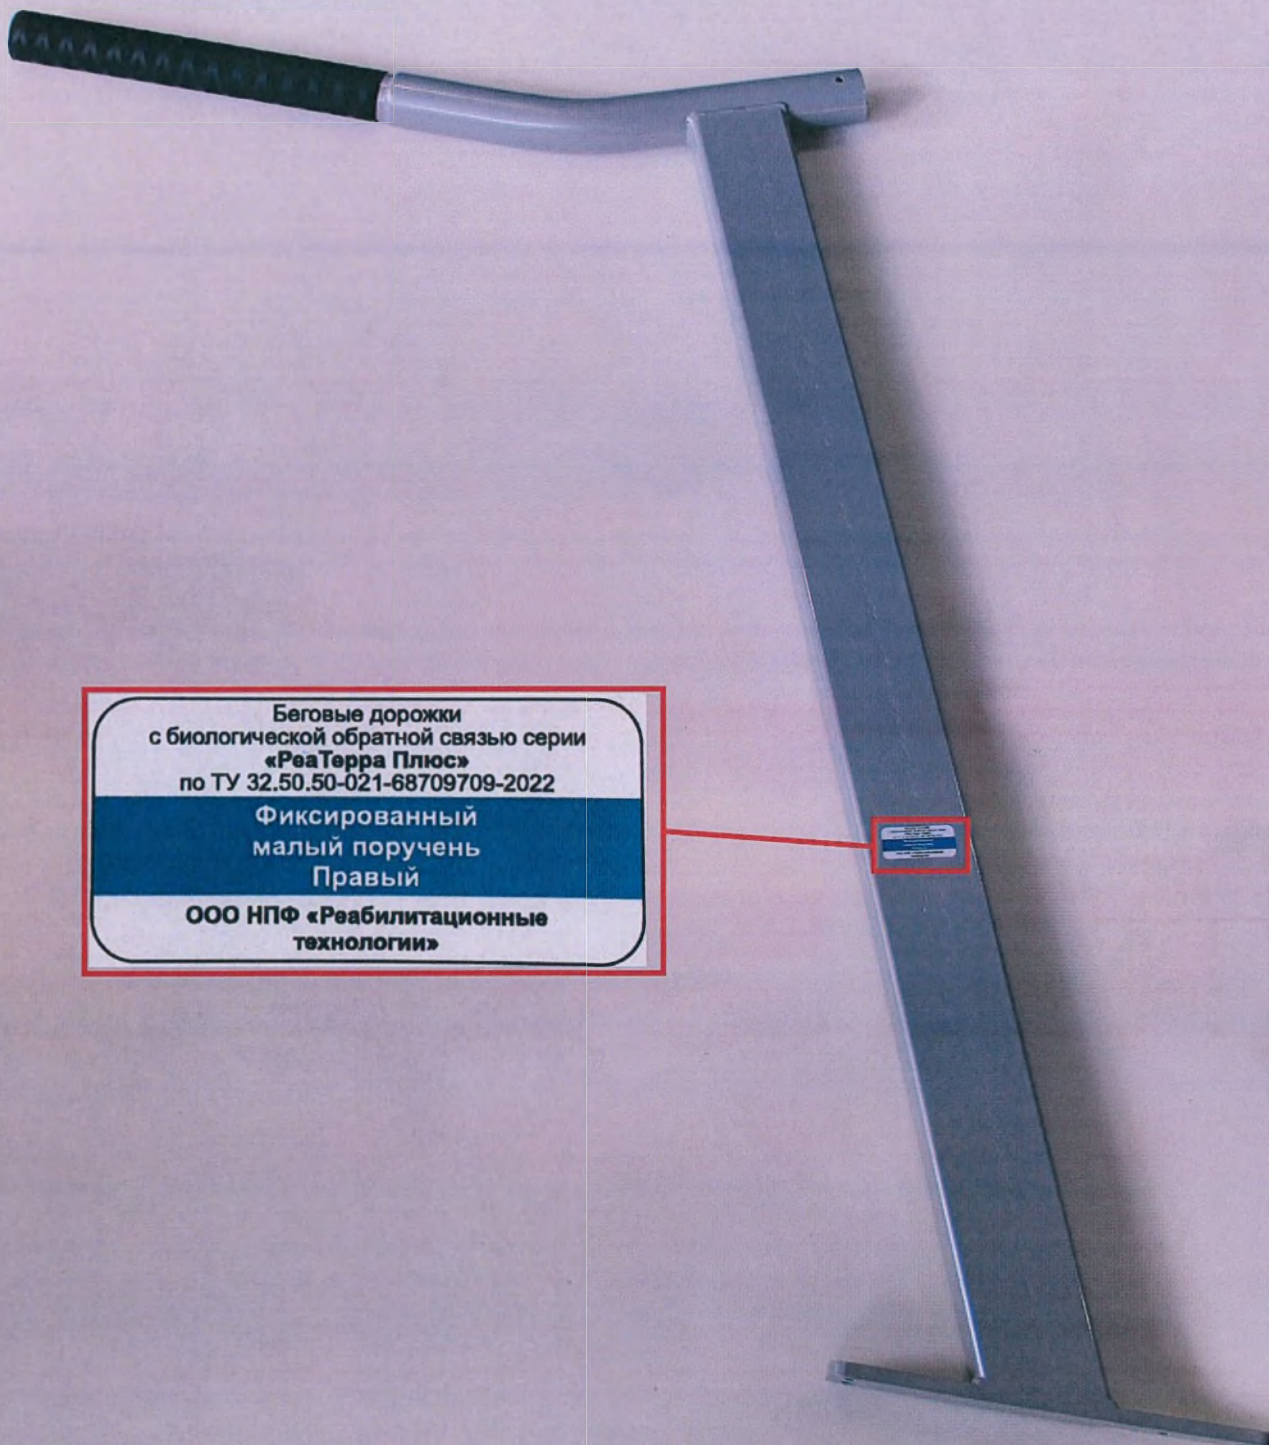


Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Фиксированный
малый поручень
Правый

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»



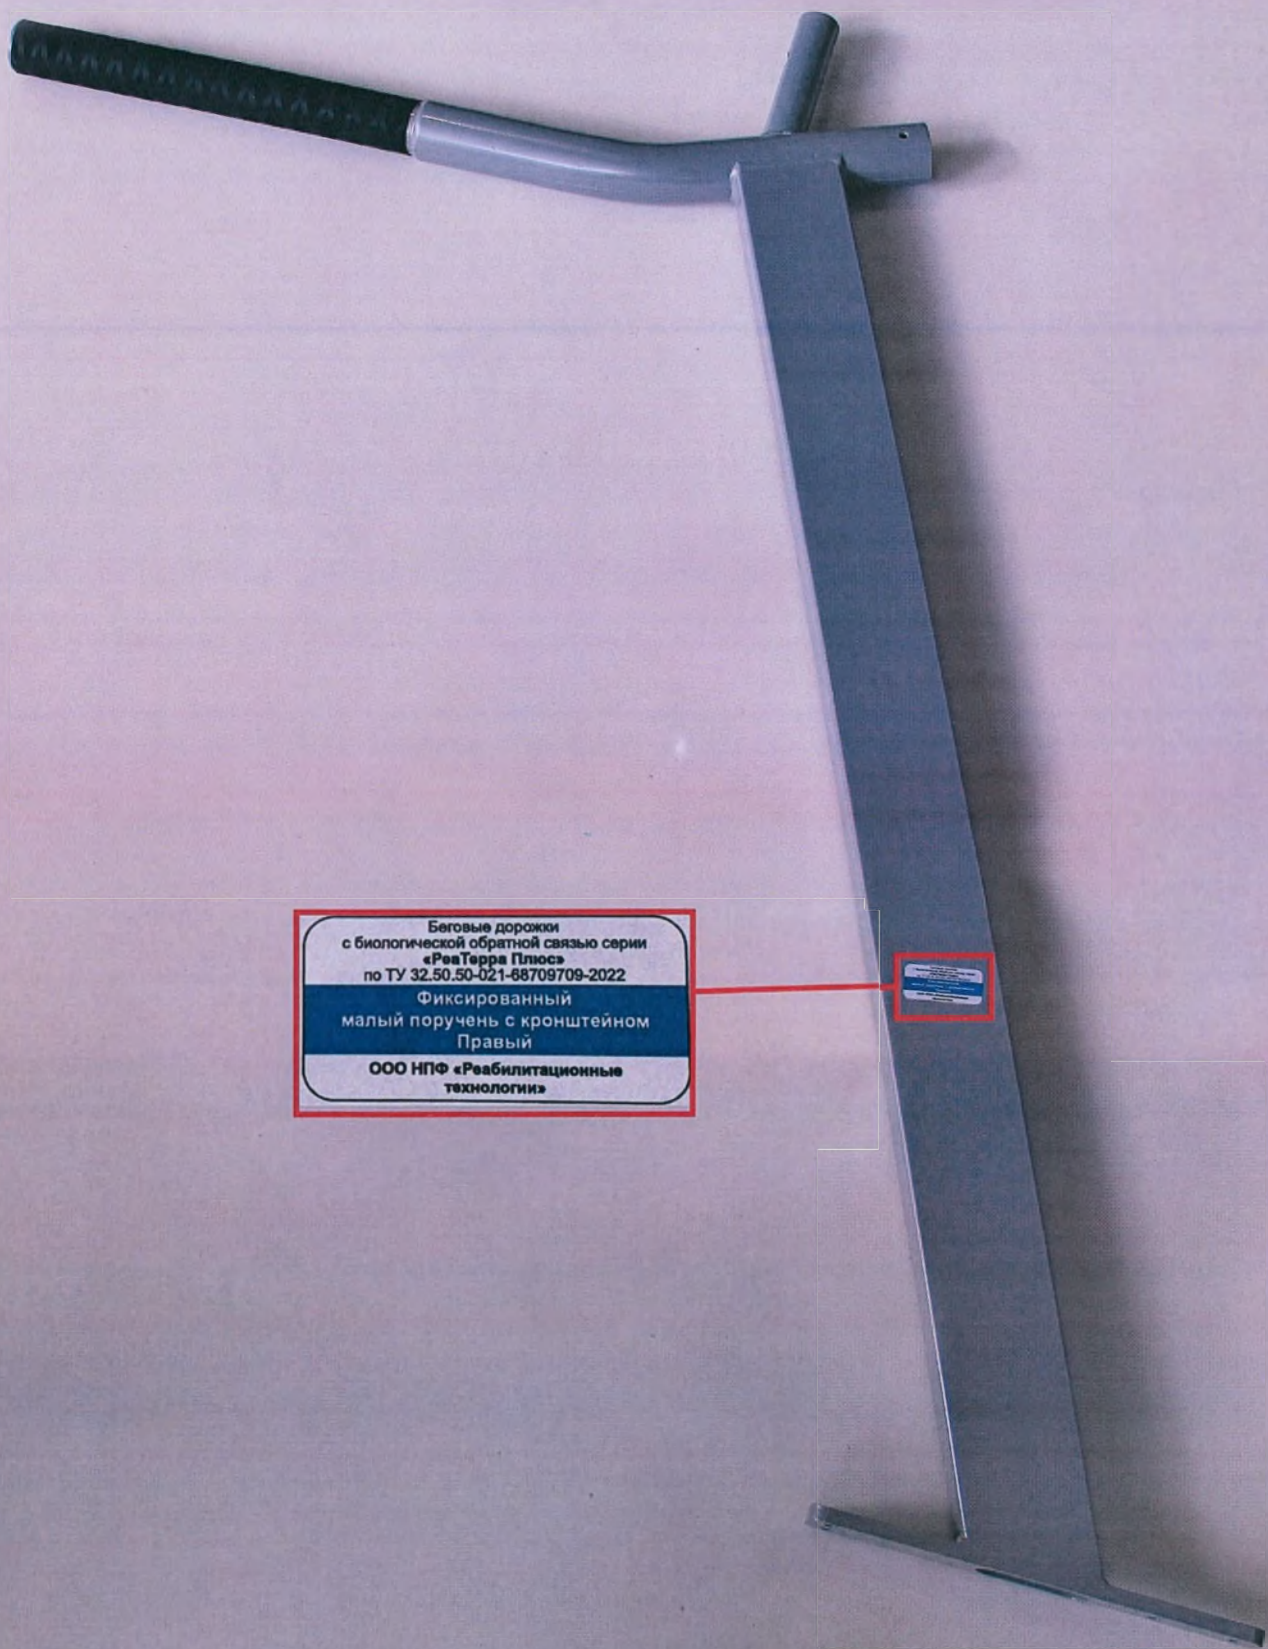

Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РесТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Фиксированный
малый поручень с кронштейном
Правый

ООО НПФ «Реабилитационные
технологии»



Беговые дорожки
с биологической обратной связью серии
«РеаТерра Плюс»
по ТУ 32.50.50-021-68709709-2022

Трансформатор разделительный 2.5 кВА

При работе необходимо обеспечить свободный
доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

Изготовитель
ООО НПФ «Реабилитационные технологии»




1

2

3

4

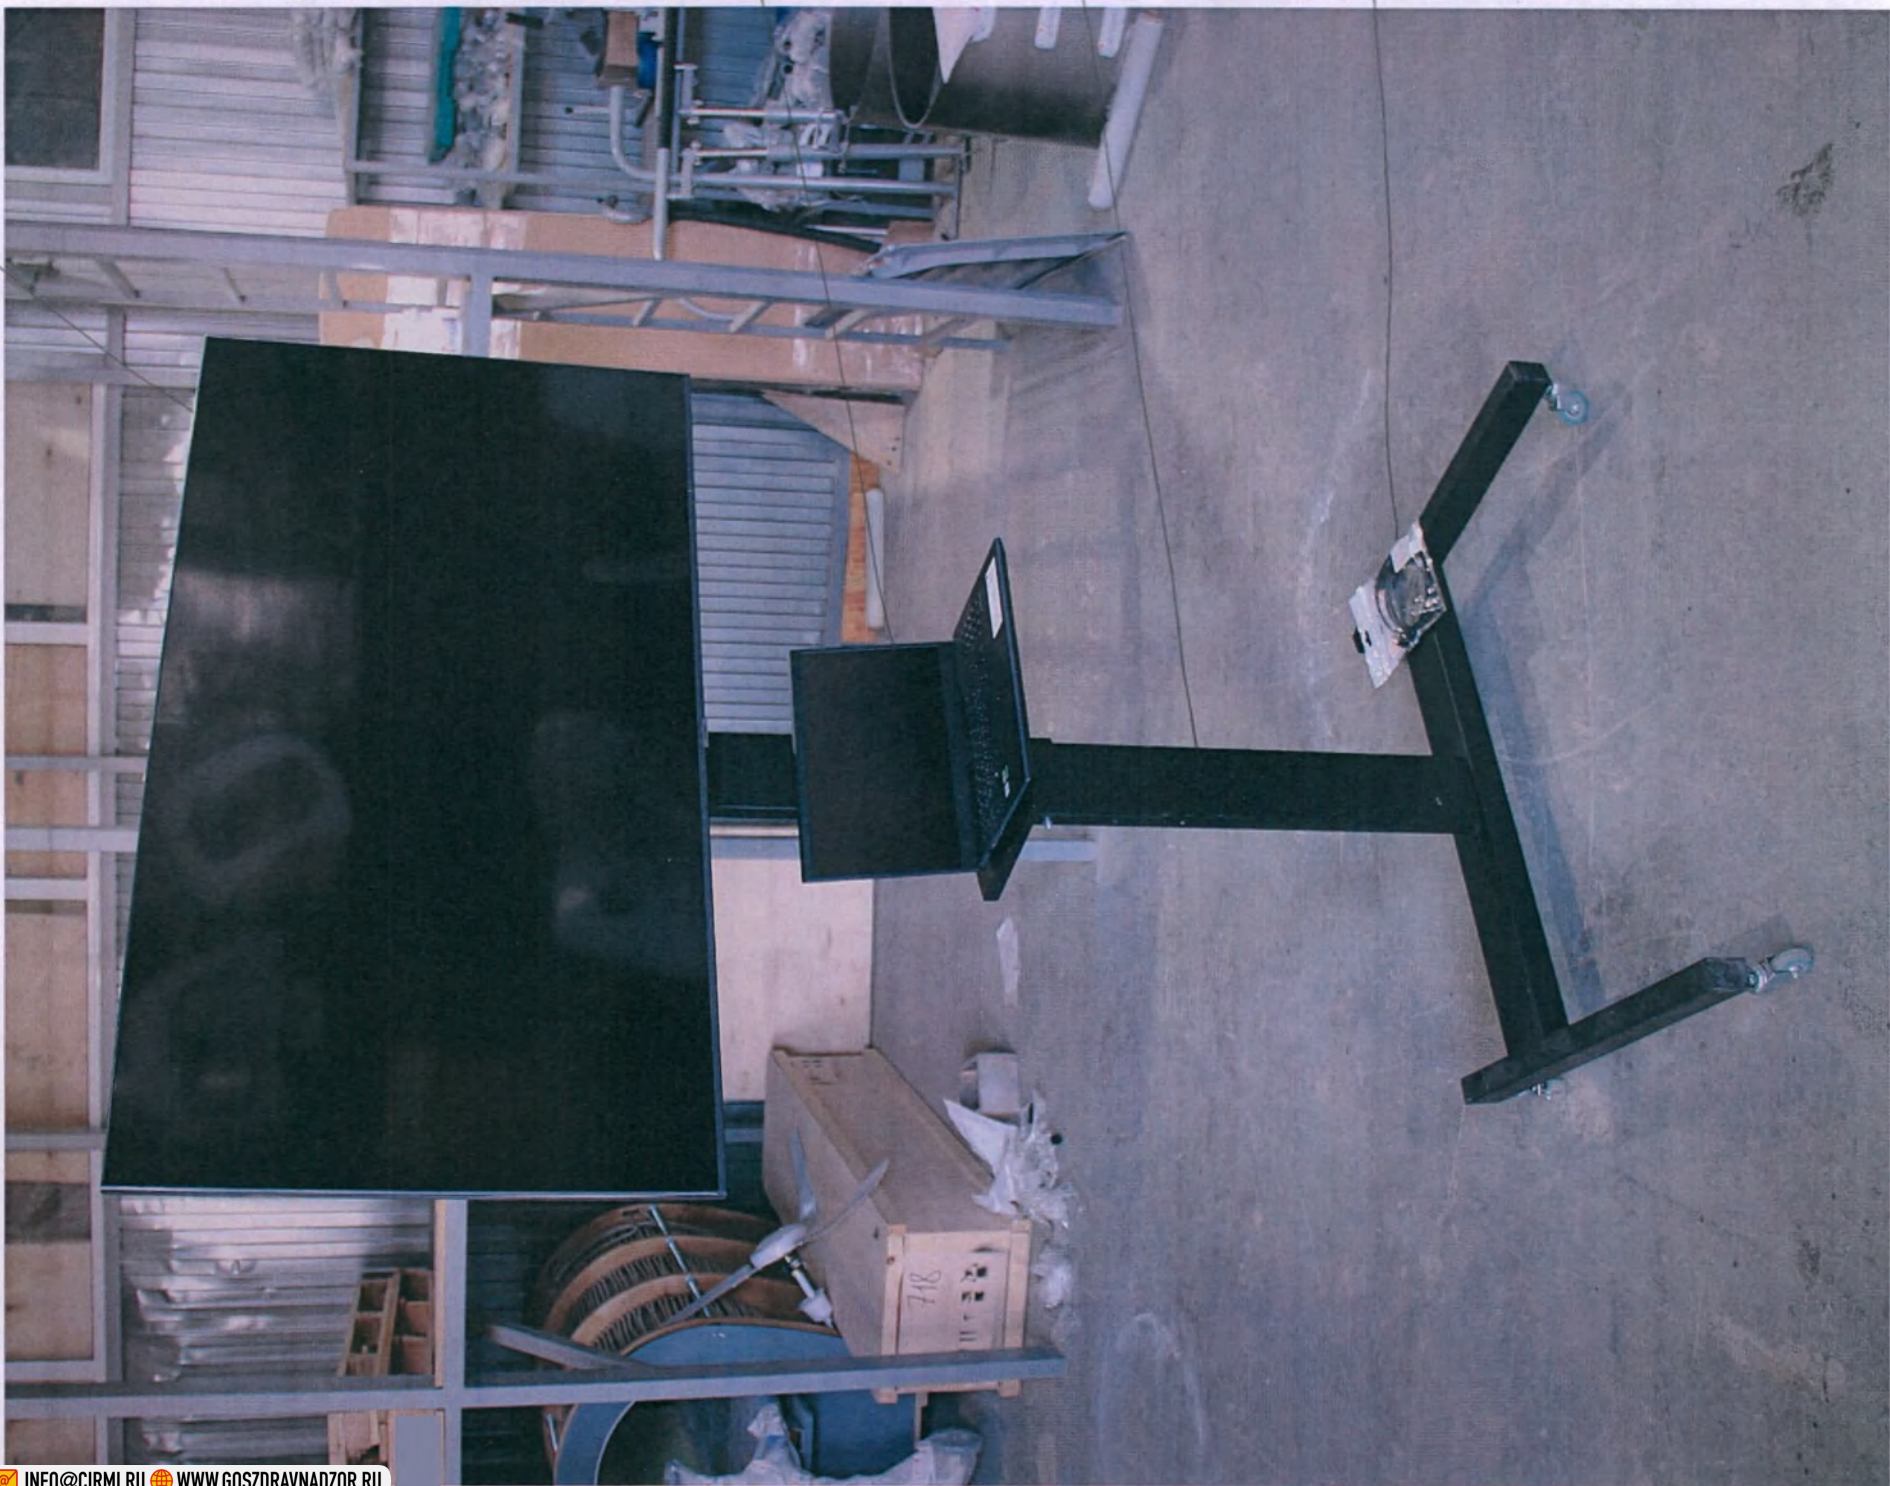


Специализированная "Служба"

Объем ВЧД

1. Требуемое (43" или 55")
2. Программный компьютер
3. Аппаратная часть на основе
4. Карты NVIDIA



 Система визуализации «МАДИС»
по ТУ 26.20.14-012-68709709-2019
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
Заводской номер: 

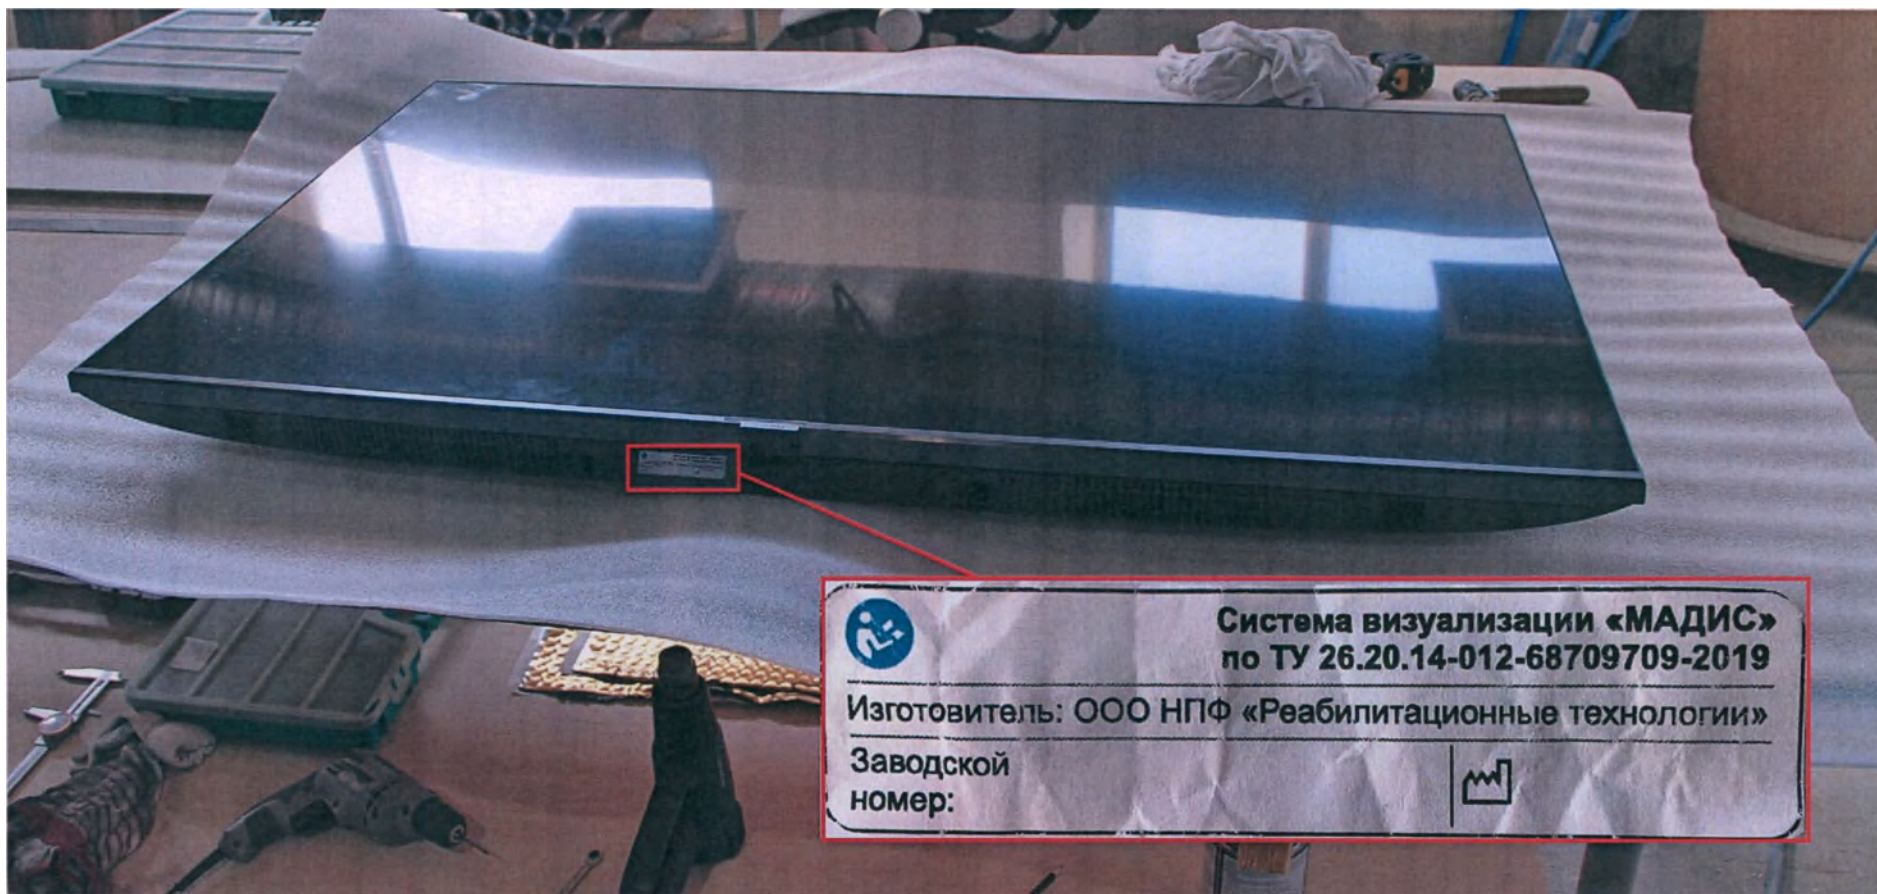


**Система визуализации «МАДИС»
по ТУ 26.20.14-012-68709709-2019**

Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

**Заводской
номер:**



Товаров 55 "

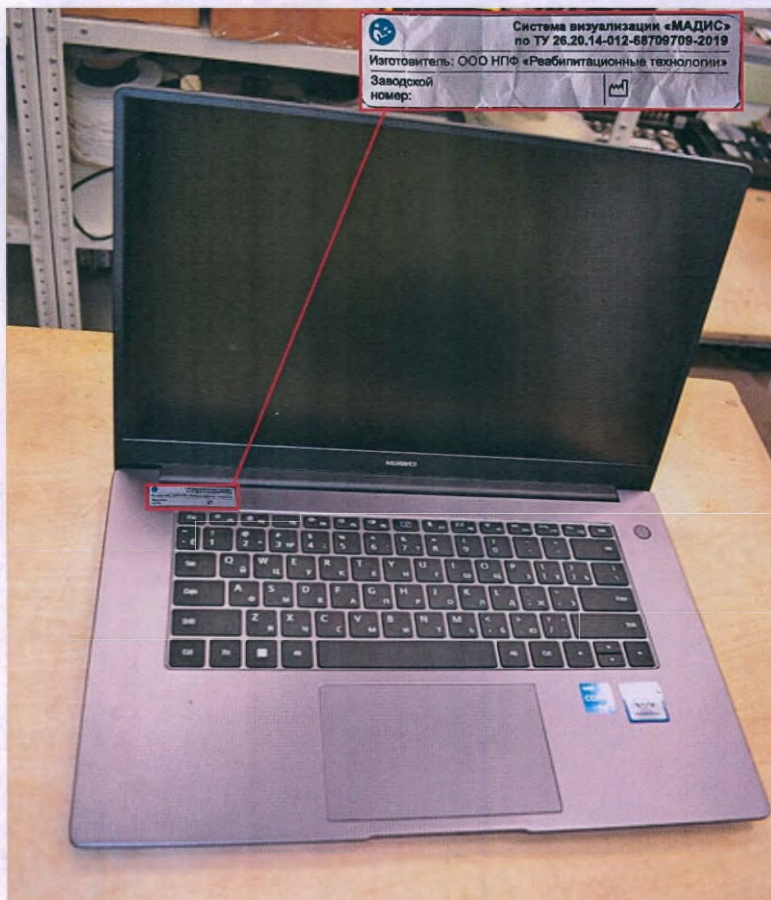

Нормативный, компания



 Система визуализации «МАДИС»
по ТУ 26.20.14-012-68709709-2019
Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
Заводской номер: 

Директор ООО «НПФ
Реабилитационные технологии»
Емельянов А.В.



прочито, пронумеровано, скреплено
печатью 64 лист(ов)

Стойка напольная на колесах