



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Урологические прокладки по ND 961900,
следующих размеров**

ООО «Онтэкс РУ»

РОССИЯ, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
Тел.: +7 495 646 92 21
ОГРН 1055008702649, ИНН 5044046964
Zemlyanoy Val St., 9, Moscow, Russian Federation, 105064

Ontex RU LLC

Member of the Ontex Group

Фото 1 – Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Ultra.

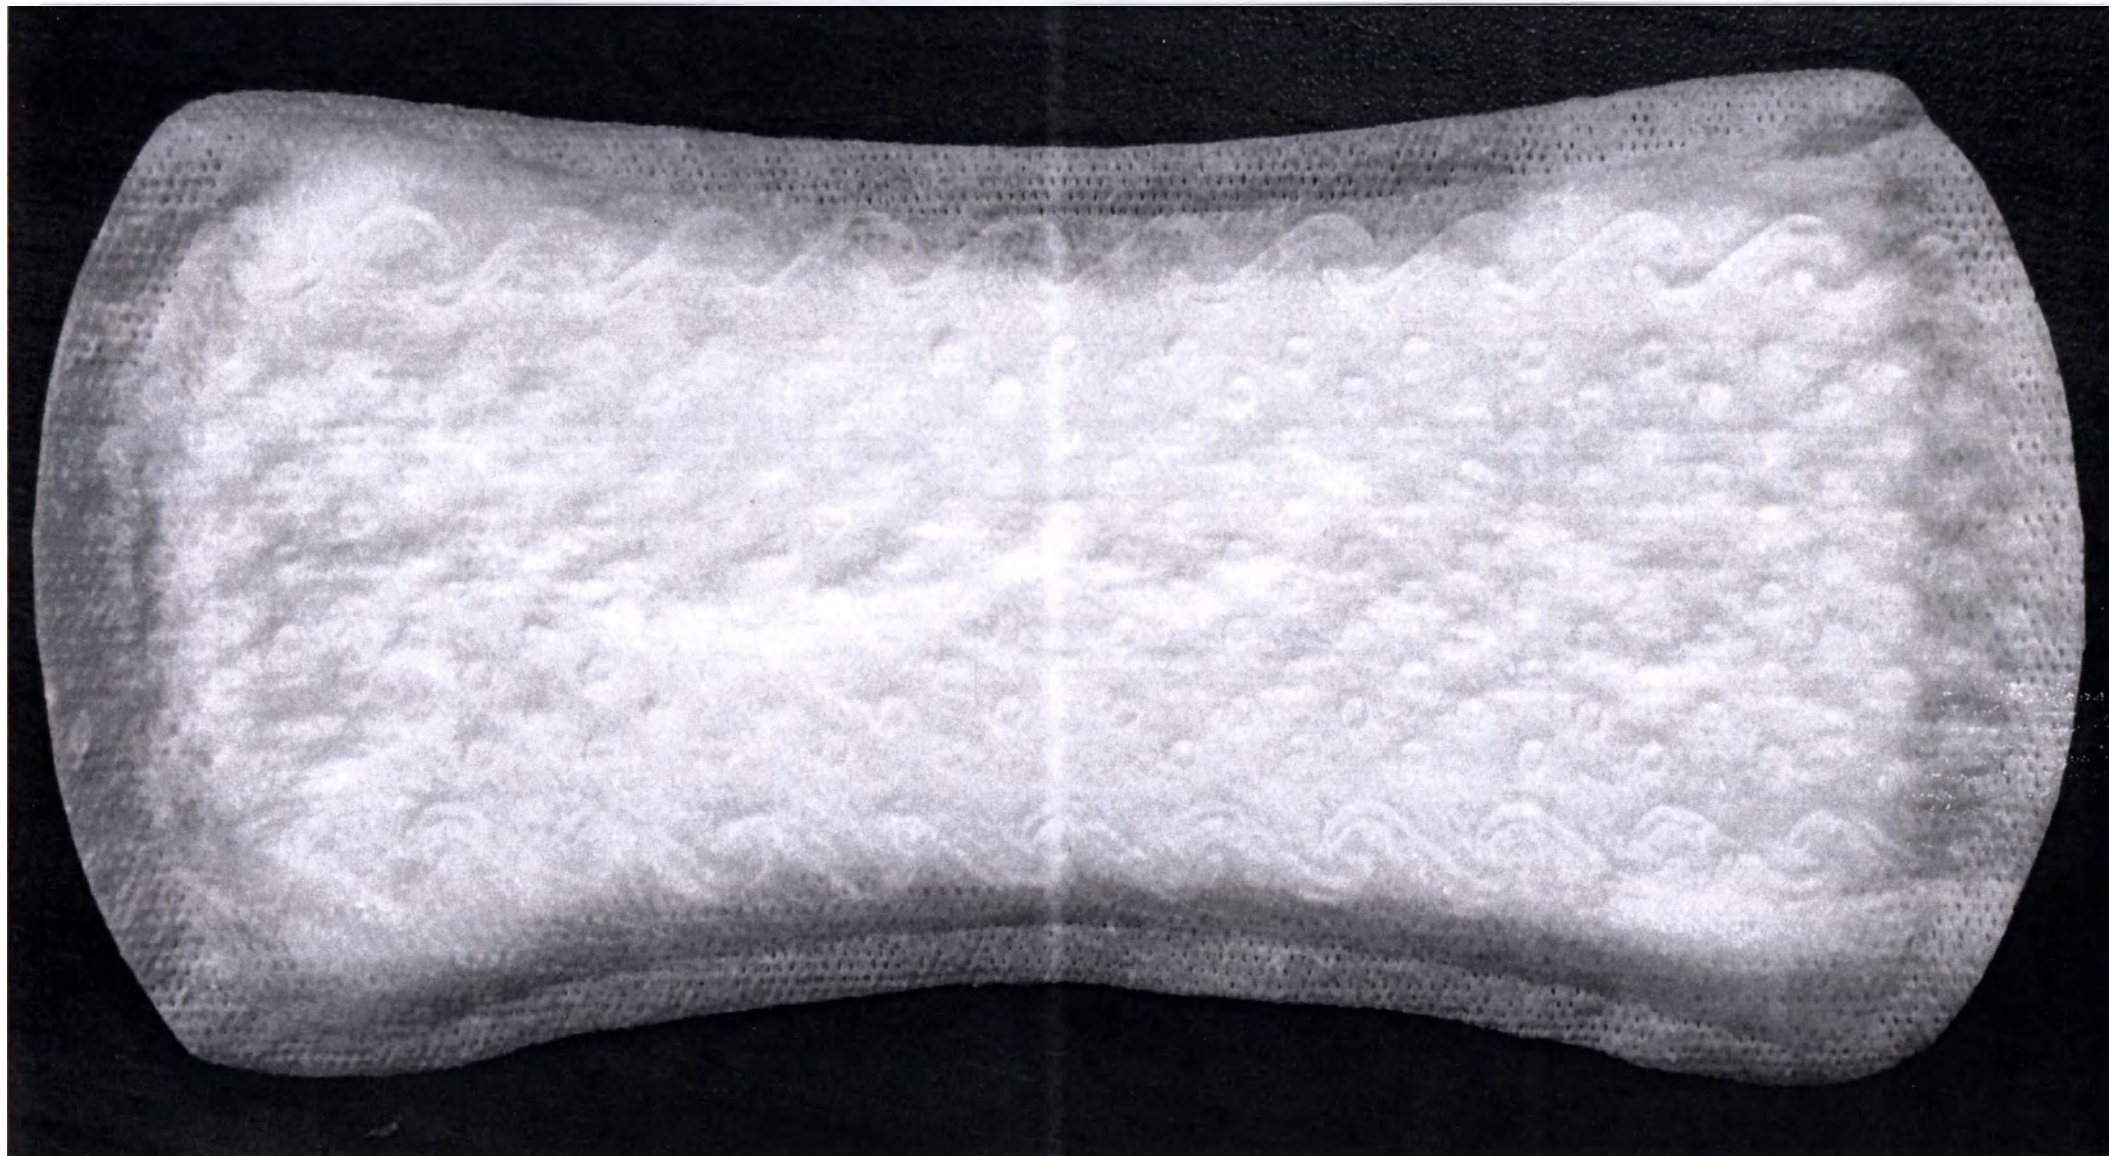


Фото 2 - Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Mini

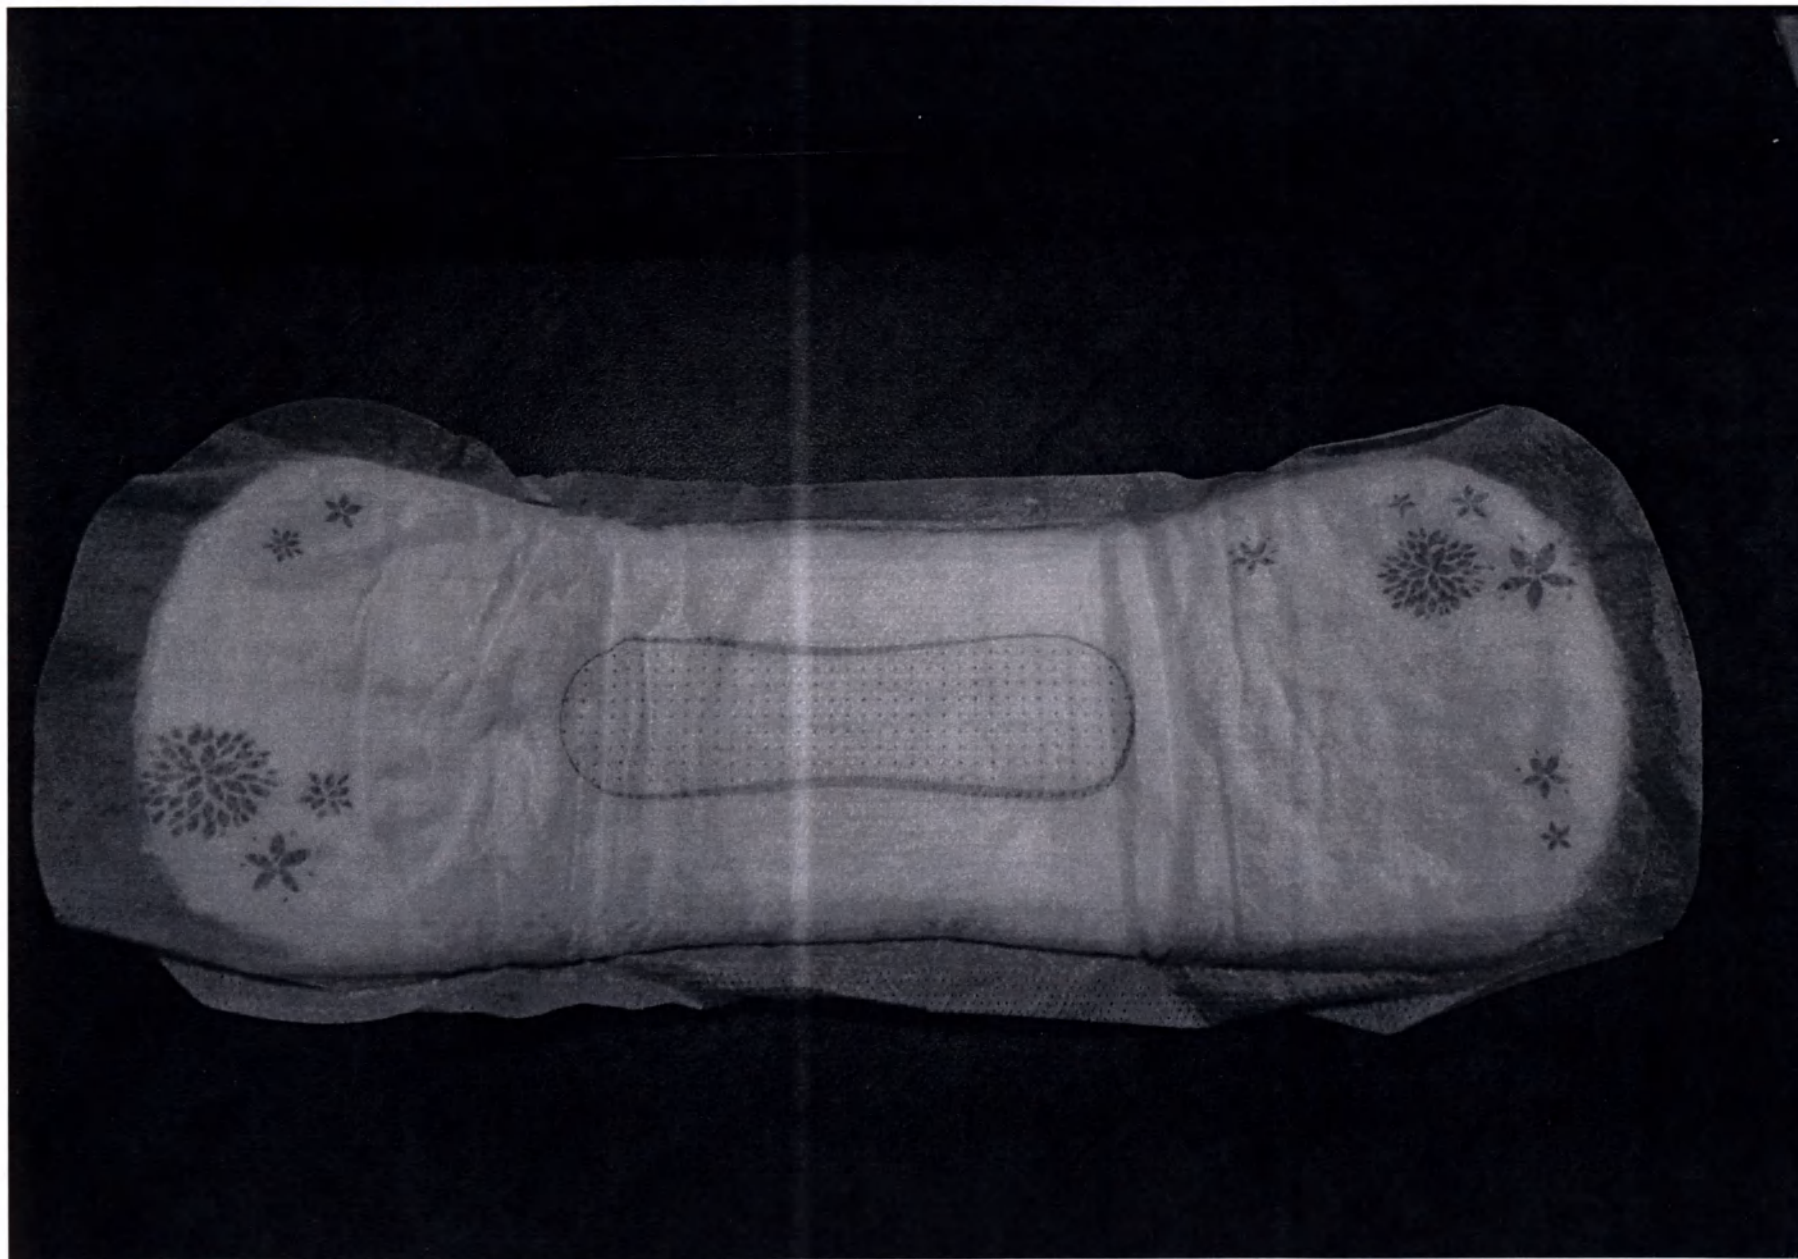


Фото 3 - Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Normal

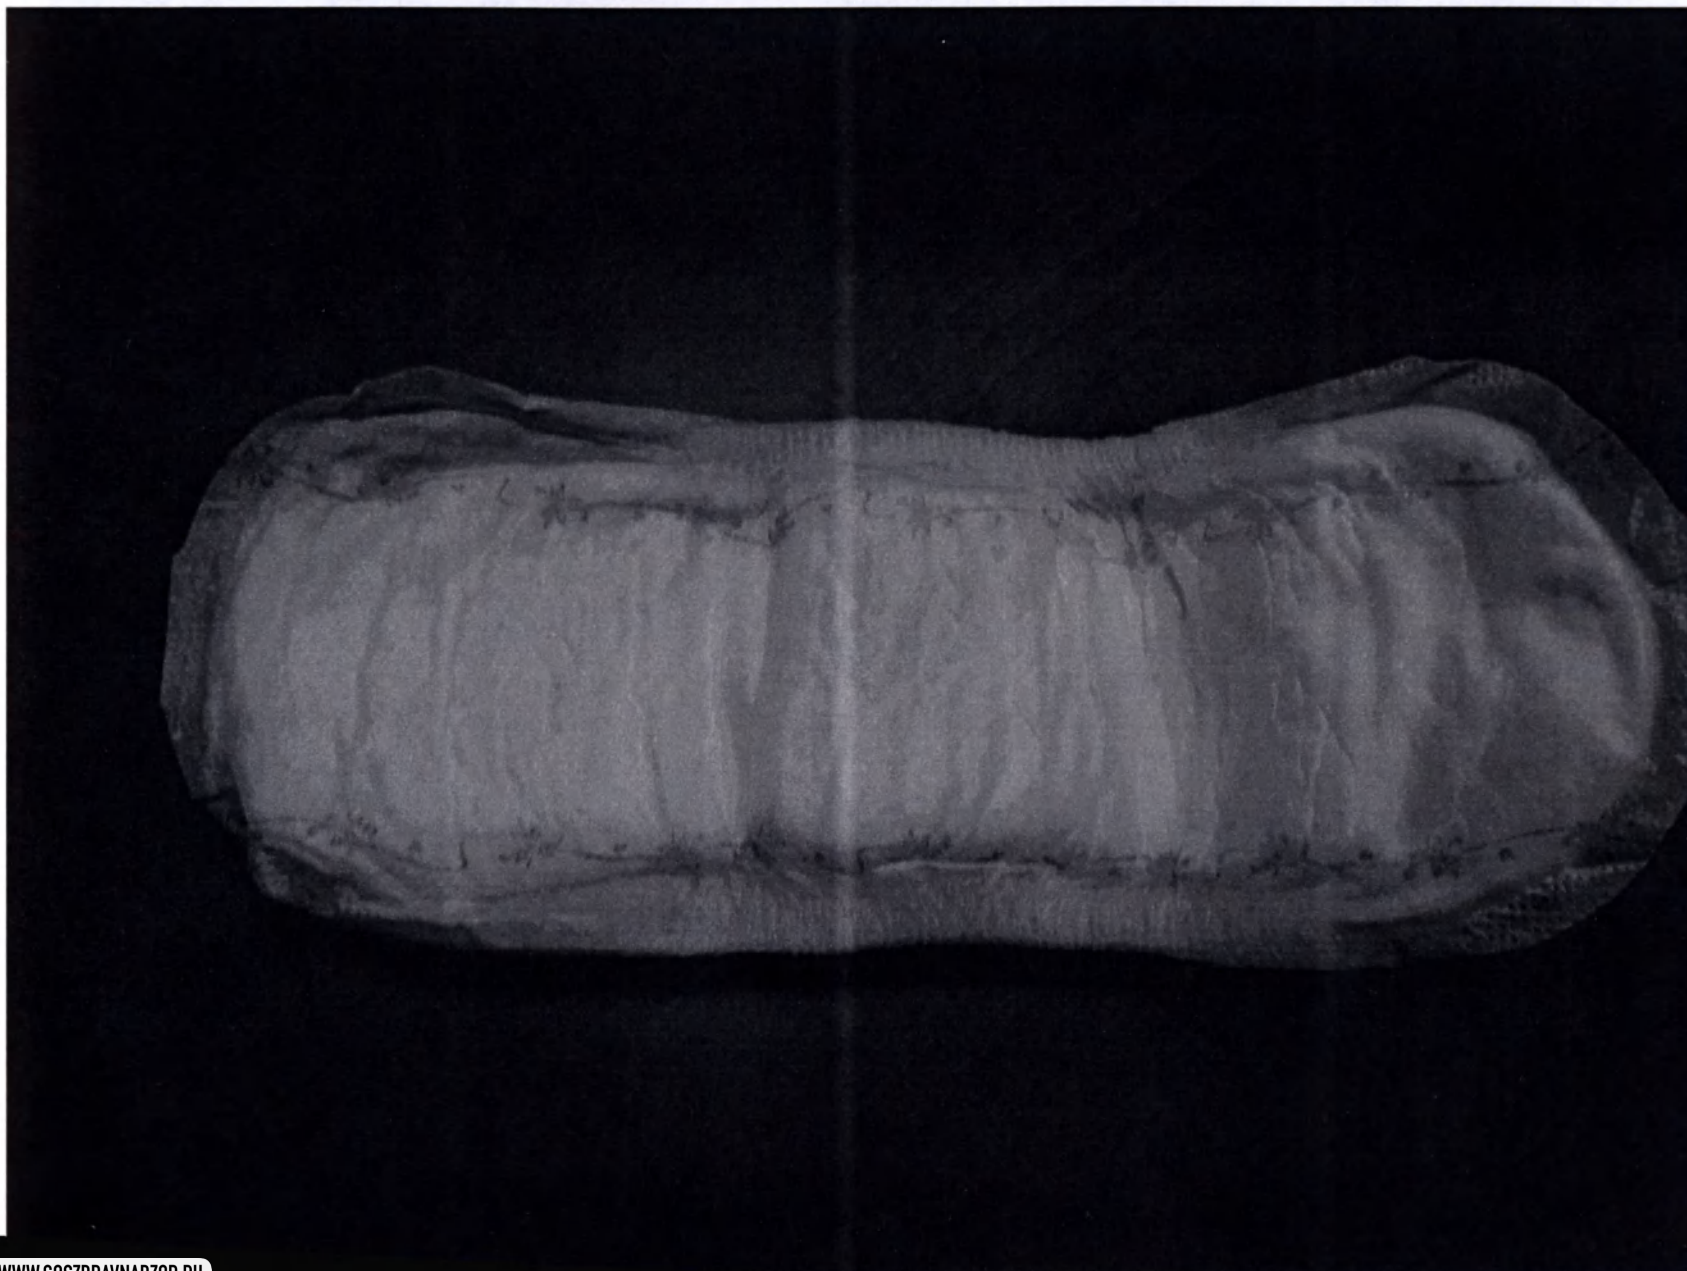


Фото 4 - Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Extra

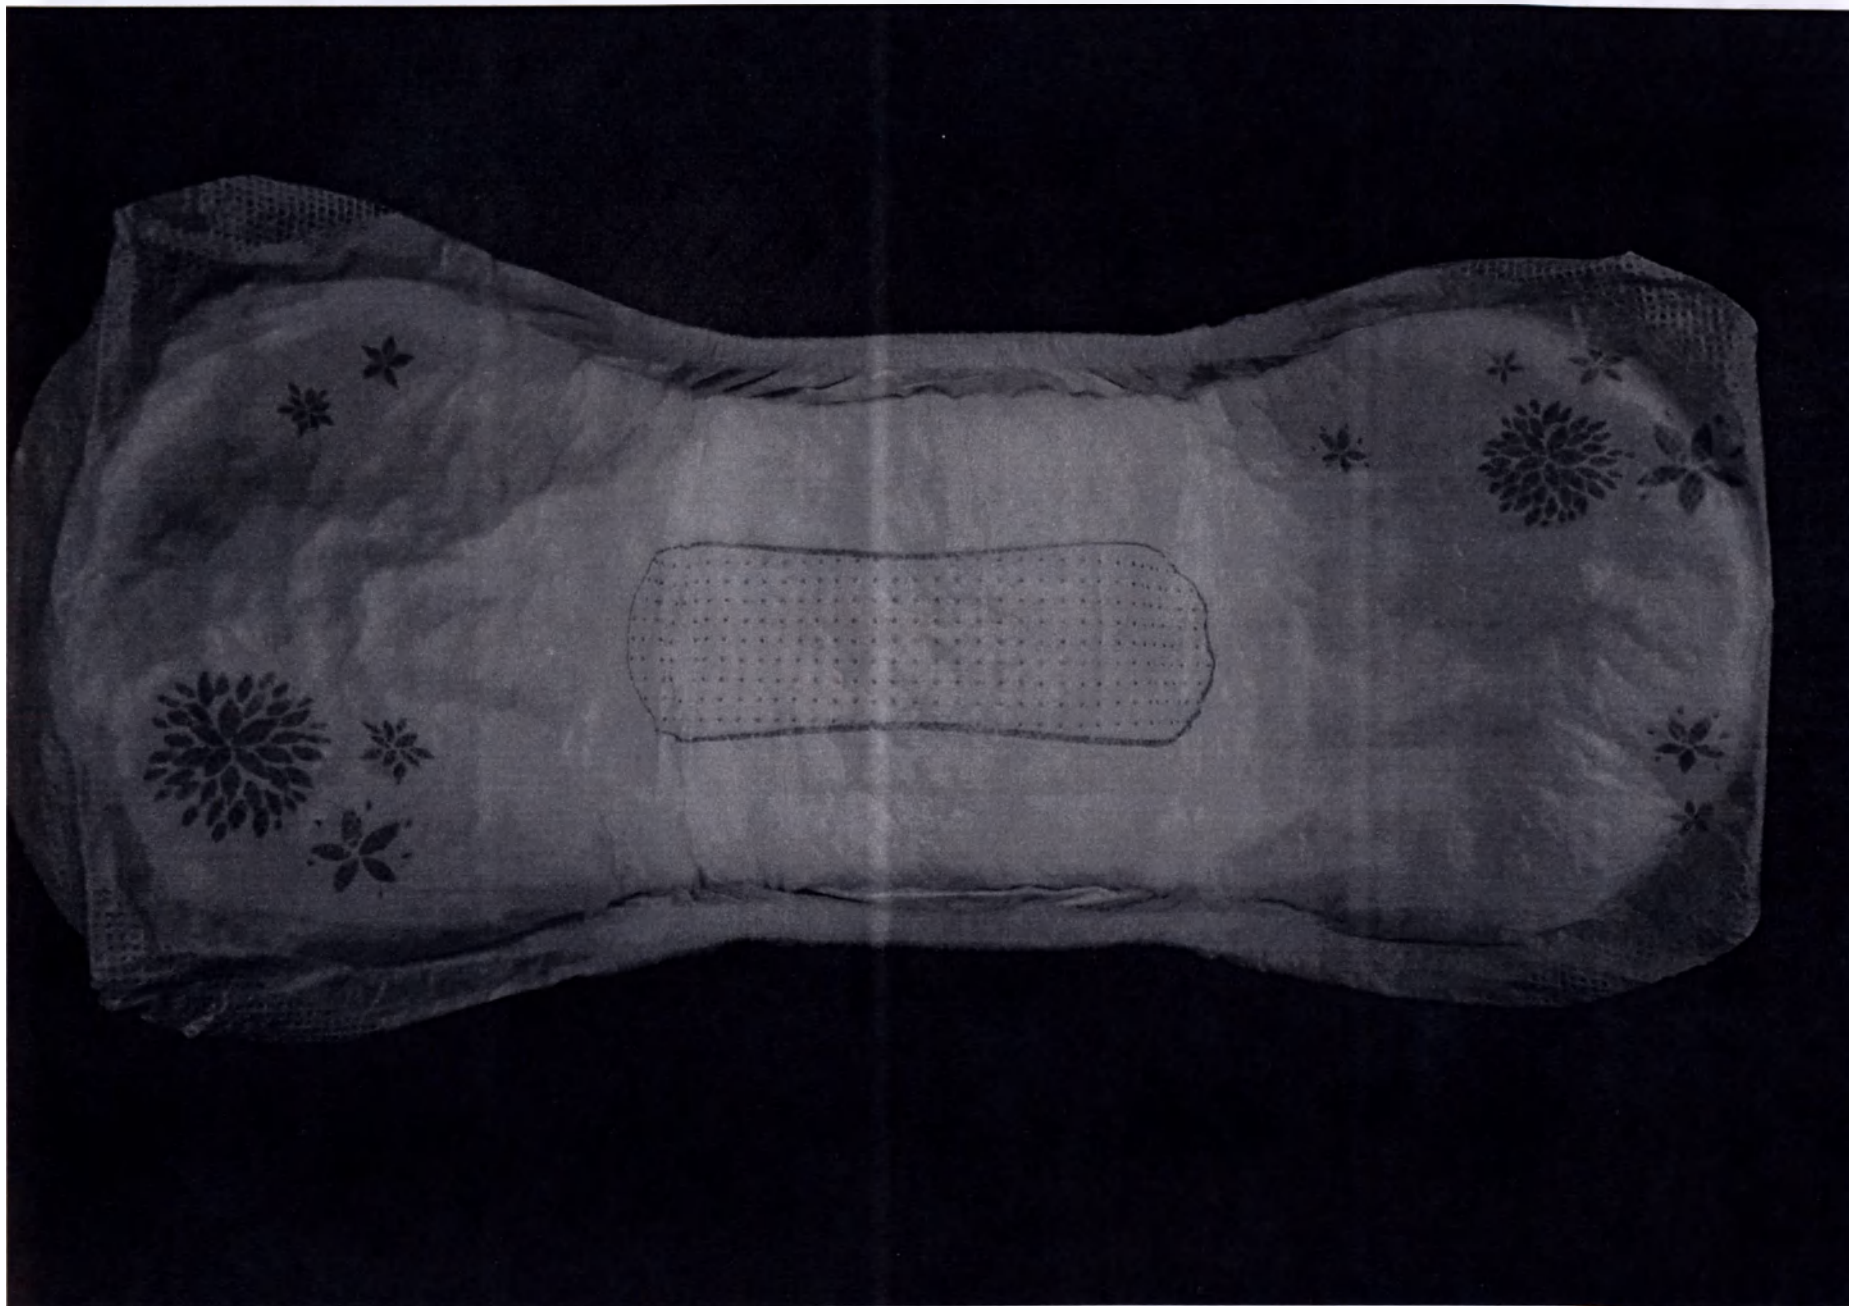


Фото 5 – Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Super

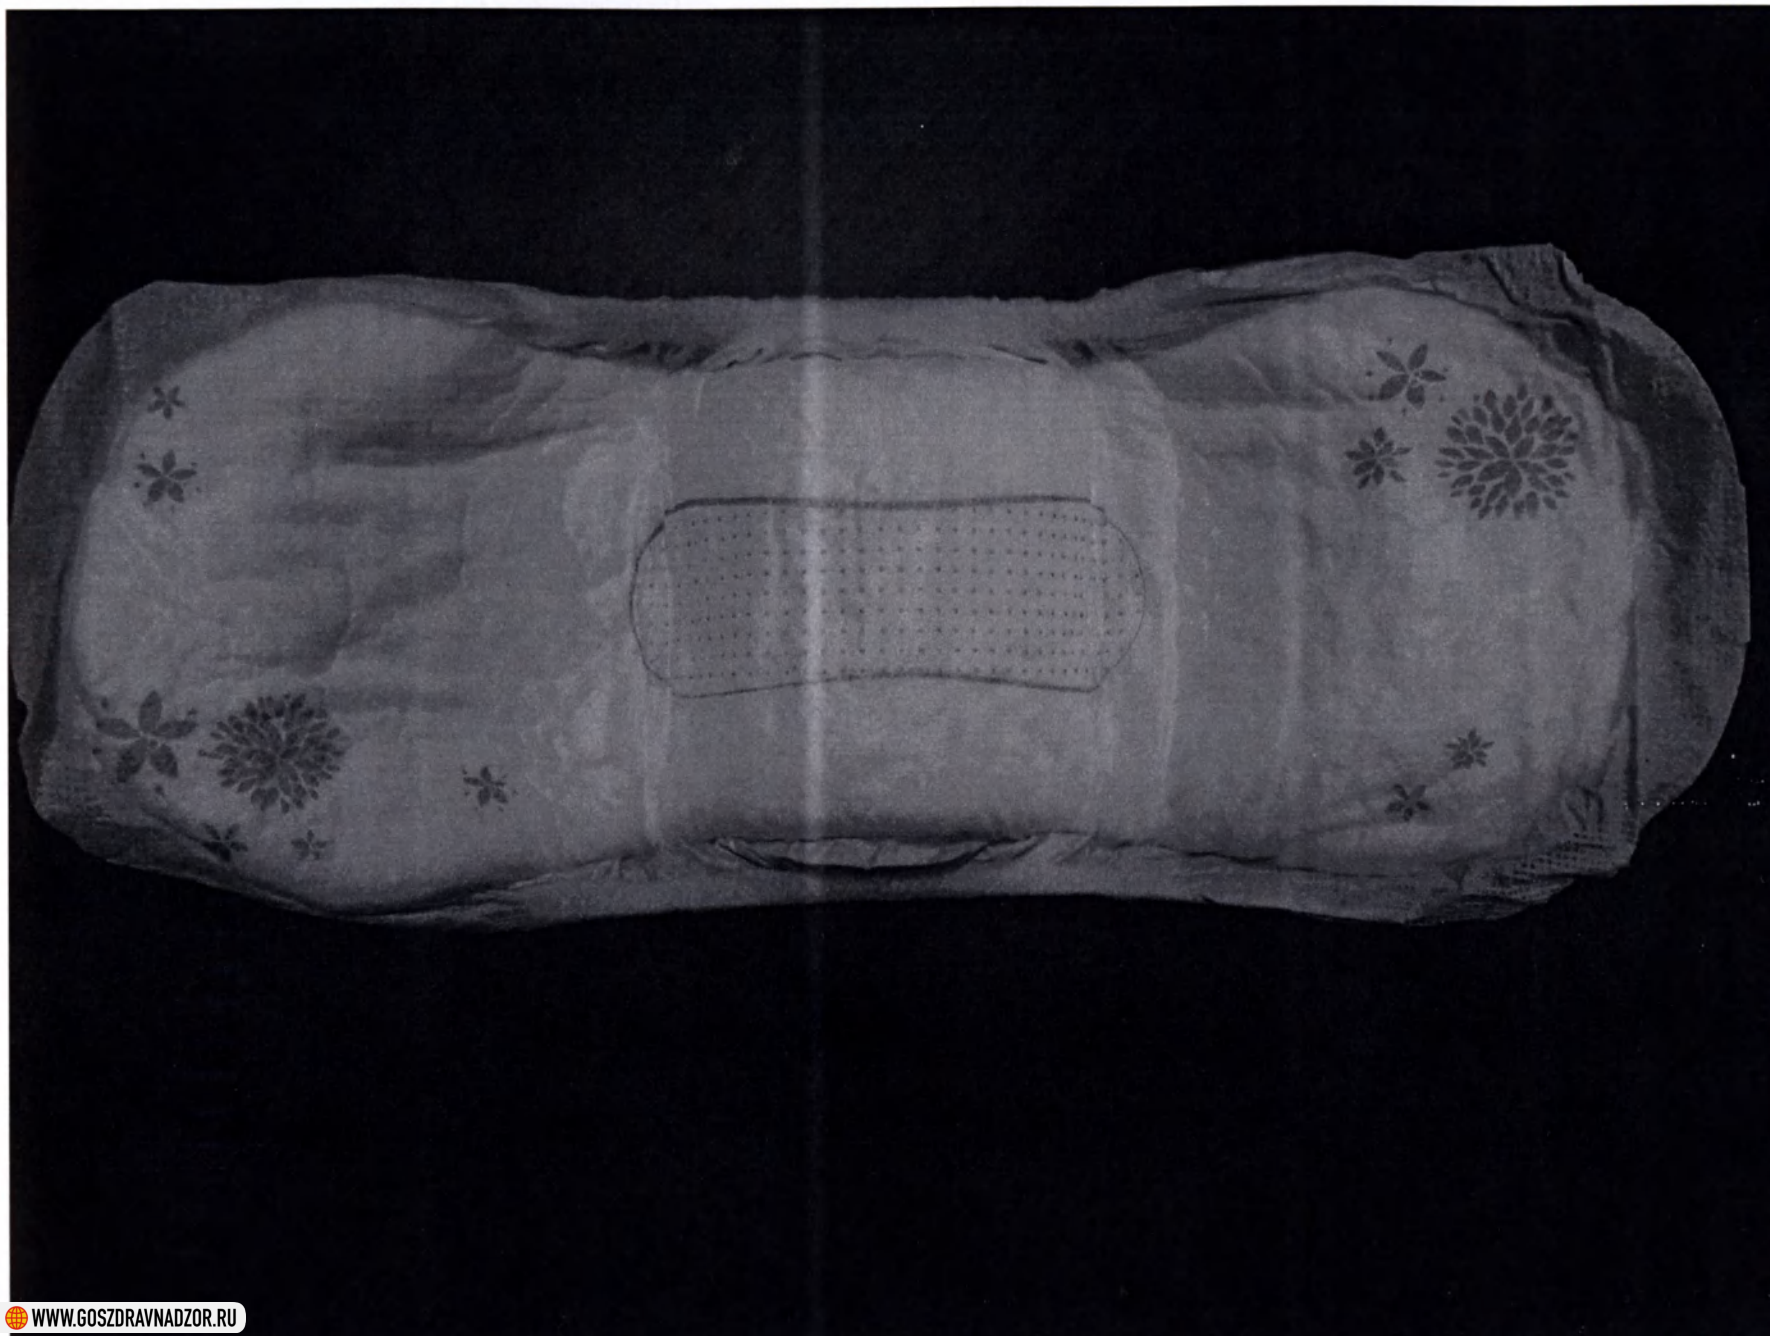


Фото 6 – Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Extra Plus

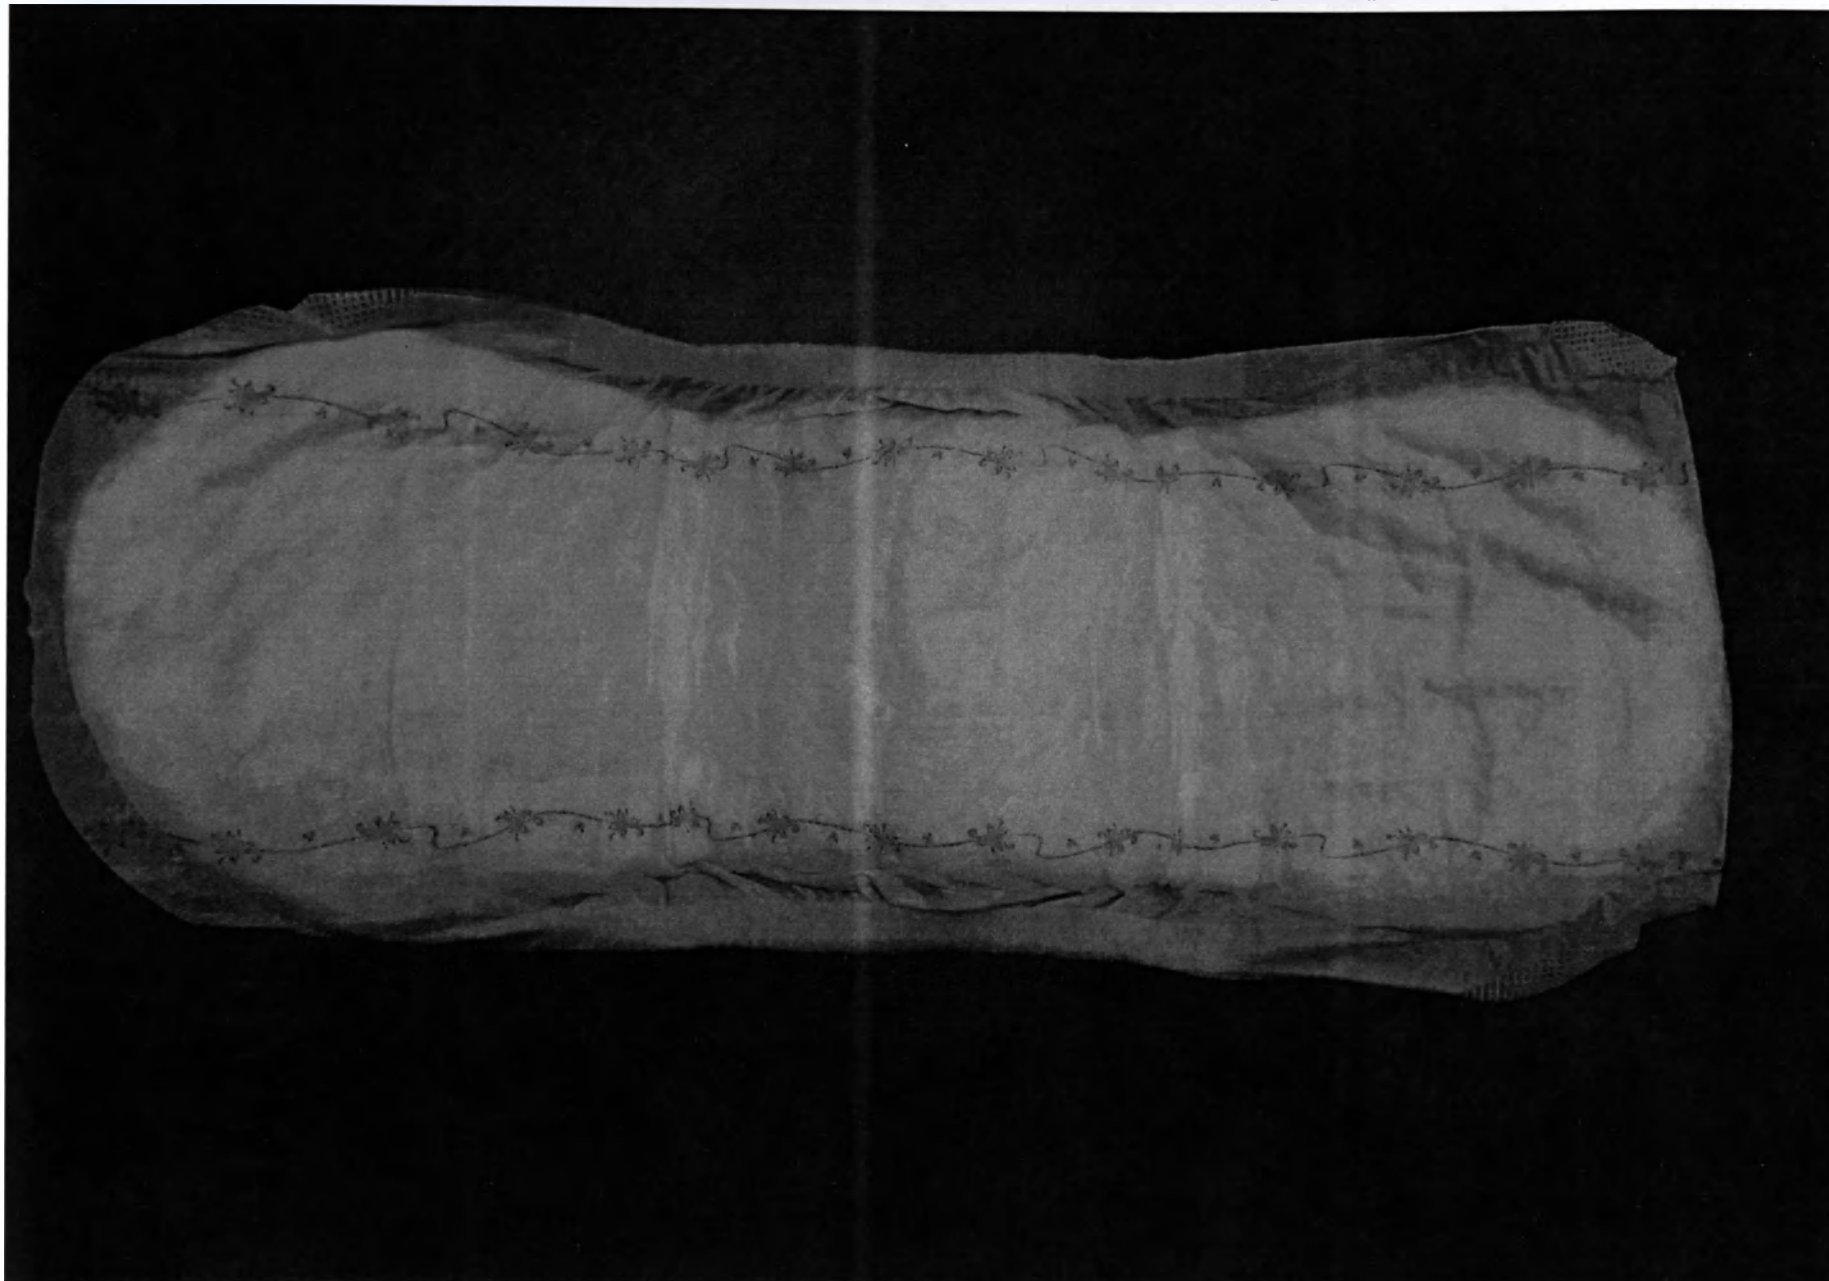


Фото 7 – Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Maxi

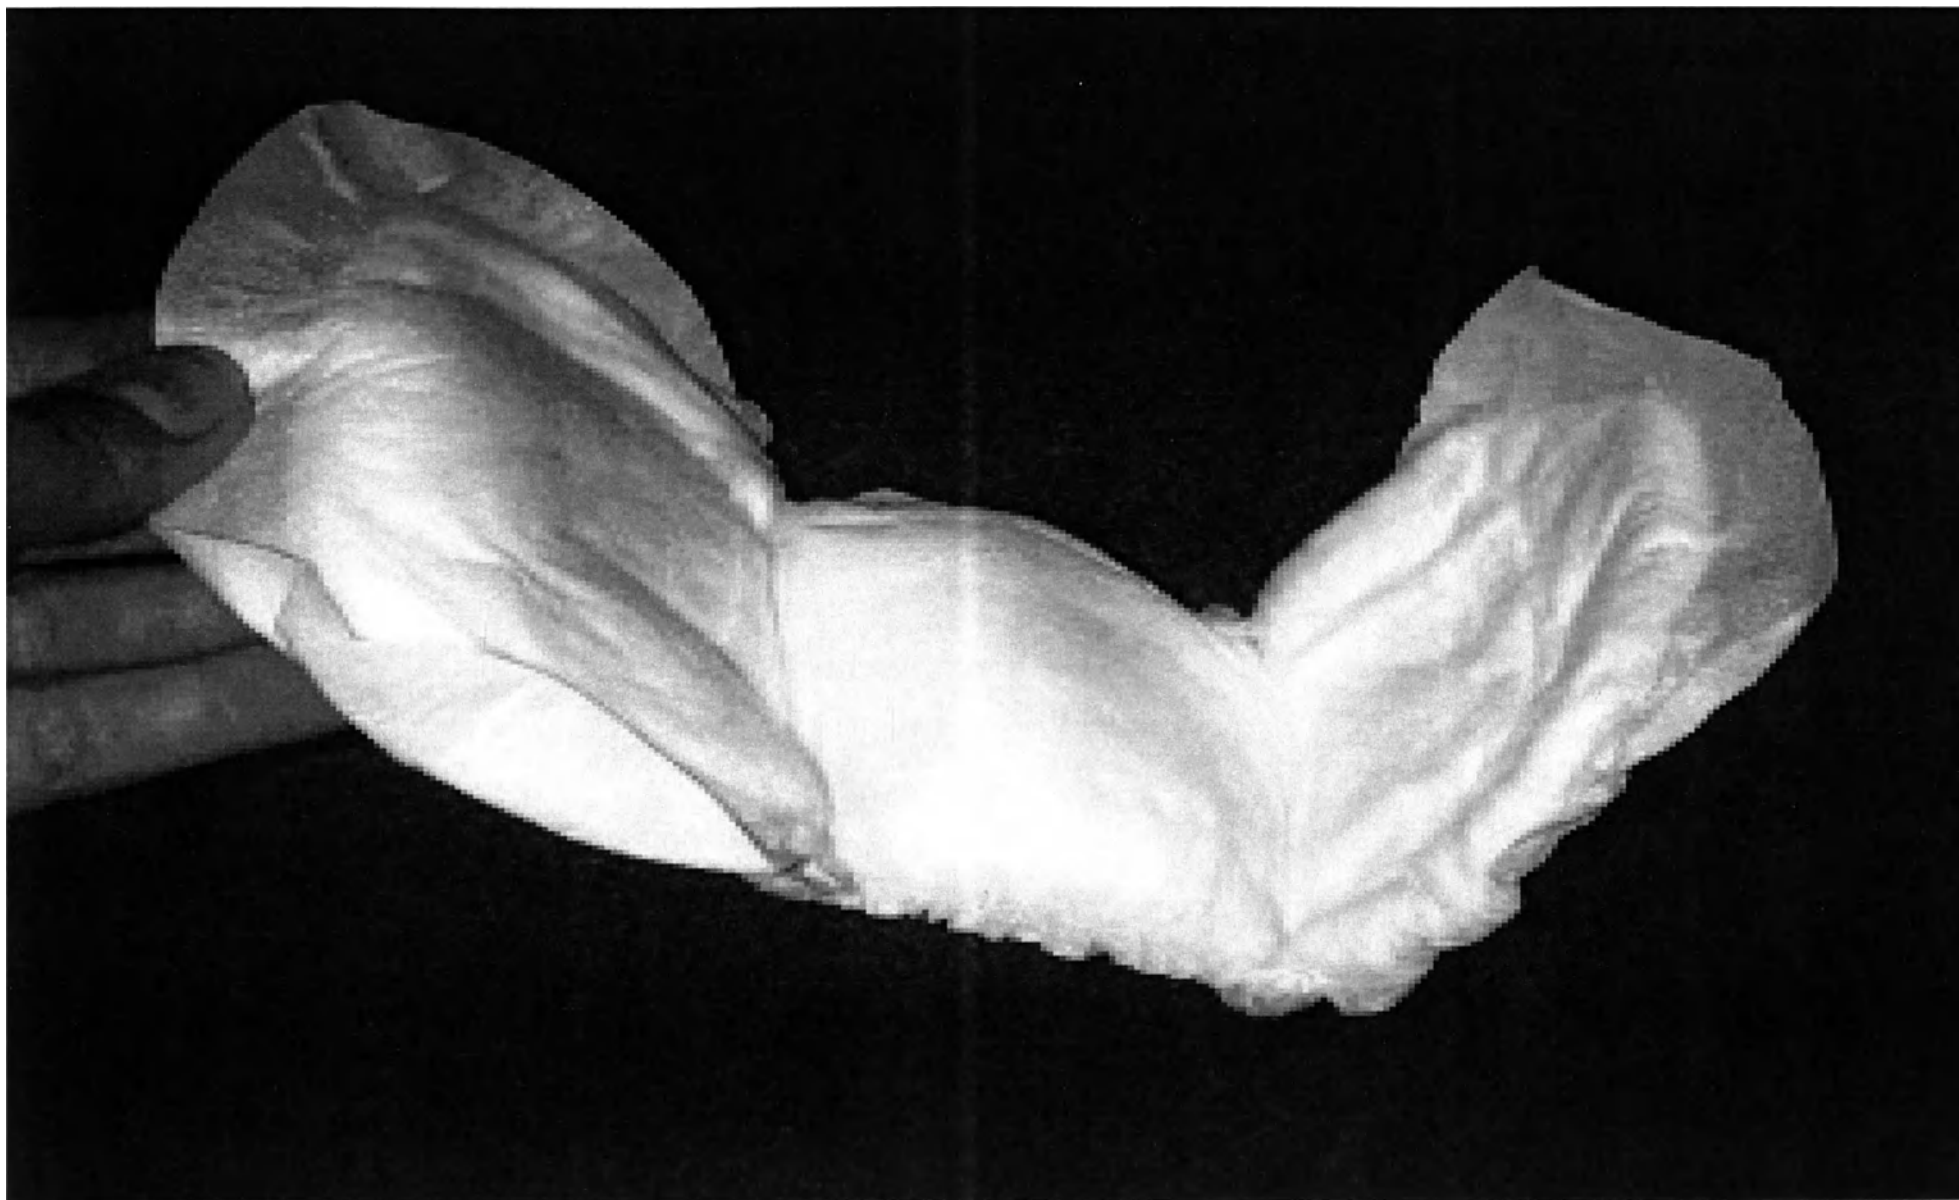


Фото 8 – Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Super plus

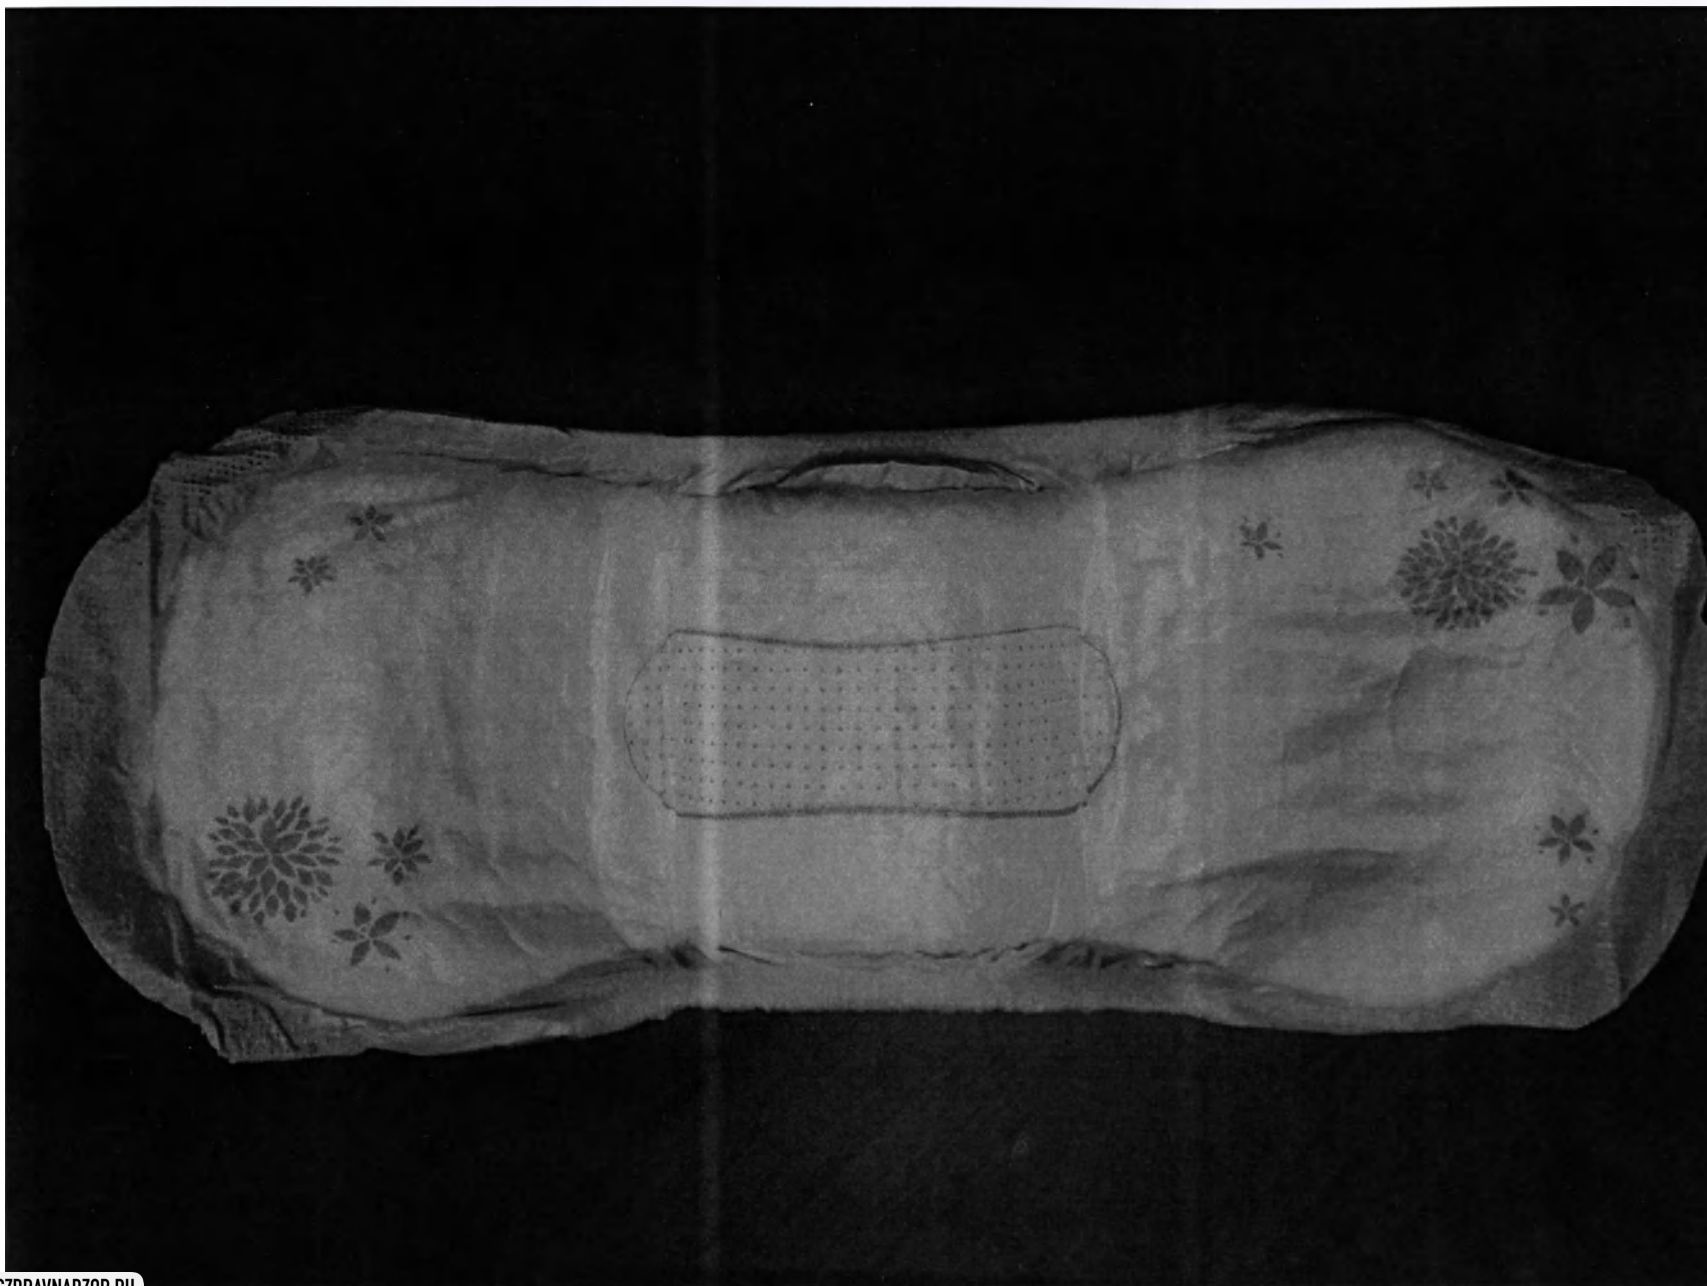


Фото 9 – Урологические прокладки по ND 961900 для мужчин, размер Extra

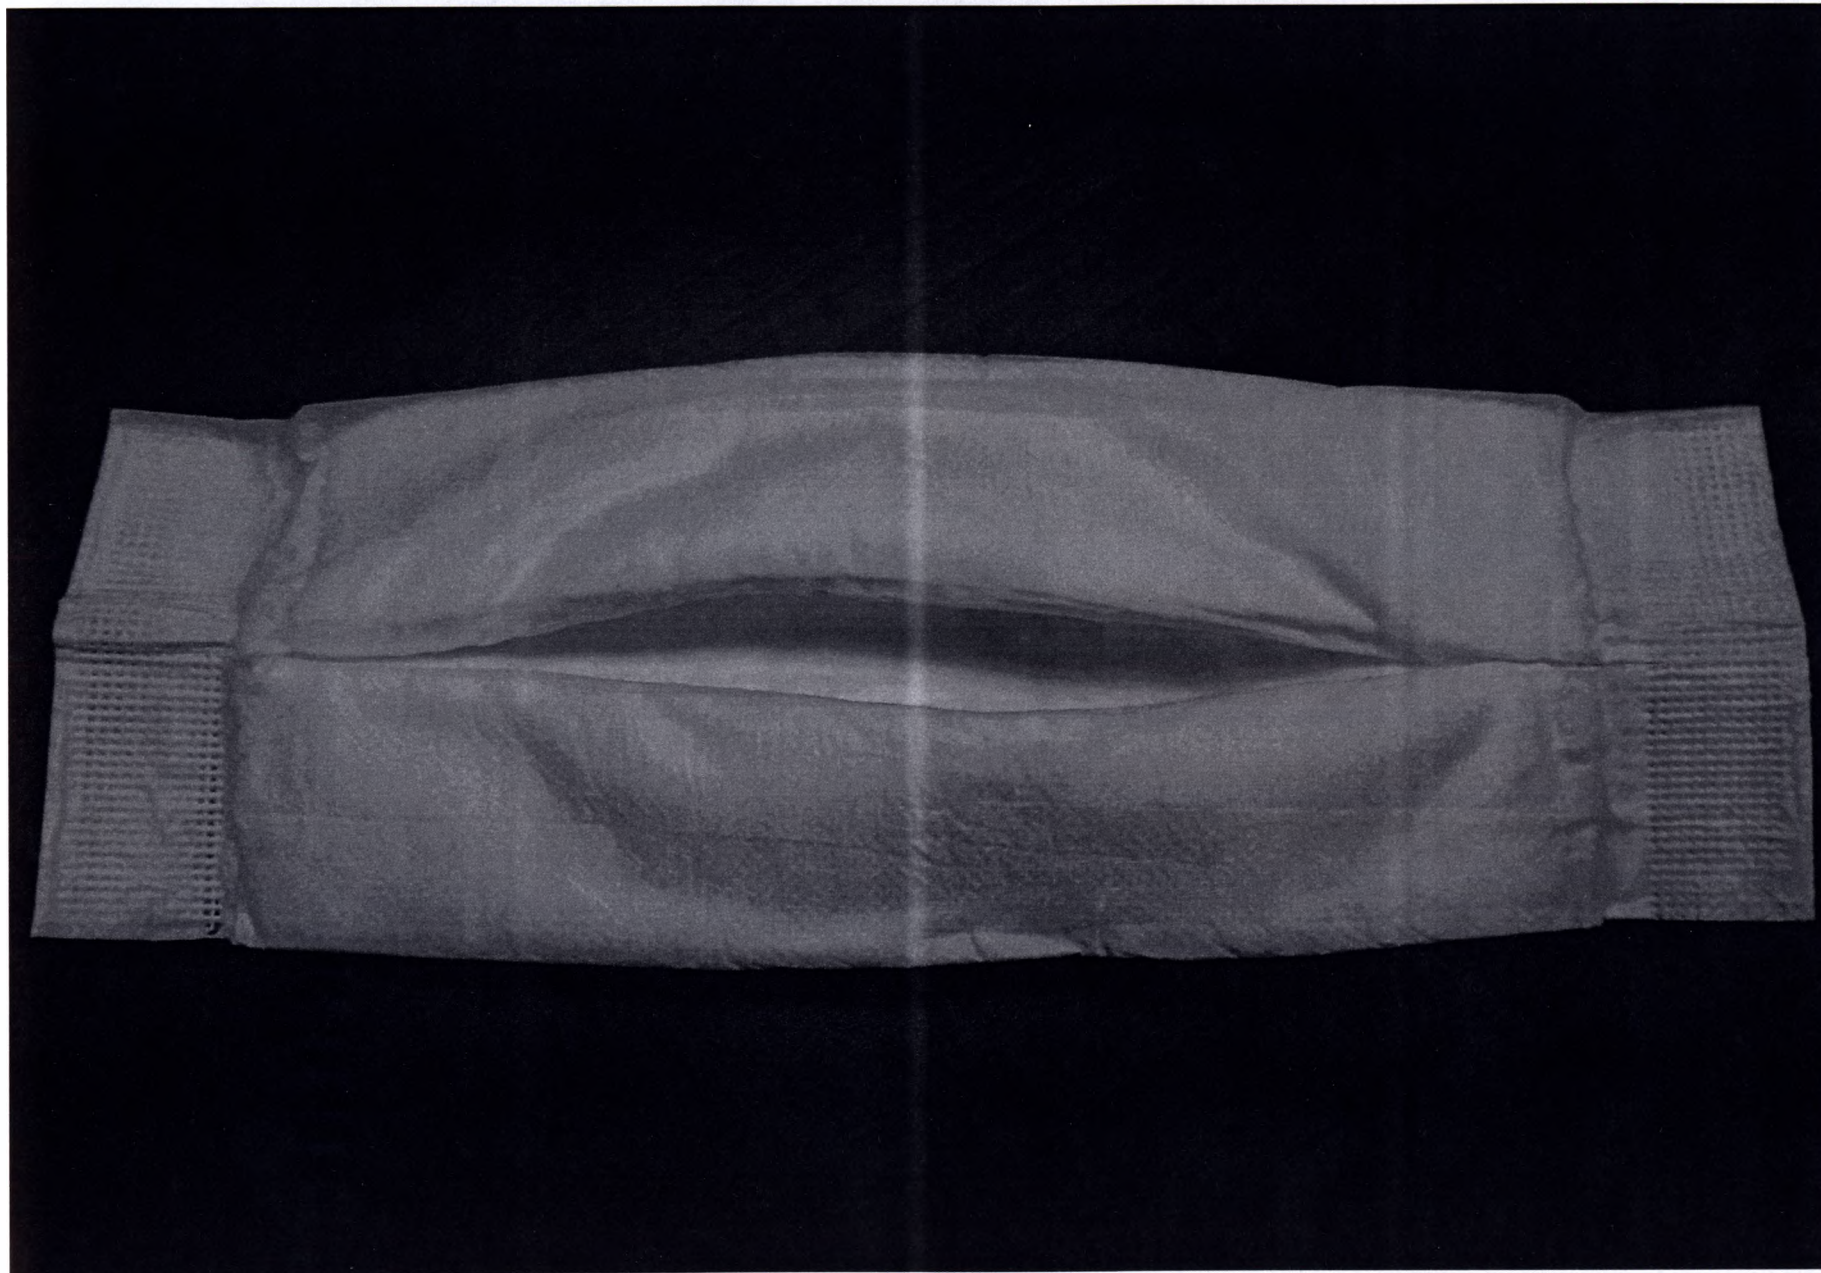


Фото 10 – Урологические прокладки по ND 961900 для мужчин, размер Super

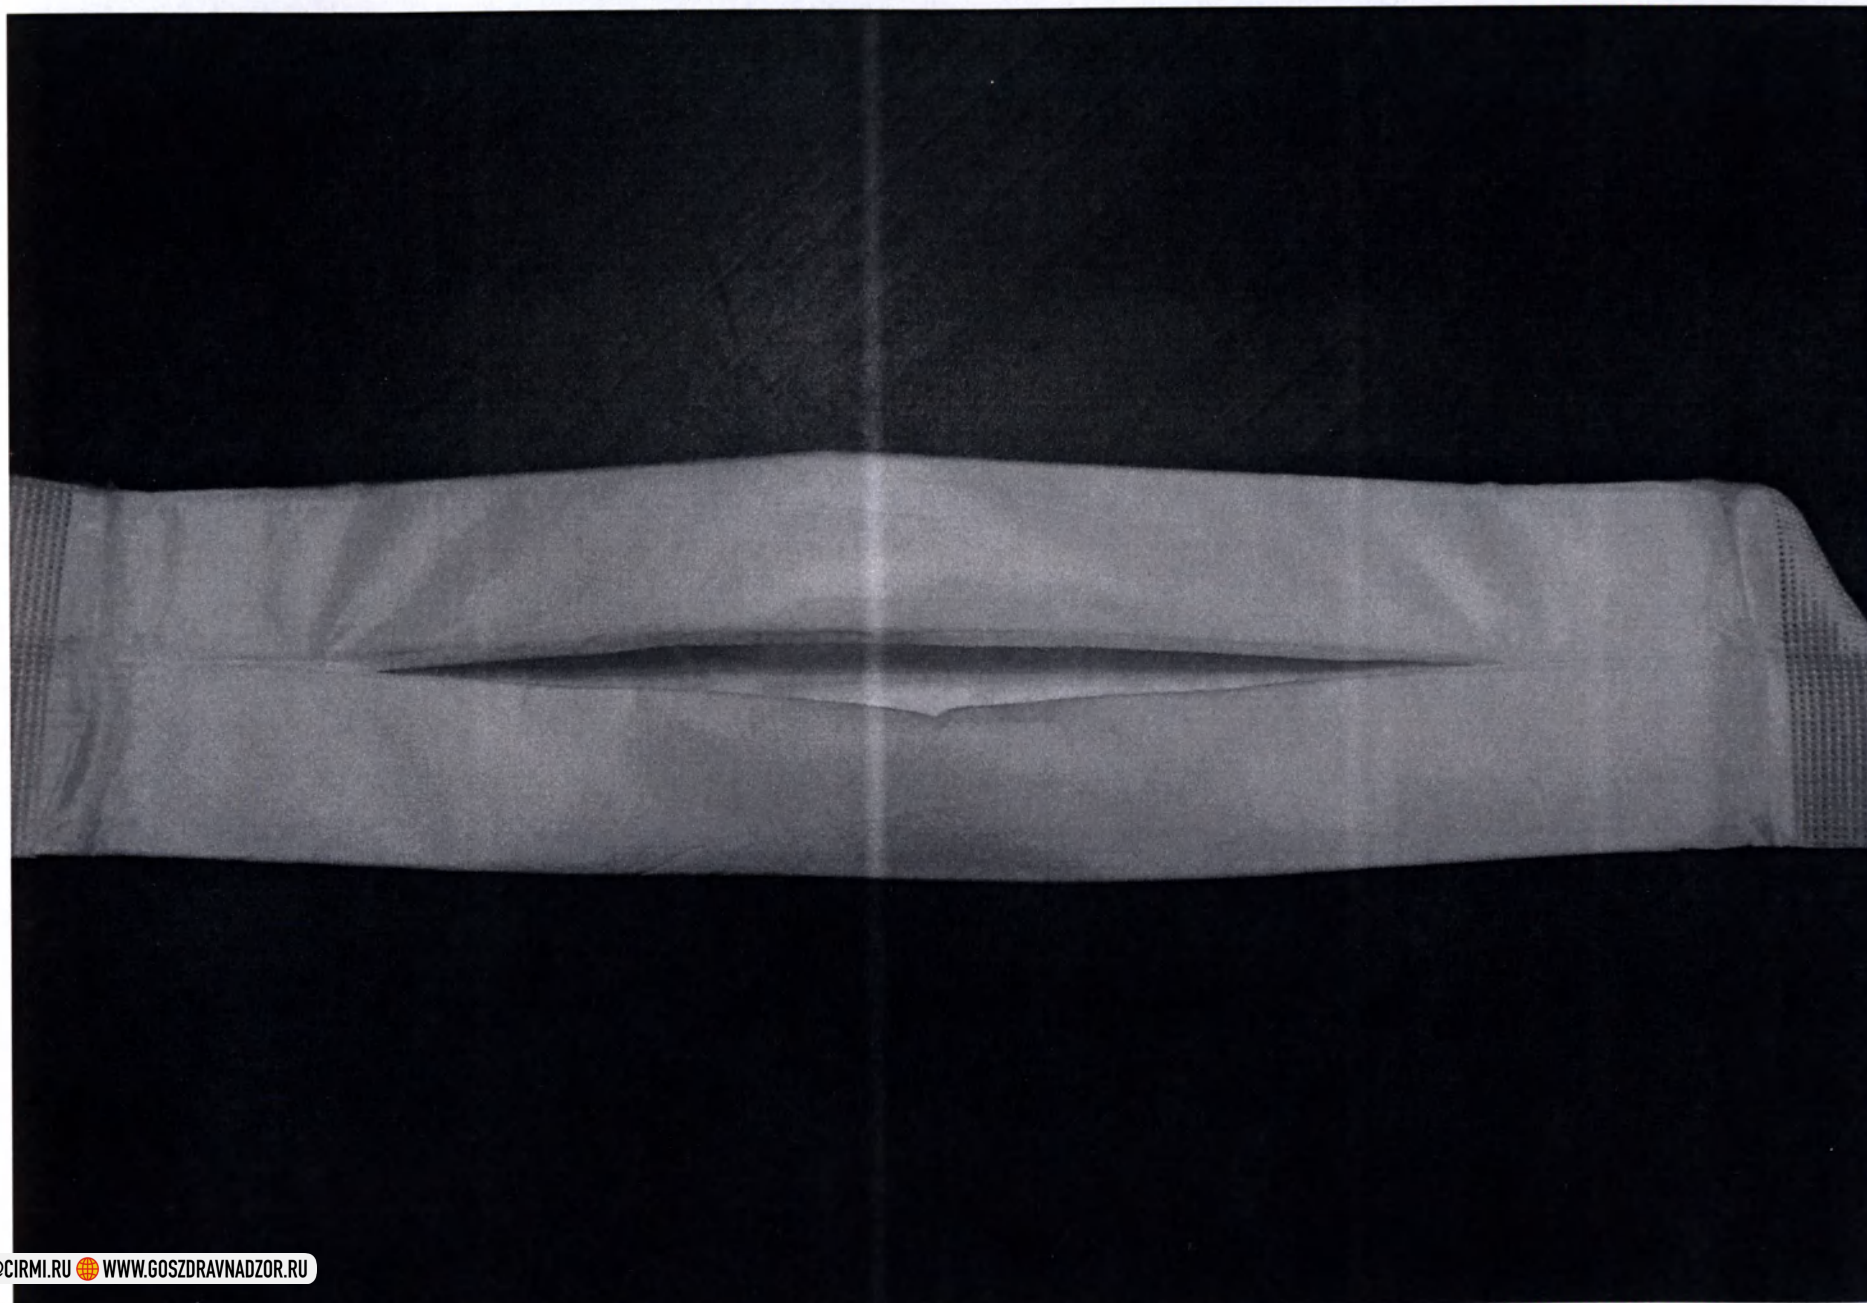


Фото 11 – Урологические прокладки по ND 961900 для мужчин, размер Level 1

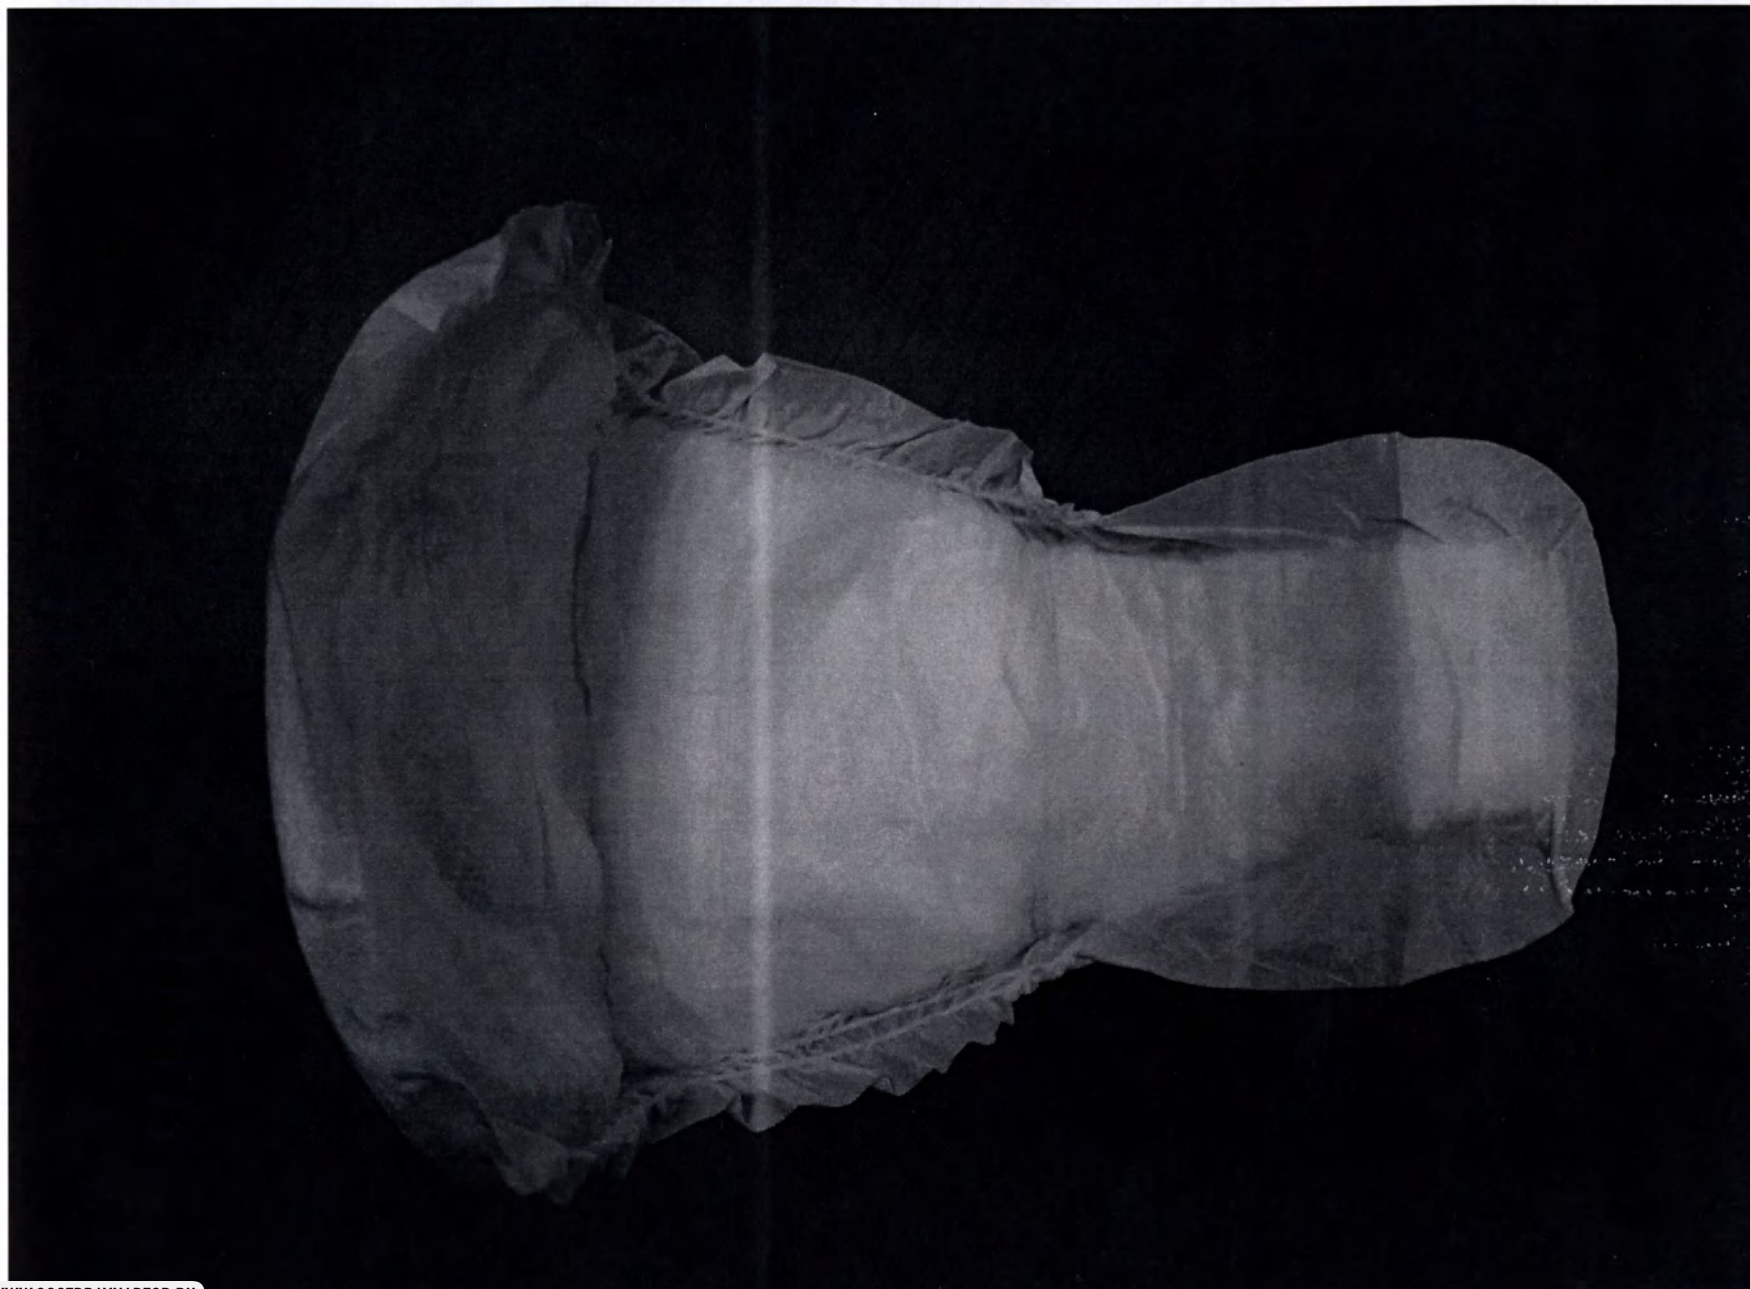


Фото 12 – Урологические прокладки по ND 961900 для мужчин, размер Level 2

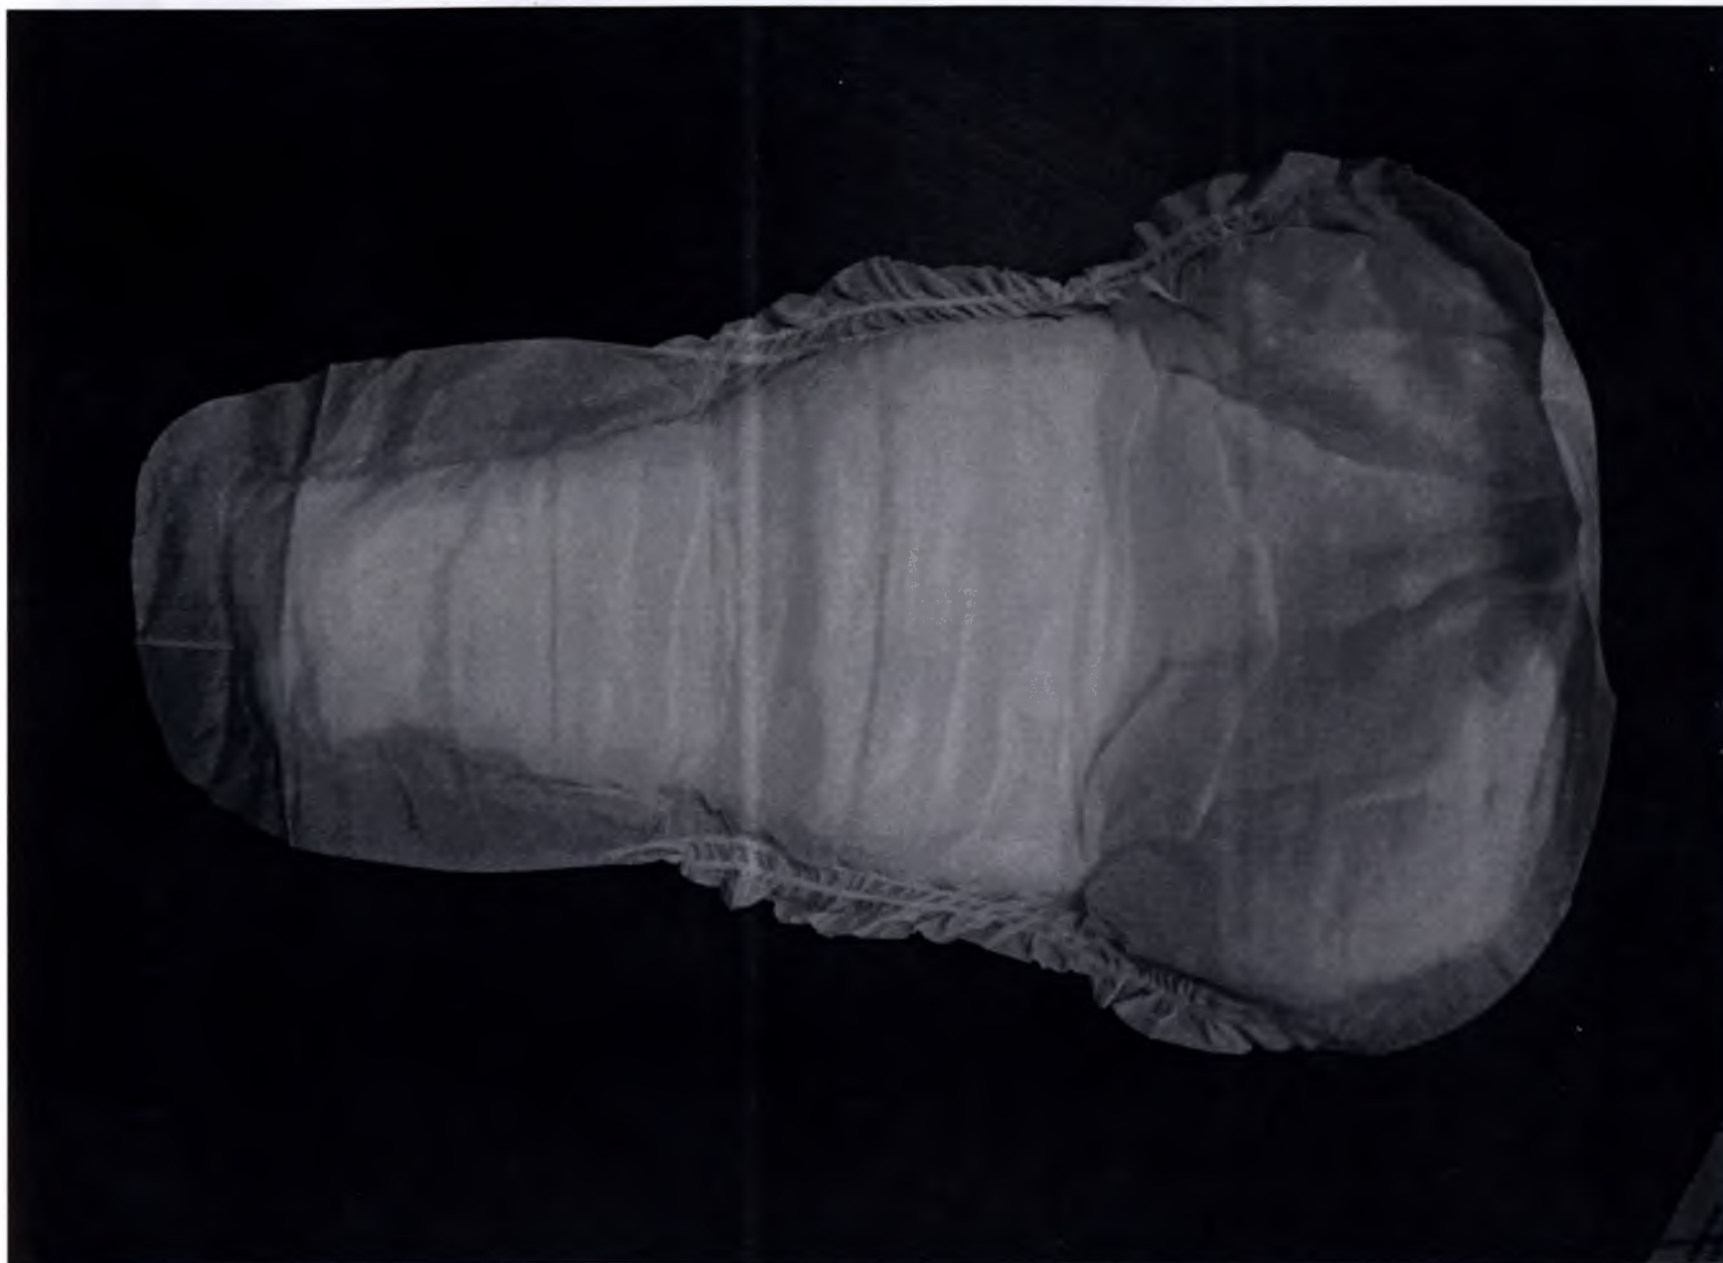


Фото 13 – Проект Маркировки на упаковке

Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Ultra, Номинальное количество - 10 шт.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: «Ontex BVBA», Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, Бельгия.

Место производства - см. код на упаковке:

• L003 «Ontex BVBA Eeklo», Korte Moeie 53, 9900 Eeklo, Belgium, Бельгия

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «ОНТЭКС РУ», Россия, 105064, г. Москва, ул.

Земляной вал, д. 9, www.ontex.ru

Для ежедневного использования при недержания мочи, в том числе и в послеродовой период, после проведения операций на репродуктивных органах, в период гинекологических заболеваний. С высокой впитывающей способностью. Способ применения: удалив клейкую ленту, закрепить прокладку на белье. Изделие одноразового использования.

Состав: целлюлоза, нетканый материал, суперабсорбент, полиэтилен, клей.


Противопоказания: заболевания кожи наружных половых органов, индивидуальная непереносимость материалов изделия, выраженные аллергические реакции. Отпускается без рецепта врача.

Дата изготовления – см. в номере партии: LOTXX чч дд гг ми мм, где LOTXX – код места производства и номер производственной линии, чч – час производства, дд – день производства, гг – год производства, ми – минуты производства, мм – месяц производства.

Срок годности: 3 года с даты производства, указанной на упаковке. Дата окончания срока годности – см. в номере партии (EXP мм гггг, где мм – месяц, гггг – год). Не использовать после окончания срока годности.

Условия хранения: хранить упаковку в недоступных для детей местах, защищенных от влаги.

Указания по утилизации: не бросать в канализацию!



Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Normal, Номинальное количество - 14 шт.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: «Ontex BVBA», Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, Бельгия.

Место производства - см. код на упаковке:

• L003 «Ontex BVBA Eeklo», Korte Moeie 53, 9900 Eeklo, Belgium, Бельгия

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «ОНТЭКС РУ», Россия, 105064, г. Москва, ул.

Земляной вал, д. 9, www.ontex.ru

Для ежедневного использования при недержания мочи, в том числе и в послеродовой период, после проведения операций на репродуктивных органах, в период гинекологических заболеваний. С высокой впитывающей способностью. Способ применения: удалив клейкую ленту, закрепить прокладку на белье. Изделие одноразового использования.

Состав: целлюлоза, нетканый материал, суперабсорбент, полиэтилен, клей, нить эластомерная.

Противопоказания: заболевания кожи наружных половых органов, индивидуальная непереносимость материалов изделия, выраженные аллергические реакции. Отпускается без рецепта врача.

Дата изготовления – см. в номере партии: LOTXX чч дд гг ми мм, где LOTXX – код места производства и номер производственной линии, чч – час производства, дд – день производства, гг – год производства, ми – минуты производства, мм – месяц производства.

Срок годности: 5 лет с даты производства, указанной на упаковке. Дата окончания срока годности – см. в номере партии (EXP мм гг, где мм – месяц, гг – год). Не использовать после окончания срока годности.

Условия хранения: хранить упаковку в недоступных для детей местах, защищенных от влаги.

Указания по утилизации: не бросать в канализацию!



Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Extra, Номинальное количество - 14 шт.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: «Ontex BVBA», Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, Бельгия.

Место производства - см. код на упаковке:

• L003 «Ontex BVBA Eeklo», Korte Moeie 53, 9900 Eeklo, Belgium, Бельгия

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «ОНТЭКС РУ», Россия, 105064, г. Москва, ул.

Земляной вал, д. 9, www.ontex.ru

Для ежедневного использования при недержания мочи, в том числе и в послеродовой период, после проведения операций на репродуктивных органах, в период гинекологических заболеваний. С высокой впитывающей способностью. Способ применения: удалив клейкую ленту, закрепить прокладку на белье. Изделие одноразового использования.

Состав: целлюлоза, нетканый материал, суперабсорбент, полиэтилен, клей, нить эластомерная.


Противопоказания: заболевания кожи наружных половых органов, индивидуальная непереносимость материалов изделия, выраженные аллергические реакции. Отпускается без рецепта врача.

Дата изготовления – см. в номере партии: LOTXX чч дд гг ми мм, где LOTXX – код места производства и номер производственной линии, чч – час производства, дд – день производства, гг – год производства, ми – минуты производства, мм – месяц производства.

Срок годности: 5 лет с даты производства, указанной на упаковке. Дата окончания срока годности – см. в номере партии (EXP мм гг, где мм – месяц, гг – год). Не использовать после окончания срока годности.

Условия хранения: хранить упаковку в недоступных для детей местах, защищенных от влаги.

Указания по утилизации: не бросать в канализацию!

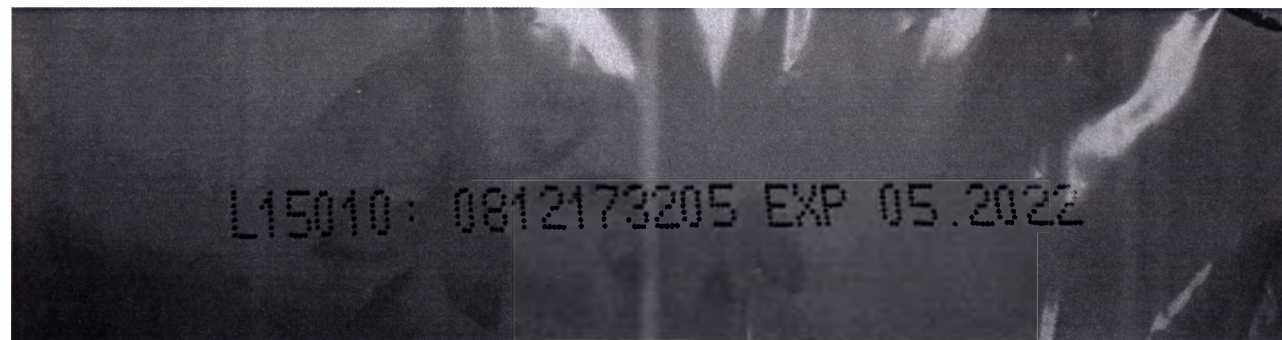

Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Extra Plus, Номинальное количество - 16 шт.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: «Ontex BVBA», Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, Бельгия.

Место производства - см. код на упаковке:

• L003 «Ontex BVBA Eeklo», Korte Moeie 53, 9900 Eeklo, Belgium, Бельгия

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «ОНТЭКС РУ», Россия, 105064, г. Москва, ул.

Земляной вал, д. 9, www.ontex.ru

Для ежедневного использования при недержания мочи, в том числе и в послеродовой период, после проведения операций на репродуктивных органах, в период гинекологических заболеваний. С высокой впитывающей способностью. Способ применения: удалив клейкую ленту, закрепить прокладку на белье. Изделие одноразового использования.

Состав: целлюлоза, нетканый материал, суперабсорбент, полиэтилен, клей, нить эластомерная.

Противопоказания: заболевания кожи наружных половых органов, индивидуальная непереносимость материалов изделия, выраженные аллергические реакции. Отпускается без рецепта врача.

Дата изготовления – см. в номере партии: LOTXX чч дд гг ми мм, где LOTXX – код места производства и номер производственной линии, чч – час производства, дд – день производства, гг – год производства, ми – минуты производства, мм – месяц производства.

Срок годности: 5 лет с даты производства, указанной на упаковке. Дата окончания срока годности – см. в номере партии (EXP мм гг, где мм – месяц, гг – год). Не использовать после окончания срока годности.

Условия хранения: хранить упаковку в недоступных для детей местах, защищенных от влаги.

Указания по утилизации: не бросать в канализацию!



Урологические прокладки по ND 961900 для женщин, размер Maxi, Номинальное количество - 14 шт.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: «Ontex BVBA», Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, Бельгия.

Место производства - см. код на упаковке:

• L003 «Ontex BVBA Eeklo», Korte Moeie 53, 9900 Eeklo, Belgium, Бельгия

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «ОНТЭКС РУ», Россия, 105064, г. Москва, ул.

Земляной вал, д. 9, www.ontex.ru

Для ежедневного использования при недержания мочи, в том числе и в послеродовой период, после проведения операций на репродуктивных органах, в период гинекологических заболеваний. С высокой впитывающей способностью. Способ применения: удалив клейкую ленту, закрепить прокладку на белье. Изделие одноразового использования.

Состав: целлюлоза, нетканый материал, суперабсорбент, полиэтилен, клей, нить эластомерная.

Противопоказания: заболевания кожи наружных половых органов, индивидуальная непереносимость материалов изделия, выраженные аллергические реакции. Отпускается без рецепта врача.

Дата изготовления – см. в номере партии: LOTXX чч дд гг ми мм, где LOTXX – код места производства и номер производственной линии, чч – час производства, дд – день производства, гг – год производства, ми – минуты производства, мм – месяц производства.

Срок годности: 5 лет с даты производства, указанной на упаковке. Дата окончания срока годности – см. в номере партии (EXP мм гг, где мм – месяц, гг – год). Не использовать после окончания срока годности.

Условия хранения: хранить упаковку в недоступных для детей местах, защищенных от влаги.

Указания по утилизации: не бросать в канализацию!



L15009:0021171402 EXP 02:2022

Урологические прокладки по ND 961900 для мужчин, размер Level 2, Номинальное количество - 28 шт.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: «Ontex BVBA», Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, Бельгия.

Место производства - см. код на упаковке:

• L003 «Ontex BVBA Eeklo», Korte Moeie 53, 9900 Eeklo, Belgium, Бельгия

Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «ОНТЭКС РУ», Россия, 105064, г. Москва, ул.

Земляной вал, д. 9, www.ontex.ru

Для ежедневного использования при недержания мочи, в том числе и в послеродовой период, после проведения операций на репродуктивных органах, в период гинекологических заболеваний. С высокой впитывающей способностью. Способ применения: удалив клейкую ленту, закрепить прокладку на белье. Изделие одноразового использования.

Состав: целлюлоза, нетканый материал, суперабсорбент, полиэтилен, клей, нить эластомерная.



Противопоказания: заболевания кожи наружных половых органов, индивидуальная непереносимость материалов изделия, выраженные аллергические реакции. Отпускается без рецепта врача.

Дата изготовления – см. в номере партии: LOTXX чч дд гг ми мм, где LOTXX – код места производства и номер производственной линии, чч – час производства, дд – день производства, гг – год производства, ми – минуты производства, мм – месяц производства.

Срок годности: 5 лет с даты производства, указанной на упаковке. Дата окончания срока годности – см. в номере партии (EXP мм гг, где мм – месяц, гг – год). Не использовать после окончания срока годности.

Условия хранения: хранить упаковку в недоступных для детей местах, защищенных от влаги.

Указания по утилизации: не бросать в канализацию!

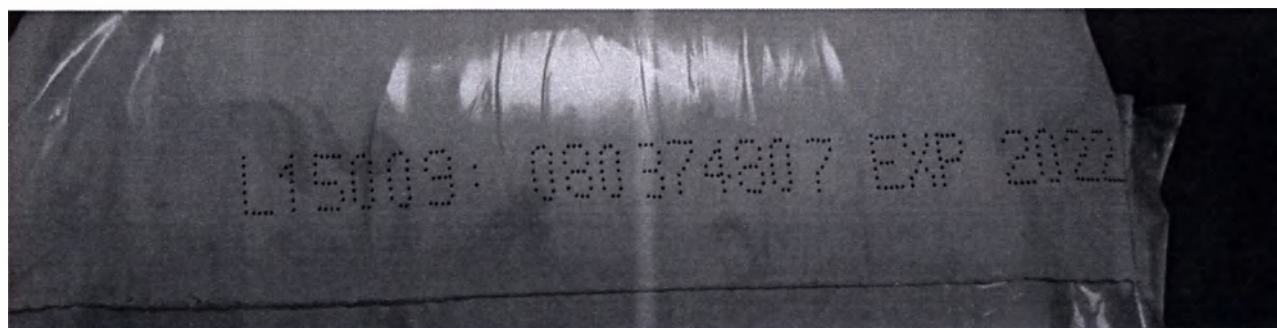

Пронумеровано, прошнуровано

11 (одинадцять) листів.

Ген. директор Верболюденко П. А.

