

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Левенгук»

Епифанов А.В.



09 2022г.

## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**«Микроскоп медицинский флуоресцентный «Левенгук» MED PRO 600 Fluor»**

**ТУ 26.70.22-002- 09587521 -2021**

**Производитель:** ОАО «Левенгук», 190005 г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22 лит. А

2022

«Микроскоп медицинский флуоресцентный «Левенгук» MED PRO 600 Fluor» (в собранном виде)

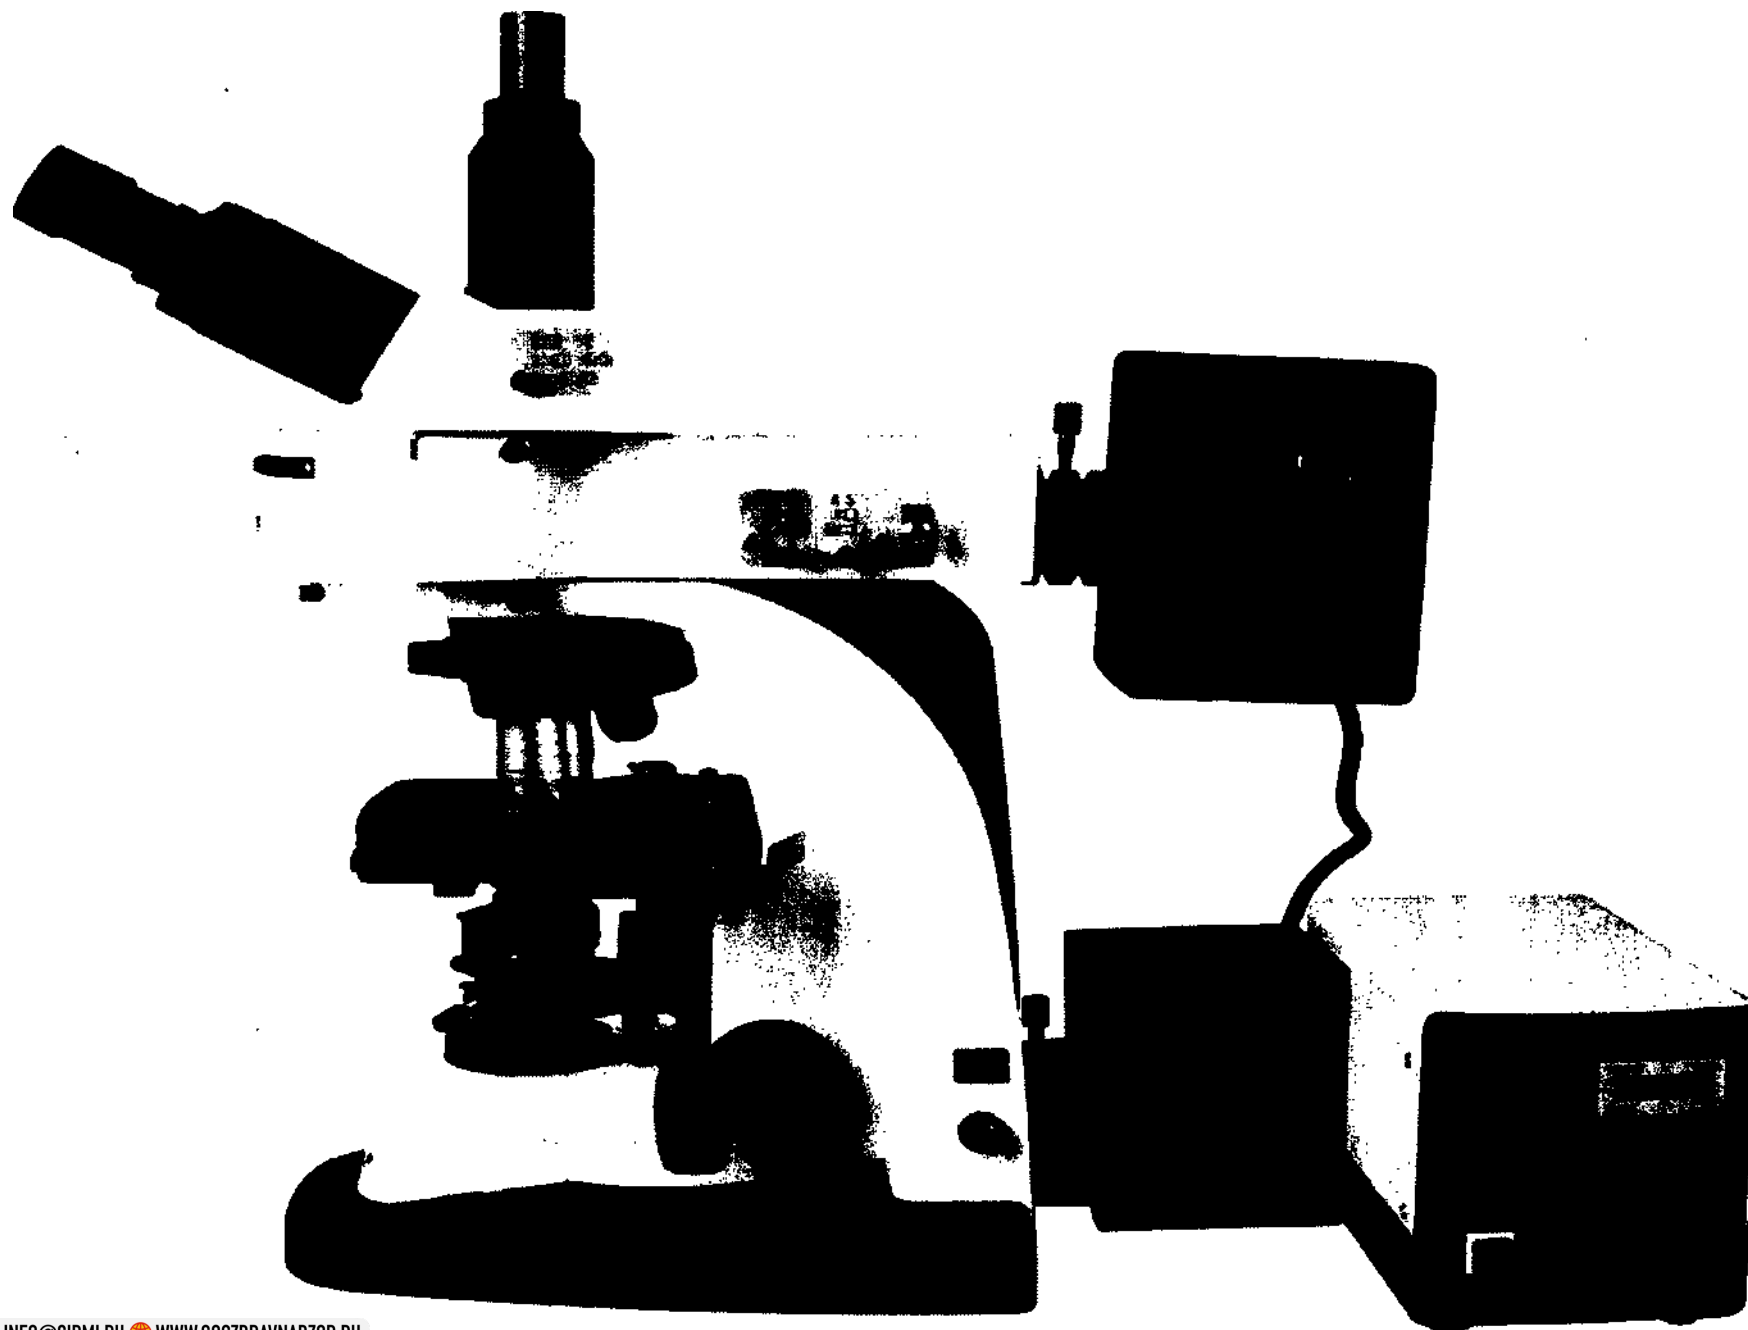


Насадка тринокулярная




Окуляр 10х/22 мм




Револьверное устройство на 6 объективов

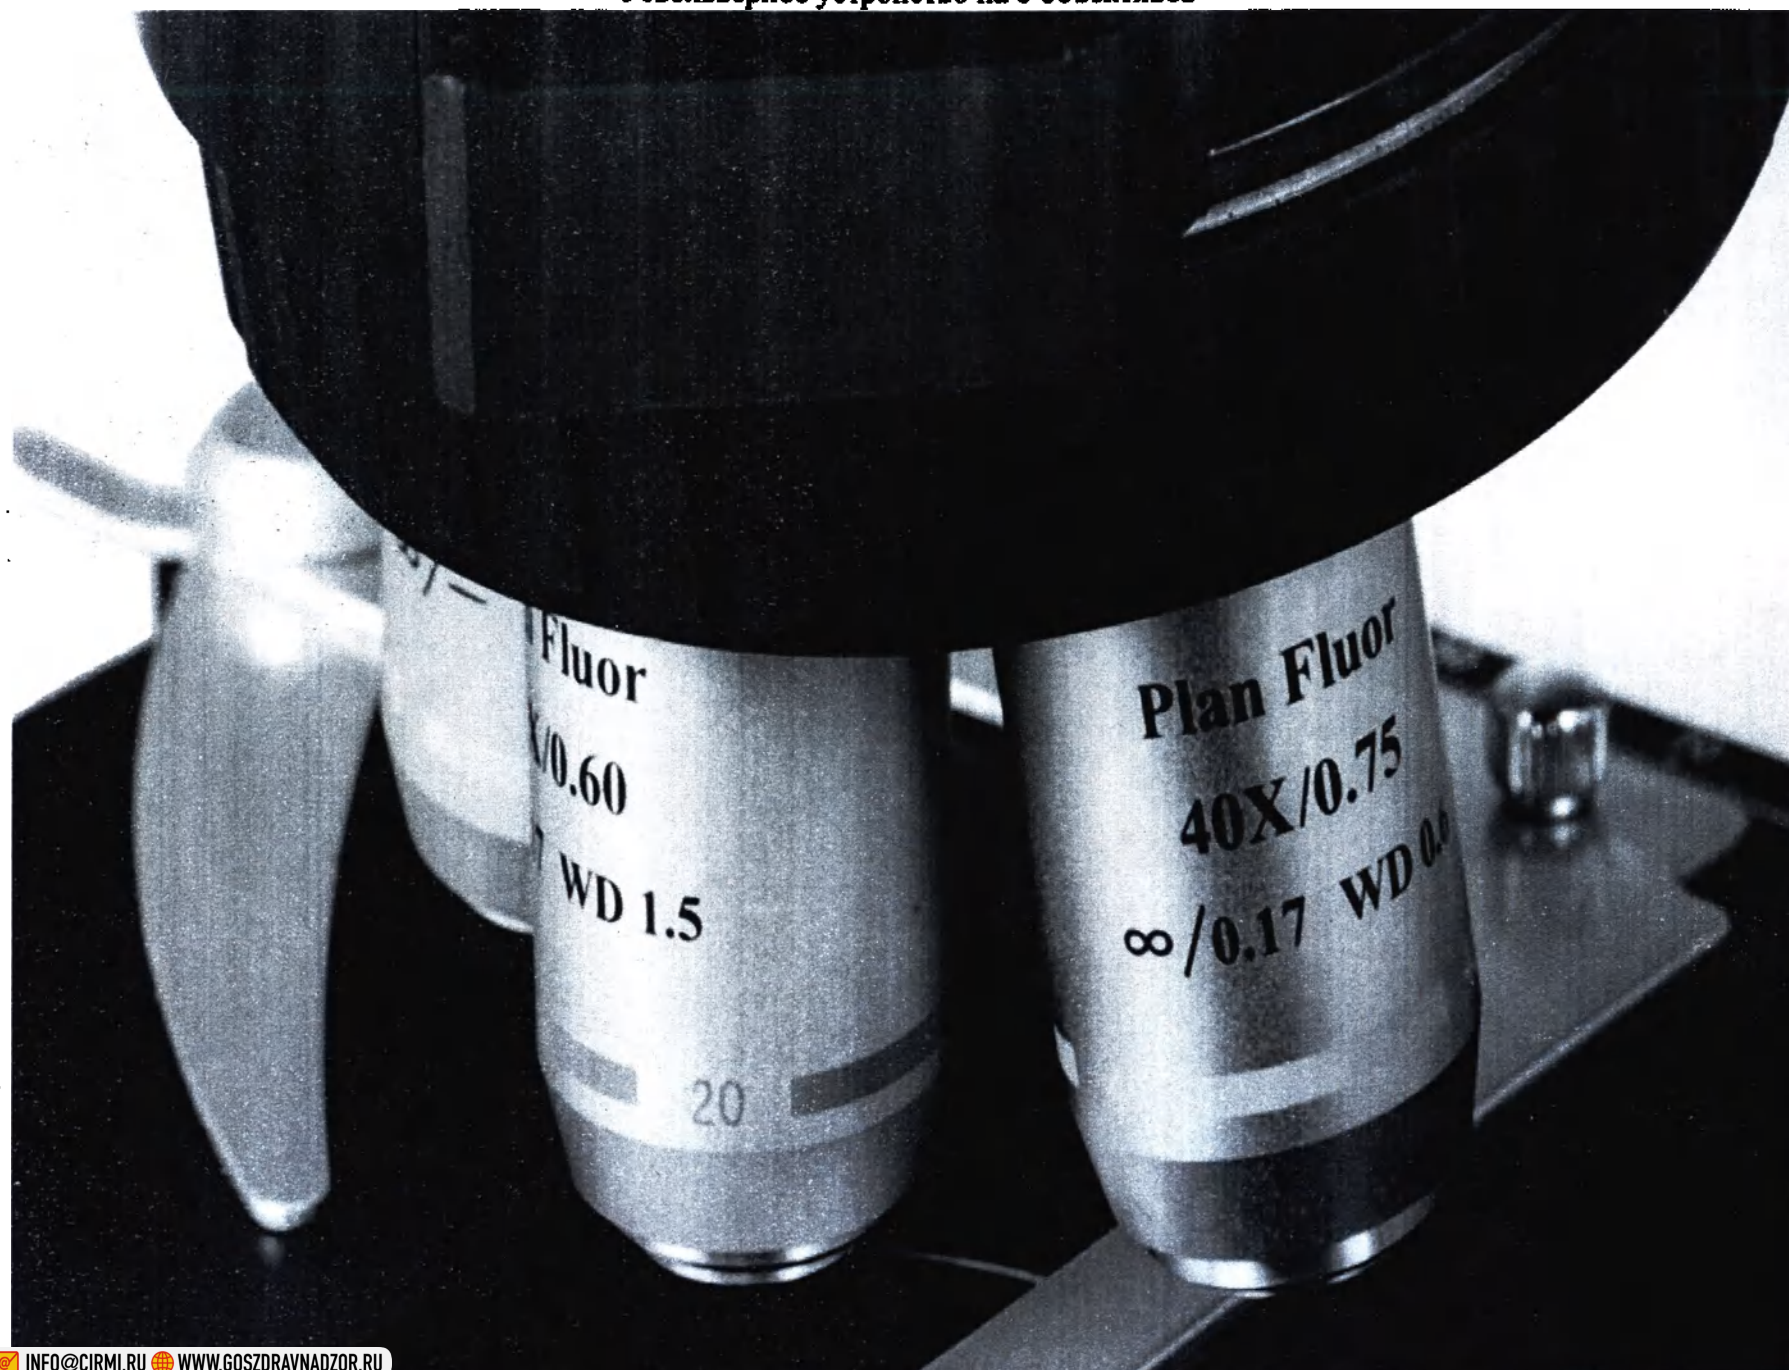

Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 4х

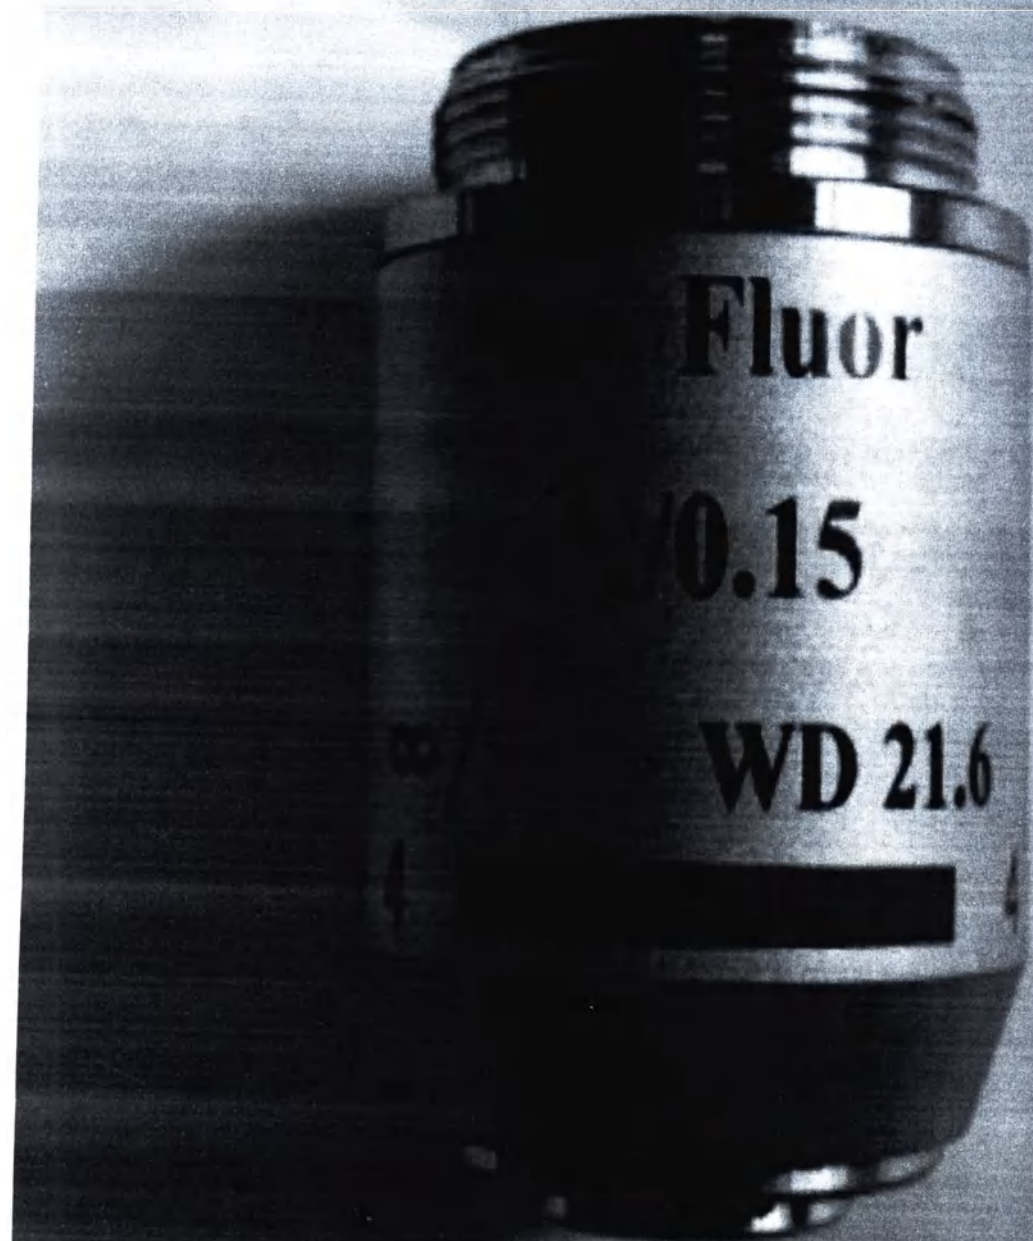


Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 10х

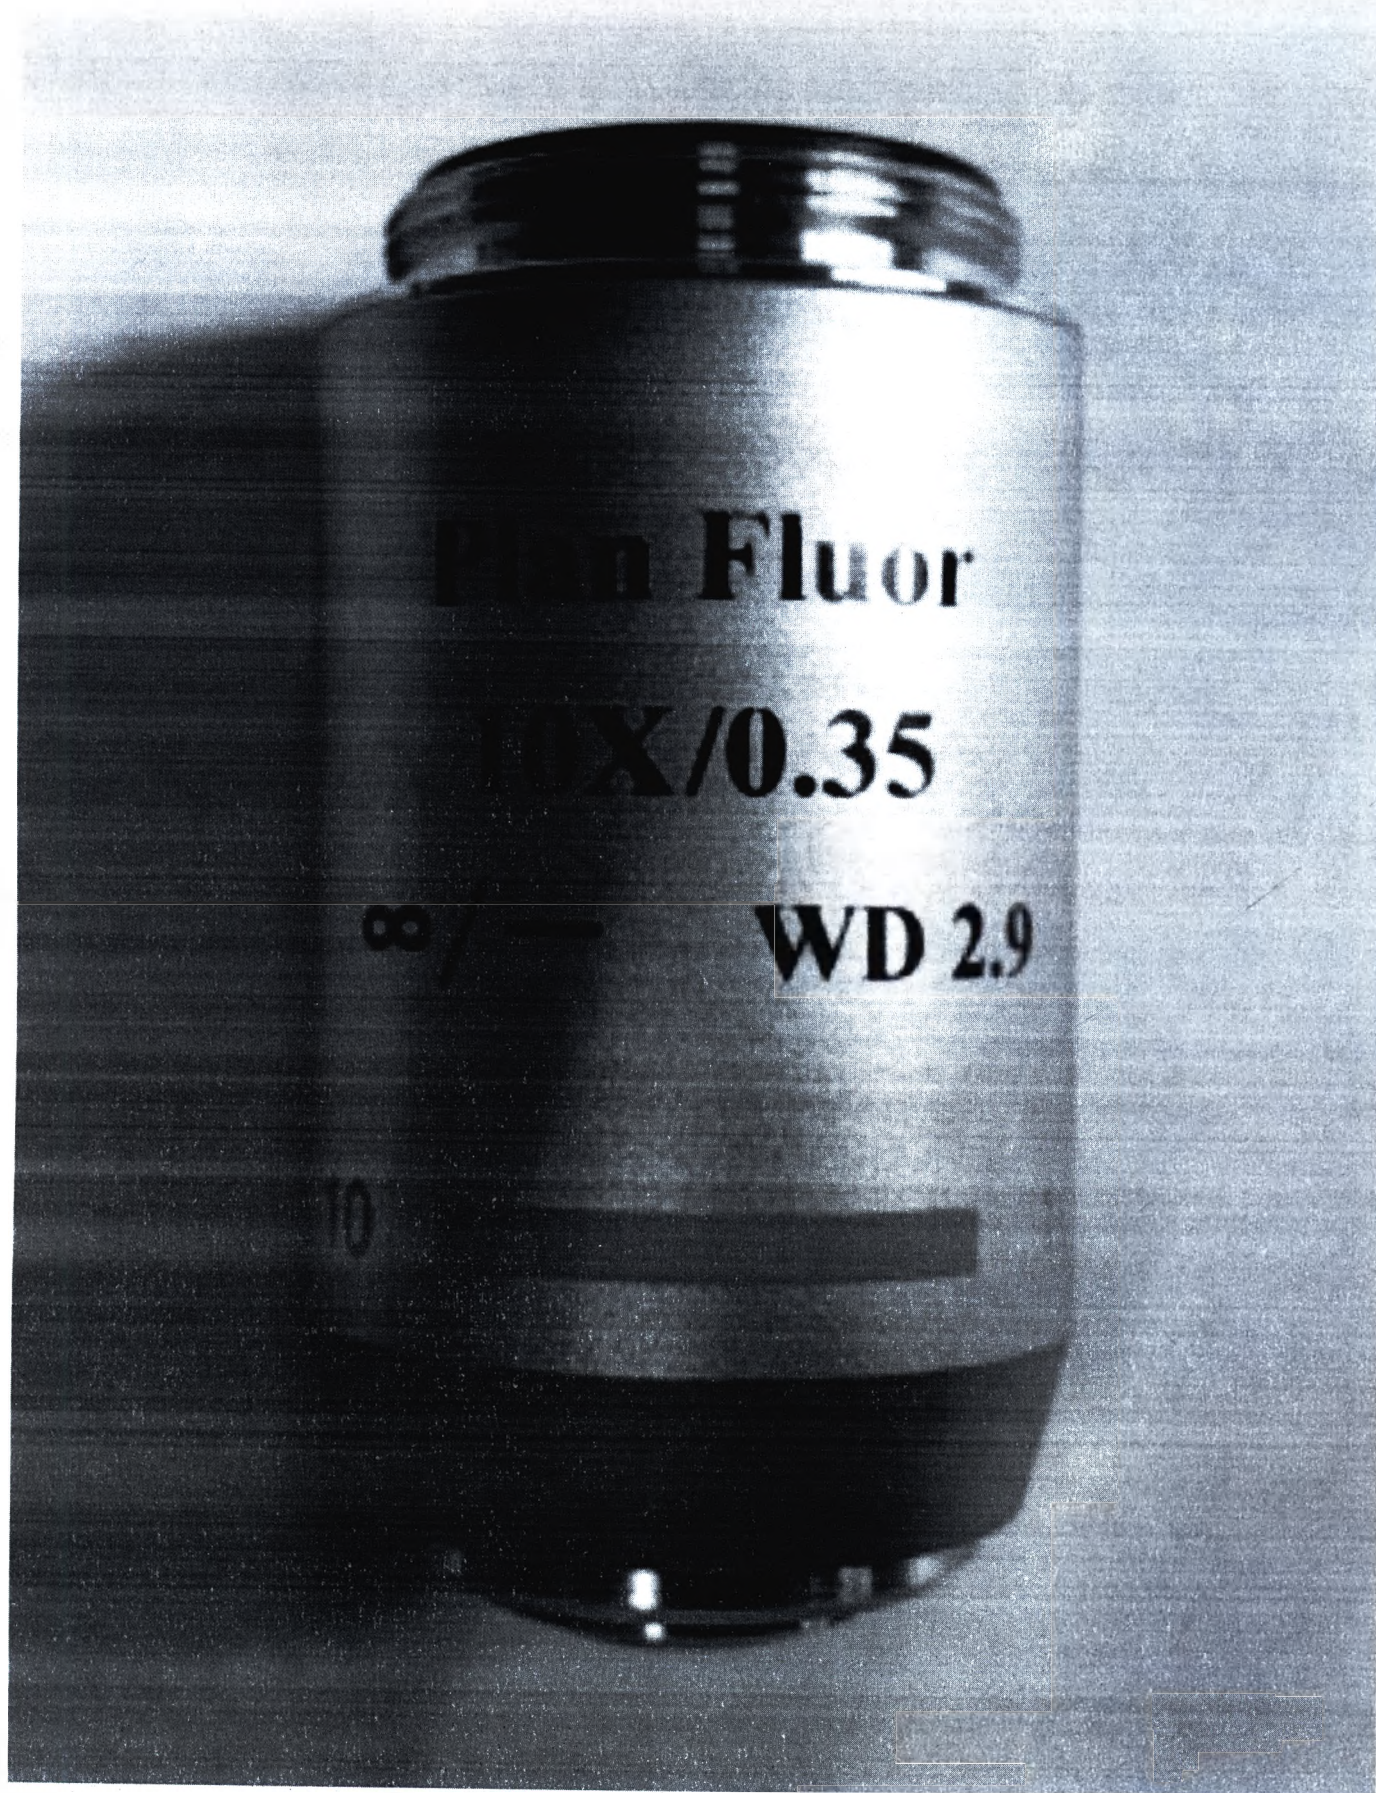


Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 20х



Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 40х

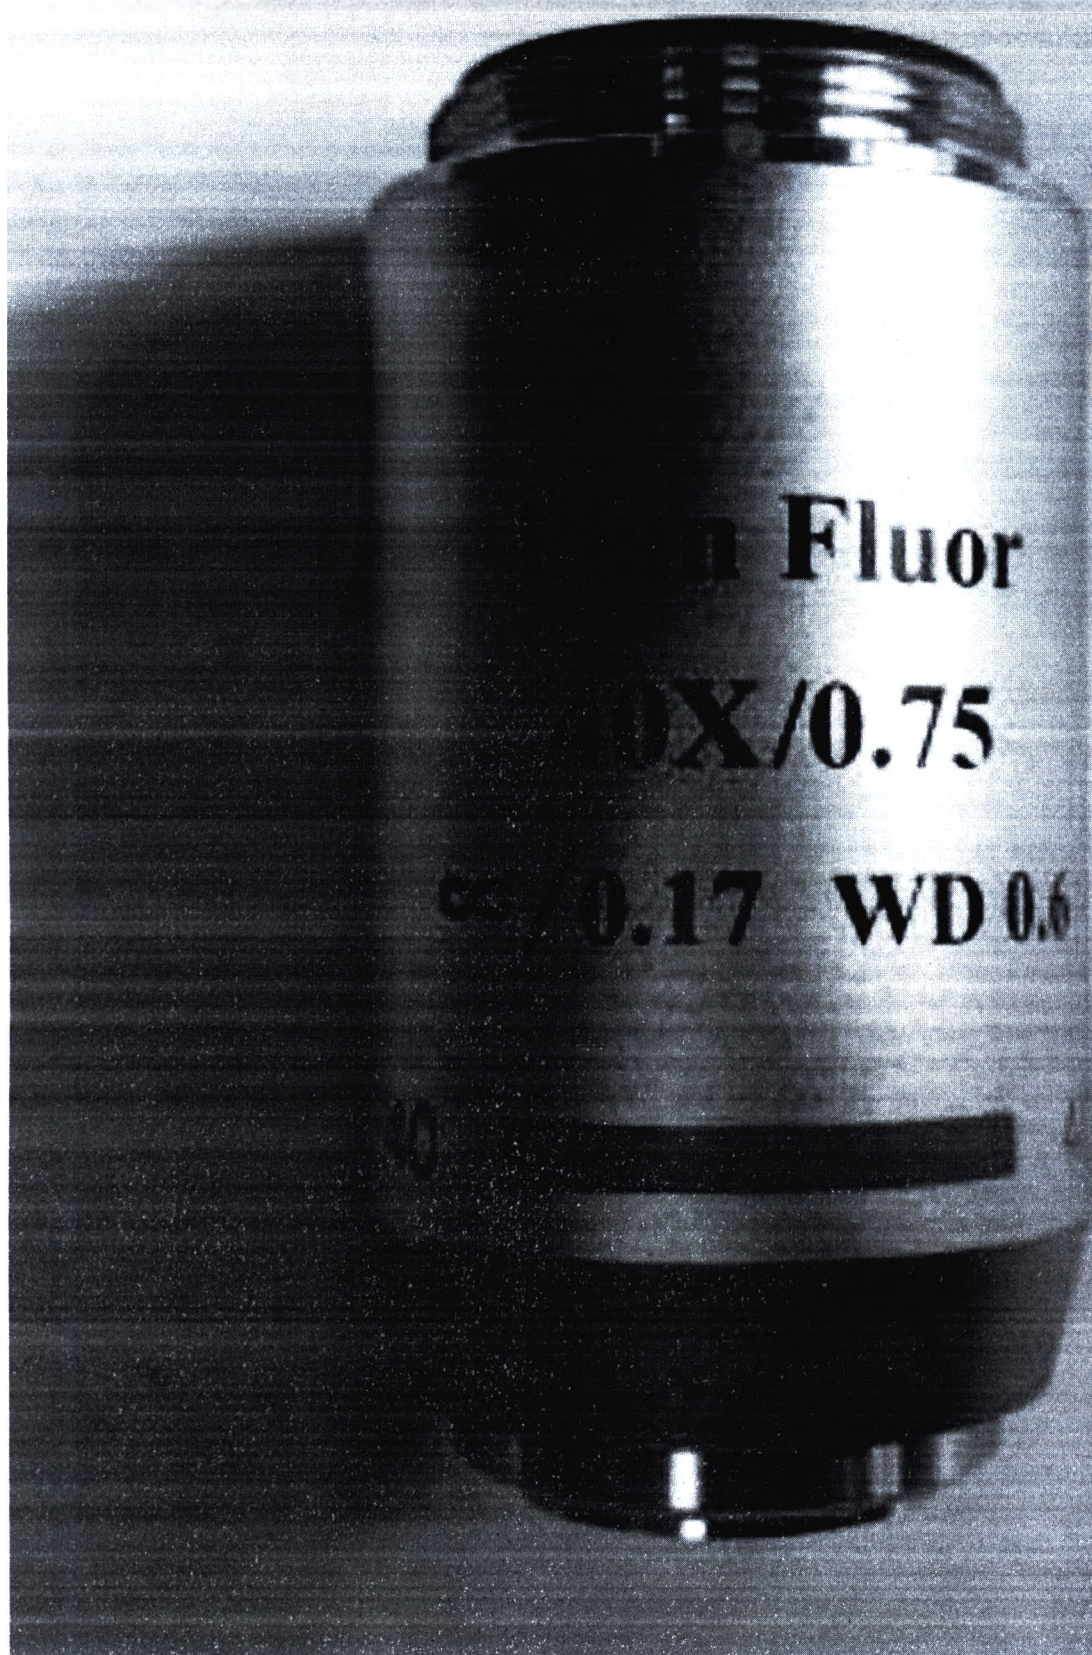


Предметный столик

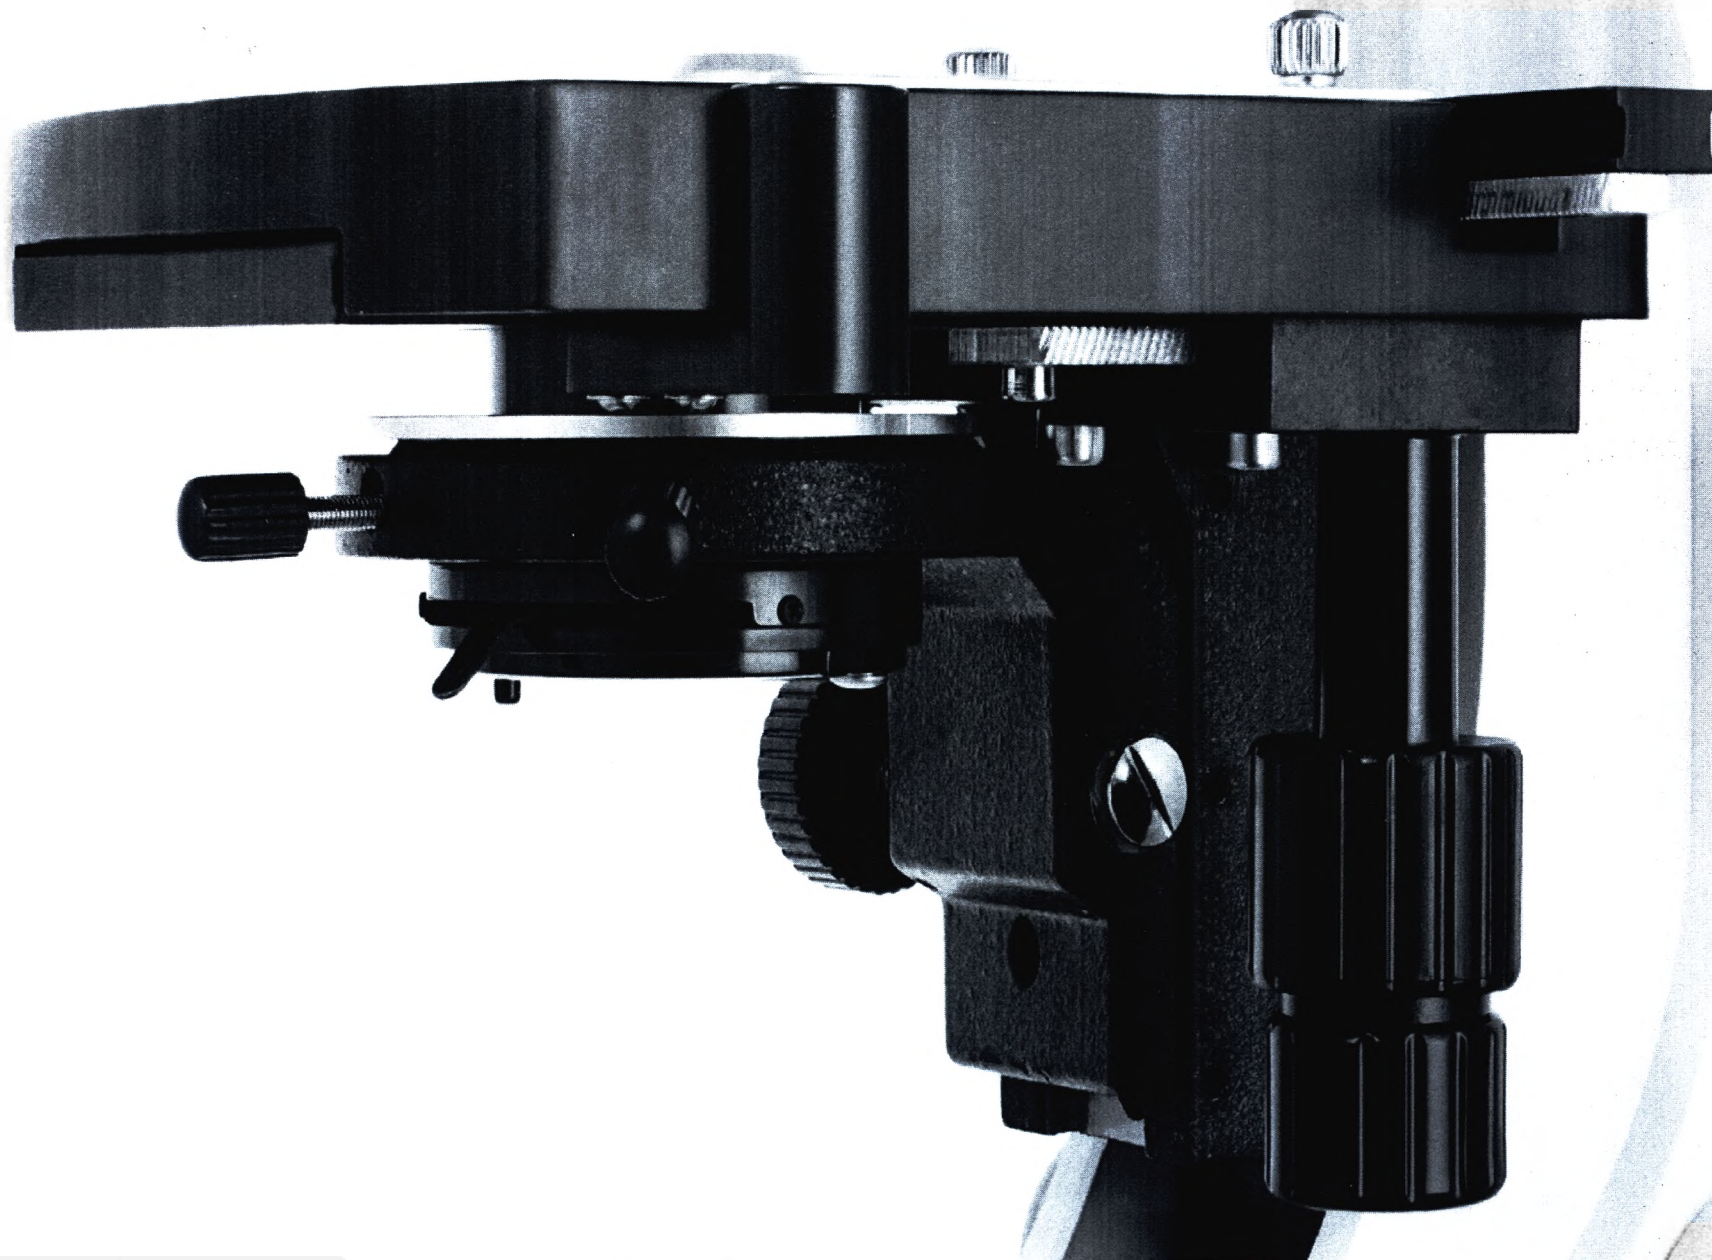

Конденсор 1,25



Галогенный осветитель

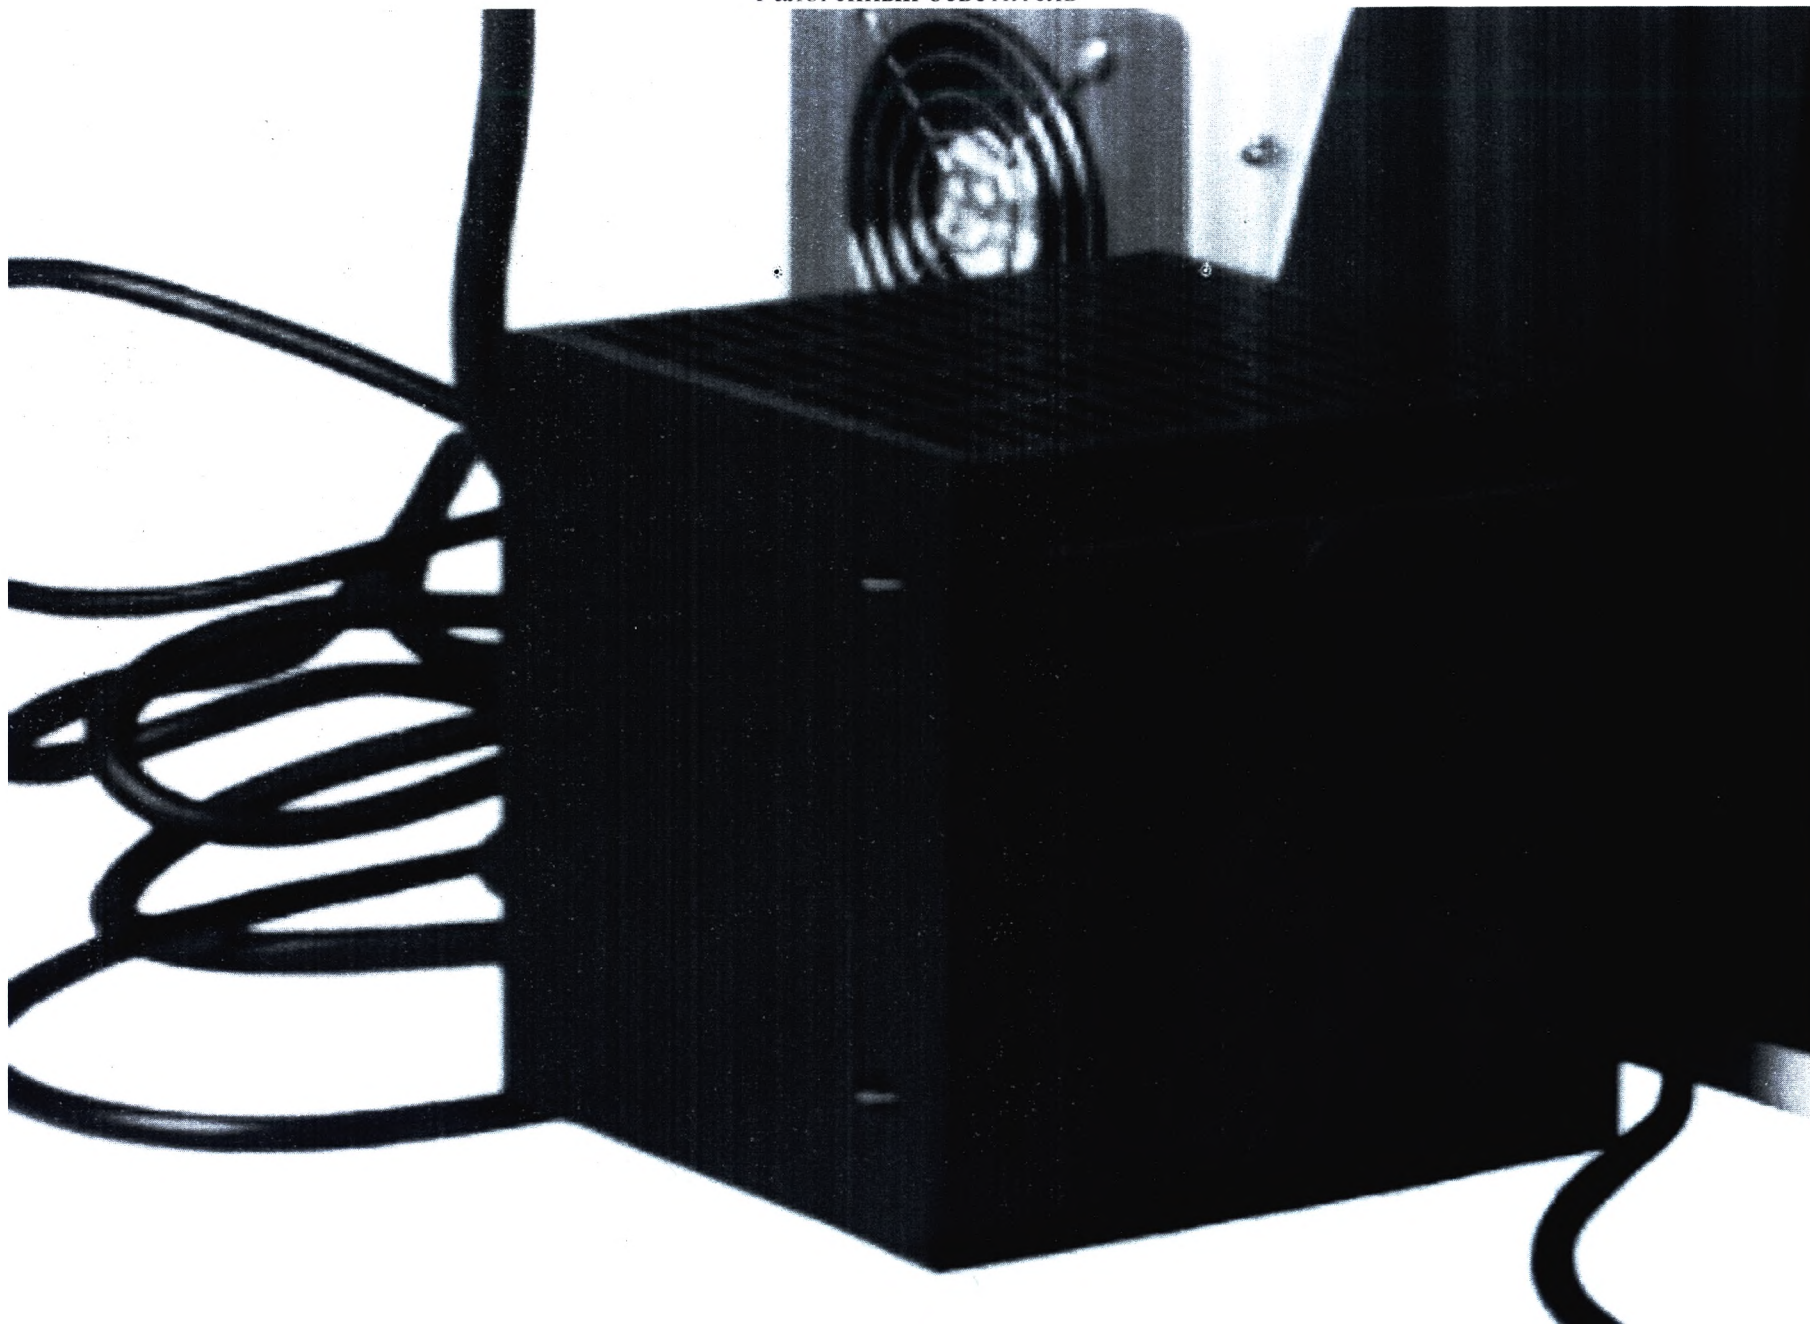


Ртутная лампа с внешним блоком питания




Флуоресцентный модуль (фильтры «G», «B», «BV», «V», «U»)




Светофильтр зеленый, синий, желтый

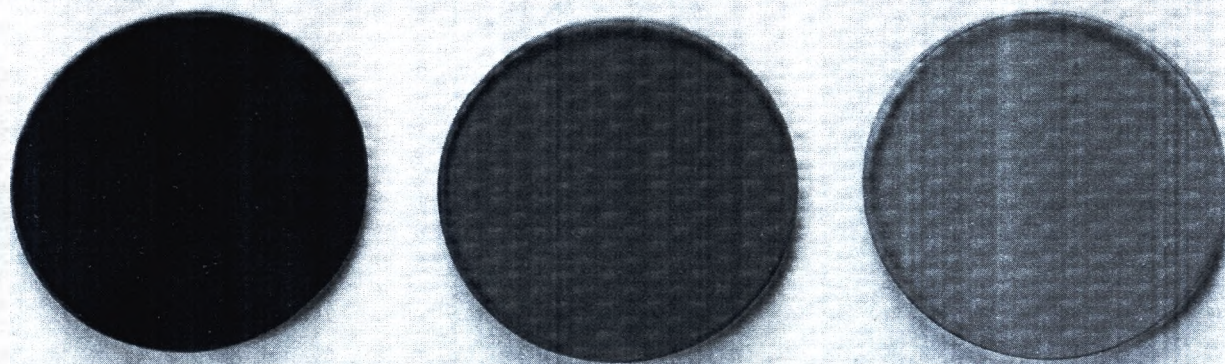

Сетевой кабель

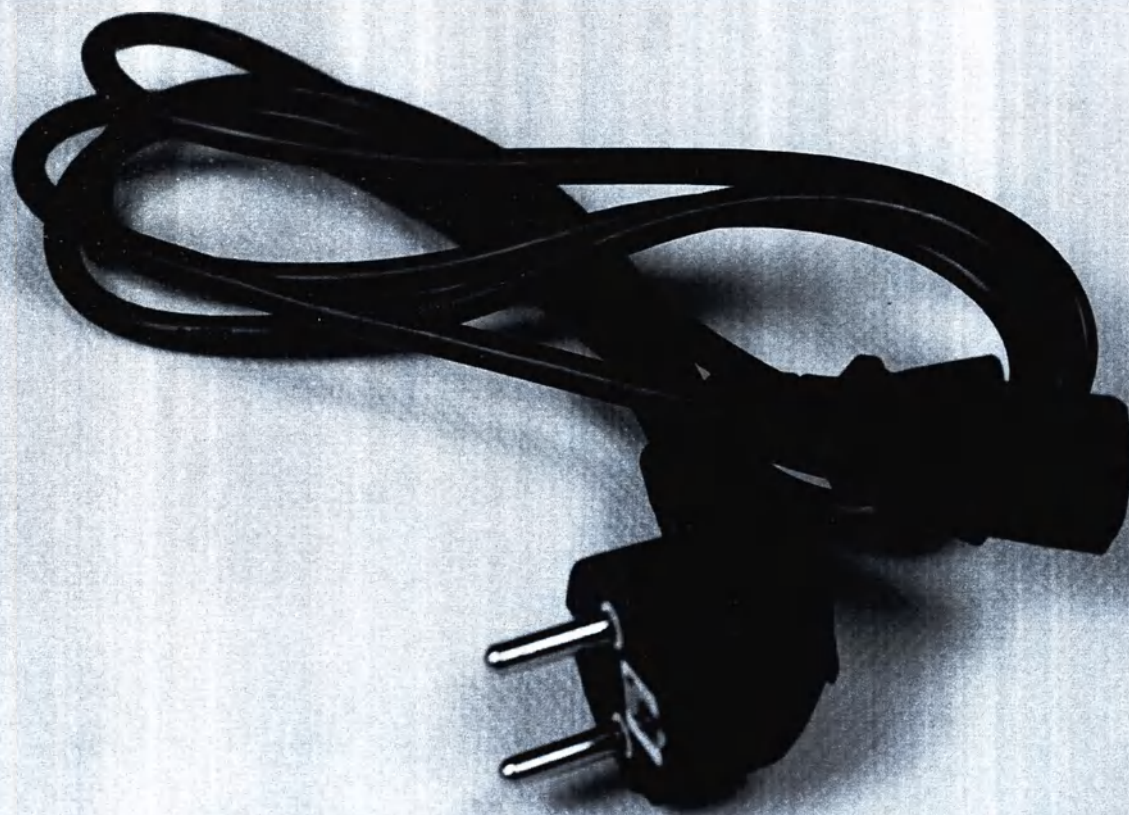

Чехол защитный

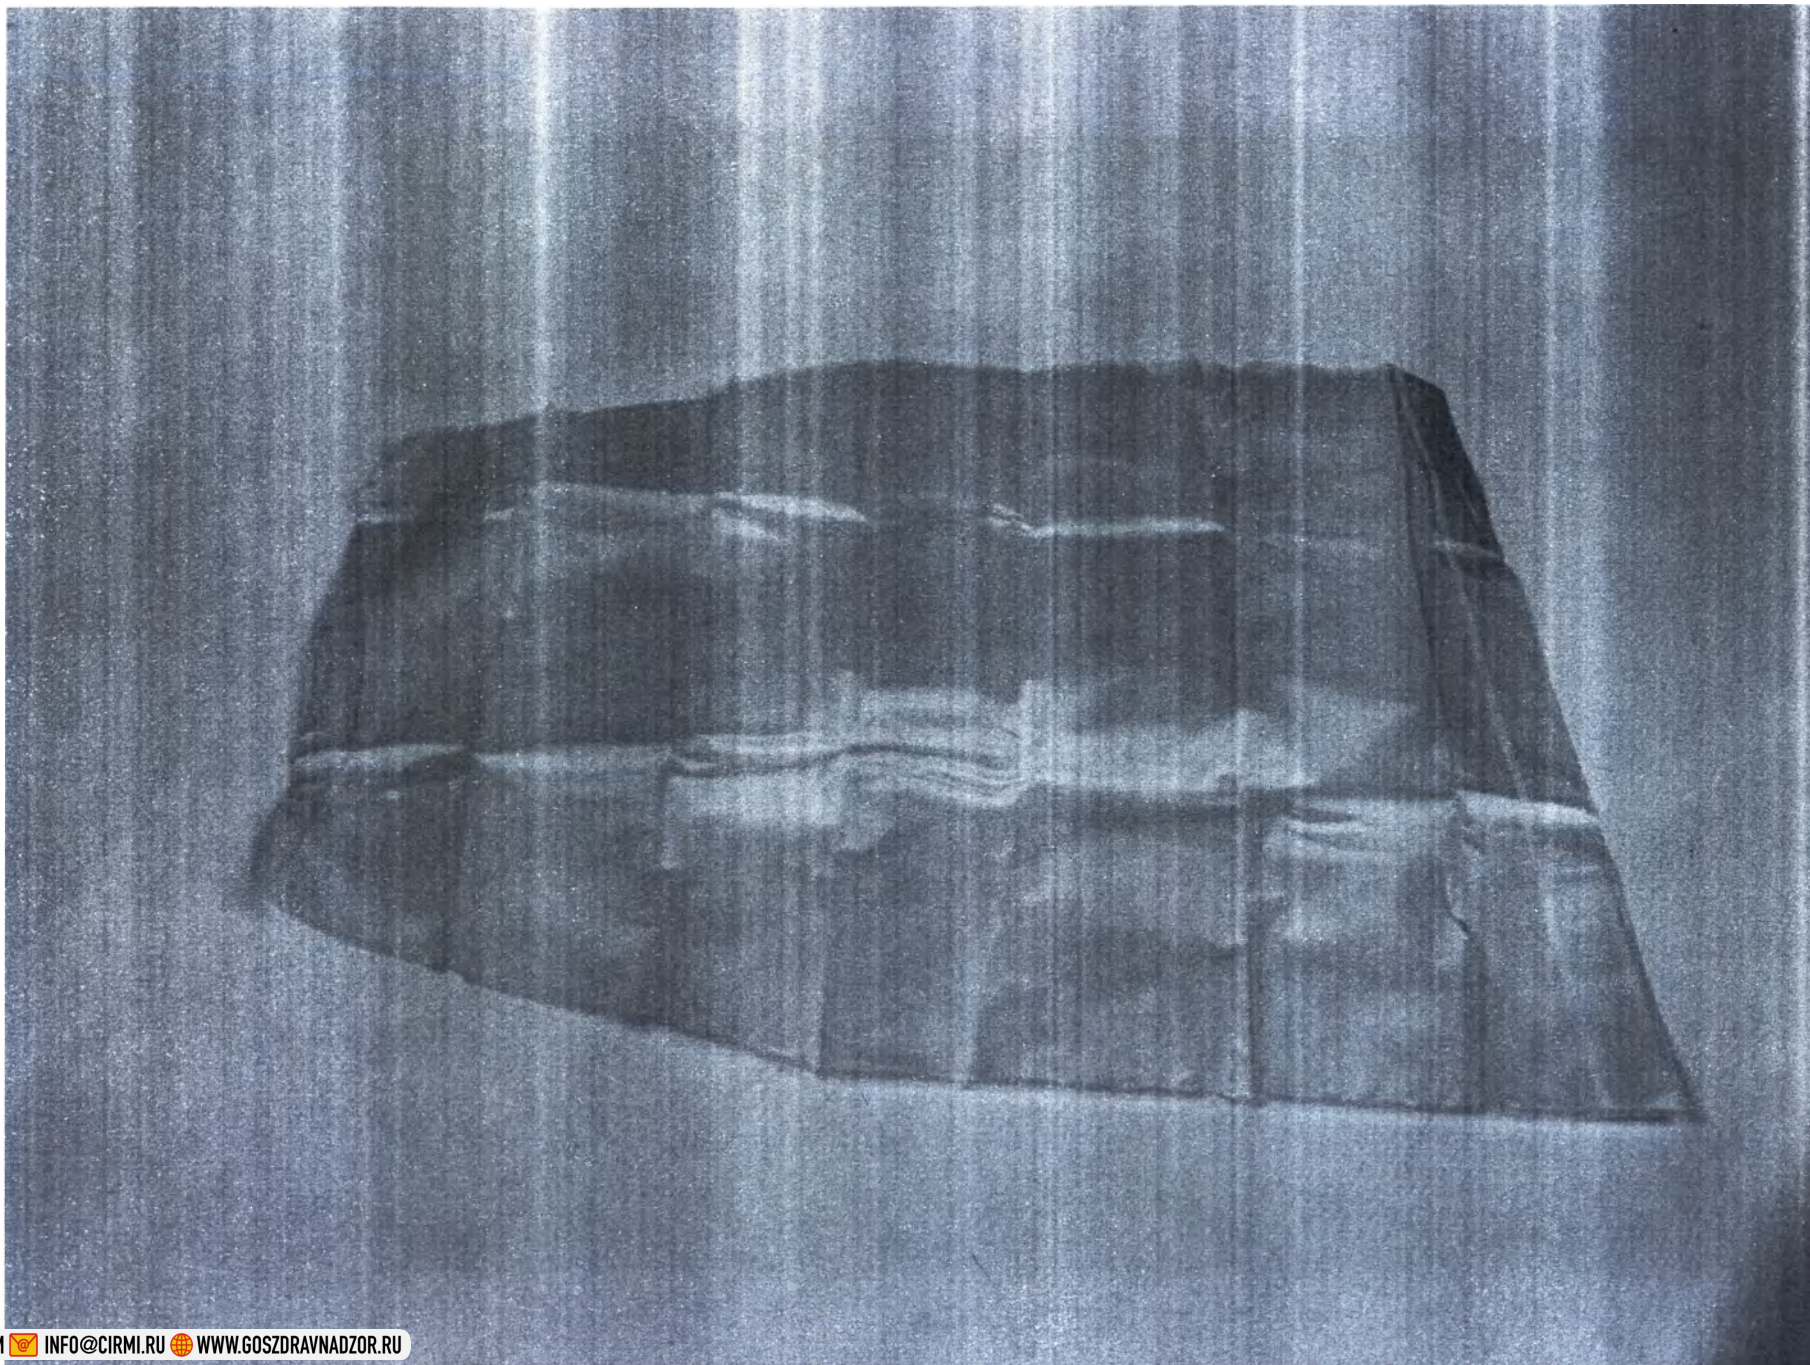

«Микроскоп медицинский флуоресцентный  
«Левенгук» MED PRO 600 Fluor»

ТУ 26.70.22-002- 09587521 -2021

Зав.№:0001


Дата изготовления: 08.03.2021

230±10В, 50/60Гц, ~

LED: 5Вт IP44

265Вт

12V 30W



Рег.уд № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Россия, ОАО «Левенгук», 190005 г.  
Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22  
лит. А

# МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ



«Микроскоп медицинский флуоресцентный

«Левенгук» MED PRO 600 Fluor»

ТУ 26.70.22-002- 09587521 -2021

Зав. №.0001



Дата изготовления: 08.03.2021

## Комплектность:

«Микроскоп медицинский флуоресцентный «Левенгук» MED PRO 600 Fluor»  
ТУ 26.70.22-002- 09587521 -2021, в составе:

1. Штатив – 1 шт.
2. Насадка тринокулярная – 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм – 2 шт.
4. Револьверное устройство на 6 объективов – 1 шт.
5. Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 4х – 1 шт.
6. Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 10х – 1 шт.
7. Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 20х – 1 шт.
8. Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 40х – 1 шт.
9. Предметный столик – 1 шт.
10. Конденсор 1,25 – 1 шт.
11. Газоламповый осветитель – 1 шт.
12. Ртутная лампа с блоком питания лабораторным, артикул YG-100, торговая марка Ориес, производства NINGBO TEACHING INSTRUMENT CO., LTD – 1 шт.
13. Флуоресцентный модуль (фильтры «G», «B», «BV», «V», «U») – 1 шт.
14. Светофильтр желтый – 1 шт.
15. Светофильтр зеленый – 1 шт.
16. Светофильтр синий – 1 шт.
17. Сетевой кабель – 1 шт.
18. Чехол защитный – 1 шт.
19. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

## Условия транспортирования:

Температура от -50°C до +50°C, относительная влажность от 0% до 80%.

## Условия хранения:

Температура от +5°C до +40°C, относительной влажности от 0% до 80%.



Россия, ОАО «Левенгук», 190005 г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22 лит. А

## МАКЕТ МАРКИРОВКИ ШТАТИВА

«Микроскоп медицинский флуоресцентный

«Левенгук» MED PRO 600 Fluo»

ТУ 26.70.22-002- 09587521 -2021

Зав.№:

Дата изготовления:

230±10В, 50/60Гц, ~

LED: 5Вт IP44

265Вт

12V 30W



Рег.уд № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Россия, ОАО «Левенгук», 190005 г.

Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22

лит. А

Маркировка потребительской упаковки:



**«Микроскоп медицинский флуоресцентный «Левенгук» MED PRO 600 Fluor»  
ТУ 26.70.22-002- 09587521 -2021**



Зав.№:

Дата изготовления:

**Комплектность:**

«Микроскоп медицинский флуоресцентный «Левенгук» MED PRO 600 Fluor» ТУ 26.70.22-002- 09587521 -2021, в составе:

1. Штатив – 1 шт.
2. Насадка тринокулярная – 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм — 2 шт.
4. Революционное устройство на 6 объективов – 1 шт.
5. Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 4х – 1 шт.
6. Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 10х – 1 шт.
7. Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 20х – 1 шт.
8. Планахроматический люминесцентный (флуоресцентный) объектив: 40х – 1 шт.
9. Предметный столик – 1 шт.
10. Конденсор 1,25 – 1 шт.
11. Галогенный осветитель – 1 шт.
12. Ртутная лампа с блоком питания лабораторным, артикул YG-100, торговая марка Optites, производства NINGBO TEACHING INSTRUMENT CO., LTD – 1 шт.
13. Флуоресцентный модуль (фильтры «С», «В», «BV», «V», «U») – 1 шт.
14. Светофильтр желтый – 1 шт.
15. Светофильтр зеленый – 1 шт.
16. Светофильтр синий – 1 шт.
17. Сетевой кабель – 1 шт.
18. Чехол защитный – 1 шт.
19. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

**Условия транспортирования:**

Температура от -50°C до +50°C, относительная влажность от 0% до 80%.

**Условия хранения:**

Температура от +5°C до +40°C, относительной влажности от 0% до 80%.



Россия, ОАО «Левенгук», 190005 г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22 лит. А

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 21 лист

Должность

Подпись



*Директор*  
*Иванов А.В.*