

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Левенгук»

Елифанов А.В.



15» 07 20 21.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Микроскоп медицинский лабораторный «Левенгук»

ТУ 26.70.22-001- 09587521 -2021

Производитель: ОАО «Левенгук», 190005 г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22
лит. А

2022

Микроскоп медицинский лабораторный «Левенгук» MED 45 В, бинокулярный, (арт.74008), в собранном виде на опорной стойке (штативе)



Микроскоп медицинский лабораторный «Левенгук» MED 45T, тринокулярный, (арт.74009), в собранном виде на опорной стойке (штативе)



Микроскоп медицинский лабораторный цифровой «Левенгук» MED D45T, тринокулярный, (арт.74010)
собранным виде на опорной стойке (штативе)



Микроскоп медицинский лабораторный цифровой «Левенгук» MED D45T LCD, тринокулярный (арт.74011), в собранном виде на опорной стойке (штативе)



Насадка бинокля ярная



Насадка тринокулярная




Орхип 10х/22 мм




Револьверное устройство на 5 объективов




Предметный столик

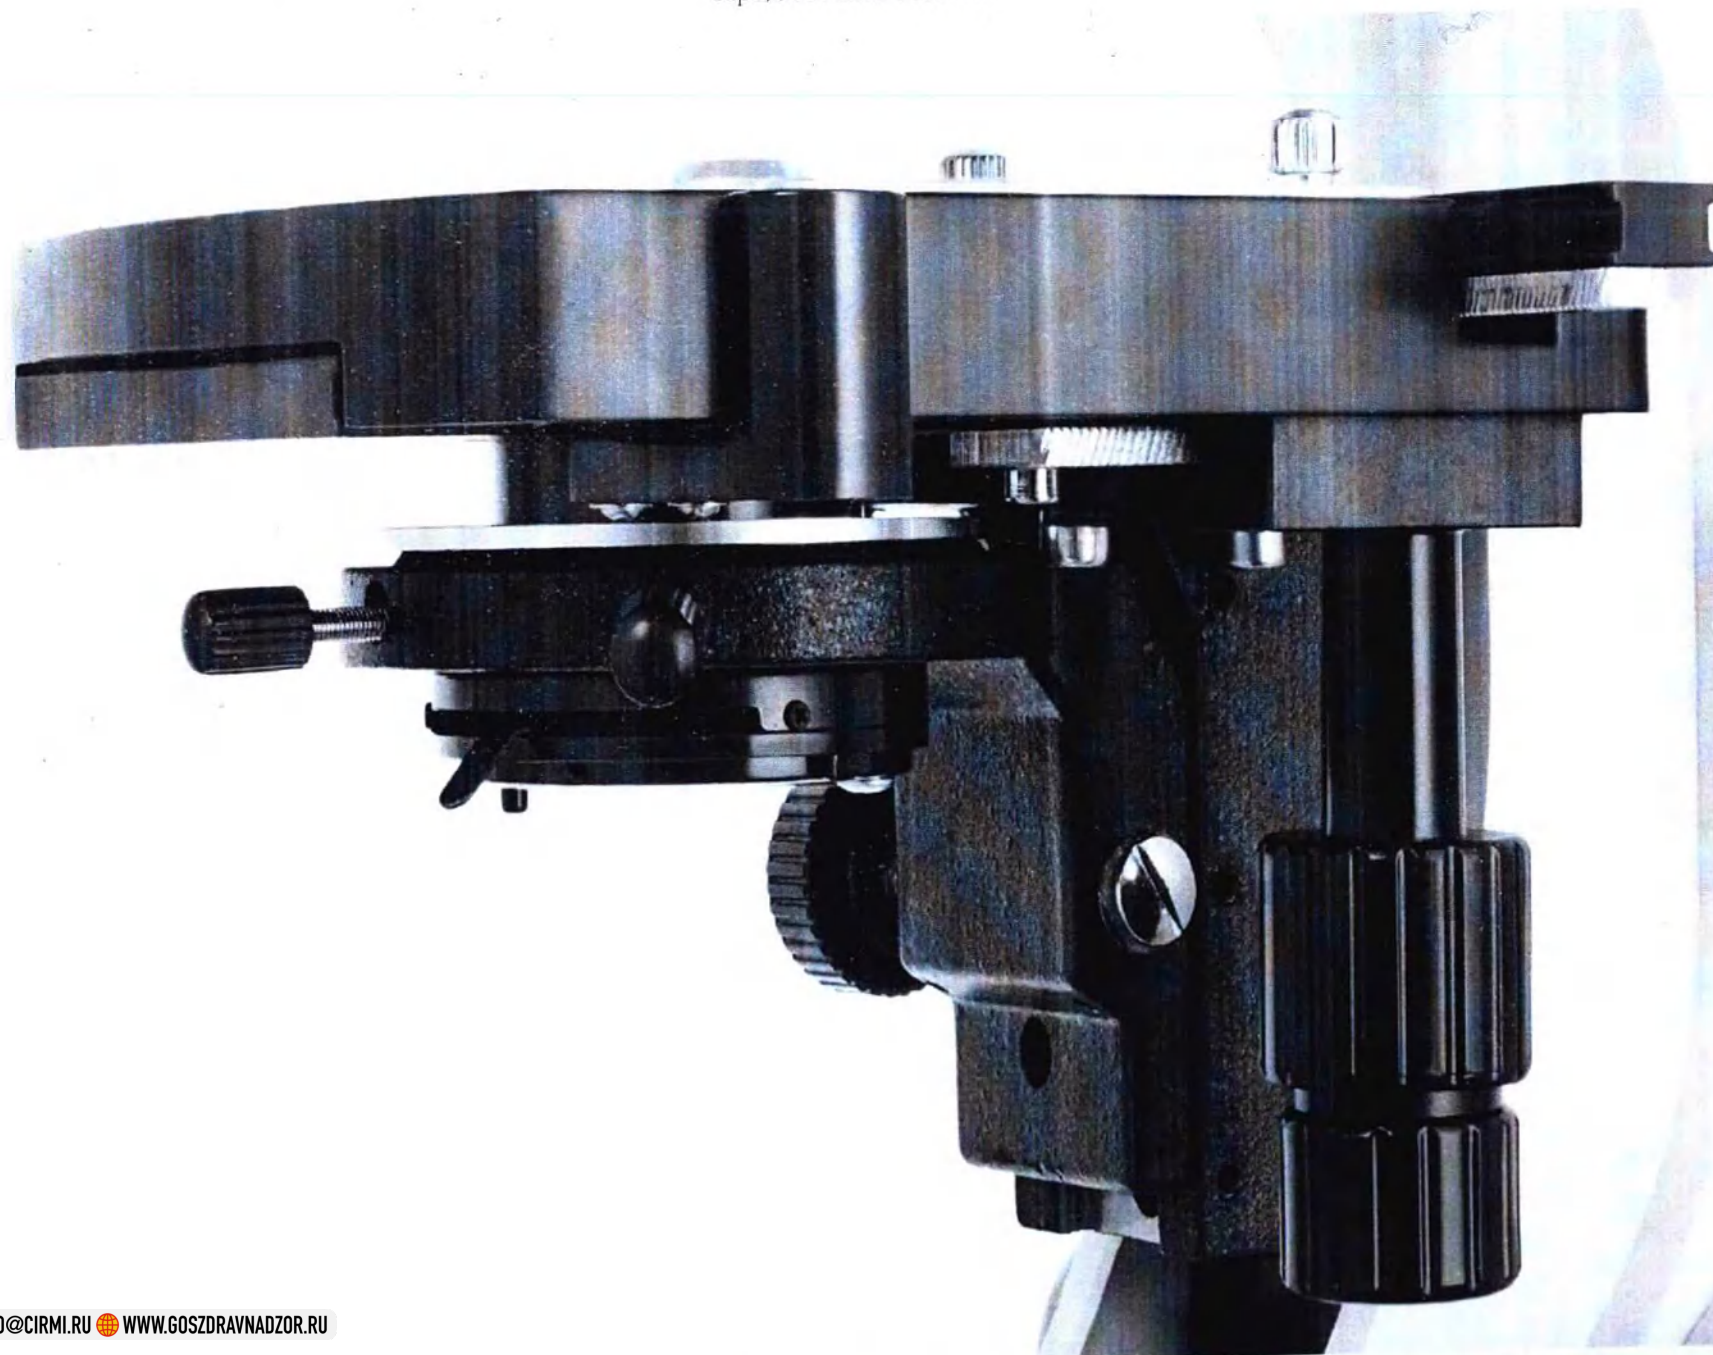


Фазово-контрастный набор в составе: апланхроматические объективы, скорректированные на бесконечность, 4х, 10х, 40хs, 100хs; фазово-контрастный конденсор 1.25, вспомогательный микроскоп

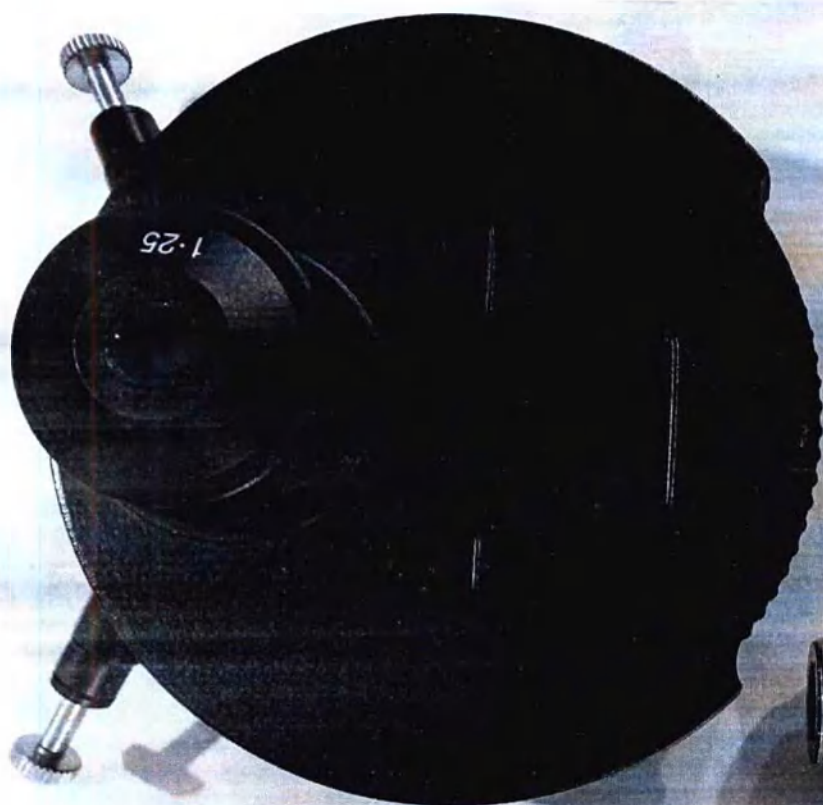


Светодиодная лампа

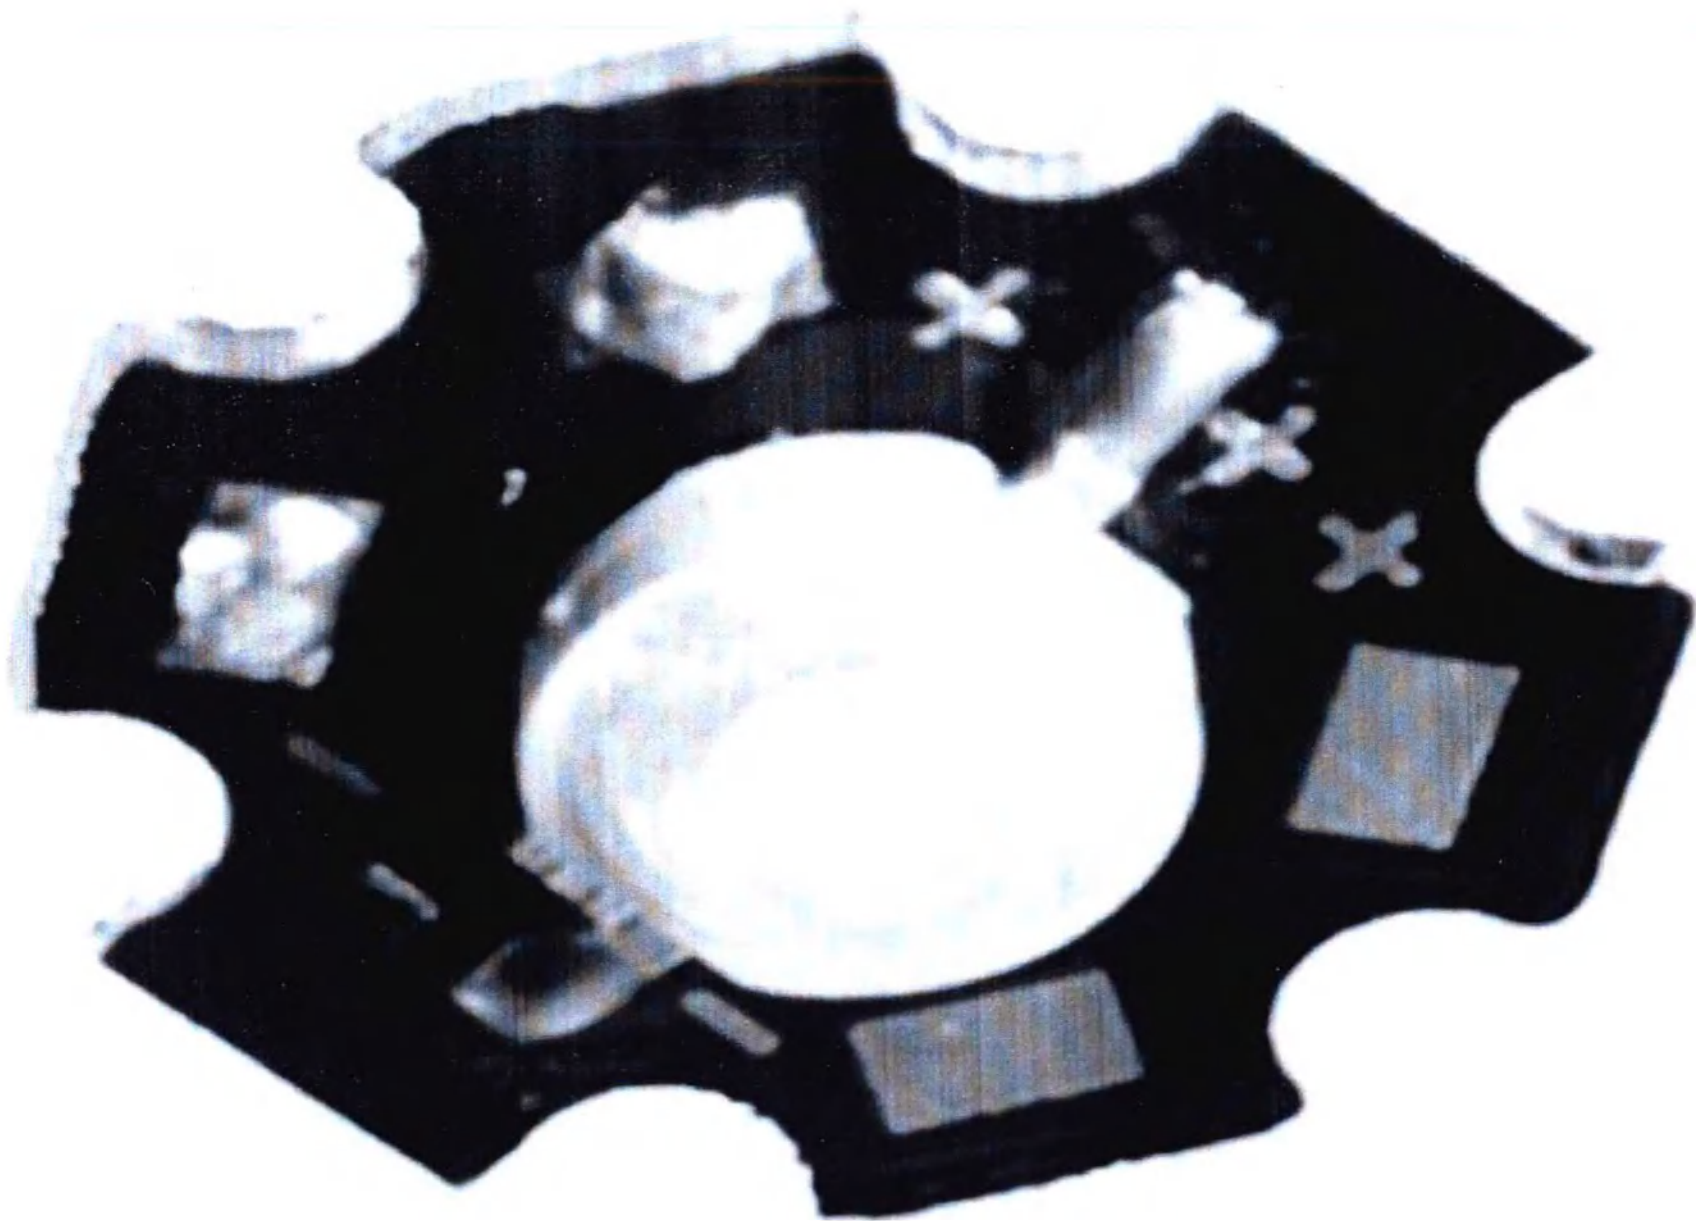


Сетевой кабель

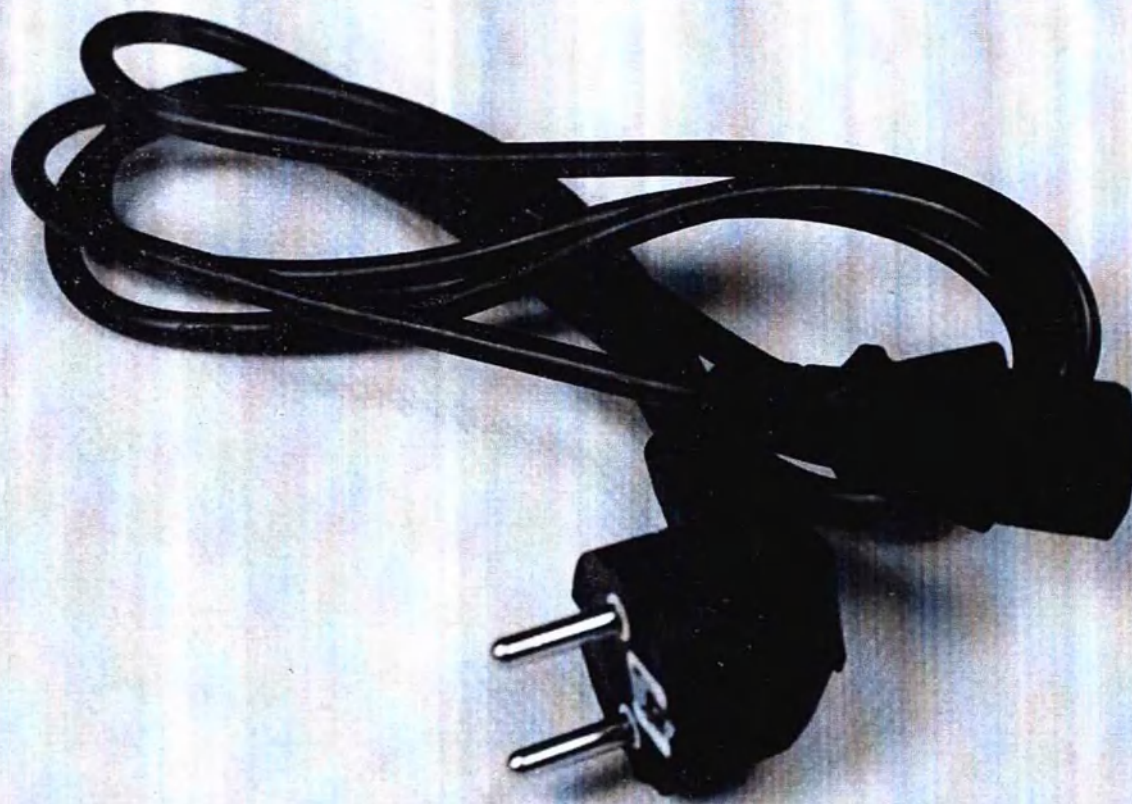

Светофильтр зеленый, синий, желтый

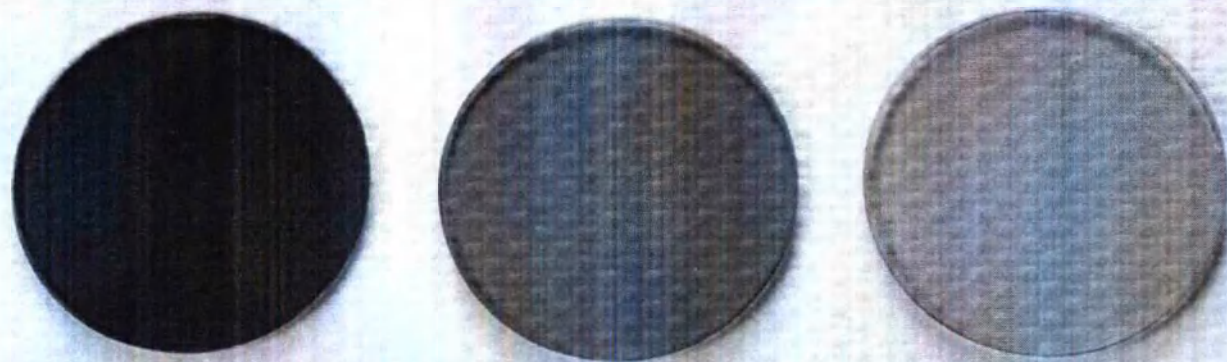


Чехол защитный

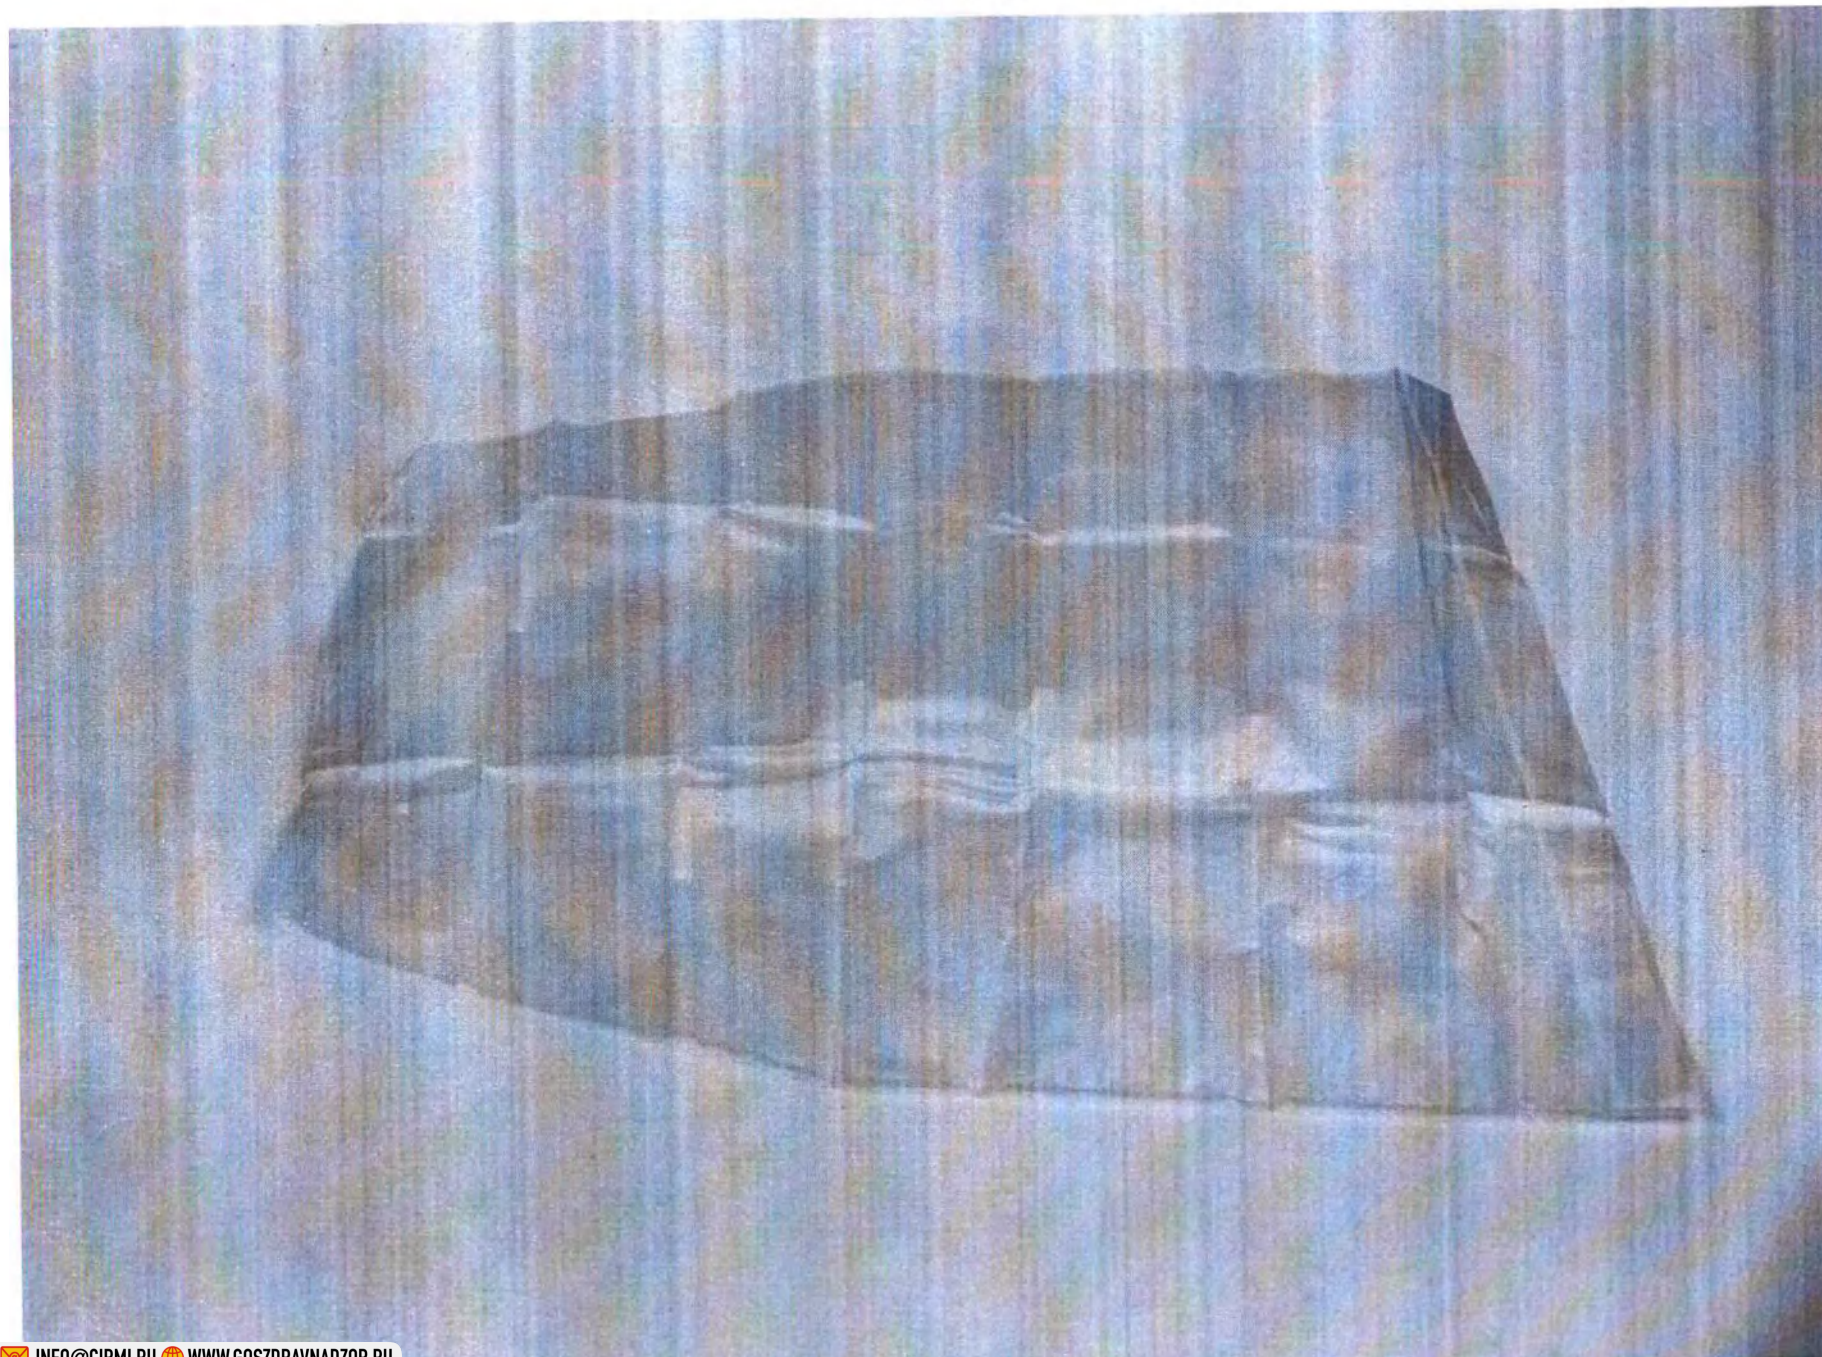

Камера цифровая 16 Мпикс



Цифровая камера 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры

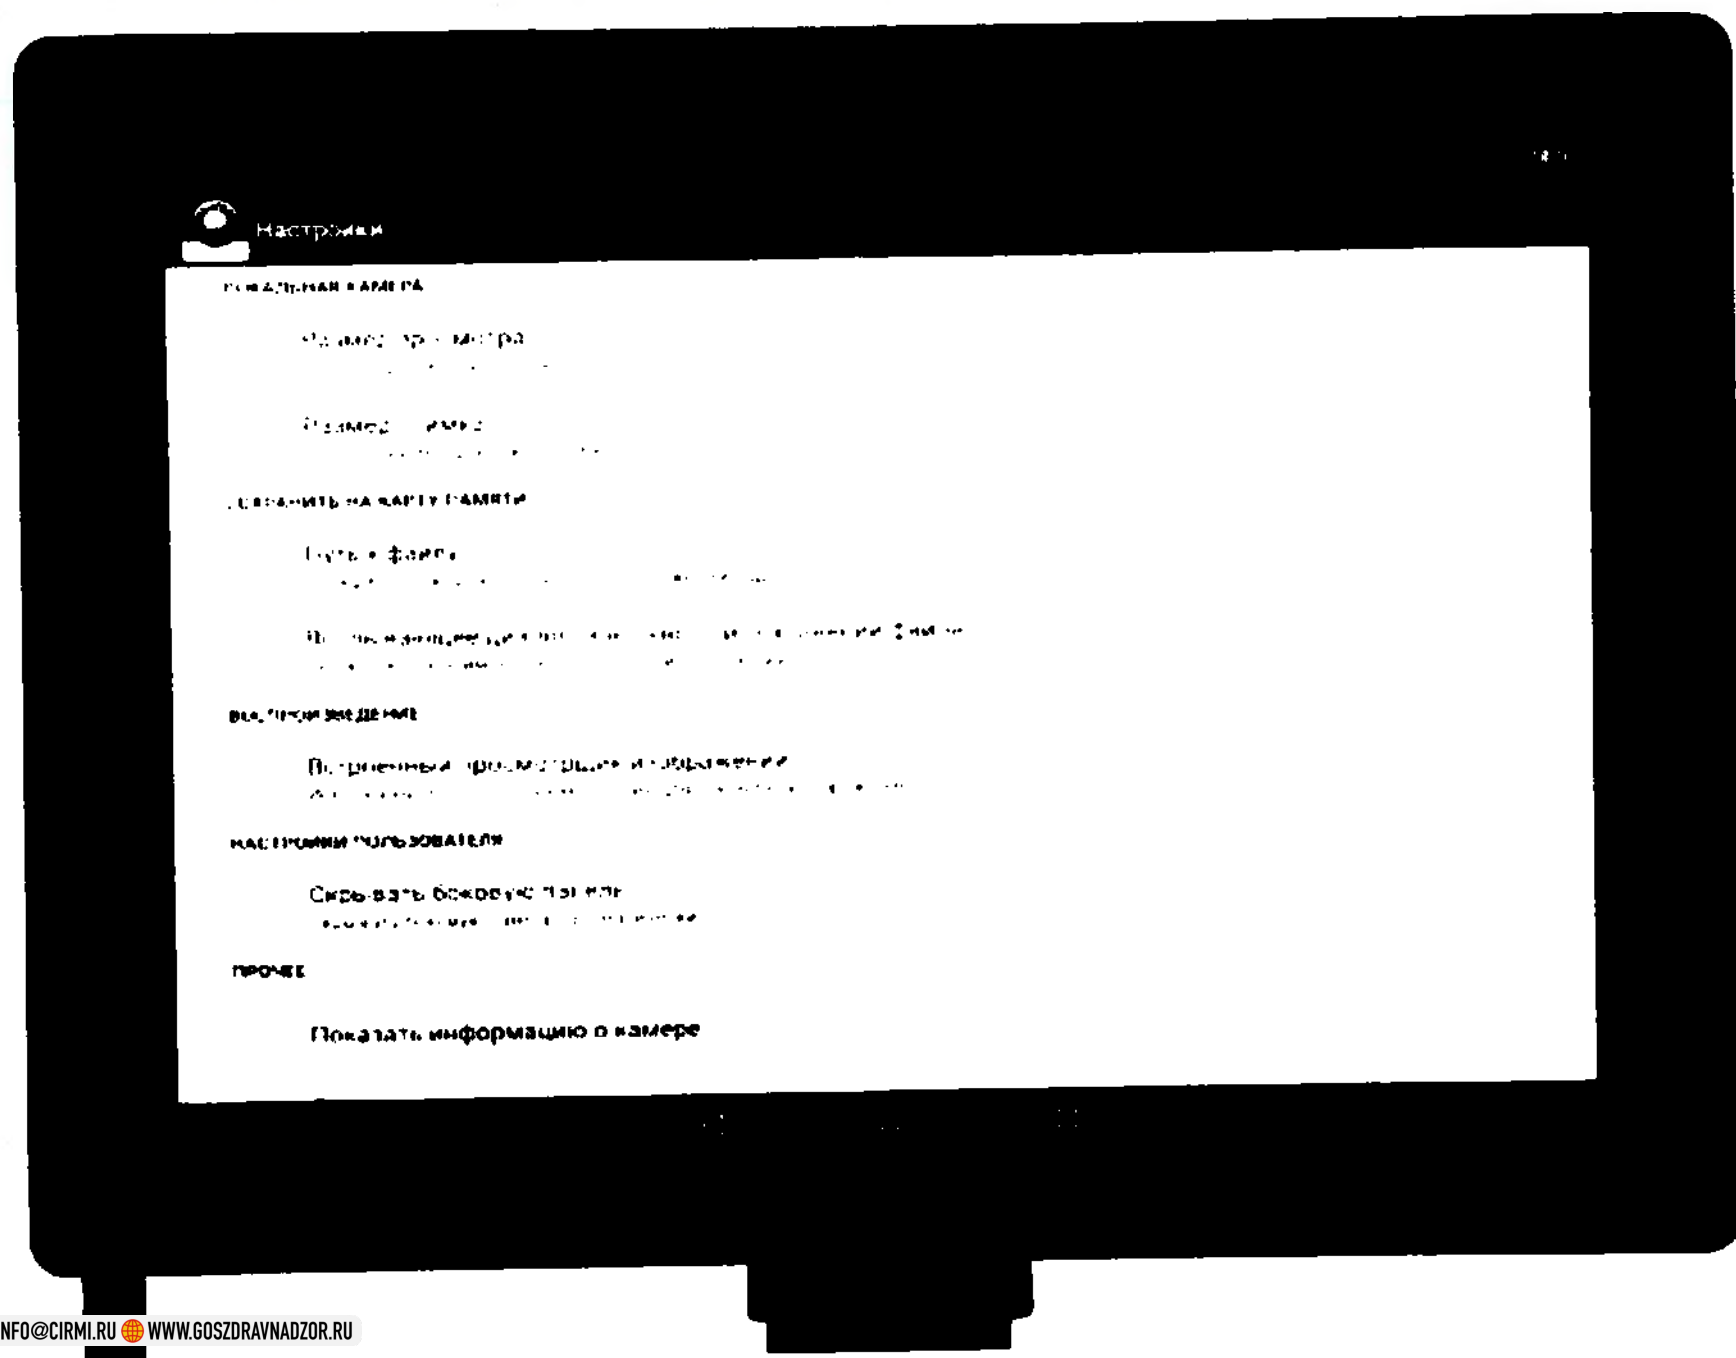

МАРКИРОВКА ШТАТИВА

«Микроскоп медицинский
лабораторный «Левенгук»
IU 26.70.22-001- 09587521 -2021

Вариант исполнения
MED D45T LCD, тринокулярный (арт
74011)

Зав. № 0001


Дата изготовления 08.03.2021

230±10В, 50-60Гц.

LED-5Вт

IP44

265Вт



Рег. №

от



Россия, ОАО «Левенгук», 190005
г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д.
22 лит. А



МАКЕТ МАРКИРОВКИ ШТАТИВА

«Микроскоп медицинский лабораторный
«Левенгук»
ТУ 26.70.22-001- 09587521 -2021

Вариант исполнения:

Зав.№:

Дата изготовления:

230±10В, 50/60Гц, ~

LED: 5Вт

IP44


265Вт



Рег.уд № _____ от _____



Россия, ОАО «Левенгук», 190005 г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22 лит. А



«Микроскоп медицинский лабораторный «Левенгук»

ТУ 26.70.22-001- 09587521 -2021

Зав.№:0001

Дата изготовления: 08.03.2021

Вариант исполнения:

MED D45T LCD, тринокулярный (арт. 74011)

Комплектность:

«Микроскоп медицинский лабораторный «Левенгук» MED D45T LCD, тринокулярный, (арт.74011), в составе:

1. Опорная стойка (штатив) - 1 шт.
2. Насадка тринокулярная - 1 шт.
3. Окуляр 10х/22 мм - 2 шт.
4. Револьверное устройство на 5 объективов - 1 шт.
5. Предметный столик - 1 шт.
6. Фазово-контрастный набор в составе: плахроматические объективы, скорректированные на бесконечность, 4х, 10х, 40хs, 100хs; фазово-контрастный конденсор 1,25; вспомогательный микроскоп - 1 шт.
7. Светодиодная лампа - 1 шт.
8. Сетевой кабель - 1 шт.
9. Светофильтр зеленый - 1 шт.
10. Светофильтр синий - 1 шт.
11. Светофильтр желтый - 1 шт.
12. Чехол защитный - 1 шт.
13. Цифровая камера 5 Мпикс с ЖК-экраном с креплением и сетевым шнуром для питания камеры - 1 шт.
14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Условия транспортирования:

Температура от -50°C до +50°C, относительная влажность от 0% до 80%.

Условия хранения:

Температура от +5°C до +40°C, относительной влажности от 0% до 80%.



Россия, ОАО «Левенгук», Россия, 190005 г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22 лит. А



**«Микроскоп медицинский лабораторный «Левеншук»
ТУ 26.70.22-001- 09587521 -2021**

Вариант исполнения:

Зав.№:

Дата изготовления:

Комплектность:

Условия транспортирования:

Температура от -50°C до +50°C, относительная влажность от 0% до 80%.

Условия хранения:

Температура от +5°C до +40°C, относительной влажности от 0% до 80%.



Россия, ОАО «Левеншук», Россия, 190005 г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д.

22 лнп. А

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью 23 листа
Должность Генеральный директор ООО "Левентик"
Подпись Евгений В. А.

