


«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор
ООО «ПРОФИТ ФАРМ»
А.Ю. Осинцев





Фотографические изображения общего вида, фотографические изображения упаковки и макета маркировки медицинского изделия

Автоматический экстрактор компонентов крови по ТУ 32.50.50-011-18833344-2021

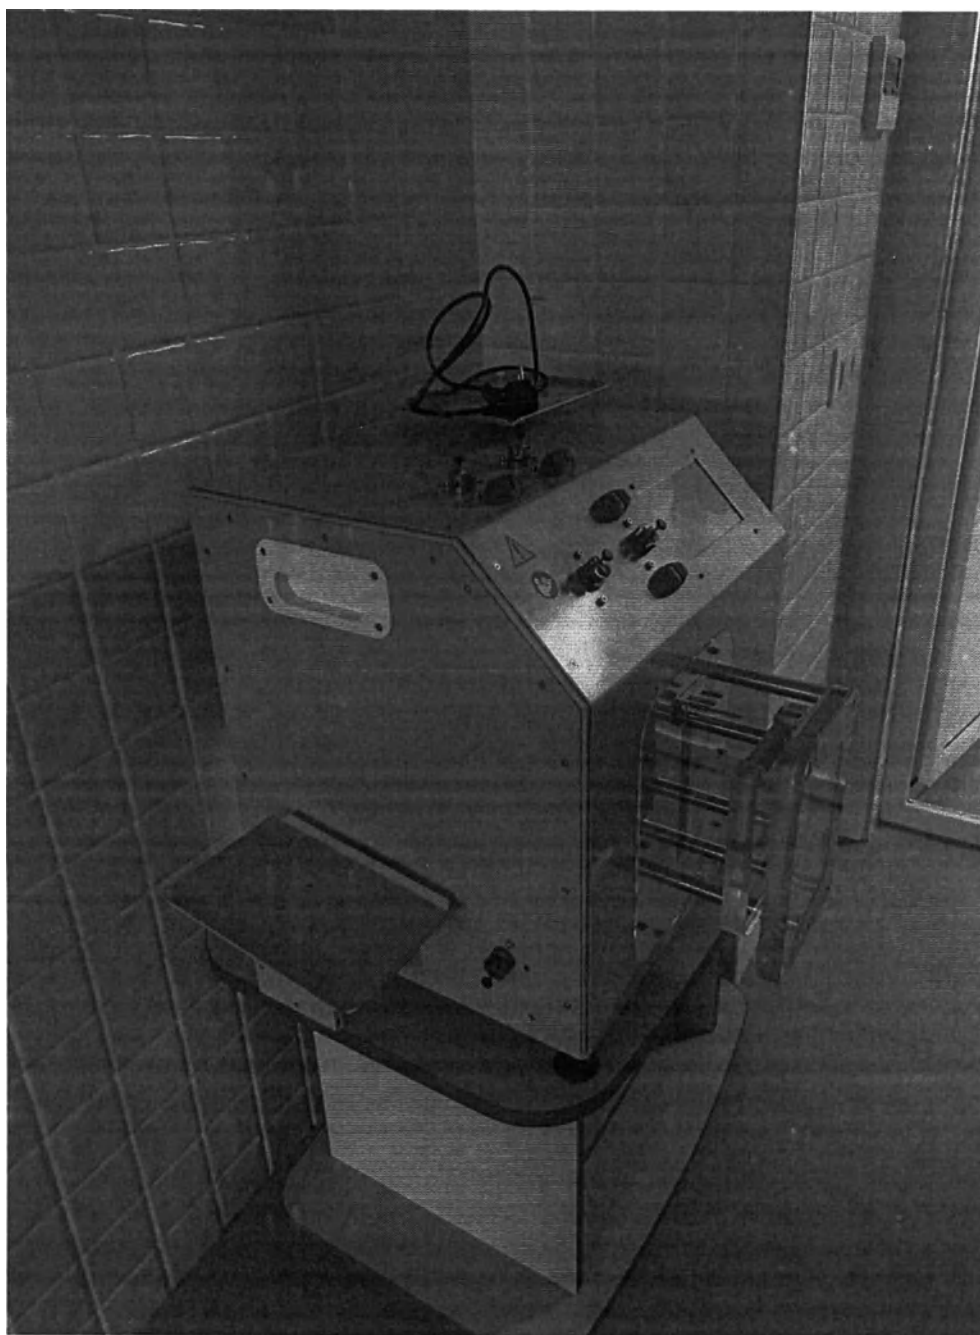

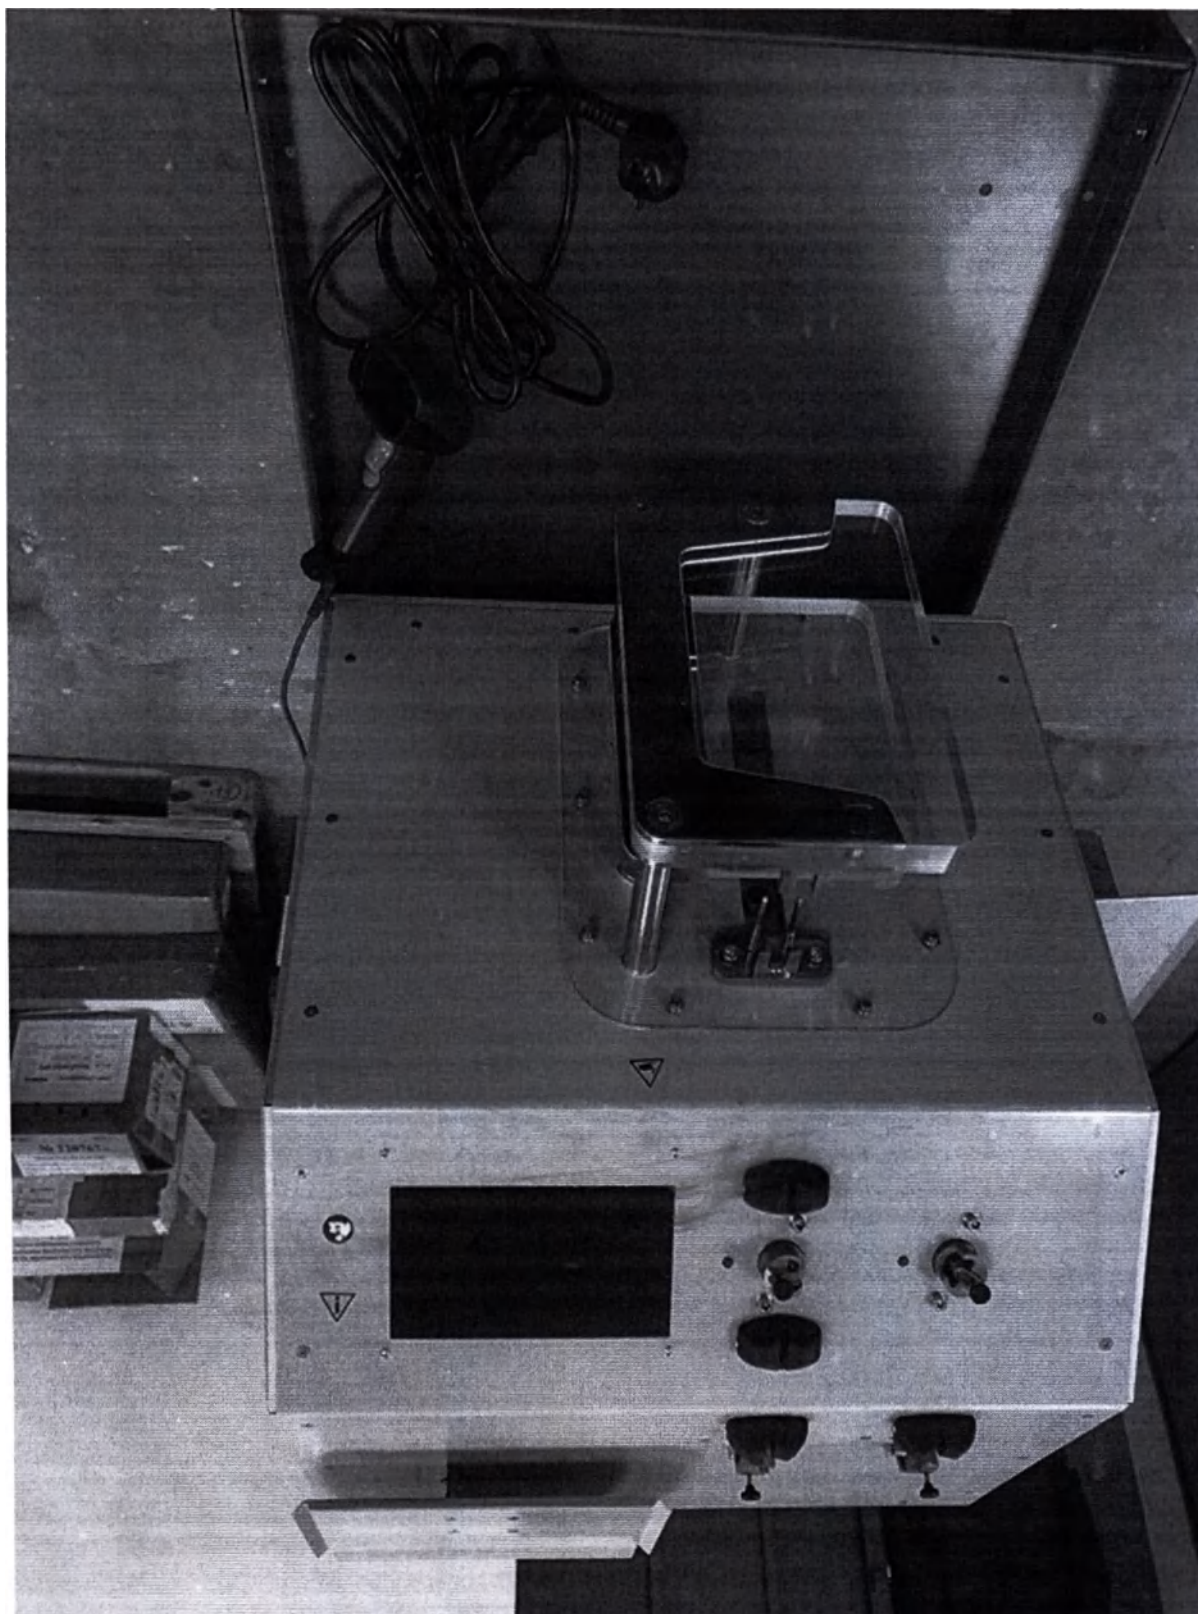

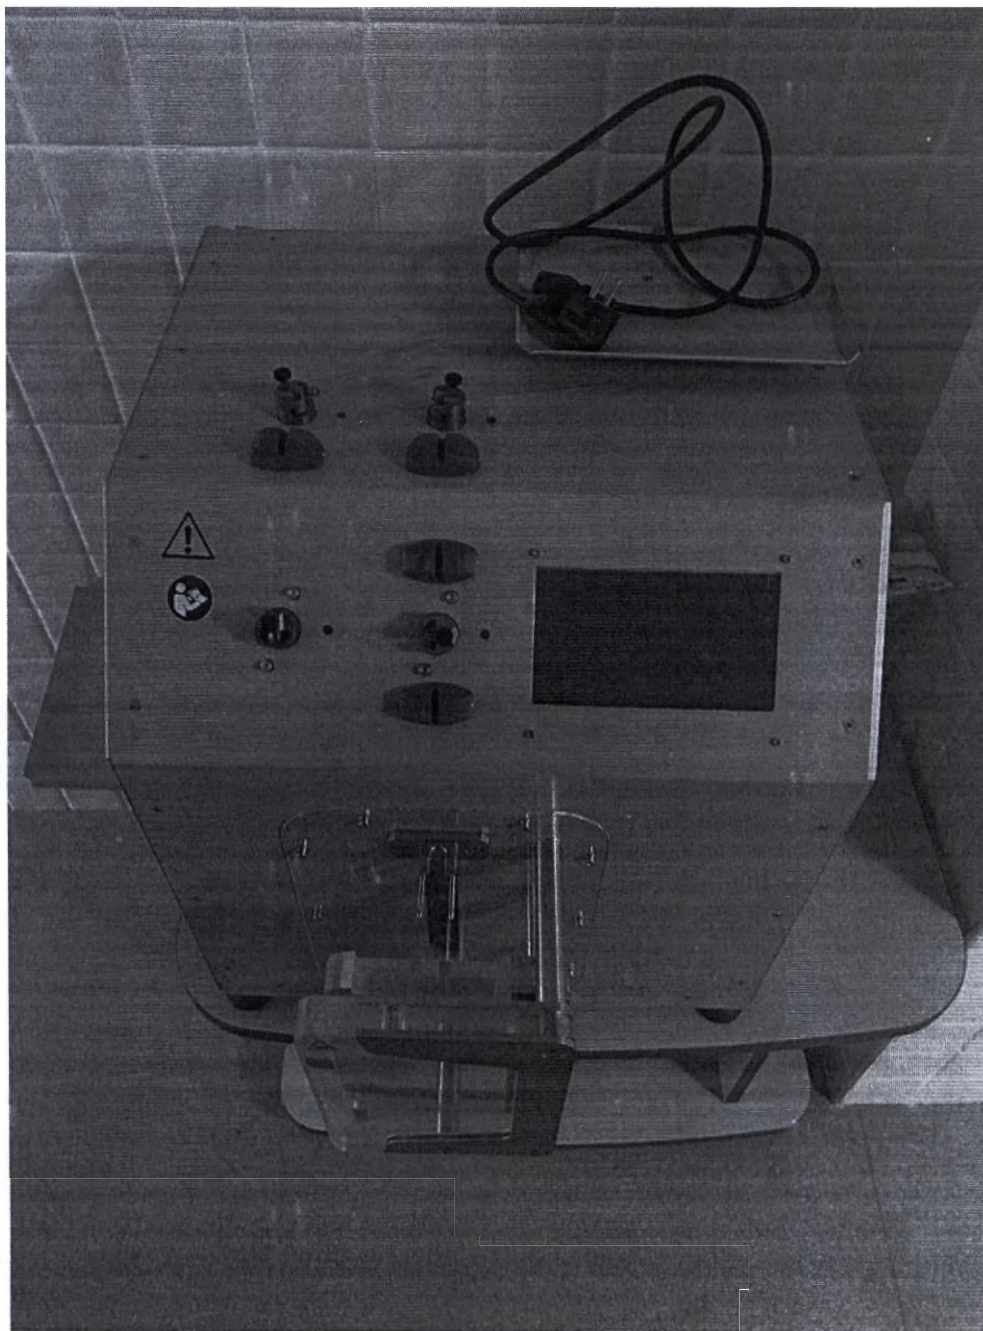

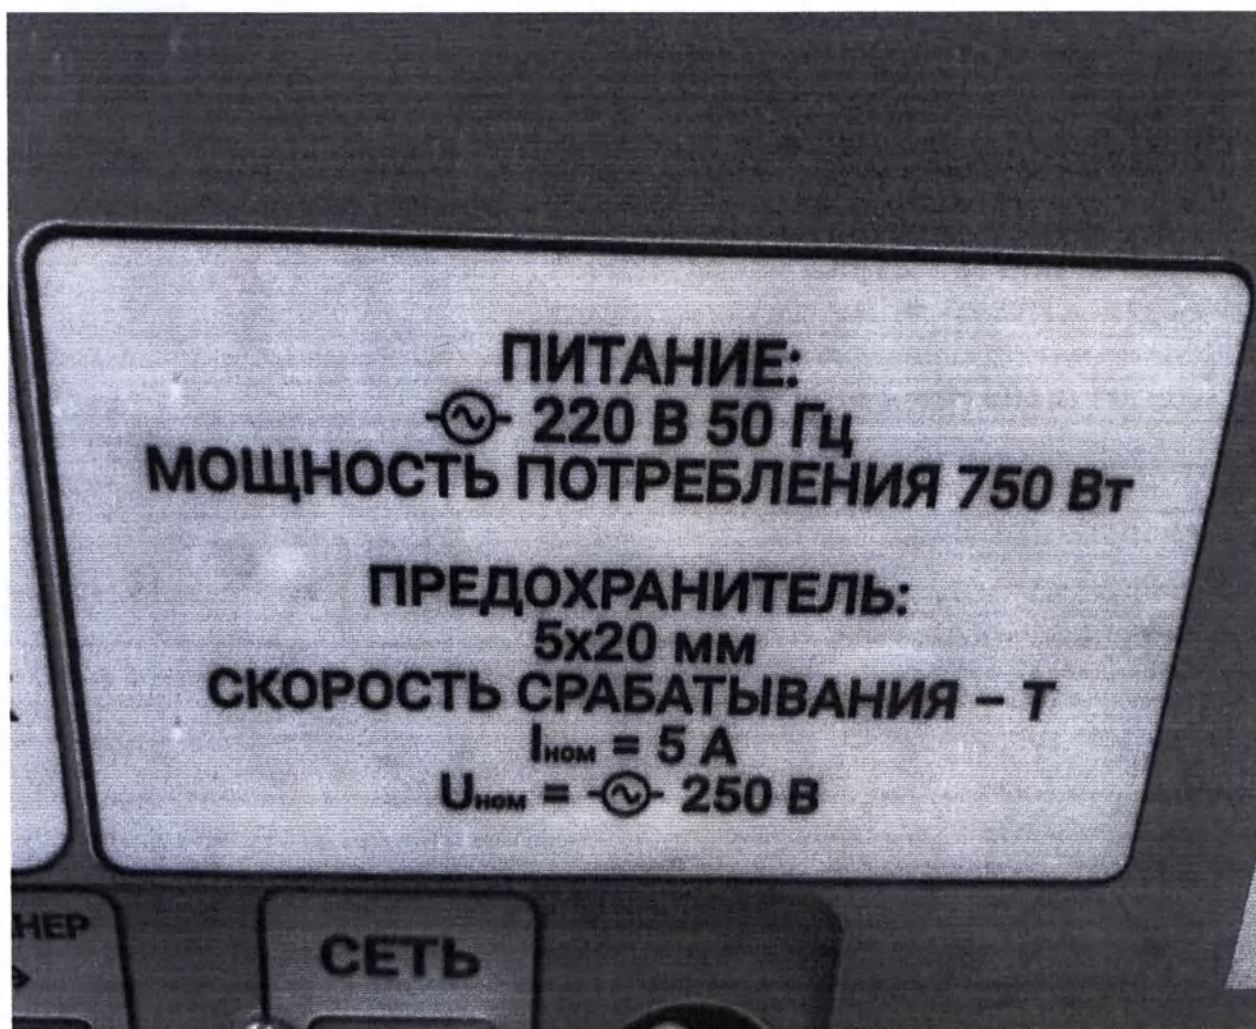

наименование изделия	Автоматический экстрактор компонентов крови по ТУ 32.50.50-011-18833344-2021, в составе: 1. Автоматический экстрактор компонентов крови MMS-0501 – 1 шт.; 2. Кабель питания – 1 шт.; 3. Сканер штрих-кодов – 1 шт.; 4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.; 5. Паспорт – 1 шт.
номер серии	
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак	ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4
месяц и год упаковывания	...-....
дата истечения срока годности	...-....
условия хранения и транспортирования	Условия транспортирования изделий должны соответствовать: температура – от минус 5°C до плюс 35°C; относительная влажность – от 80% при температуре 25 °C; атмосферное давление – от 70 кПа до 106 кПа. Хранение АППАРАТА у изготовителя и потребителя должно осуществляться в оригинальной упаковке производителя в соответствии с условиями хранения: температура – от минус 5°C до плюс 35°C; относительная влажность – от 80% при температуре 25 °C; атмосферное давление – от 70 кПа до 106 кПа.
Масса брутто, кг	
Масса нетто, кг	
	



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 1 лист(ов)

Генеральный директор

ООО "ПРОФИТ ФАРМ" Овчинцев А.Ю.

20 20 г.

