

Фотографические изображения

«Реагенты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), в вариантах исполнения»

тенты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях
 иммунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 100
 тестов



агенты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях
иммунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 100
тестов



агенты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях
иммунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 100
тестов



Elecsys®


реагенты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 100 тестов




...енты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
...мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях
...мунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 100
...стов




реагенты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях
иммунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FP5A), вариант исполнения 100
местов

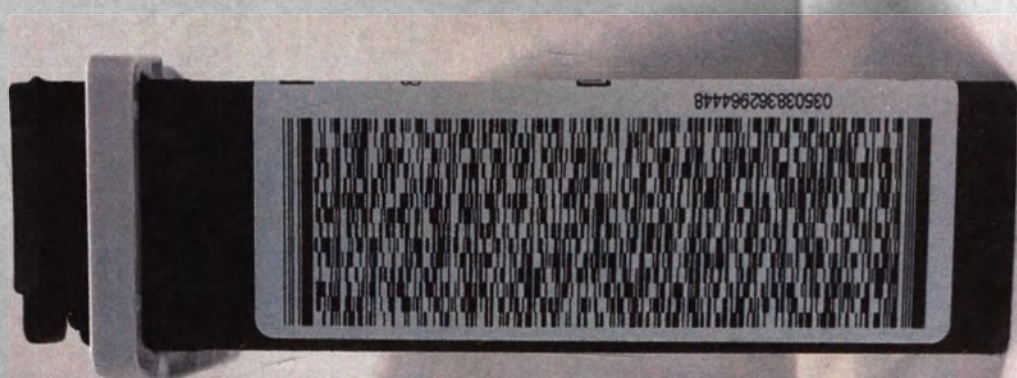


менты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
флуоресцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях
химических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 100
стов

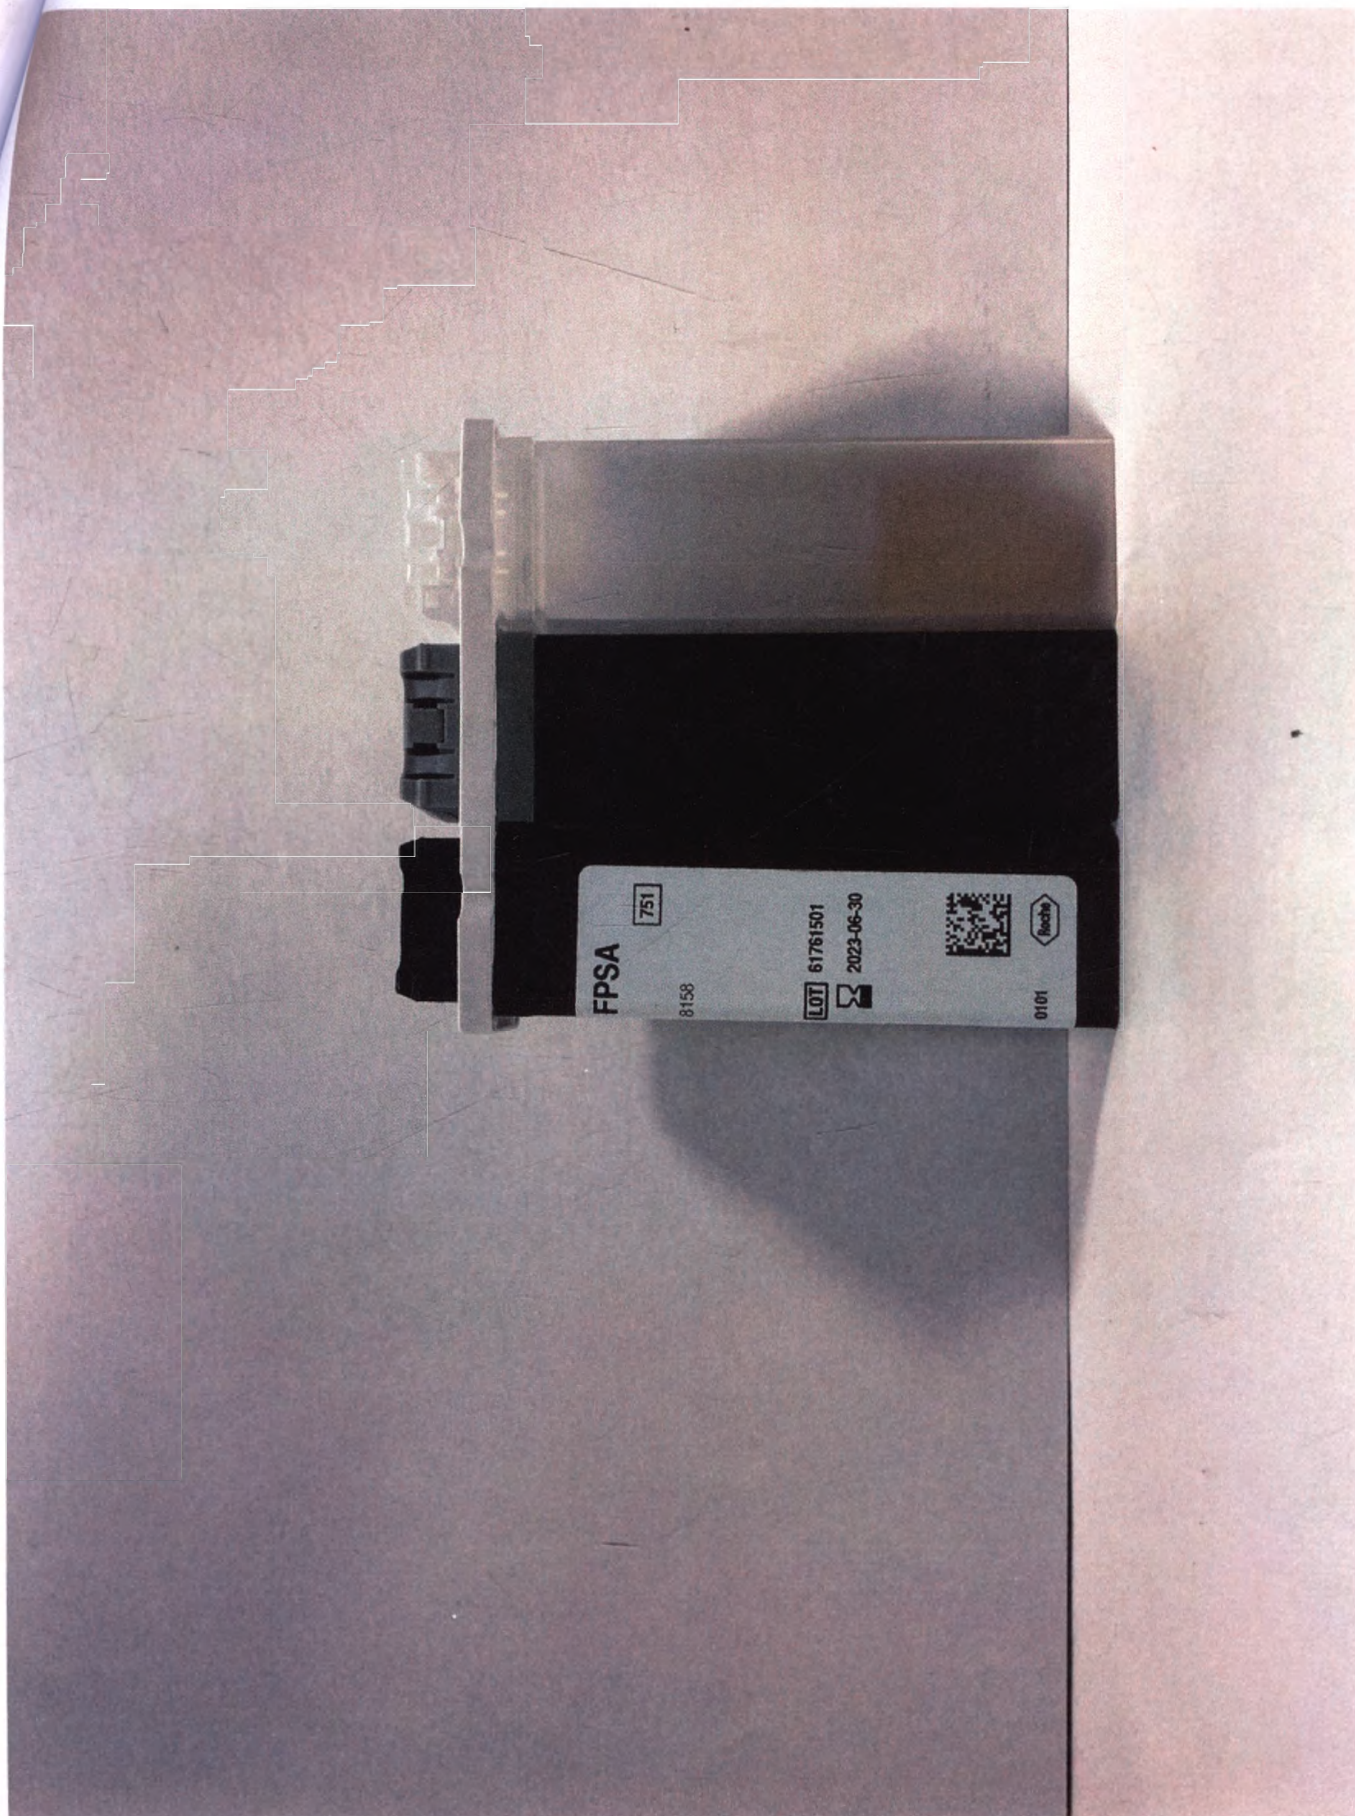

менты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях
мунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 100
стов

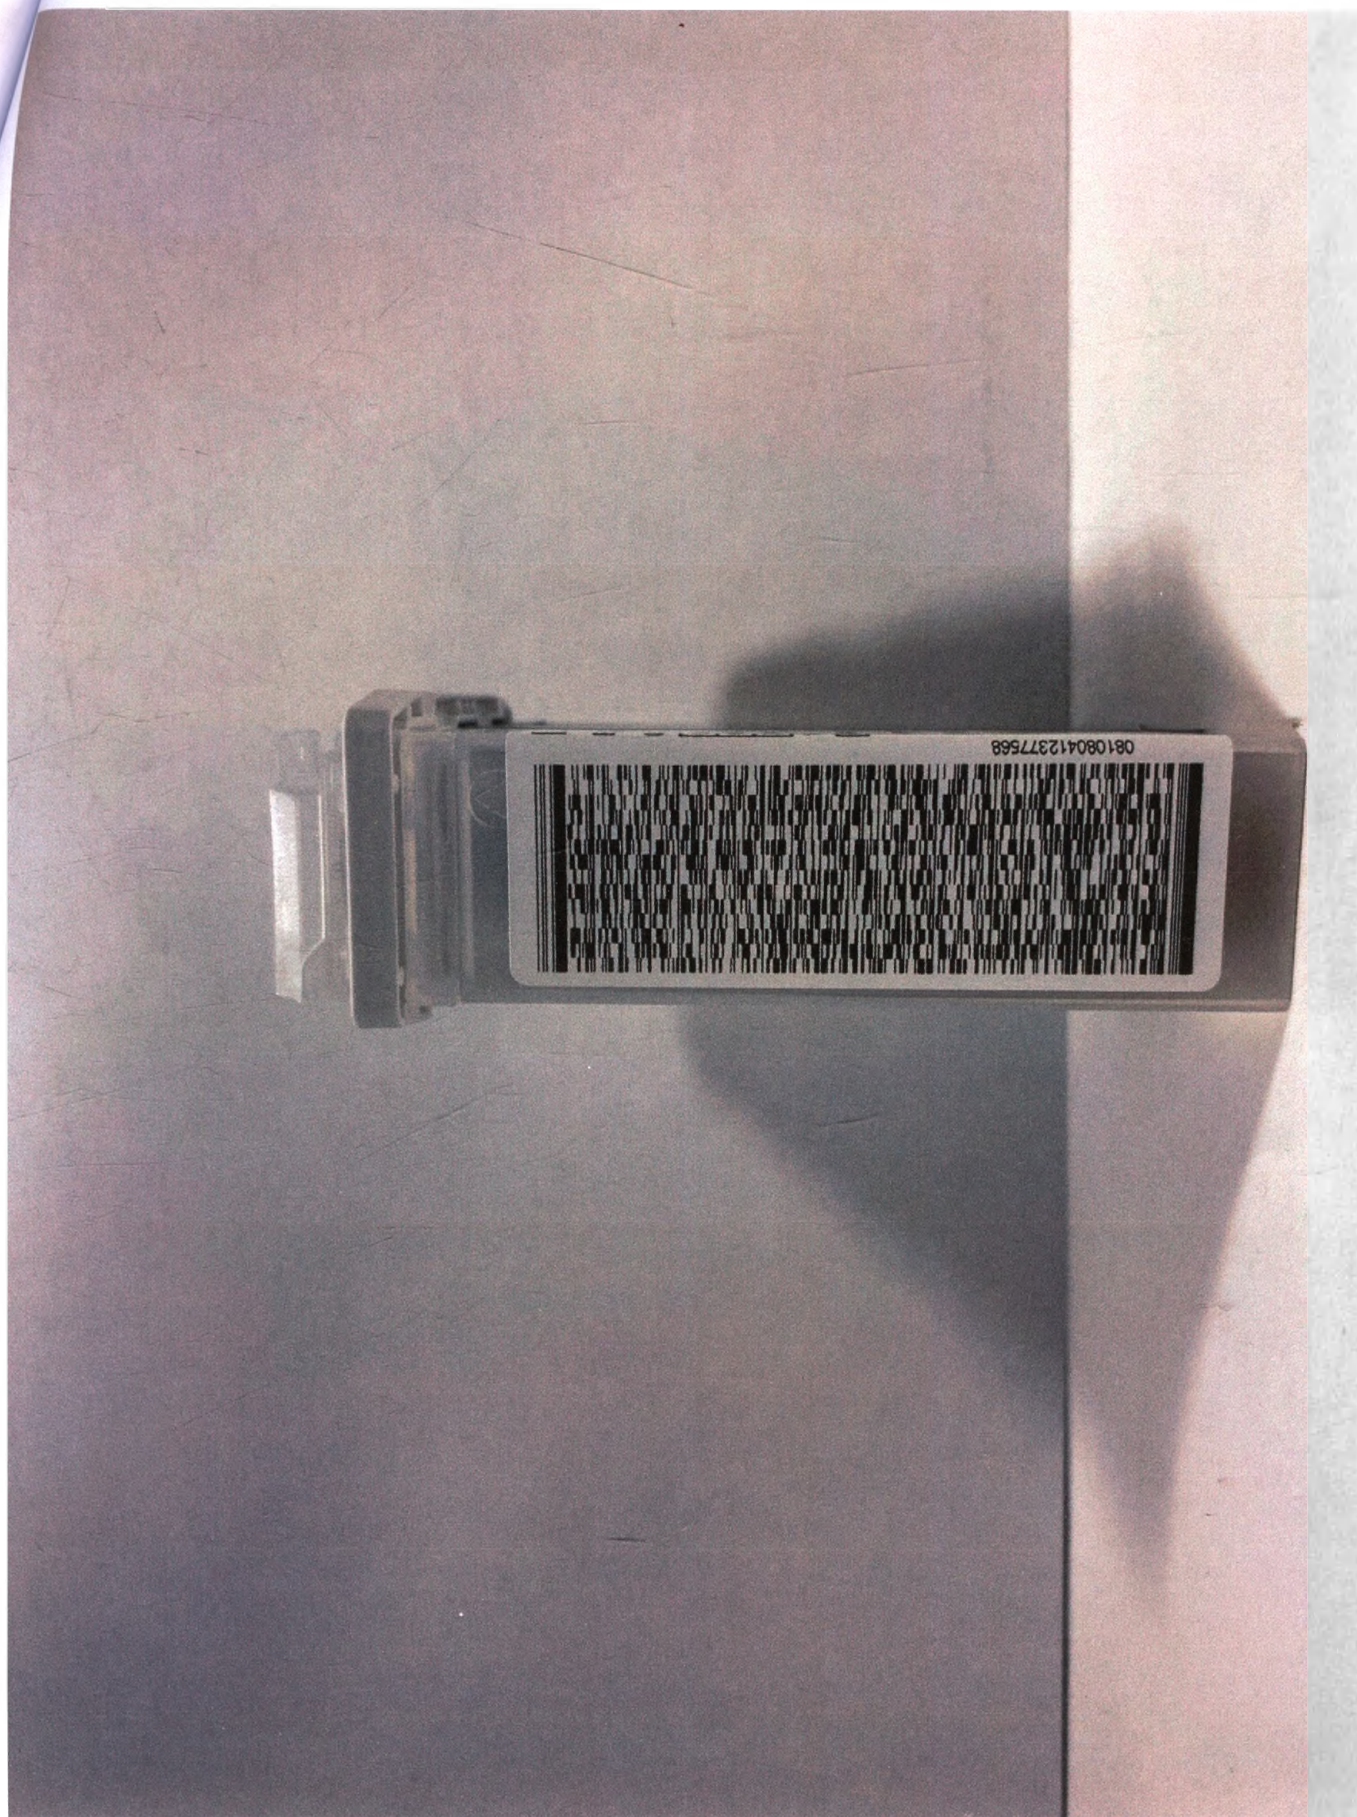



тенты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях
мунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 100
тестов

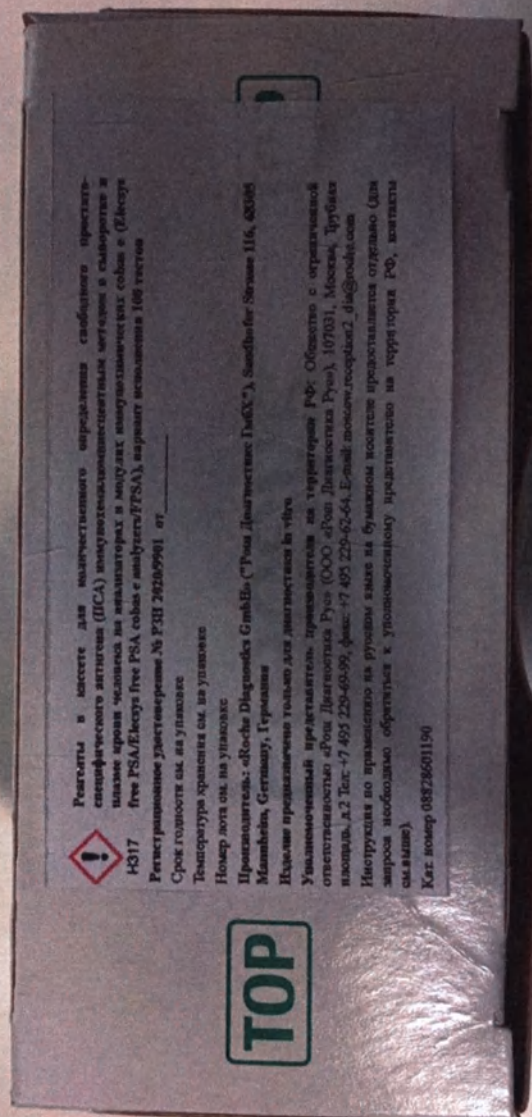


менты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на модулях иммунохимических cobas e
Elecys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 300 тестов




менты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на модулях иммунохимических cobas e
cobas free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 300 тестов

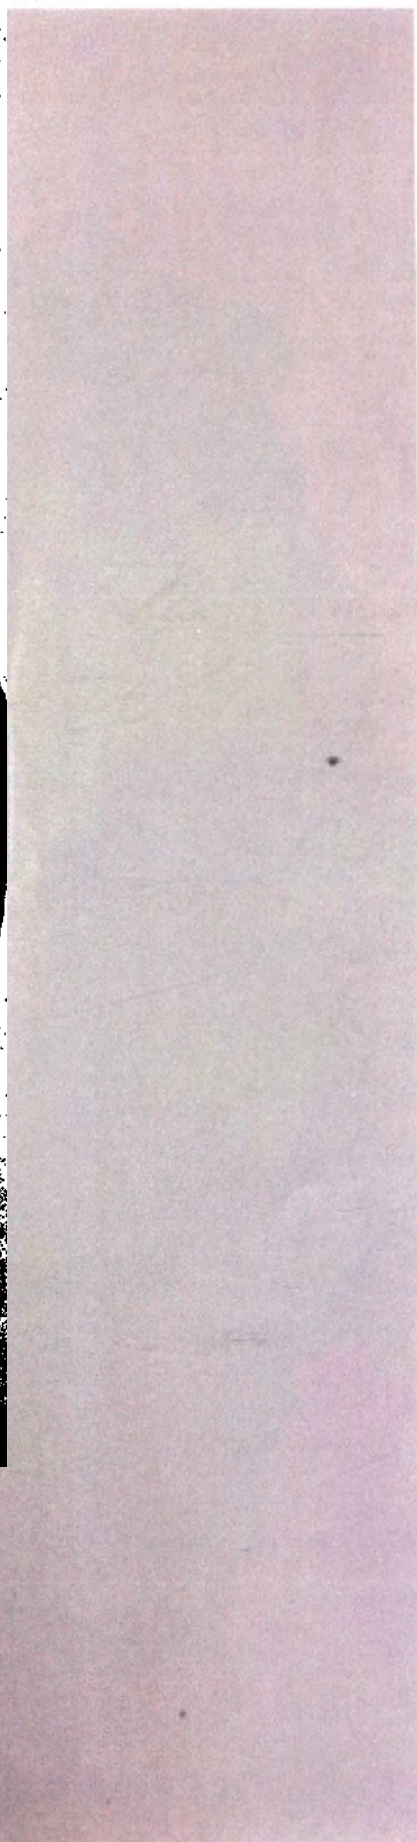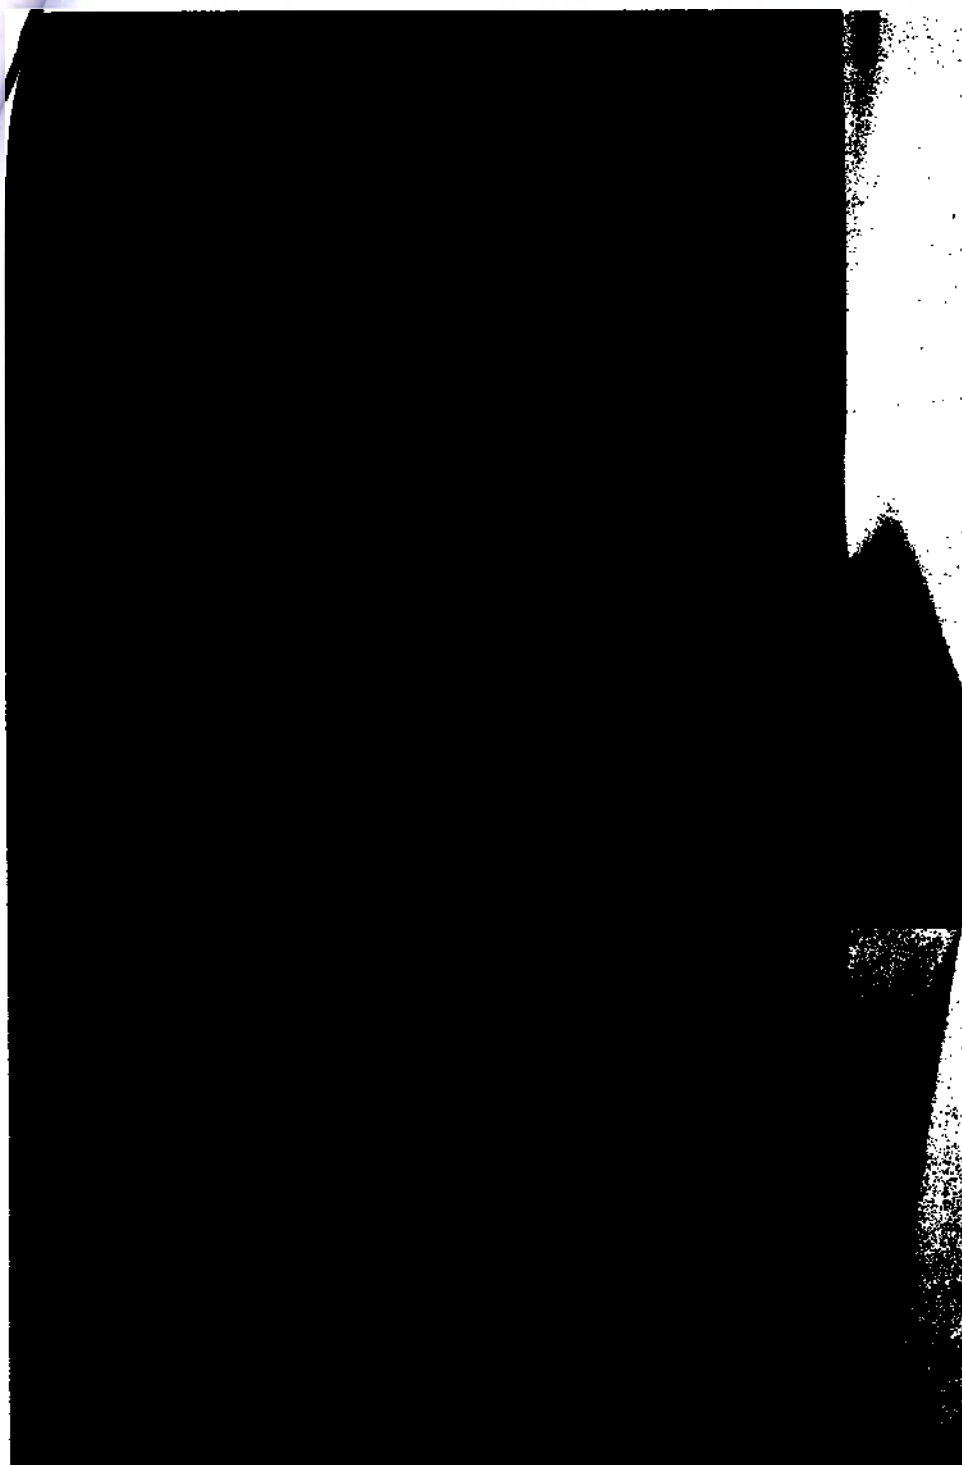

...нты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
...унохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на модулях иммунохимических cobas e
...ecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 300 тестов

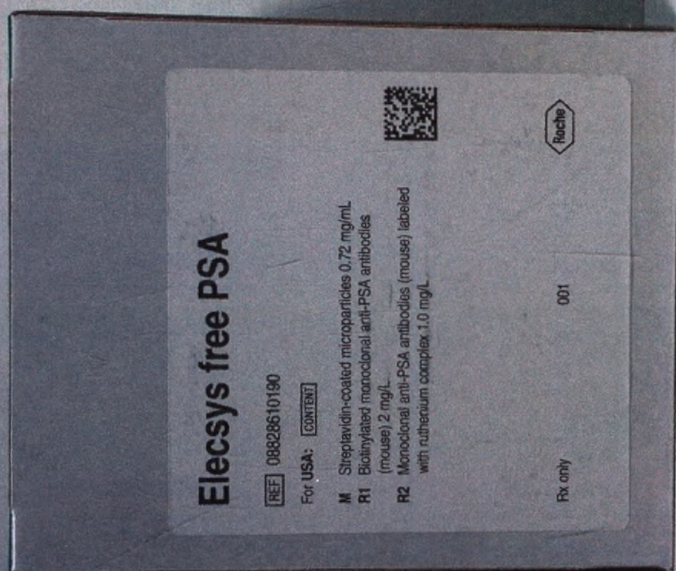

...НТЫ в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
 ...унохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на модулях иммунохимических cobas e
 ...ecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 300 тестов

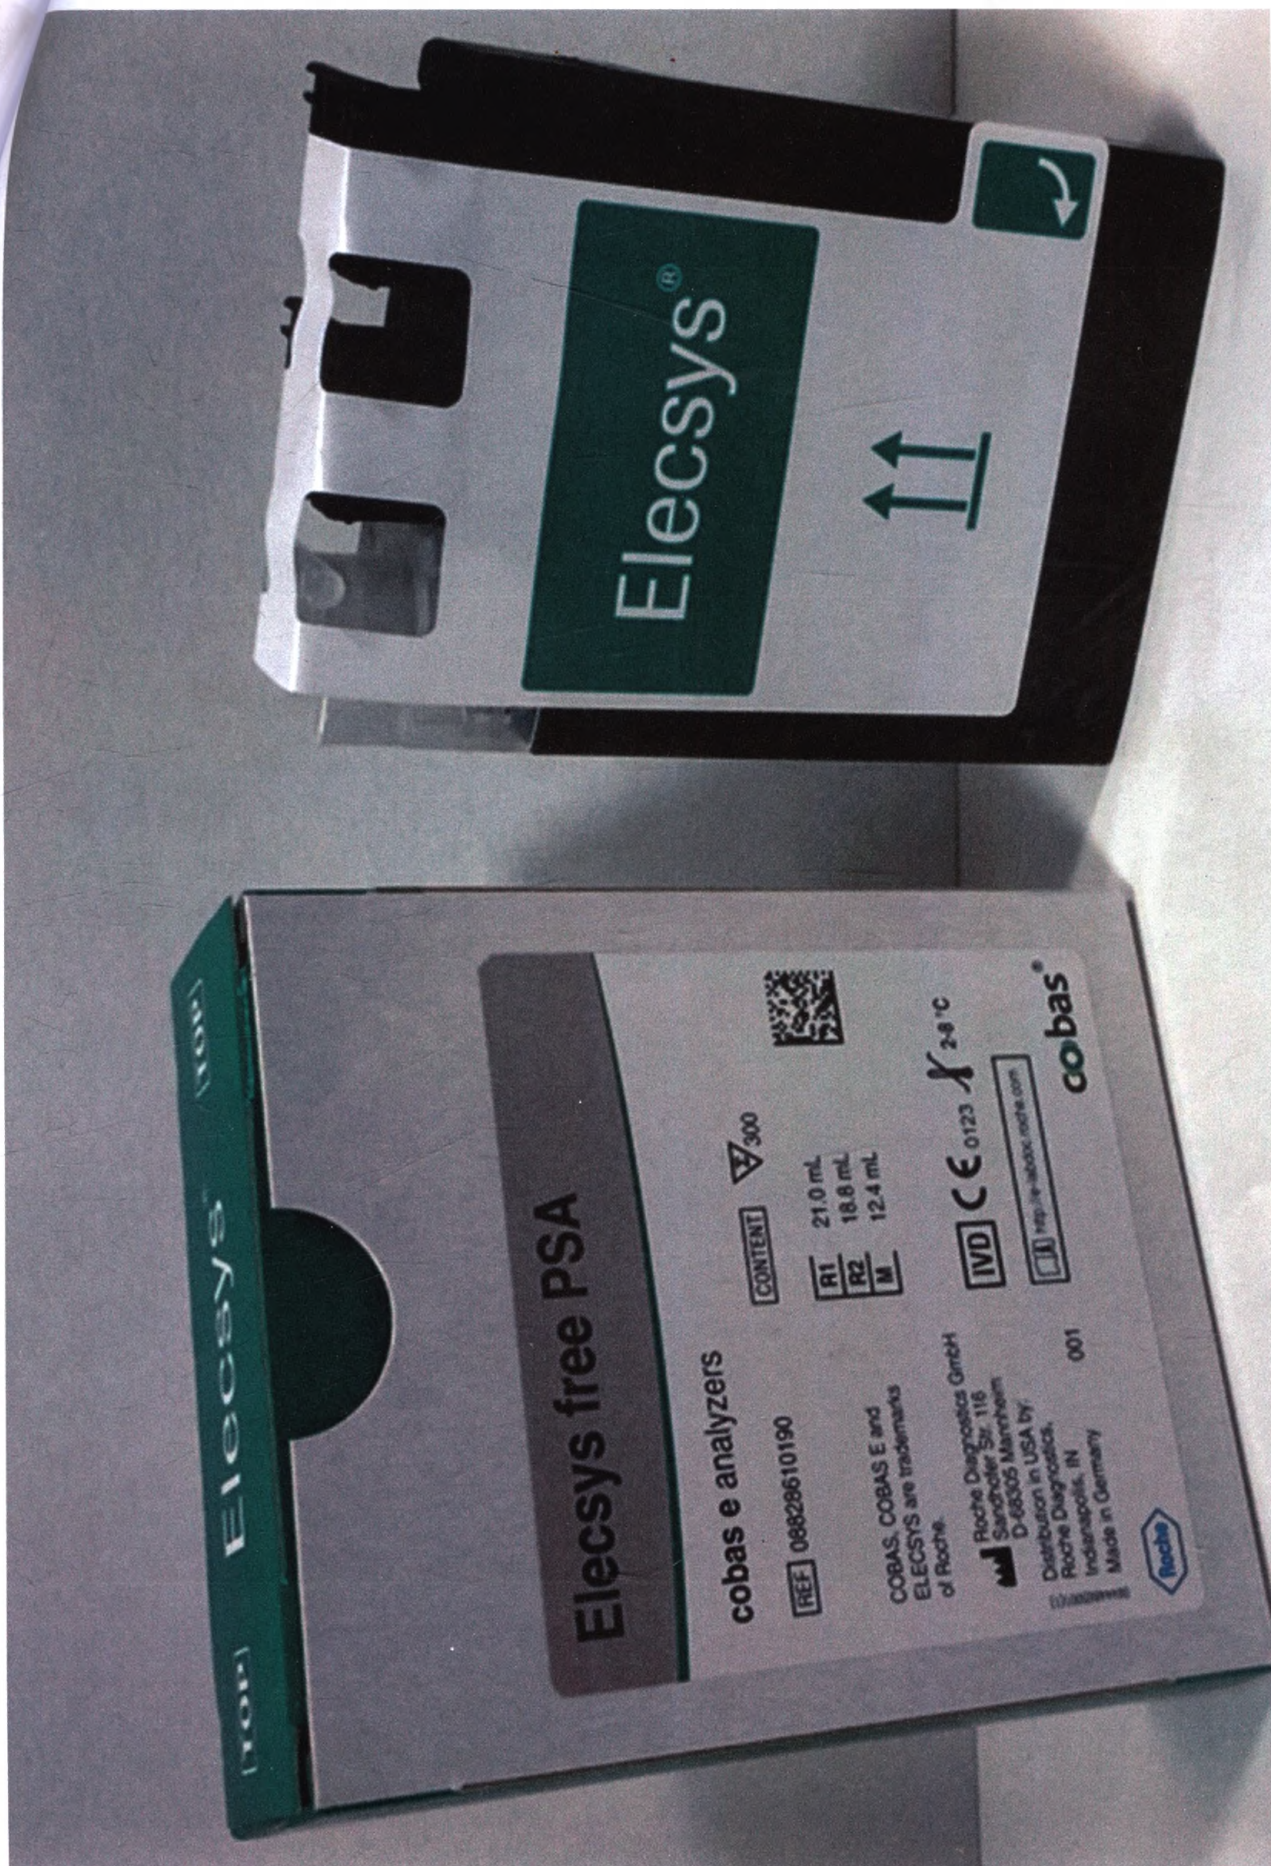

тты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
унохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на модулях иммунохимических cobas e
ecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 300 тестов



менты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на модулях иммунохимических cobas e
ecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 300 тестов



менты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА)
мунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на модулях иммунохимических cobas e
ecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на модулях иммунохимических cobas e 601 (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 300 тестов



H317

Реагенты в кассете для количественного определения свободного простато-специфического антигена (ПСА) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys free PSA/Elecsys free PSA cobas e analyzers/FPSA), вариант исполнения 300 тестов

Регистрационное удостоверение № PZN 2020/9901 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik GmbH"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Идентифицировано только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), Москва, Трубинная улица, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: moscow.registration2.dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).

Кат. номер 08828610190

TOP

OP

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

18

Лист № 18



Кашаева А.С.
по доверенности
от 30.05.23г.