




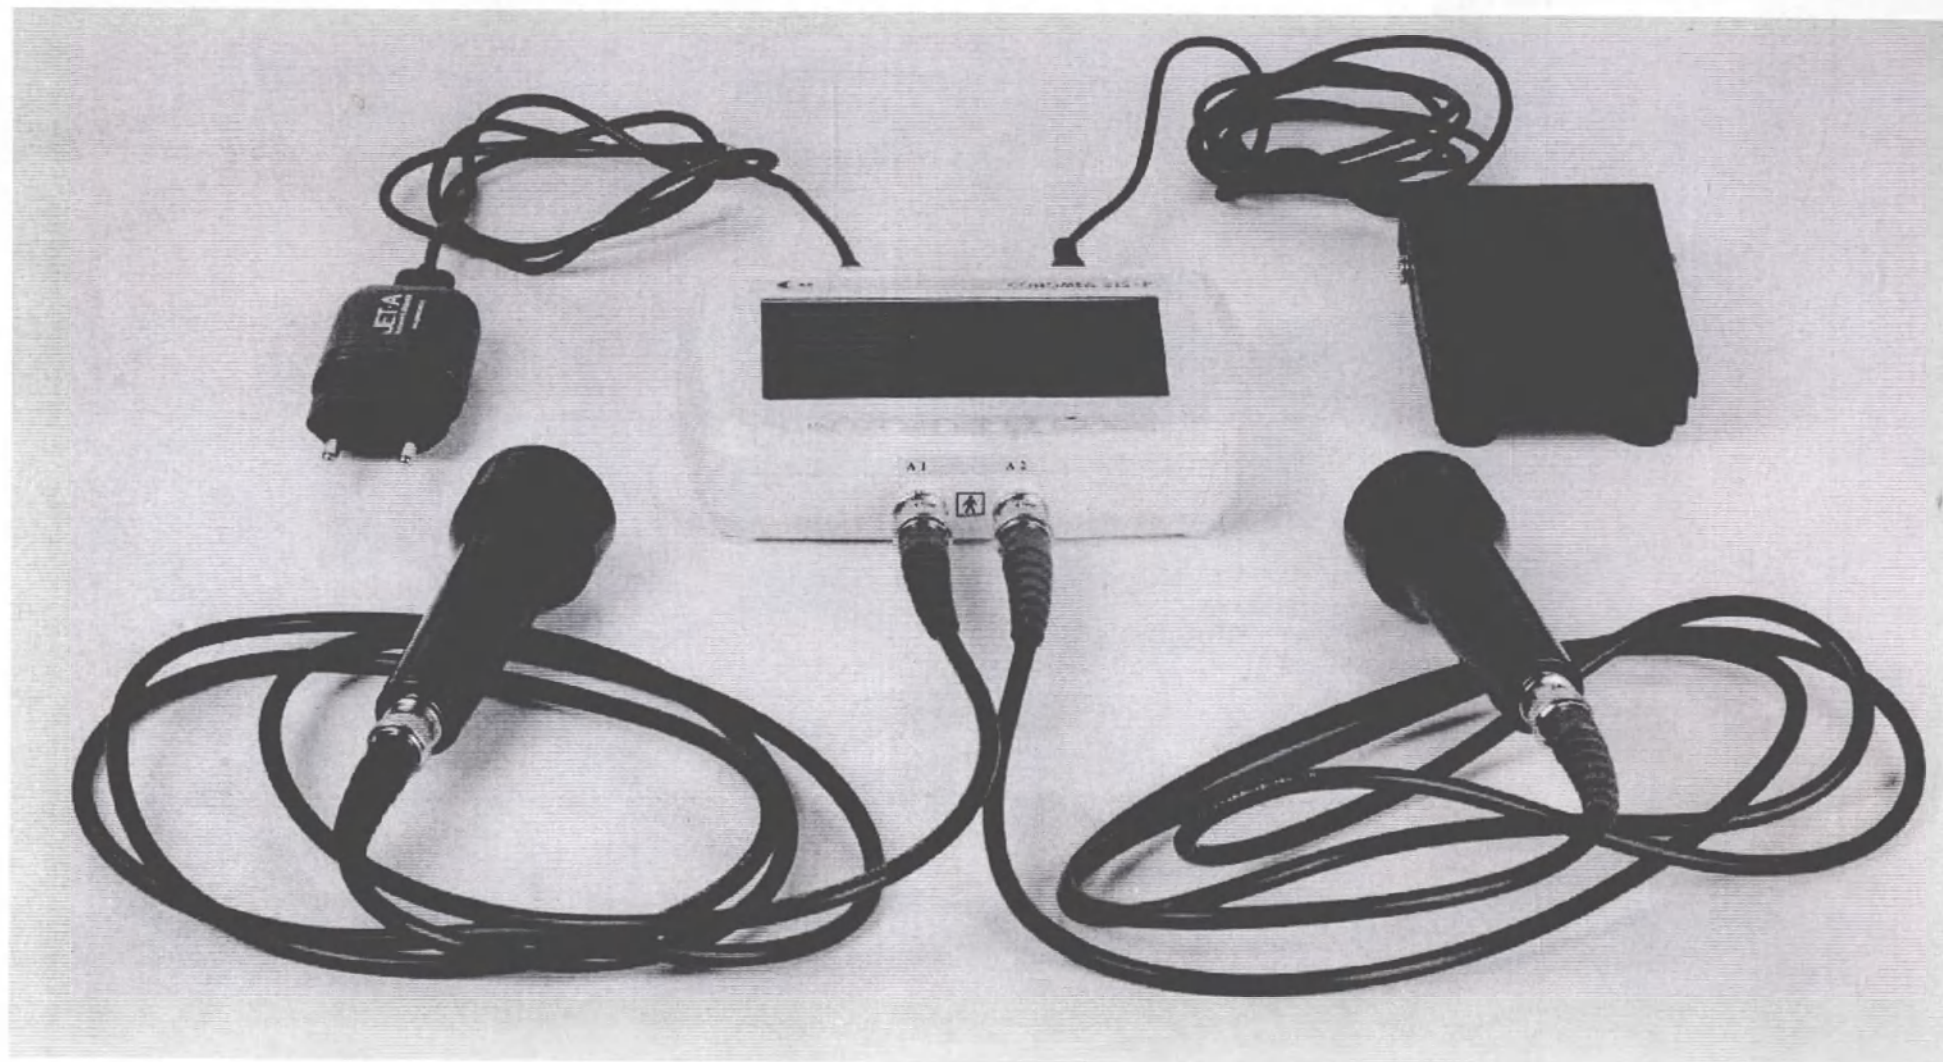

Общий вид прибора СОНОМЕД 315 исполнение – Р

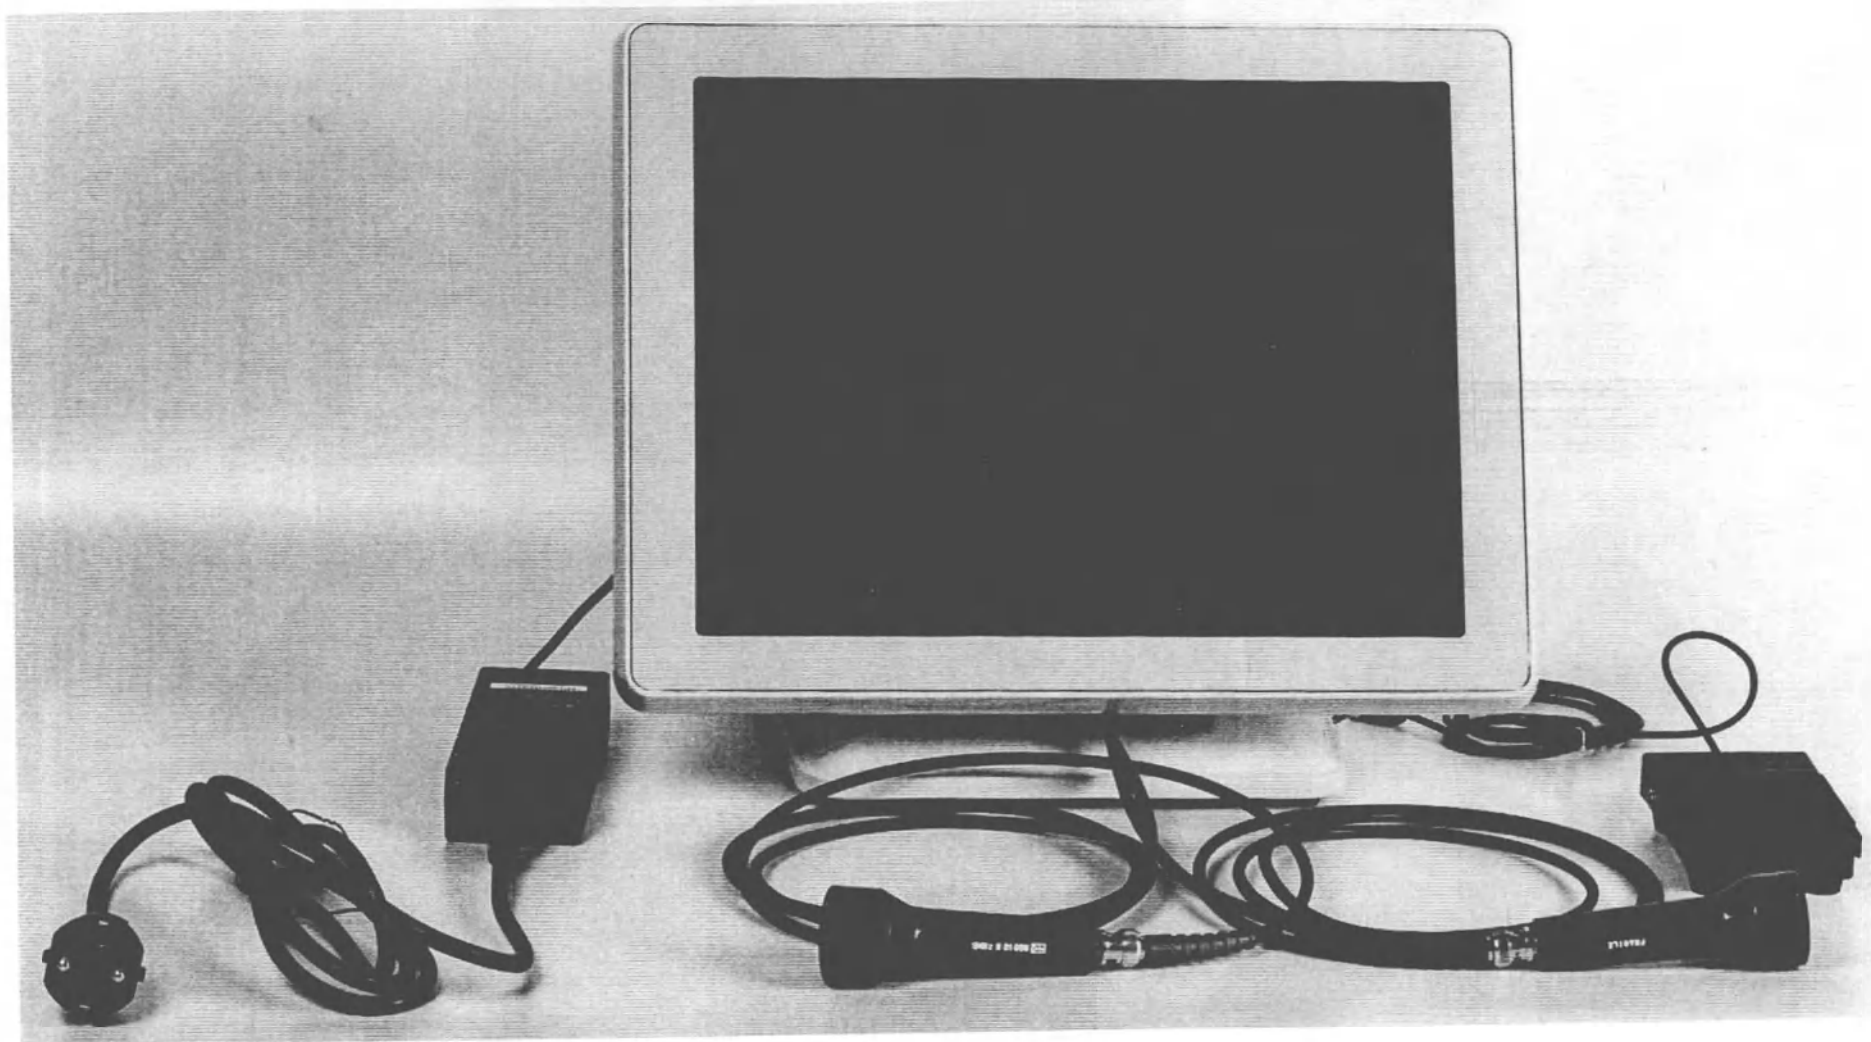

Общий вид прибора СОНОМЕД 315 исполнение - С

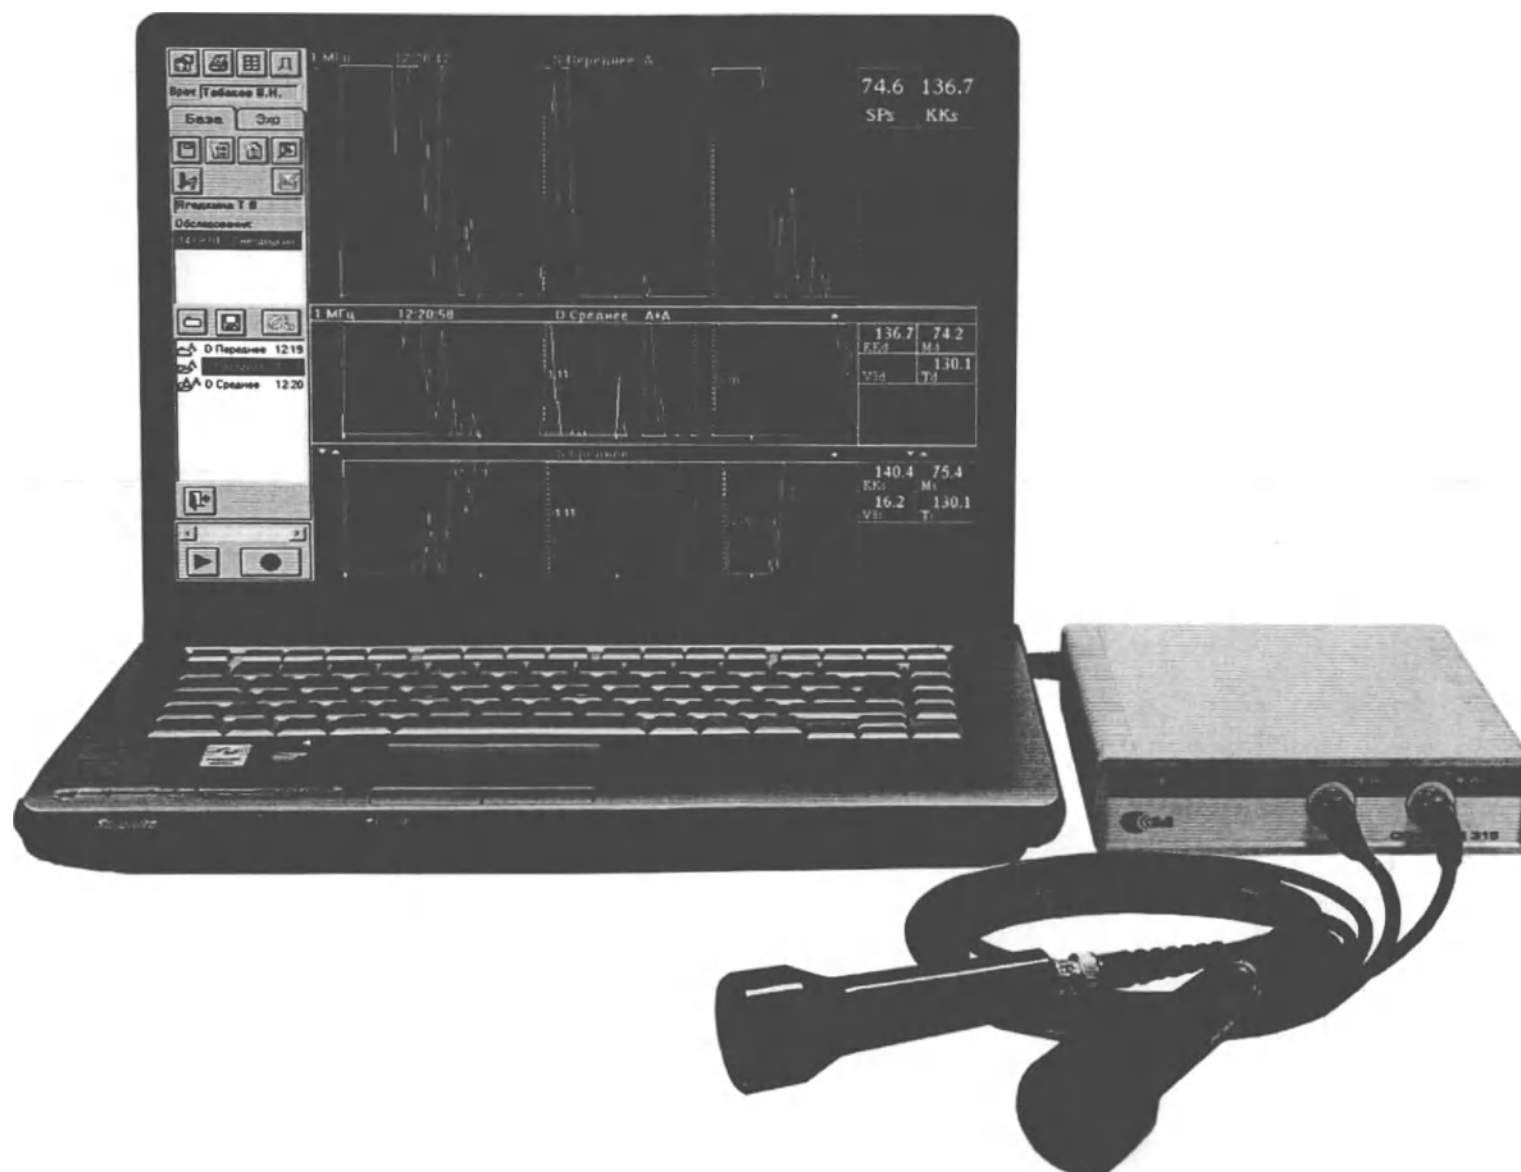

Общий вид прибора SONOMED 315 исполнение - В

Образцы этикеток




Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315 по ТУ 9442-015-31322051-2010,
исполнение СОНОМЕД 315-Р




Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315 по ТУ 9442-015-31322051-2010,
исполнение СОНОМЕД 315-С



Эхоэнцефалограф СОНОМЕД 315 по ТУ 9442-015-31322051-2010,
исполнение СОНОМЕД 315-В

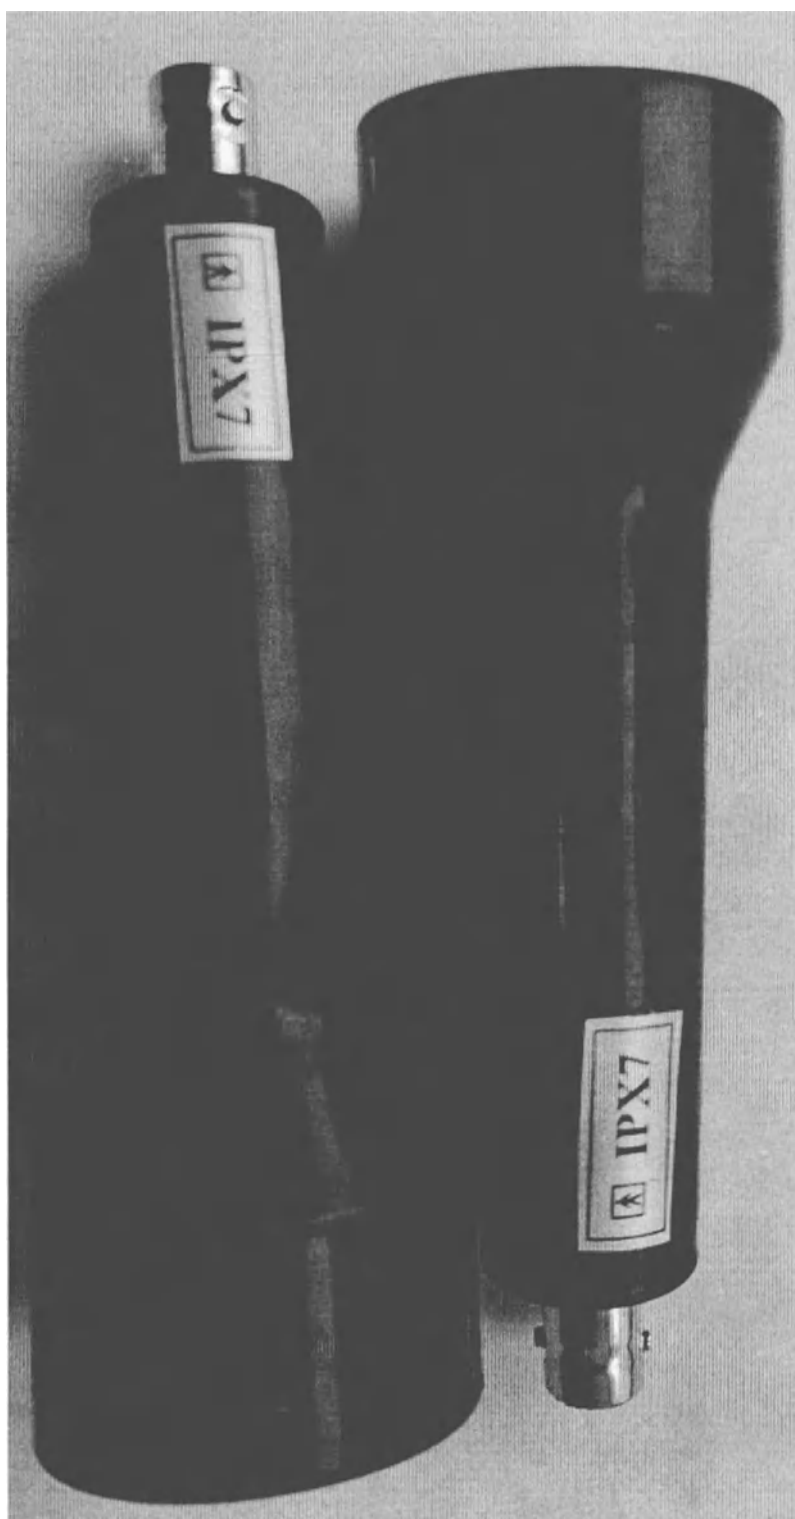

Ультразвуковые датчики без кабеля.

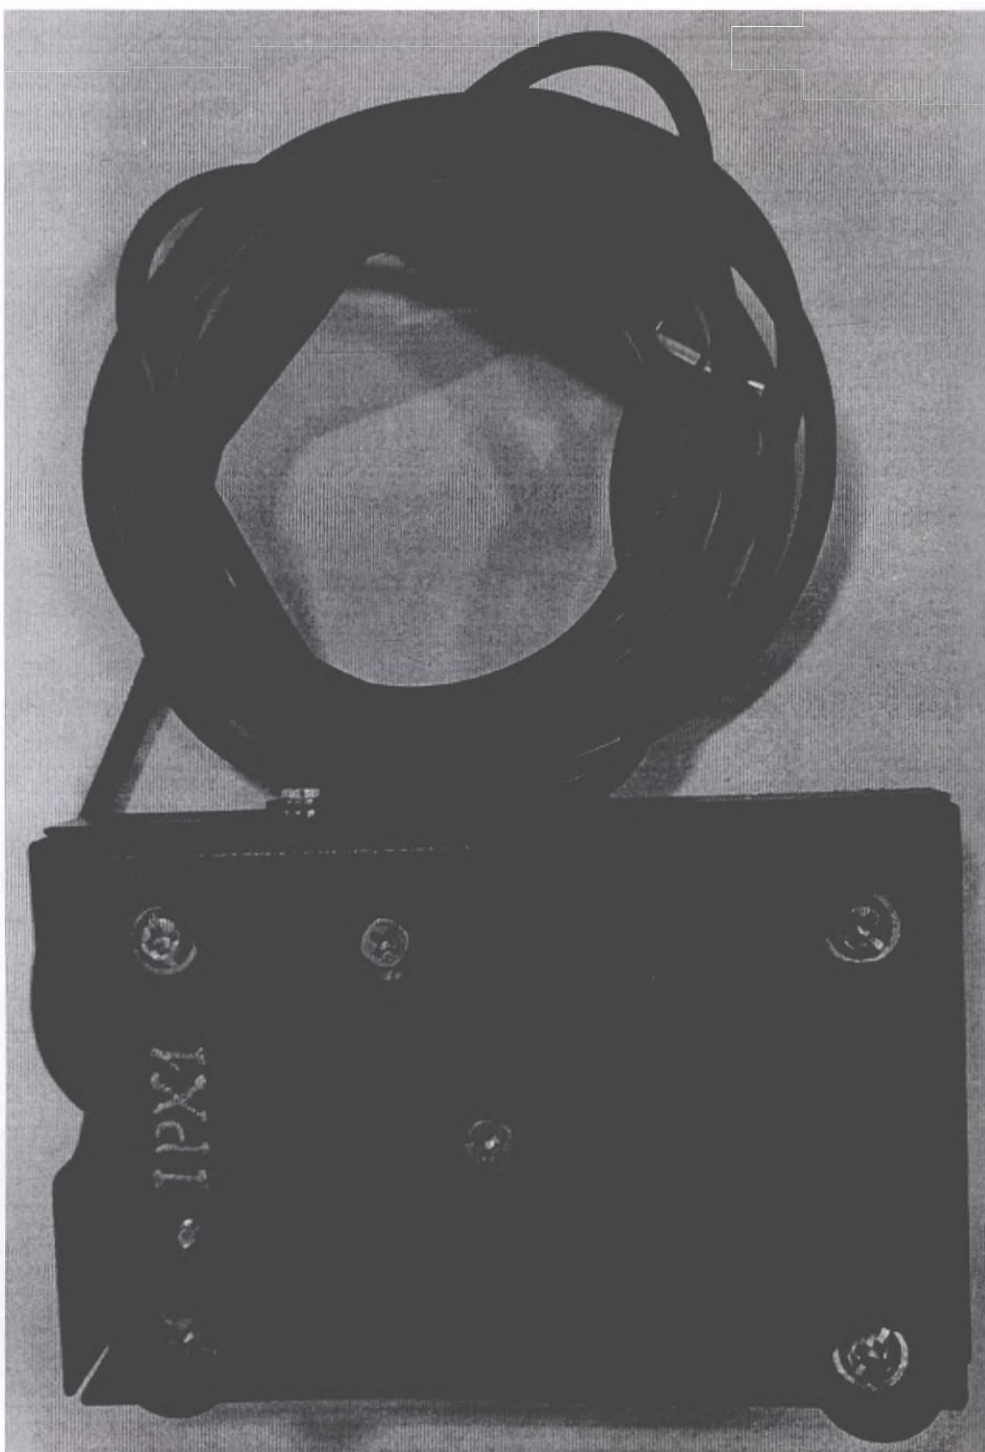

Педаль

Упаковка


Составные части прибора, эксплуатационная документация упаковываются в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и предохраняются от перемещения прокладками и амортизаторами.




Маркировка упаковки

На ящик наносится следующая информация:

- "Хрупкое, осторожно!";
- "Верх";
- "Беречь от влаги";
- "Штабелировать запрещается"

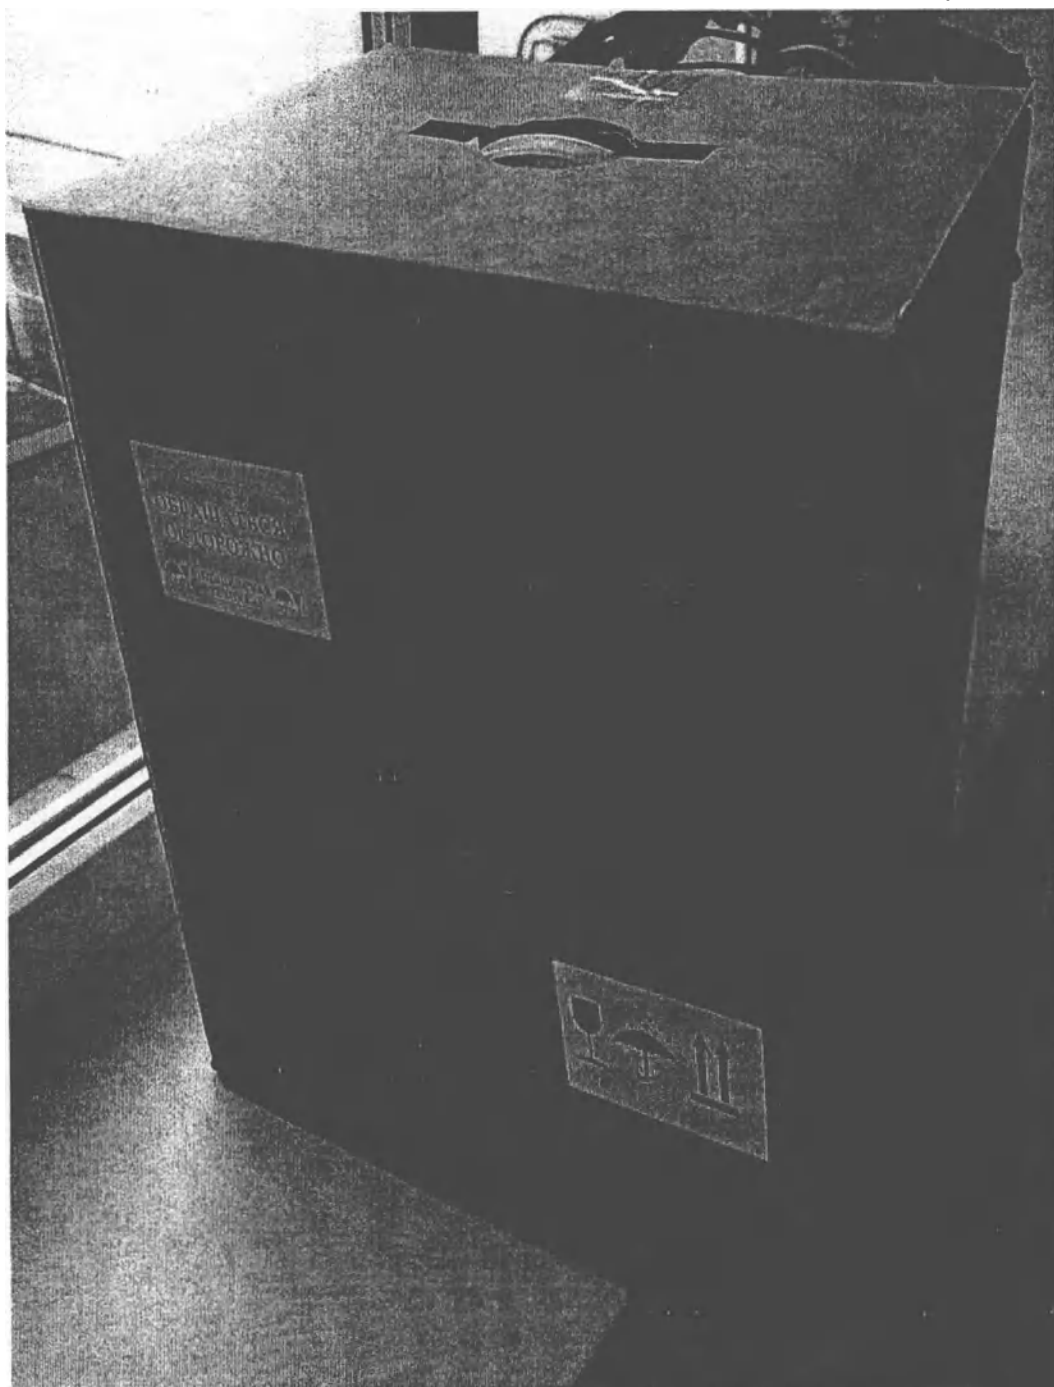

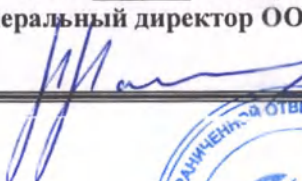Пронумеровано, прошнуровано и печатью
скреплено 8 листа(ов)
Генеральный директор ООО СПЕКТРОМЕД
 Н.Е. Нагулин/

