




"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ООО «АСП РУС»
Амирханов Р.Т.
_____ 02 _____ 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индикатор биологический STERRAD VELOCITY

1. Индикатор биологический STERRAD VELOCITY – 60 шт./1 уп.
2. Индикатор биологический STERRAD VELOCITY – 30 шт./1 уп.

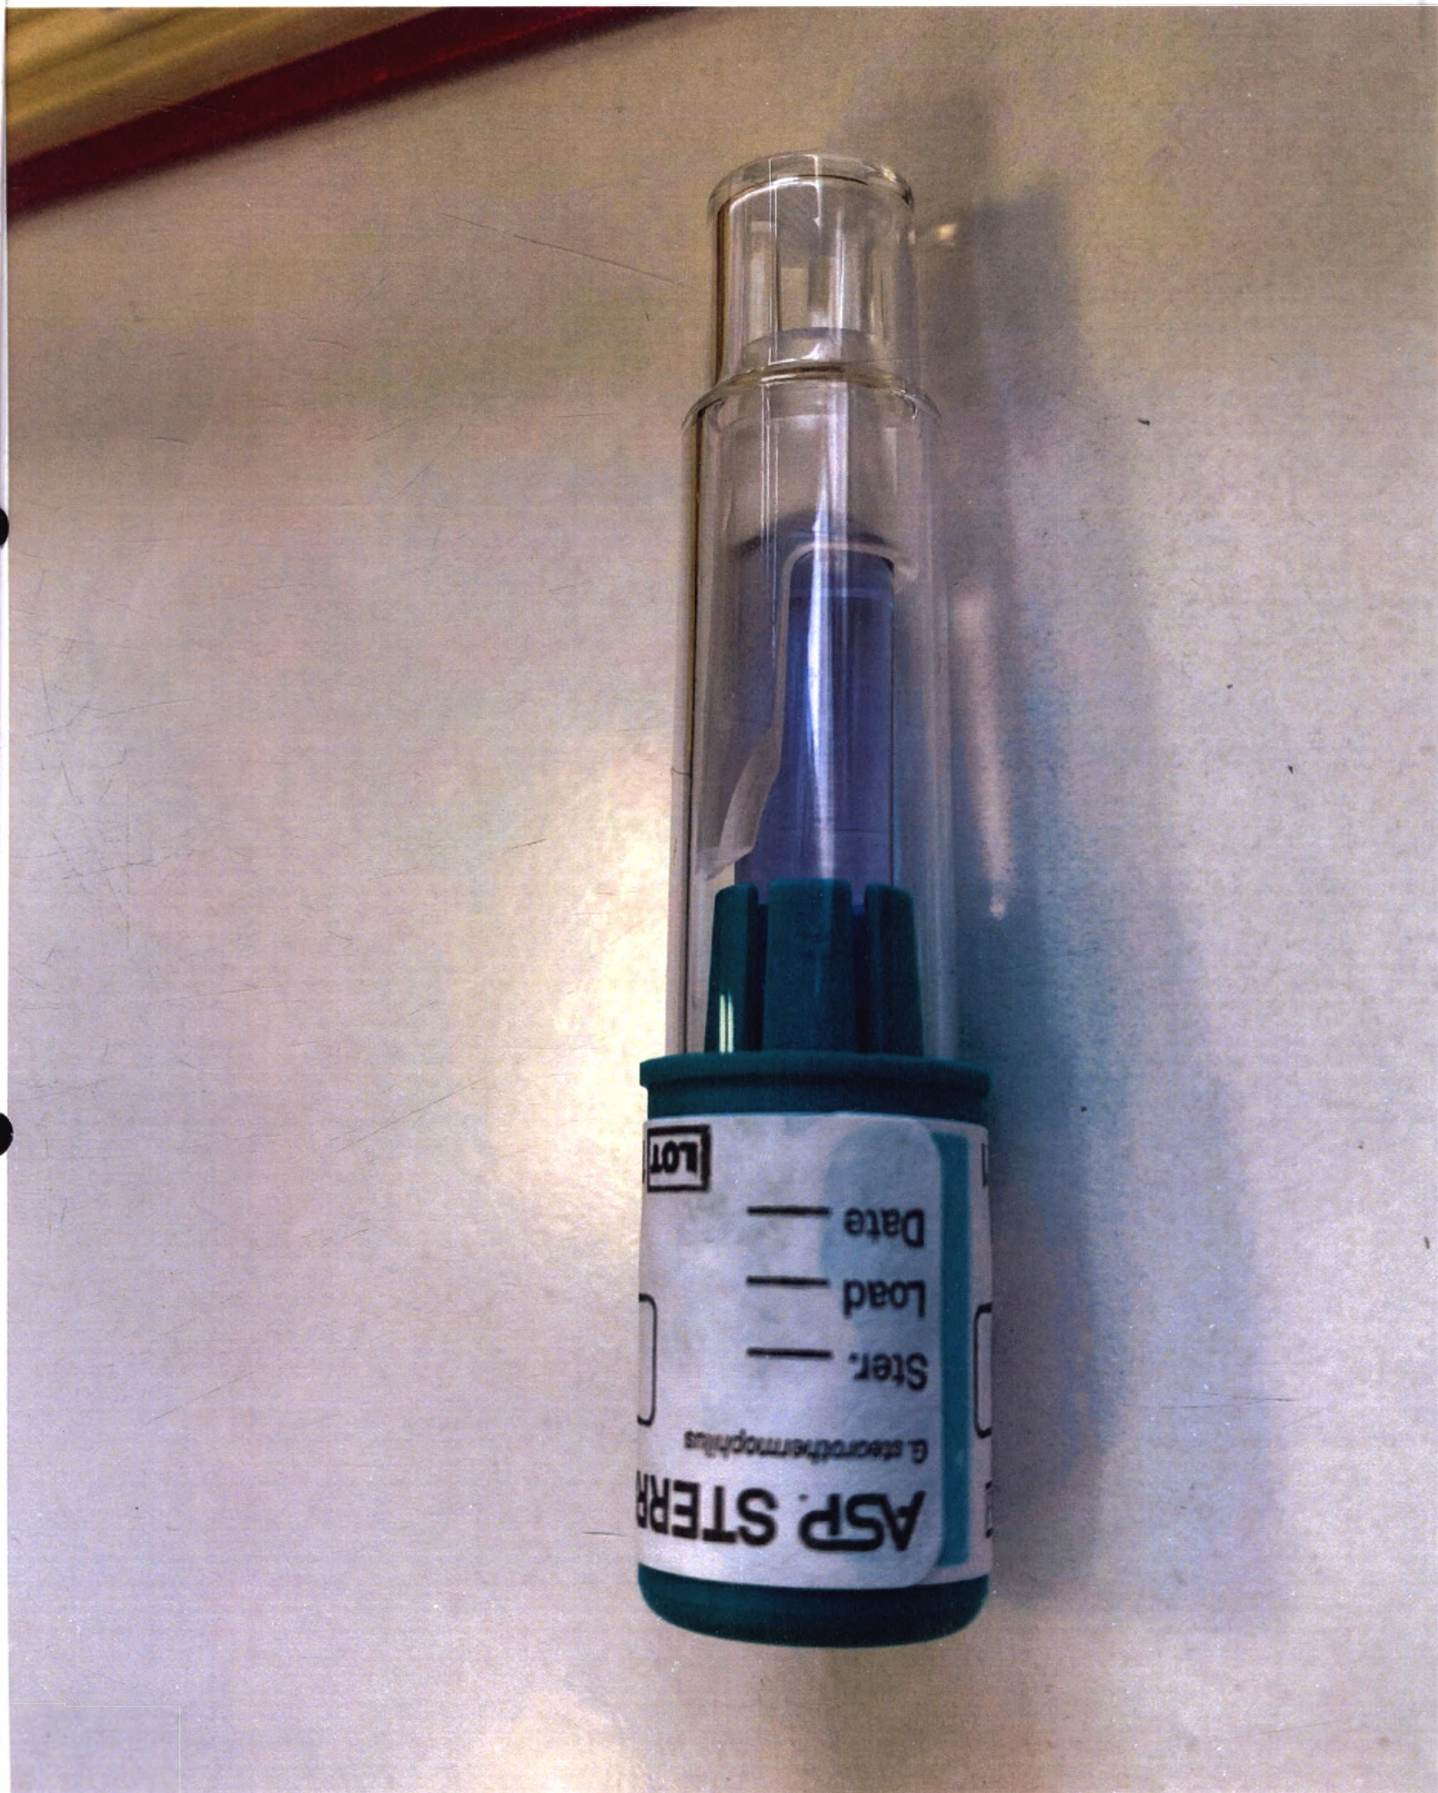



OL-43210RU01-50

43210

Индикатор биологический STERRAD
VELOCITY Вариант исполнения:
Индикатор биологический STERRAD
VELOCITY - 60 шт./уп.



Advanced Sterilization Products, Inc.
33 Technology Drive, Irvine, CA 92618,
USA

Регистрационное Удостоверение: РЗН
2019/8542

Страну происхождения см. на упаковке
"Produced
by/Made in"

Уполномоченный представитель
производителя:

ООО «АСП РУС»

Российская Федерация, 119027, г.

Москва, поселок Внуково, ул.

Центральная, д. 8Б, пом. 215

E-mail: asprus@asp.com



eifu.asp.com

43210RU01-50

См. Серийный номер на
основной маркировке

OL-43210RU02-50

43210-30

Индикатор биологический STERRAD
VELOCITY

Вариант исполнения: Индикатор
биологический STERRAD VELOCITY - 30
шт./уп.



Advanced Sterilization Products, Inc.
33 Technology Drive, Irvine, CA 92618,
USA

Регистрационное Удостоверение: РЗН
2019/8542

Страну происхождения см. на упаковке
"Produced
by/Made in"

Уполномоченный представитель
производителя:

ООО «АСП РУС»

Российская Федерация, 119027, г.

Москва, поселок Внуково, ул.

Центральная, д. 8Б, пом. 215

E-mail: asprus@asp.com



eifu.asp.com

43210RU02-50

См. Серийный номер на
основной маркировке

ASP

ASP Advanced
Sterilization
Products

STERRAD VELOCITY™

Biological Indicator / Process Challenge Device

Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™



ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC.

33 Technology Drive, Irvine, CA 92618, USA

© ASP 2021. All rights reserved.



GTIN 10705037048908



2022-01-24



2022-10-24

LOT

0242211

(01)10705037048908(11)220124(17)221024(10)0242211

For D-value/spore population
visit: www.bi.asp.com



elfu.asp.com



ASP

REF 43210



ASP Advanced Sterilization Products



minutes to result*

STERRAD VELOCITY™

Biological Indicator / Process Challenge Device

Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™

Discard Date: _____

* Time to result dependent on software version on the STERRAD VELOCITY™ Reader. See IFU section "Readout Times".
* El tiempo para obtener el resultado depende de la versión del software del lector STERRAD VELOCITY™. Consulte la sección de las instrucciones de uso "Tiempos de lectura".
* O tempo até à obtenção do resultado depende da versão de software no Lector STERRAD VELOCITY™. Consulte a secção "Tempos de leitura" das Instruções de Utilização.
* 結果までの時間、STERRAD VELOCITY™ Readerのソフトウェアバージョンによって異なります。IFUの「読取時間」セクション、必ずご確認ください。

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено оттиском
печати 7 листа (ов)

Генеральный директор ООО "АСП РУС"

Р.Т. Амирханов

