

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Актимед плюс»

Попов В.А.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Шприцы и соединительные линии к ним для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии**

●
Модель: 100200А (2) в составе:

- Шприц, 200 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

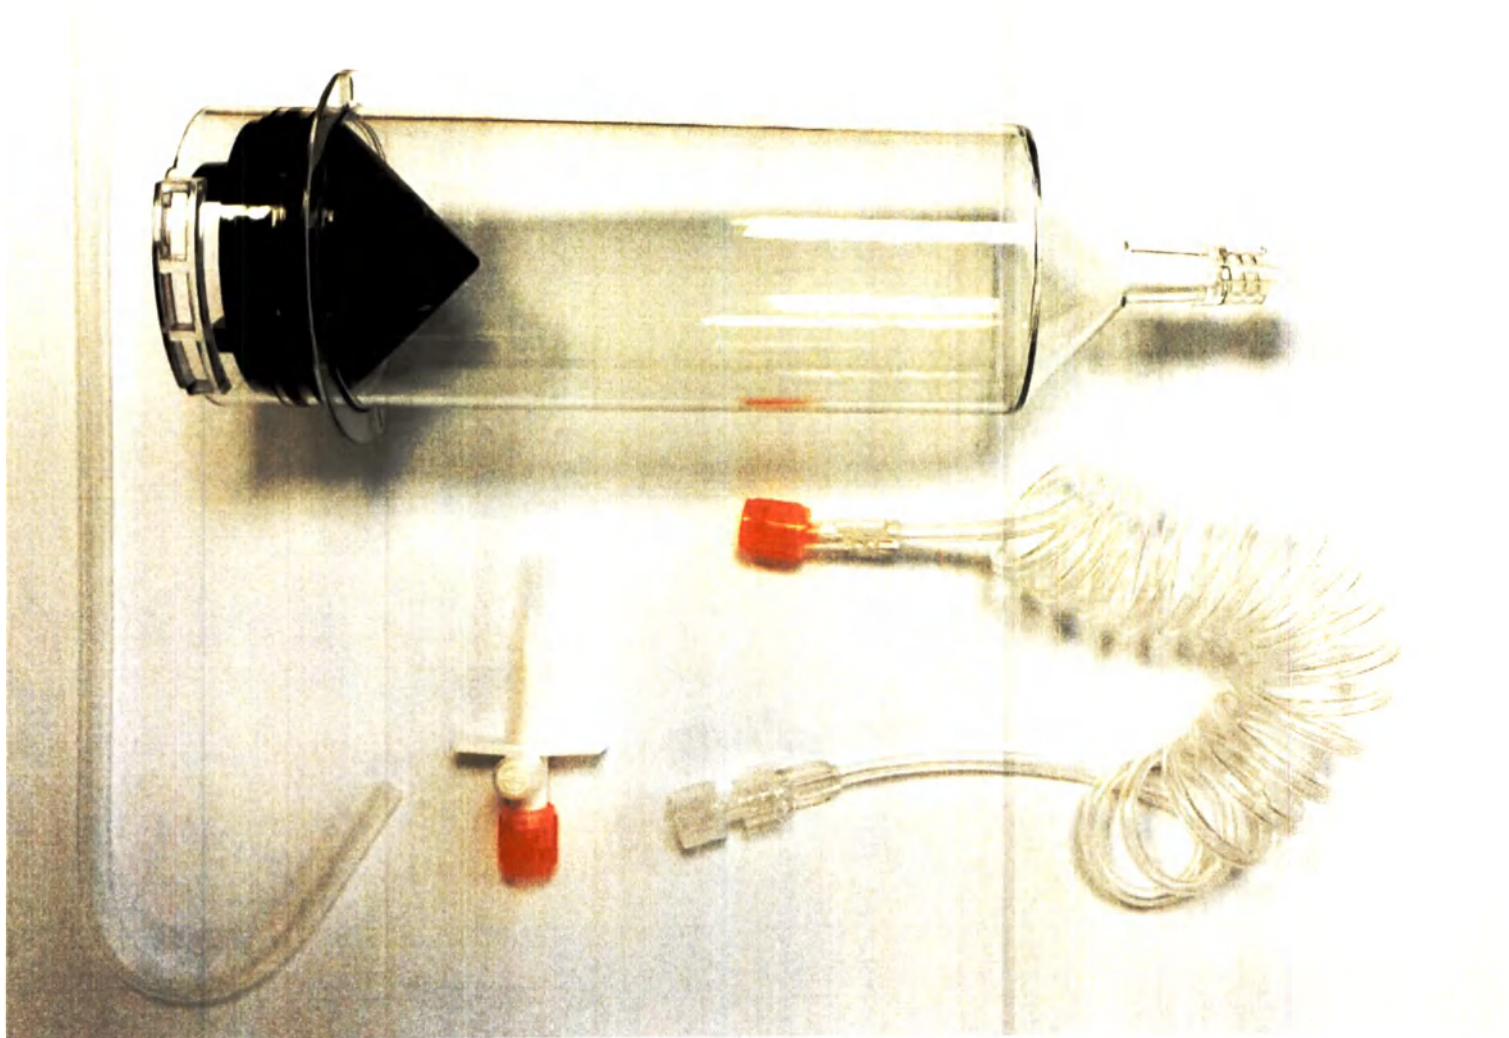

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100200A (2)


- Шприц 200 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)


LOT 2007192

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO  20°C 25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп.1, Литер А, пом.21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100200A (2)

- Шприц 200 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

LOT 2007192

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO  20°C 25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп.1, Литер А, пом.21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

●
Модель: 100100В в составе:

- Шприц, 125 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type

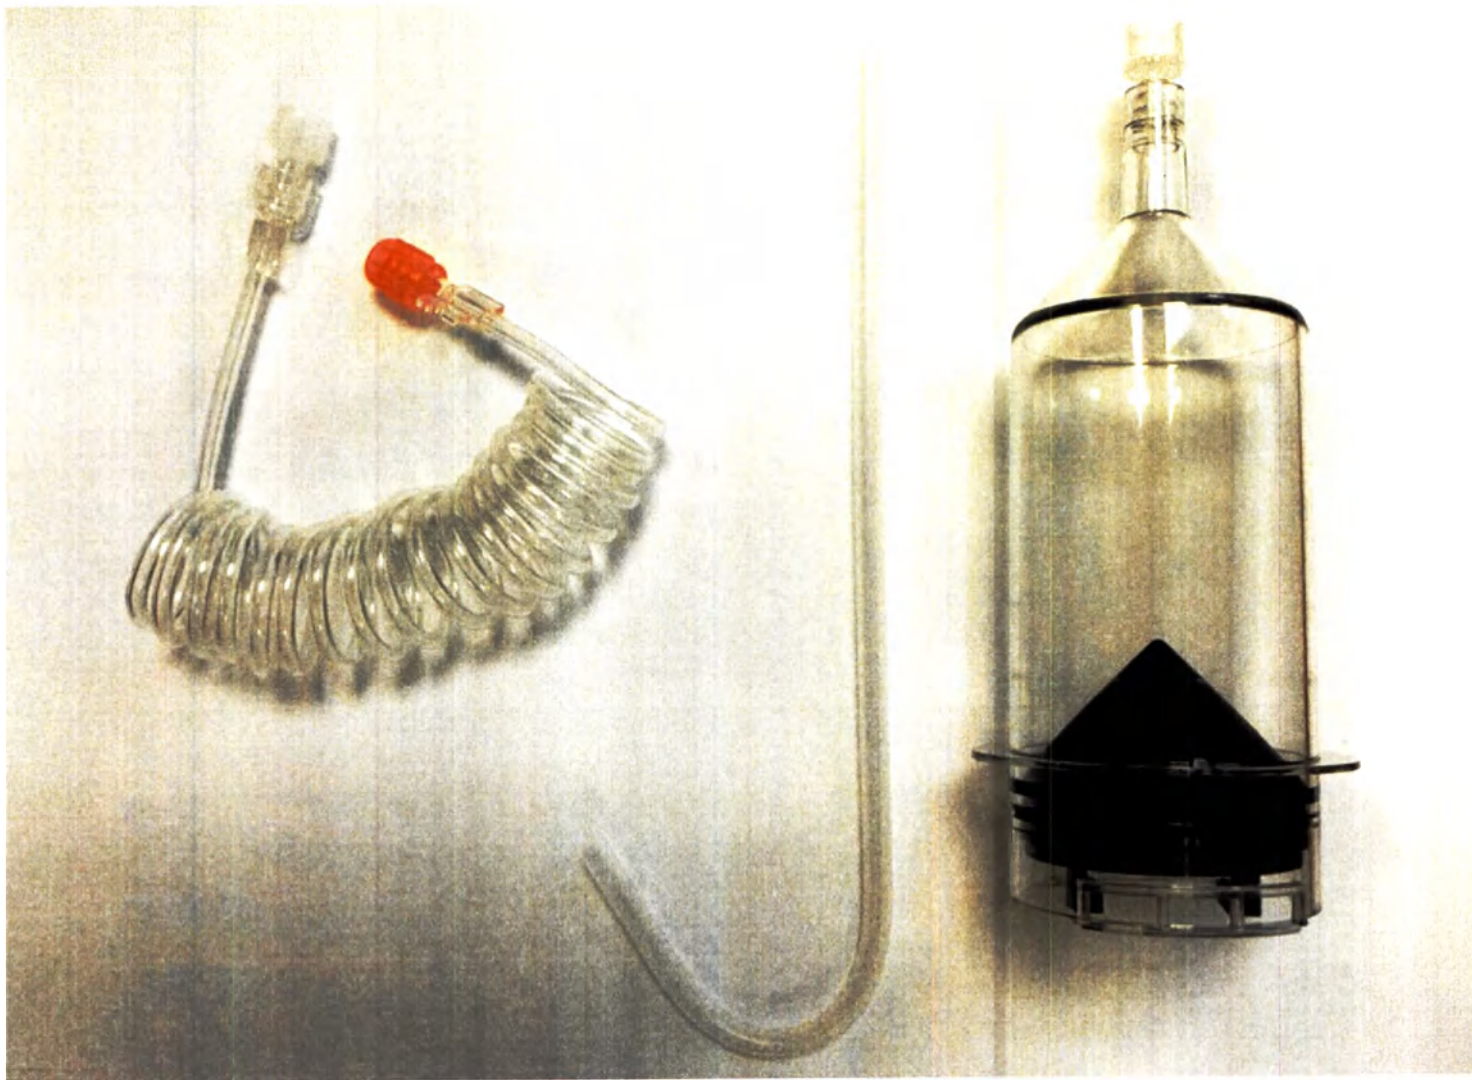

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100100B

- Шприц, 125 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type

LOT 2007193

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20°C  25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими



Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь



Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100100B

- Шприц, 125 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type

LOT 2007193

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20°C  25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими



Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения


Сделано в Китае

Открывать здесь



Модель: 100200В/100200В в составе:

- Шприц, 200 мл
- Шприц, 200 мл
- Line T Type CLV, с трубкой для сбора избытка контраста
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

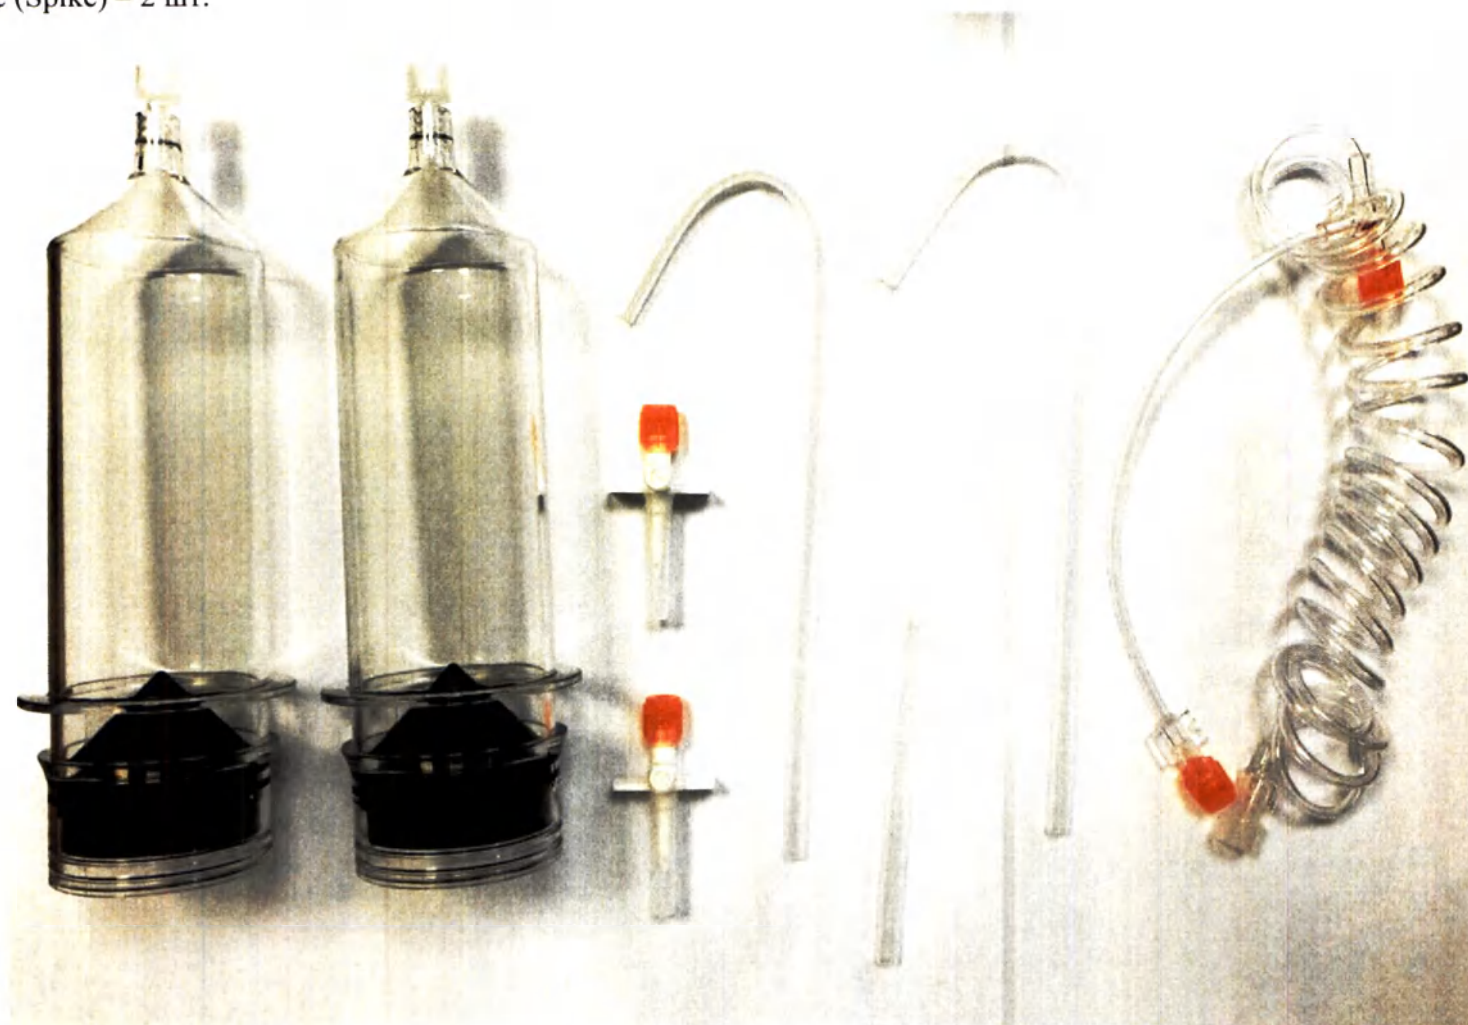

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 100200B/100200B

- Шприц 200 мл
- Шприц 200 мл
- Line T Type CLV, с трубкой для
сбора избытка контраста
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spike) - 2шт

LOT 2007194

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими



«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd»,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 100200B

- Шприц 200 мл
- Шприц 200 мл
- Line T Type CLV, с трубкой для
сбора избытка контраста
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spike) - 2шт

LOT 2007194

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd»,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

●
Модель: 100200В/100200В (2) в составе:

- Шприц, 200 мл
- Шприц, 200 мл
- Line Y Type CLV
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

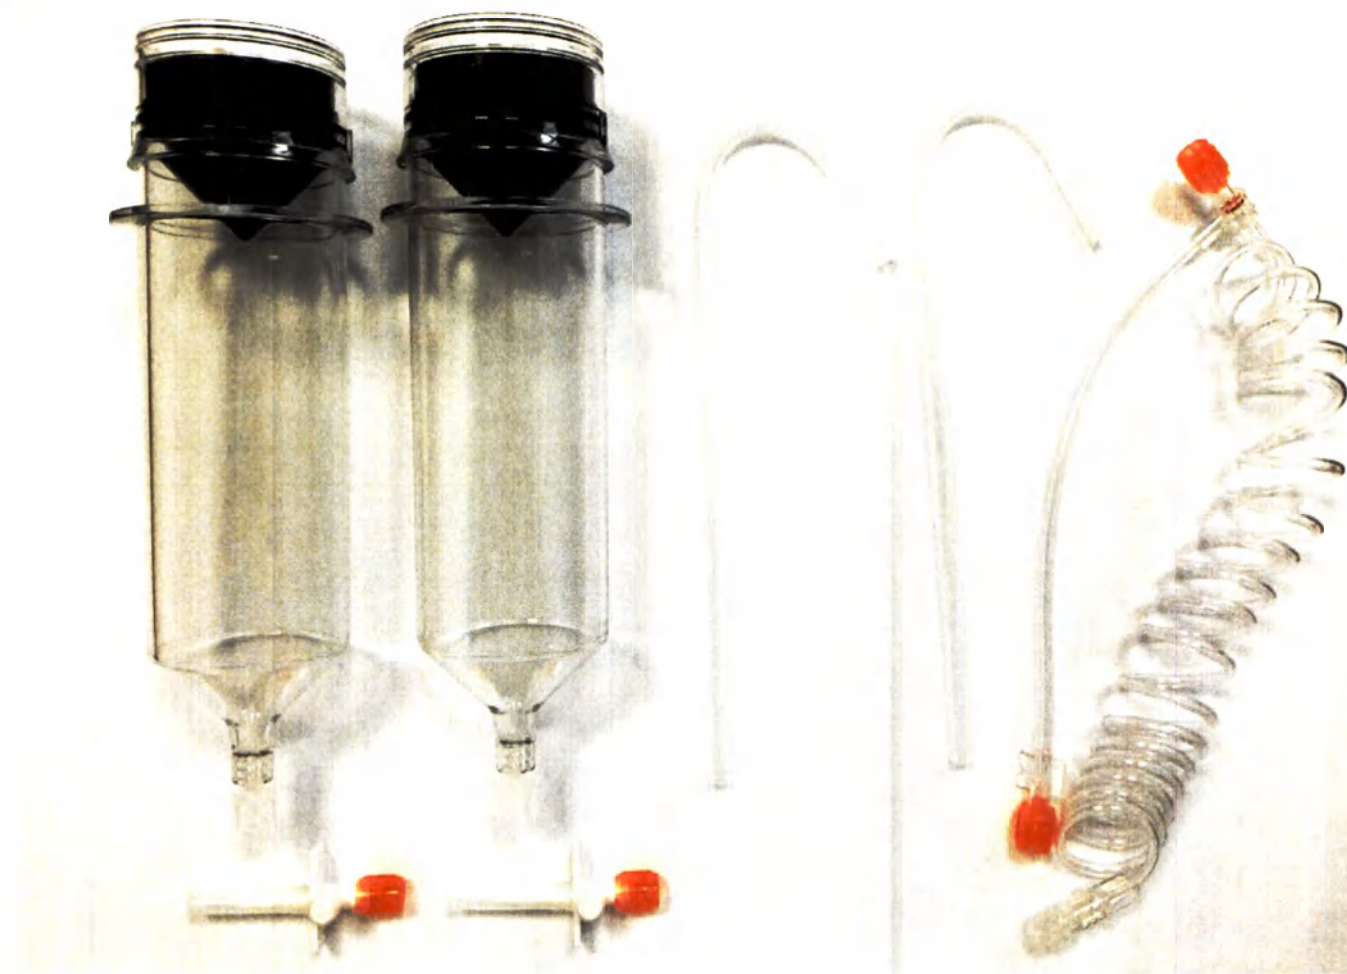

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 100200B/100200B (2)

- Шприц 200 мл
- Шприц 200 мл
- Line Y Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spoke) - 2шт

LOT 2007195


2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими



«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.»
No. 115, Nongtinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 100200B/100200B (2)

- Шприц 200 мл
- Шприц 200 мл
- Line Y Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spoke) - 2шт

LOT 2007195

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.»
No. 115, Nongtinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения
Сделано в Китае

Открывать здесь

●
Модель: 100200 F/100200 F в составе:

- Шприц, 190 мл
- Шприц, 190 мл
- Line T Type CLV
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

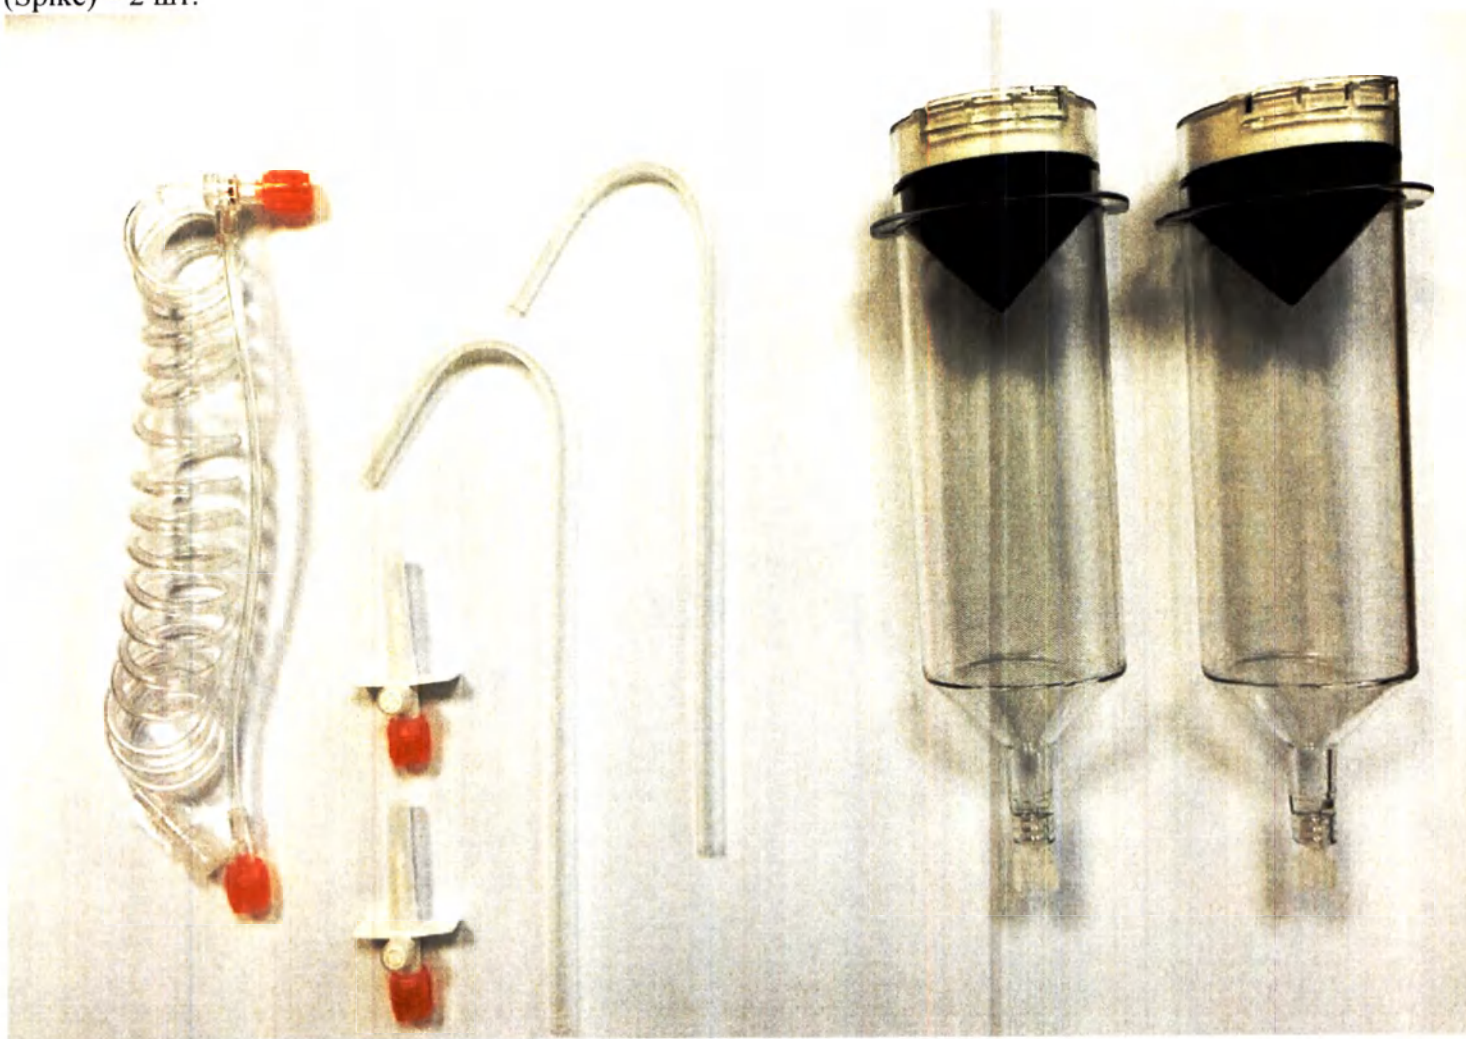

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 100200 F/100200 F

- Шприц 190 мл
- Шприц 190 мл
- Line T Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Splice) - 2шт

LOT 2007196

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



20°C 25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd»,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 100200 F/100200 F

- Шприц 190 мл
- Шприц 190 мл
- Line T Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Splice) - 2шт

LOT 2007196

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



20°C 25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

●
Модель: 100100С/10060А (2) в составе:

- Шприц, 115 мл
- Шприц, 65 мл
- Line Y Type CLV
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

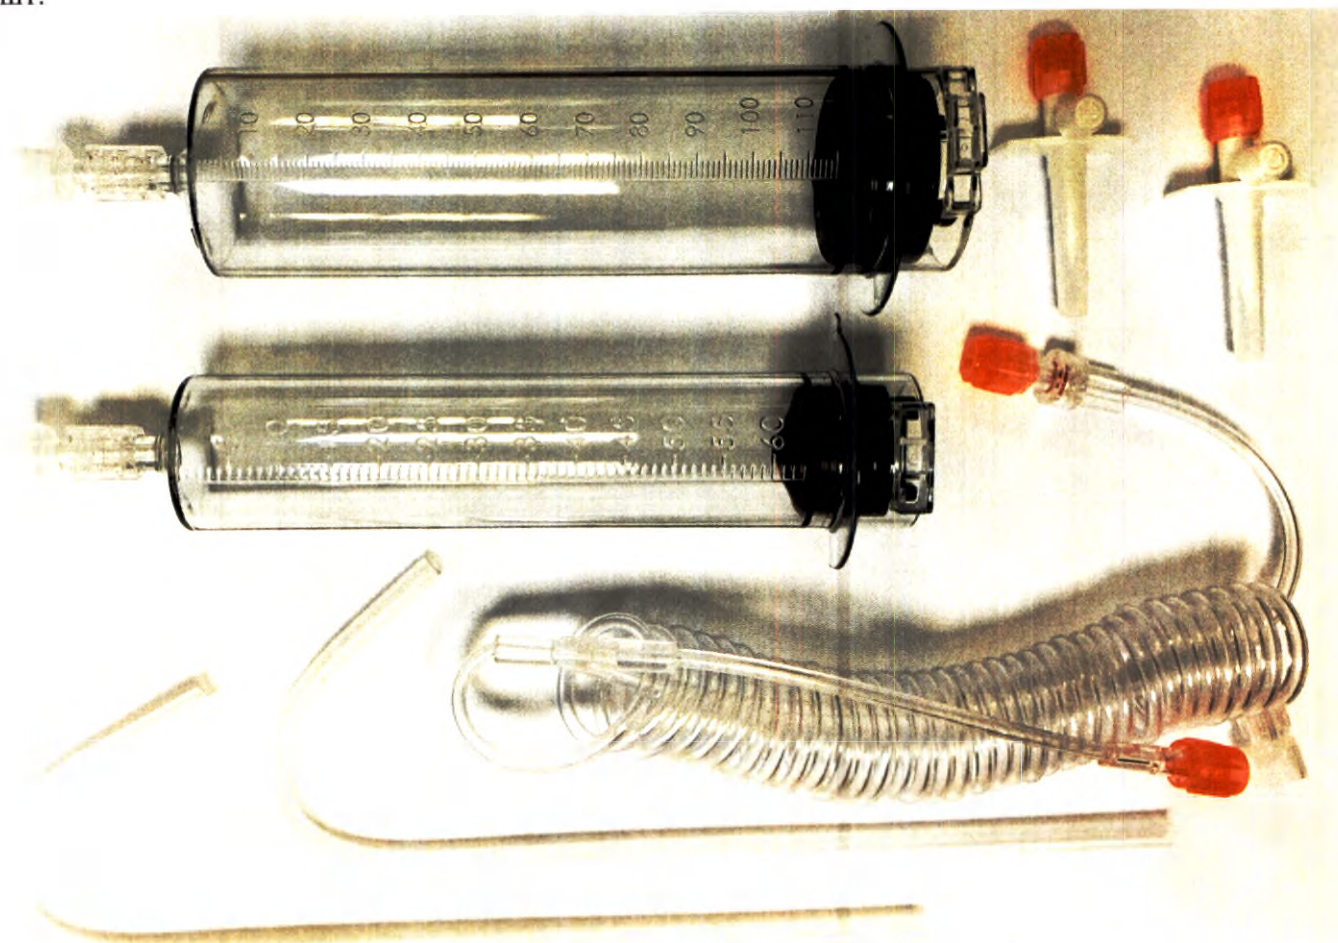

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100100C/10060A (2)

- Шприц 115 мл
- Шприц 65 мл
- Line Y Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spike) - 2шт

LOT 2007197

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20 °C 

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100100C/10060A (2)

- Шприц 115 мл
- Шприц 65 мл
- Line Y Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spike) - 2шт

LOT 2007197

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20 °C 

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

●
Модель: 10060A/10060A в составе:

- Шприц, 65 мл
- Шприц, 65 мл
- Line T Type CLV
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

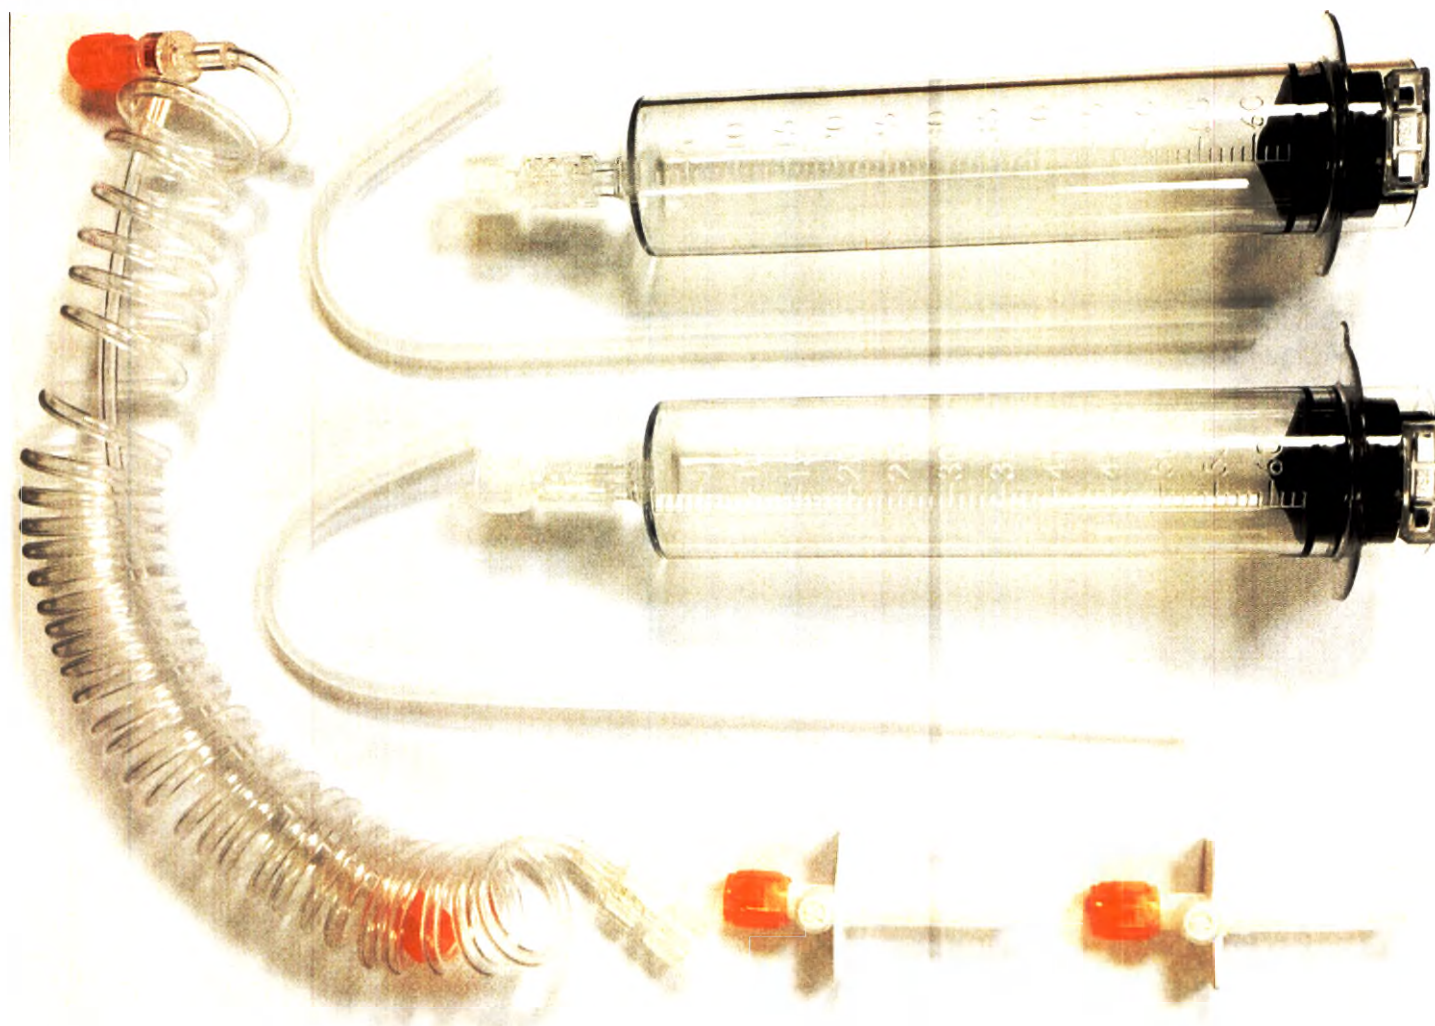

Шприцы и
соединительные линии
для инъекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 10060A/10060A

- Шприц 65 мл
- Шприц 65 мл
- Line T Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spike) - 2шт

LOT 2007198

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20 °C  25 °C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инъекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и
соединительные линии
для инъекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 10060A/10060A

- Шприц 65 мл
- Шприц 65 мл
- Line T Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spike) - 2шт

LOT 2007198

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20 °C  25 °C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инъекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

●
Модель: 100150М (2) в составе:

- Шприц, 150 мл
- CT Line Type SH
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

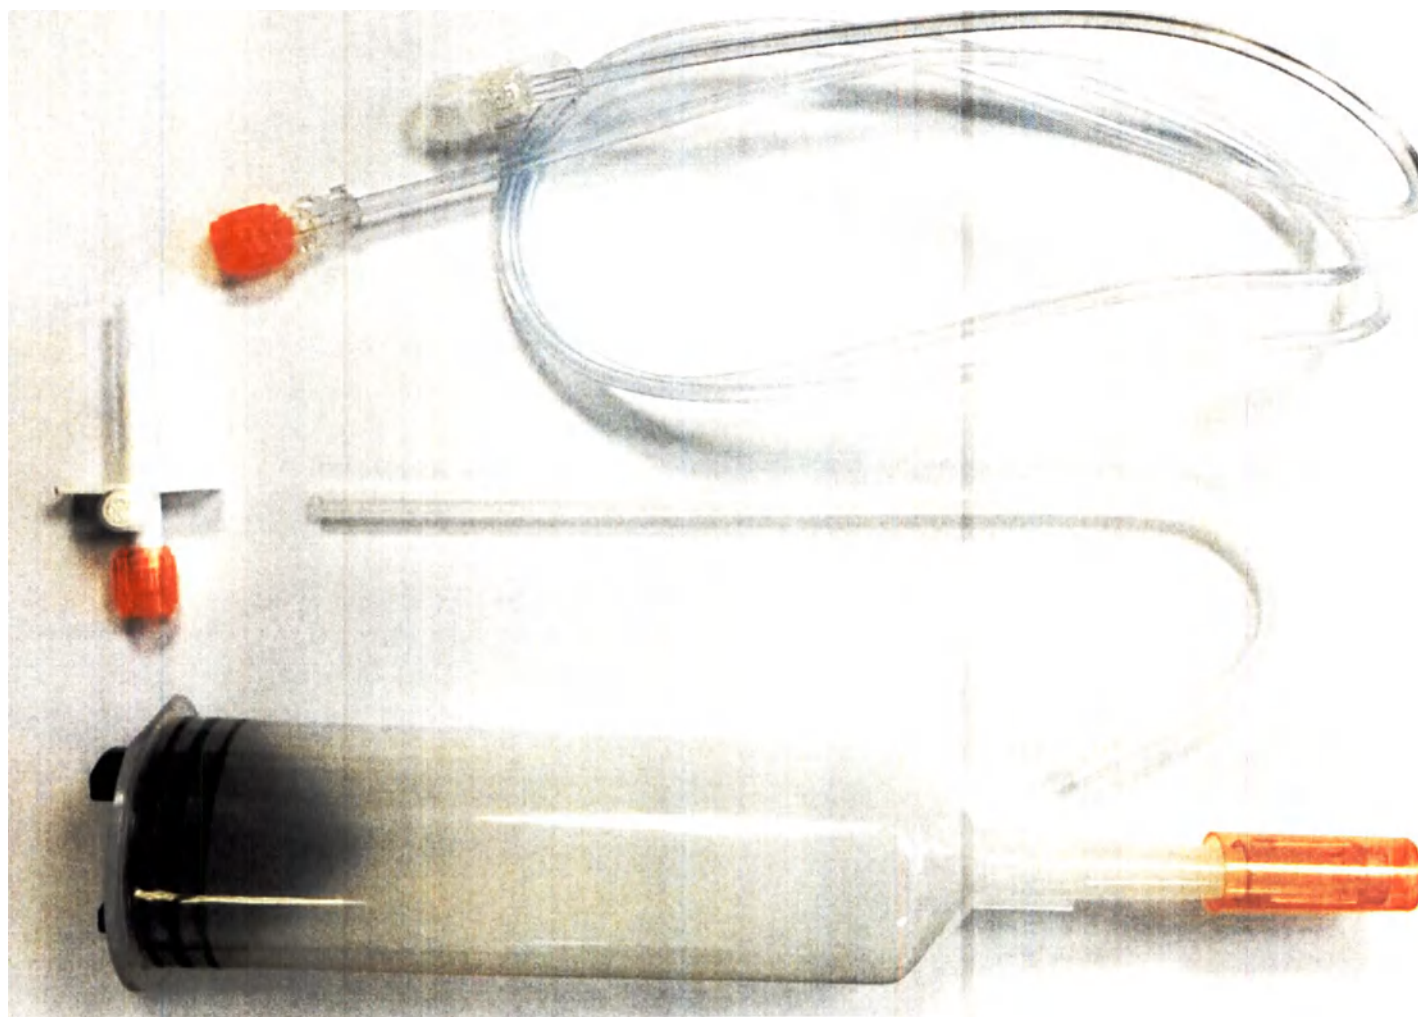

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100150M (2)

- Шприц 150 мл
- CT Line Type SH
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Splice)

LOT 2007199

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20 °C  25 °C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100150M (2)

- Шприц 150 мл
- CT Line Type SH
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Splice)

LOT 2007199

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20 °C  25 °C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

●
Модель: 100200М (2) в составе:

- Шприц, 200 мл
- CT Line Type SH
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

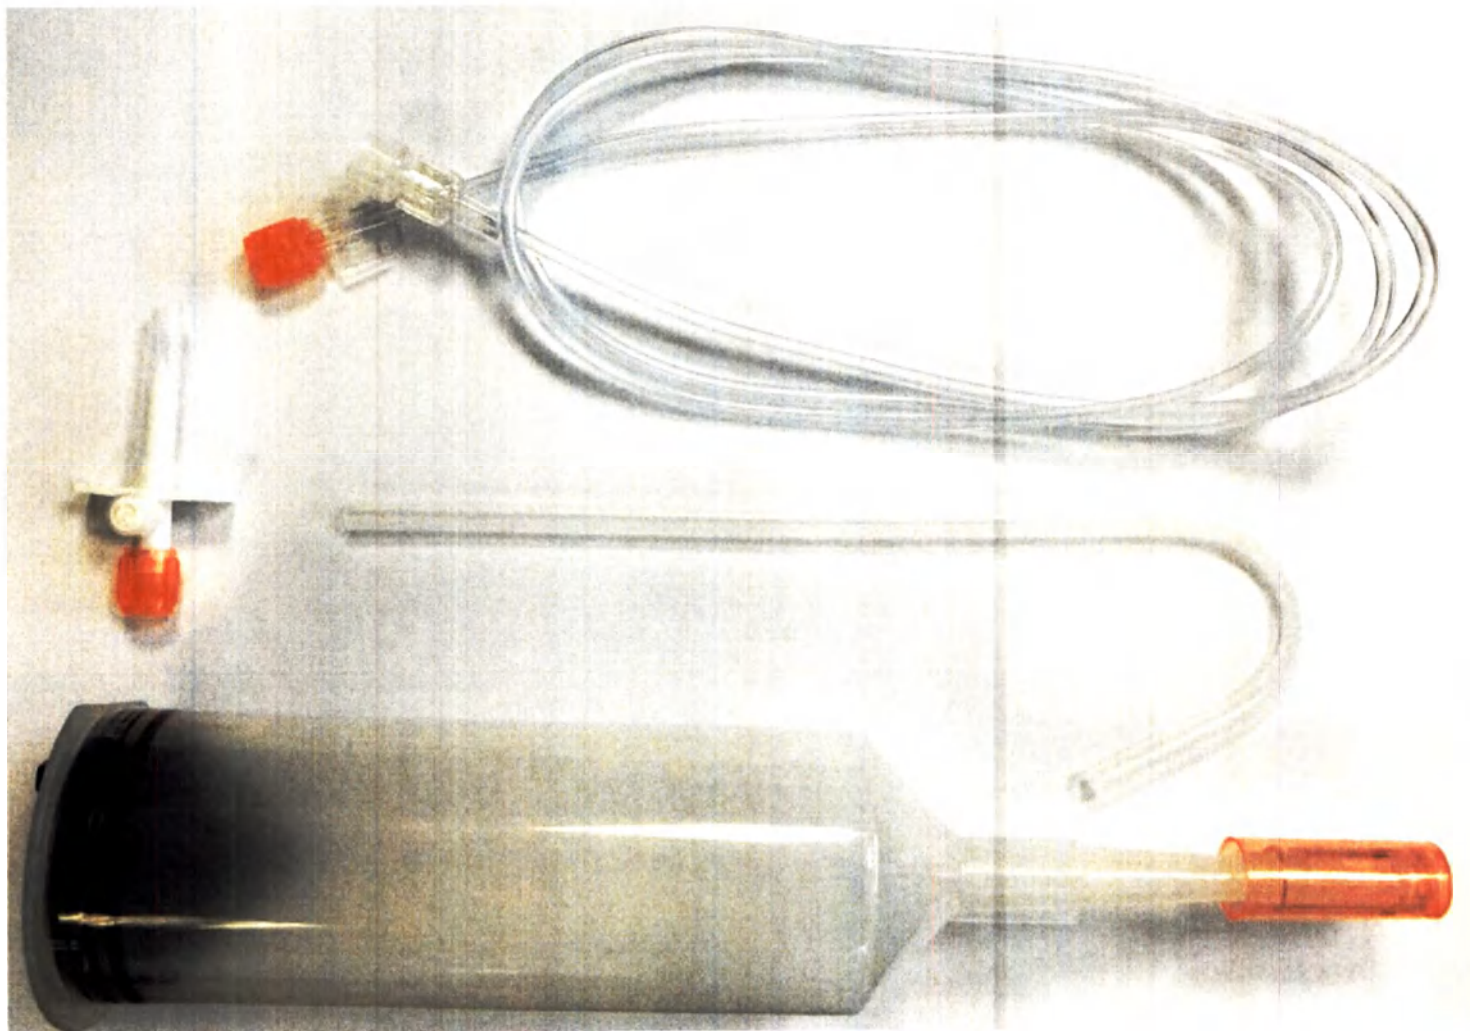

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100200M (2)

- Шприц 200 мл
- CT Line Type SH
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

LOT 2007200

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO  25 °C
20 °C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп.1, Литер А, пом.21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100200M (2)


- Шприц 200 мл
- CT Line Type SH
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

LOT 2007200

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO  25 °C
20 °C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп.1, Литер А, пом.21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

●
Модель: 100150MS (2) в составе:

- Шприц, 150 мл
- CT Line Type SH
- CT Line J-Type

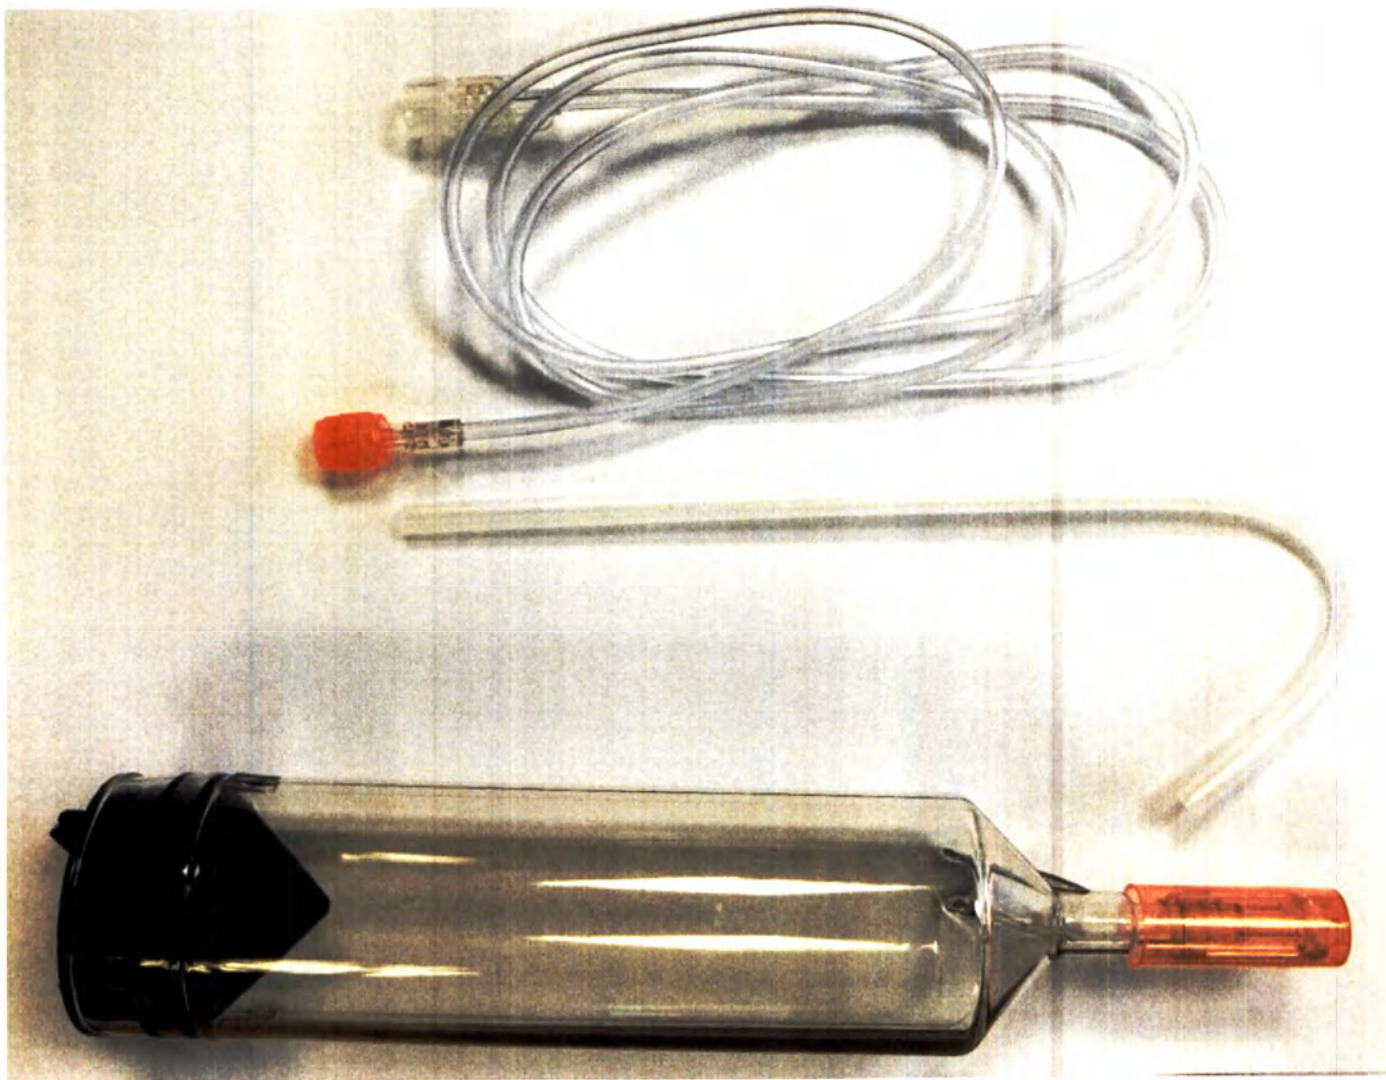

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100150MS (2)

- Шприц 150 мл
- CT Line Type SH
- CT Line J-Type

LOT 2007201

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE **EO**

20 °C  25 °C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100150MS (2)

- Шприц 150 мл
- CT Line Type SH
- CT Line J-Type

LOT 2007201

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE **EO**

20 °C  25 °C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

●
Модель: 300100В (2) в составе:

- Шприц, 100 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

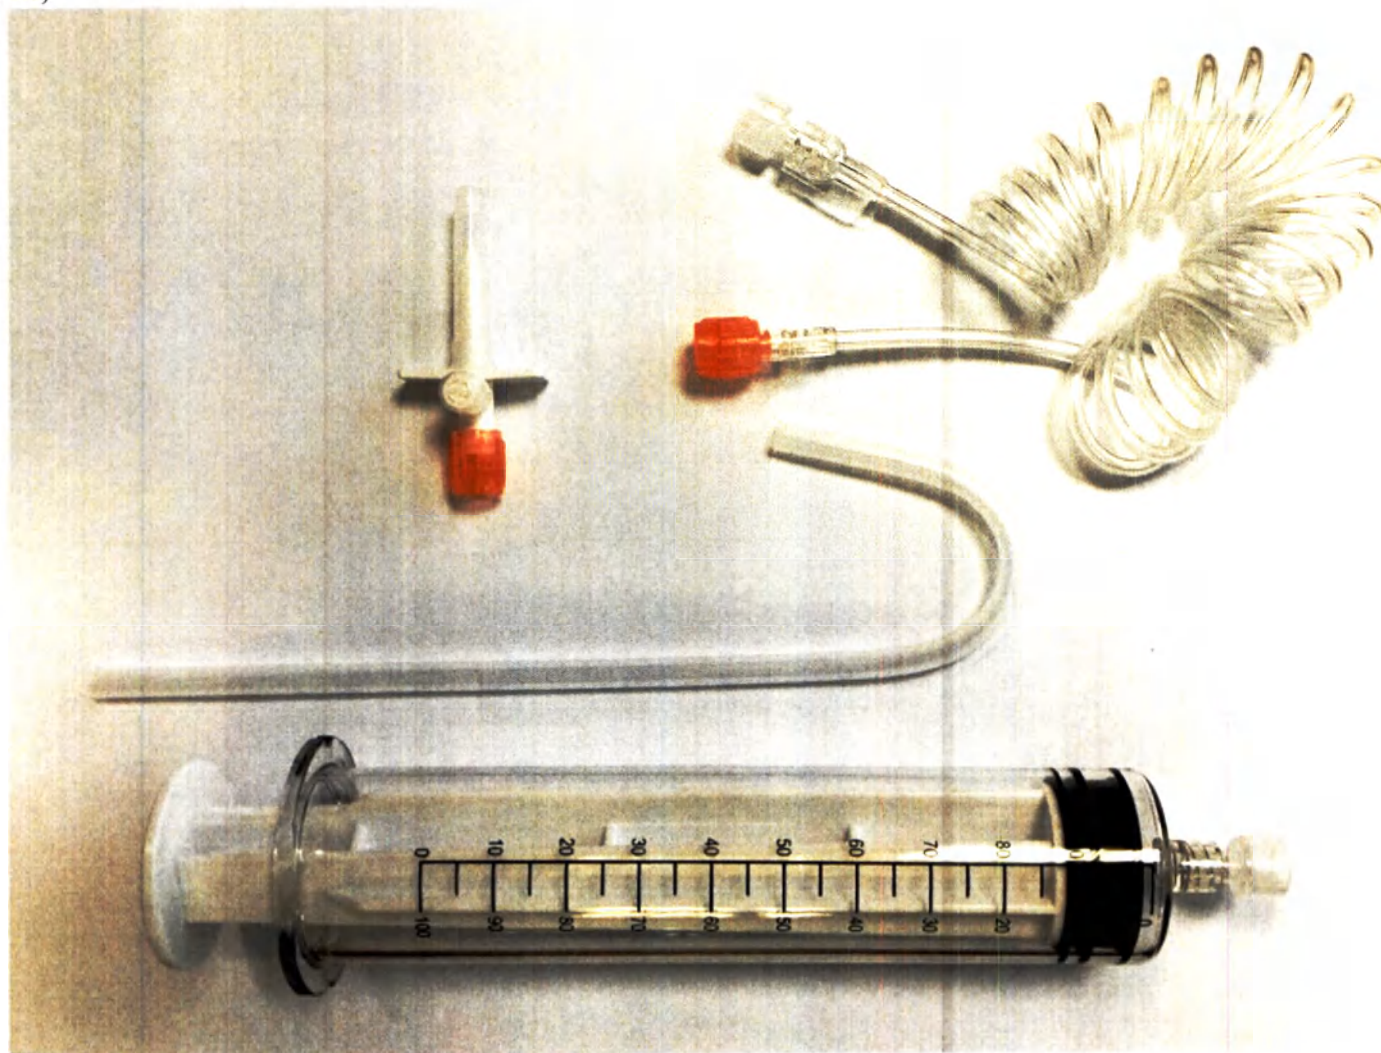

Шприцы и
соединительные линии
для инъекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF

300100B (2)

- Шприц 100 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

LOT

2007202



2020.07.12



2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инъекторами автоматическими



Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

Шприцы и
соединительные линии
для инъекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF

300100B (2)

- Шприц 100 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

LOT

2007202



2020.07.12



2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инъекторами автоматическими



Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

●
Модель: 300200В/300100В в составе:

- Шприц, 200 мл
- Шприц, 100 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

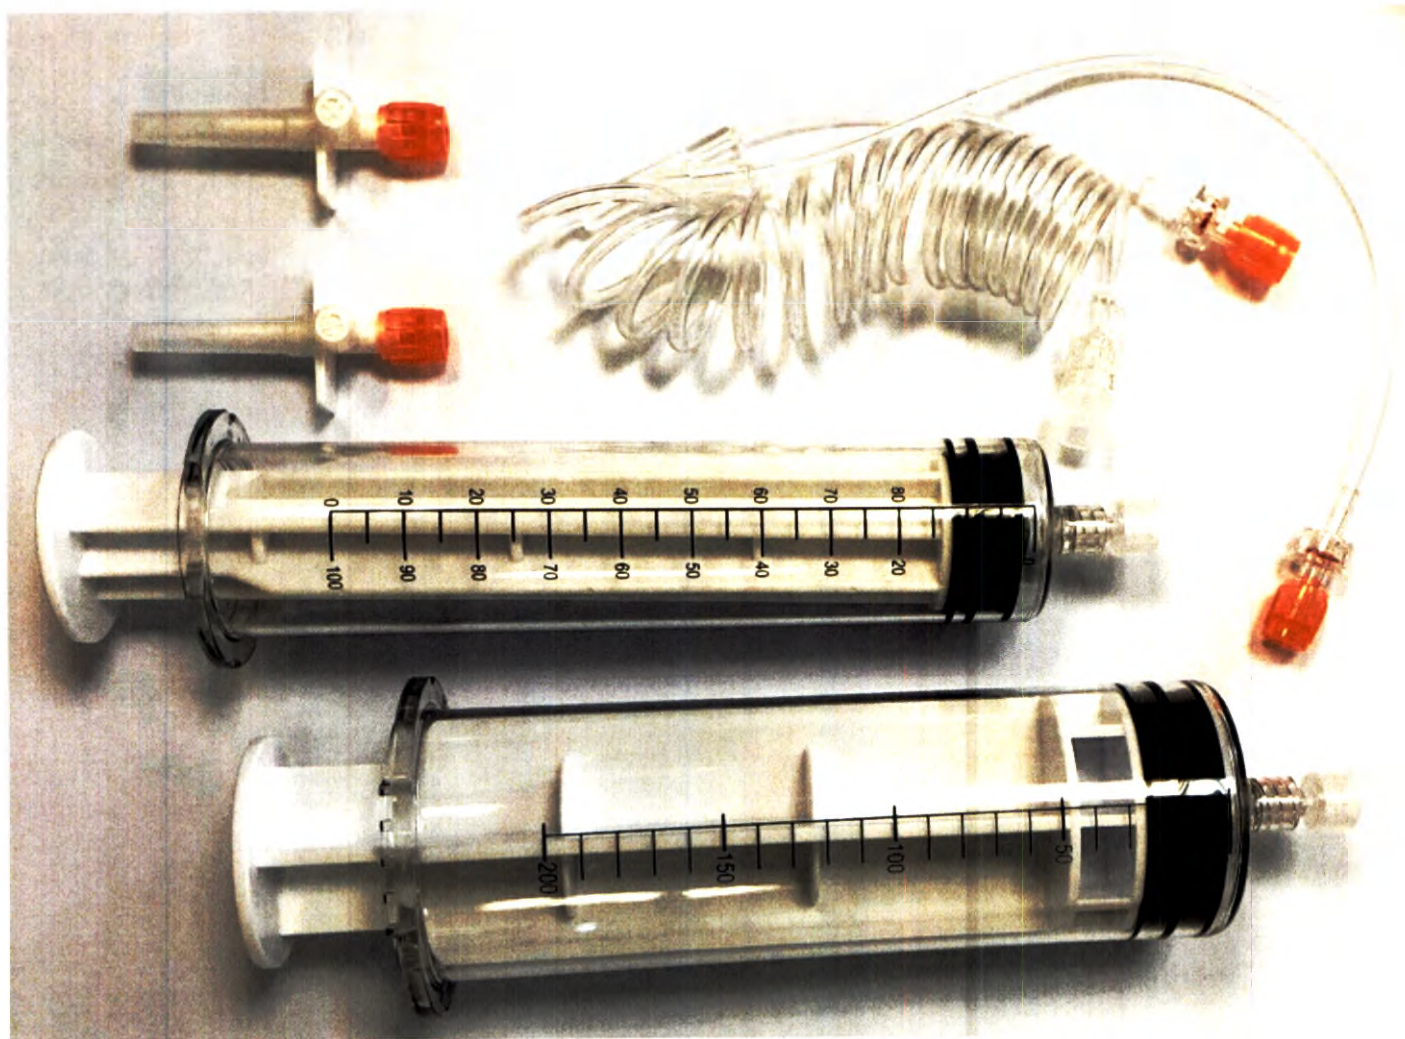

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 300200B/300100B

- Шприц 200 мл
- Шприц 100 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line Type (Spike) -2шт

LOT 2007203

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.»
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36, Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 300200B/300100B

- Шприц 200 мл
- Шприц 100 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line Type (Spike) -2шт

LOT 2007203

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.»
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36, Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

●
Модель: 300200В/300100В (2) в составе:

- Шприц, 200 мл
- Шприц, 100 мл
- Line Y Type CLV
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

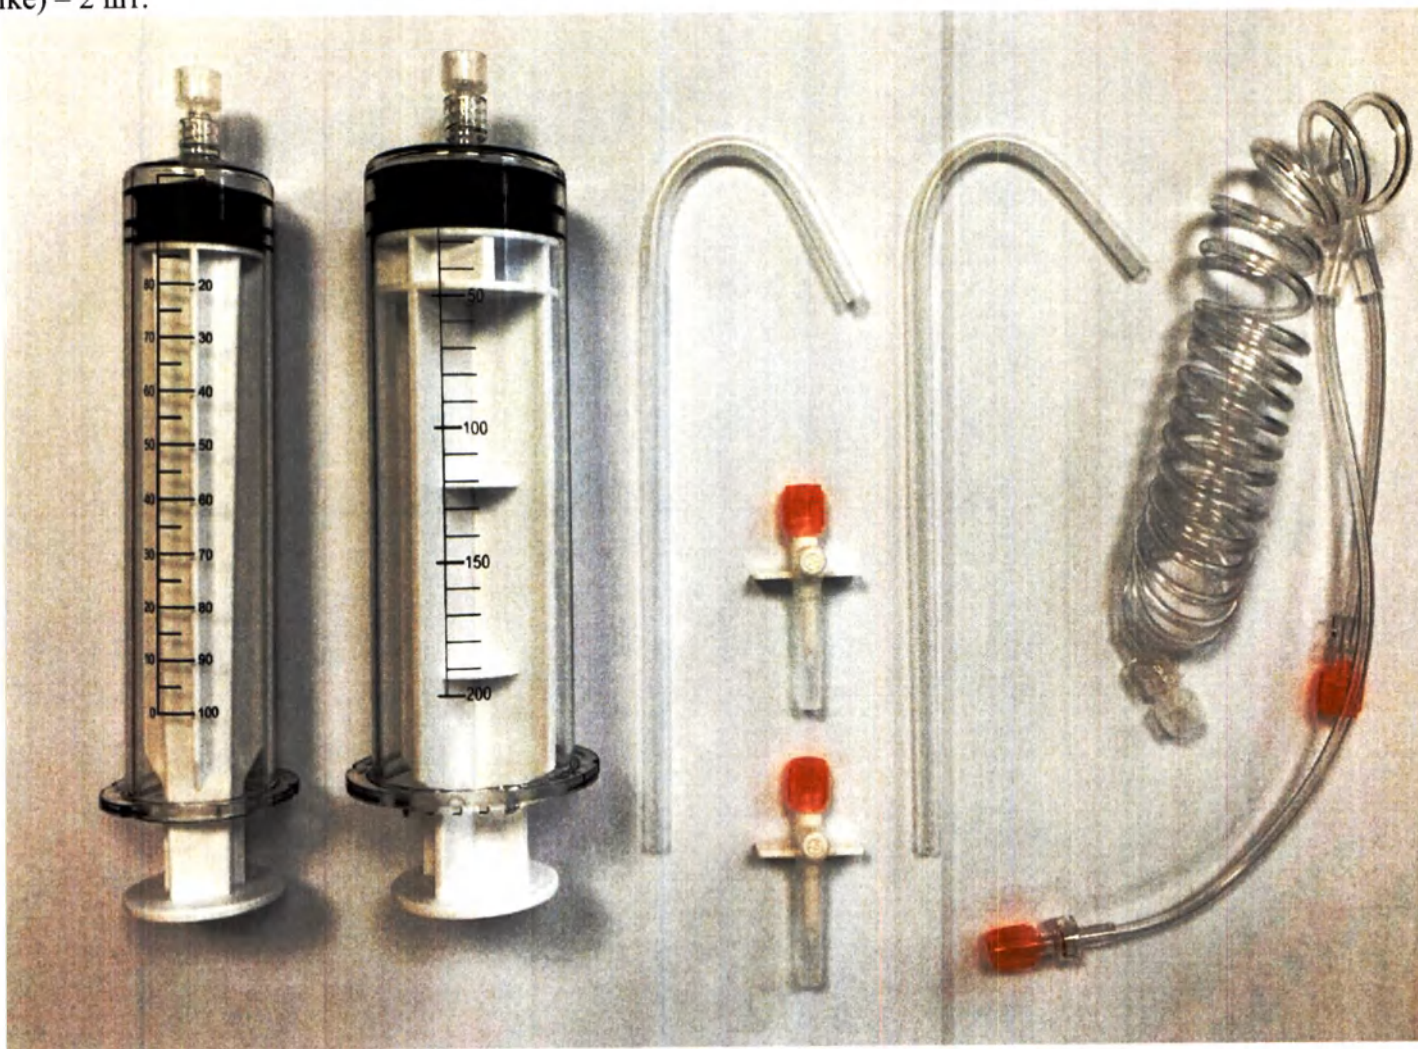

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 300200B/300100B (2)

- Шприц 200 мл
- Шприц 100 мл
- Line Y Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spike) - 2шт

LOT 2007204

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



20°C 25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими



«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd»,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Акзимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@akzimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь →

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 300200B/300100B (2)

- Шприц 200 мл
- Шприц 100 мл
- Line Y Type CLV
- CT Line J-Type - 2шт
- CT Line Type (Spike) - 2шт

LOT 2007204

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ТОКСИЧНО

НЕ ПИРОГЕННО

STERILE EO



20°C 25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd»,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Акзимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@akzimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения
Сделано в Китае

Открывать здесь →



Модель: 100060А в составе:

- Шприц, 60 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

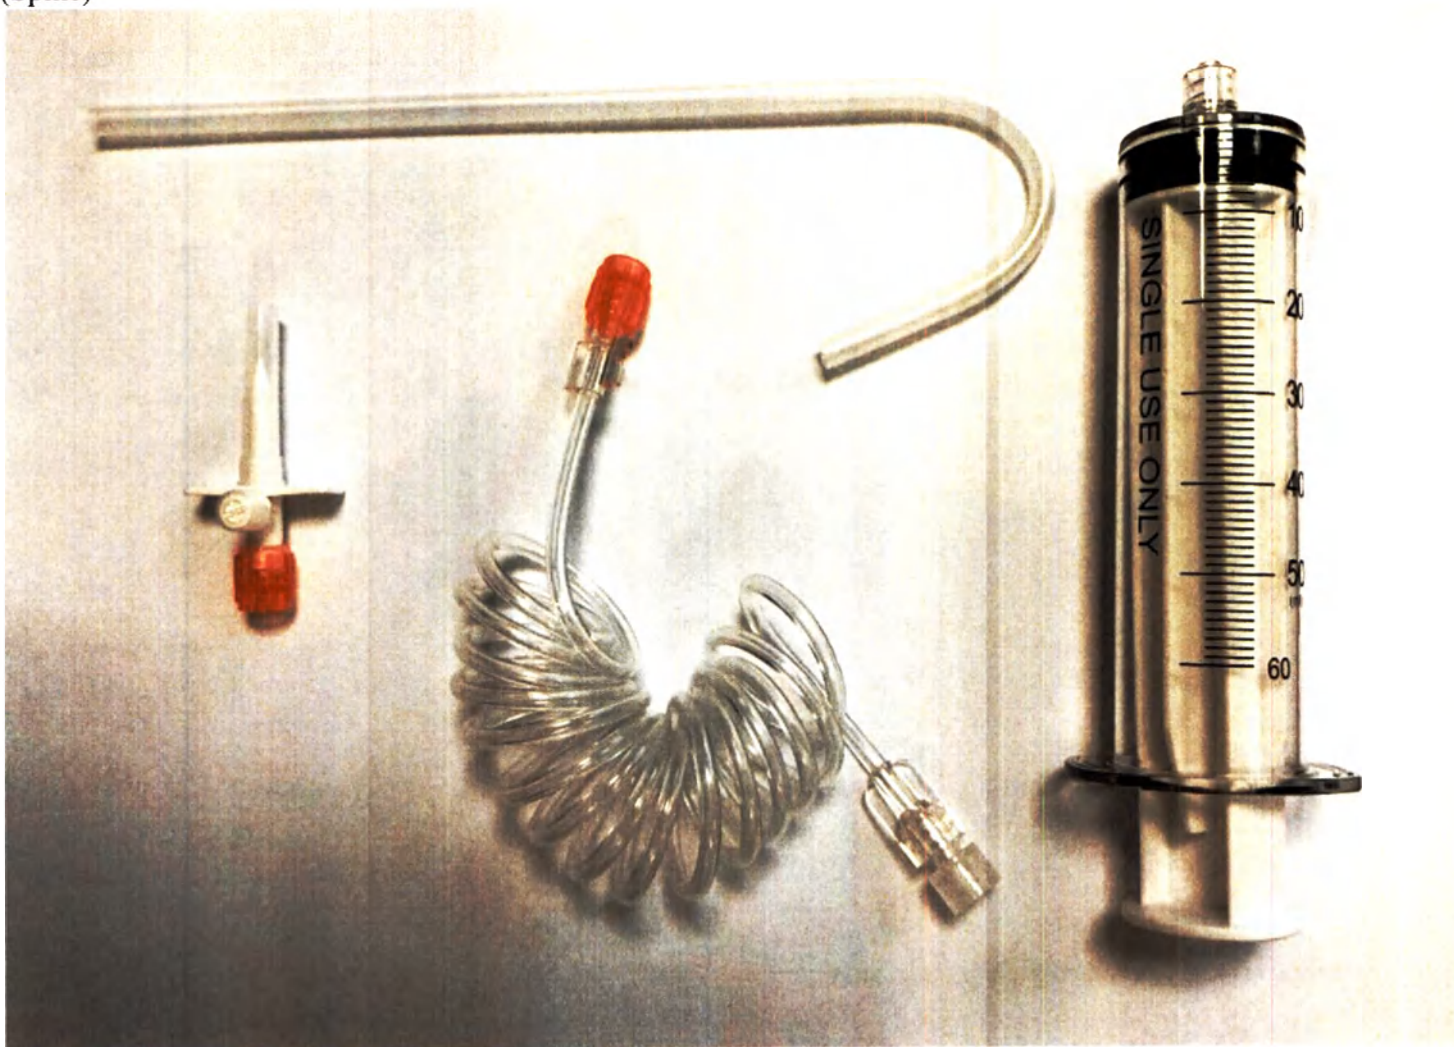

Шприцы и
соединительные линии
для инъекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF

100060A

- Шприц 60мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

LOT

2007205



2020.07.12



2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20 °C



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инъекторами автоматическими



Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Акзимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь



Шприцы и
соединительные линии
для инъекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF

100060A

- Шприц 60мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

LOT

2007205



2020.07.12



2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20 °C



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инъекторами автоматическими

Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Акзимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения


Сделано в Китае

Открывать здесь



Модель: 100050А (2) в составе:

- Шприц, 50 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

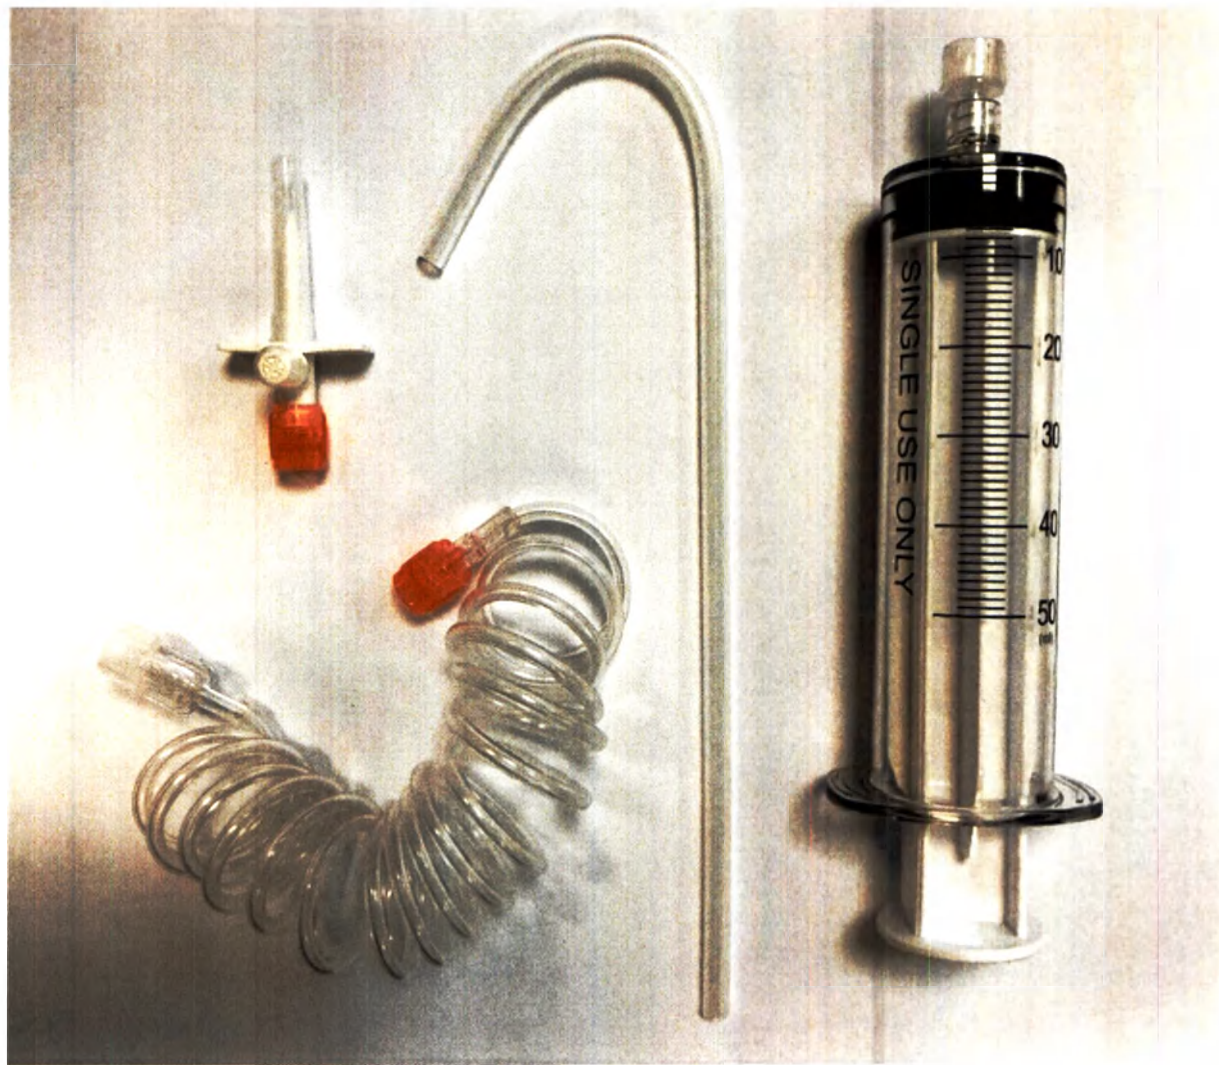

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100050A (2)

- Шприц 50 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

LOT 2007206

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20°C  25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими



Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100050A (2)

- Шприц 50 мл
- CT Line Type CL
- CT Line J-Type
- CT Line Type (Spike)

LOT 2007206

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20°C  25°C

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Модель: 100060A/100060A в составе:

- Шприц, 60 мл
- Шприц, 60 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

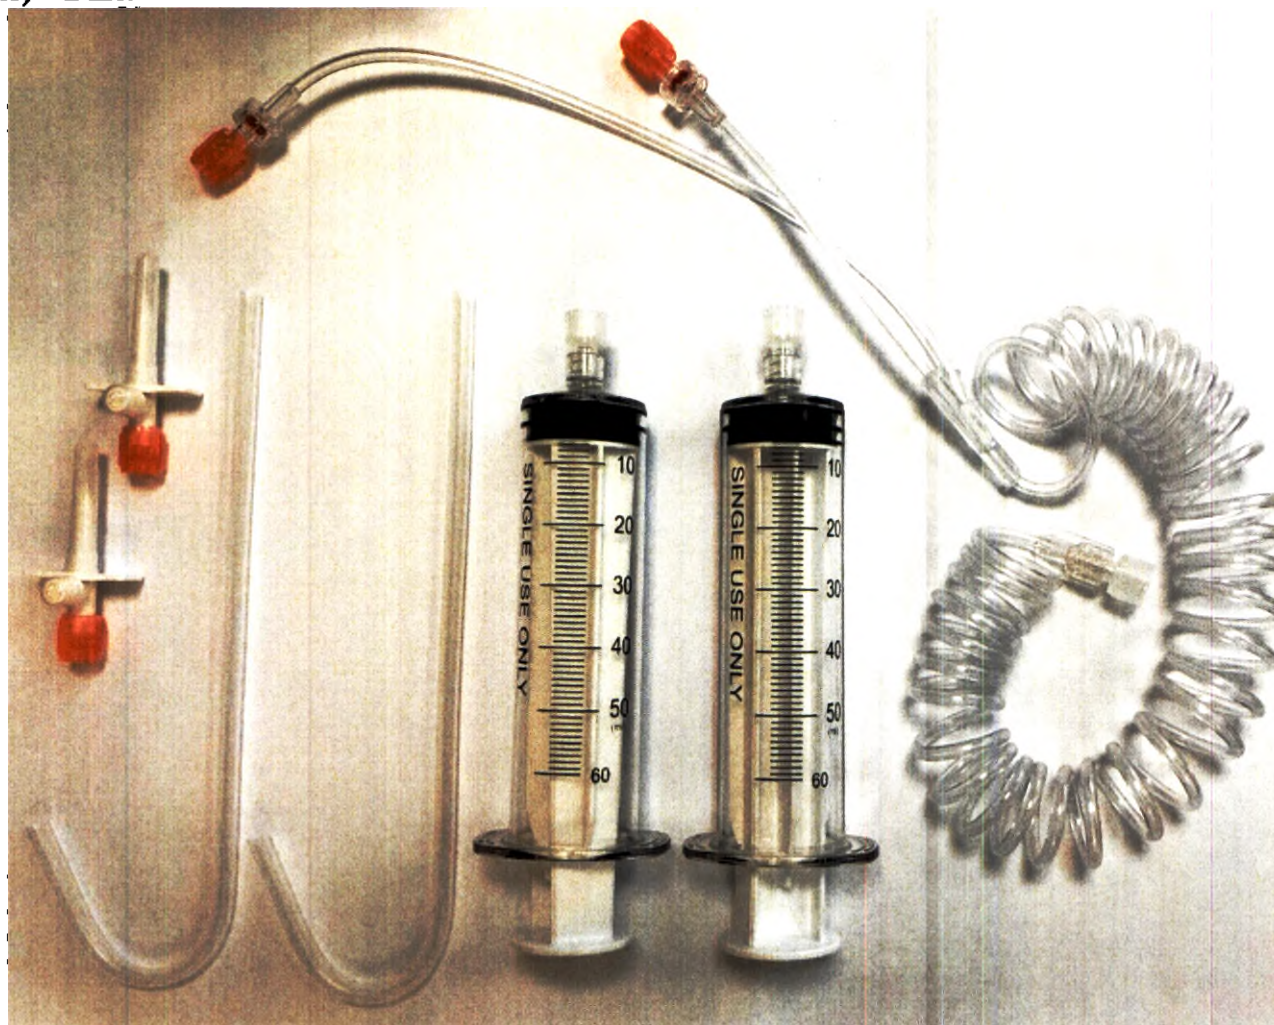

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100060A/100060A

- Шприц 60мл
- Шприц 60мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type-2шт
- CT Line Type (Spike) -2шт

LOT 2007207

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20°C 

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп.1, Литер А, пом.21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF 100060A/100060A

- Шприц 60мл
- Шприц 60мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type-2шт
- CT Line Type (Spike) -2шт

LOT 2007207

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO

20°C 

Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

 Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя


ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп.1, Литер А, пом.21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения
Сделано в Китае

Открывать здесь 

●
Модель: 200200A/200200A в составе:

- Шприц, 200 мл
- Шприц, 200 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

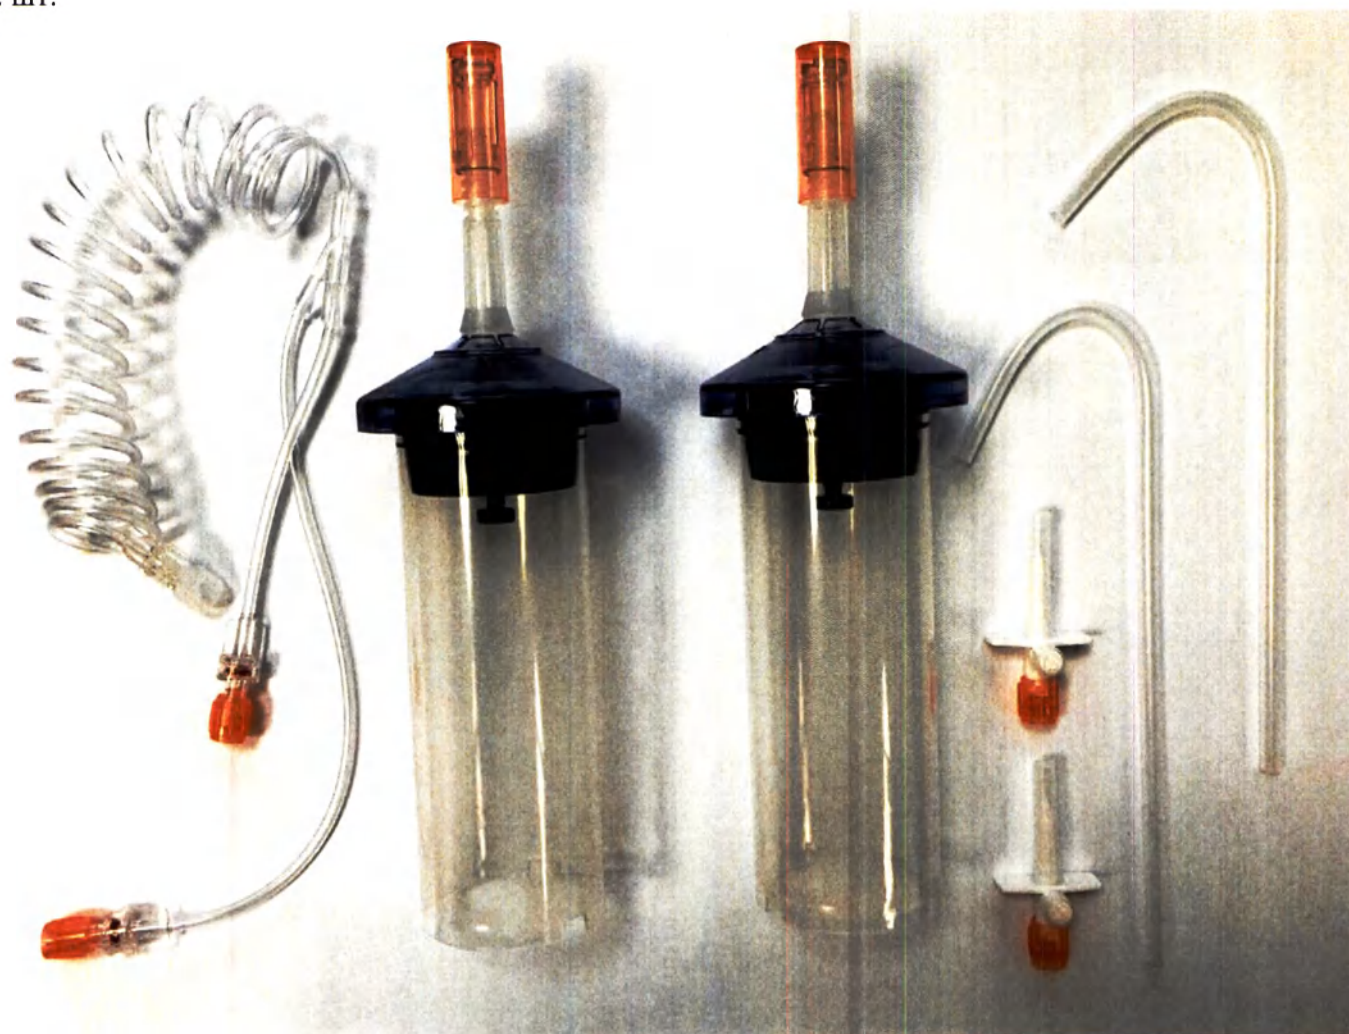

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 200200A/200200A

- Шприц 200 мл
- Шприц 200 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type-2шт
- CT Line Type (Spike) -2шт

LOT 2007208

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.»,
No. 115, Nongxinbe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 200200A/200200A

- Шприц 200 мл
- Шприц 200 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type-2шт
- CT Line Type (Spike) -2шт

LOT 2007208

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.»,
No. 115, Nongxinbe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

Модель: 10060C/10060C в составе:

- Шприц, 60 мл
- Шприц, 60 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

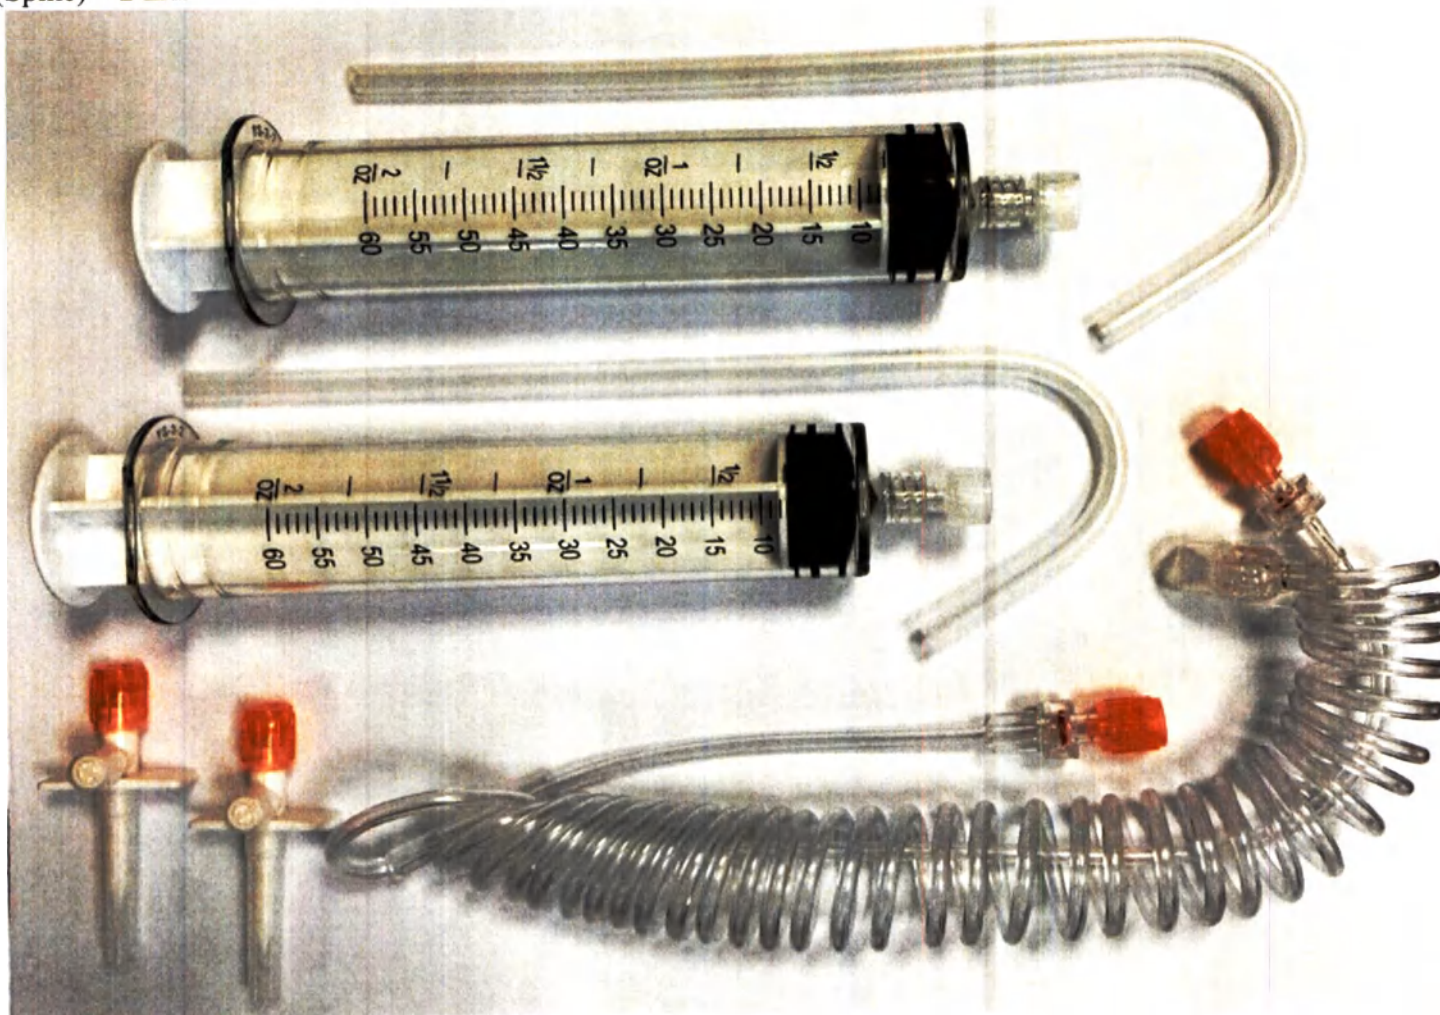

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

REF

10060C/10060C

- Шприц 60 мл
- Шприц 60 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type-2шт
- CT Line Type (Spike) -2шт

LOT

2007209



2020.07.12




2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

Шприцы и
соединительные линии
для инжекторов
автоматических для
ангиографии,
компьютерной и
магниторезонансной
томографии, модель

10060C/10060C

- Шприц 60 мл
- Шприц 60 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type-2шт
- CT Line Type (Spike) -2шт

LOT

2007209



2020.07.12



2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО



STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими

Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя

ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36;
Email: info@aktimed-plus.ru


№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

●
Модель: 400200А/400065А в составе:

- Шприц, 200 мл
- Шприц, 65 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

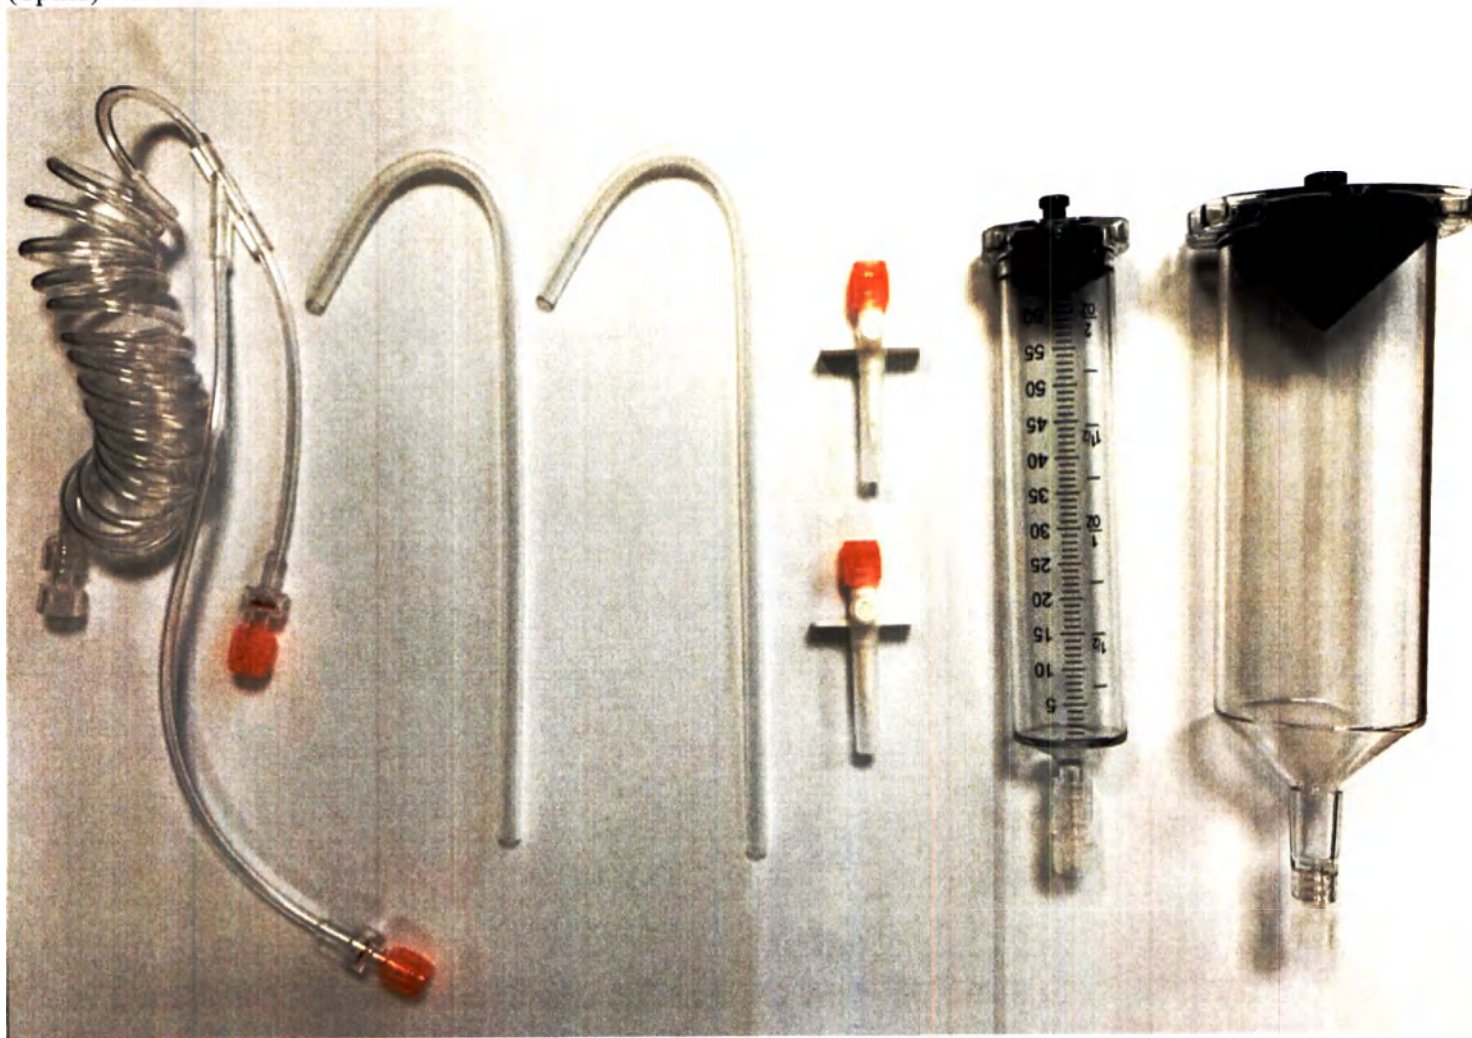

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 400200A/400065A

- Шприц 200 мл
- Шприц 65 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type-2шт
- CT Line Type (Spike) -2шт

LOT 2007210

2020.07.12

2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими



«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd»,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 400200A/400065A
LOT 2007210
2020.07.12
2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими


Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.,
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом. 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru

Открывать здесь

●
Модель: 100200С/100200С (2) в составе:

- Шприц, 200 мл
- Шприц, 200 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type – 2 шт.
- CT Line Type (Spike) – 2 шт.

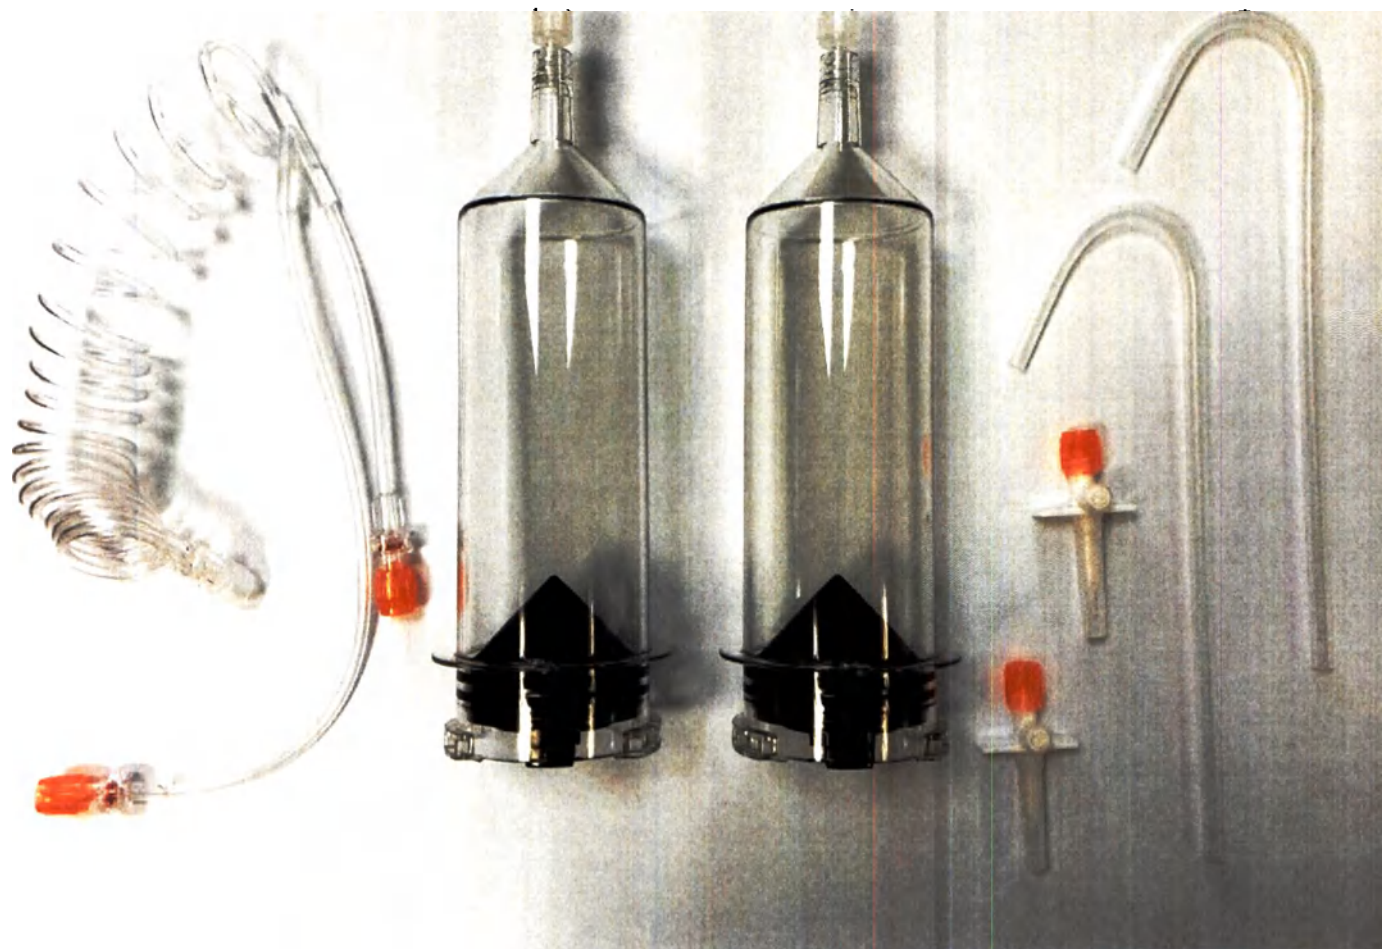

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 100200C/100200C (2)

- Шприц 200 мл
- Шприц 200 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type-2шт
- CT Line Type (Spoke) -2шт

LOT 2007216

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими



«Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.»
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения

Сделано в Китае

Открывать здесь 

Шприцы и соединительные линии для
инжекторов автоматических для
ангиографии, компьютерной и
магниторезонансной томографии, модель

REF 100200C (2)

- Шприц 200 мл
- Шприц 200 мл
- Line Y Type CL2V
- CT Line J-Type-2шт
- CT Line Type (Spoke) -2шт

LOT 2007216

 2020.07.12

 2025.07.12

НЕ ПИРОГЕННО

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE EO



Подходит для использования с
электрическими шприцевыми насосами
или с инжекторами автоматическими


Wuxi Yushou Medical Appliances Co. Ltd.
No. 115, Nongxinhe Road, Xishan District,
214191 Wuxi City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Уполномоченный представитель производителя
ООО «Актимед плюс», Россия,
194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского,
д. 43, корп. 1, Литер А, пом 21-32
Телефон +7 (812) 448-95-36; Email: info@aktimed-plus.ru

№ и дата регистрационного удостоверения
Сделано в Китае


Открывать здесь 


CT Line Type (линия насоса)


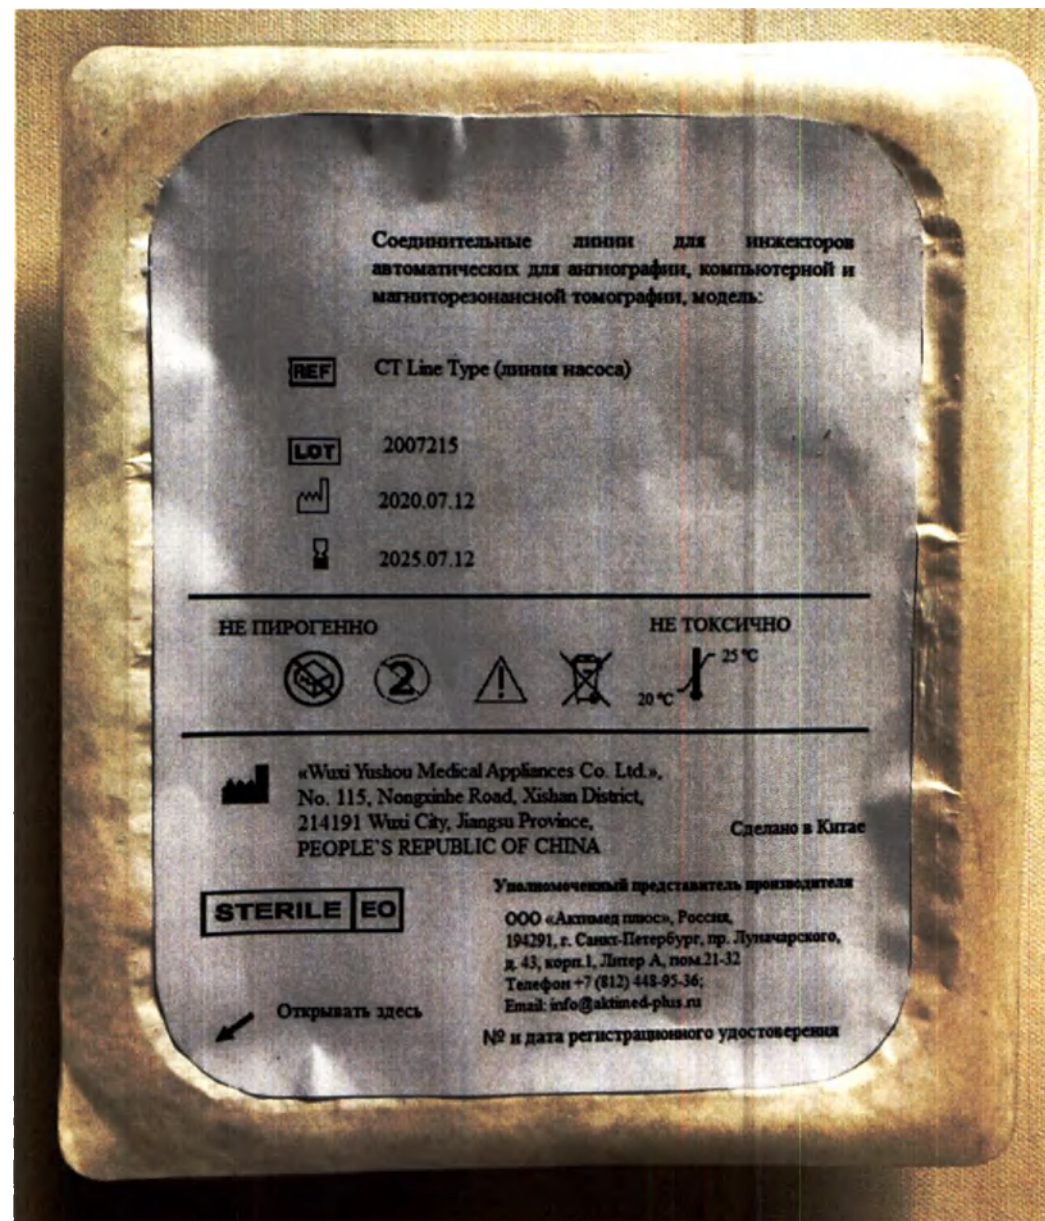



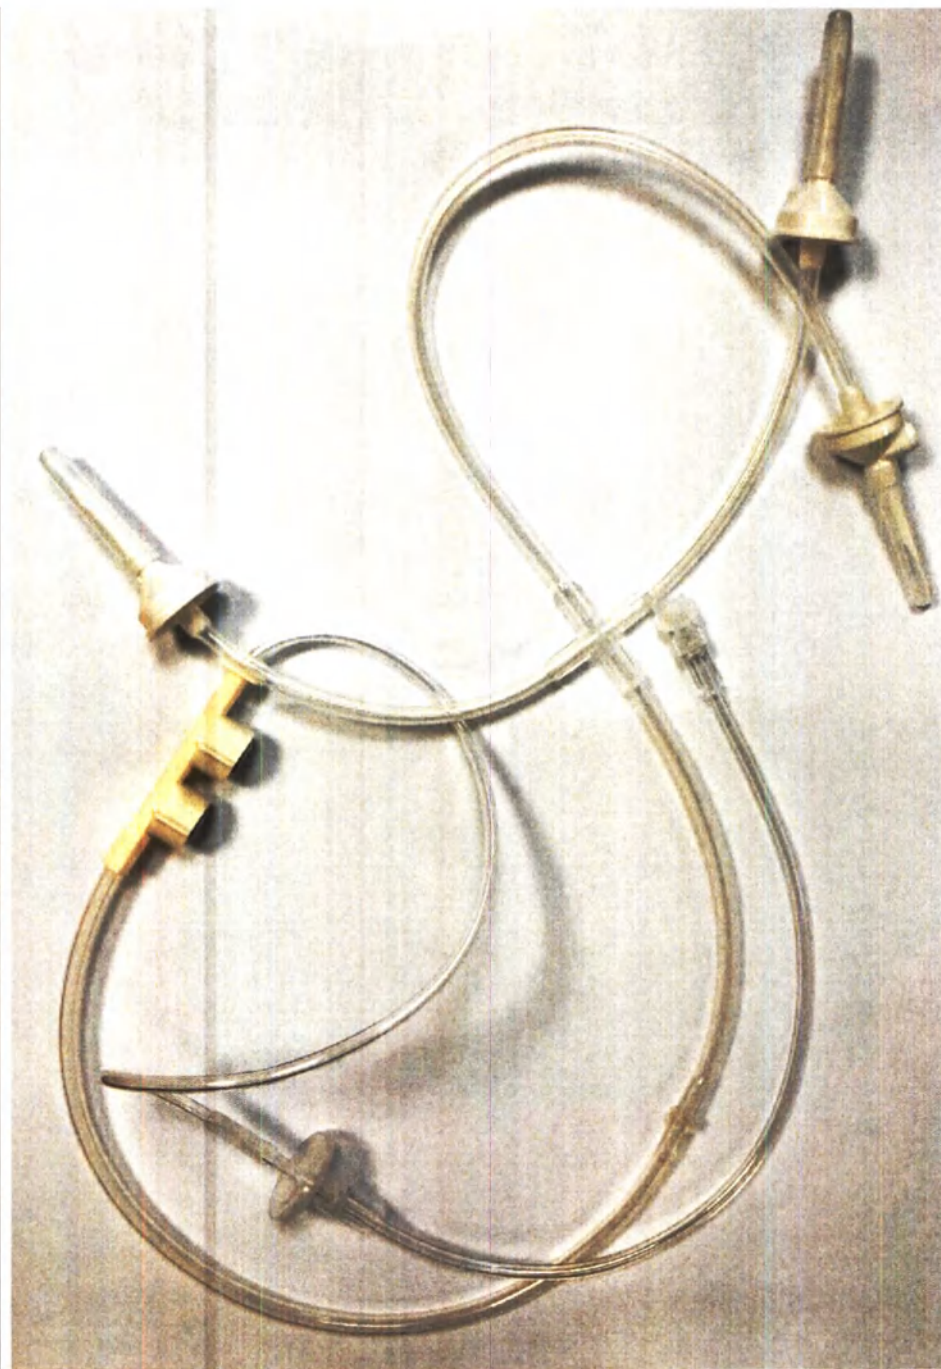


CT Line Type (линия пациента)

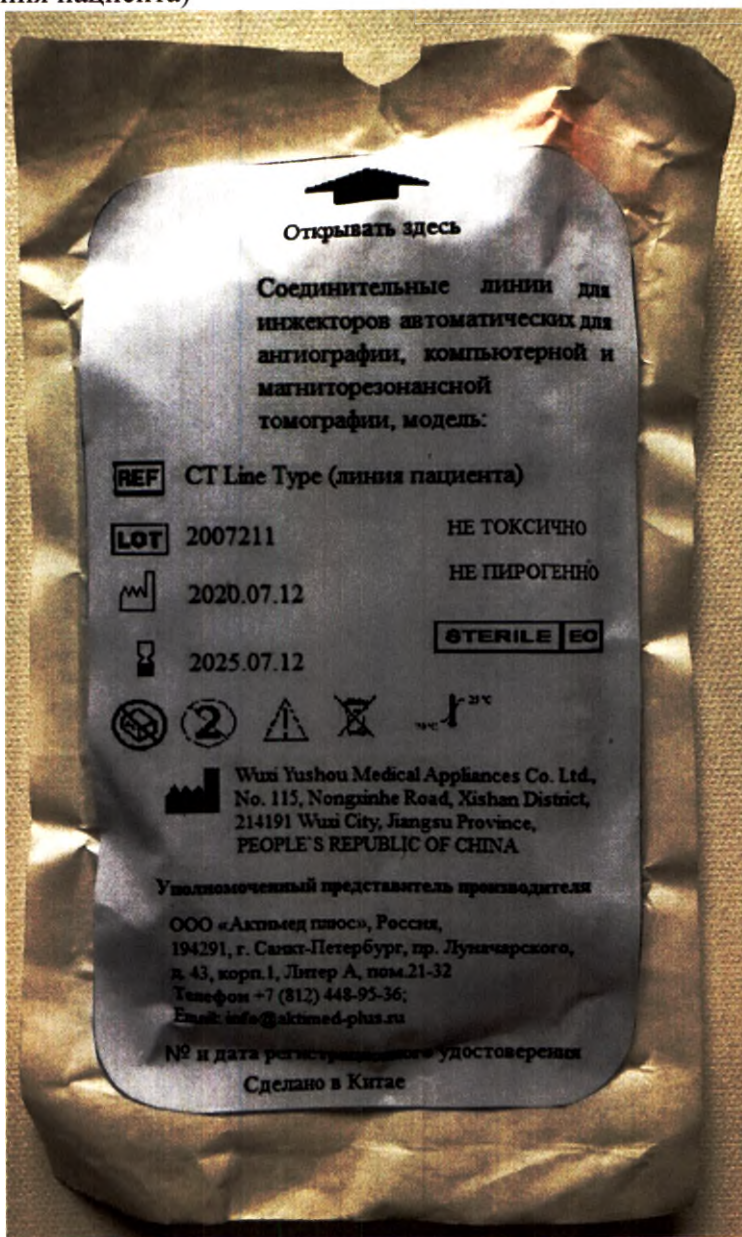

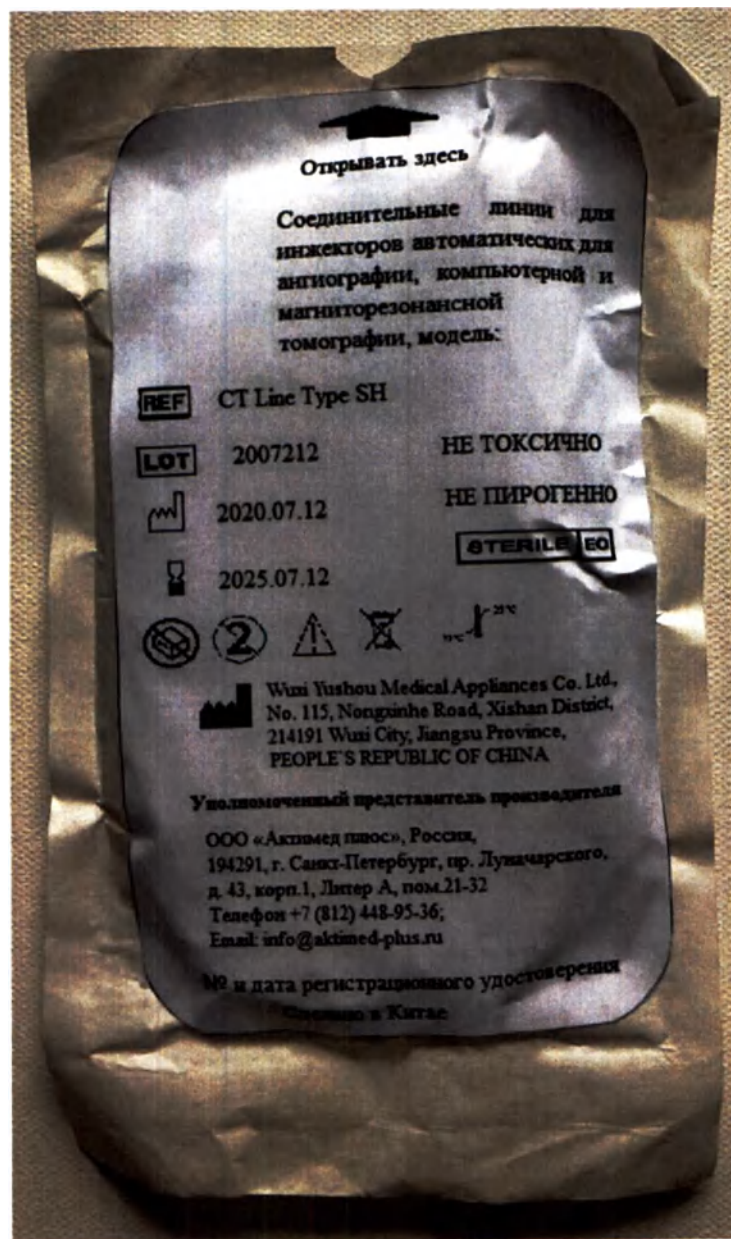

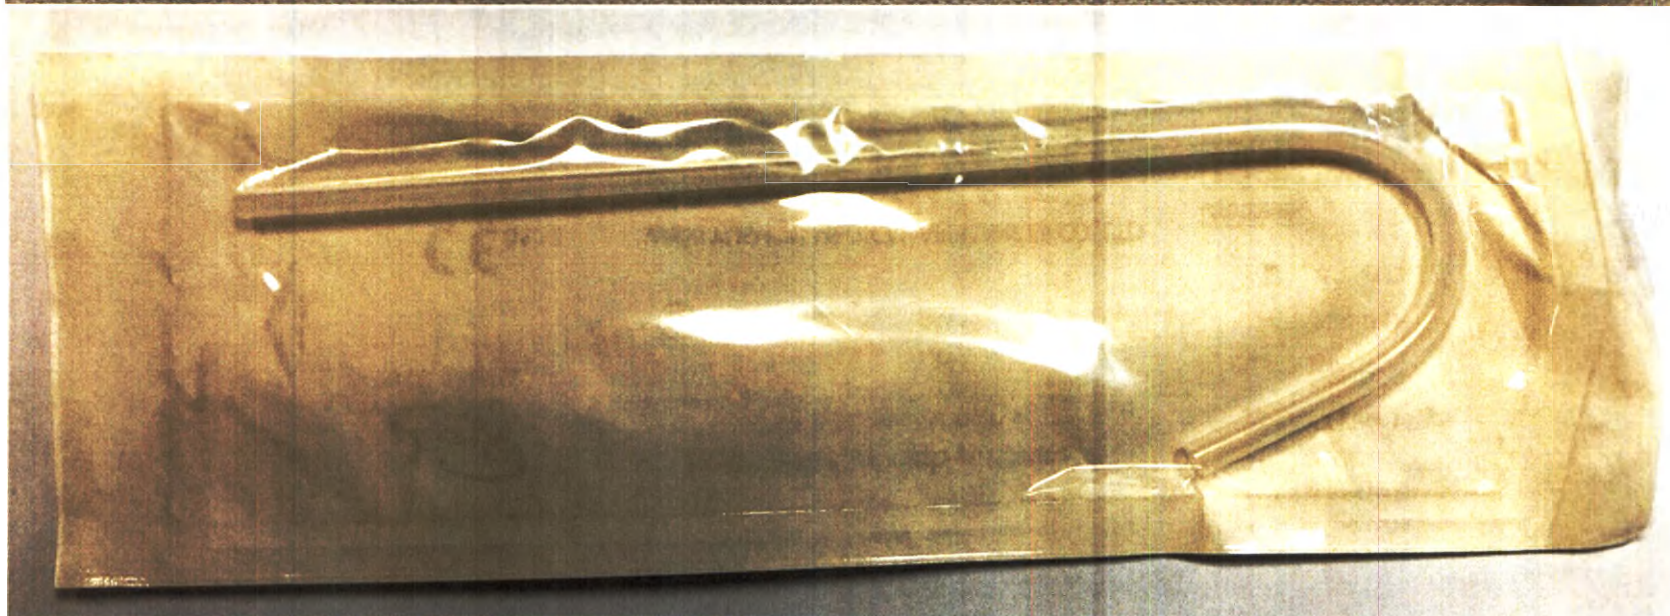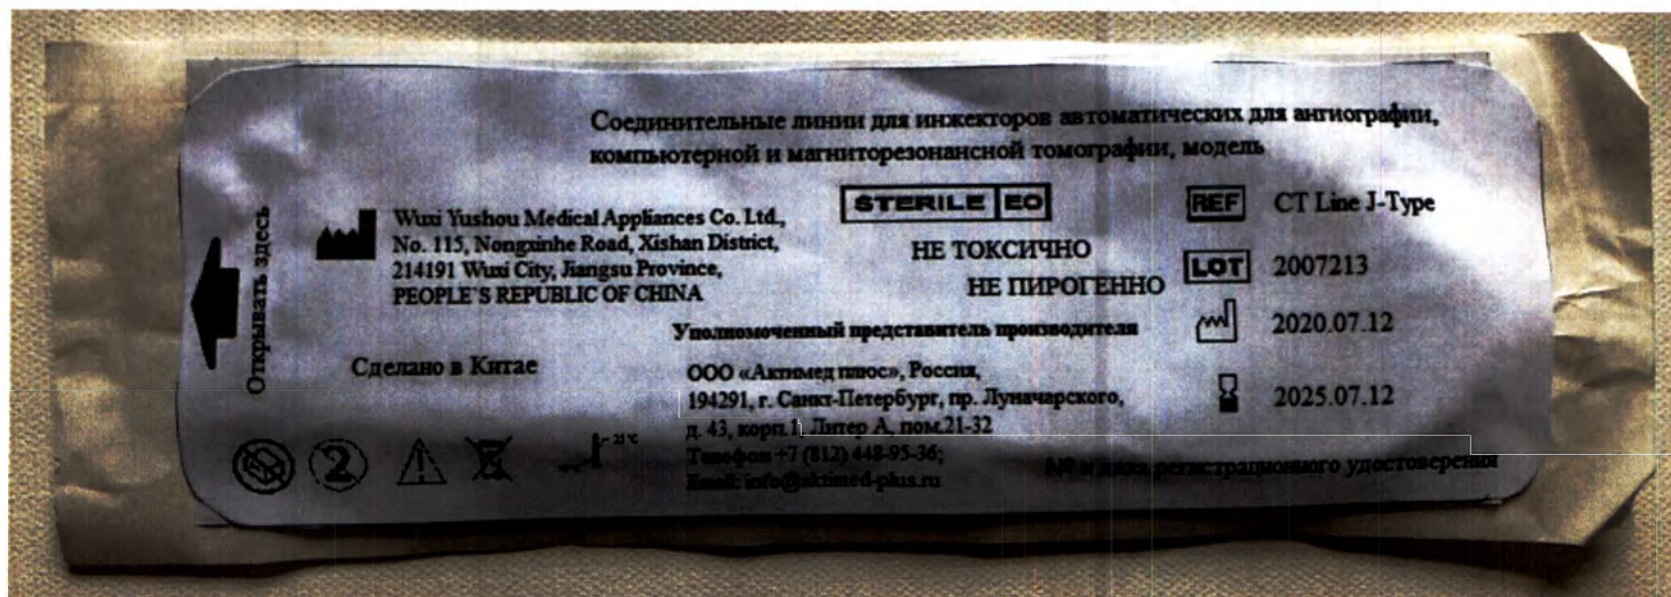

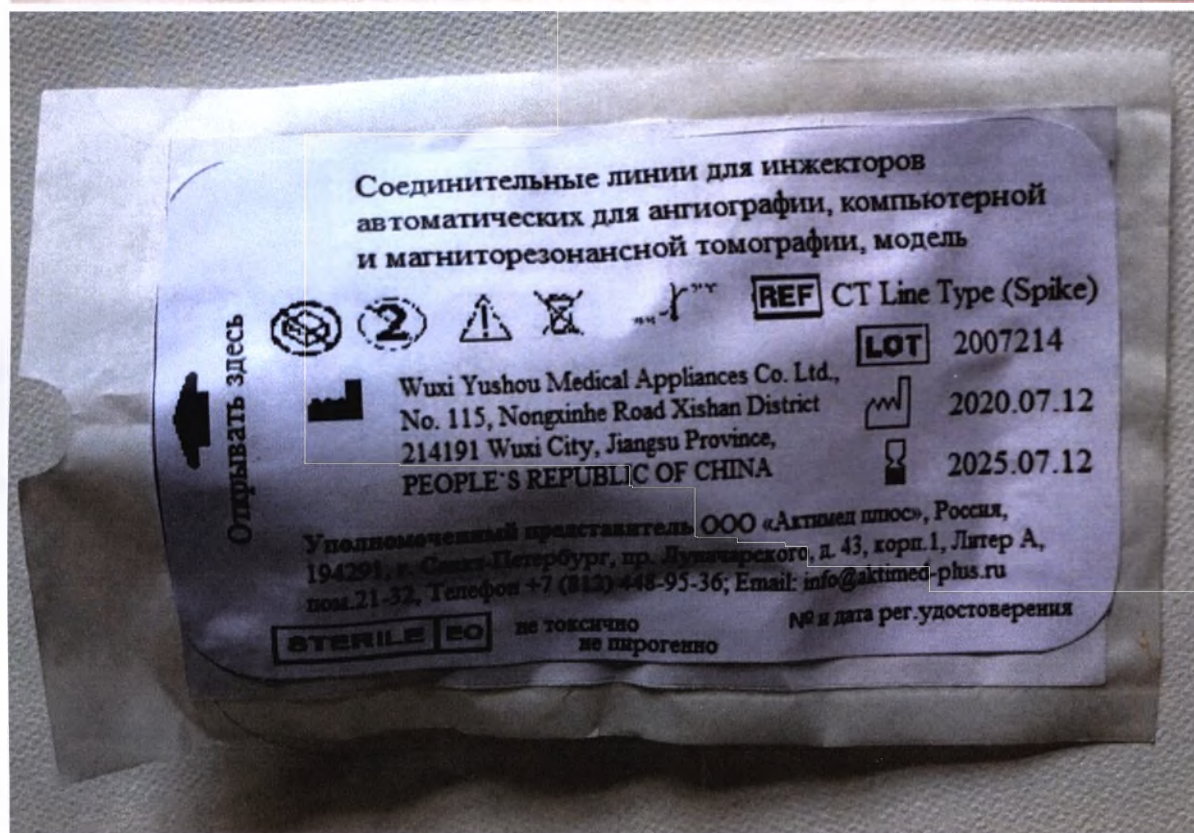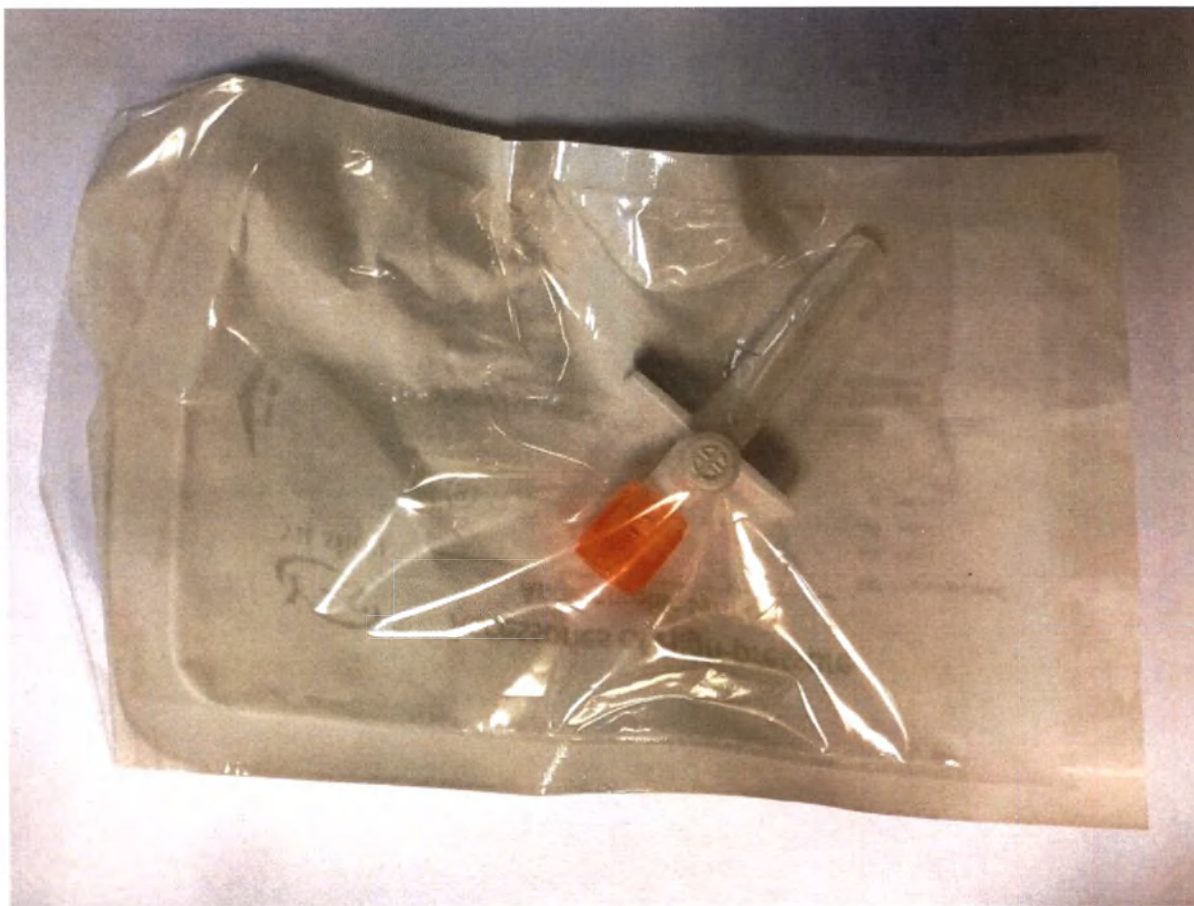

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
27 (двадцать семь) листов

Генеральный директор ООО «Актимед плюс»

Подпись / В.А.Полов /

