

Руководитель группы

ООО «Сименс Здравоохранение»




И.И.Левитский

«16» июня 2023 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система мобильная рентгеновская для ангиографических и рентгеноскопических процедур Cios Flow с принадлежностями»

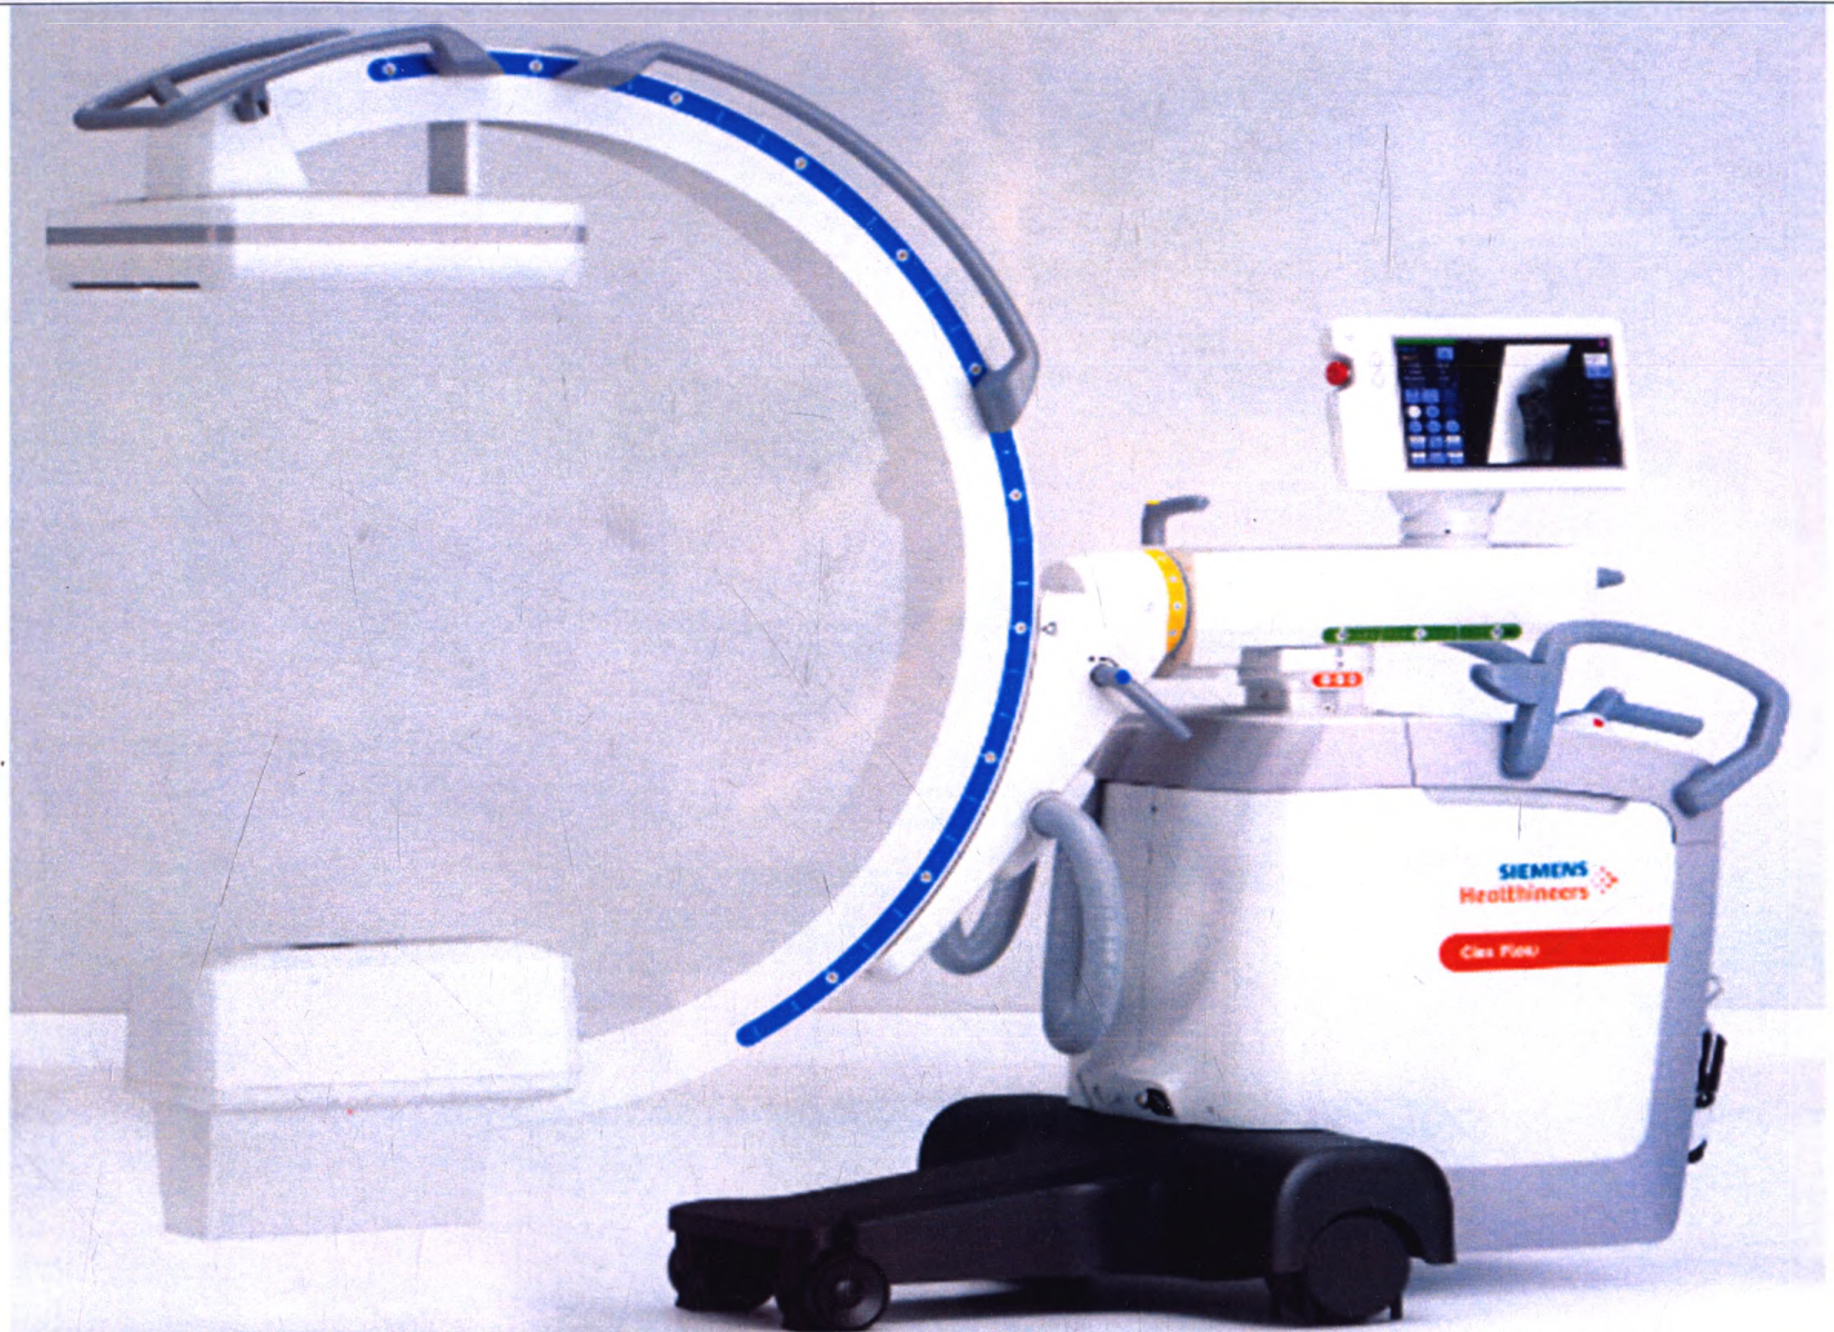




С-образная дуга. Мобильный штатив с блоком электроники и С-дугой.

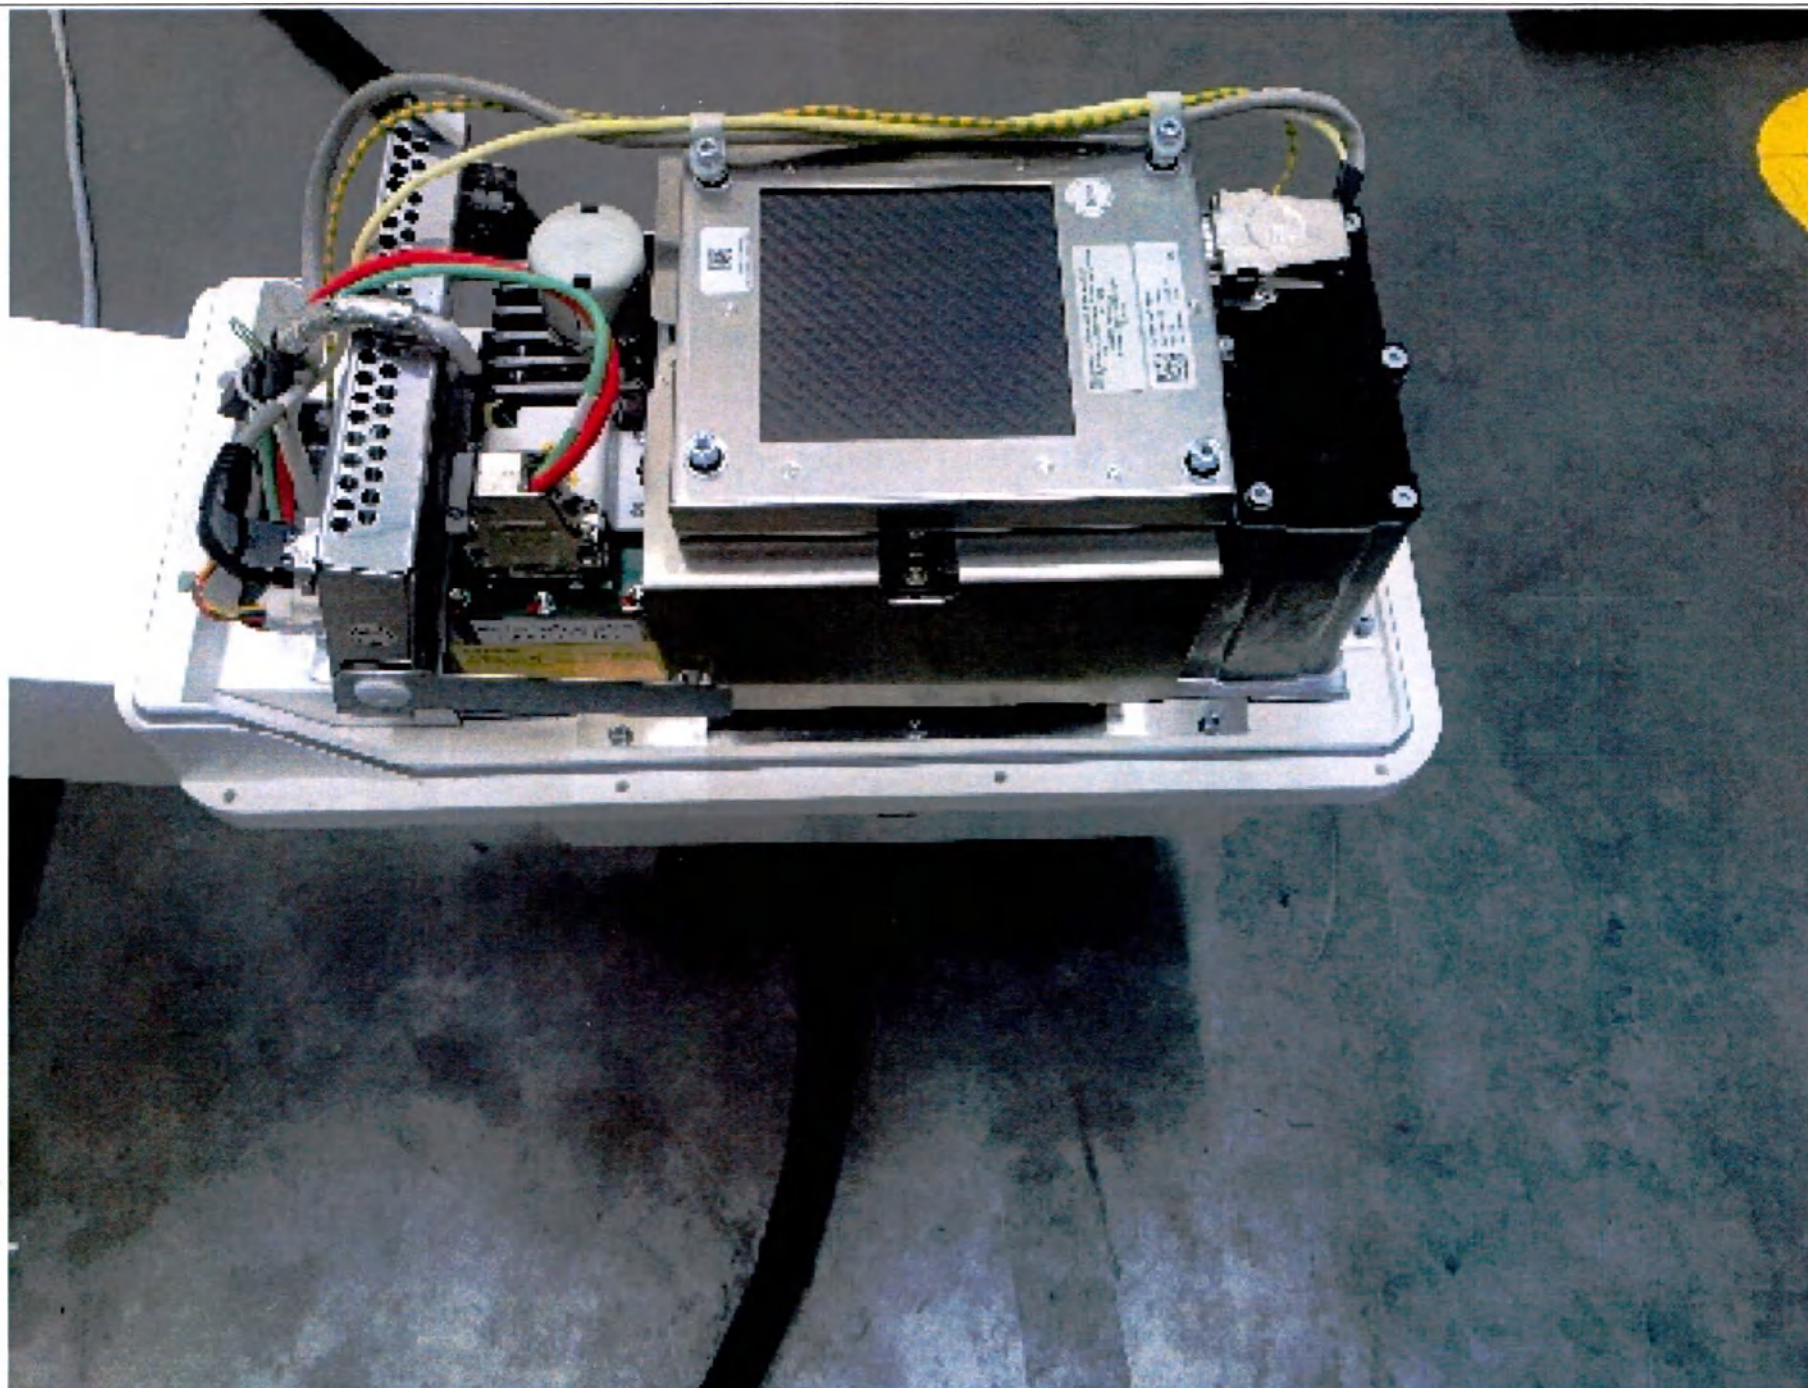

С-образная дуга. Моноблочная рентгеновская трубка со встроенным коллиматором.

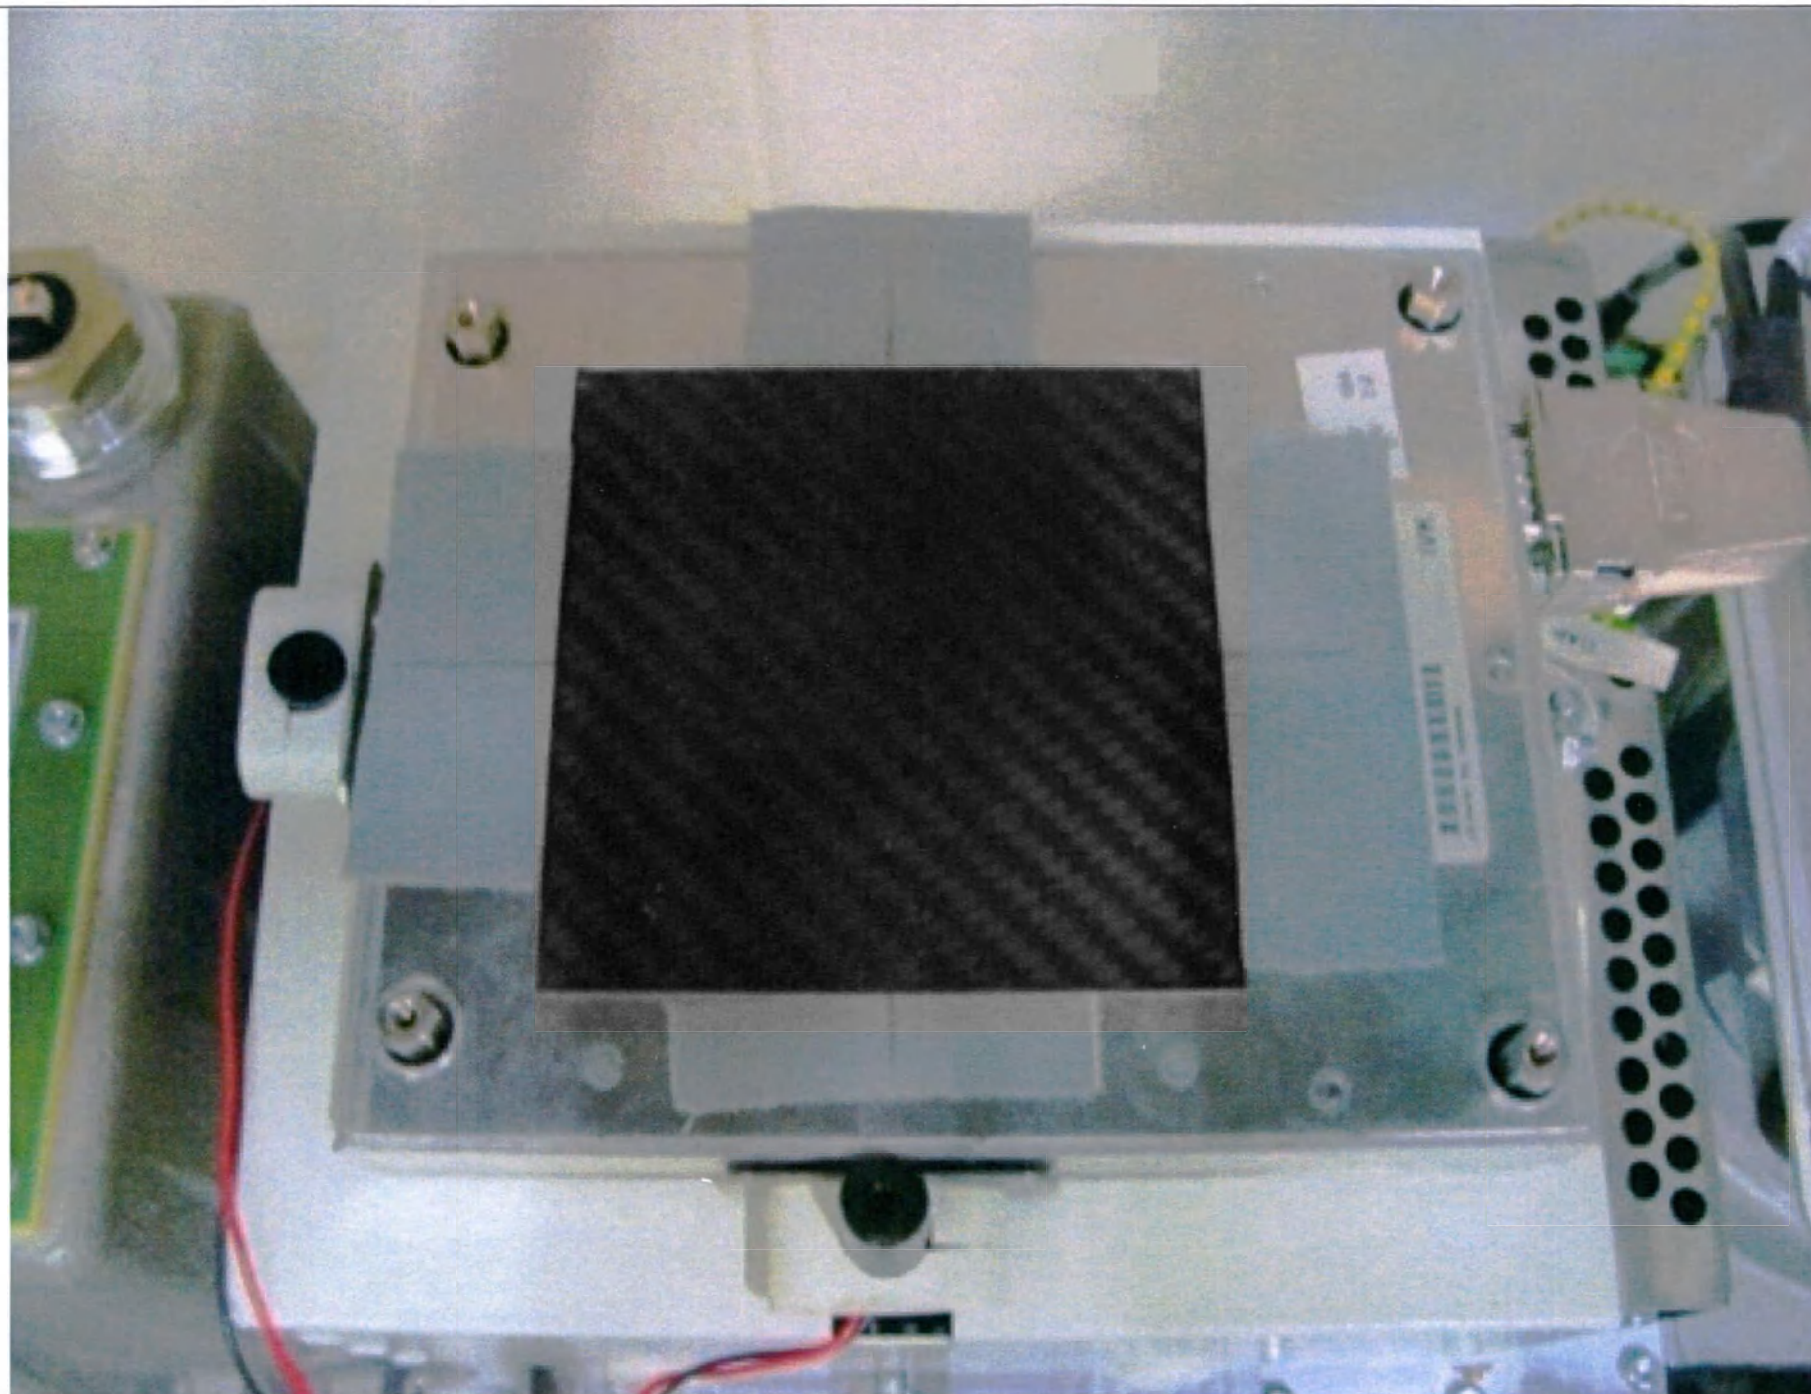

С-образная дуга. Камера для измерения дозы излучения.




С-образная дуга. Блок управления.




С-образная дуга. Ручной переключатель




С-образная дуга. Плоский детектор CMOS размером 20 см x 20 см. Изображение также распространяется на: Плоский детектор CMOS размером 30 см x 30 см

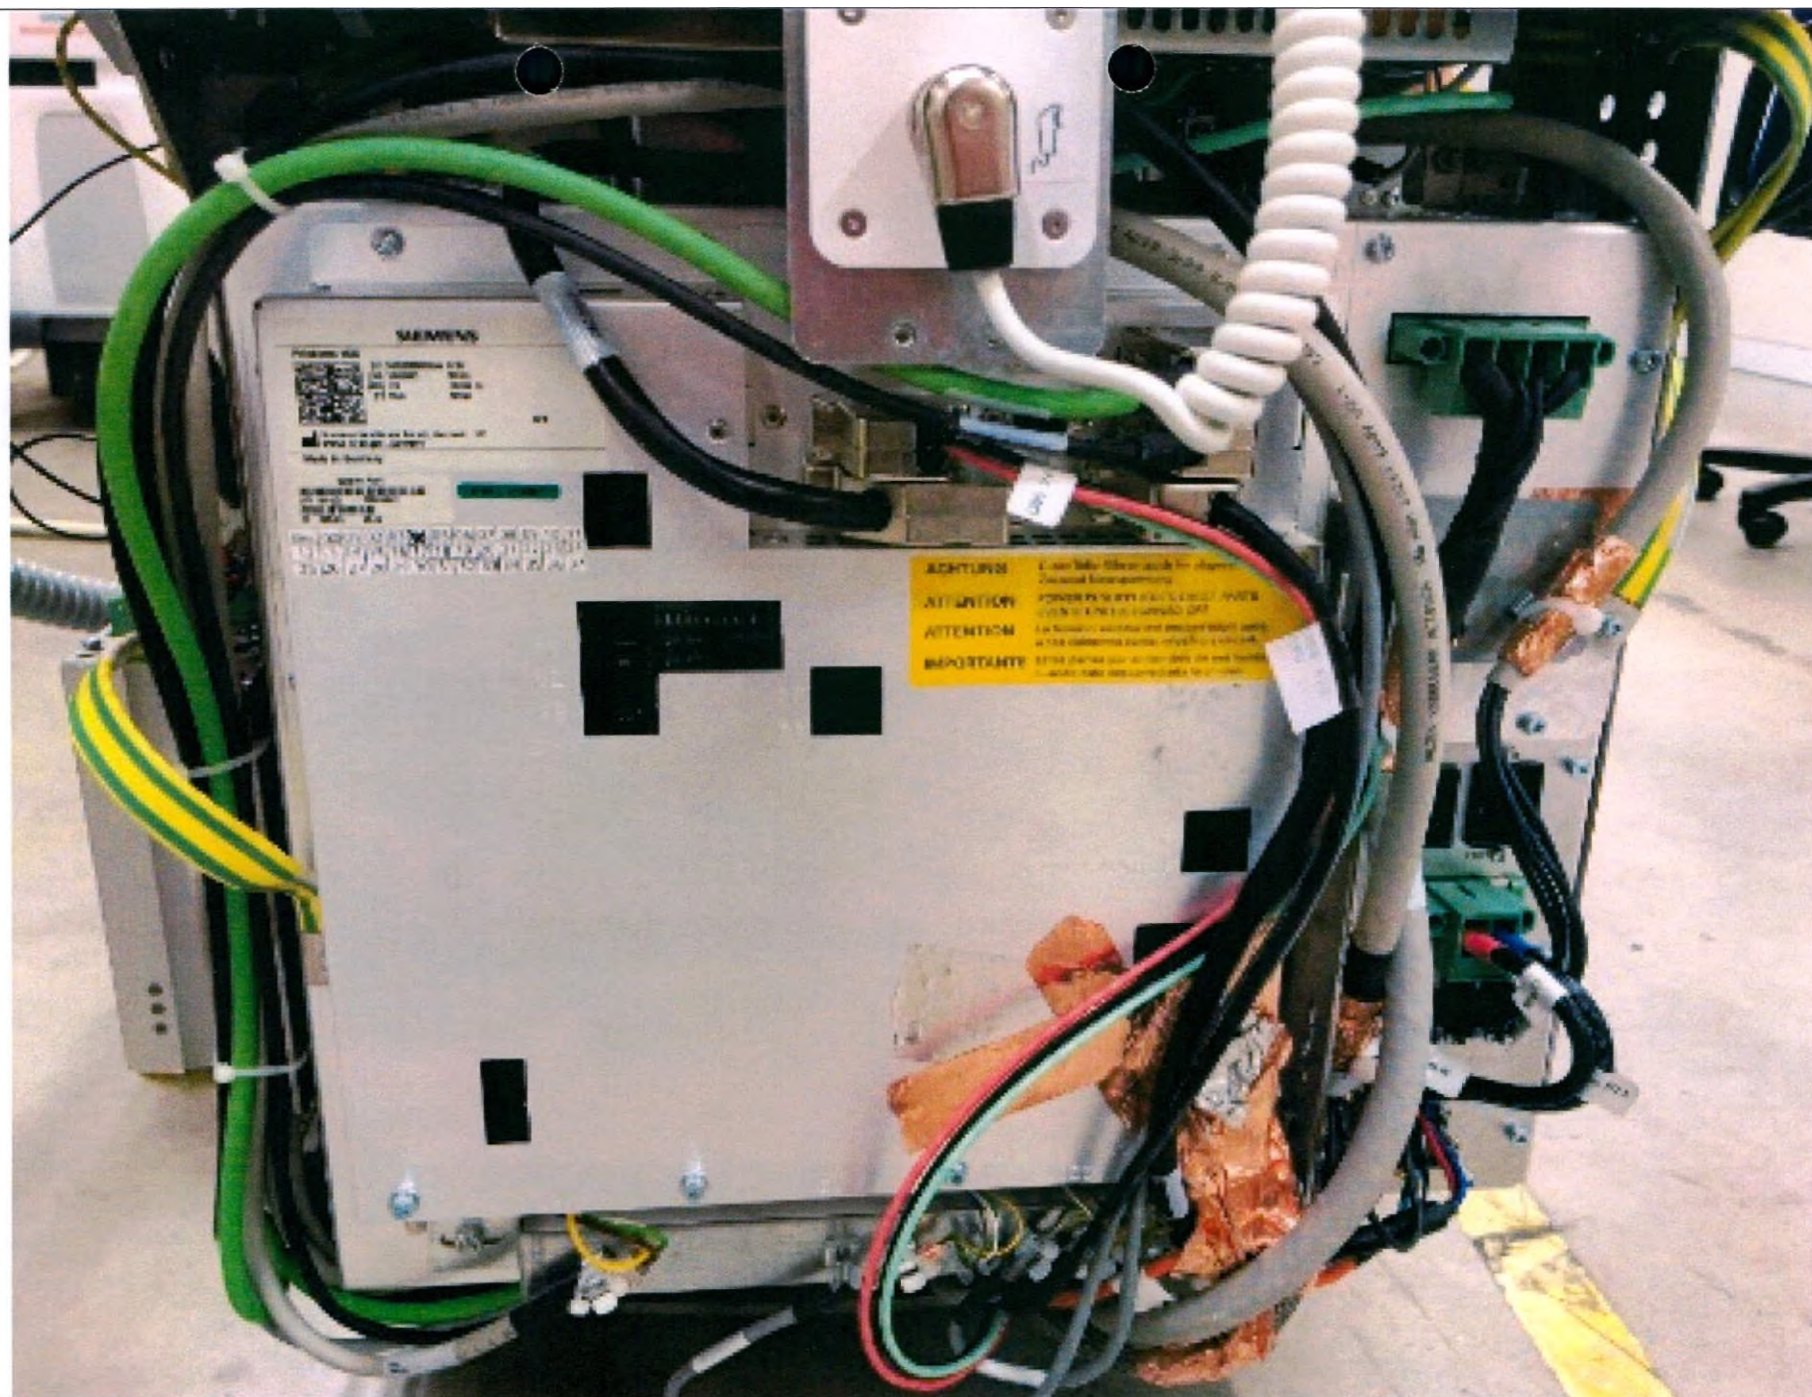


С-образная дуга. Высокочастотный генератор.

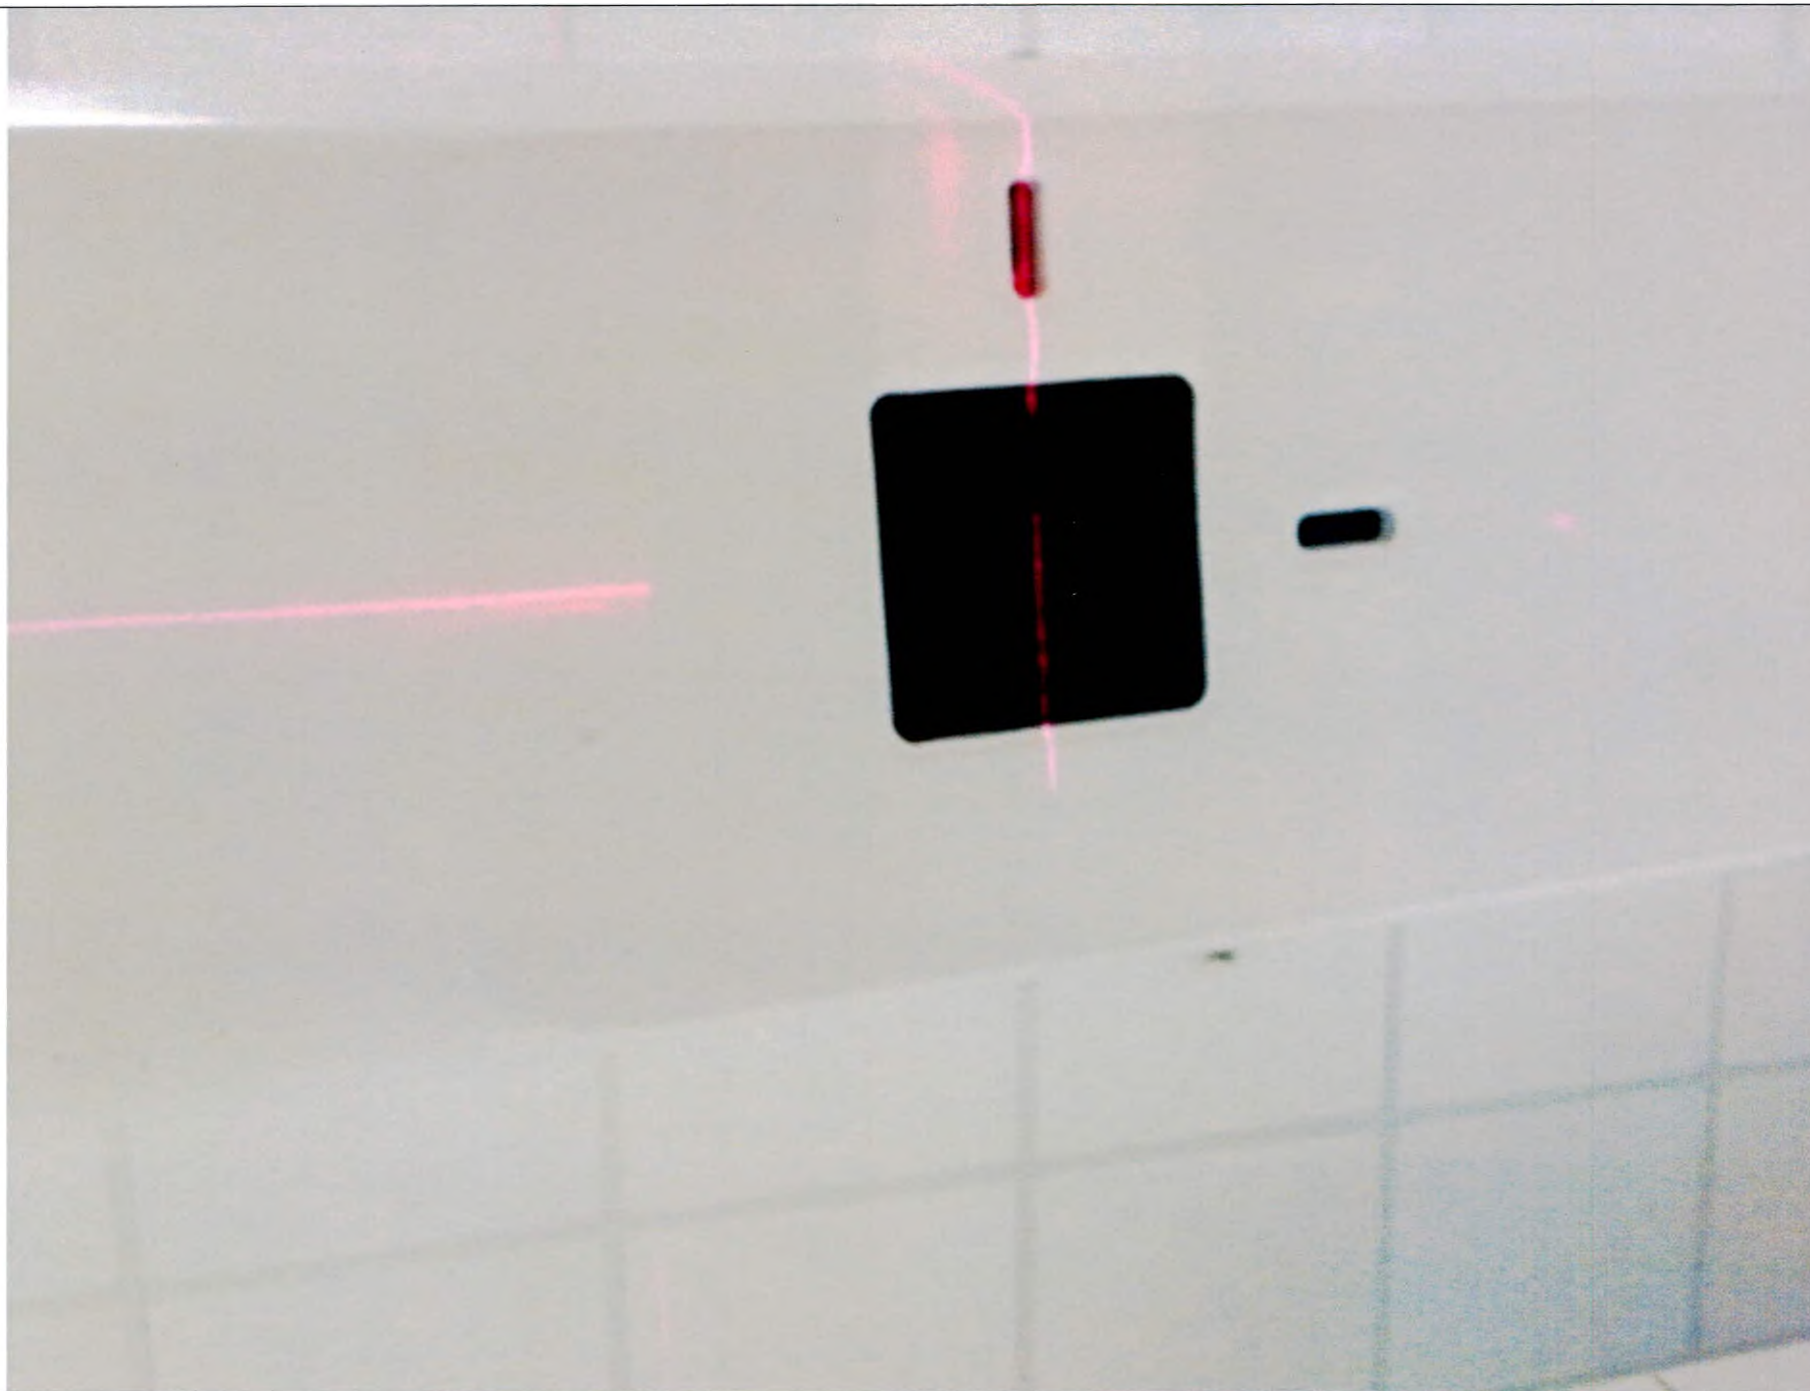

С-образная дуга. Моноблочный лазерный оптический центратор, варианты исполнения: красный цвет лазера

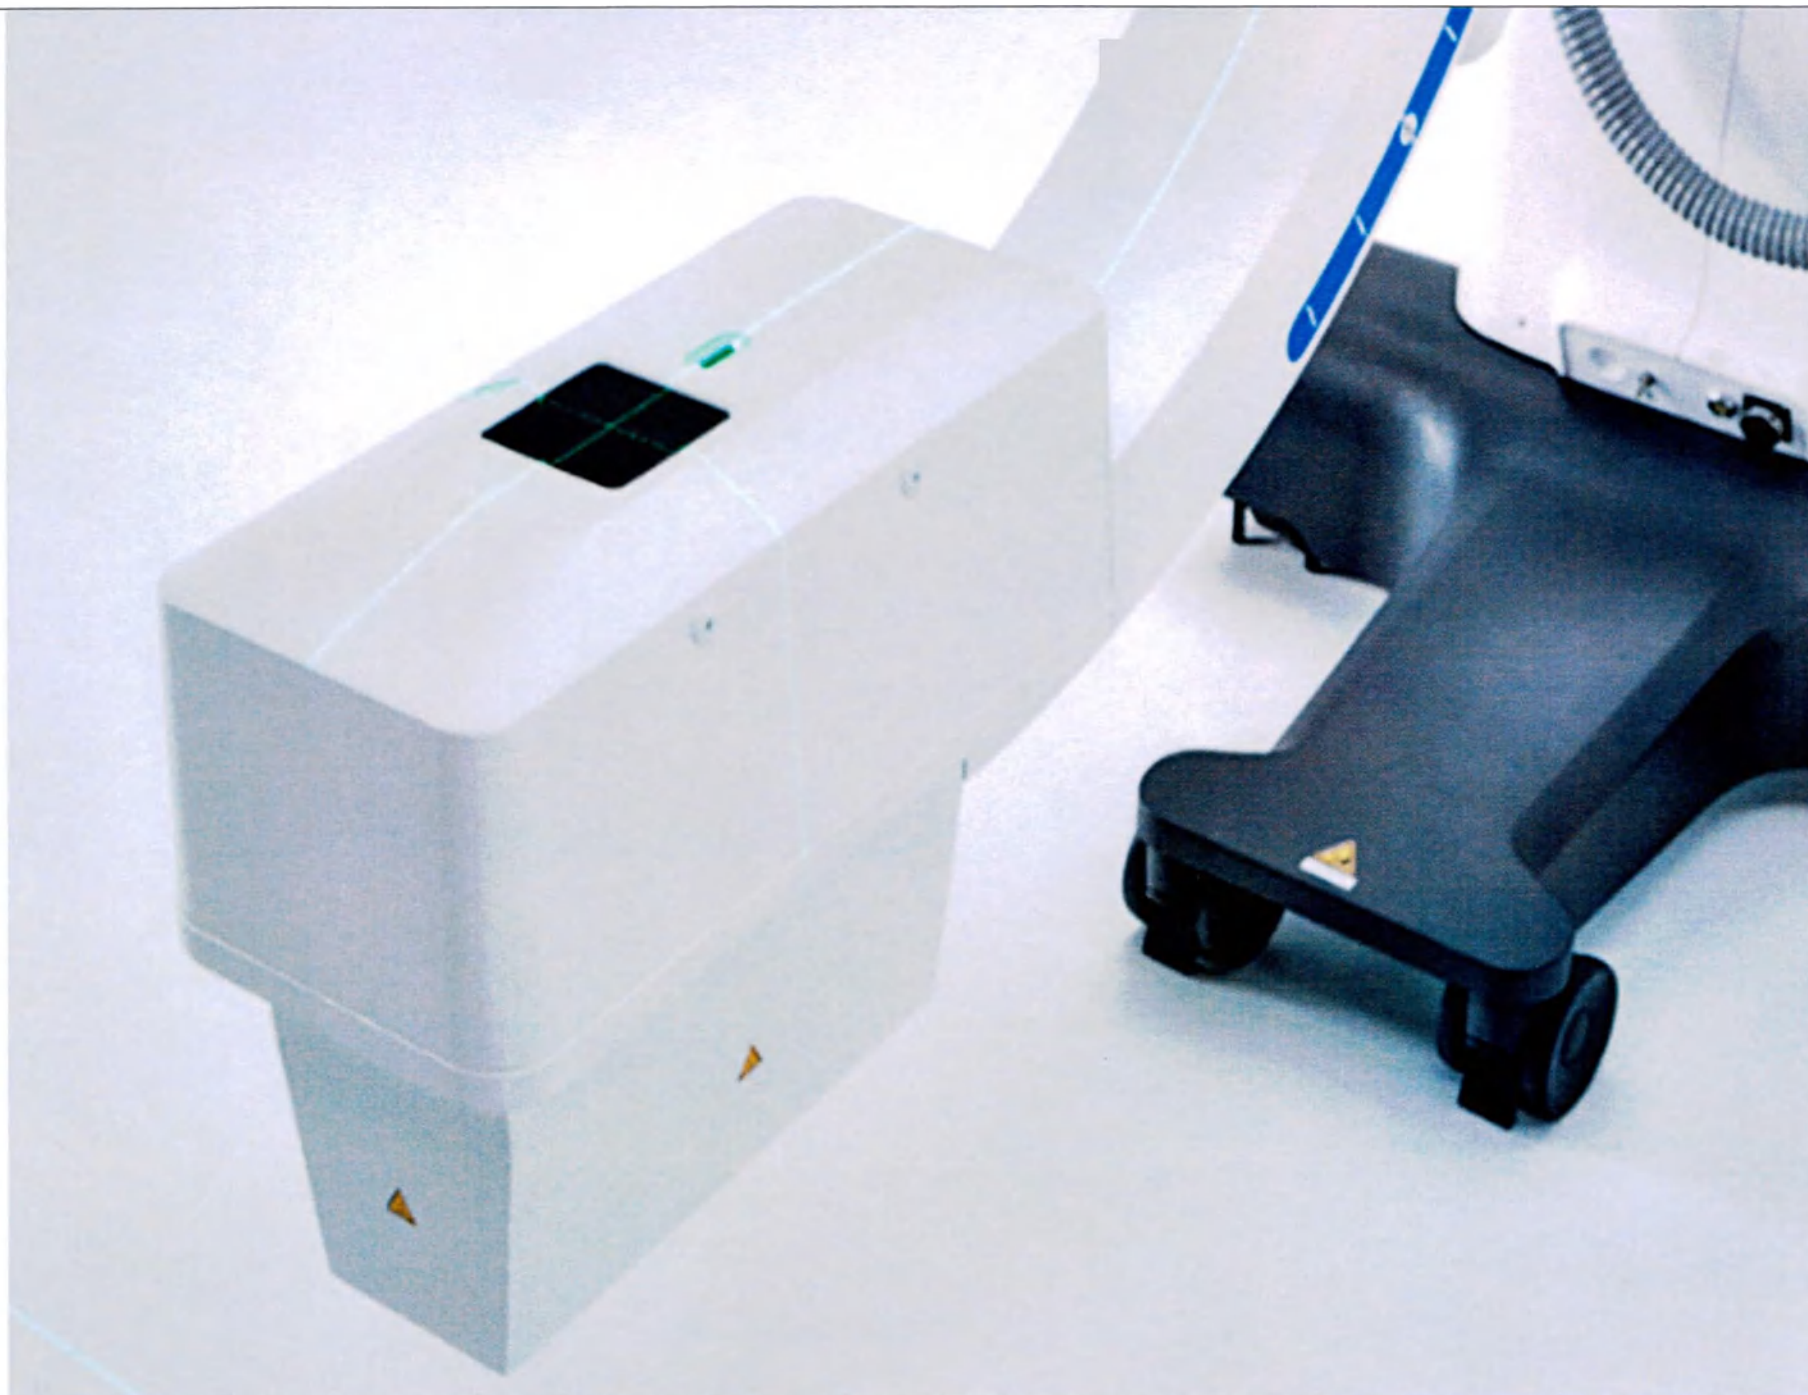


С-образная дуга. Моноблочный лазерный оптический центратор, варианты исполнения: зеленый цвет лазера

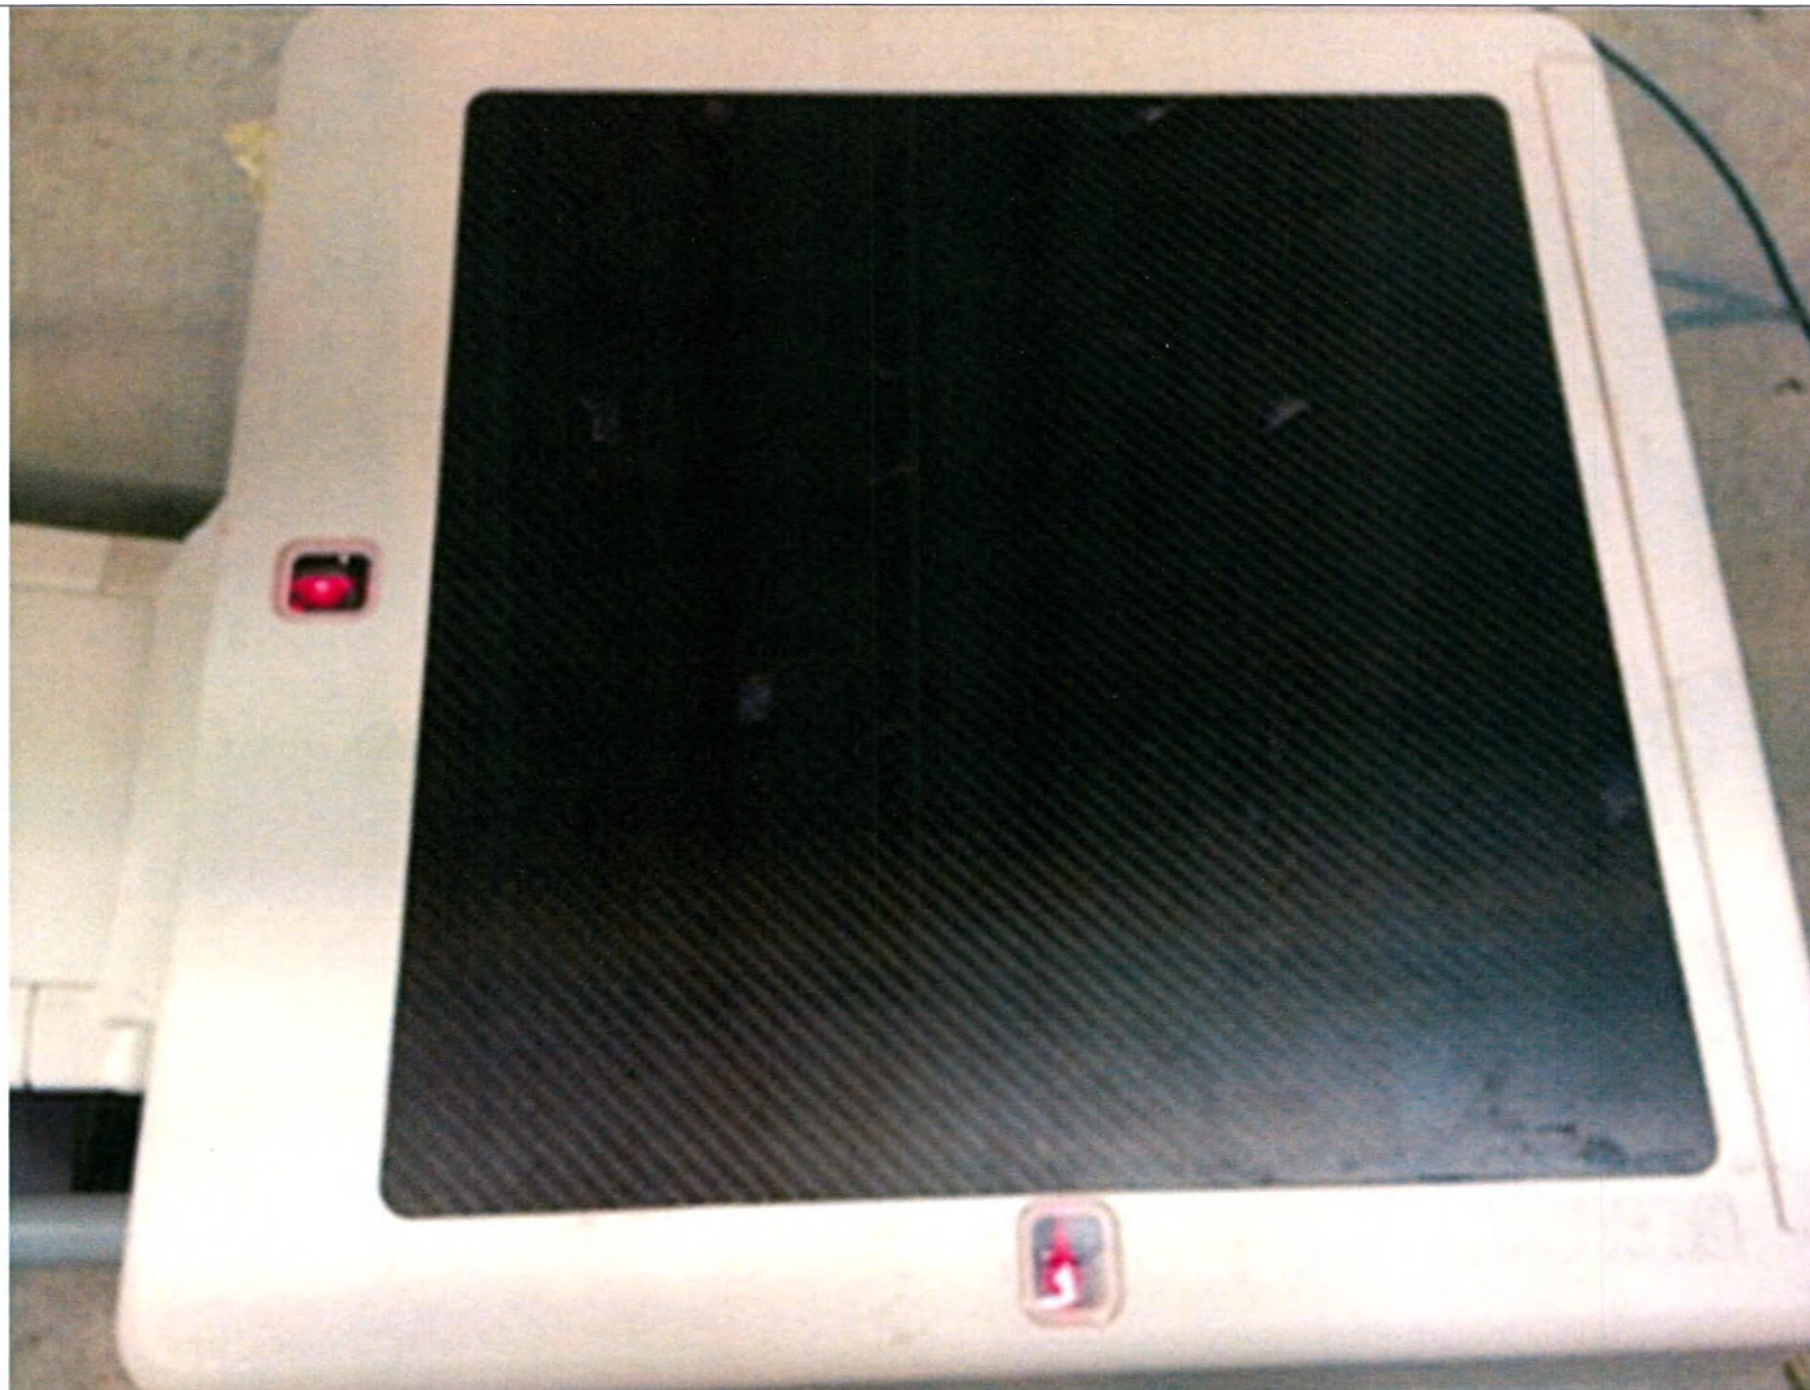

С-образная дуга. Интегрированный лазерный оптический центратор детектора, варианты исполнения: -красный цвет лазера;



С-образная дуга. Интегрированный лазерный оптический центратор детектора, варианты исполнения: -зеленый цвет лазера;

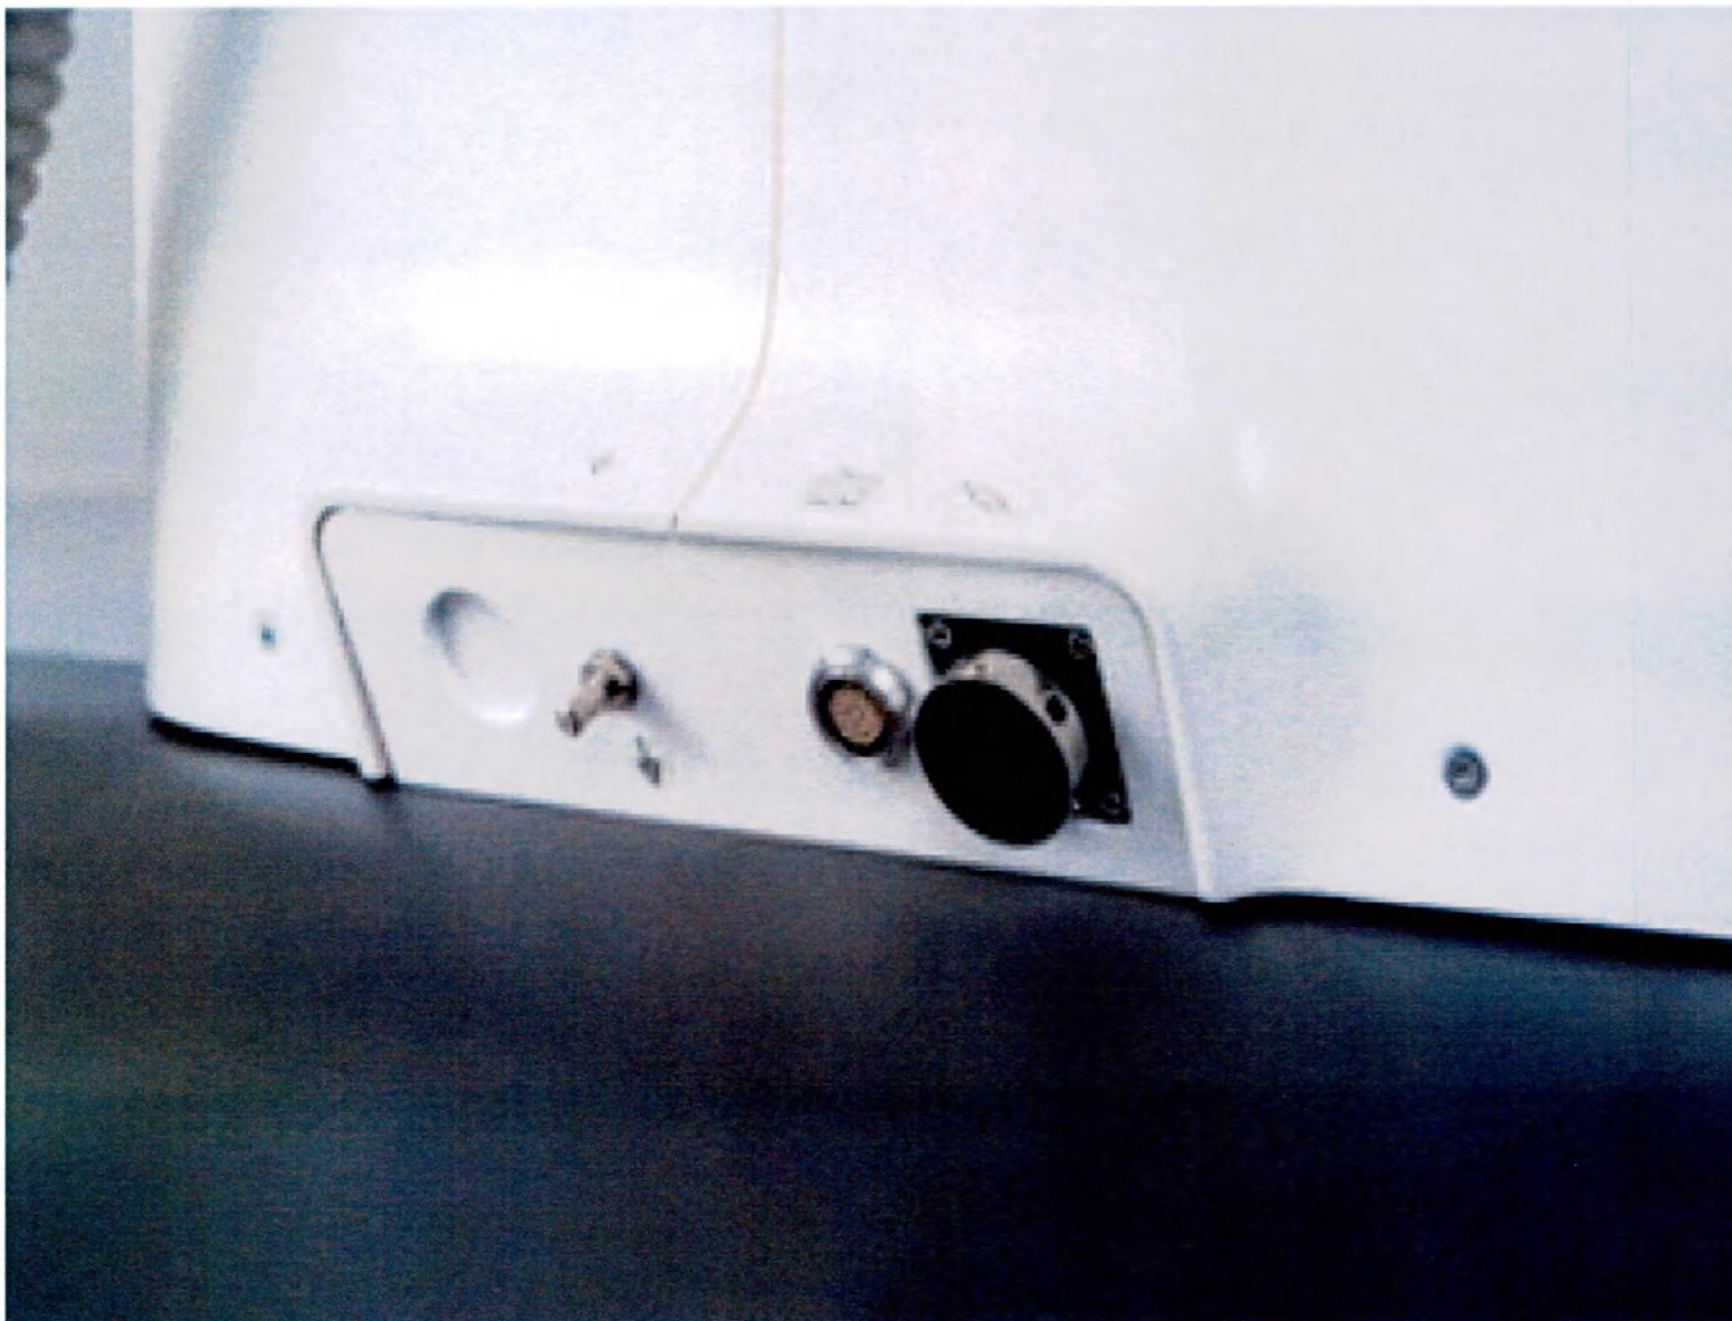

С-образная дуга. Разъем для инжектора контрастного вещества (интерфейс инжектора).



Мониторная стойка, вариант исполнения: мониторная стойка Flex



4

Мониторная стойка, вариант исполнения: мониторная стойка Flex Plus



Мониторная стойка. Цветные TFT-мониторы, варианты исполнения: 2 цветных TFT-монитора повышенной яркости



Мониторная стойка. Цветные TFT-мониторы, варианты исполнения: 2 цветных TFT-монитора высокой яркости




Мониторная стойка. Панель управления




Мониторная стойка. Мышь




Мониторная стойка. Диспетчер видеоизображения SmartView - HD Video Manager.

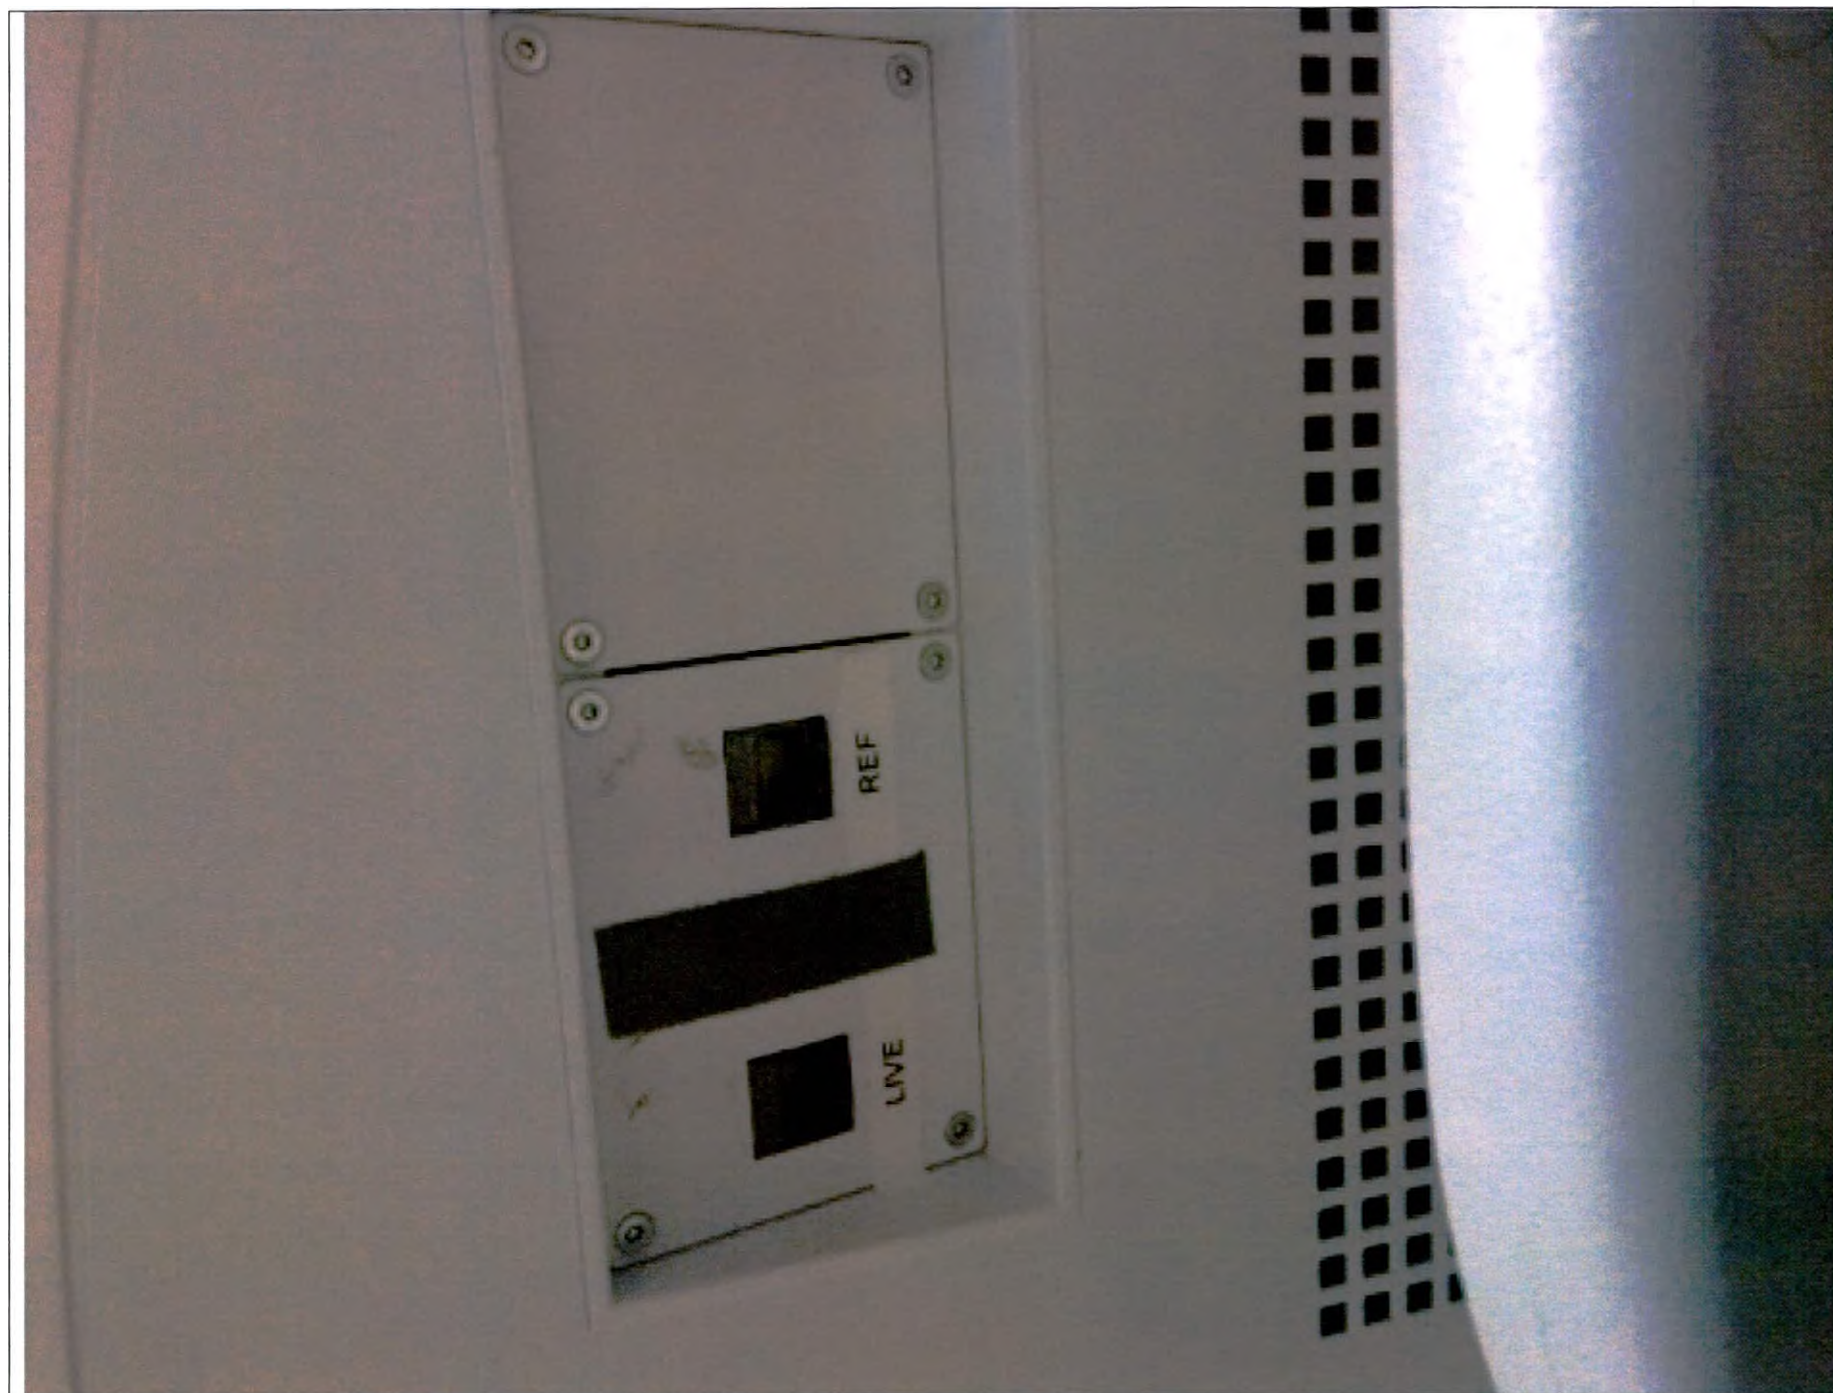


Мониторная стойка. Разветвитель видеосигнала DVI (мониторы А и В).

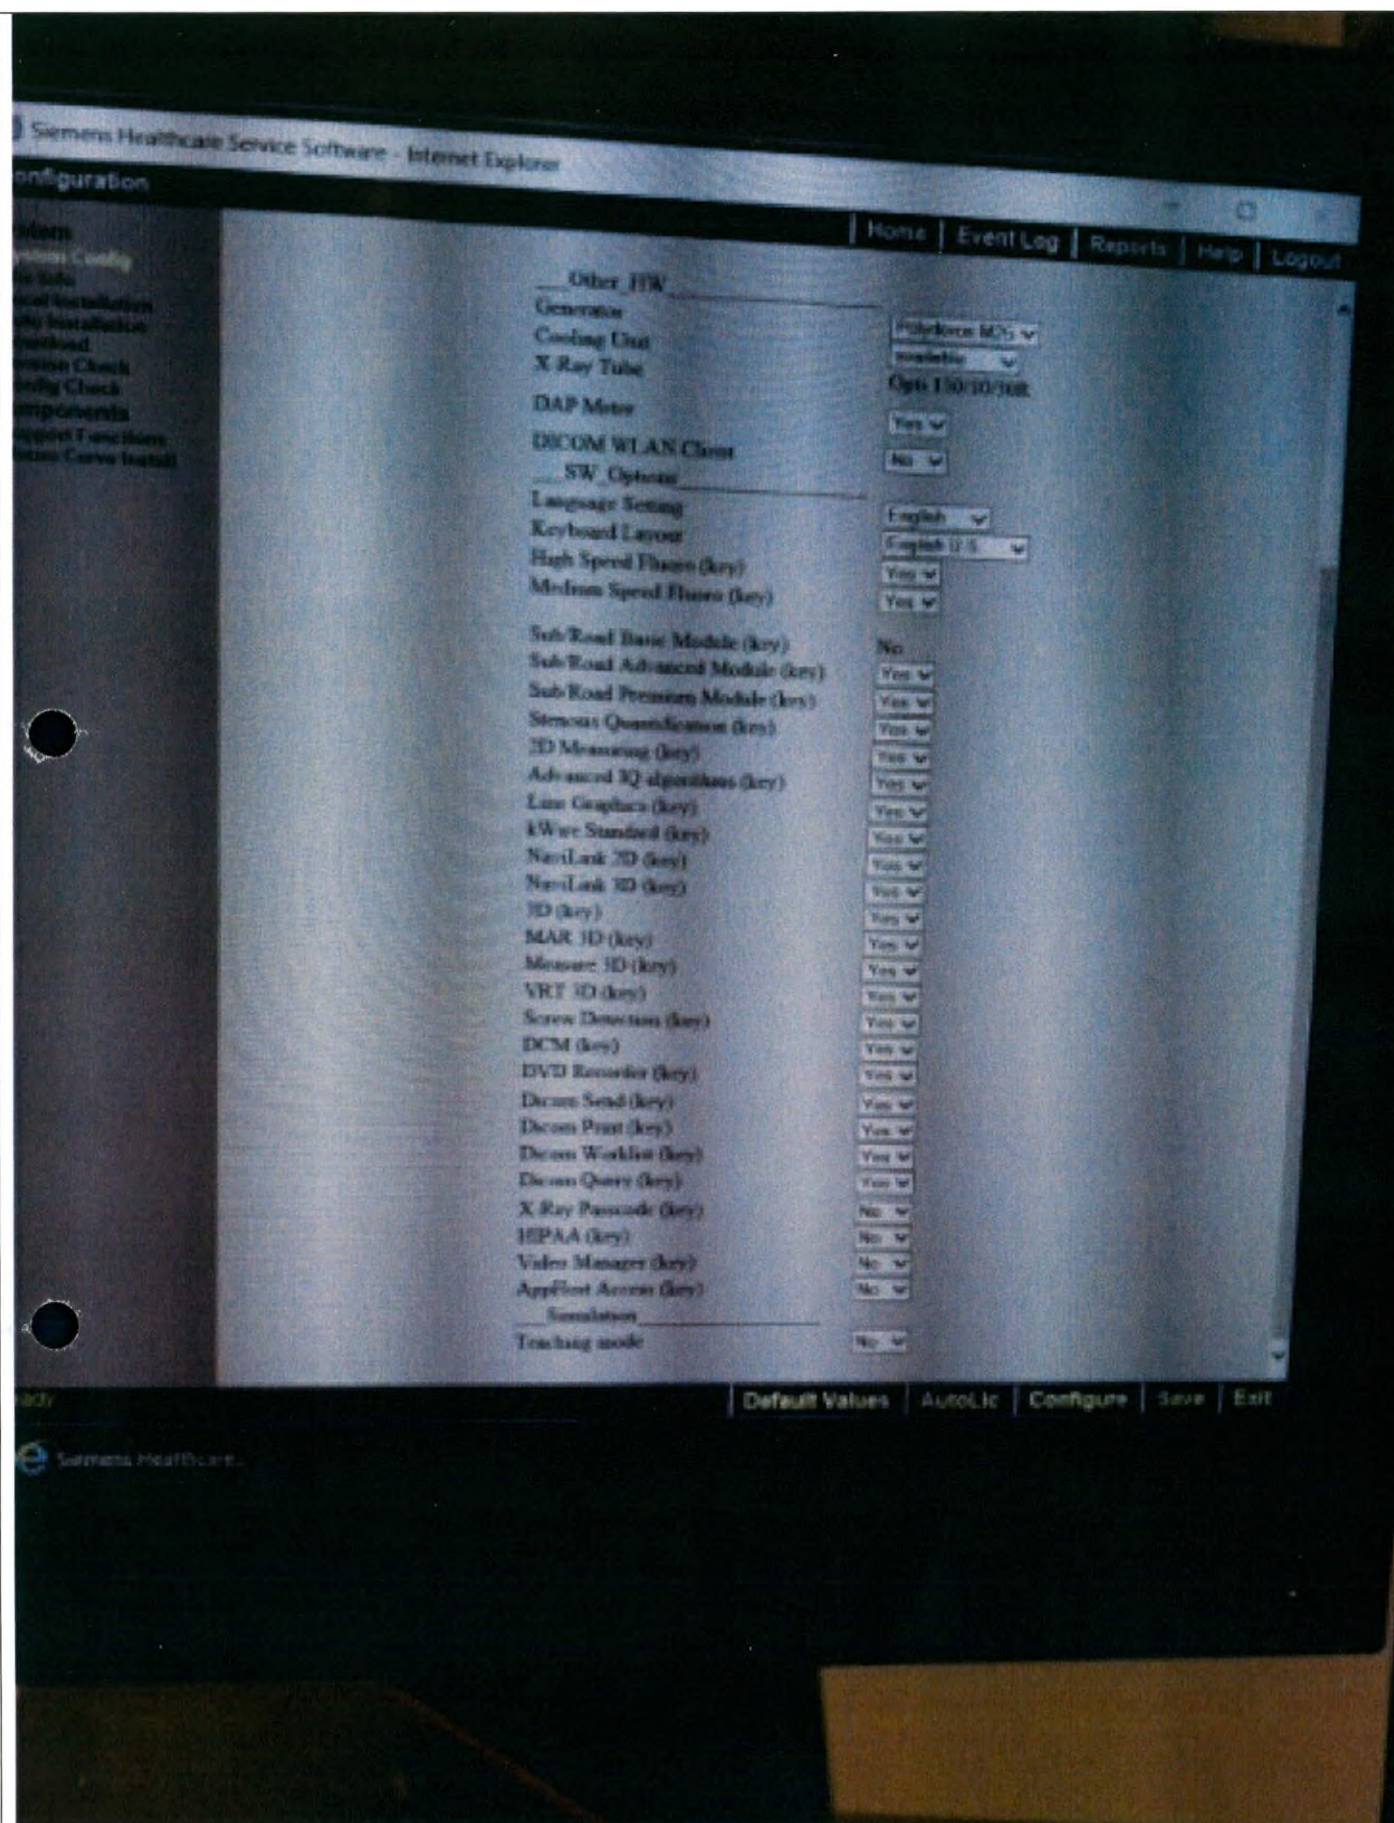

Мониторная стойка. Интерфейс подключения к беспроводной локальной сети WLAN.

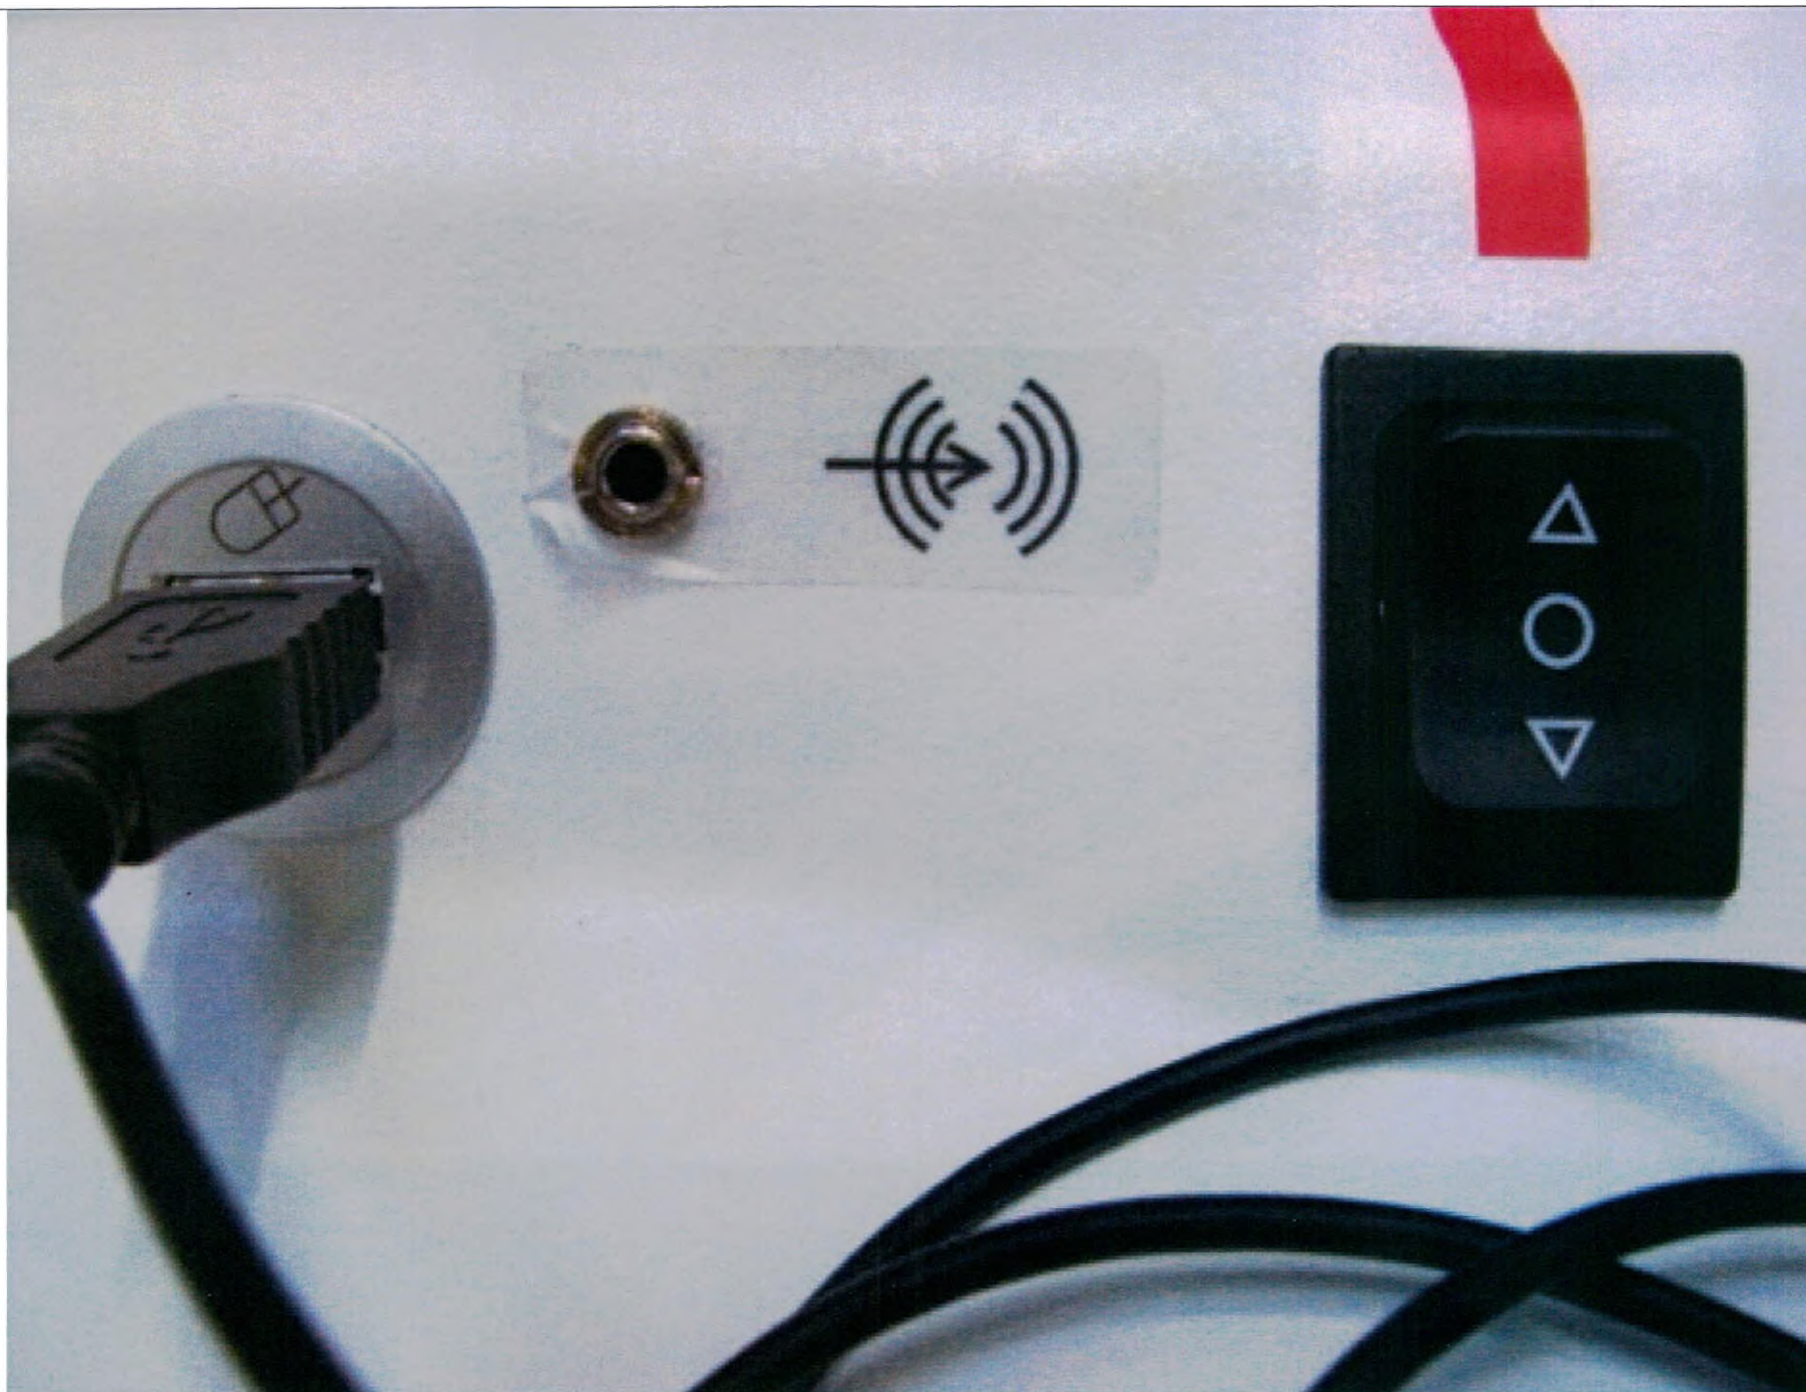

Мониторная стойка. Акустическая система EMotion.

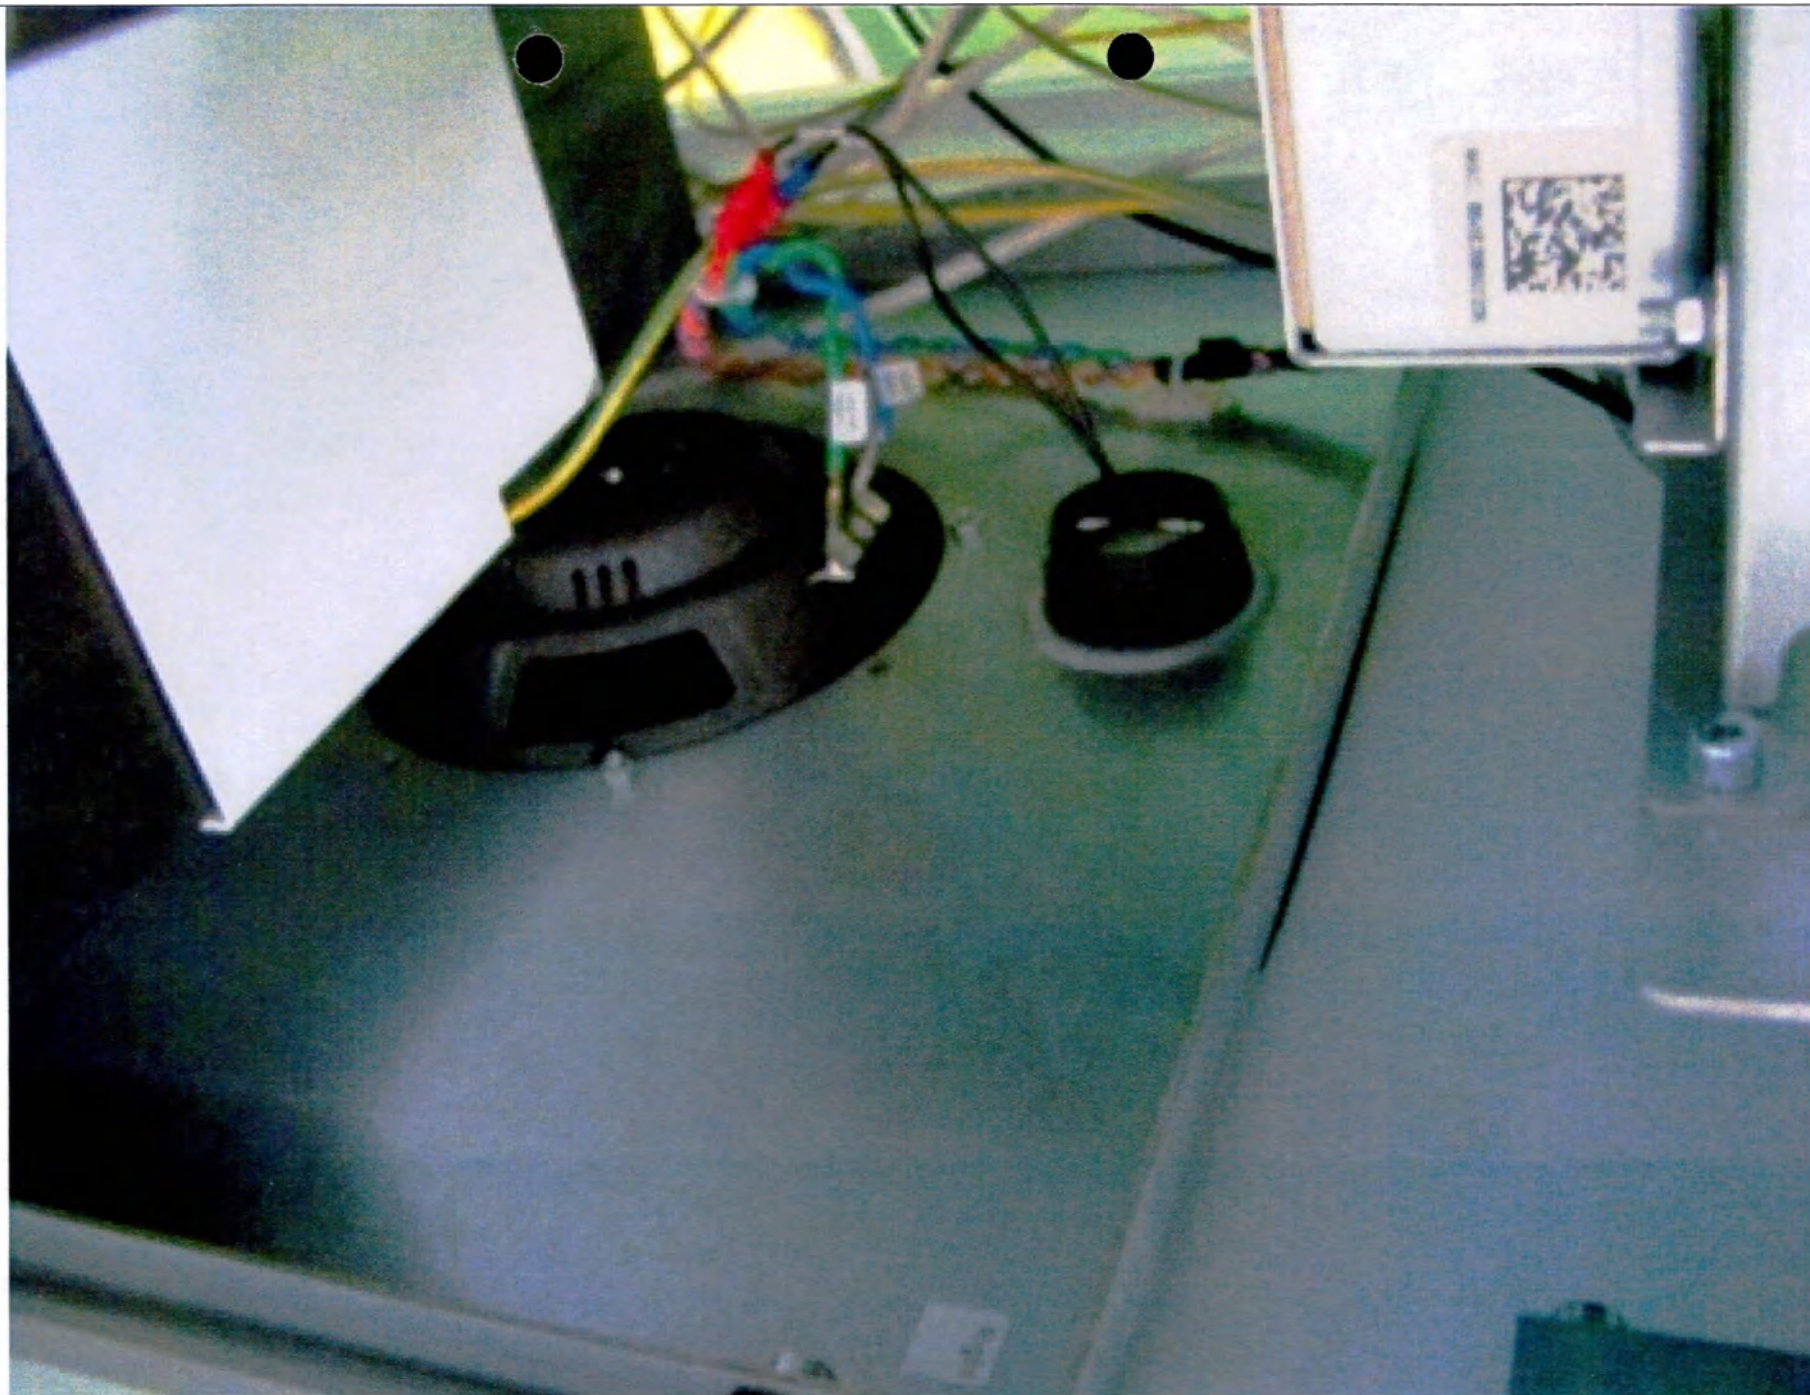

Мониторная стойка. Акустическая система EMotion.




Педальный переключатель, вариант исполнения: стандартный педальный переключатель



Педальный переключатель, вариант исполнения: многофункциональный напольный переключатель



Педальный переключатель, вариант исполнения: беспроводной многофункциональный напольный переключатель

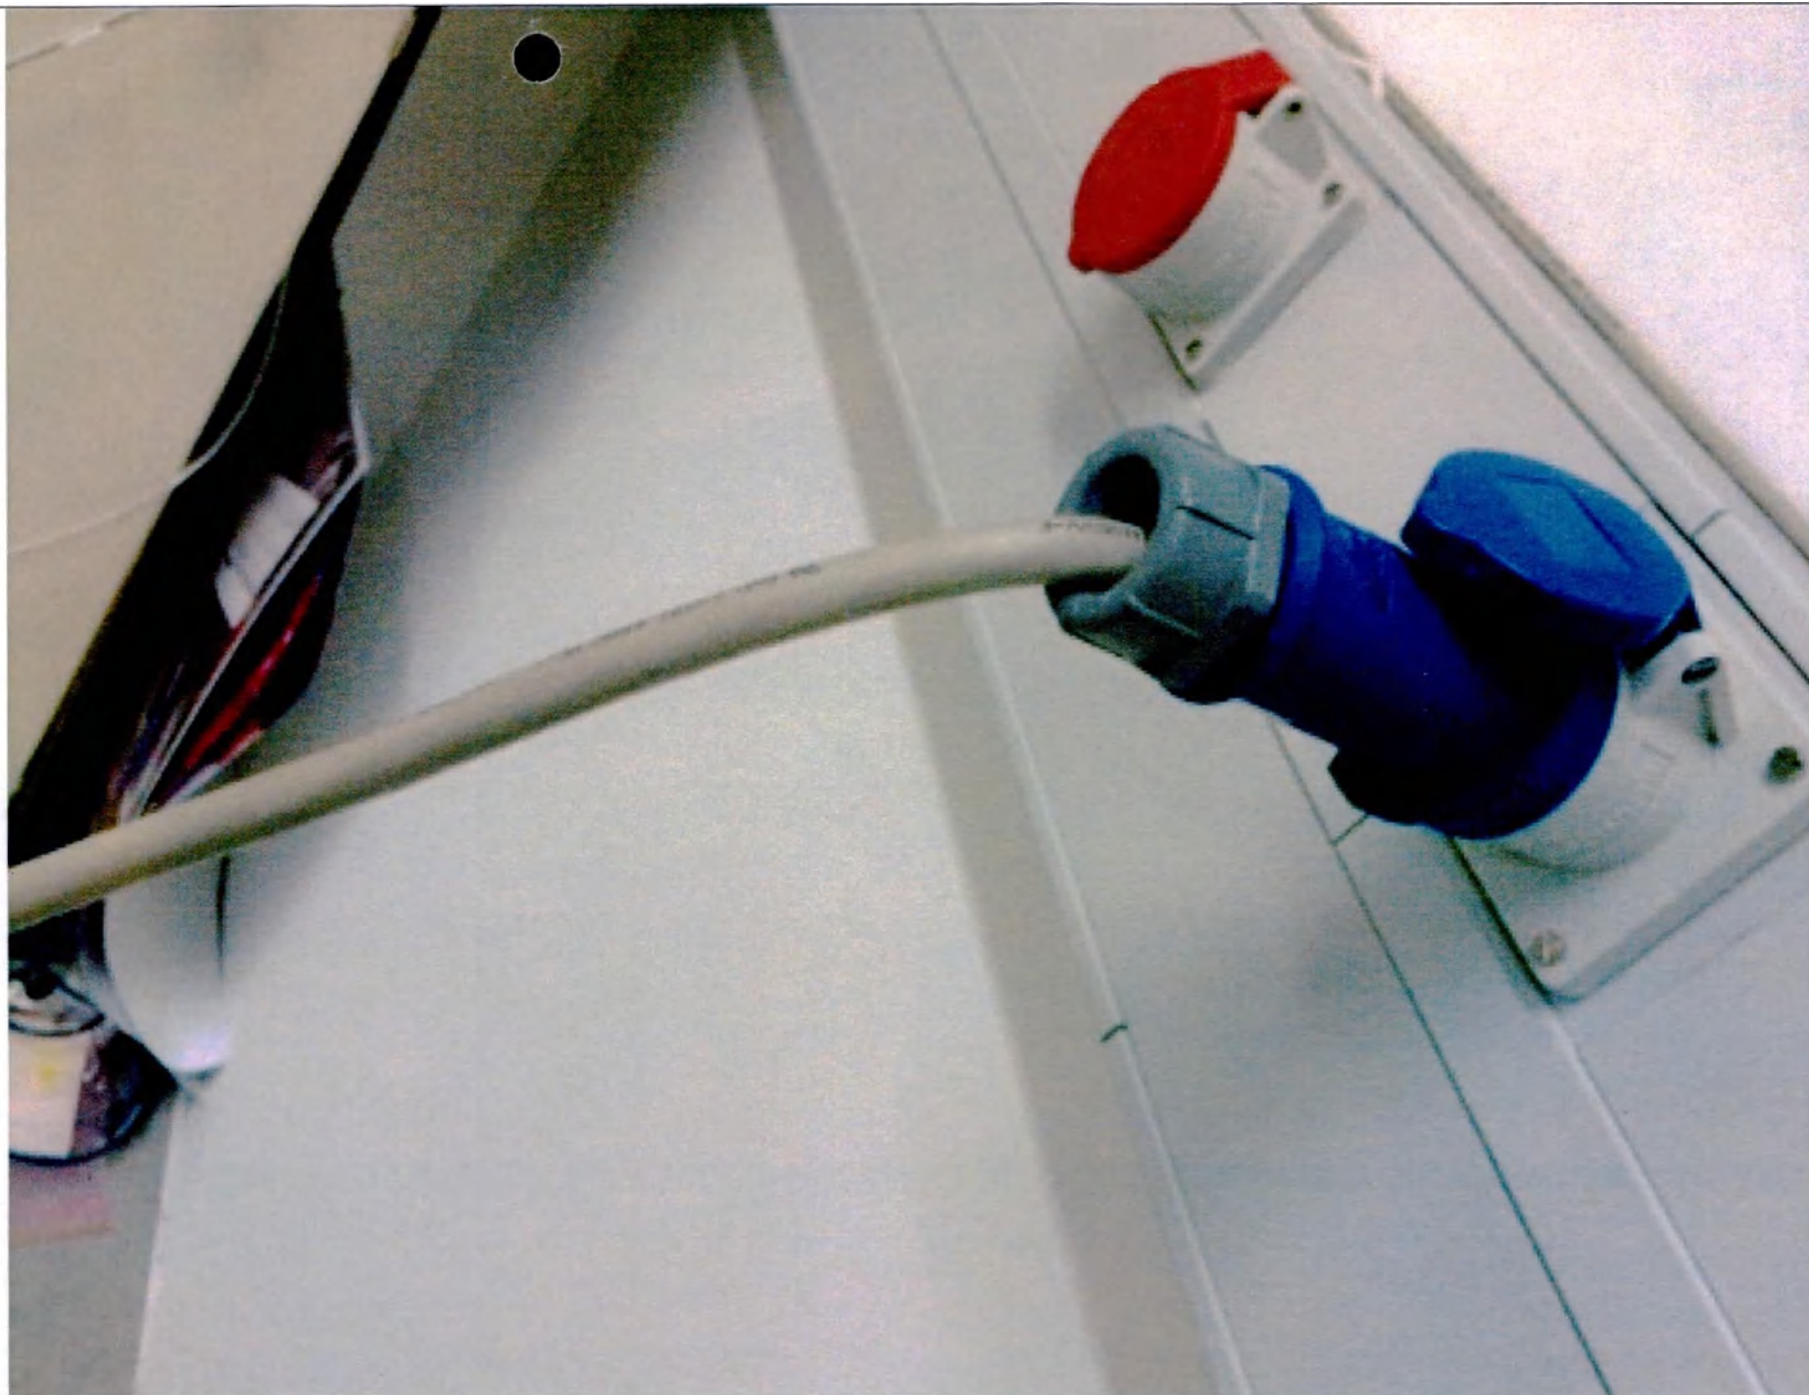

Кабель электропитания



Cios Flow

Руководство пользователя

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers

Эксплуатационная документация: Руководство пользователя Cios Flow.

Cios Alpha, Flow, Spin

Важная дополнительная информация

Руководство пользователя

[siemens-healthineers.com](https://www.siemens-healthineers.com)

SIEMENS
Healthineers 

Эксплуатационная документация: Руководство пользователя Cios Alpha, Flow, Spin. Важная дополнительная информация.



Cios

Руководство администратора

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers 

Эксплуатационная документация: Руководство администратора Cios.

Cios Flow – Порядок действий в аварийной ситуации

При интервенционных вмешательствах, на случай аварийных ситуаций всегда должен быть доступен второй аппарат

Процедура при сердечно-легочной реанимации (CPR)



- ◆ Отпустите механические тормоза и переместите С-образную дугу в такое положение, из которого ее можно удалить от стола пациента, не вызывая столкновения.
- ◆ В случае сбоя в электрической сети/аварийного останова: Отключите тормоза.
- ◆ При необходимости снимите пульт дистанционного управления со стола пациента и установите его на мониторную стойку.
- ◆ Отпустите рычаг тормоза и выведите систему Cios Flow из кабинета. Следите за кабелями, идущими к мониторной стойке, пульта дистанционного управления и педальному переключателю!
- ◆ При необходимости отпустите ножной тормоз и выведите мониторную стойку из кабинета.

Разблокировка включения излучения



- ◆ Нажмите эту кнопку на вкладке ПОДГОТОВКА.
- ◆ Щелкните поле ввода и введите пароль для активации включения излучения (заводское значение "0000").

Аварийная остановка




Кнопка аварийного останова расположена на блоке управления системы Cios Flow.

- ◆ Нажмите кнопку аварийного останова.
 - Все автоматизированные перемещения отключены.
 - Излучение прекращено.
- ◆ Снова включите излучение: еще раз нажмите педальный или ручной переключатель.

Сброс Cios Flow

Если компьютер не завершает работу или не реагирует на команды, может потребоваться выполнить сброс системы:

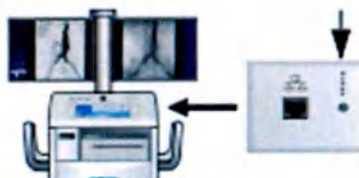

- ◆ НЕ нажимайте кнопку OFF (Выкл.).
- ◆ Нажмите кнопку сброса предметом с острым кончиком, затем нажмите кнопку ON (Вкл.) на мониторной стойке.
- ◆ Дождитесь перезагрузки системы (прибл. 4 минуты).

Во время сброса будет утрачена следующая информация: Положение коллиматора, заданные значения дозы, ориентация изображения, память положения.

Возобновление работы после отказа электропитания

В случае отключения электропитания аппарат выключается.



Общее время до возобновления работы: прибл. 4 минуты.

- ◆ Подождите, пока компьютер не выключится.
- ◆ Перезагрузите систему с помощью кнопки ON (Вкл.) на мониторной стойке сразу после восстановления электропитания.
- ◆ Дождитесь полной перезагрузки аппарата. Обратите внимание на любые сообщения об ошибках, которые могут возникнуть во время загрузки.
- ◆ Возобновите лечение:
 - Повторно выберите последнего пациента.
 - Выполните необходимые настройки, например параметры дозы, коллиматора, изображения и т.д.
 - Проверьте/исправьте положения С-образной дуги.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя системы.

ATSC-300.640.02.01.12 © Siemens Healthcare GmbH, 12/2020. Все права защищены.



Cios Flow

Руководство пользователя – Важная дополни-
тельная информация
VA30K

siemens-healthineers.com

SIEMENS
Healthineers 

Эксплуатационная документация: Руководство пользователя - Важная дополнительная информация.

Приложение к эксплуатационной документации для России

Система мобильная рентгеновская для ангиографических и рентгеноскопических процедур Cios Flow с принадлежностями

Примечание:

Настоящий документ предназначен для использования только на территории Российской Федерации.

Этот документ дополняет эксплуатационную документацию на медицинское изделие, и в случае возникновения каких-либо разночтений информацию, содержащуюся в этом документе, следует считать приоритетной.

Эксплуатационная документация: Приложение к эксплуатационной документации для России.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:



Программный режим Перекрестие литотрипсии

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE DicomSend SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3F7229CF6739F71AD012 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MagicWatch SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FE2695F3C4095F9EF3A \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomPrint SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF22A90F653762565800 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomWorklist SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FC2A9BF1461F6879641 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

#FEATURE Hipaa_C SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 CF92C9EFAE99DEB0E614 \
#VENDOR_STRING=SIENET HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DF82A95FDF7D50291309 VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE SUB_ROAD_P SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3FC2094FF3A8FC0486B1 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F92C9EF0F3F7D6DB7B2 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3FA2692F2F87E1CA662B VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
9F62A9BF88487F29F48F VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE AppHost_Access SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 FF92994F13A2F7EBC7C9 \
VENDOR_STRING=AppHost_Access \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DFF2D9CF6AB040CB7B51 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DCM SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0F22698FDF9142EBE3AA \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

```

Комплект для проведения сосудистых исследований Vascular Premium PLUS в составе: Программный режим SUB/Road расширенной функциональности

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE DicomSend SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3F7229CF6739F71AD012 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MagicWatch SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FE2695F3C4095F9EF3A \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomPrint SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF22A90F653762565800 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomWorklist SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FC2A9BF1461F6879641 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

#FEATURE Hipaa_C SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 CF92C9EFAE99DEB0E614 \
#VENDOR_STRING=SIENET HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DF82A95FDF7D50291309 VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE SUB_ROAD_P SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3FC2094FF3A8FC0486B1 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F92C9EF0F3F7D6DB7B2 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3FA2692F2F87E1CA662B VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
9F62A9BF88487F29F48F VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE AppHost_Access SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 FF92994F13A2F7EBC7C9 \
VENDOR_STRING=AppHost_Access \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DFF2D9CF6AB040CB7B51 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14


FEATURE DCM SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0F22698FDF9142EBE3AA \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

```

Комплект для проведения сосудистых исследований Vascular Premium PLUS. Программный режим 2D измерения (для измерения углов и расстояний)



Комплект для проведения сосудистых исследований Vascular Premium PLUS. Пульт дистанционного управления

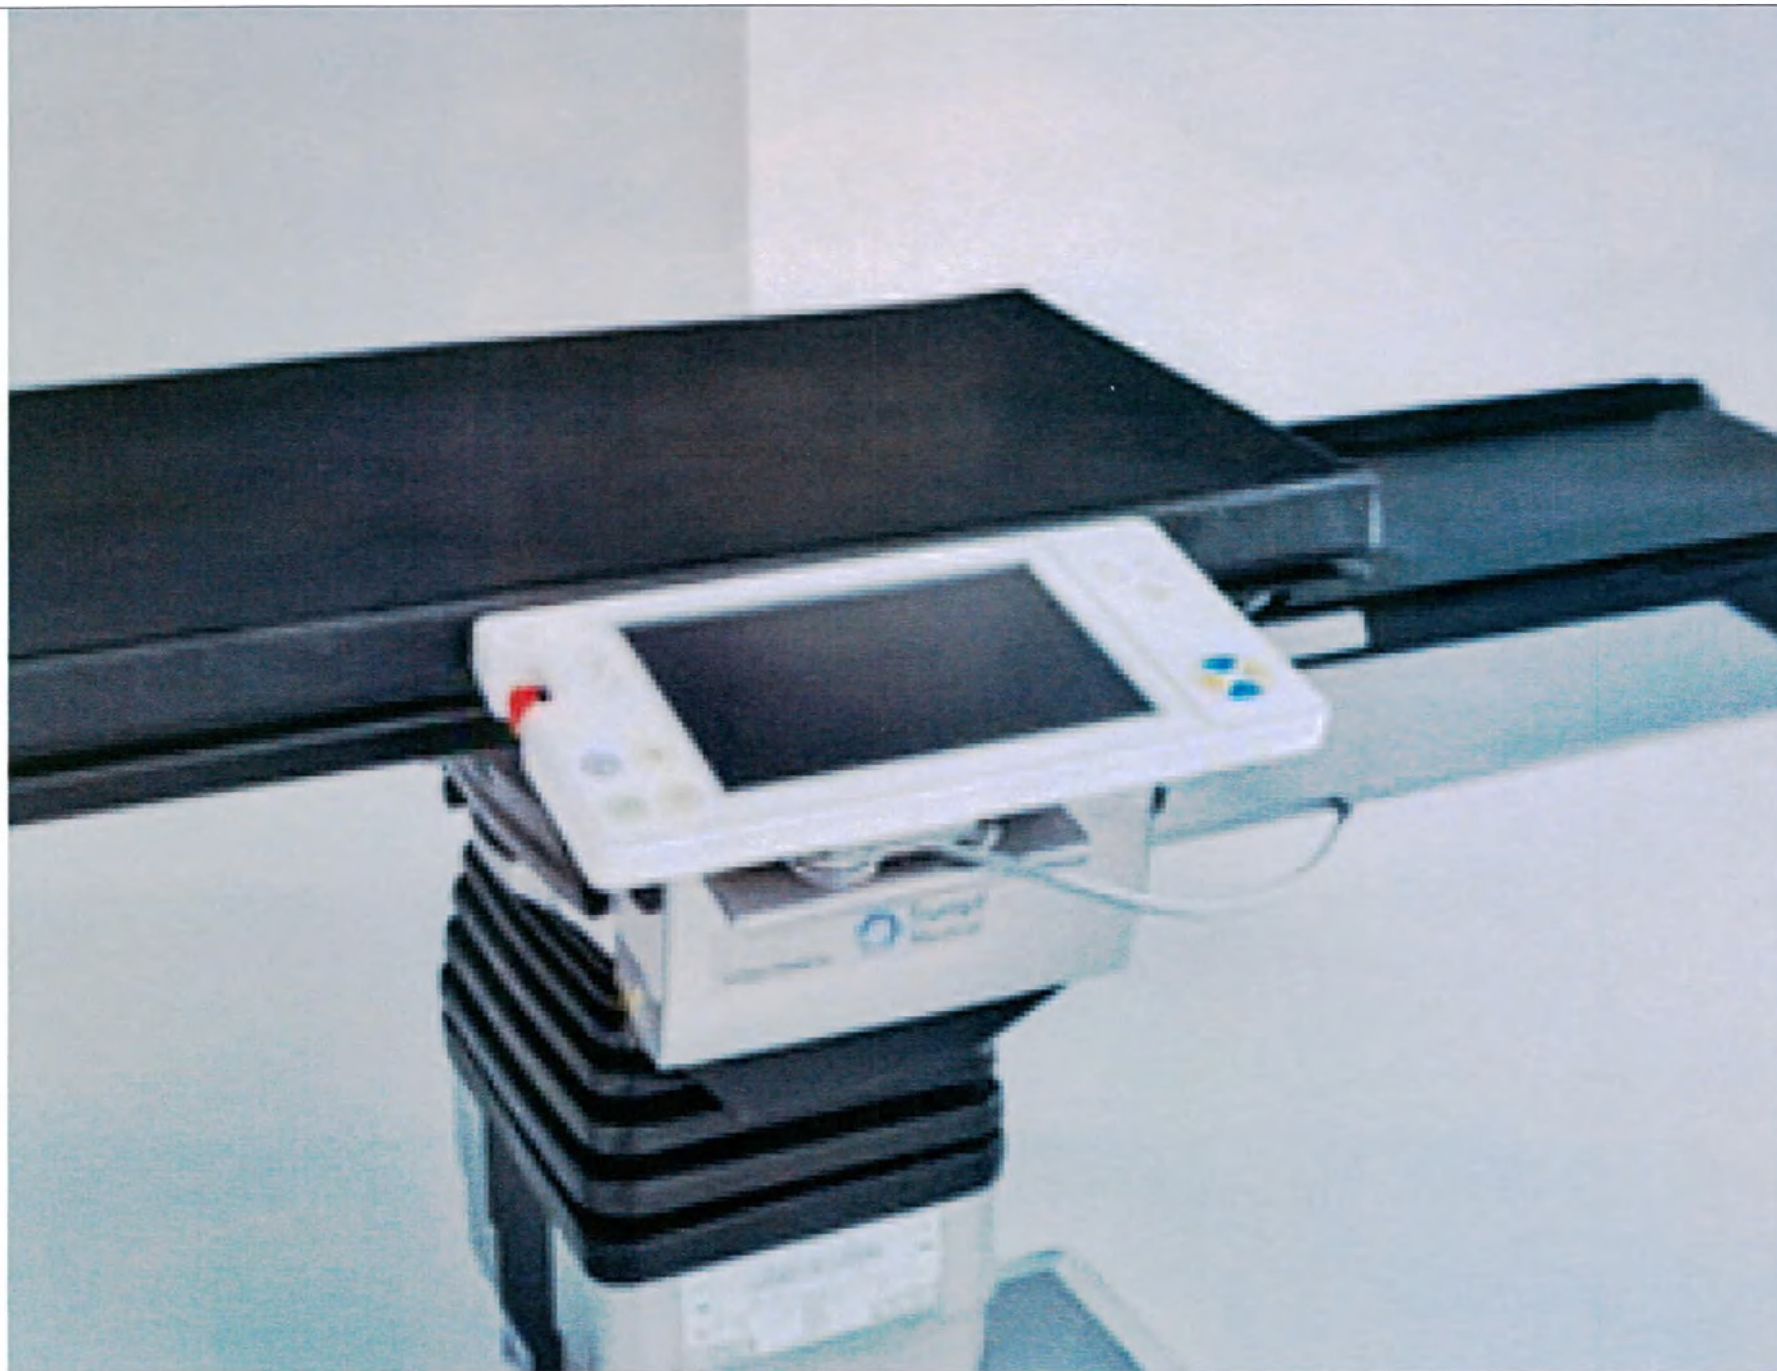

Комплект для проведения сосудистых исследований Vascular Premium PLUS. Держатель пульта дистанционного управления на рельсе стола

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE Stenosis quantification SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Position memory SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Dicom Query \ Retrieve SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Navilink 2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3F02CC34D958D4FF058F VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF12DC24E5A58B9F43BE \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
5FA27CE419B39FCECCB5 VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
0FA20C7460CCDBC16A9D VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE LGO_LINES SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F220CA4D5548F40B705 \
VENDOR_STRING=BU_XP HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE KWIRE_STANDARD SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 8FE2DC04C1B786F88BD5 \
VENDOR_STRING=SAG_Med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
CF322CE4C8DA7C6B6141 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

```

Комплект для проведения сосудистых исследований Vascular Premium PLUS. Программный режим количественного представления стеноза

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE Stenosis quantification SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Position memory SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Dicom Query \ Retrieve SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Navilink 2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3F02CC34D95BD4FF058F VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF12DC24E5A58B9F43BE \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
5FA27CE419B39FCECCB5 VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
0FA20C7460CCDBC16A9D VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE LGO_LINES SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F220CA4D5548F40B705 \
VENDOR_STRING=BU_XP HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE KWIRE_STANDARD SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 8FE2DC04C1B786F88BD5 \
VENDOR_STRING=SAG_Med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
CF322CE4C8DA7C6B6141 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

```

Программный режим памяти положения.



Сетевой видеокабель с адаптером электропитания для разветвителя видеосигнала

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE DicomSend SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3F7229CF6739F71AD012 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MagicWatch SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FE2695F3C4095F9EF3A \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomPrint SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF22A90F653762565800 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomWorklist SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FC2A9BF1461F6879641 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

#FEATURE Hipaa_C SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 CF92C9EFAE99DEB0E614 \
#VENDOR_STRING=SIENET HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DF82A95FDF7D50291309 VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE SUB_ROAD_P SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3FC2094FF3A8FC0486B1 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F92C9EF0F3F7D6DB7B2 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3FA2692F2F87E1CA662B VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
9F62A9BF88487F29F48F VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE AppHost_Access SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 FF92994F13A2F7EBC7C9 \
VENDOR_STRING=AppHost_Access \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DFF2D9CF6AB040CB7B51 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DCM SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0F22698FDF9142EBE3AA \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

```

Программный режим DICOM Send

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE DicomSend SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3F7229CF6739F71AD012 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MagicWatch SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FE2695F3C4095F9EF3A \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomPrint SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF22A90F653762565800 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomWorklist SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FC2A9BF1461F6879641 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

#FEATURE Hipaa_C SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 CF92C9EFAE99DEB0E614 \
#VENDOR_STRING=SIENET HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DF82A95FDF7D50291309 VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE SUB_ROAD_P SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3FC2094FF3A8FC0486B1 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F92C9EF0F3F7D6DB7B2 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3FA2692F2F87E1CA662B VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
9F62A9BF88487F29F48F VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE AppHost_Access SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 FF92994F13A2F7EBC7C9 \
VENDOR_STRING=AppHost_Access \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DFF2D9CF6AB040CB7B51 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DCM SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0F22698FDF9142EBE3AA \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

```

Программный режим DICOM Print

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: [REDACTED]
# System SerialNumber: [REDACTED]
# HW_ID MaterialNumber: [REDACTED]
# HW_ID SerialNumber (=ID): [REDACTED]
# Creation Date: [REDACTED]
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE Stenosis quantification SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Position memory SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Dicom Query \ Retrieve SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Navilink 2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3F02CC34D958D4FF058F VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF12DC24E5A58B9F43BE \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
5FA27CE419B39FCECCB5 VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
0FA20C7460CCDBC16A9D VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE LGO_LINES SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F220CA4D5548F40B705 \
VENDOR_STRING=BU_XP HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE KWIRE_STANDARD SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 8FE2DC04C1B786F88BD5 \
VENDOR_STRING=SAG_Med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
CF322CE4C8DA7C6B6141 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

```

Программный режим DICOM Query/Retrieve

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE DicomSend SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3F7229CF6739F71AD012 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MagicWatch SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FE2695F3C4095F9EF3A \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomPrint SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF22A90F653762565800 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomWorklist SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FC2A9BF1461F6879641 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

#FEATURE Hipaa_C SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 CF92C9EFAE99DEB0E614 \
#VENDOR_STRING=SIENET HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DF82A95FDF7D50291309 VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE SUB_ROAD_P SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3FC2094FF3A8FC0486B1 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F92C9EF0F3F7D6DB7B2 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3FA2692F2F87E1CA662B VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
9F62A9BF88487F29F48F VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE AppHost_Access SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 FF92994F13A2F7EBC7C9 \
VENDOR_STRING=AppHost_Access \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DFF2D9CF6AB040CB7B51 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DCM SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0F22698FDF9142EBE3AA \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

```

Программный режим рабочего списка DICOM Worklist и DICOM MPPS

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE Stenosis quantification SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Position memory SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Dicom Query \ Retrieve SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Navilink 2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3F02CC34D95BD4FF058F VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF12DC24E5A58B9F43BE \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
5FA27CE419B39FCECCB5 VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
0FA20C7460CCDBC16A9D VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE LGO_LINES SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F220CA4D5548F40B705 \
VENDOR_STRING=BU_XP HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE KWIRE_STANDARD SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 8FE2DC04C1B786F88BD5 \
VENDOR_STRING=SAG_Med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
CF322CE4C8DA7C6B6141 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

```

Программный режим DICOM Advanced



Программный режим Cios OpenApps для удаленного доступа к базе данных приложений

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE Stenosis quantification SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Position memory SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Dicom Query \ Retrieve SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Navilink 2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3F02CC34D95BD4FF058F VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF12DC24E5A58B9F43BE \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
5FA27CE419B39FCECCB5 VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
0FA20C7460CCDBC16A9D VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE LGO_LINES SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F220CA4D5548F40B705 \
VENDOR_STRING=BU_XP HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE KWIRE_STANDARD SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 8FE2DC04C1B786F88BD5 \
VENDOR_STRING=SAG_Med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
CF322CE4C8DA7C6B6141 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

```

Программный режим Navilink 2D (встроенный цифровой навигационный интерфейс для передачи без потерь данных
двухмерного изображения в навигационную систему)

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE DicomSend SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 2FD22C446D75C3BA0298 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE MagicWatch SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3F024C94B8EA4595BB56 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE DicomPrint SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 7FC29C849D356A3230DC \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE DicomWorklist SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F42AC14FCE16E8186C5 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3F02CC34D95BD4FF058F VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF12DC24E5A58B9F43BE \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
5FA27CE419B39FCECCB5 VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
0FA20C7460CCDBC16A9D VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE LGO_LINES SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F220CA4D554BF40B705 \
VENDOR_STRING=BU_XP HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE KWIRE_STANDARD SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 8FE2DC04C1B786F88BD5 \
VENDOR_STRING=SAG_Med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
CF322CE4C8DA7C6B6141 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

```

Программный режим 2D измерения (для измерения углов и расстояний)

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: [REDACTED]
# System SerialNumber: [REDACTED]
# HW_ID MaterialNumber: [REDACTED]
# HW_ID SerialNumber (=ID): [REDACTED]
# Creation Date: [REDACTED]
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE DicomSend SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3F7229CF6739F71AD012 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MagicWatch SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FE2695F3C4095F9EF3A \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomPrint SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF22A90F653762565800 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomWorklist SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FC2A9BF1461F6879641 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

#FEATURE Hipaa_C SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 CF92C9EFAE99DEB0E614 \
#VENDOR_STRING=SIENET HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DF82A95FDF7D50291309 VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE SUB_ROAD_P SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3FC2094FF3A8FC0486B1 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F92C9EF0F3F7D6D87B2 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3FA2692F2F87E1CA662B VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
9F62A9BF88487F29F48F VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE AppHost_Access SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 FF92994F13A2F7EBC7C9 \
VENDOR_STRING=AppHost_Access \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DFF2D9CF6AB040CB7B51 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DCM SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0F22698FDF9142EBE3AA \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

```

Программный режим SUB/Road

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: [REDACTED]
# System SerialNumber: [REDACTED]
# HW_ID MaterialNumber: [REDACTED]
# HW_ID SerialNumber (=ID): [REDACTED]
# Creation Date: [REDACTED]
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE DicomSend SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3F7229CF6739F71AD012 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MagicWatch SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FE2695F3C4095F9EF3A \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomPrint SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF22A90F653762565800 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DicomWorklist SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0FC2A9BF1461F6879641 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

#FEATURE Hipaa_C SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 CF92C9EFAE99DEB0E614 \
#VENDOR_STRING=SIENET HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DF82A95FDF7D50291309 VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE SUB_ROAD_P SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 3FC2094FF3A8FC0486B1 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F92C9EF0F3F7D6D87B2 \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3FA2692F2F87E1CA662B VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
9F62A9BF88487F29F48F VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE AppHost_Access SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 FF92994F13A2F7EBC7C9 \
VENDOR_STRING=AppHost_Access \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
DFF2D9CF6AB040CB7B51 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

FEATURE DCM SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 0F22698FDF9142EBE3AA \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A14

```

Программный режим SUB/Road расширенной функциональности



Программный режим для рисования линий на изображении

```

# [SOH]
# BU: AX
# Systemname: Cios Flow
# System MaterialNumber: 
# System SerialNumber: 
# HW_ID MaterialNumber: 
# HW_ID SerialNumber (=ID): 
# Creation Date: 
#
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]

FEATURE Stenosis quantification SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Position memory SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Dicom Query \ Retrieve SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 00988FE47B49CC578925 \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE Navilink 2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
6D083F148F81466ED4DF HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=11C55A77

FEATURE REMOTE_ASSISTANCE SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
3F02CC34D958D4FF058F VENDOR_STRING=BU_XP \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE MEASURE_2D SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 AF12DC24E5A58B9F43BE \
VENDOR_STRING=SAG_med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROMEDIUMSPEED15 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
5FA27CE419B39FCECCB5 VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE FLUOROHIGHSPEED30 SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
0FA20C7460CCDBC16A9D VENDOR_STRING=SAG_med \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE LGO_LINES SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 9F220CA4D5548F40B705 \
VENDOR_STRING=BU_XP HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE KWIRE_STANDARD SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 8FE2DC04C1B786F88BD5 \
VENDOR_STRING=SAG_Med HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

FEATURE DICOM_ENCRYPTION SAG_med 1.0 01-jan-2300 0 \
CF322CE4C8DA7C6B6141 VENDOR_STRING=DICOM_ENCRYPTION \
HOSTID=VENDOR_DEFINED_HOSTID=39024A92

```

Программный режим количественного представления стеноза

Configuration

System
System Config
Info
Local Installation
Remote Installation
Download
Version Check
Config Check
Components
Support Functions
Future Curve Install

Home | Event Log | Reports | Help | Logout

Other_HW	
Generator	Polydrom M25
Cooling Unit	available
X-Ray Tube	Opt 150/10/30R
DAP Meter	Yes
DICOM WLAN Client	No
SW_Options	
Language Setting	English
Keyboard Layout	English U.S.
High Speed Fluoro (key)	Yes
Medium Speed Fluoro (key)	Yes
SubRoad Basic Module (key)	No
SubRoad Advanced Module (key)	Yes
SubRoad Premium Module (key)	Yes
Stenosis Quantification (key)	Yes
2D Measuring (key)	Yes
Advanced IQ algorithms (key)	Yes
Line Graphics (key)	Yes
kWise Standard (key)	Yes
Navilink 2D (key)	Yes
Navilink 3D (key)	Yes
3D (key)	Yes
MAR 3D (key)	Yes
Measure 3D (key)	Yes
VRT 3D (key)	Yes
Screw Detection (key)	Yes
DCM (key)	Yes
DVD Recorder (key)	Yes
Dicom Send (key)	Yes
Dicom Print (key)	Yes
Dicom Worklist (key)	Yes
Dicom Query (key)	Yes
X-Ray Pascode (key)	No
HIPAA (key)	No
Video Manager (key)	No
Applfont Access (key)	No
Simulation	
Teaching mode	No

Ready

Default Values | AutoLic | Configure | Save | Exit

Siemens Healthcare

Программный цифровой кинорежим- Digital Cine Mode



Программный режим Target Pointer

Фамилия 251, Emergency

Кол-во серий/снимков 1 / 15

Дата рожд. 03-03-2017

Код запроса

Код пац. E_251

Но. исследов-я

Накопленные значения

Пол Д

Назв.иссл. testcenter

Время скопии 00:00:04

Отделение

Рентгенолог

Поверхн. доза ($\mu\text{Gy}\cdot\text{m}^2$) 2.14

Имя клиники Testcenter

Воздушн. керма 0.10

kV	mAs	Продолж. ре...	Част...	Уровен...	Длина сц...	Формат	Хар. кривая	Дата и время	Название оп
57.4	0.11	6.8	15.0	0.012	1.2	Mag 0	FL-HC	03-03-2017 10:04:43	no autostore
54.5	0.05	5.5	15.0	0.012	0.8	Mag 0	FL-HC	03-03-2017 10:05:23	no autostore
51.7	0.03	6.0	15.0	0.012	0.9	Mag 0	FL-HC	03-03-2017 10:06:04	no autostore
51.3	0.03	6.3	15.0	0.012	0.8	Mag 0	FL-HC	03-03-2017 10:06:20	no autostore
66.4	0.39	13.7		0.548		Mag 0	DR-HC	03-03-2017 10:06:41	no autostore
65.4	0.28	12.2		0.548		Mag 0	DR-HC	03-03-2017 10:06:43	no autostore

☒ Печать дозы

☐ Печать на пленке

Экспорт

Печать

Закрыть

Программный режим записи рентгеноскопического видеопотока на CD/DVD в формате MPEG4

Configuration

System Config
 System Info
 Local Installation
 Remote Installation
 Download
 Version Check
 Config Check
 Components
 Support Functions
 Service Curve Install

Home | Event Log | Reports | Help | Logout

Other_HW	
Generator	Polydrom M25
Cooling Unit	variable
X-Ray Tube	Opti 150/10/30R
DAP Meter	Yes
DICOM WLAN Client	No
SW_Option	
Language Setting	English
Keyboard Layout	English U.S.
High Speed Fluoro (key)	Yes
Medium Speed Fluoro (key)	Yes
Sub-Road Basic Module (key)	No
Sub-Road Advanced Module (key)	Yes
Sub-Road Premium Module (key)	Yes
Stenosis Quantification (key)	Yes
2D Measuring (key)	Yes
Advanced IQ algorithms (key)	Yes
Line Graphics (key)	Yes
kWare Standard (key)	Yes
NaviLink 2D (key)	Yes
NaviLink 3D (key)	Yes
3D (key)	Yes
MAR 3D (key)	Yes
Measure 3D (key)	Yes
VRT 3D (key)	Yes
Screw Detection (key)	Yes
DCM (key)	Yes
DVD Recorder (key)	Yes
Dicom Send (key)	Yes
Dicom Print (key)	Yes
Dicom Worklist (key)	Yes
Dicom Query (key)	Yes
X-Ray Passcode (key)	No
HIPAA (key)	No
Video Manager (key)	No
Applinet Access (key)	No
Simulation	
Teaching mode	No

Default Values | AutoLic | Configure | Save | Exit

Лицензионный ключ электронной блокировки излучения



[Home](#) | [Event Log](#) | [Reports](#) | [Help](#) | [Logout](#)

Other HW	
Generator	Polydoron M25 v
Cooling Unit	variable v
X-Ray Tube	Opt: 150-10/30H
DAP Meter	Yes v
DCOM WLAN Client	No v
SW Options	
Language Settings	English v
Keyboard Layout	English US v
High Speed Fluoro (key)	Yes v
Medium Speed Fluoro (key)	Yes v
Sub Road Basic Module (key)	No
Sub Road Advanced Module (key)	Yes v
Sub Road Premium Module (key)	Yes v
Simous Quantification (key)	Yes v
2D Measuring (key)	Yes v
Advanced IQ algorithms (key)	Yes v
List Graphics (key)	Yes v
iWare Standard (key)	Yes v
NavisLink 2D (key)	Yes v
NavisLink 3D (key)	Yes v
1D (key)	Yes v
MAR 1D (key)	Yes v
Measure 3D (key)	Yes v
VRT 3D (key)	Yes v
Screw Detection (key)	Yes v
DCM (key)	Yes v
DVD Recorder (key)	Yes v
Decom Send (key)	Yes v
Decom Print (key)	Yes v
Decom Workflow (key)	Yes v
Decom Query (key)	Yes v
X-Ray Pascode (key)	No v
HIPAA (key)	No v
Video Manager (key)	No v
ApplSoft Access (key)	No v
Simulation	
Tracking mode	No v

Default Values	AutoLic	Configure	Save	Exit
----------------	---------	-----------	------	------

 Surrenderia Inc. 2012

Программный режим HIPAA (Закон об отчетности и использовании данных в сфере медицинского страхования)

Password Policy

The password complexity configured here takes effect with the next password change of each user. A zero (0) setting means no limitation.

Minimum password length: characters

Enforce password history: passwords remembered

Minimum number of Uppercase

Minimum number of Lowercase

Minimum number of Numeric (0-9)

Minimum number of Non alpha-numeric
(e. g., |, #, \$, %)

Emergency User

Emergency Login provides the possibility to log on to the system without authentication.

☒ Allow Emergency Login

Use default settings

Application Accounts

Change internal passwords

Unharden OS

Temporarily unhardened OS

OK

Cancel

Лицензионный ключ DoD License




Принтер для вывода изображений в варианте исполнения: UP-971AD



Принтер для вывода изображений в варианте исполнения: UP-991AD



Принтер для вывода изображений в варианте исполнения: UP-D898MD

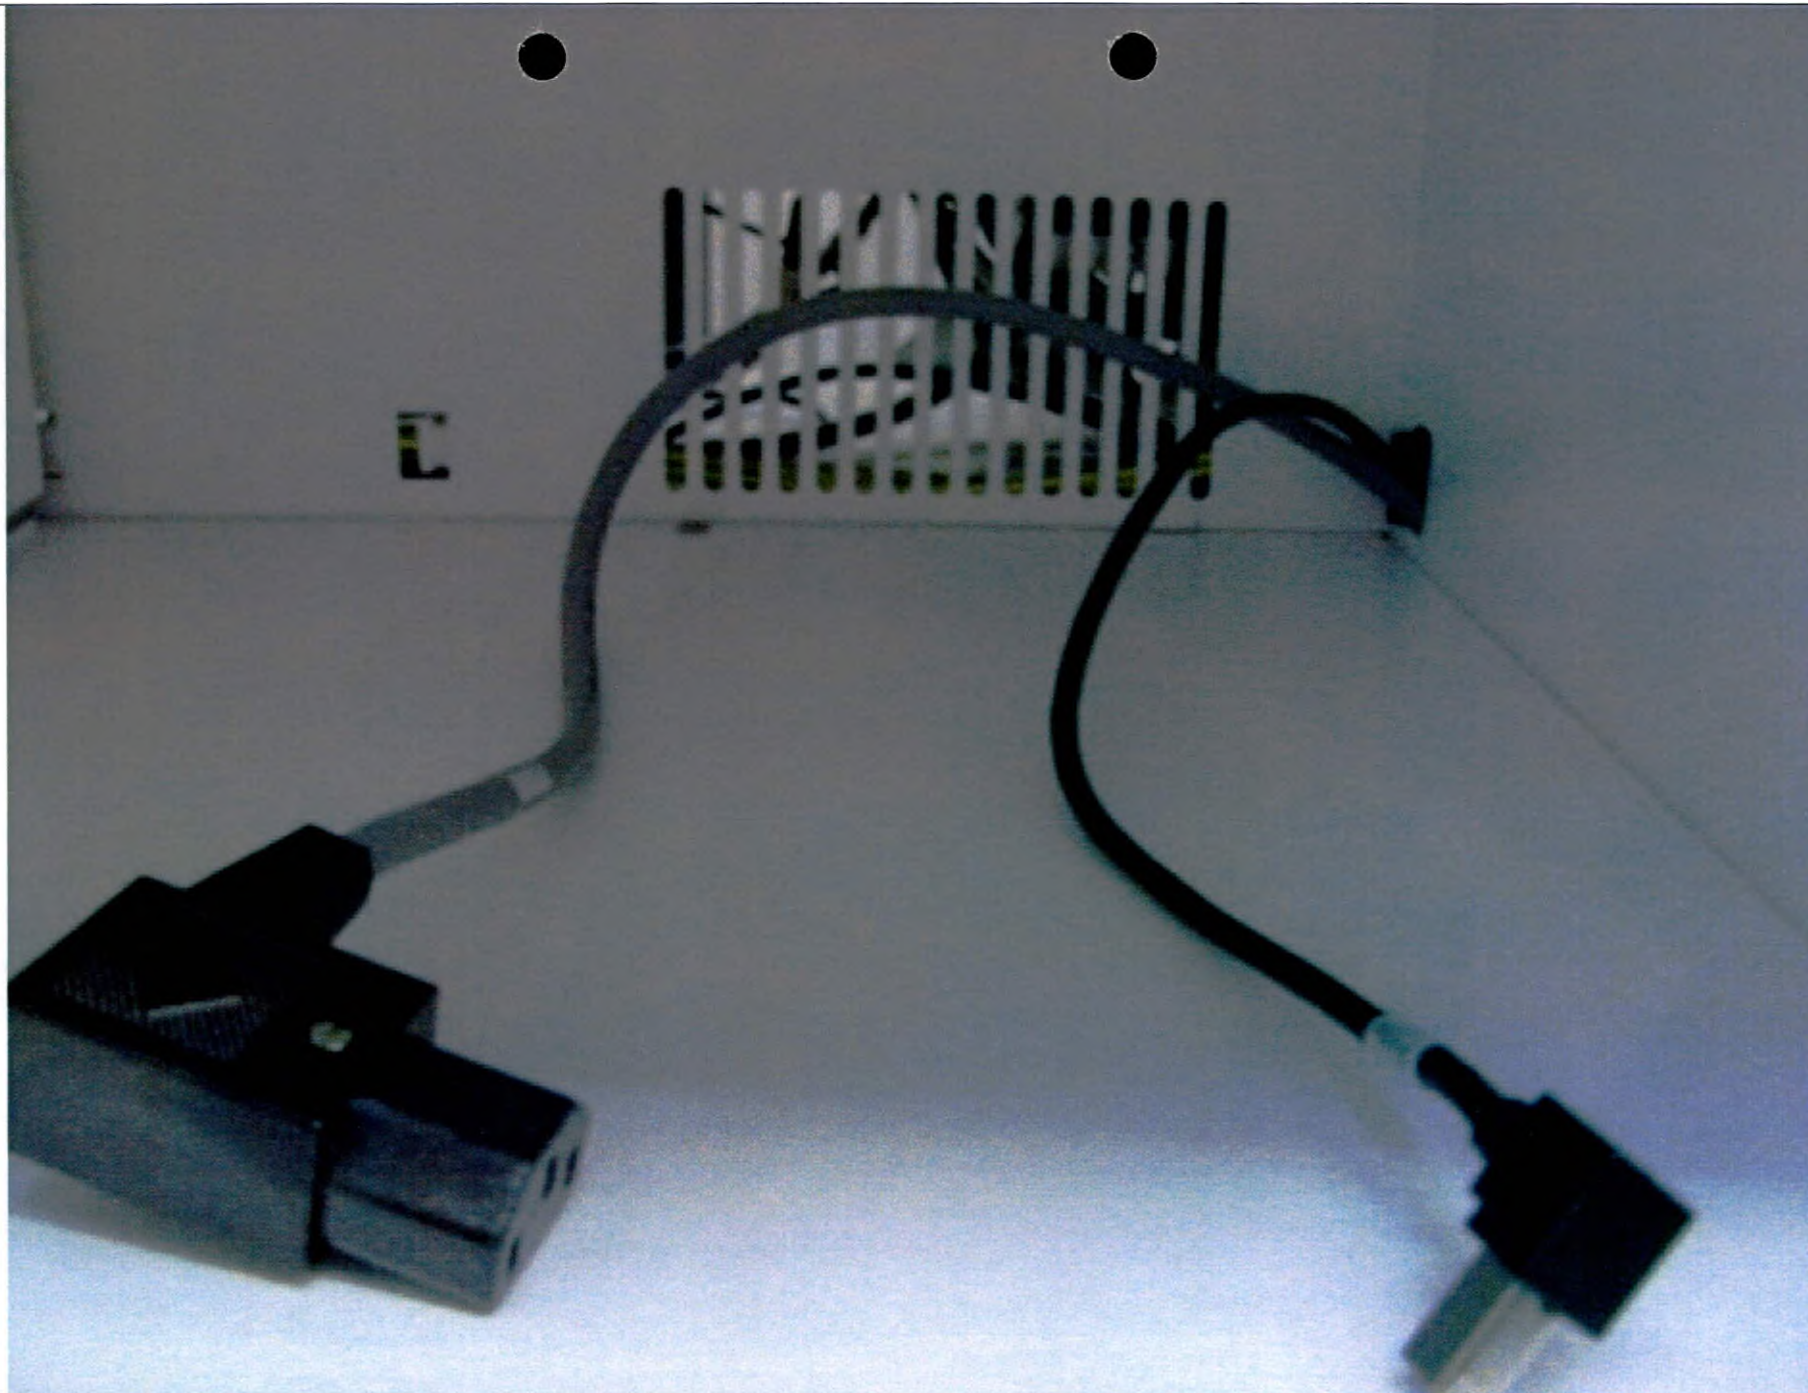

Инсталляционный набор для принтера. Кабель подключения питания



Инсталляционный набор для принтера. Кабель USB



Пульт дистанционного управления



Фиксатор пульта дистанционного управления на рельсе стола




Тележка пульта дистанционного управления



Дополнительный ножной переключатель, вариант исполнения: многофункциональный напольный переключатель



Дополнительный ножной переключатель, вариант исполнения: беспроводной многофункциональный напольный переключатель

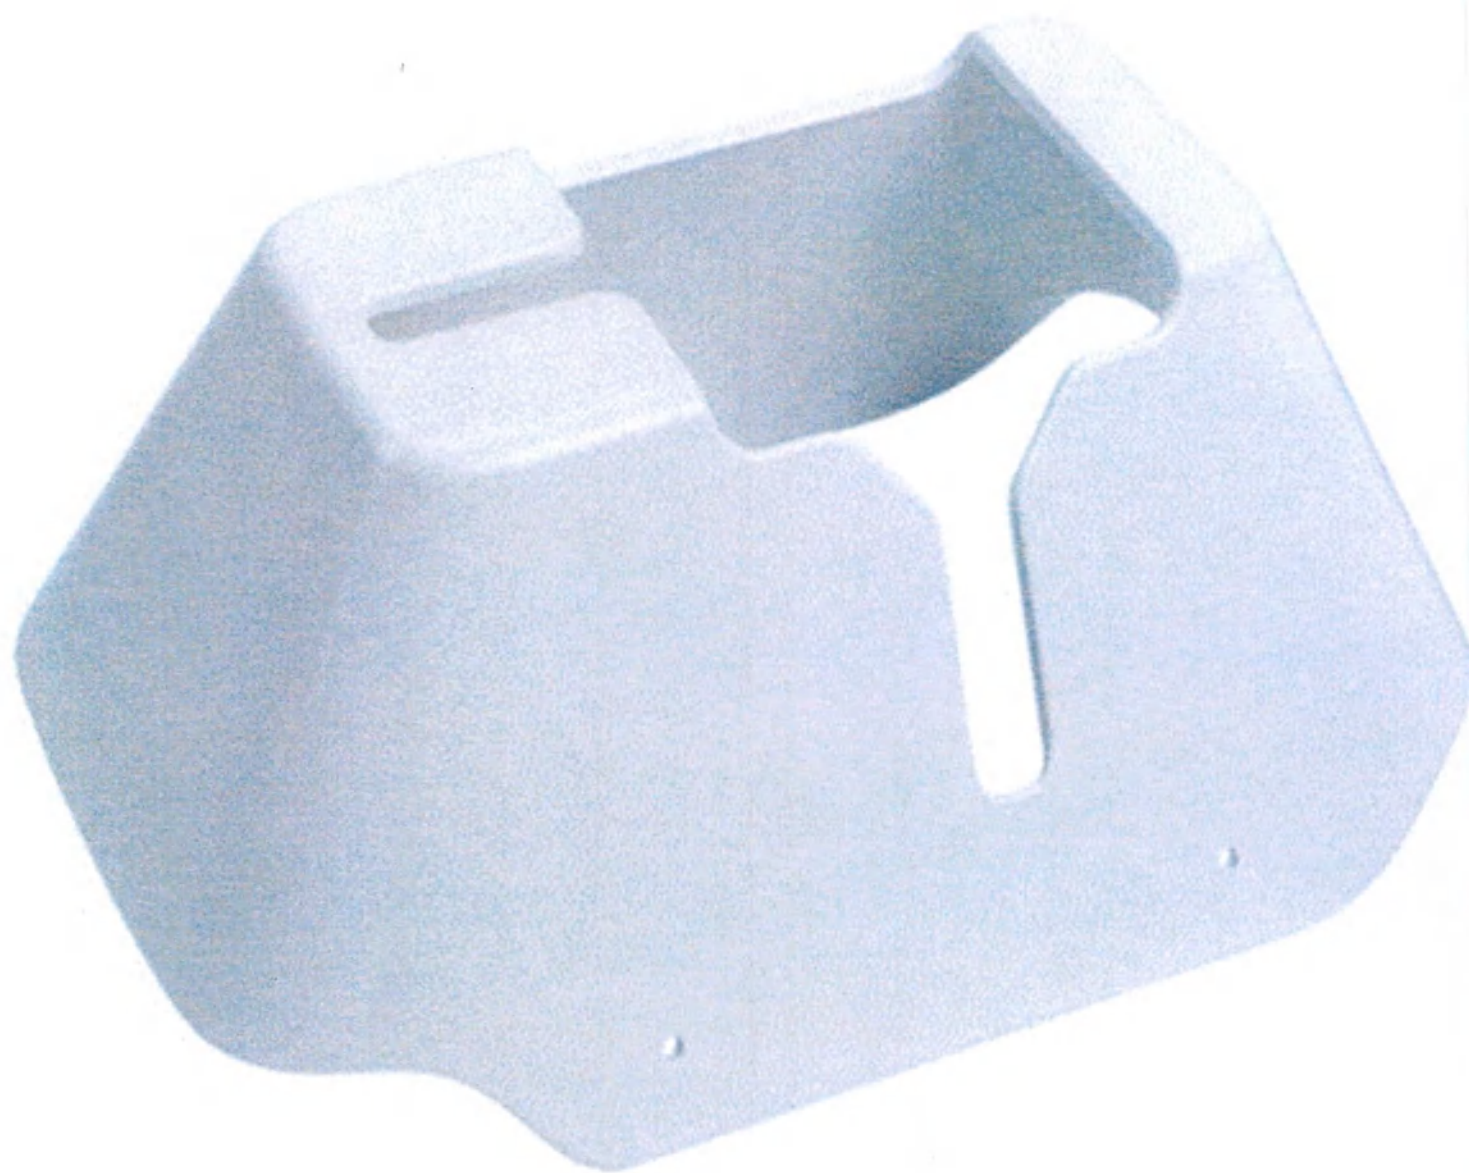

Проставка для обеспечения минимального расстояния фокус-кожа



Кабель эквипотенциального соединения

FLC Service

[Back to Overview](#)

System

[System Settings](#)[System Diagnostics](#)[System Restart](#)[Image Restore](#)[Hard Disk Encryption](#)[Network Access Watchdog](#)

Network Access Watchdog Settings

Activation/Deactivation

Status

Enabled

Disabled

Whitelist

Defined trusted non-compressed IP addresses, one address per line

Save


Cancel

Last suspicious IP addresses detected

DRCOM Interface

Navigation Interface

with SpotAdapt

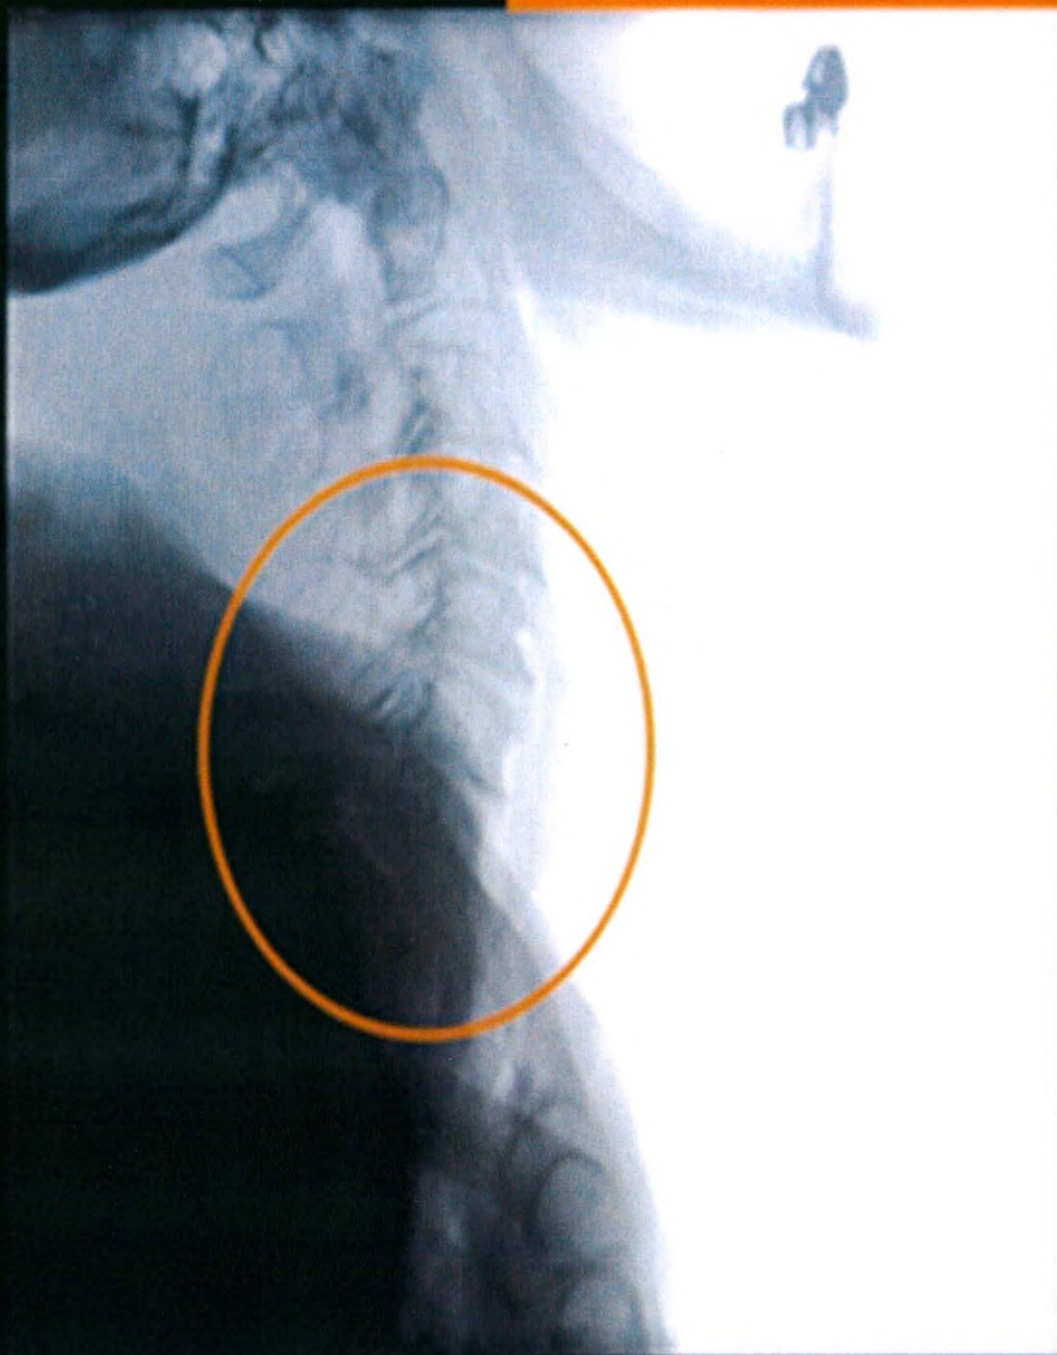

12

Restricted © Siemens Healthineers, 2020

Программный режим Spotadapt

Patient:

Accession No.: 0815_4711

✓ Institution

Hospital name and address

✓ Report ID

Accession No. 0815_4711

Date 26-08-2020 12:46:53 PM

✓ Patient Data

Patient ID 280820_123834

Ward testward

Name Mustermann

Perf. Physician Otto

First Name Max

Assistance

Date of Birth 29-05-1968

Age 52

Anesthetist

Sex M

Weight 115 kg

Size 1 cm

BMI 115000 kg/m²

☒ stationary

☐ ambulatory

✓ Status pre-ESWL

Diagnosis with

☒ Ultrasound

☒ KUB

☒ IVP

Localisation with


☒ Ultrasound

☒ X-Ray

Obstruction None

✓ Stone position

☒ Urinary Tract ☐ Bile Duct

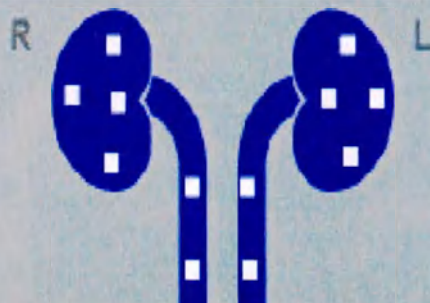

Location

Stone Size

Therapy

Stone 1

Stone 2

No images marked in the study or exceed the limit


Print

OK

Apply

Cancel

Программный режим Litho Report

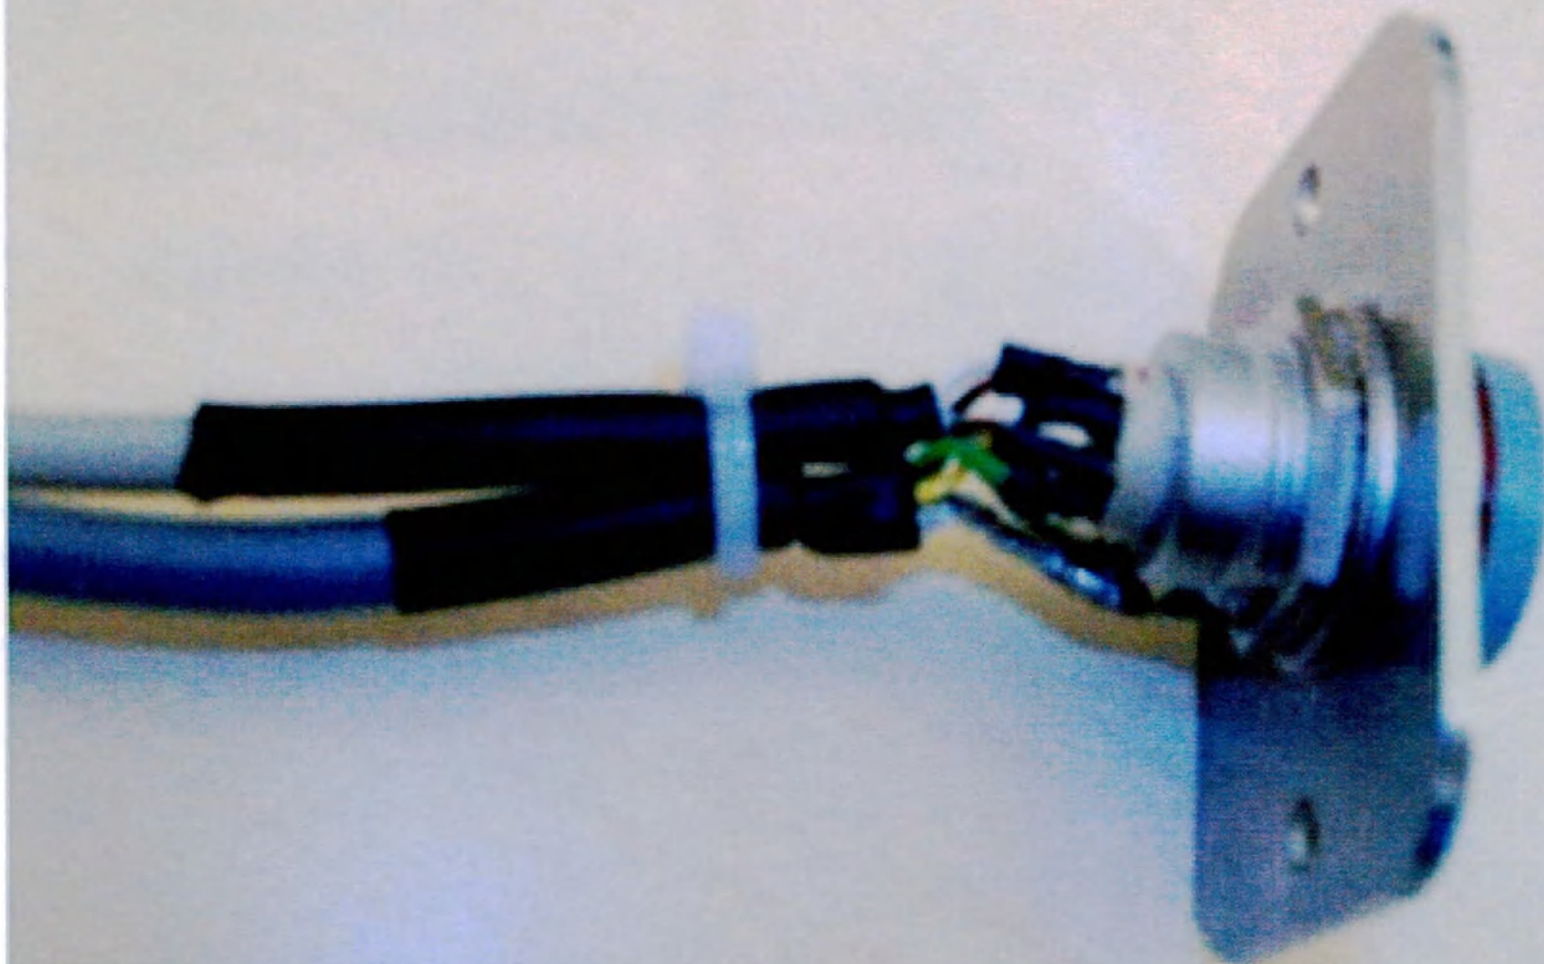

Кабель для обеспечения опций литотрипсии



Упаковка

Cios Flow



(01) 04056869245628
(240) 11108110
(422) 276
(21) 100

SYSTEM IVK

GTIN
MODEL
ORIGIN DE
SERIAL **SN**



**Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany**

Made in Germany

Идентификационная табличка системы от производителя

Система мобильная рентгеновская для ангиографических и рентгеноскопических процедур Cios Flow с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от dd.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

~100/110/120/127/200/220/230/240 В

50/60 Гц

18 - 9 А / 29 – 14 А

Всего прошито и пронумеровано
40 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

