


**Приложение А
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)**

Фотографические изображения медицинского изделия

Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003

1. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, белого цвета, с полимерным покрытием, размеры XS, S, M, L, XL.

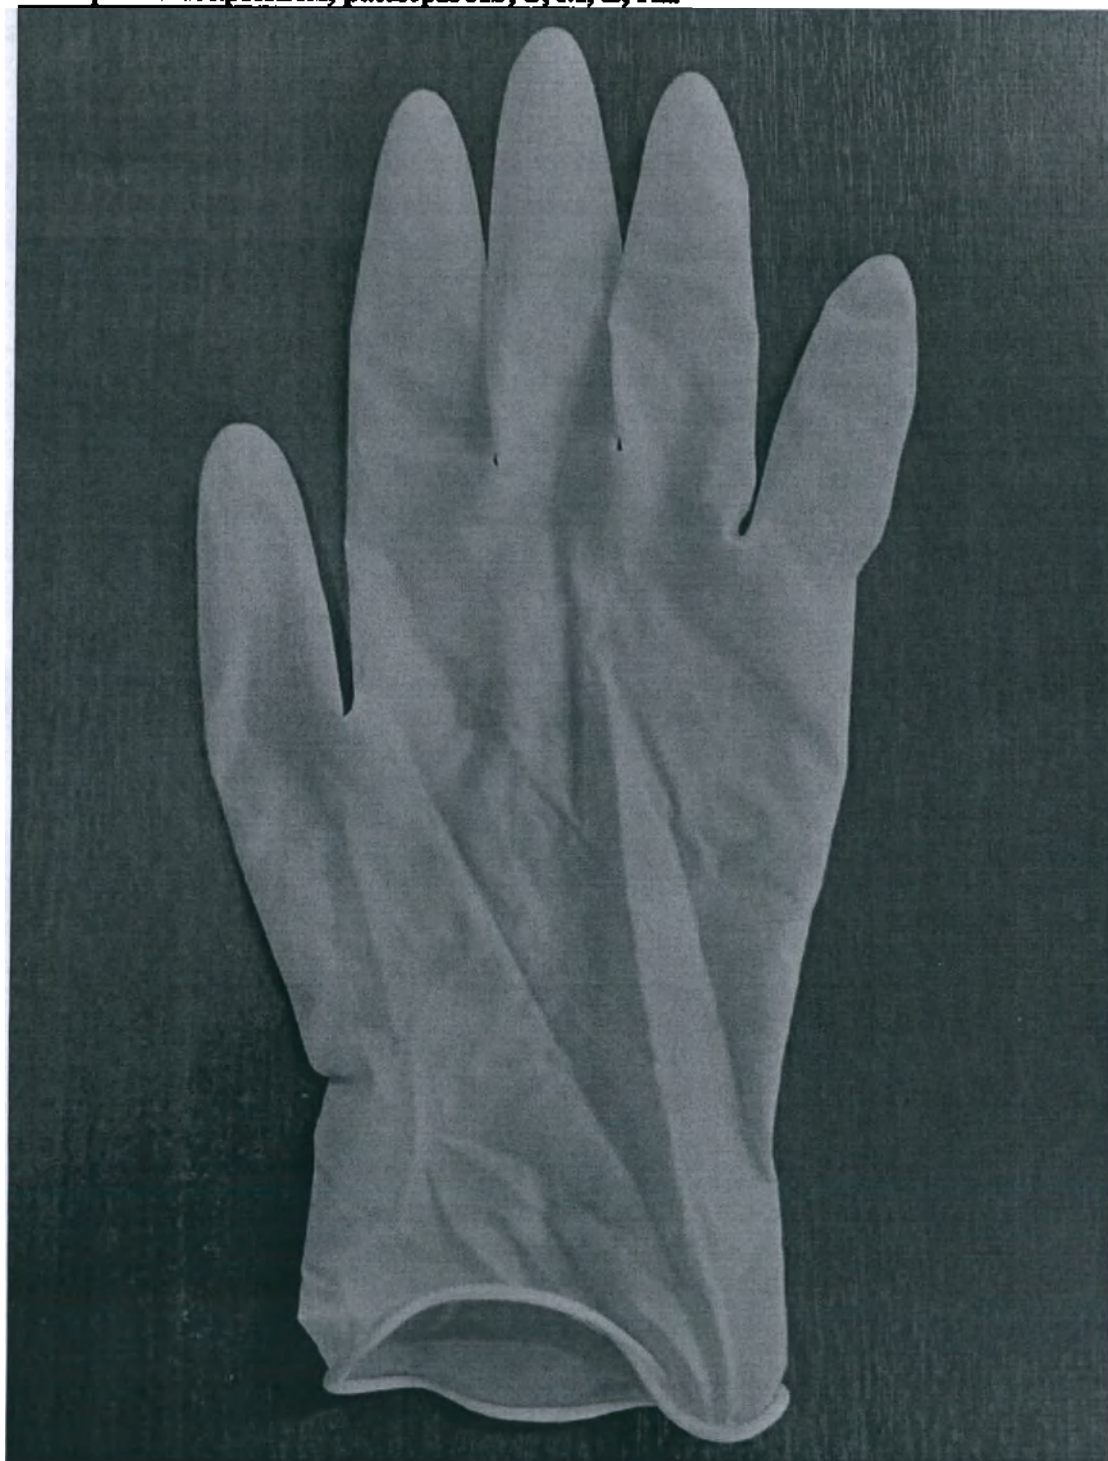

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
23

Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239

НЕОПУДРЕННЫЕ		ГЛАДКИЕ	☐	Цвет белый	☒	Размер:	☐
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☒					XS	
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☒	Цвет бежевый	☐	Размер: S	☒
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					Размер: M	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☐					Размер: L	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐					Размер: XL	☐

LOT

1221001



02.02.2022

НЕТОКСИЧНО



Количество:

50 пар (1 пара – 2шт).



02.2025



Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию



Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»
123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, белого цвета, с полимерным покрытием, размеры XS, S, M, L, XL

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист

24

2. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, с полимерным покрытием, размеры XS, S, M, L, XL

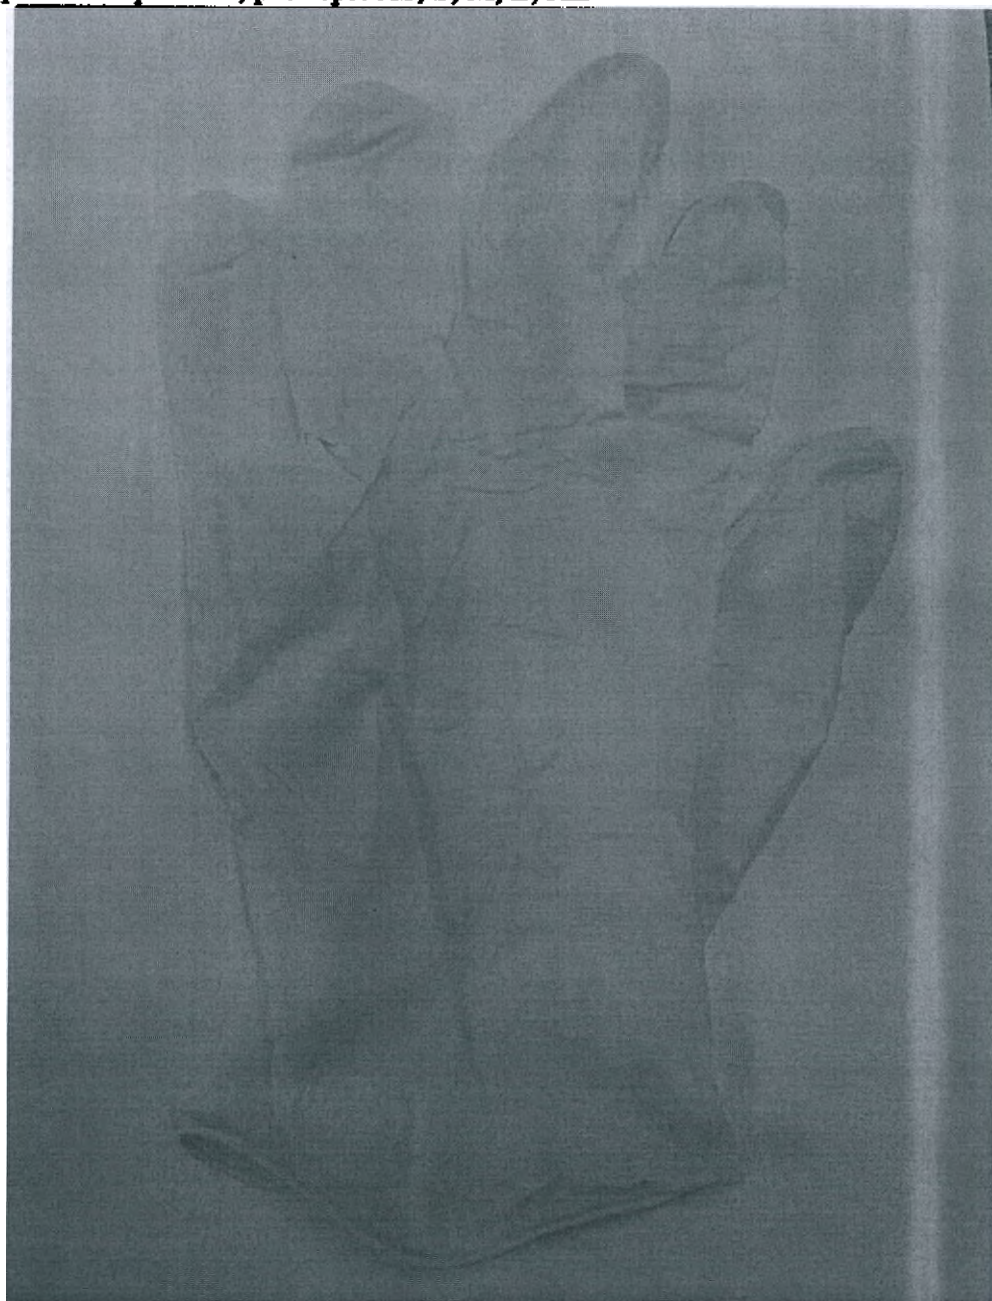

Изм. № подл.	Полн. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Полн. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
25

Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239

НЕОПУДРЕННЫЕ		ГЛАДКИЕ	☐	Цвет белый	☐	Размер: XS	☐
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☒					Размер: S	☐
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☒	Цвет бежевый	☒	Размер: M	☒
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					Размер: L	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☐					Размер: XL	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐						

LOT

1221001



02.02.2022

НЕТОКСИЧНО



Количество:

50 пар (1 пара – 2шт).



02.2025



Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию

Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»
123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, с полимерным покрытием, размеры XS, S, M, L, XL

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист

26

3. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, гладкие, белого цвета, с полимерным покрытием, размеры XS, S, M, L, XL

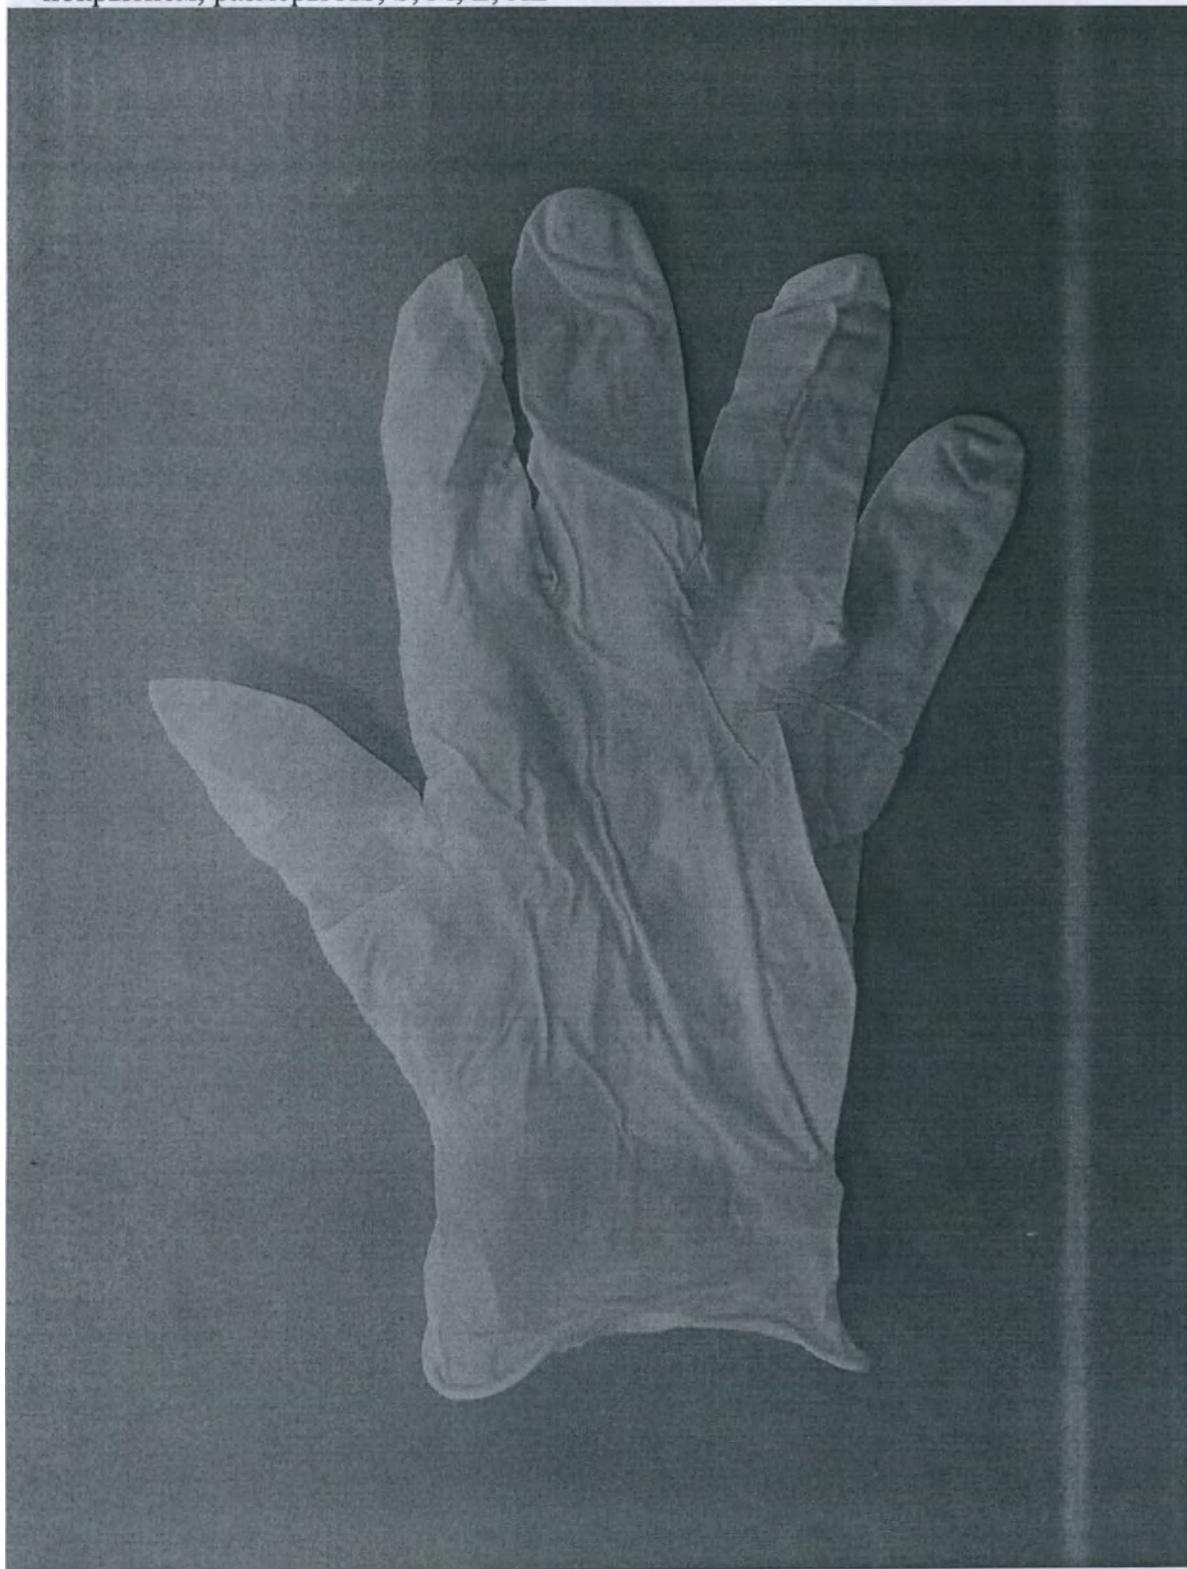

Изм. № подл.	Полн. и дата	Взам. инв. №	Исх. № дубл.	Полн. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
27

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239**

НЕОПУДРЕННЫЕ		ГЛАДКИЕ	☒	Цвет белый	☒	Размер:	☒
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☒					XS	
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☐	Цвет бежевый	☐	Размер: S	☐
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					Размер: M	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☐					Размер: L	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐					Размер: XL	☐

LOT

1221001



02.02.2022

НЕТОКСИЧНО



Количество:

50 пар (1 пара – 2шт).



02.2025



Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию



Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»

123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, гладкие, белого цвета, с полимерным покрытием, размеры XS, S, M, L, XL

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист

28

4. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, гладкие, бежевого цвета, с полимерным покрытием, размеры XS, S, M, L, XL

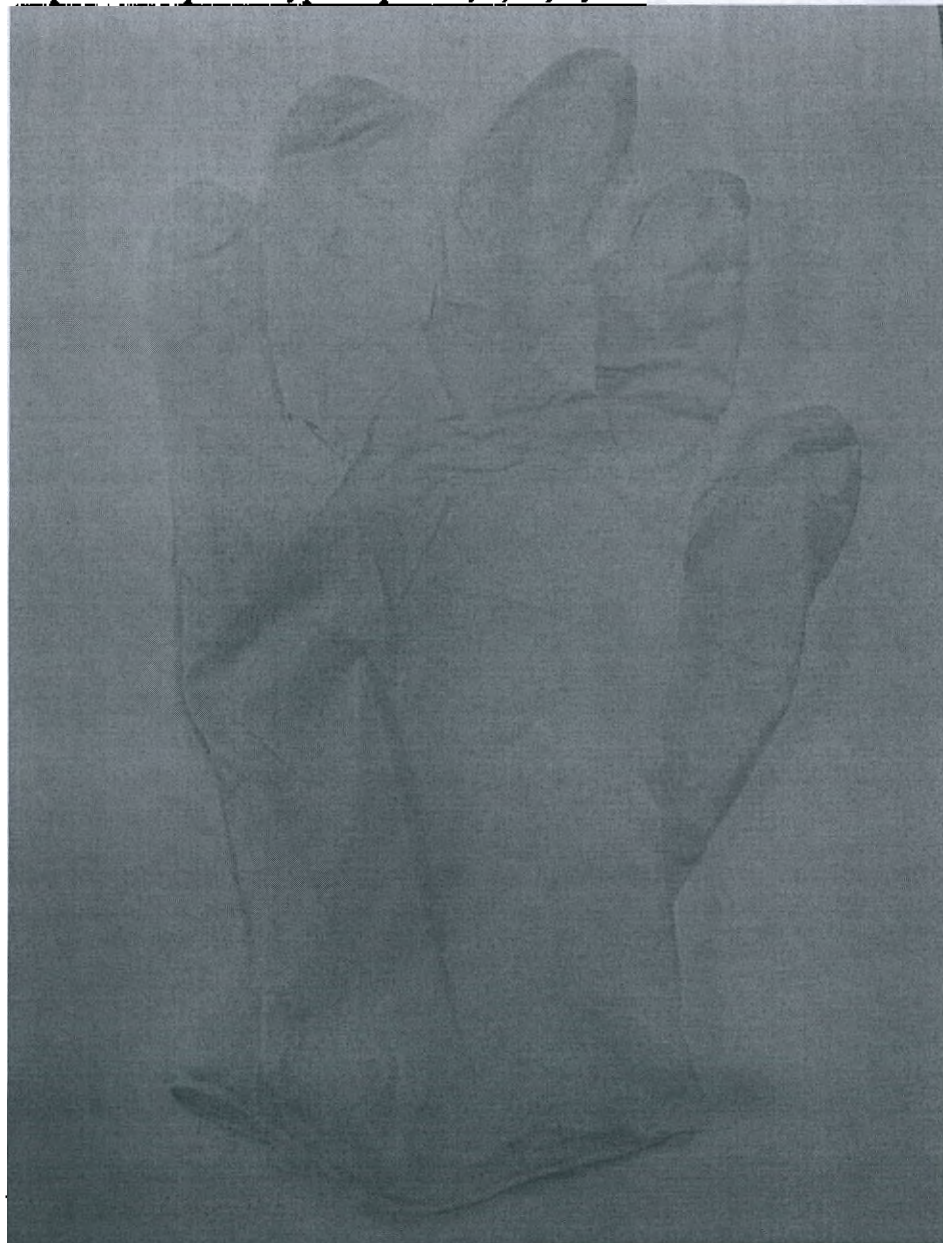

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ТУ 22.19.60-001-06663635-2022				Лист
				29

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239**

НЕОПУДРЕННЫЕ		ГЛАДКИЕ	☒	Цвет белый	☐	Размер: XS	☐
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☒					Размер: S	☐
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☐	Цвет бежевый	☒	Размер: M	☐
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					Размер: L	☒
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☐					Размер: XL	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐						

LOT

1221001



02.02.2022

НЕТОКСИЧНО



Количество:

50 пар (1 пара – 2шт).



02.2025



Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию



Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»

123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, гладкие, бежевого цвета, с полимерным покрытием, размеры XS, S, M, L, XL

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист

30

5. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, хлорированные, размеры XS, S, M, L, XL

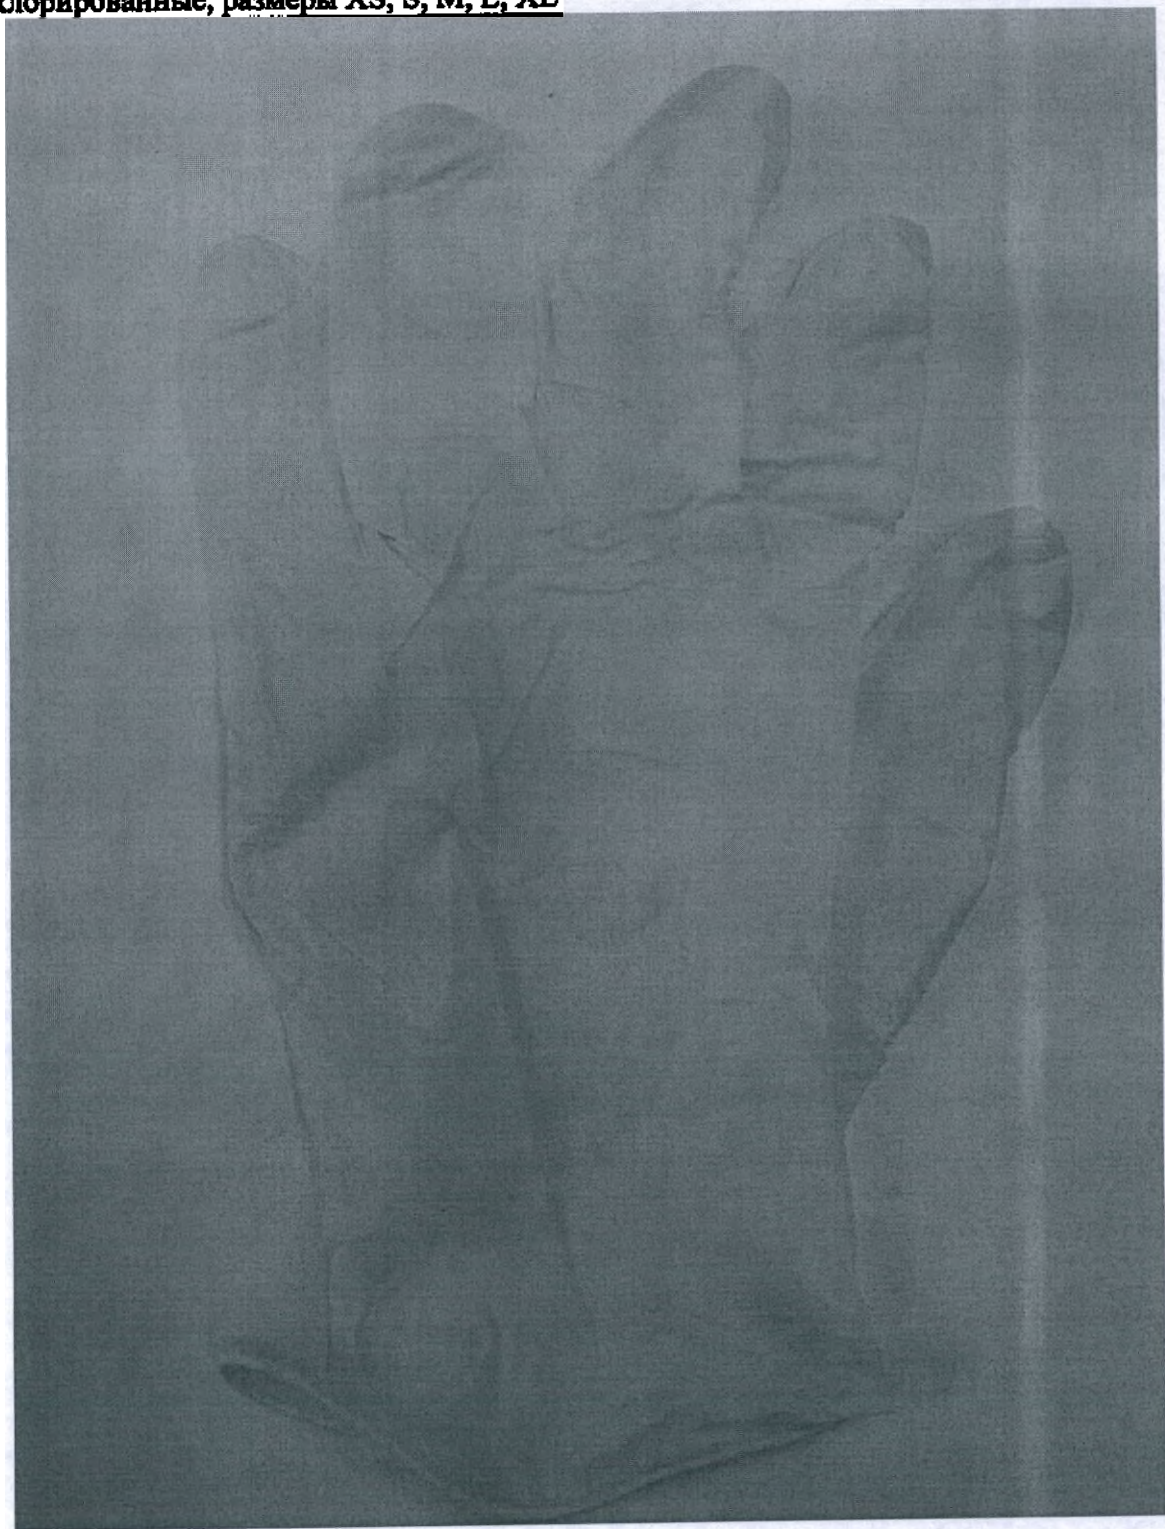

Изм. № подл.	Полн. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Полн. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист

31

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239**

НЕОПУДРЕННЫЕ						Размер:	
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☐	ГЛАДКИЕ	☐	Цвет	☐	XS	☐
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☒			белый		S	☐
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					M	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☒	Цвет	☒	L	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐			бежевый		XL	☒

LOT 1221002  02.02.2022 **НЕТОКСИЧНО** 

Количество: 50 пар (1 пара – 2шт).

 02.2025  

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию

 Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»
123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, хлорированные, размеры XS, S, M, L, XL


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
32

6. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, с двукратным хлорированием, размеры XS, S, M, L, XL

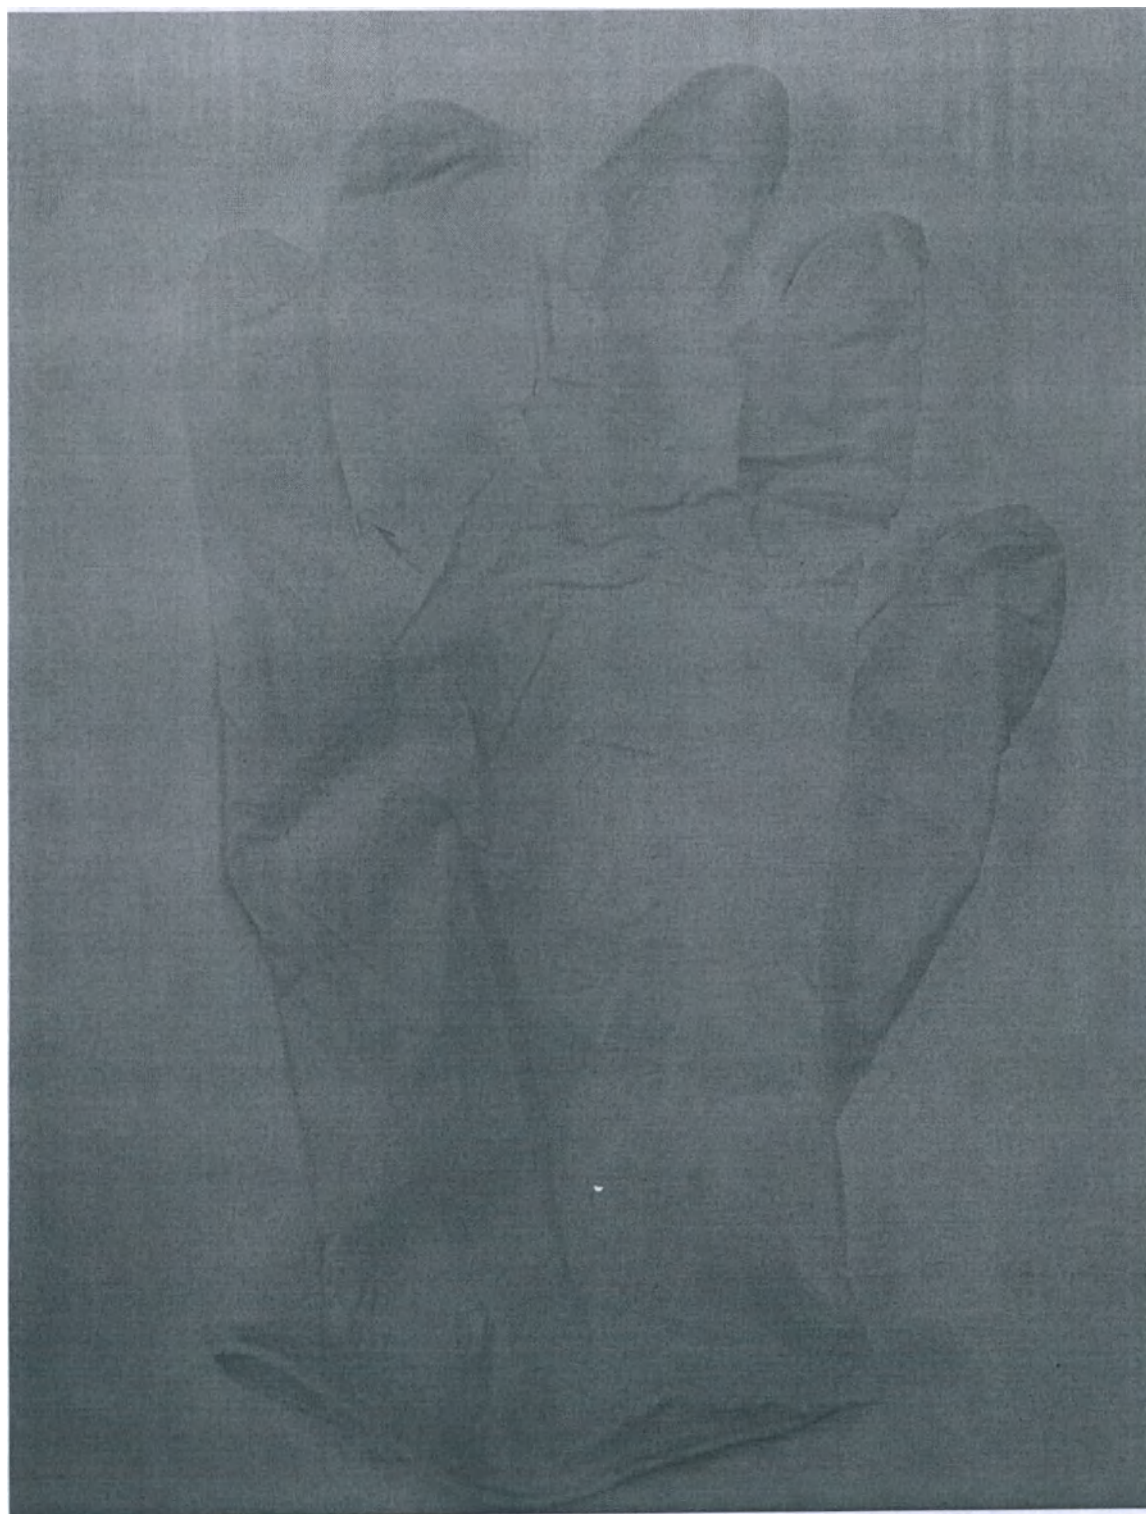

Изм. №	Полн. и дата	Разм. инв. №	Исп. №	Полн. и дата
год.			глуб.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
33

Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239

НЕОПУДРЕННЫЕ		ГЛАДКИЕ		Цвет белый		Размер: XS	
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☐					Размер: S	☐
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☒	Цвет бежевый	☒	Размер: M	☒
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☒					Размер: L	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☐					Размер: XL	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐						

LOT

1221002



02.02.2022

НЕТОКСИЧНО



Количество:

50 пар (1 пара – 2 шт).



02.2025



Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию



Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»

123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, с двухкратным хлорированием, размеры XS, S, M, L, XL

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист

34

7. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, белого цвета, без покрытия, размеры XS, S, M, L, XL

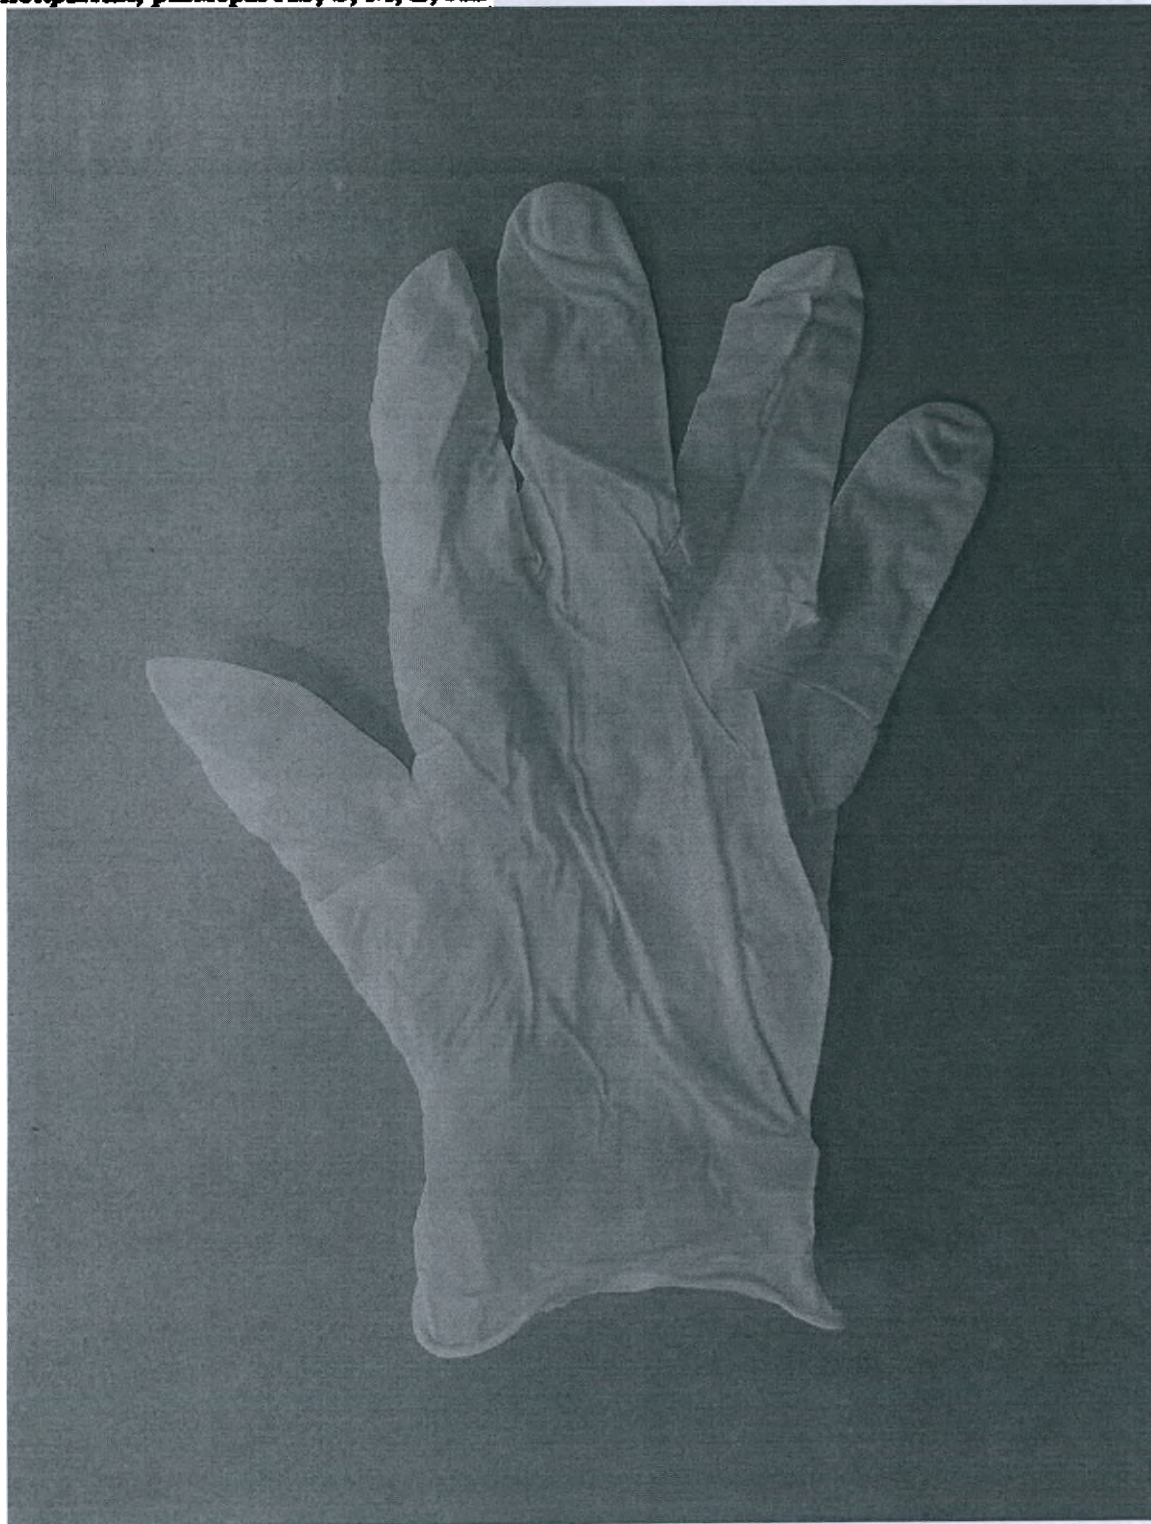

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Исх. №	Подп. и дата
подл.		инв.	клуб.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
35

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239**

НЕОПУДРЕННЫЕ						Размер:	
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☐	ГЛАДКИЕ	☐	Цвет	☒	XS	☐
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐			белый	☒	S	☒
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					M	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☒	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☒	Цвет	☐	L	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐			бежевый	☐	XL	☐

LOT	1221002		02.02.2022	НЕТОКСИЧНО	
Количество:	50 пар (1 пара – 2шт).		02.2025		

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию

 Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»
123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224


Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, белого цвета, без покрытия, размеры XS, S, M, L, XL

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 22.19.60-001-06663635-2022	Лист 36
-----	------	----------	-------	------	--------------------------------------	------------

8. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, без покрытия, размеры XS, S, M, L, XL

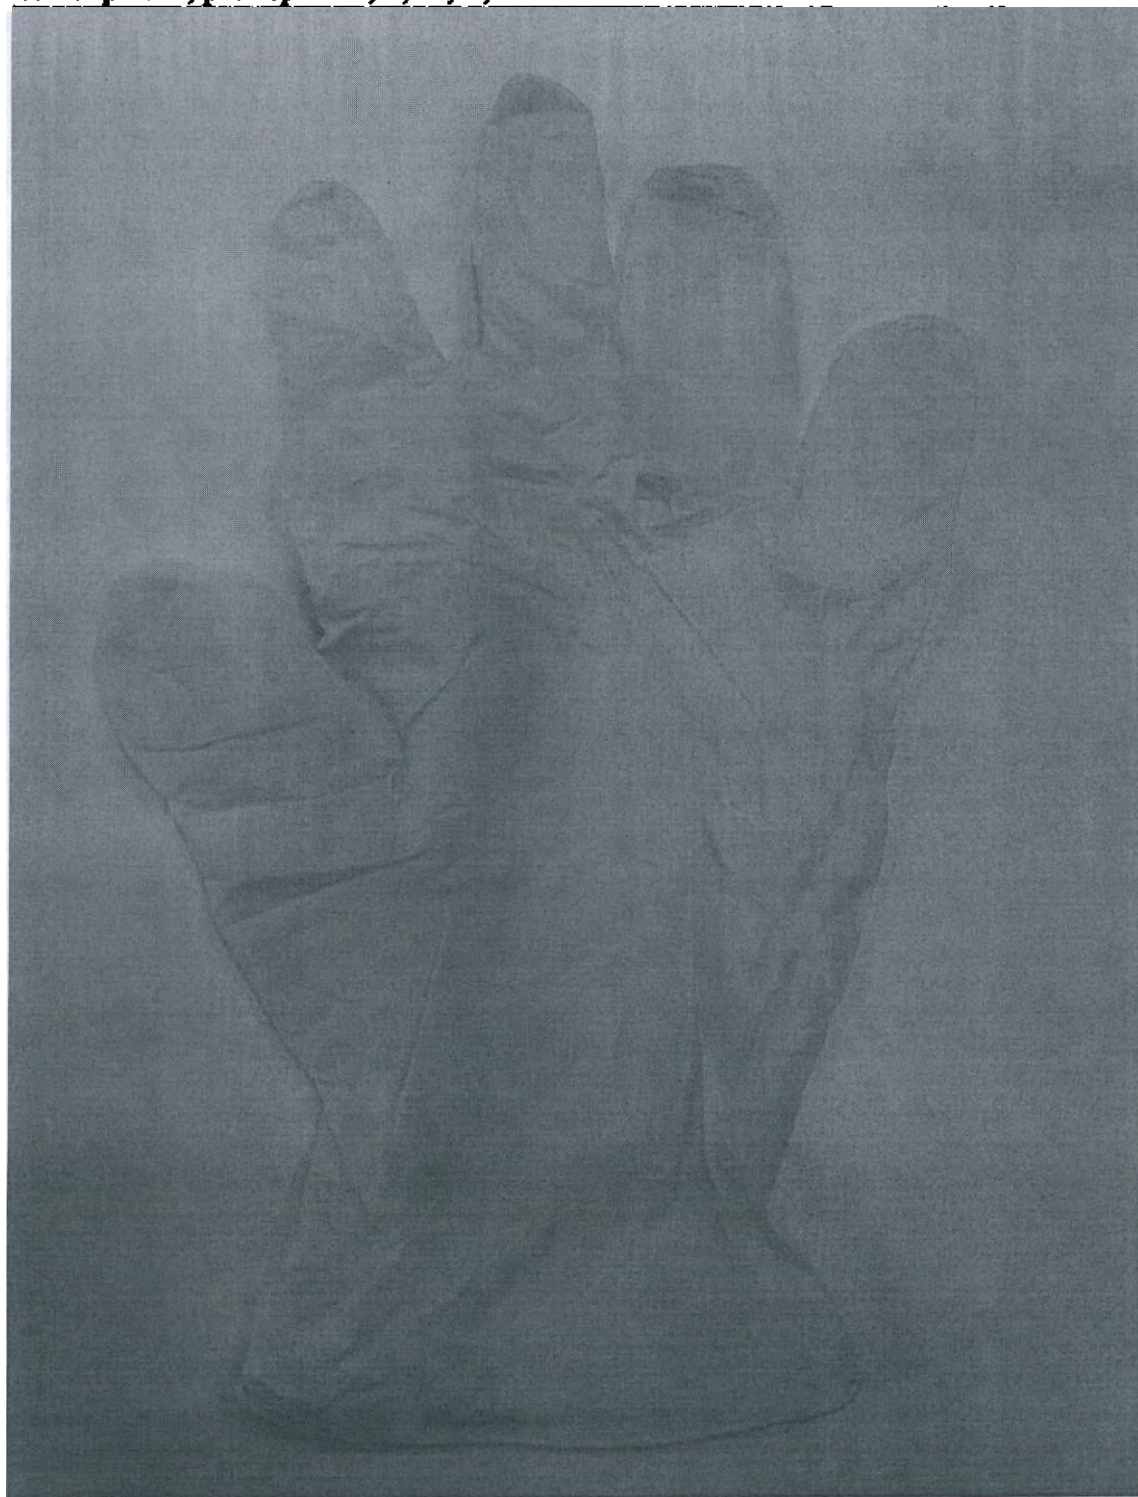

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
37

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239**

НЕОПУДРЕННЫЕ		ГЛАДКИЕ	☐	Цвет белый	☐	Размер:	☐
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☐					XS	
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☒	Цвет бежевый	☒	Размер: S	☐
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					Размер: M	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☒					Размер: L	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐					Размер: XL	☒

LOT	1221002		02.02.2022	НЕТОКСИЧНО	
Количество:	50 пар (1 пара – 2шт).		02.2025		

Условия хранения: при температуре от 0°С до плюс 30°С, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию

Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»
123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:


Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, без покрытия, размеры XS, S, M, L, XL

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 38

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

9. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, без покрытия, удлиненные, размеры XS, S, M, L, XL

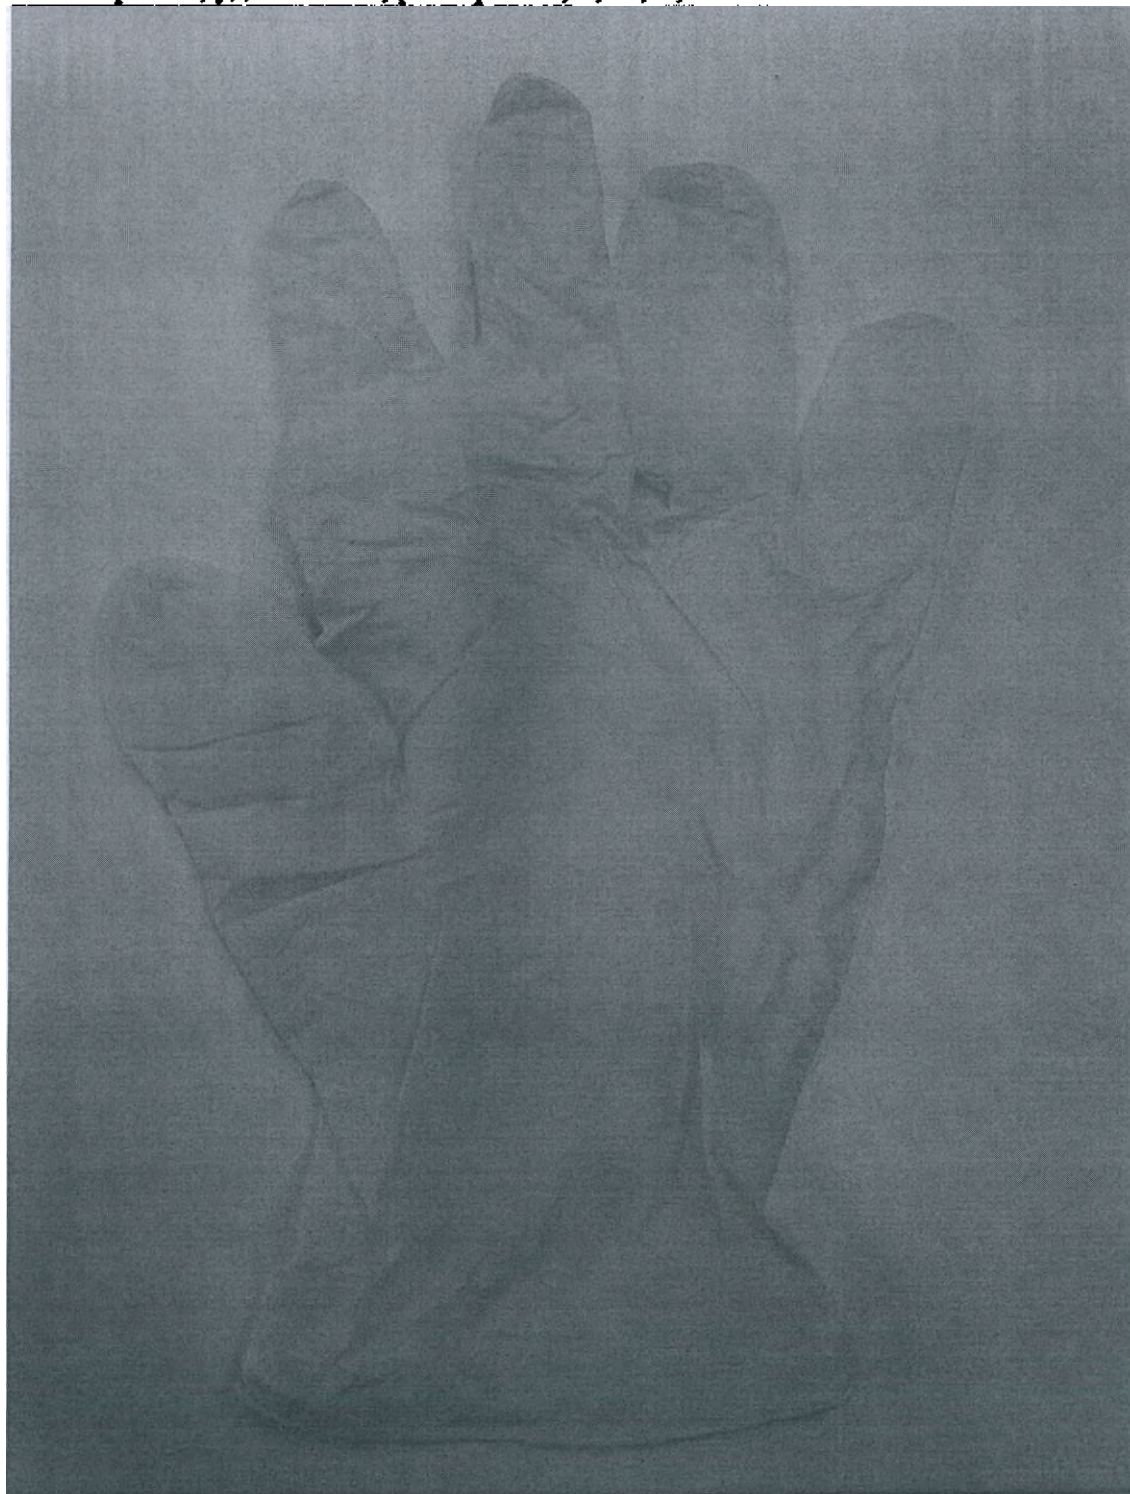

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
39

Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239

НЕОПУДРЕННЫЕ		ГЛАДКИЕ	☐	Цвет белый	☐	Размер: XS	☐
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☐					Размер: S	☐
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☒	Цвет бежевый	☒	Размер: M	☐
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					Размер: L	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☒					Размер: XL	☒
УДЛИНЕННЫЕ	☒						

LOT

1221003



02.02.2022

НЕТОКСИЧНО



Количество:

50 пар (1 пара – 2шт).



02.2025



Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию



Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»
123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, текстурированные, бежевого цвета, без покрытия, удлиненные, размеры XS, S, M, L, XL

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист

40

10. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, гладкие, белого цвета, без покрытия, размеры XS, S, M, L, XL

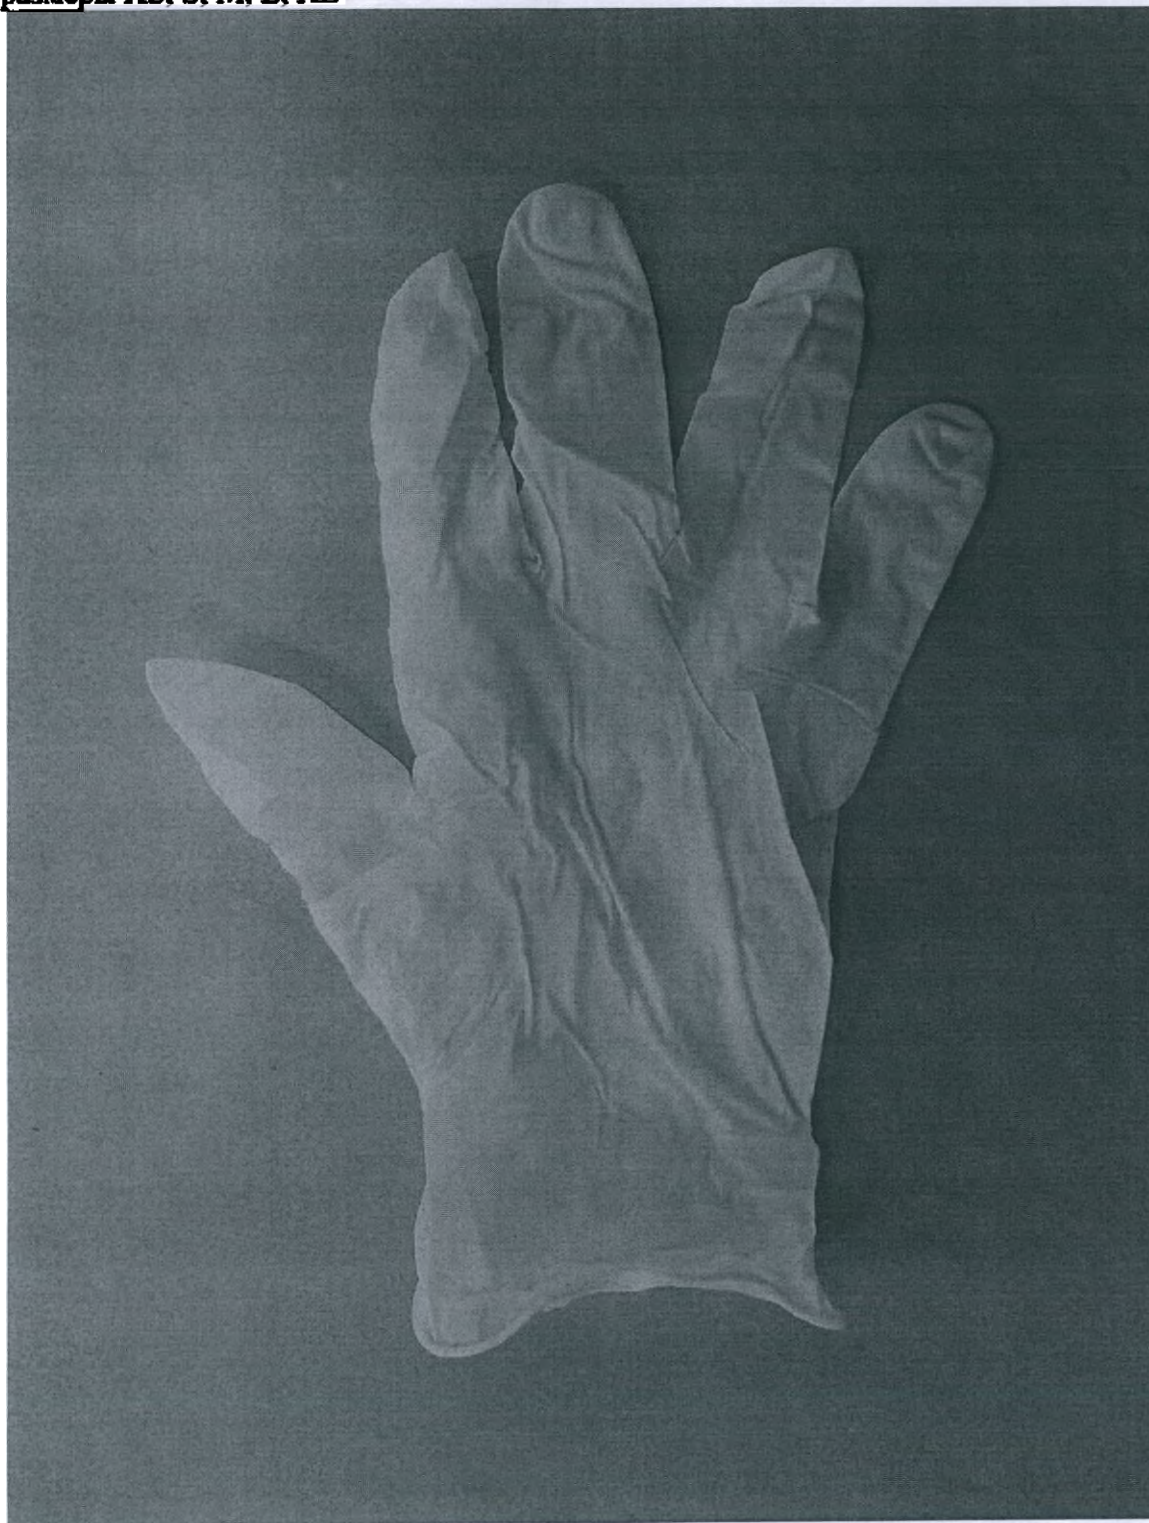

Изм. №	Полн. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Полн. и дата
ГОЛД.				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
41

Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239

НЕОПУДРЕННЫЕ		ГЛАДКИЕ	☒	Цвет белый	☒	Размер: XS	☐
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☐					Размер: S	☐
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐					Размер: M	☒
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					Размер: L	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☒					Размер: XL	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☐	Цвет бежевый	☐		

LOT

1221003



02.02.2022

НЕТОКСИЧНО



Количество:

50 пар (1 пара – 2 шт).



02.2025



Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию



Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»
123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, гладкие, белого цвета, без покрытия, размеры XS, S, M, L, XL

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист

42

11. Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, гладкие, бежевого цвета, без покрытия, размеры XS, S, M, L, XL

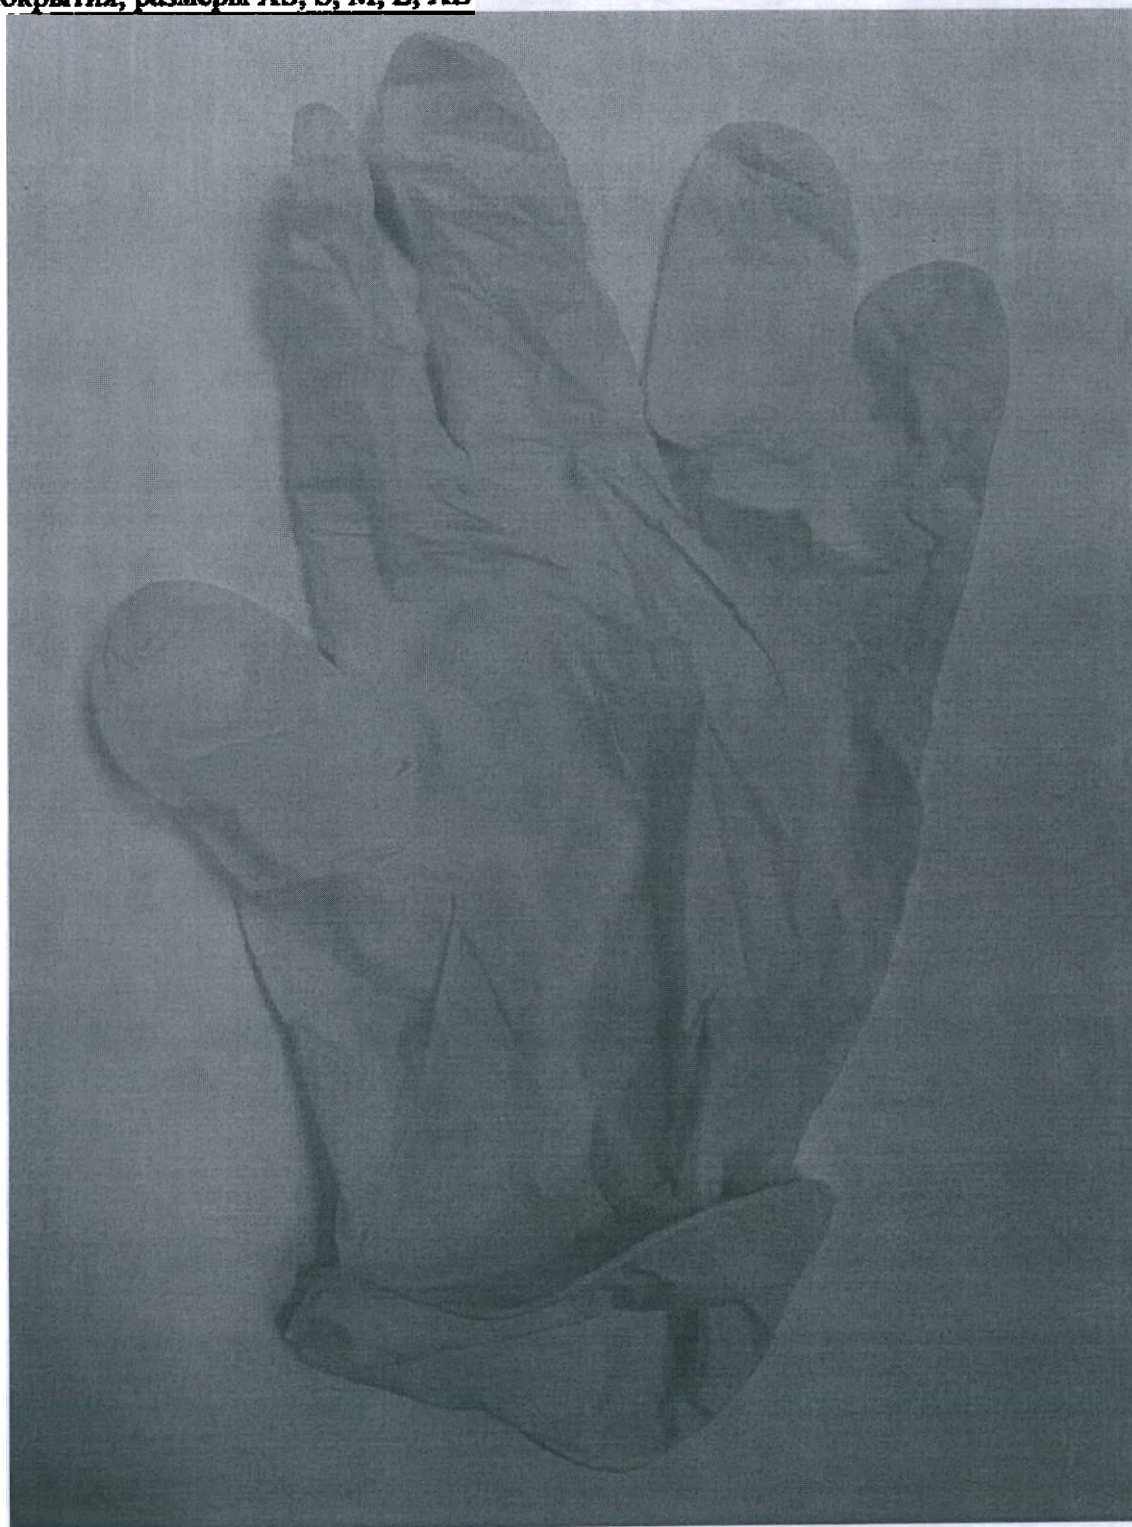

Ув. № подл.	Пол. и дата	Взам. инв. №	Исп. № лубл.	Пол. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
43

**Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239**

НЕОПУДРЕННЫЕ		ГЛАДКИЕ	☒	Цвет белый	☐	Размер: XS	☐
С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	☐					Размер: S	☒
ХЛОРИРОВАННЫЕ	☐	ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ	☐	Цвет бежевый	☒	Размер: M	☐
ДВУХКРАТНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ	☐					Размер: L	☐
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	☒					Размер: XL	☐
УДЛИНЕННЫЕ	☐						

LOT

1221003



02.02.2022

НЕТОКСИЧНО



Количество:

50 пар (1 пара – 2шт).



02.2025



Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б).

Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Изделие изготовлено из латекса натурального каучука, который может вызвать аллергическую реакцию



Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ»
123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

Регистрационное удостоверение:

Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы, гладкие, бежевого цвета, без покрытия, размеры XS, S, M, L, XL

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист

44

Фотографические изображения маркировки транспортной упаковки

Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003	ГОСТ Р 52239
	Общество с ограниченной ответственность «СОФТ.ЛИФТ» 123423, Москва г, улица Народного ополчения, д. 34, стр 2, офис 224 02.02.2022 02.2025 1221001
Условия хранения:	 
Условия транспортирования:	 
Число единиц групповой упаковки: 10 шт. Масса нетто: 420г Масса брутто: 430г Масса нетто групповой упаковки: 390г  	
Регистрационное удостоверение:	

Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003 ГОСТ Р 52239	
	Общество с ограниченной ответственностью «СОФТЛИФТ» 123423, Москва г, улица Народного ополчения, д 34, стр 2, офис 224 02.02.2022 02.2025 1221003
	Условия хранения:  
Условия транспортирования:	 
	Число единиц групповой упаковки: 10 шт. Масса нетто: 400 г Масса брутто: 430 г Масса нетто групповой упаковки: 500 г
 	
Регистрационное удостоверение:	

Перчатки медицинские диагностические нестерильные,
неопудренные, из натурального латекса, универсальной
формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001,
1221002, 1221003
ГОСТ Р 52239

Общество с ограниченной ответственностью
«СОФТЛИФТ» 123423, Москва г, улица
Народного ополчения, д. 34, стр.2, офис 224

02.02.2022
02.2025
1221002

Условия хранения:

Условия транспортирования:


Число единиц групповой упаковки: 10 шт.
Масса нетто: 429 г
Масса брутто: 435 г
Масса нетто групповой упаковки: 390 г

Регистрационное удостоверение:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные, из натурального латекса, универсальной формы по ТУ 22.19.60-001-06663635-2022, партия 1221001, 1221002, 1221003

ГОСТ Р 52239



Условия хранения:



Условия транспортирования:



Число единиц групповой упаковки: 10 шт.

Масса нетто: ~~422~~ г

Масса брутто: ~~435~~ г

Масса нетто групповой упаковки: ~~390~~ г





Регистрационное удостоверение:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 22.19.60-001-06663635-2022

Лист
45