

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
на медицинское изделие для in vitro диагностики:
**«Анализатор иммунофлуоресцентный Novatrend™ в вариантах
исполнения»**

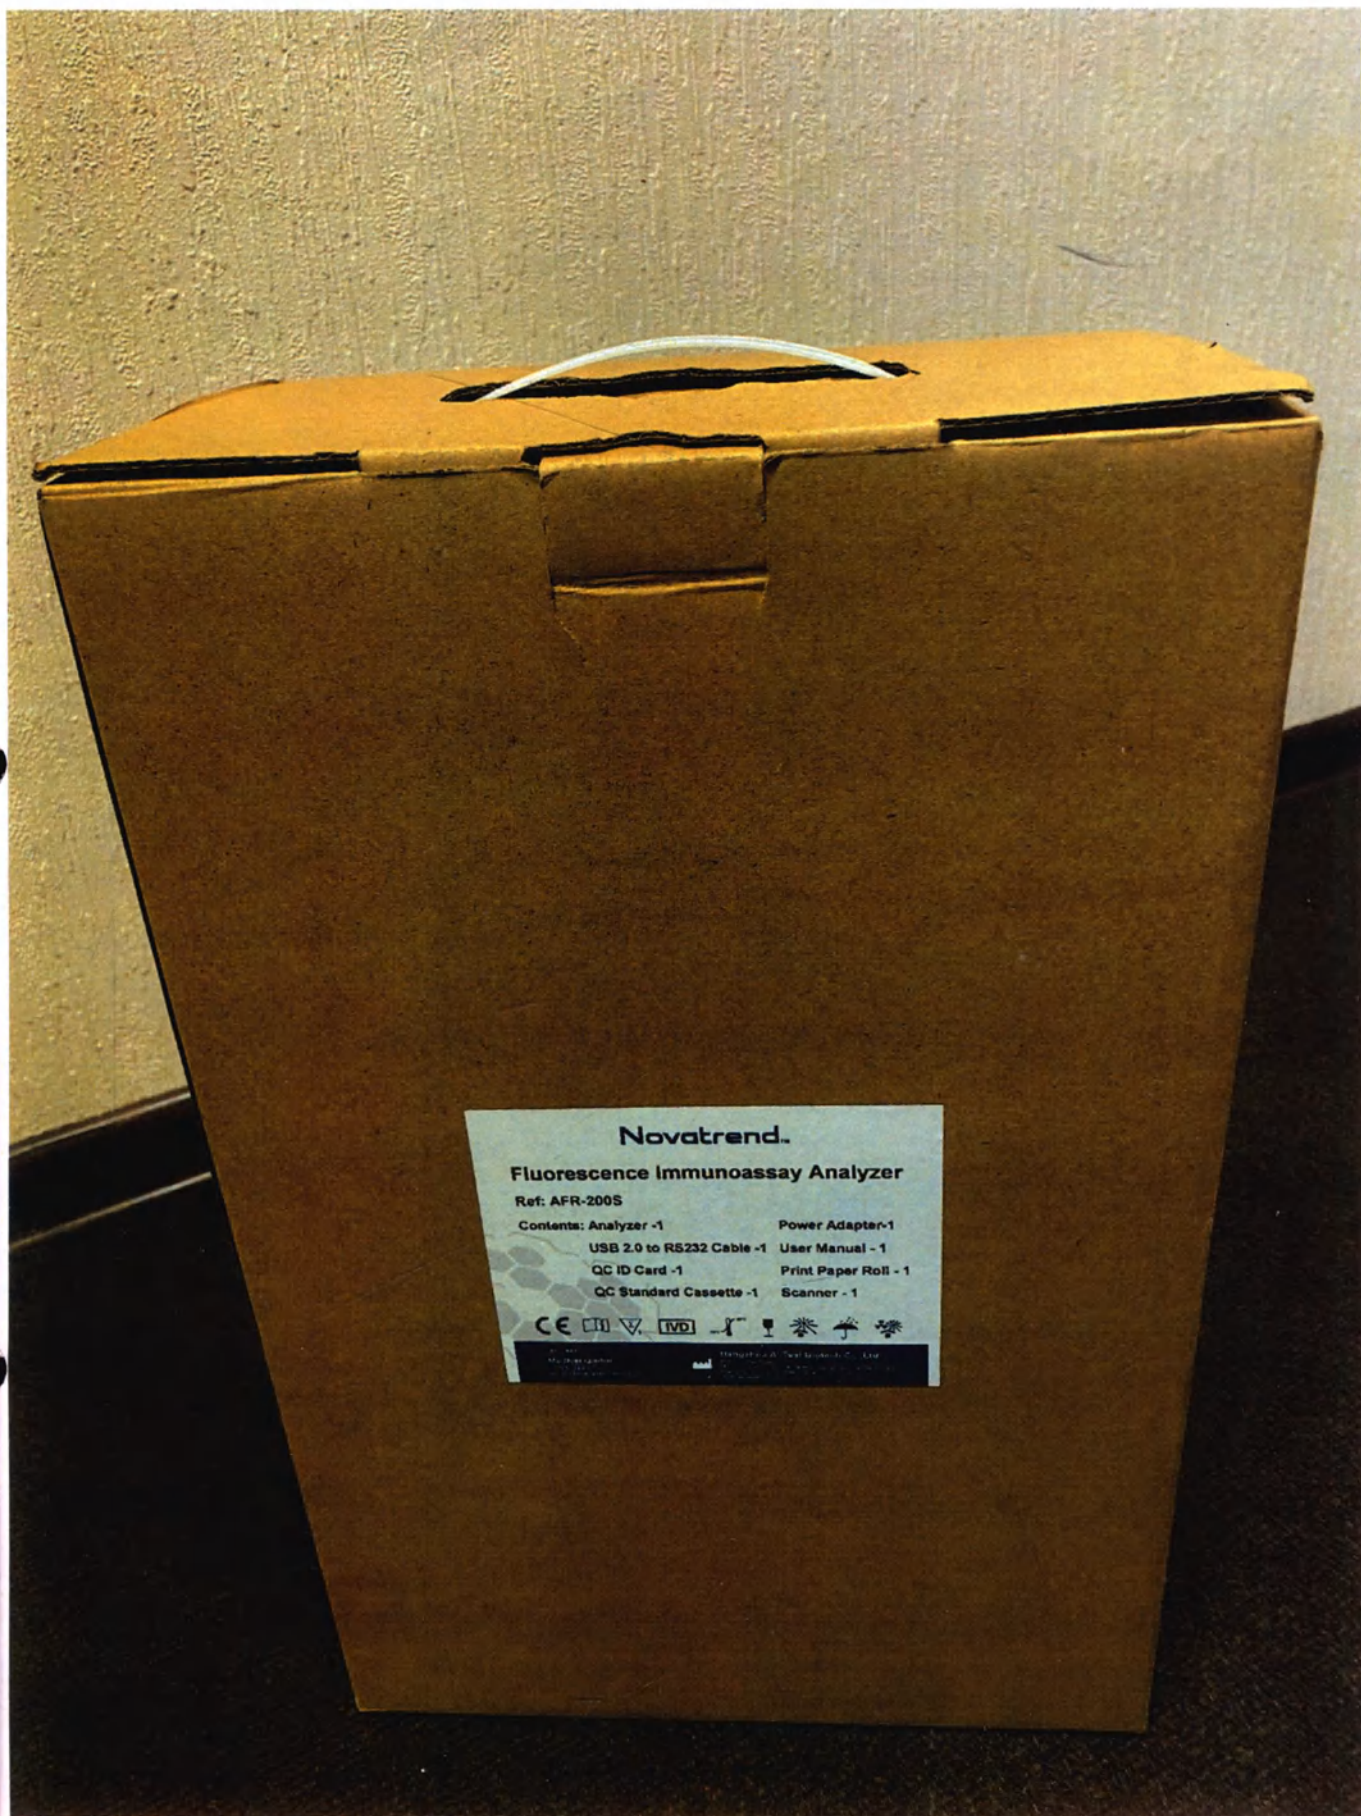


Рисунок 1. Потребительская упаковка

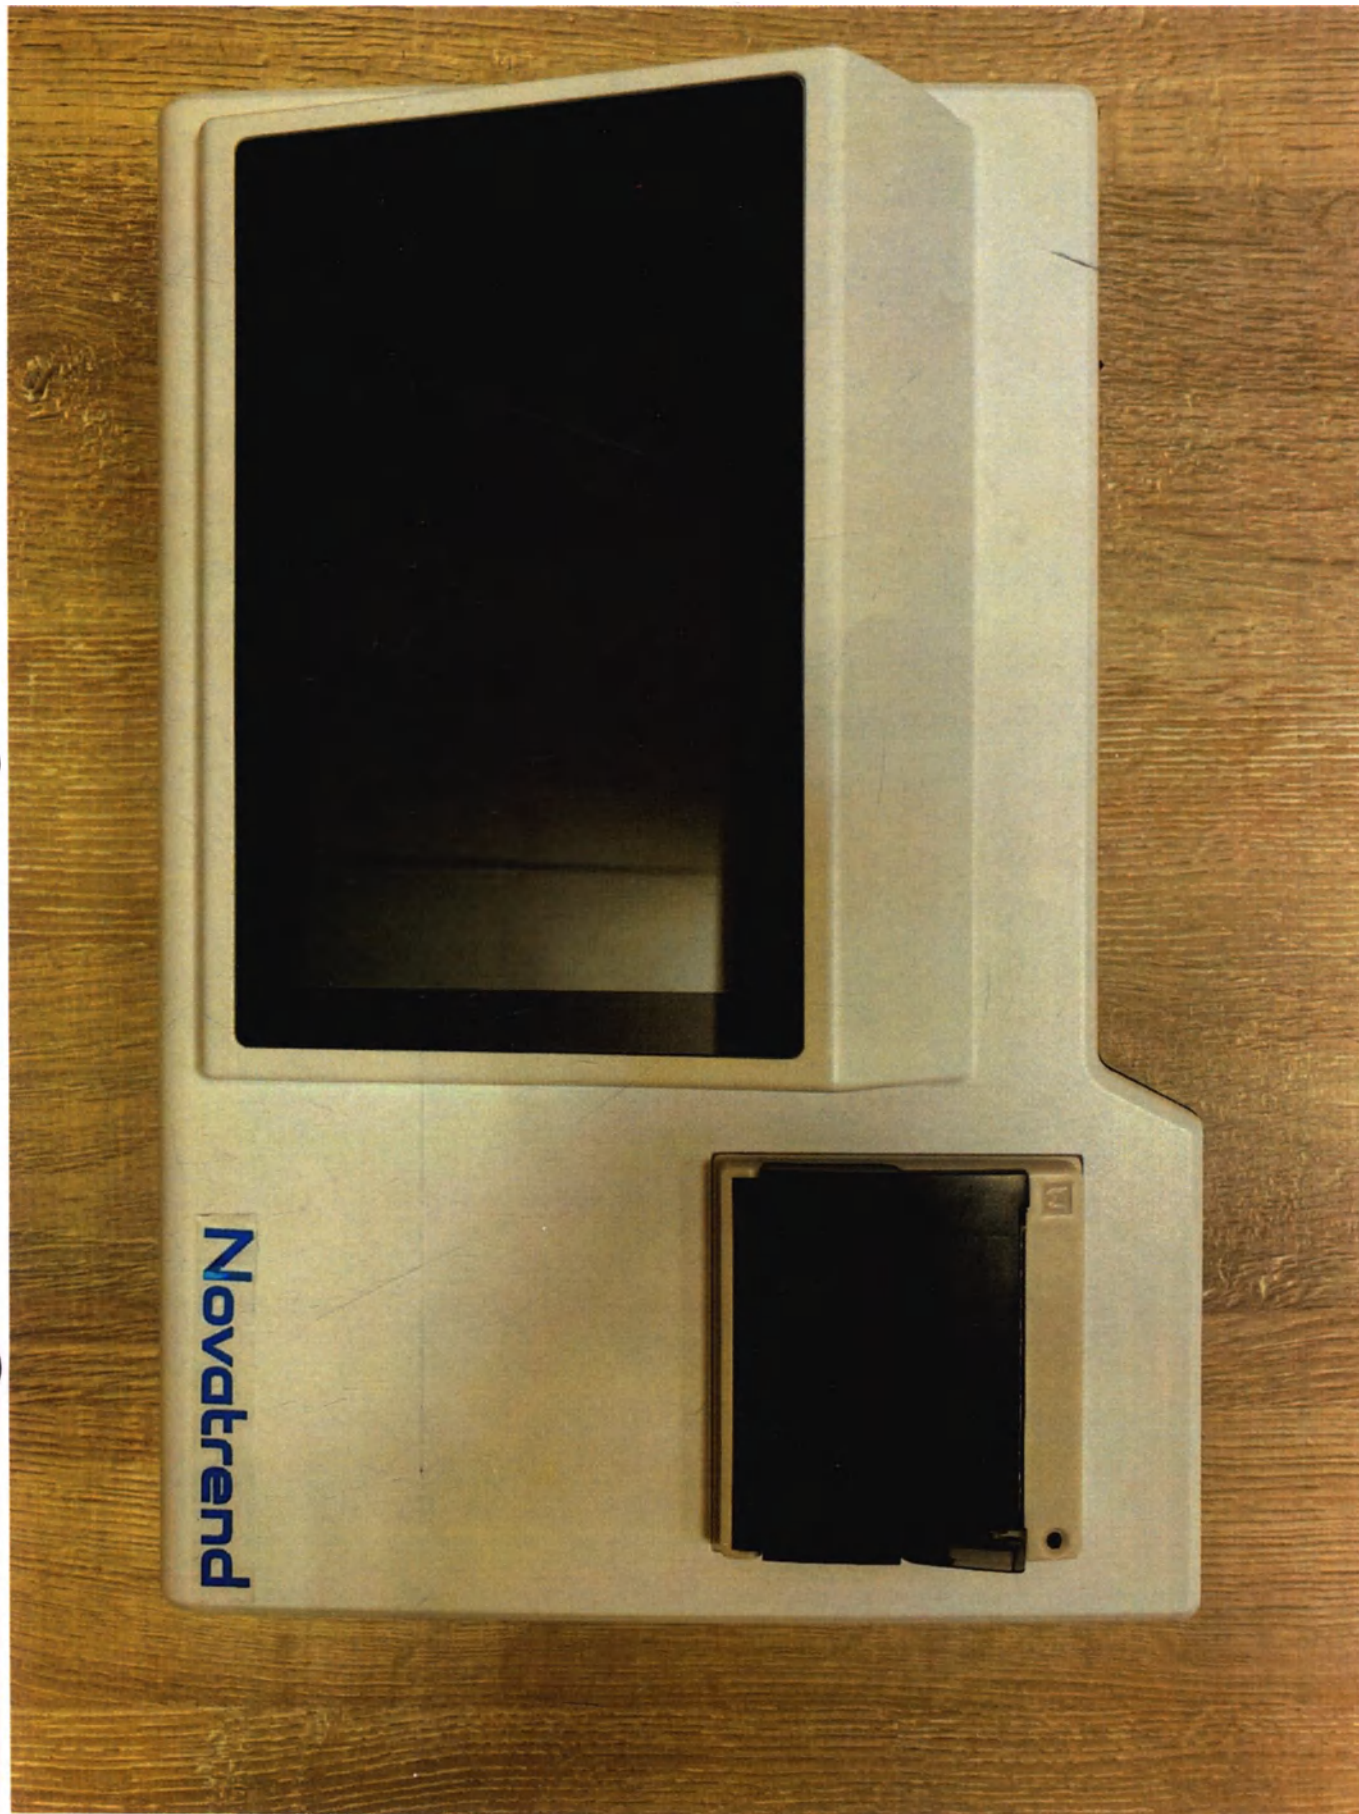


Рисунок 2. Экспресс - анализатор иммунофлуоресцентный Novatrend™(вид сверху)



Рисунок 3. Экспресс - анализатор иммунофлуоресцентный Novatrend™ (вид спереди)

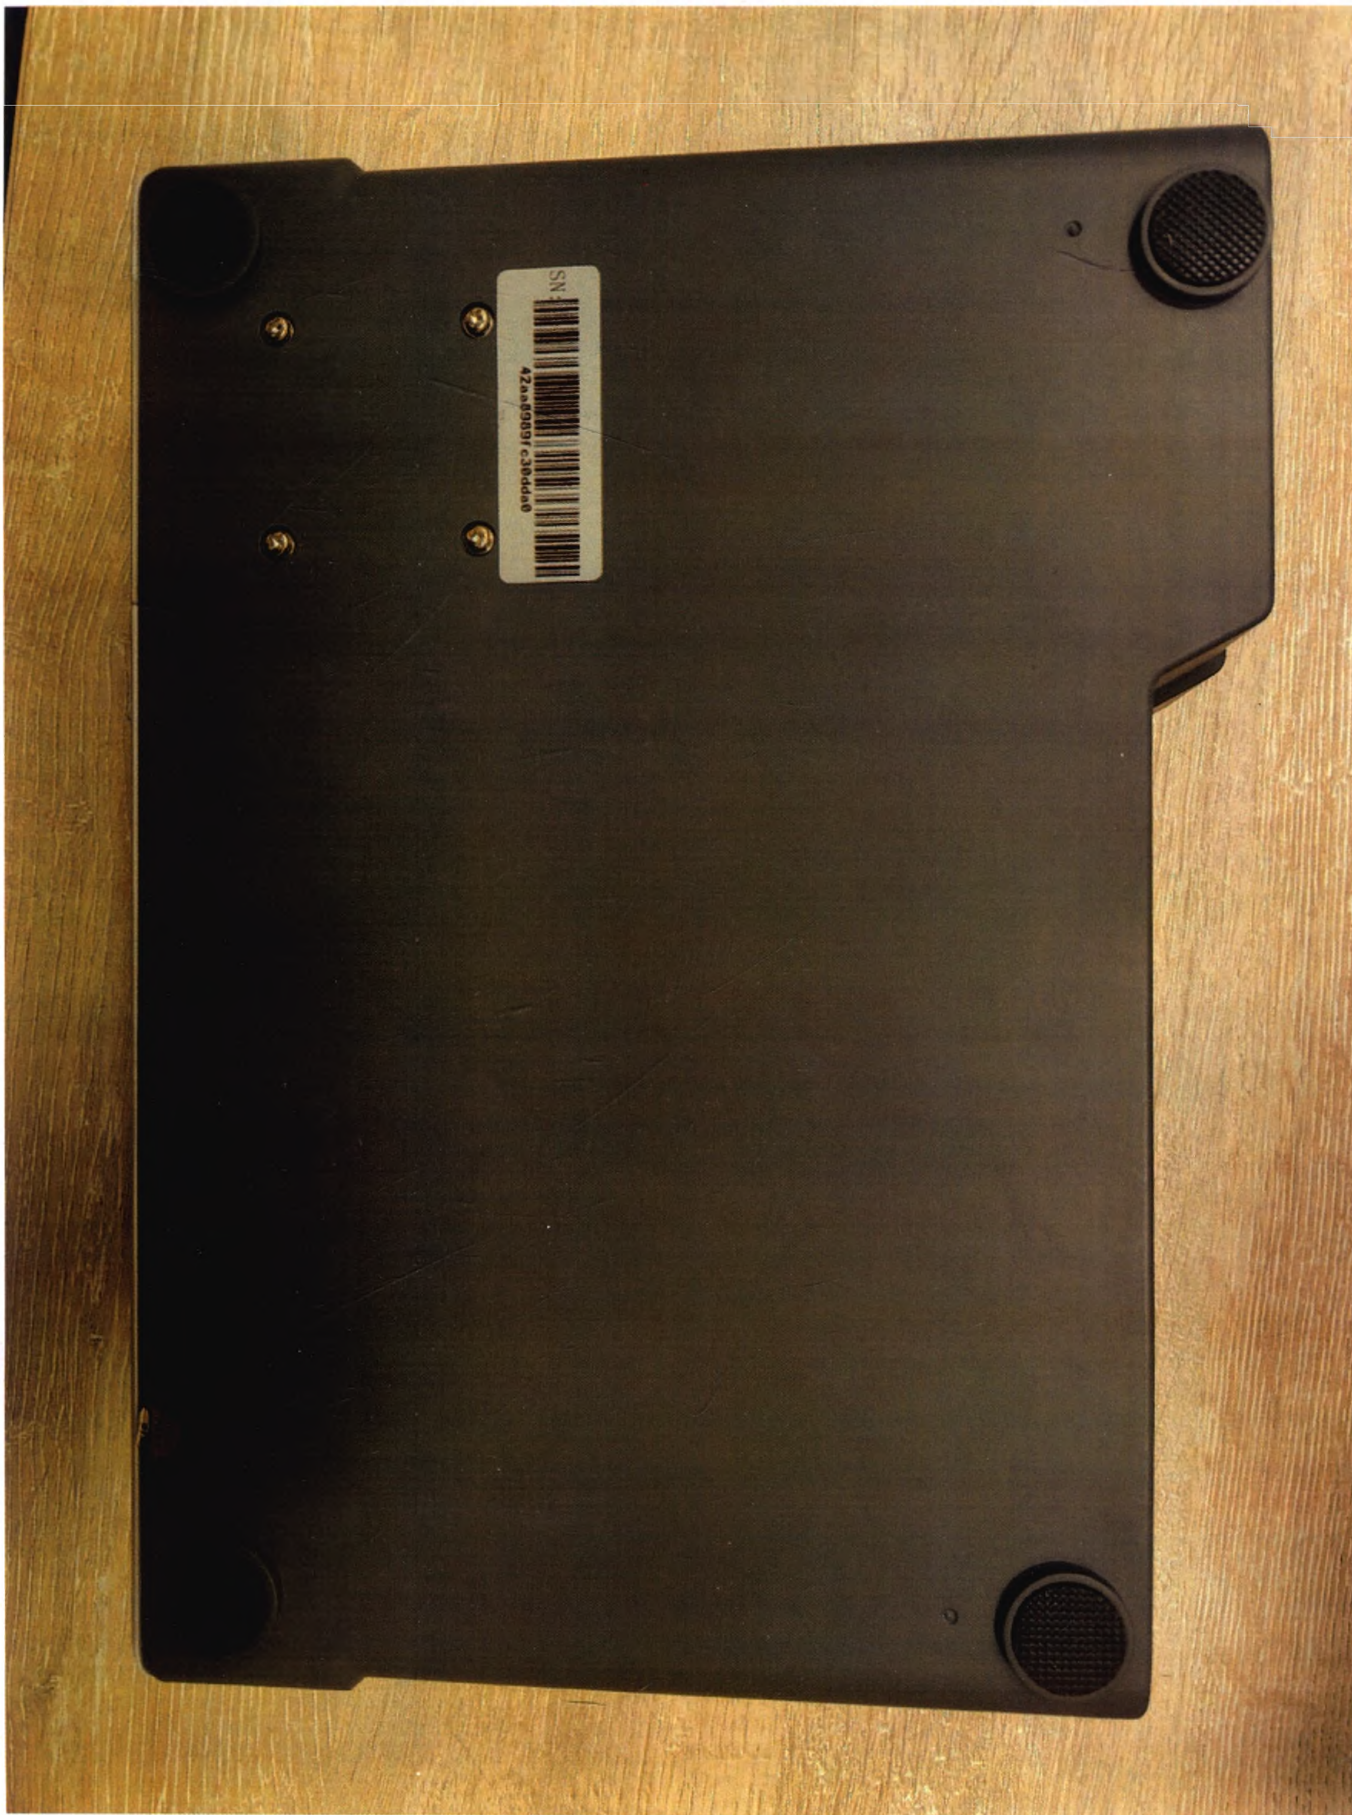


Рисунок 4. Экспресс - анализатор иммунофлуоресцентный Novatrend™ (вид снизу)



Fluorescence Immunoassay Analyzer

Model: AFR-200S

Input: 12V ---

Power: 48VA

Adapter Rate: 100 - 240V ~ 50 - 60Hz 1.5A MAX

Production Date: 2022-08 LOT ATAFR220078

Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.
8508, Yimai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltest.com.cn Email: info@alltest.com.cn

EC REP
MedNet GmbH
Berkstrasse 10
48163 Münster
Germany



Рисунок 5. Экспресс - анализатор иммунофлуоресцентный Novatrend™ (вид сбоку)



Рисунок 6. Экспресс - анализатор иммунофлуоресцентный Novatrend™ (вид сзади)

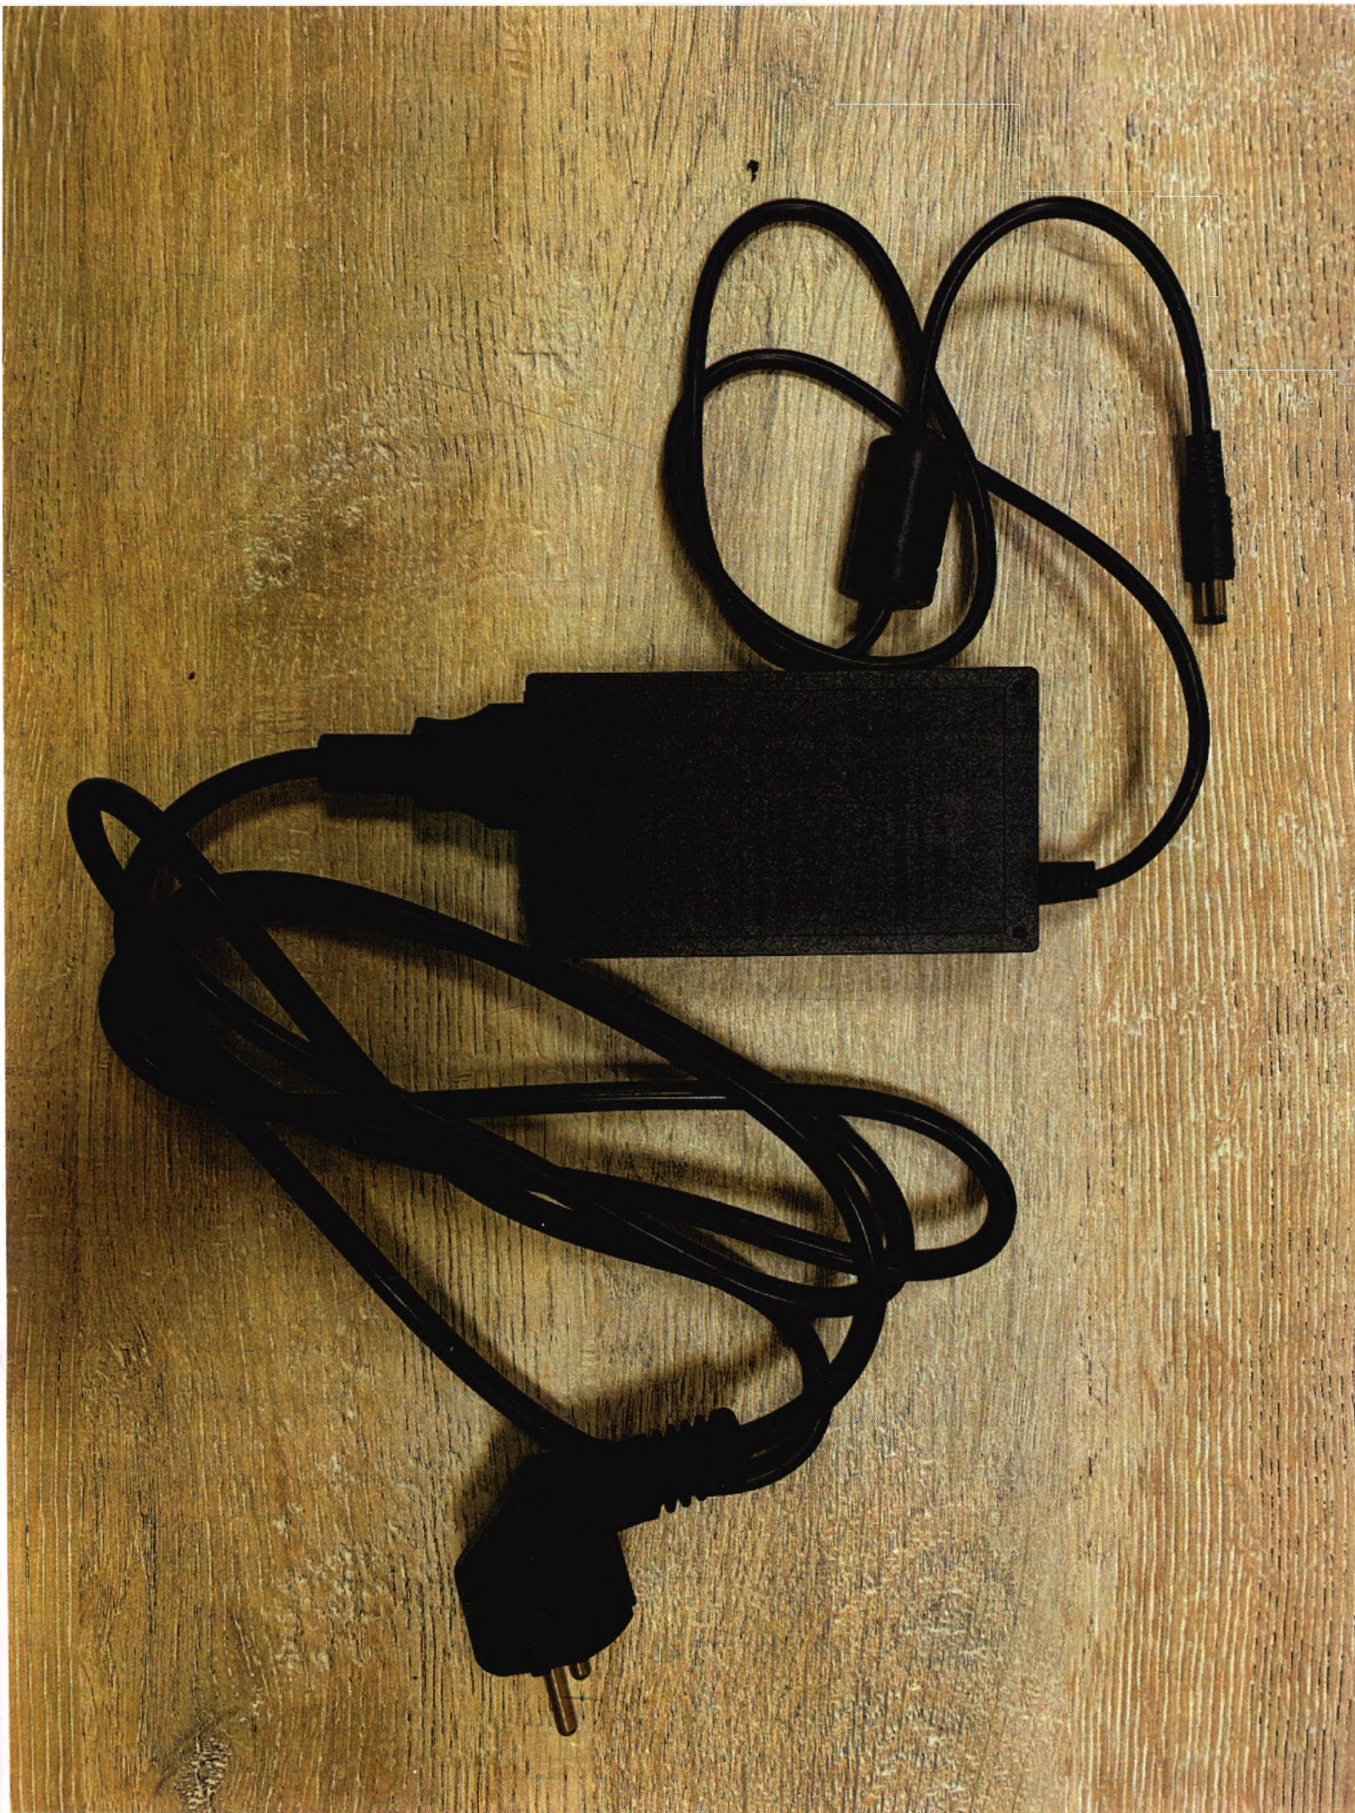


Рисунок 7. Адаптер питания

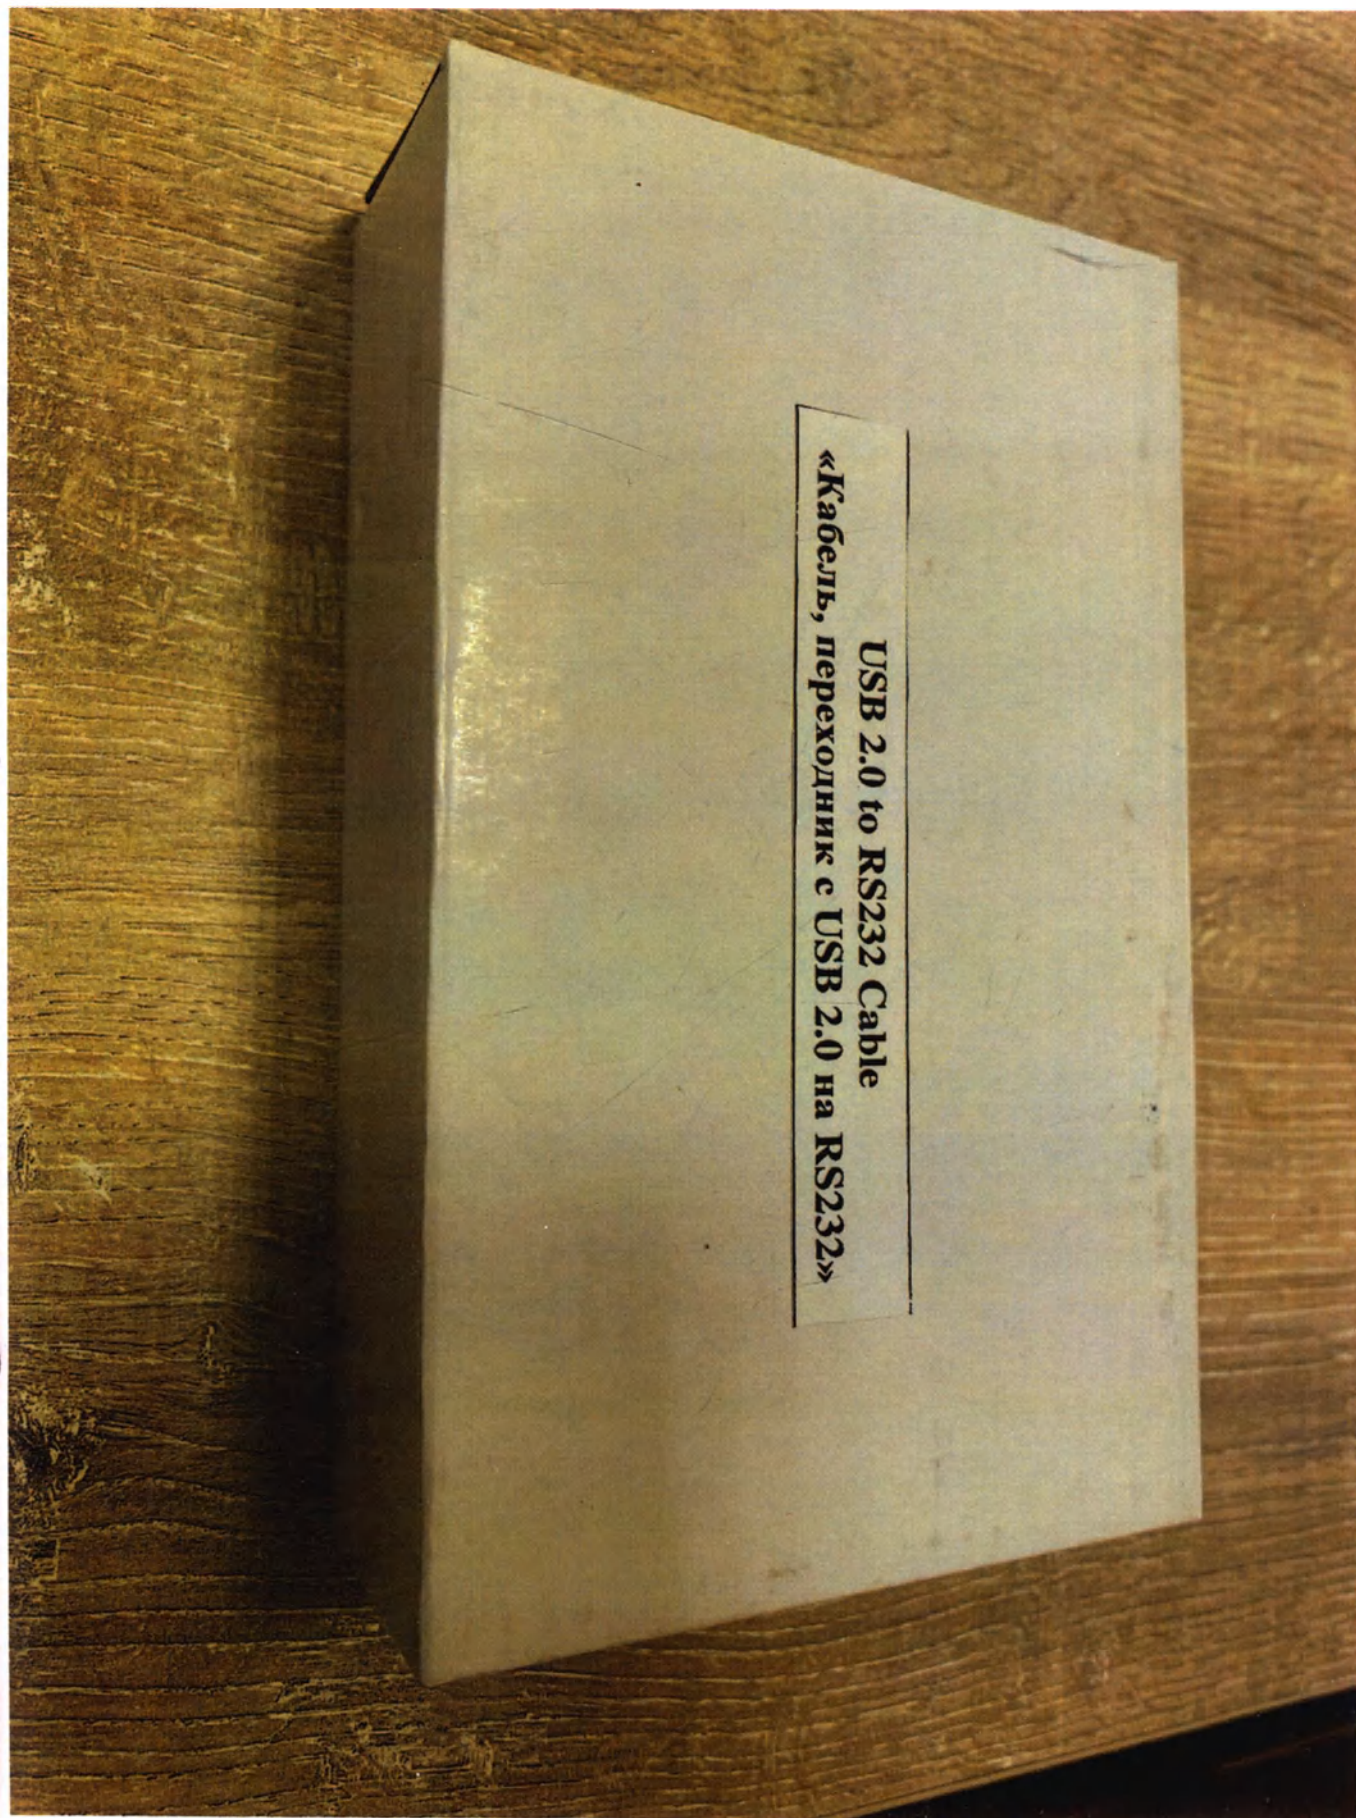


Рисунок 8. Индивидуальная упаковка «Кабель, переходник с USB 2.0 на RS232»



Рисунок 9. Кабель, переходник с USB 2.0 на RS232



Рисунок 10. Индивидуальная упаковка «Стандартная кассета контроля качества» и «Карта-идентификатор (ID-карта) контроля качества».

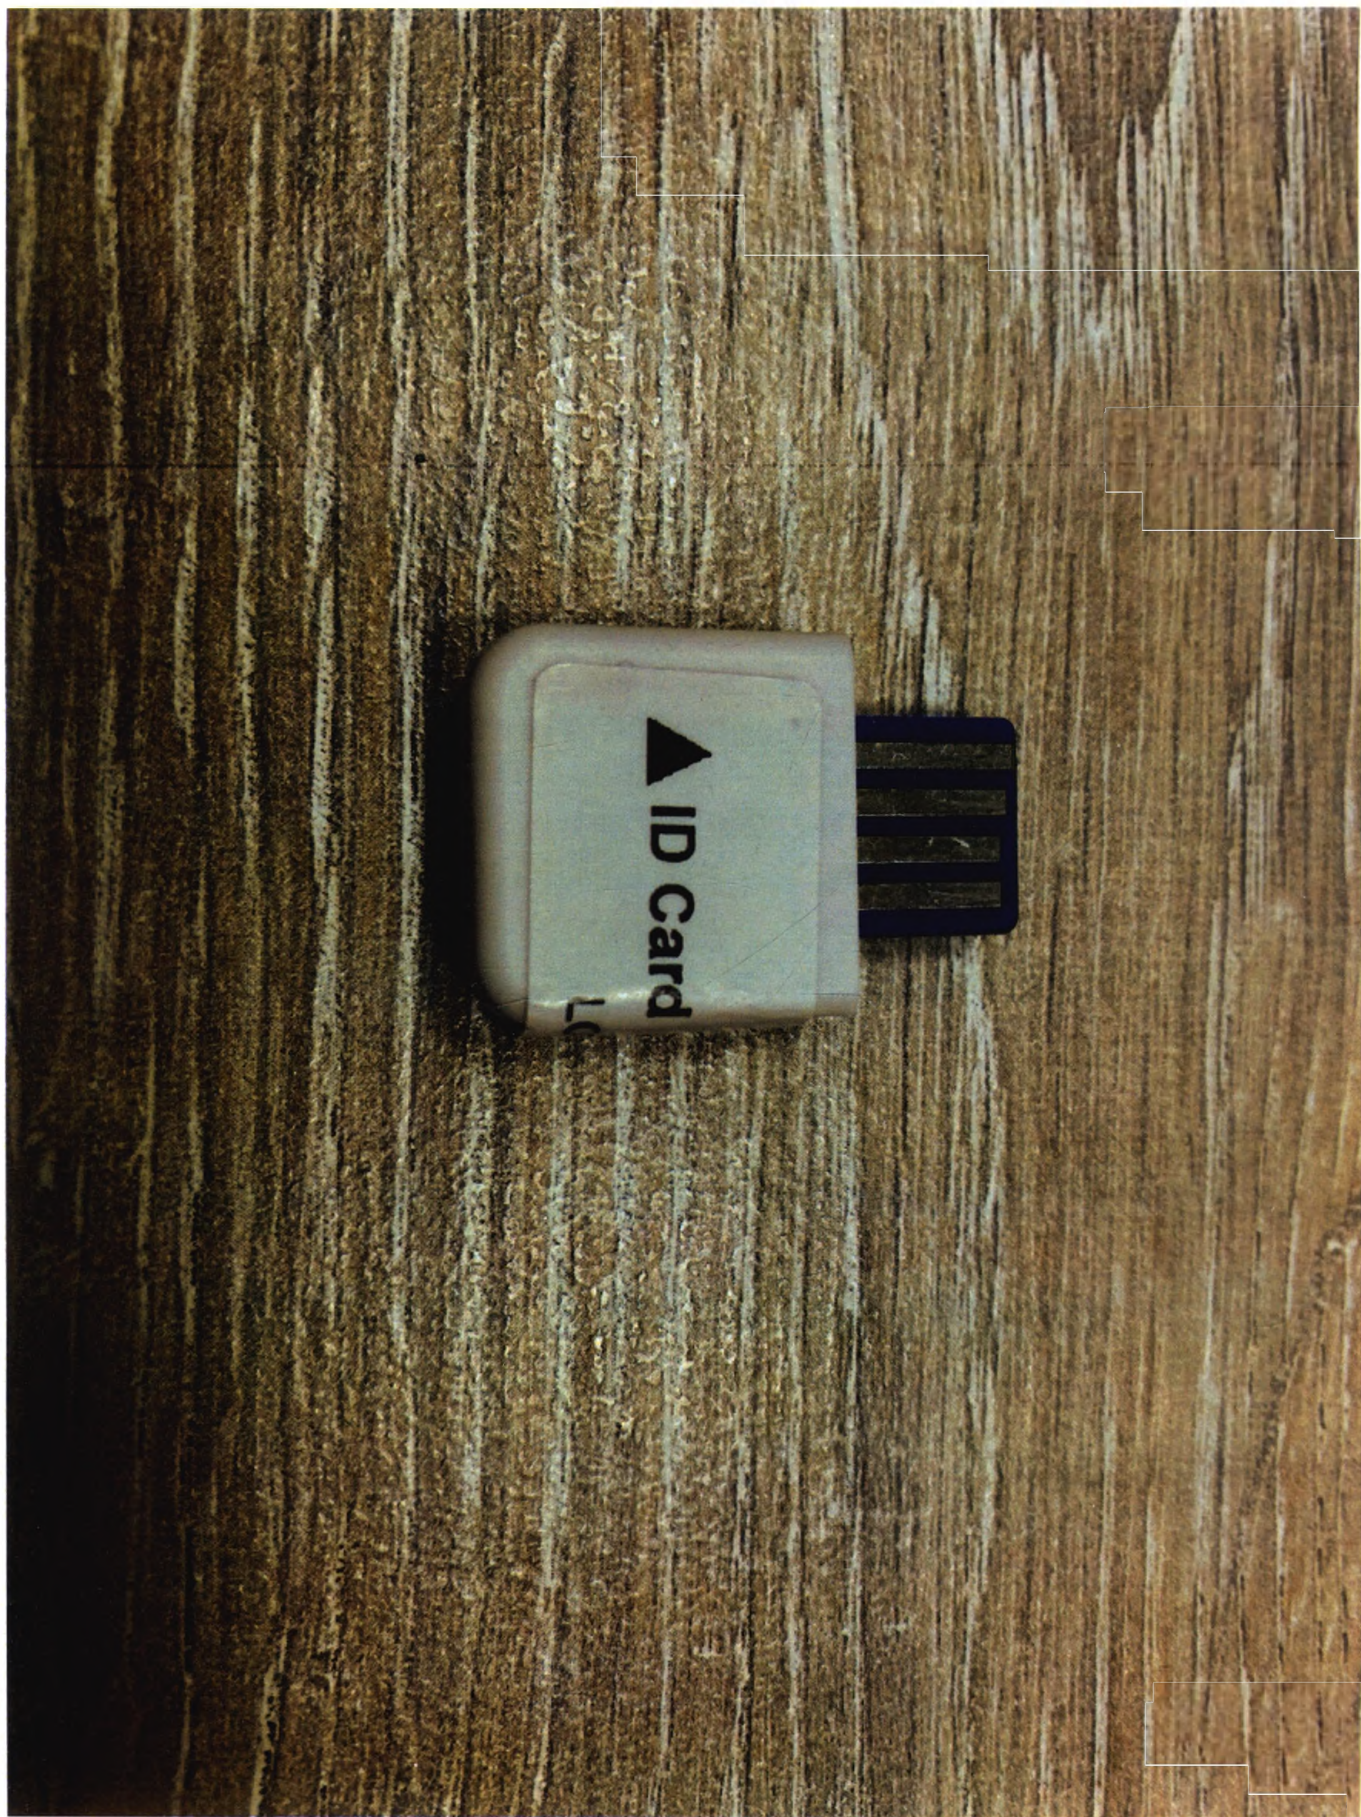


Рисунок 11. Карта-идентификатор (ID-карта) контроля качества (вид сверху)

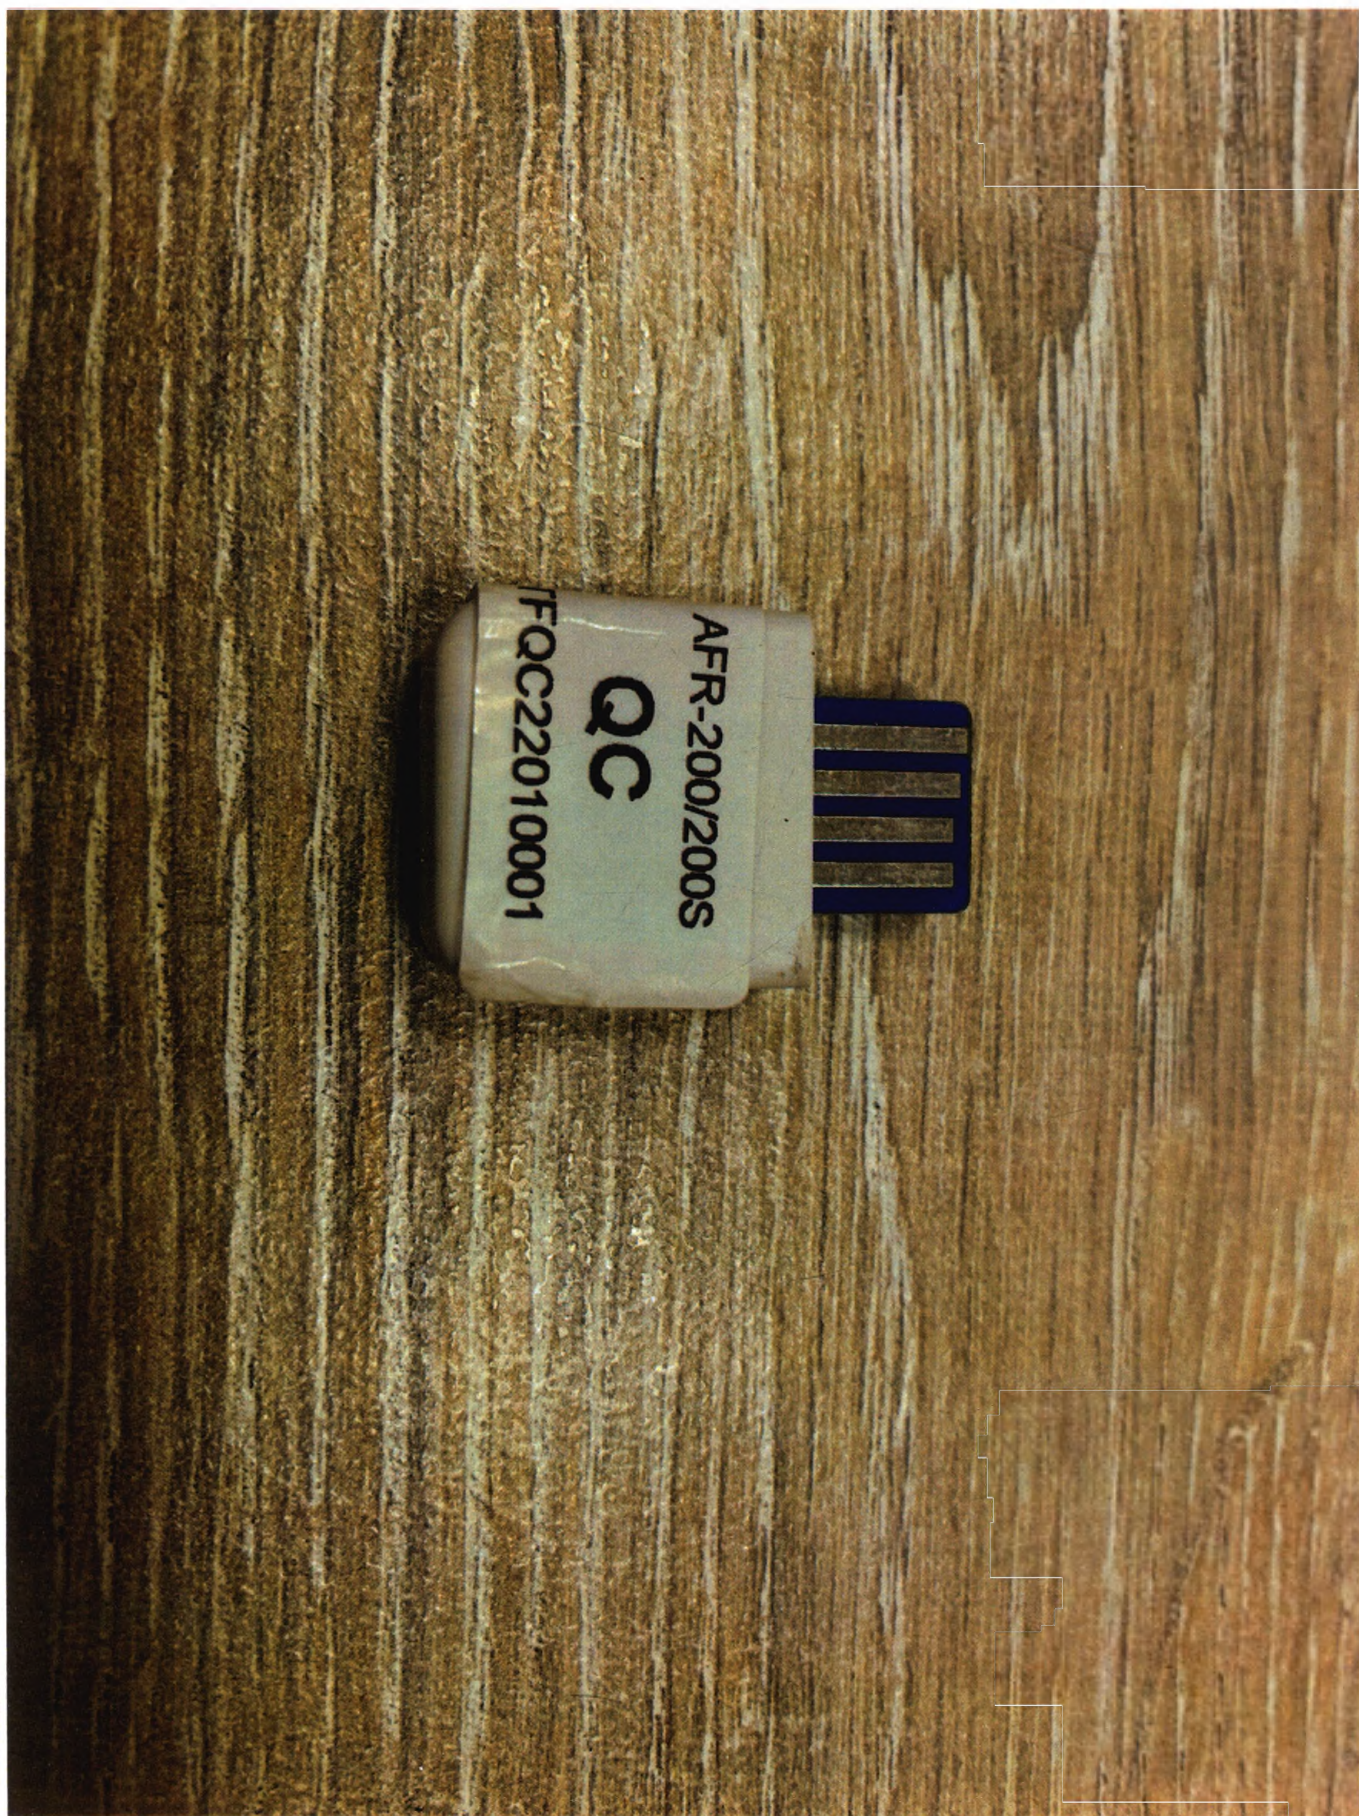


Рисунок 12. Карта-идентификатор (ID-карта) контроля качества (вид снизу)



Рисунок 13. Стандартная кассета контроля качества



Рисунок 14. Рулон печатной бумаги



Рисунок 15. Индивидуальная упаковка «Сканер штрих-кодов»



Рисунок 16. Сканер штрих-кодов (общий вид)



Рисунок 17. Сканер штрих-кодов (вид сбоку)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
К. ИЗНЕЦОВ А
ДИА А ВЕЛИБЕКОВНА



ПРОЧИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
18 ЛИСТОВ