

Контакты
Телефон:
+7 495 775-15-20(22)
Факс:
+7 495 +775-15-21
Email:
info.russia@draeger.com

Подтверждаю
Генеральный директор
ООО «Дрегер»
Харитонов А.А.



«17» января 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модели Savina 300 Select, Savina 300 Classic и Savina 300 NIV с принадлежностями»

ООО «Дрегер»
ОГРН 1027739271493
Адрес местонахождения:
107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12,
пом. LIII

Тел. +7 495 775-15-20(22)
Факс +7 495 775-15-21
www.draeger.ru

Адрес для корреспонденции
Основной офис:
Преображенская площадь, д. 8
Бизнес Центр ПРЕО8, блок «Б»,
12 этаж, Москва, Россия, 107061

Сервисный центр:
Электрозаводская ул., д. 33, стр. 4
Москва, Россия, 107076

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Morslinger Allee 53–55
23558 Lubeck, Germany
Почтовый адрес:
23542 Lubeck, Germany
Tel. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeck, Germany

Tel. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

info@draeger.com
www.draeger.com



Рисунок 1. Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Select (общий вид с тележкой для аппарата)



Рисунок 2. Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic (общий вид с тележкой для аппарата)



Рисунок 3. Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 NIV (общий вид с тележкой для аппарата компактной)



Рисунок 4. Шланг O2 для подключения к системе центрального газоснабжения



Рисунок 5. Датчик потока на примере датчика потока Spirolog



Рисунок 6. Датчик CO2 Savina 300



Рисунок 7. Кювета CO2 на примере кюветы CO2, для взрослых, многоразовой



Рисунок 8. Дыхательный контур на примере одноразового дыхательного контура серии Vent Set Coax



Рисунок 9. Дыхательный комплект VentStar на примере дыхательного комплекта VentStar с двойным подогревом, включая камеру увлажнителя с подогревателем шлангов вдоха и выдоха



Рисунок 10. Одноразовый дыхательный контур F&P, включая камеру увлажнителя, для взрослых (RT 212)



Рисунок 11. Маска на примере маски для неинвазивной вентиляции NovaStar с креплением на голову для масок для неинвазивной вентиляции и магнитными фиксаторами для крепления на голову маски



Рисунок 12. Увлажнитель F&P MR 850



Рисунок 13. Увлажнитель F&P MR 810

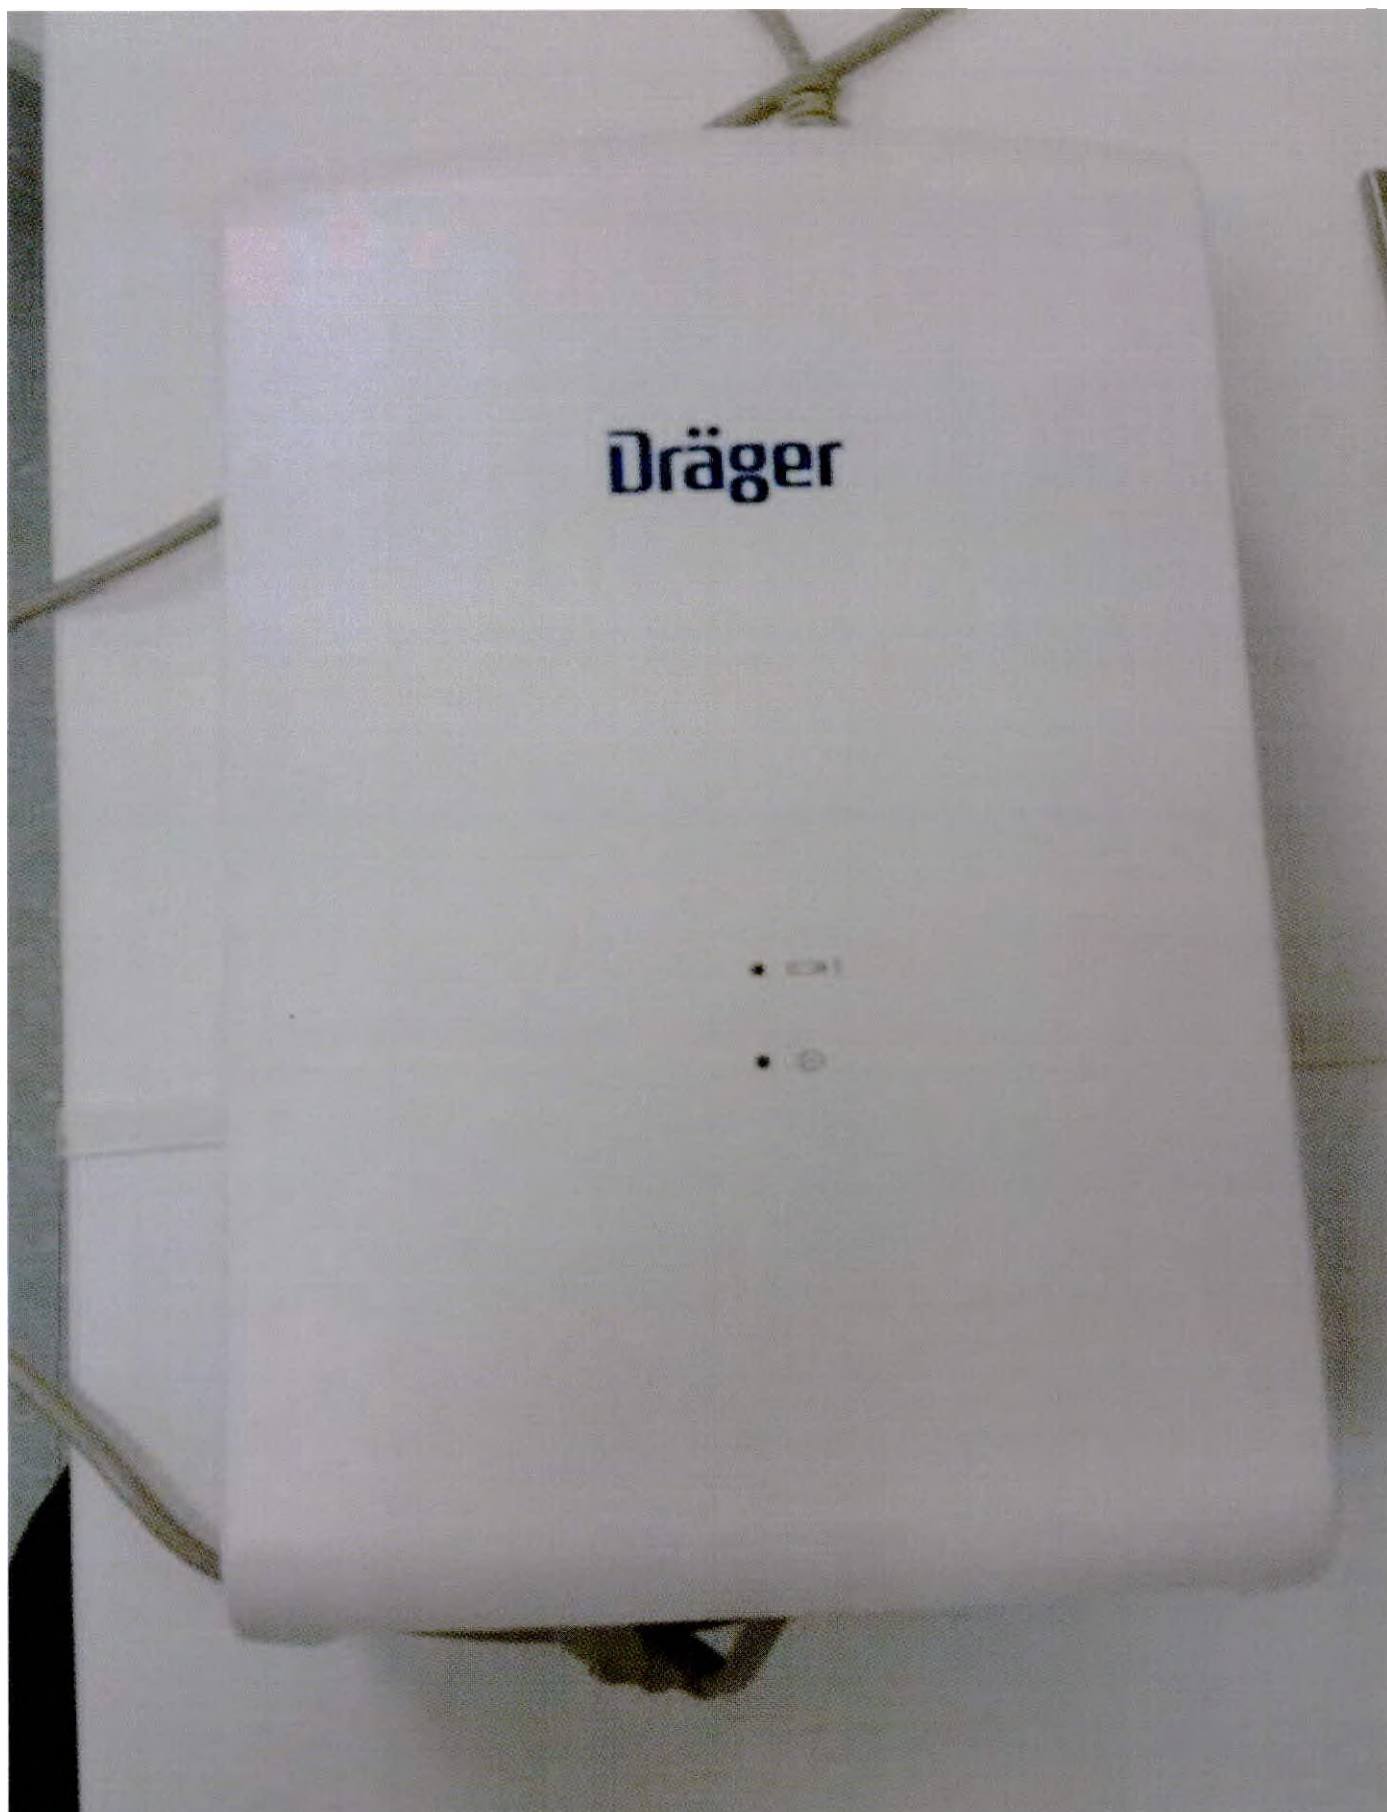


Рисунок 14. Комплект внешних батарей, состоящий из
батарейного отсека и 2 батарей



Рисунок 15. Тележка TSU для транспортировки баллонов с держателем баллона для тележки аппарата

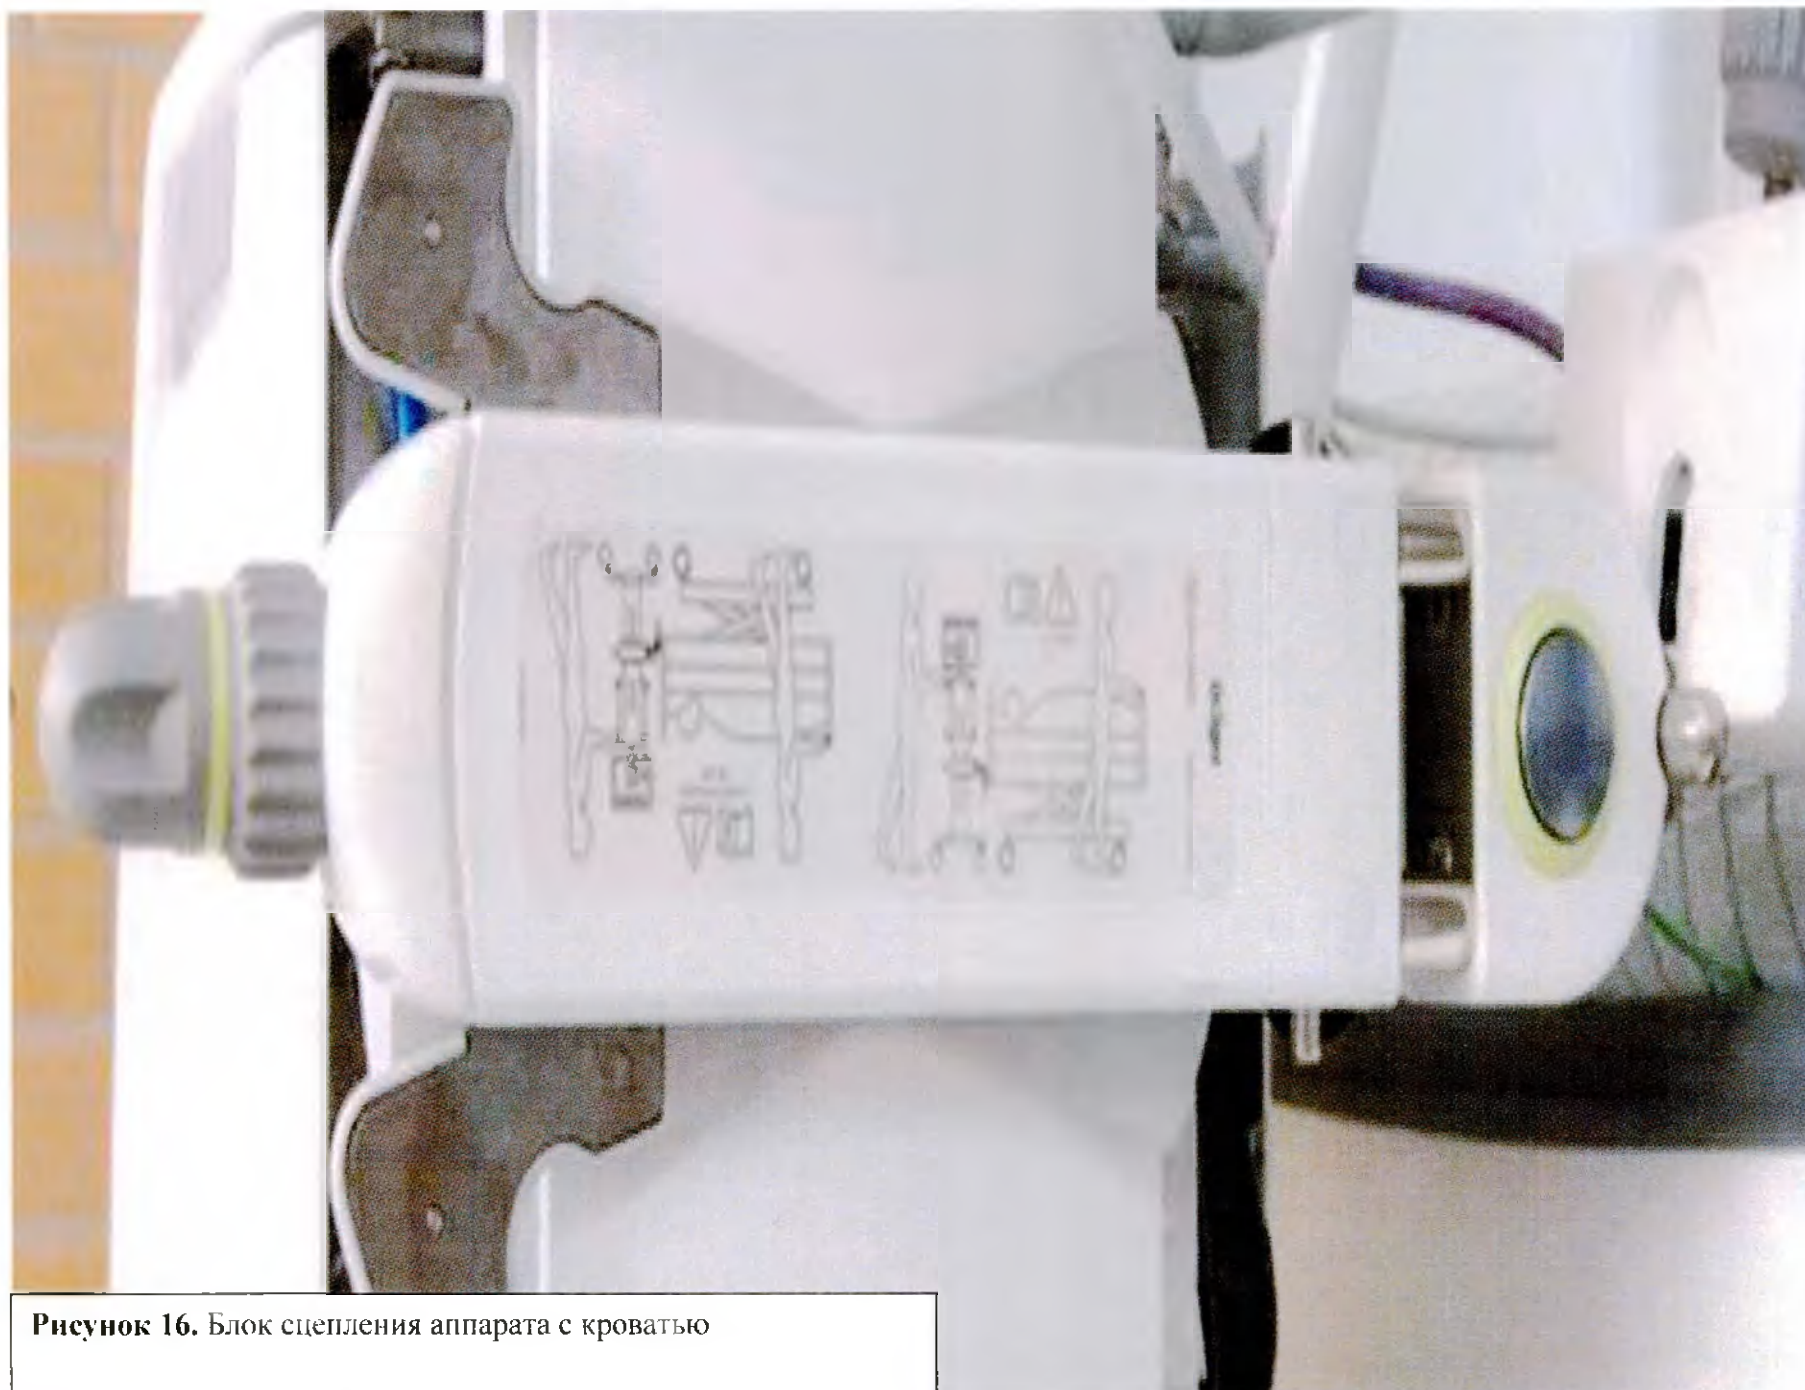


Рисунок 16. Блок сцепления аппарата с кроватью



Рисунок 17. Зажим для блока сцепления со стороны кровати



Рисунок 18. Удлинительный шланг 7,50 м для LPO



Рисунок 19. Поворотный кронштейн для поддержки дыхательных шлангов



Рисунок 20. Держатель шлангов для поворотного кронштейна



Рисунок 21. Держатель Y-тройника для поворотного кронштейна



Рисунок 22. Держатель шлангов (одинарный или двойной) на примере держателя шлангов одинарного

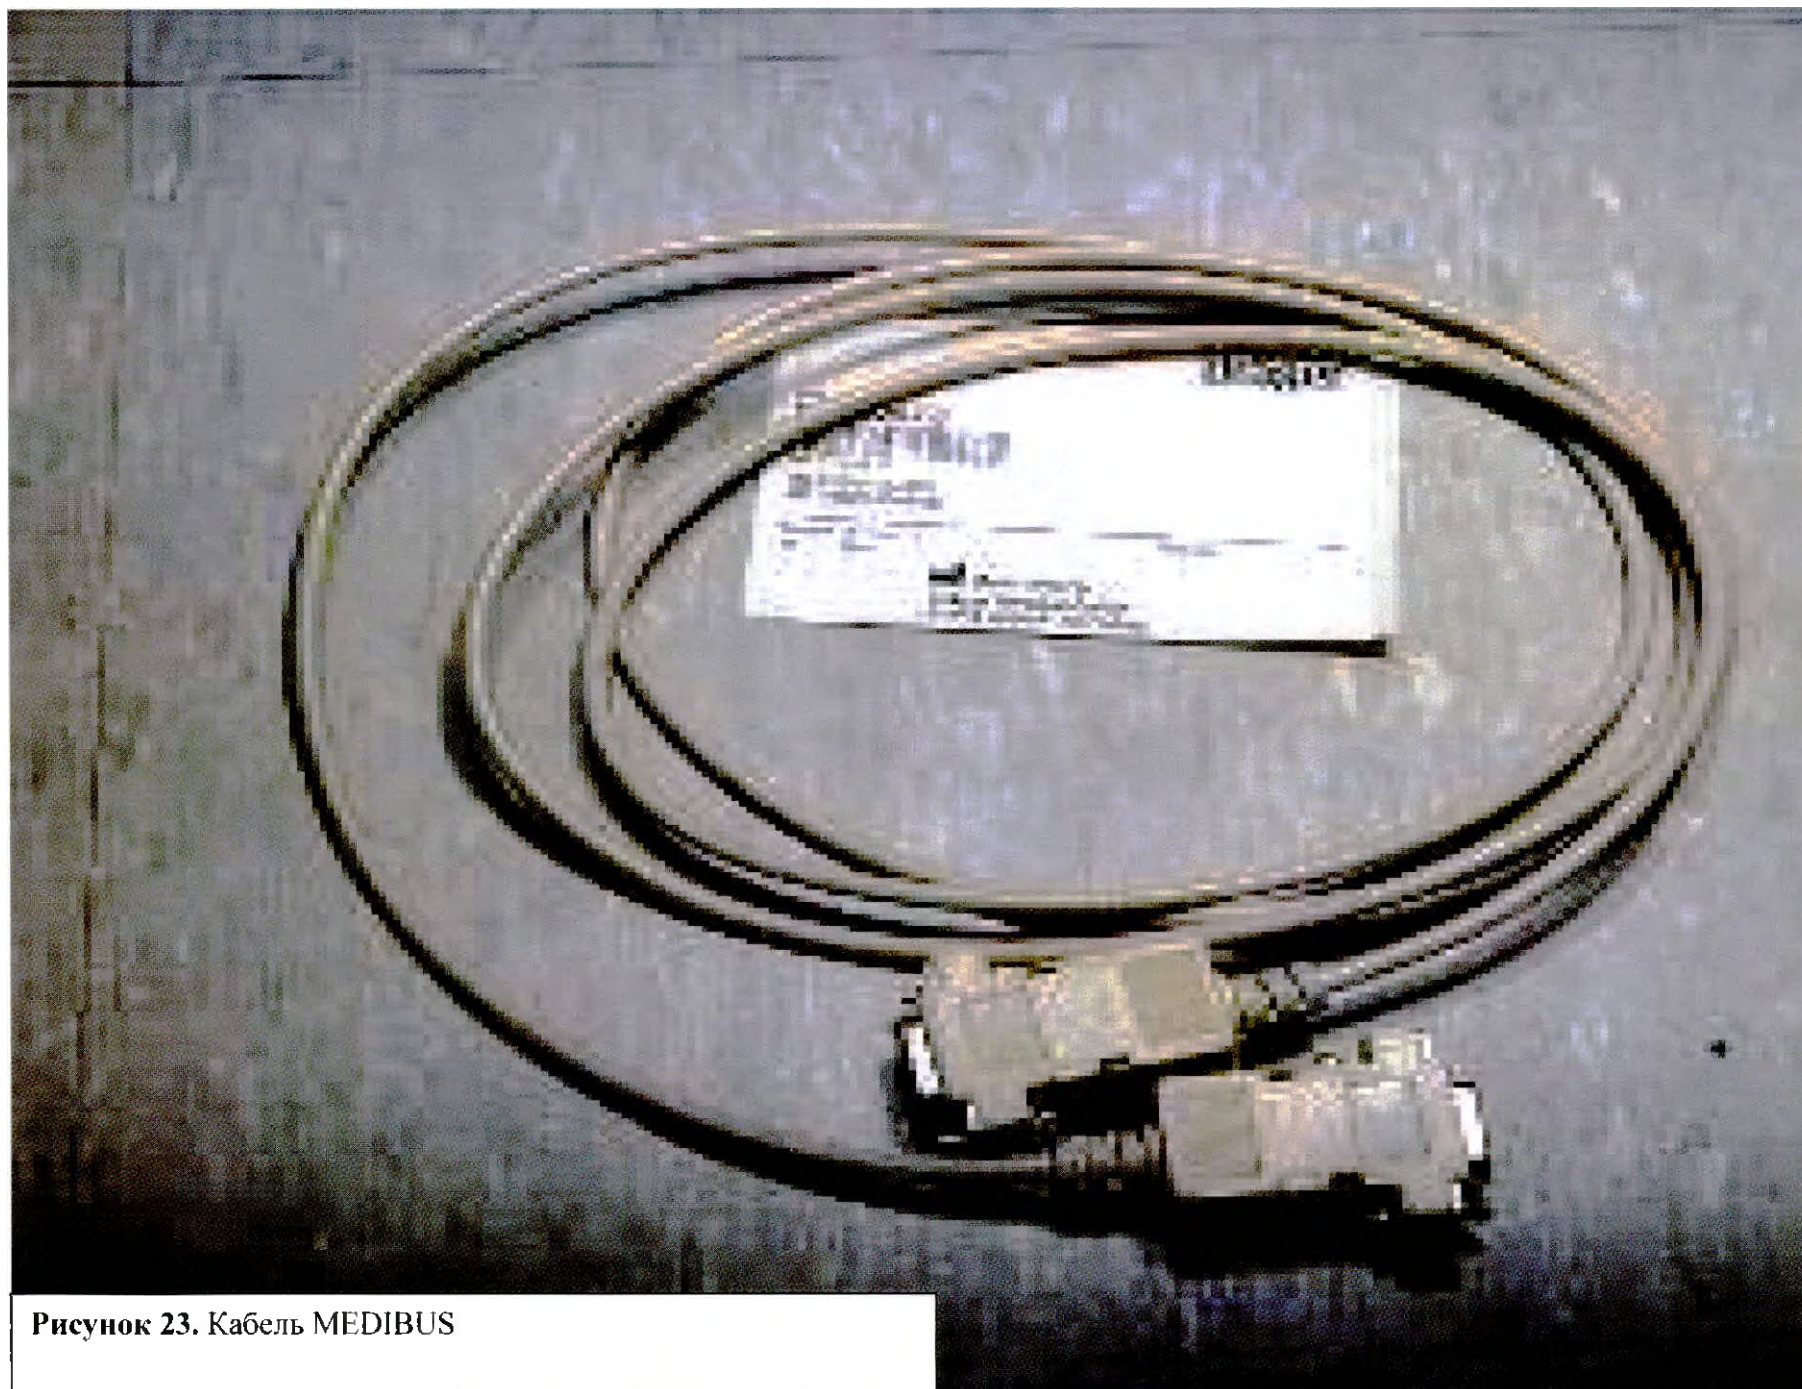


Рисунок 23. Кабель MEDIBUS



Рисунок 24. Клапан выдоха, многофункциональный, для взрослых и детей



Рисунок 25. Запасная диафрагма для многоразового клапана
выдоха



Рисунок 26. Клапан выдоха, одноразовый, для взрослых и детей



Рисунок 27. Микрофильтр (фильтр воздухозабора)



Рисунок 28. Противопылевой фильтр



Рисунок 29. Парковочный держатель для датчика CO2



Рисунок 30. Влагосборник для дыхательного контура, для новорожденных и детей



Рисунок 31. Фильтр TwinStar на примере фильтра TwinStar 90



Рисунок 32. Фильтр SafeStar на примере фильтра SafeStar 80



Рисунок 33. Фильтр CareStar на примере фильтра CareStar 30



Рисунок 34. Соединительная кислородная линия, одноразовая



Рисунок 35. Коннектор, внутренний диаметр 22 мм, одноразовый



Рисунок 36. Упаковка одноразовых принадлежностей для вентиляции легких Pack2Go



Рисунок 37. Редуктор давления для использования с баллонами



Рисунок 38. Зажим для крепления увлажнителя



Рисунок 39. Поворотный держатель увлажнителя для тележки



Рисунок 40. Камера увлажнителя F&P MR 340



Рисунок 41. Камера увлажнителя F&P MR 370

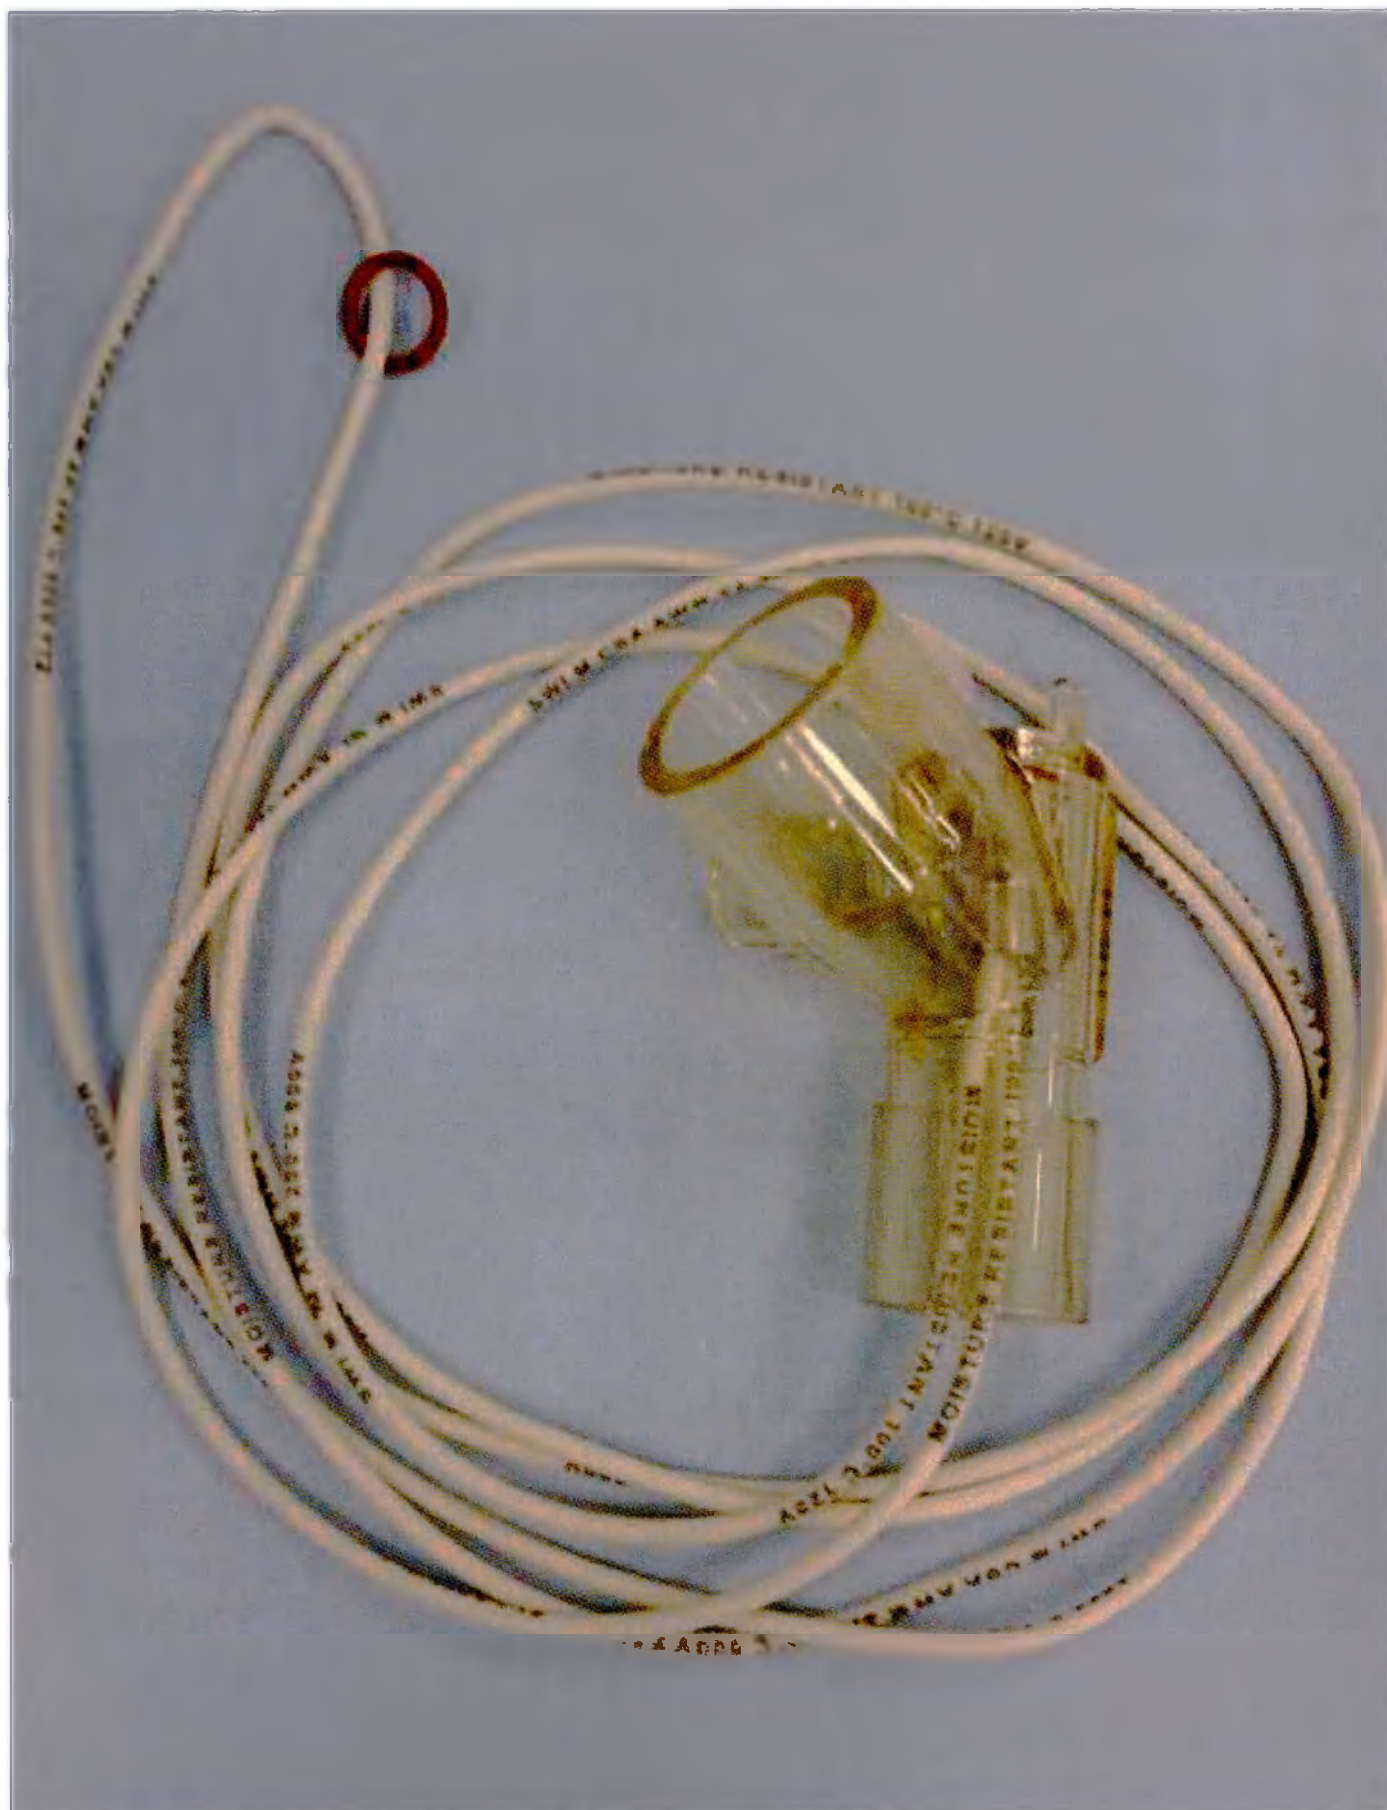


Рисунок 42. Нагреватель шлангов F&P для дыхательных контуров на примере нагревателя шлангов F&P для дыхательных контуров для взрослых

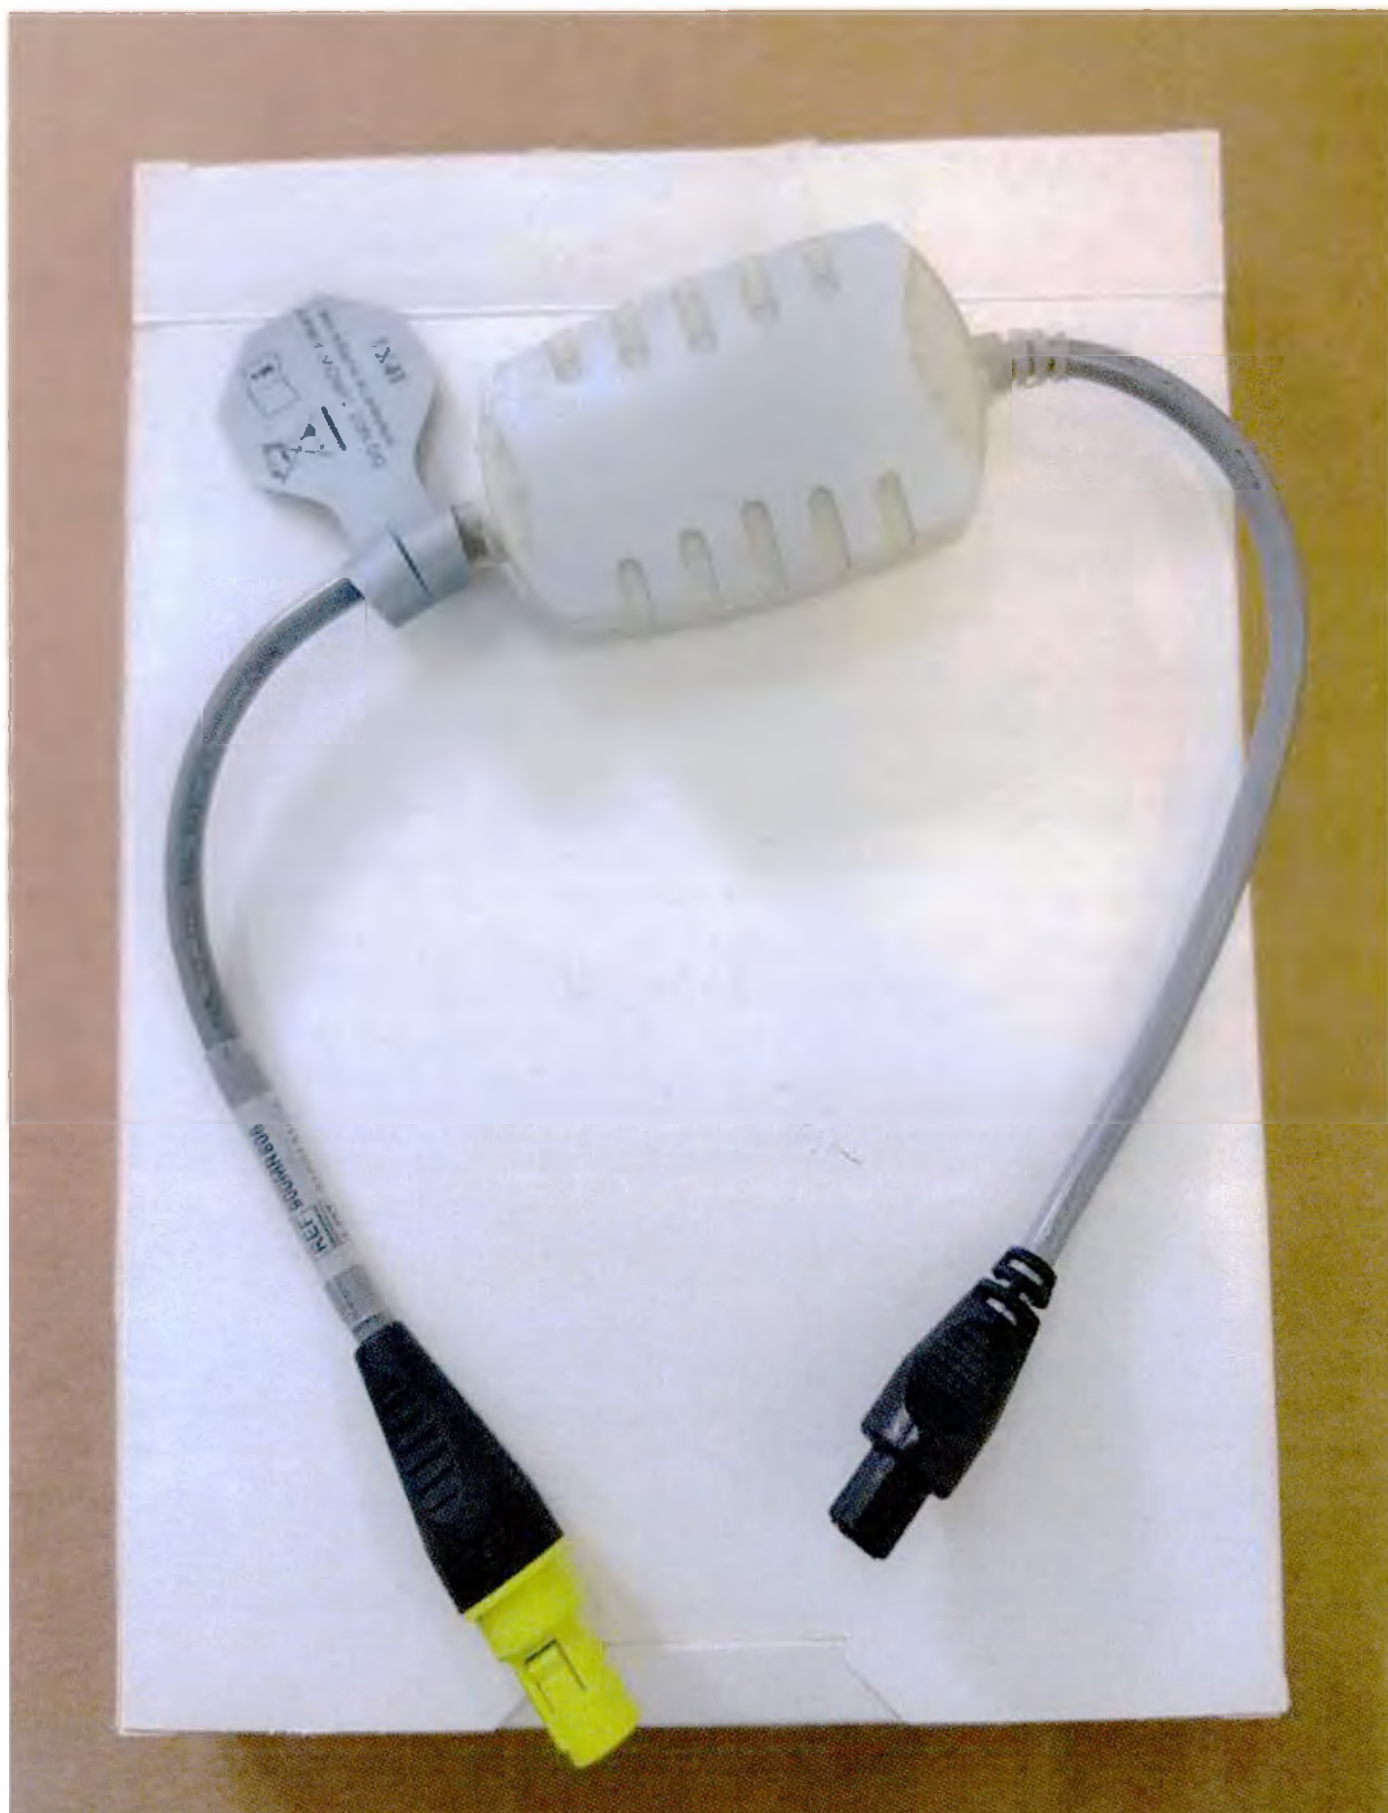


Рисунок 43. Адаптер обогревателя шлангов для дыхательных контуров Drager, для взрослых и детей

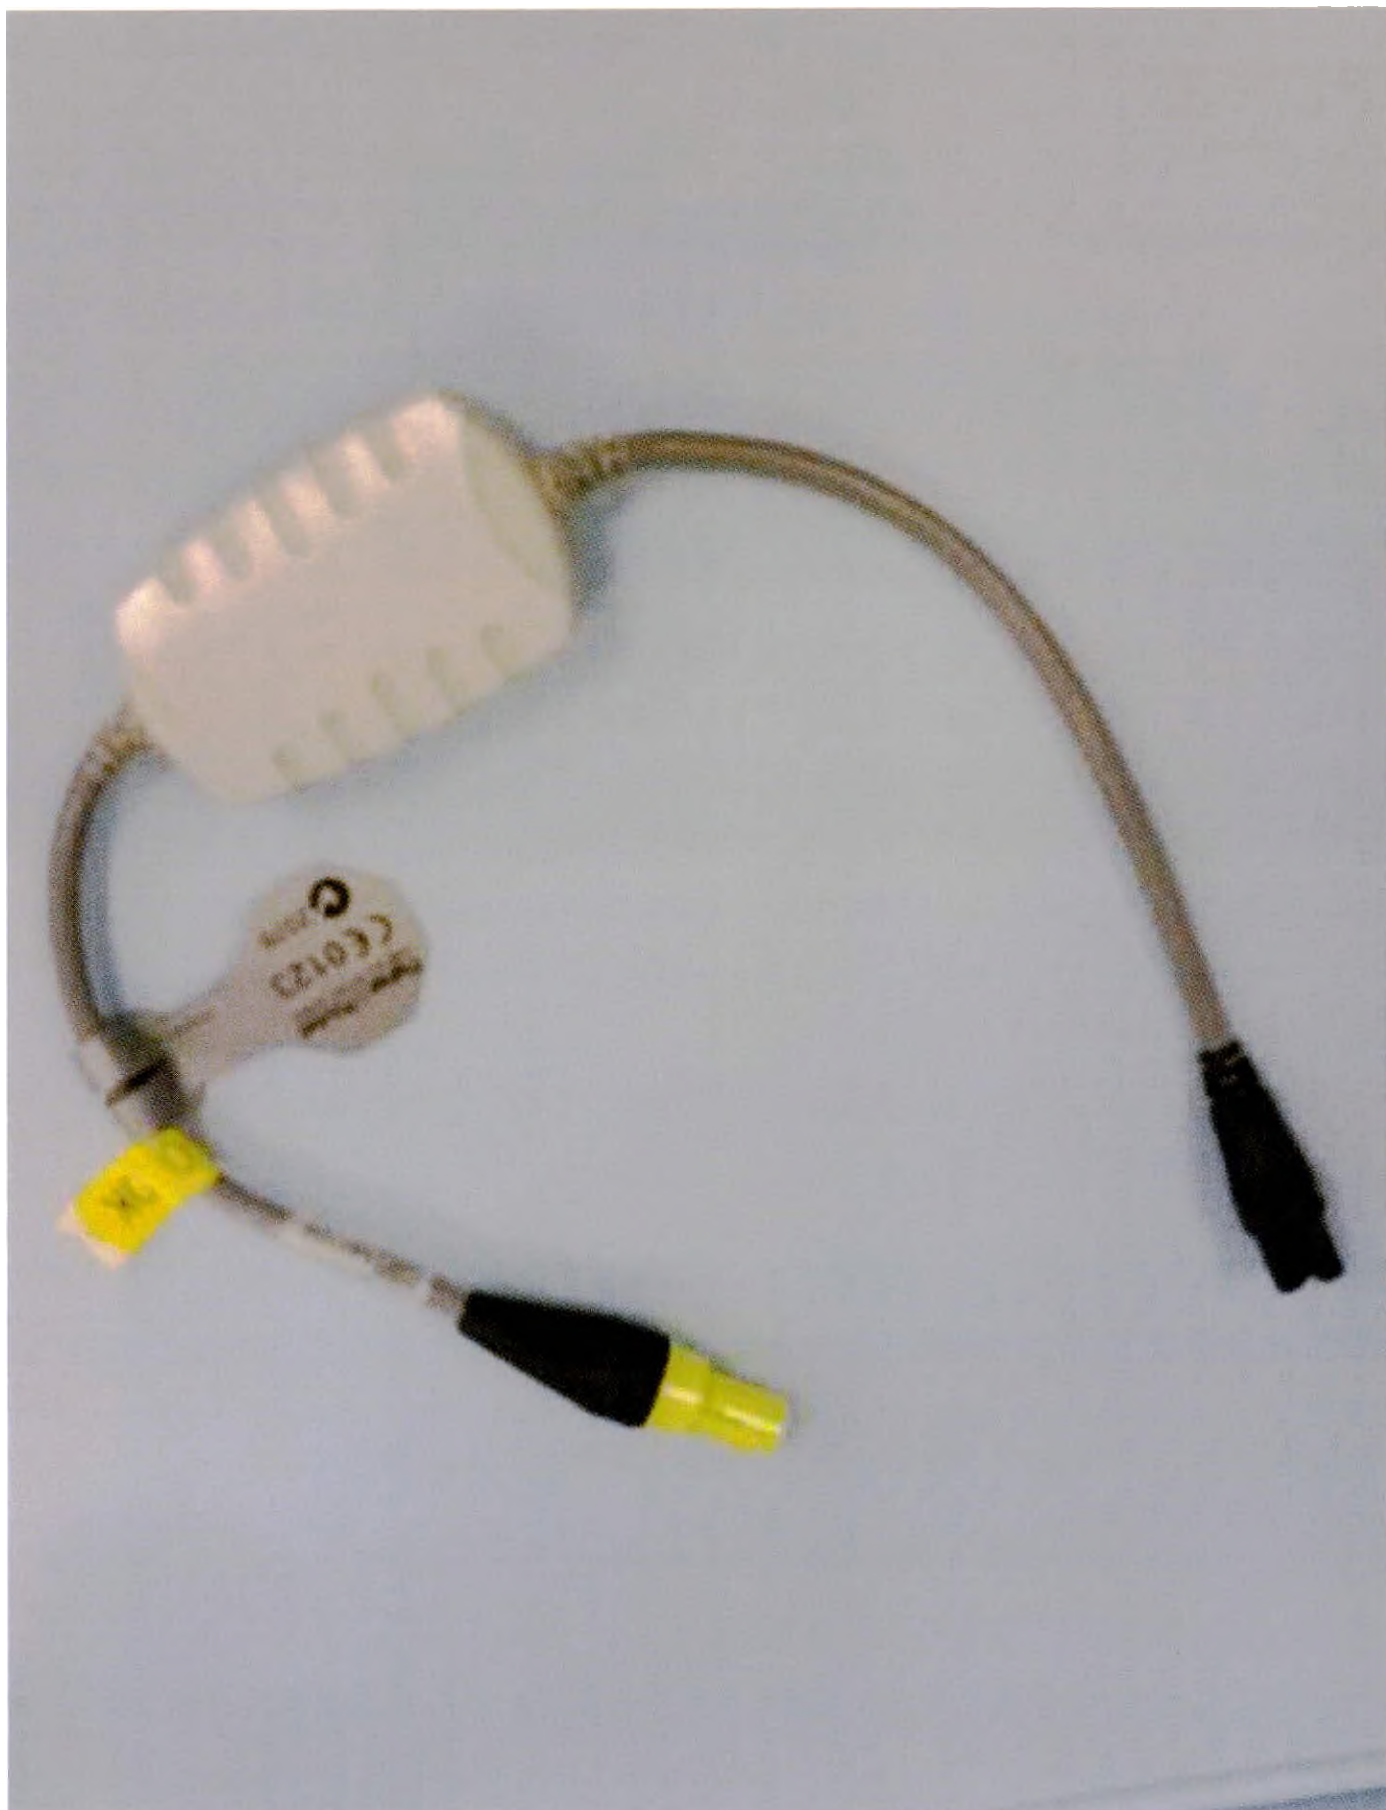


Рисунок 44. Адаптер обогревателя шлангов для F&P MR 850, для одноразовых дыхательных контуров, для взрослых и детей

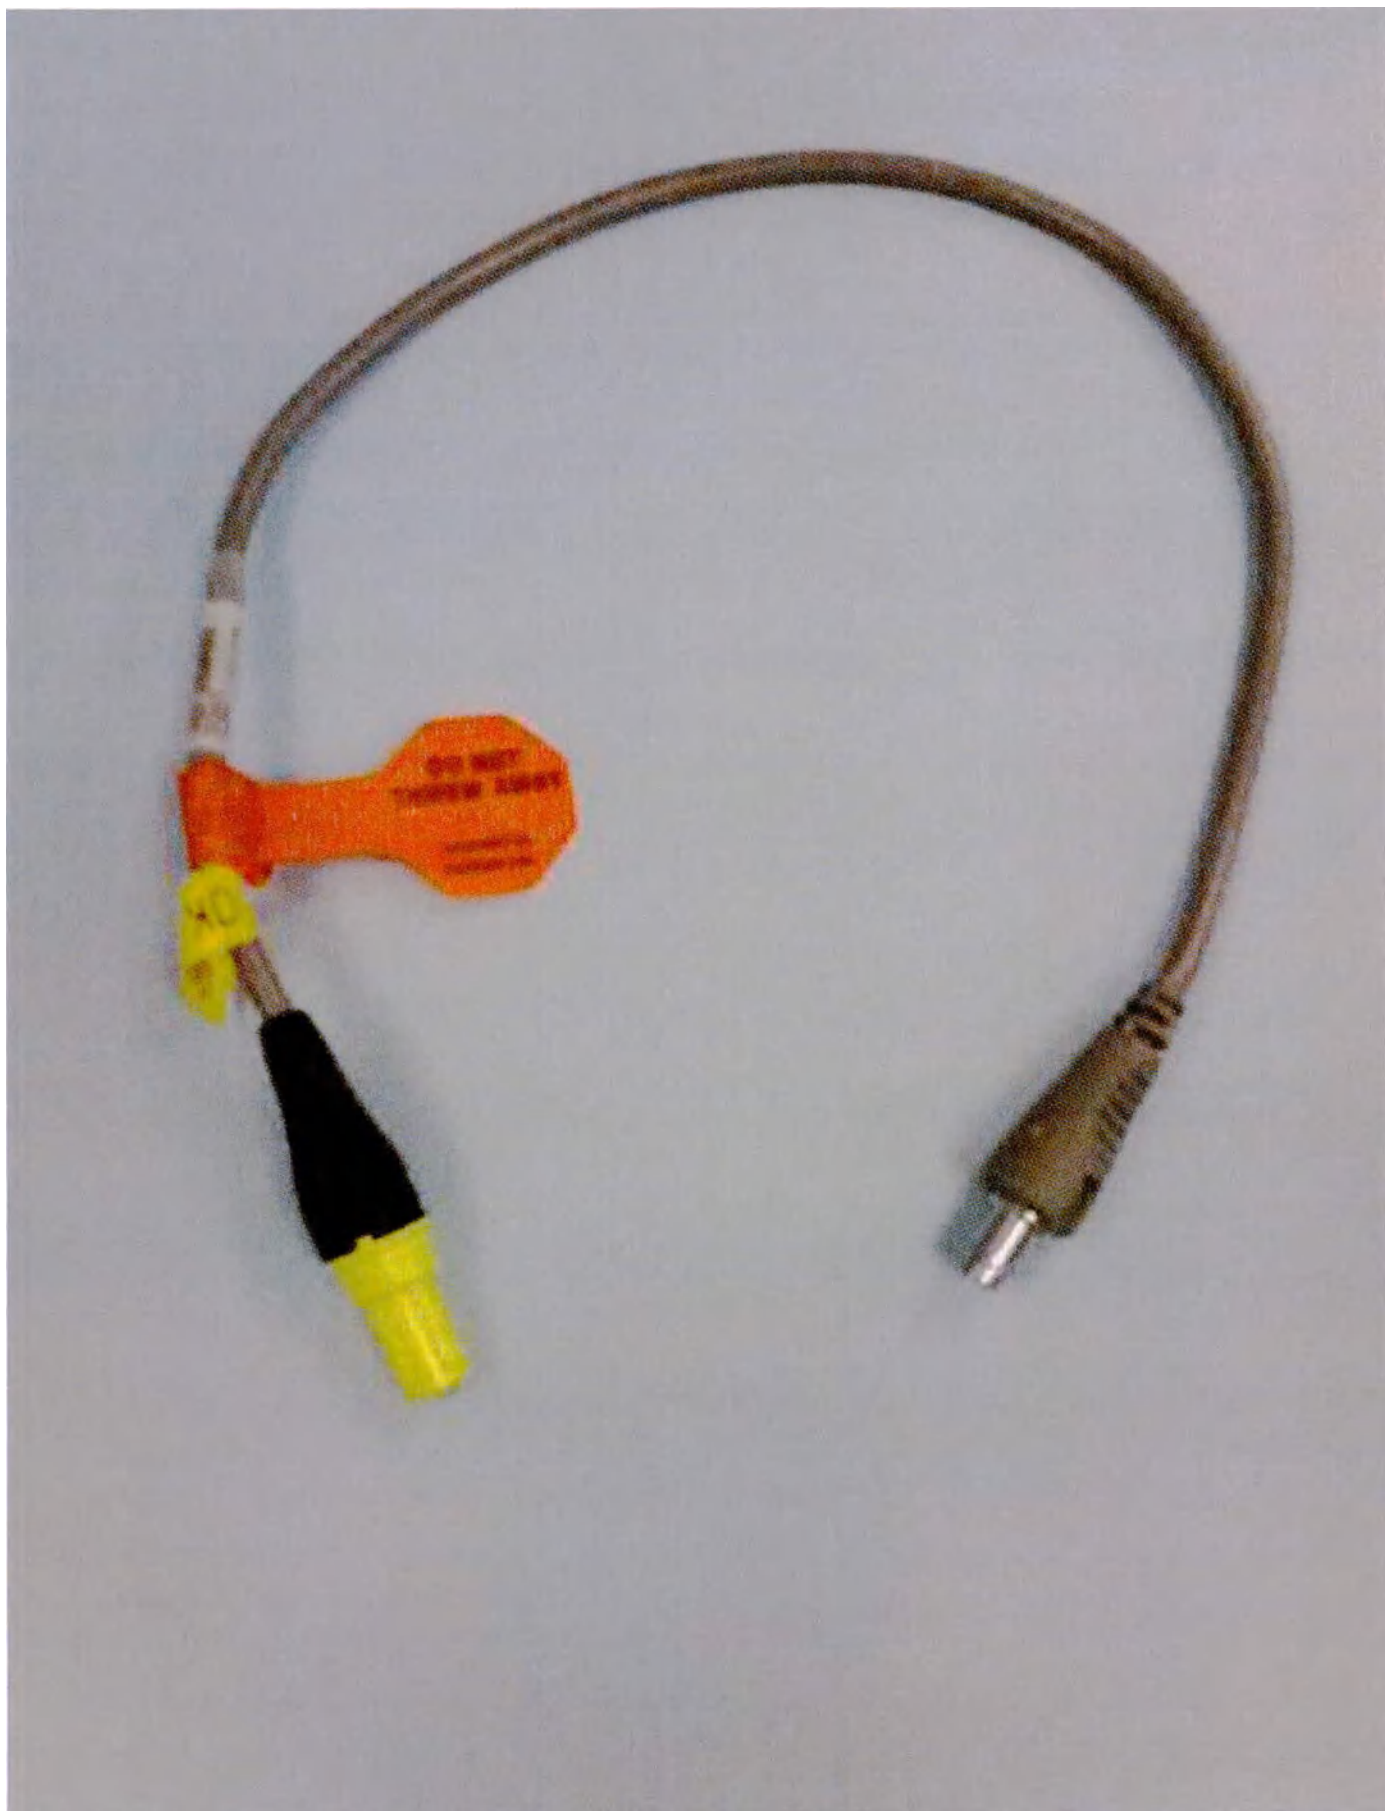


Рисунок 45. Адаптер обогревателя шлангов для дыхательных контуров с подогревателем шлангов вдоха и выдоха

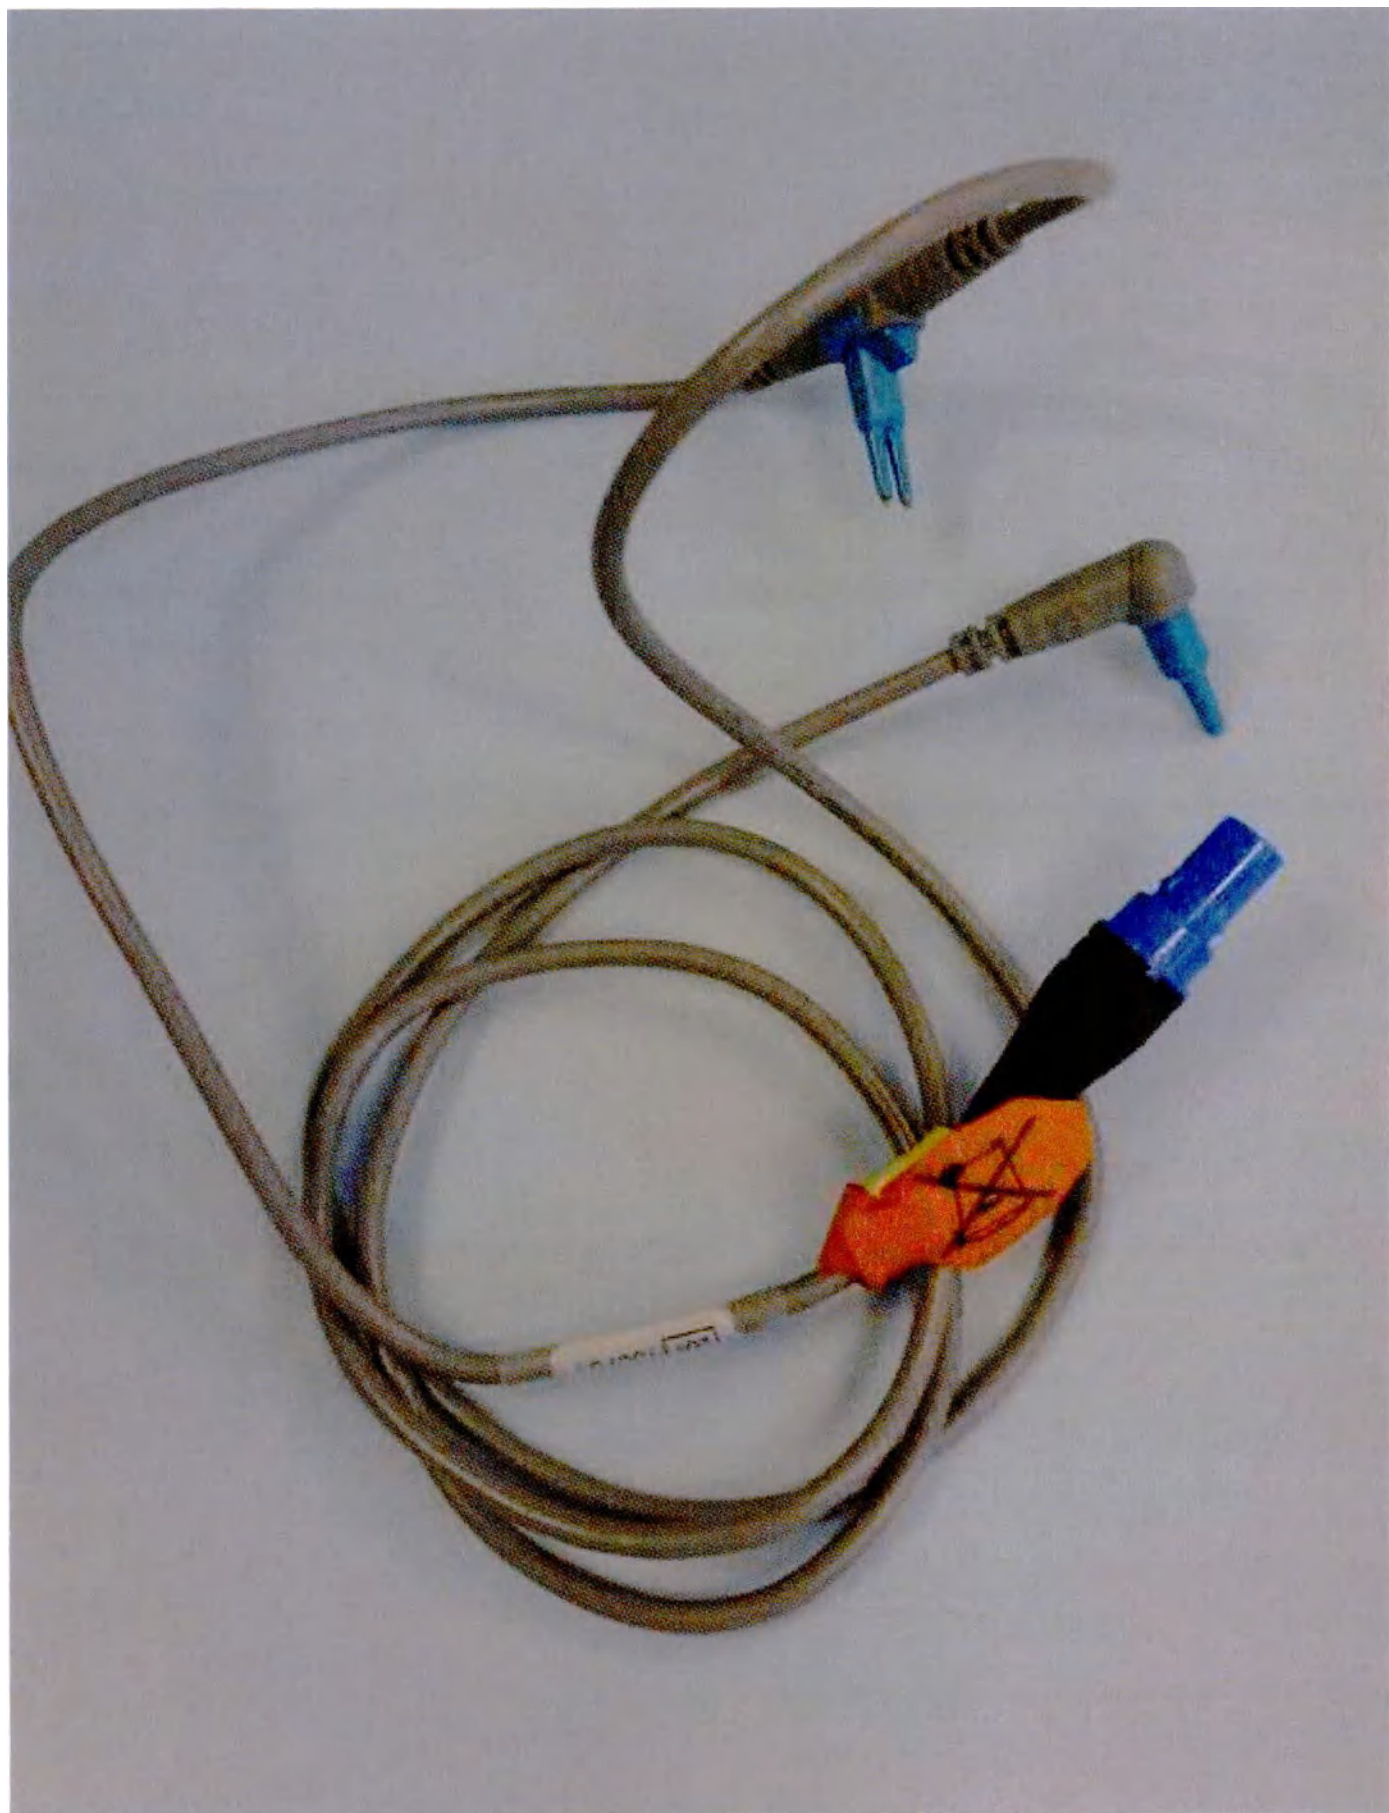


Рисунок 46. Датчик температуры и потока для F&P MR 850 для одноразовых и многоразовых дыхательных контуров



Рисунок 47. Набор для крепления F&P, зажим направляющей для крепления увлажнителя F&P MR 850

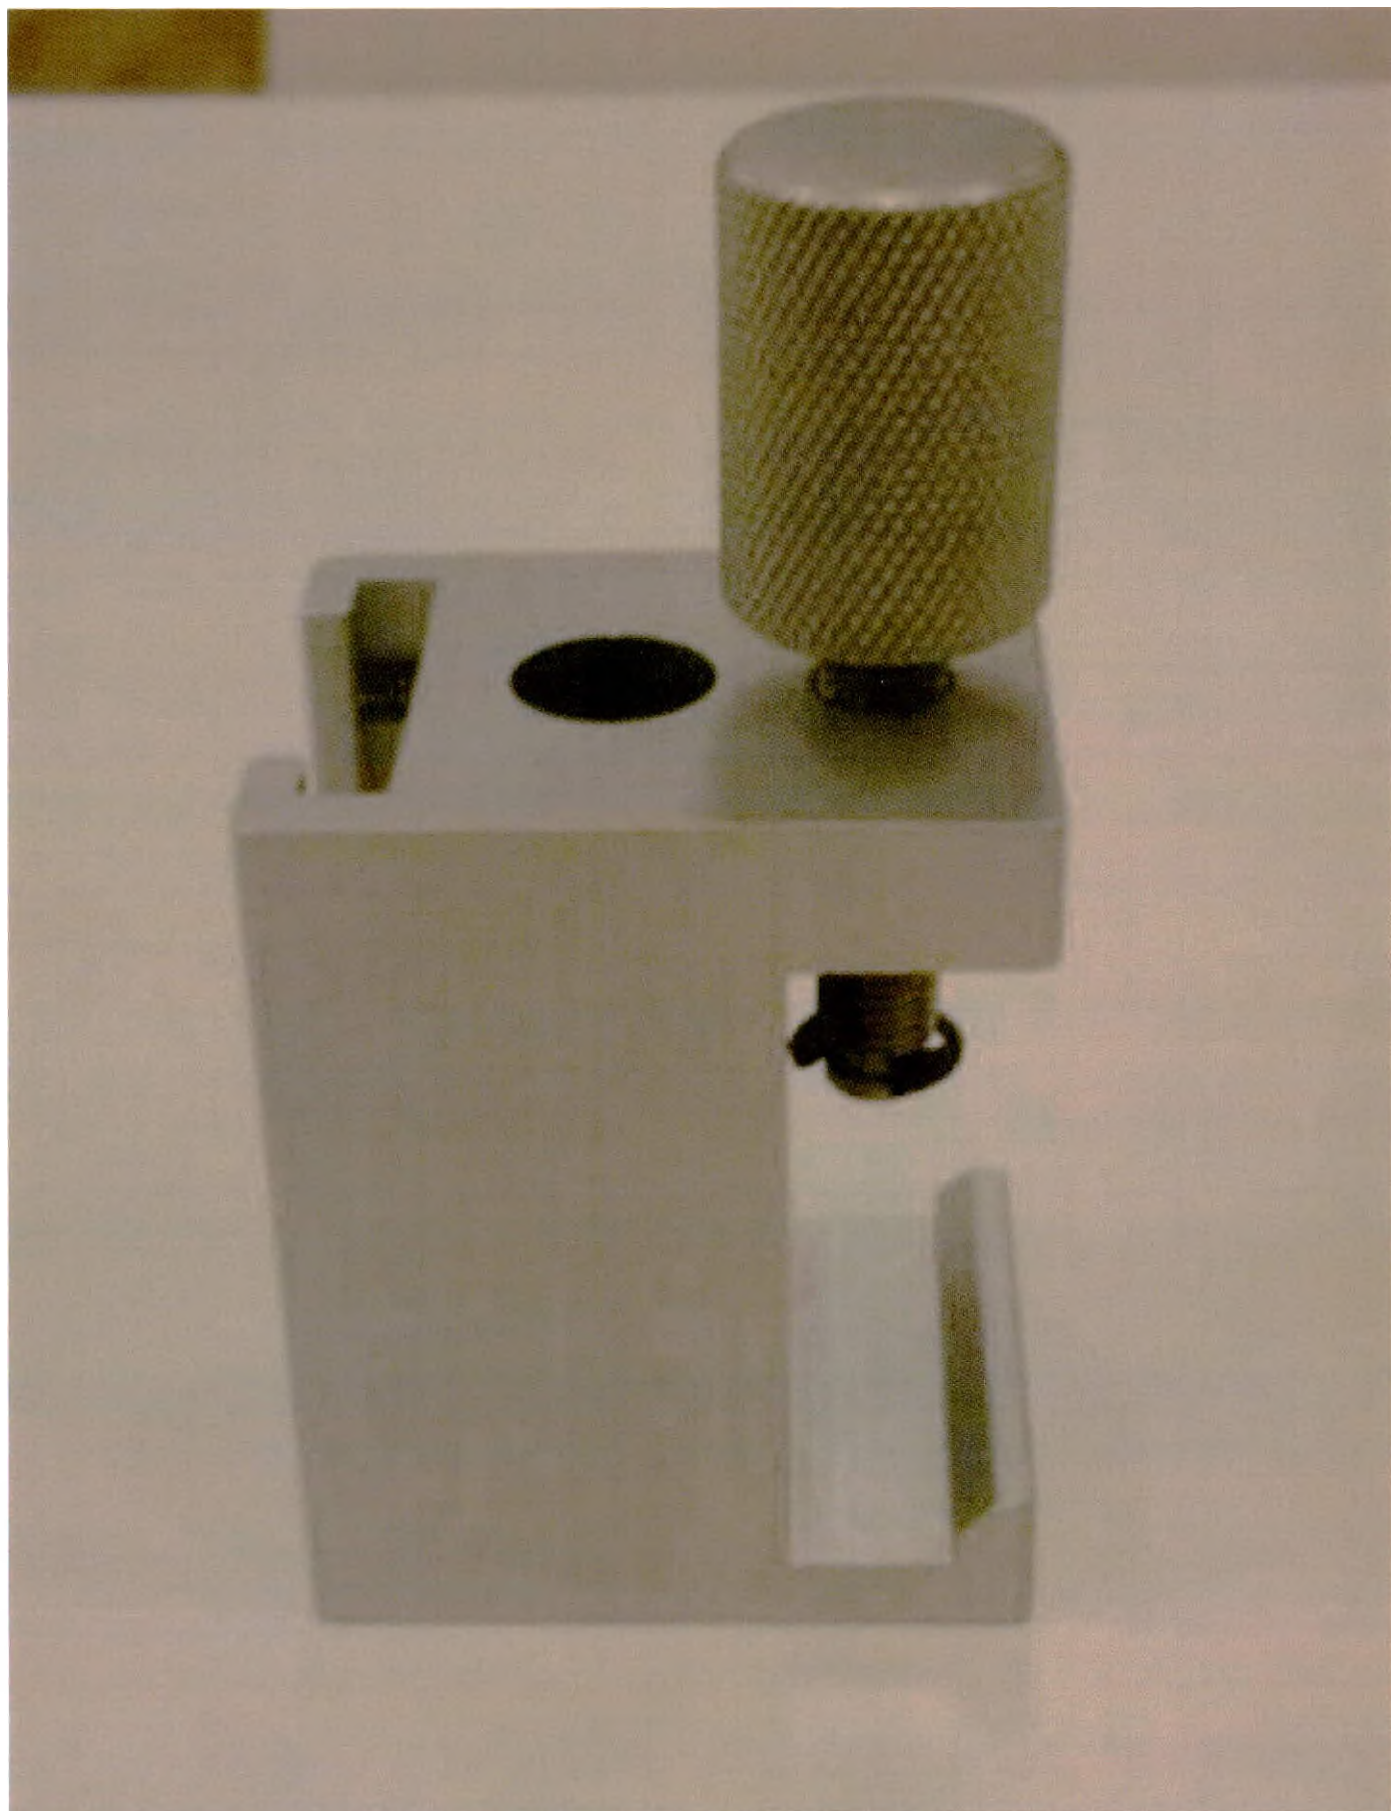


Рисунок 48. Набор для крепления F&P, зажим направляющей для крепления увлажнителя F&P MR 850

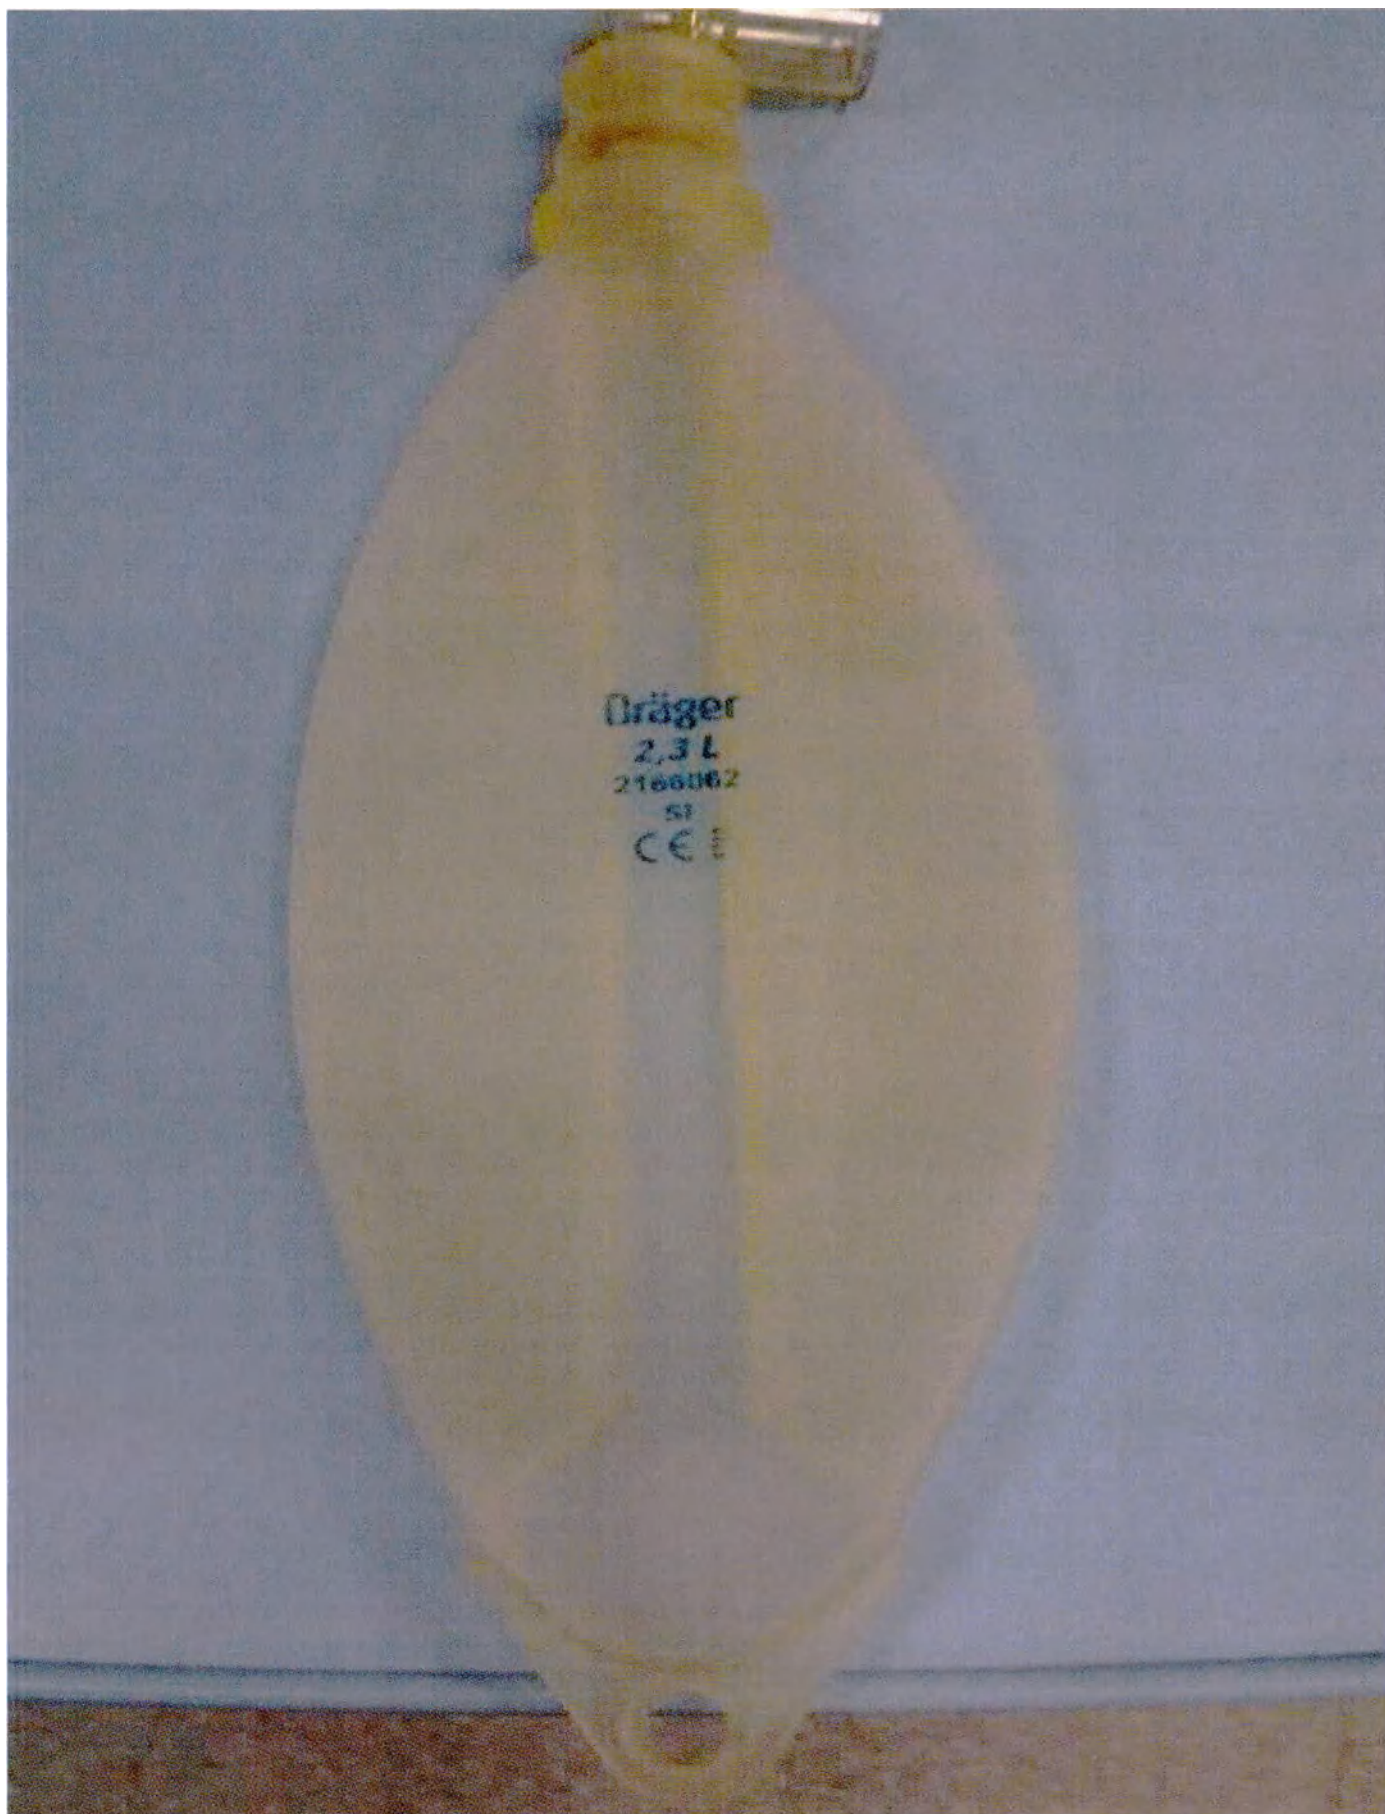


Рисунок 49. Тестовые легкие



Рисунок 50. Тестовые легкие



Рисунок 51. Фотография транспортной упаковки (картонная коробка)



Рисунок 52. Фотография транспортной упаковки (деревянный паллет)

Savina 300, System
Savina 300, System

Dräger

REF 8417800 RI 44

SN ASPK-0728




2021-09-29

-15°C
5°F



40°C
104°F

10%




95%

600 hPa
8,7 psi



1200 hPa
17,4 psi



Order-No.: 1200147517 / 5

Stock-No.: 1003232440



(01)04048675251422
(11)210929

(21)ASPK-0728
(93)8417800-44



0123



Quantity: 1

Quality by Dräger

www.draeger.com

Made in Germany



Drägerwerk AG & Co. KGaA
Molsinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Представитель в РФ:
ООО «Дрегер»
ул. Электрозаводская, д. 33,
стр. 4
107076, Москва, РФ

Рисунок 53. Фотография маркировки транспортной упаковки

Spirolog Flow Sensor (5x)
Spirolog Flow Sensor (5x)

Dräger

REF 8407355 RI 14

 Date of
manufacture
2021-12-03

Storage Temperature

75°C
167°F
-40°C
-40°F

Humidity (rel.)

85%
5%

Atmospheric pressure

1100 hPa
16 psi
115 hPa
1,7 psi



instructions for use



(01)04048875448860
(11)161203

(93)8403735-14

Рисунок 54. Маркировка датчика потока Spirolog

SpiroliFe Flow Sensor
SpiroliFe Flow Sensor

Dräger

REF 343753 RI 14

Date of
manufacture
2021-12-03

Storage Temperature

75°C
167°F
-40°C
-40°F

Humidity (rel.)

95%
5%

Atmospheric pressure

1100 hPa
16 psi
115 hPa
1,7 psi



Instructions for use



(01)44548675447860
(11)161223

(93)4813735-14

Рисунок 55. Маркировка датчика потока SpiroLife



Рисунок 56. Маркировка одноразовых дыхательных контуров на примере серии VentStar Water trap 180 без порта Luer

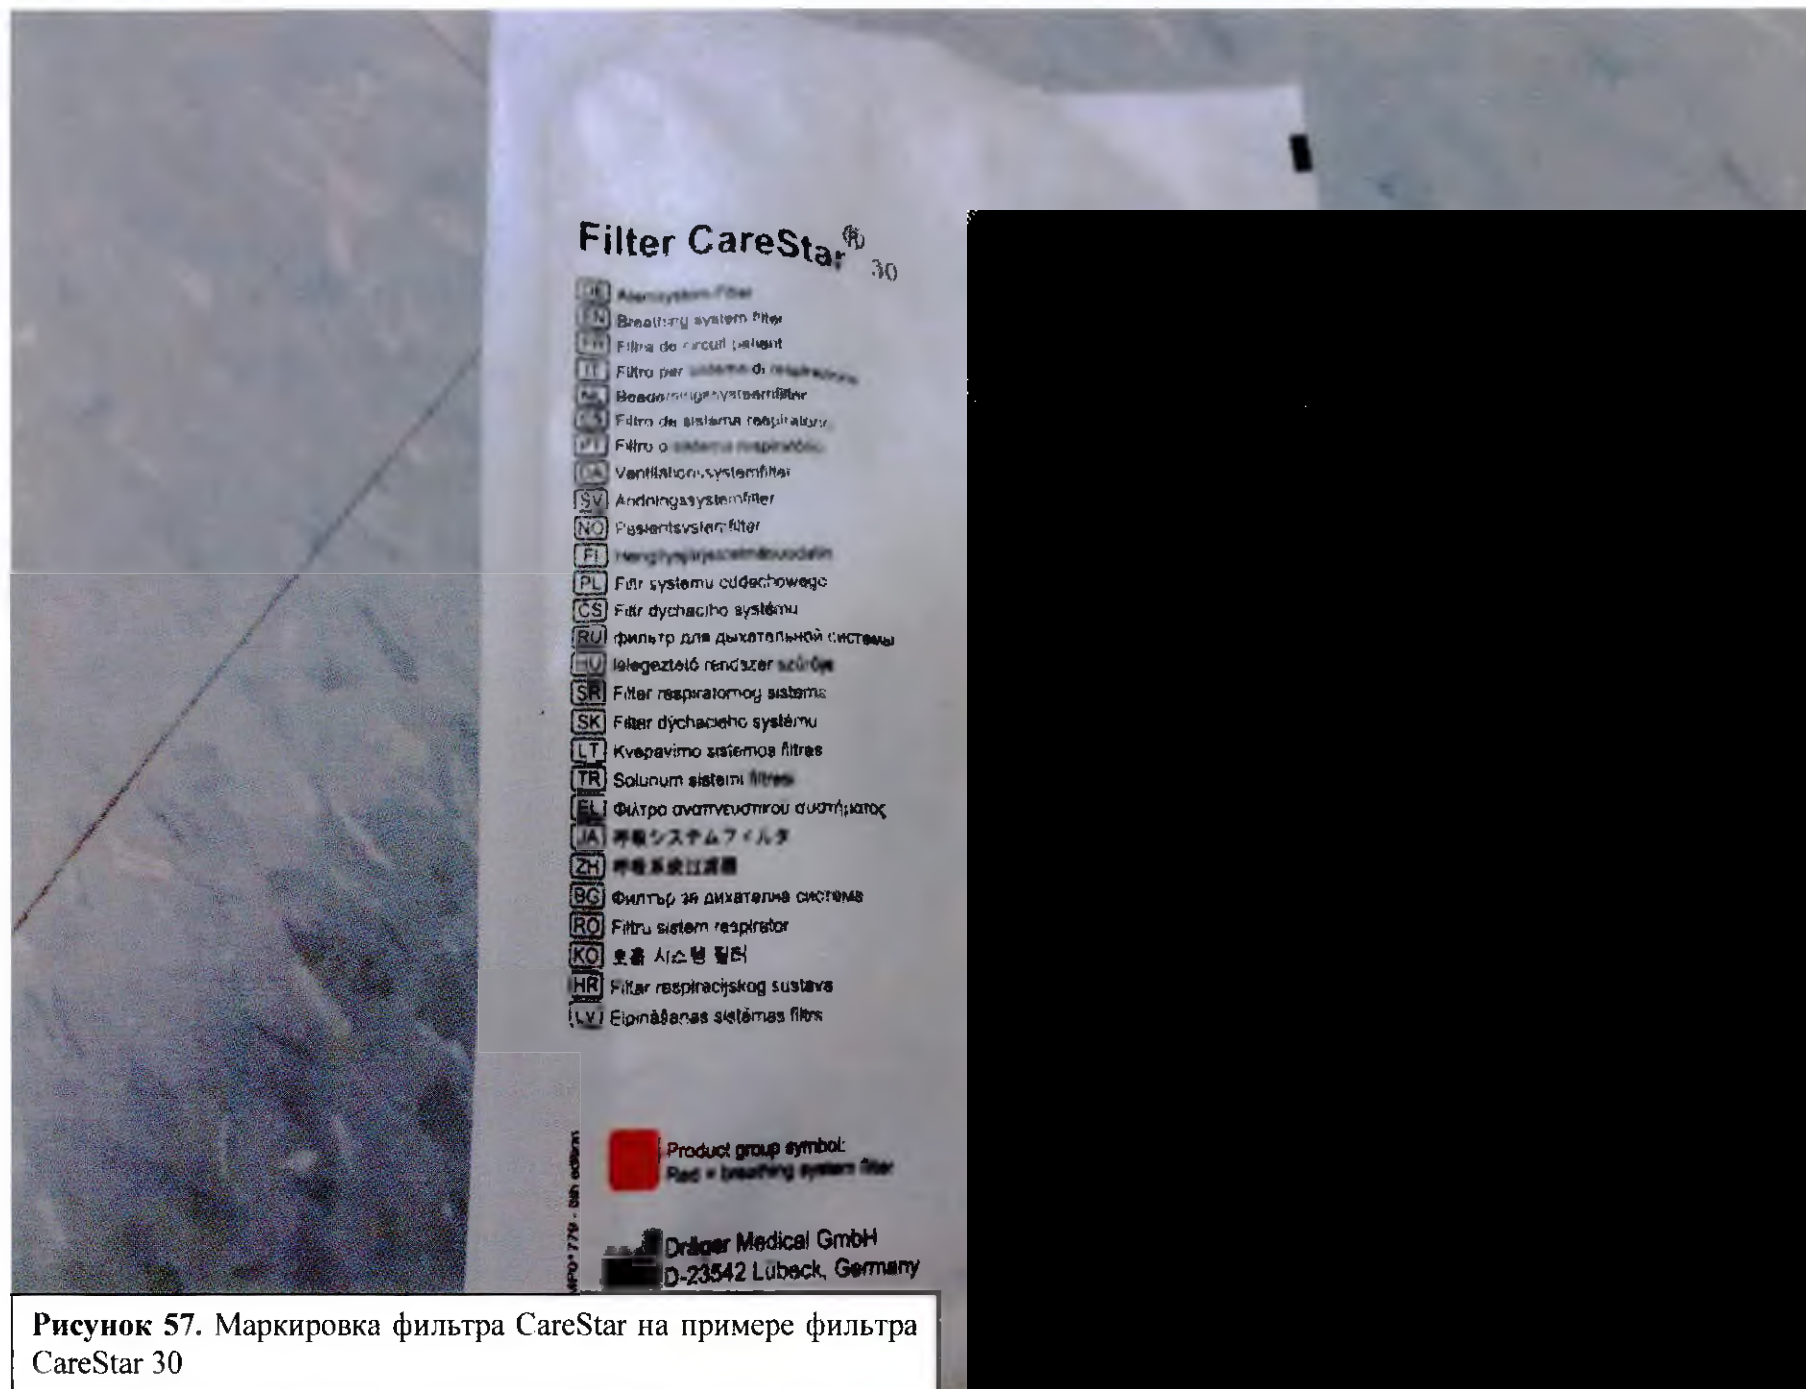


Рисунок 57. Маркировка фильтра CareStar на примере фильтра CareStar 30



Рисунок 58. Маркировка микрофильтра (фильтра воздухозабора)



Рисунок 59. Маркировка тестовых легких

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 60
_____ листах

