

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «МЕДИТЕК»
М.Ю. Бороздин
"27" февраля 2023 г.



Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и интерфейса программного
обеспечения

Система температурного мониторинга для обеспечения
безопасности при чрескожных вмешательствах
«АСТРОКАРД® - ЭЗОСЕЙФЕТИ»

Рис. 1 Общий вид



Рис. 2 Интерфейс программного обеспечения

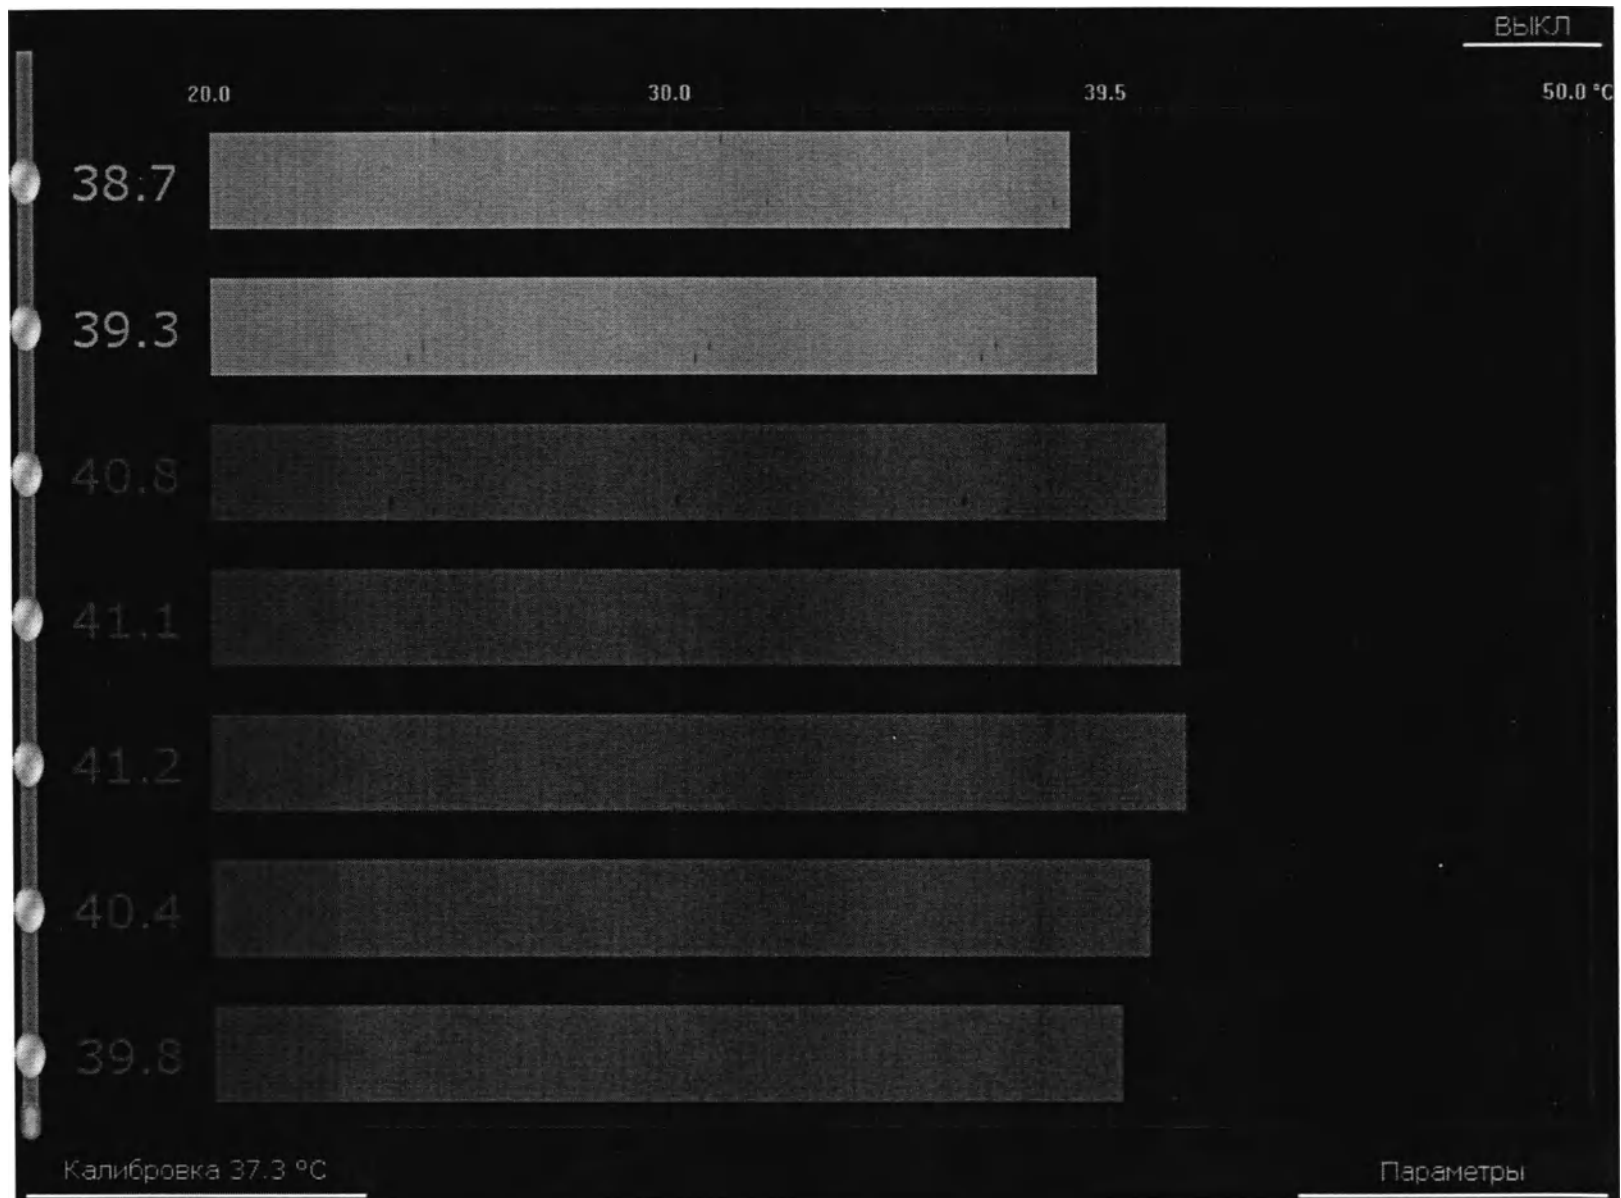


Рис. 3 Блок управления и индикации

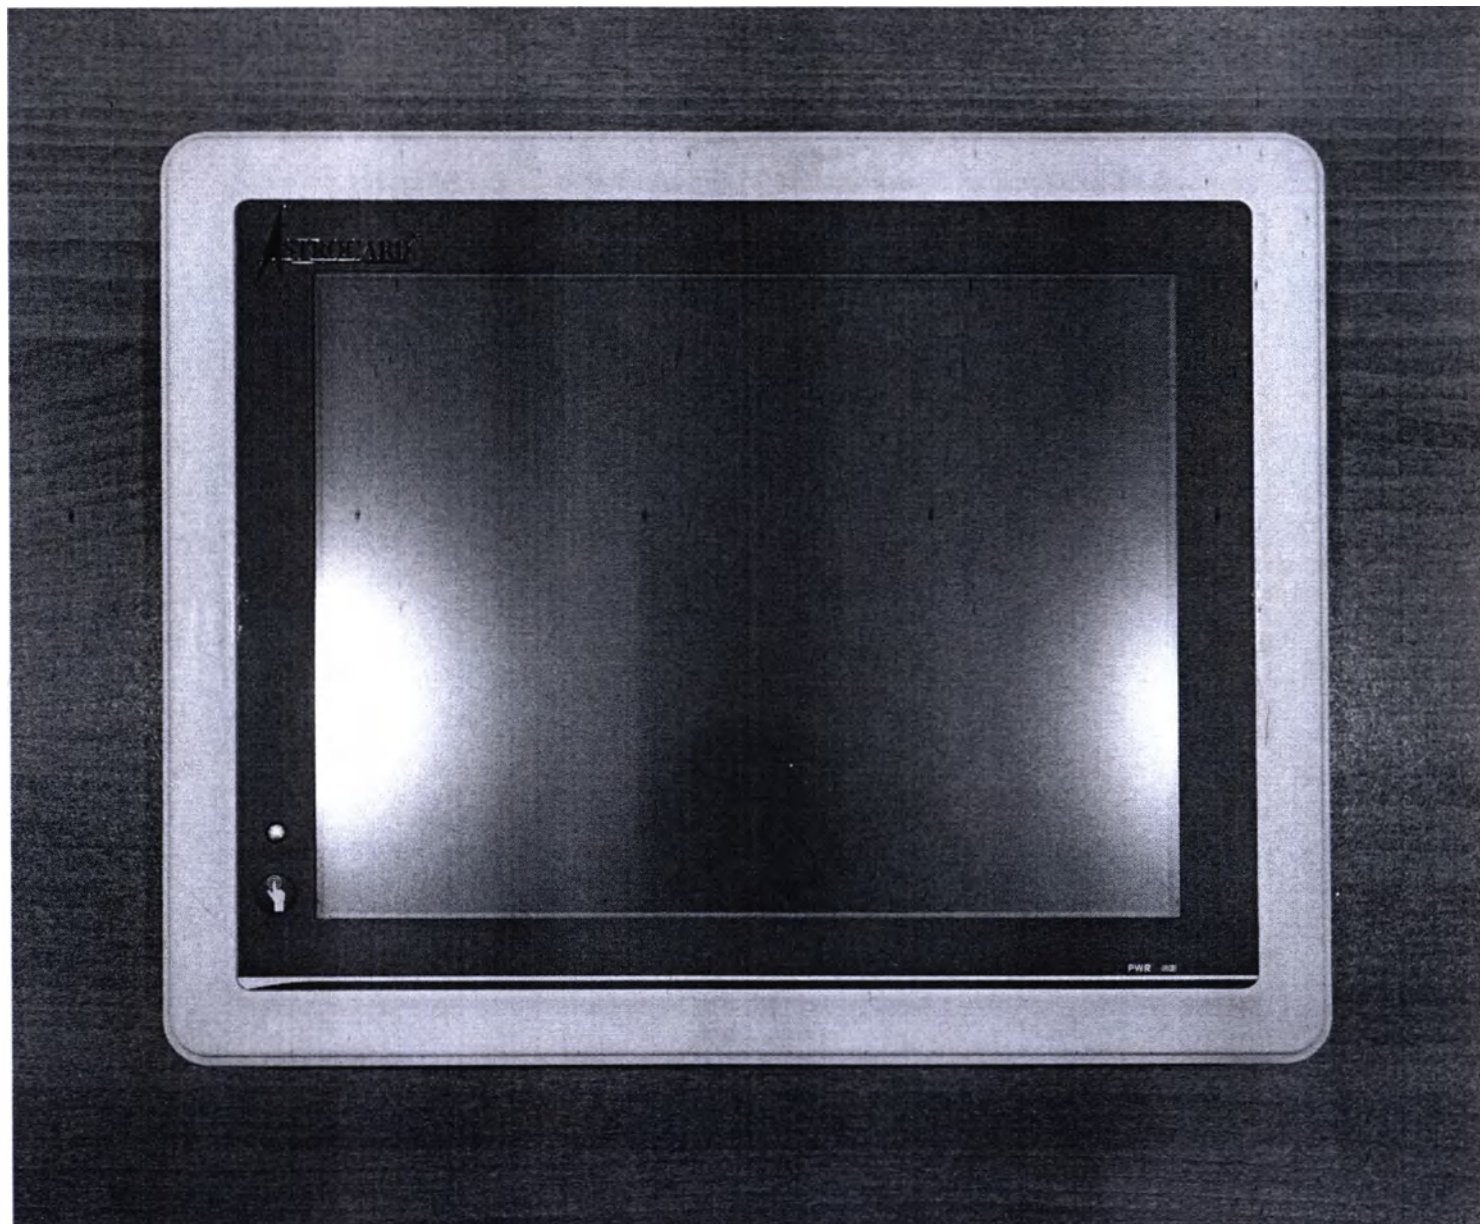


Рис. 4 Блок регистрации температуры

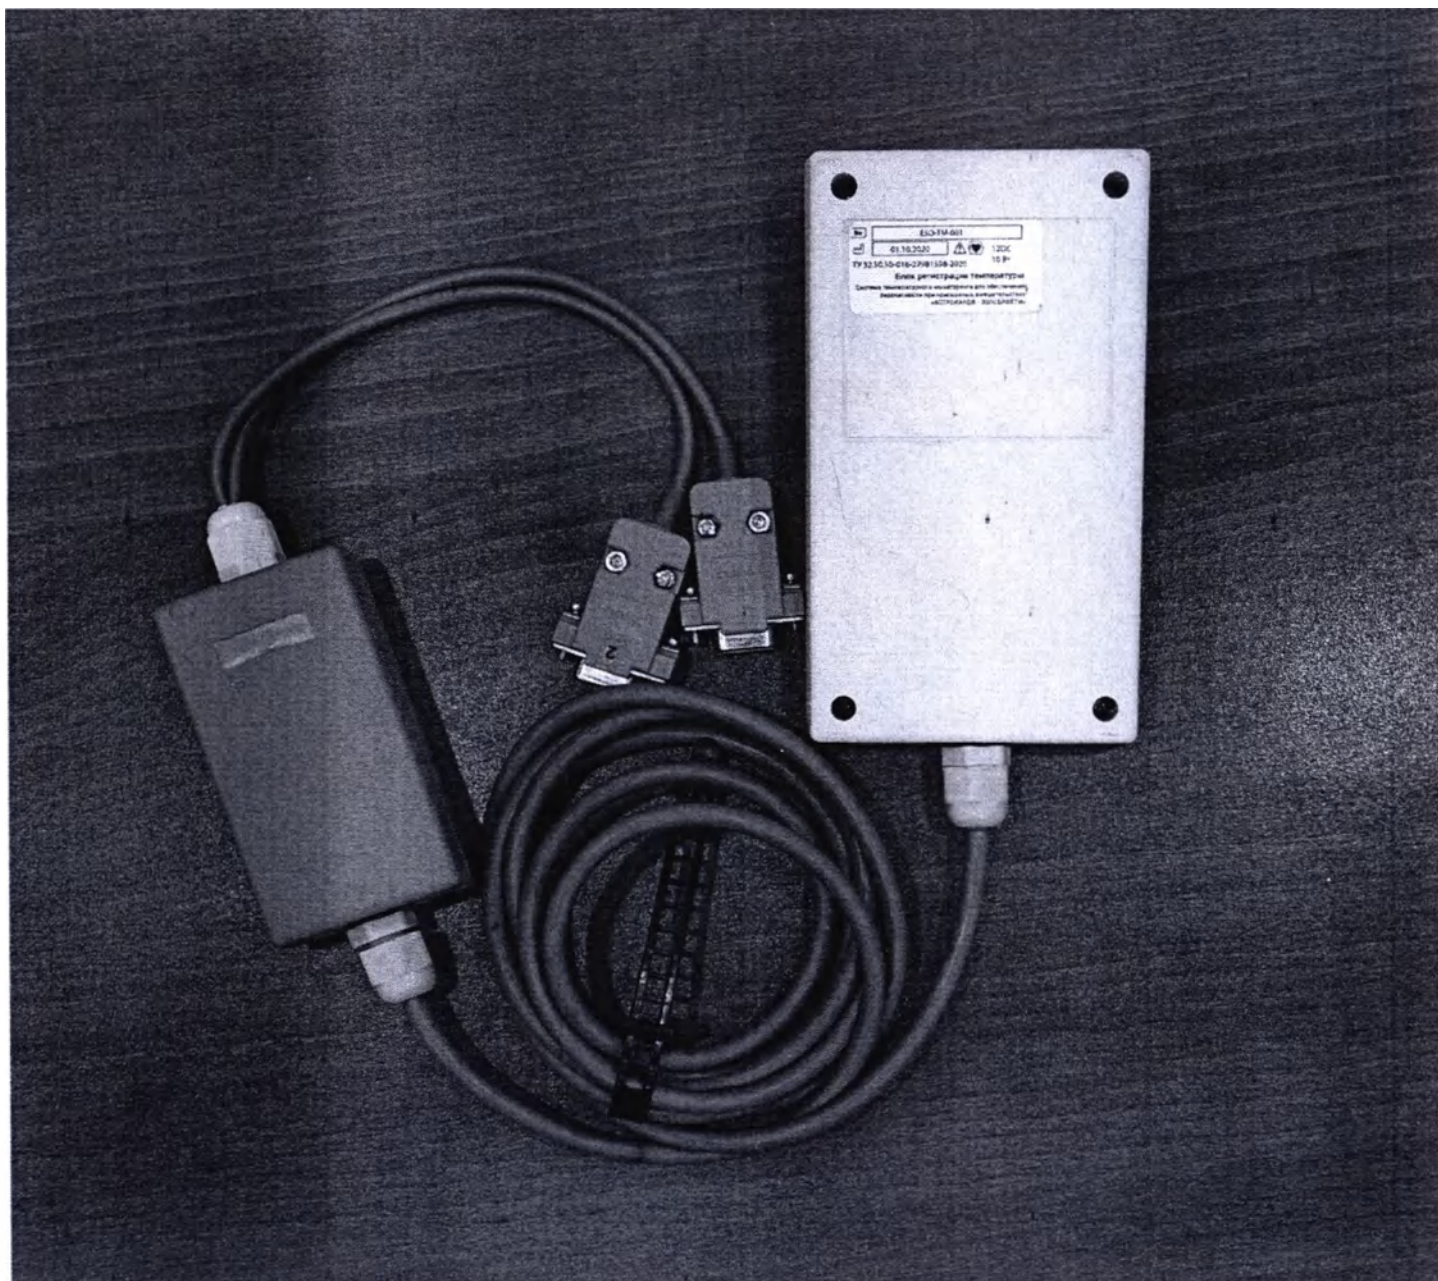


Рис. 5 Катетер пищеводный КТ-3

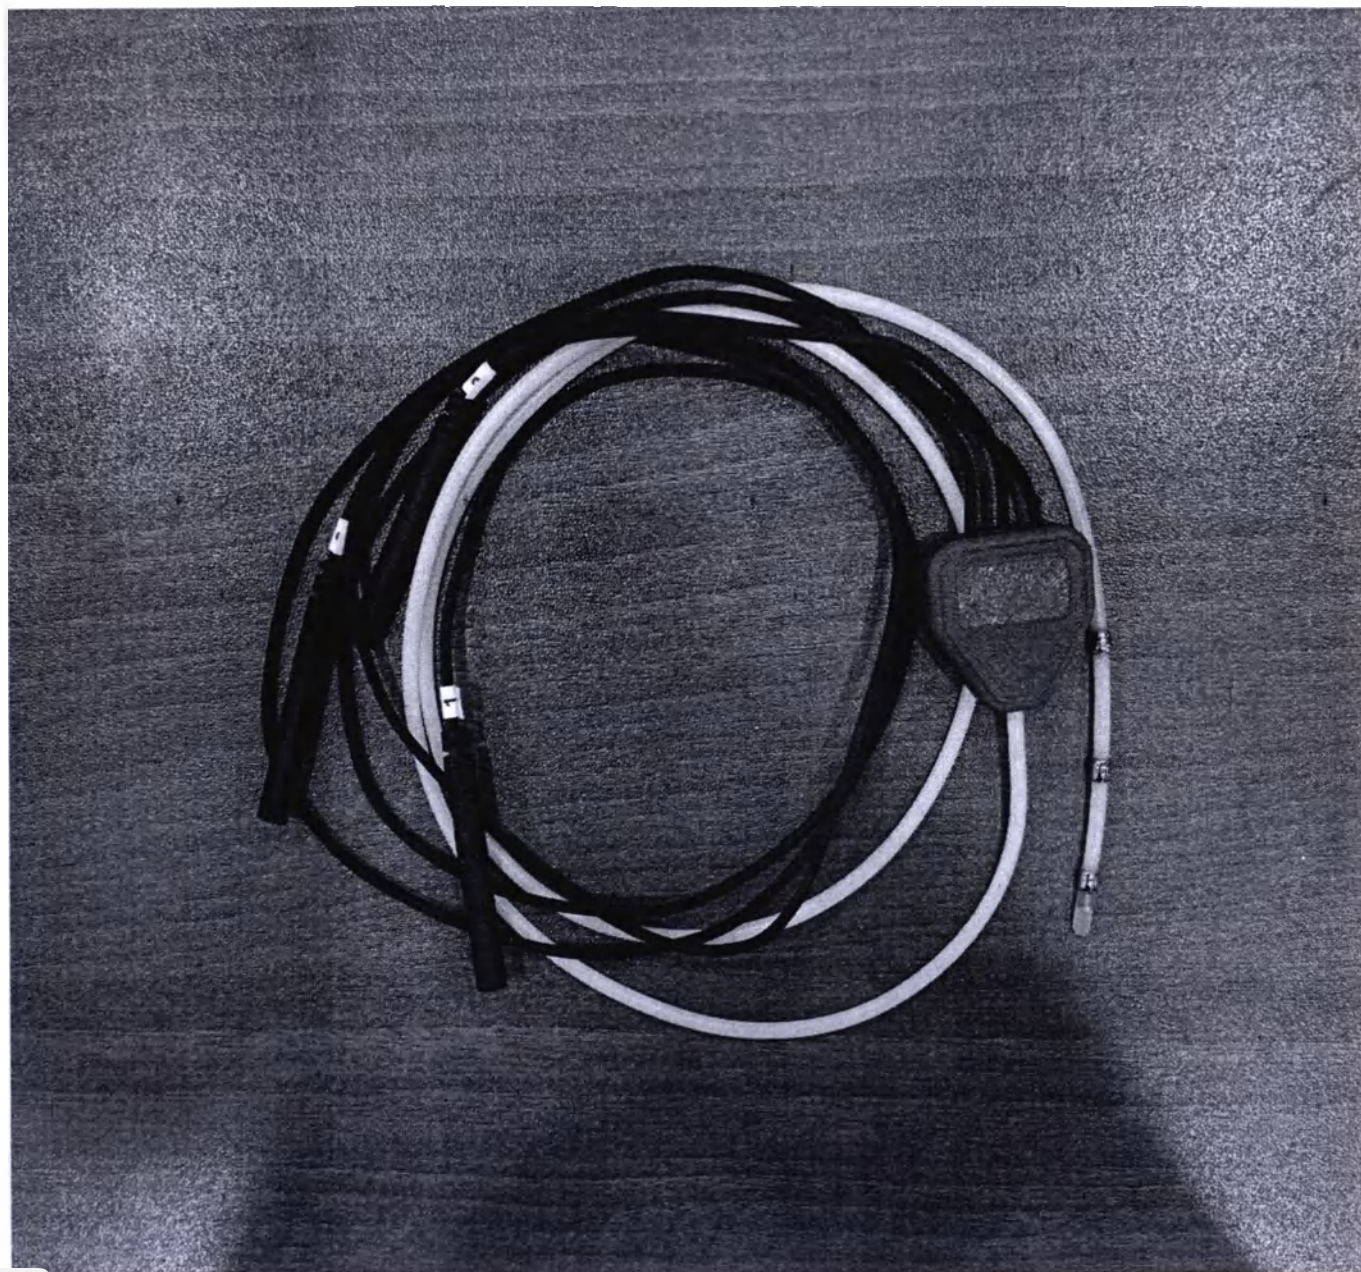


Рис. 6 Зонд для мониторинга температуры пищевода

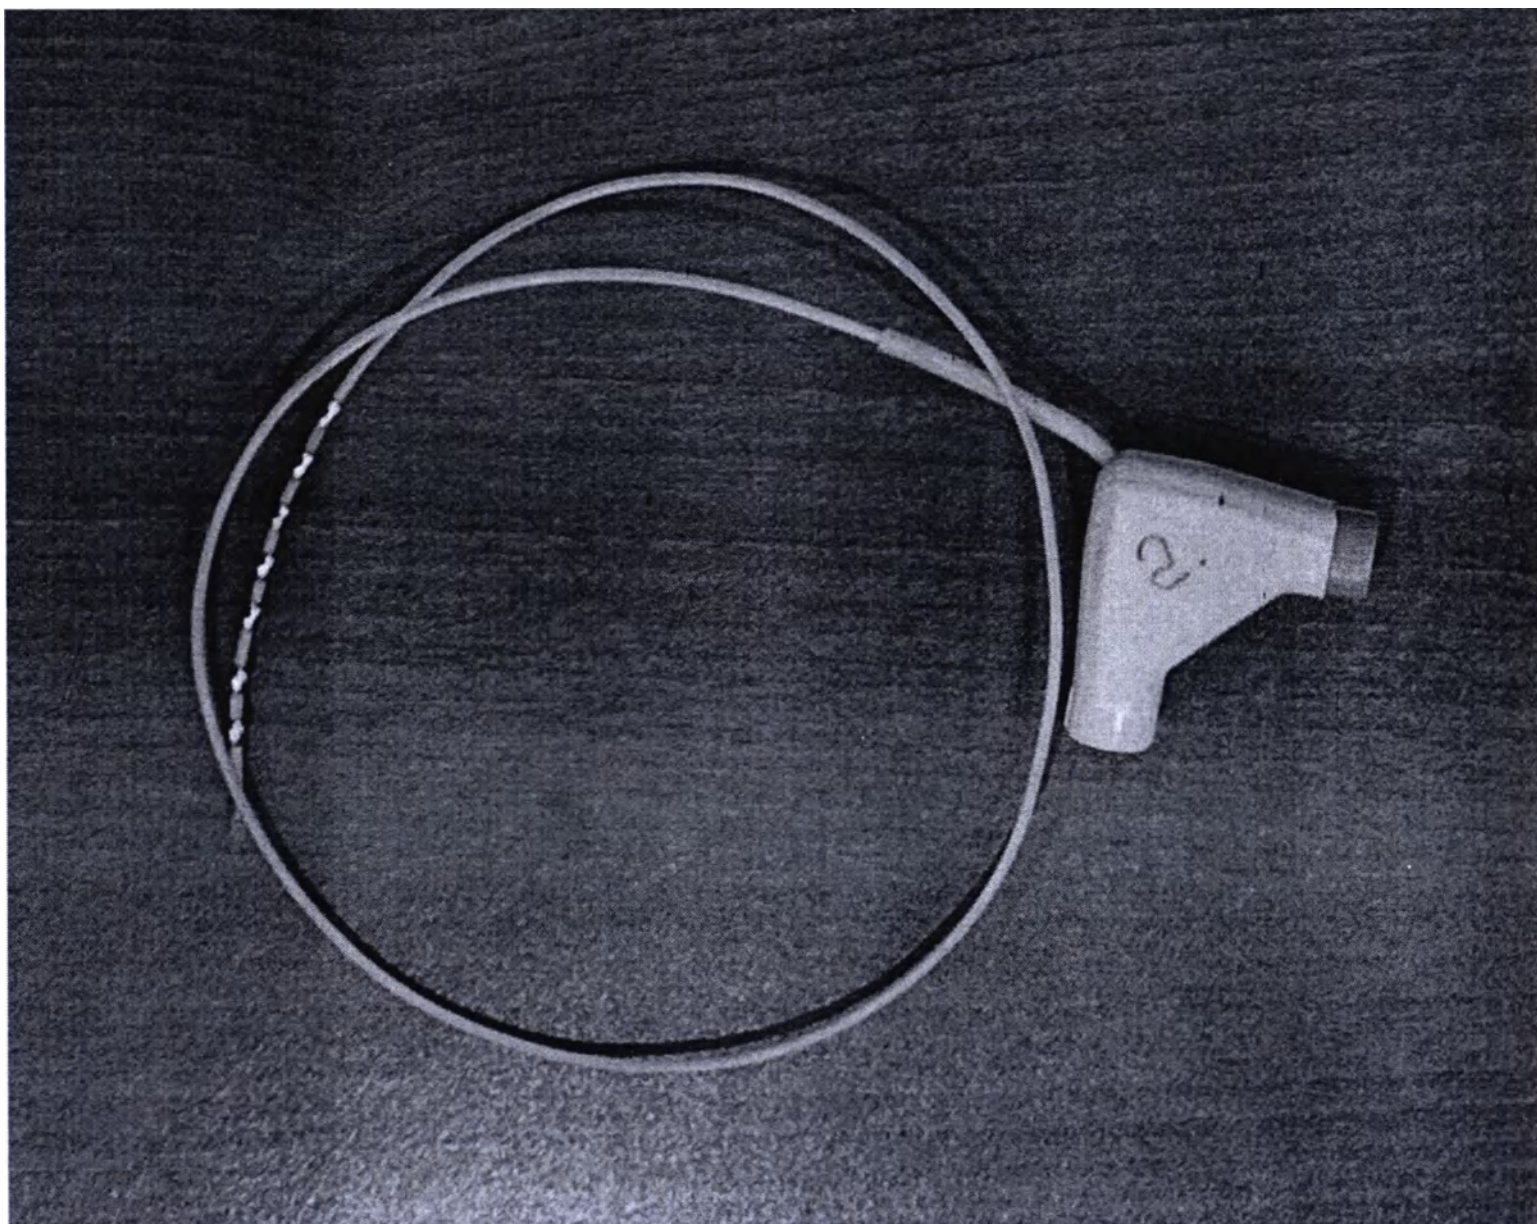


Рис. 7 Удлинитель катетерный УК150



Рис. 8 Комплект соединительных кабелей для управления от ЭФИ-системы

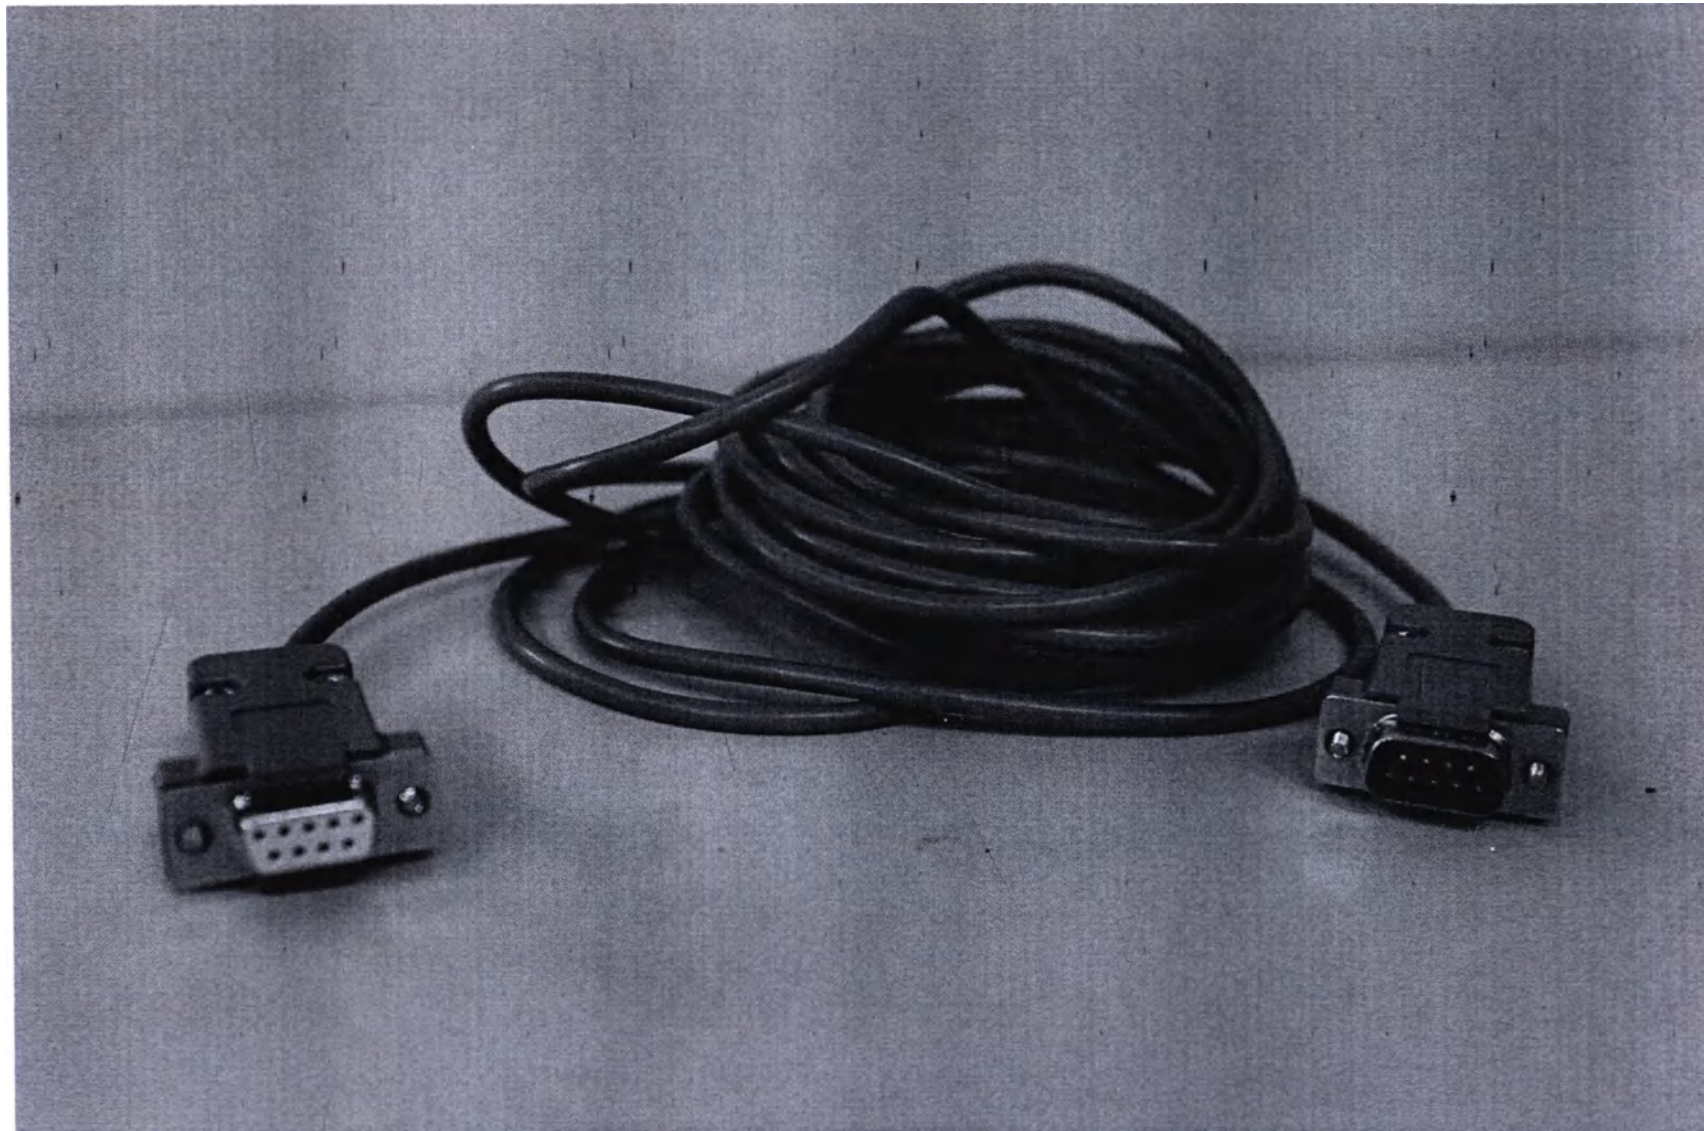


Рис. 9 Комплект соединительных кабелей для передачи осциллограмм


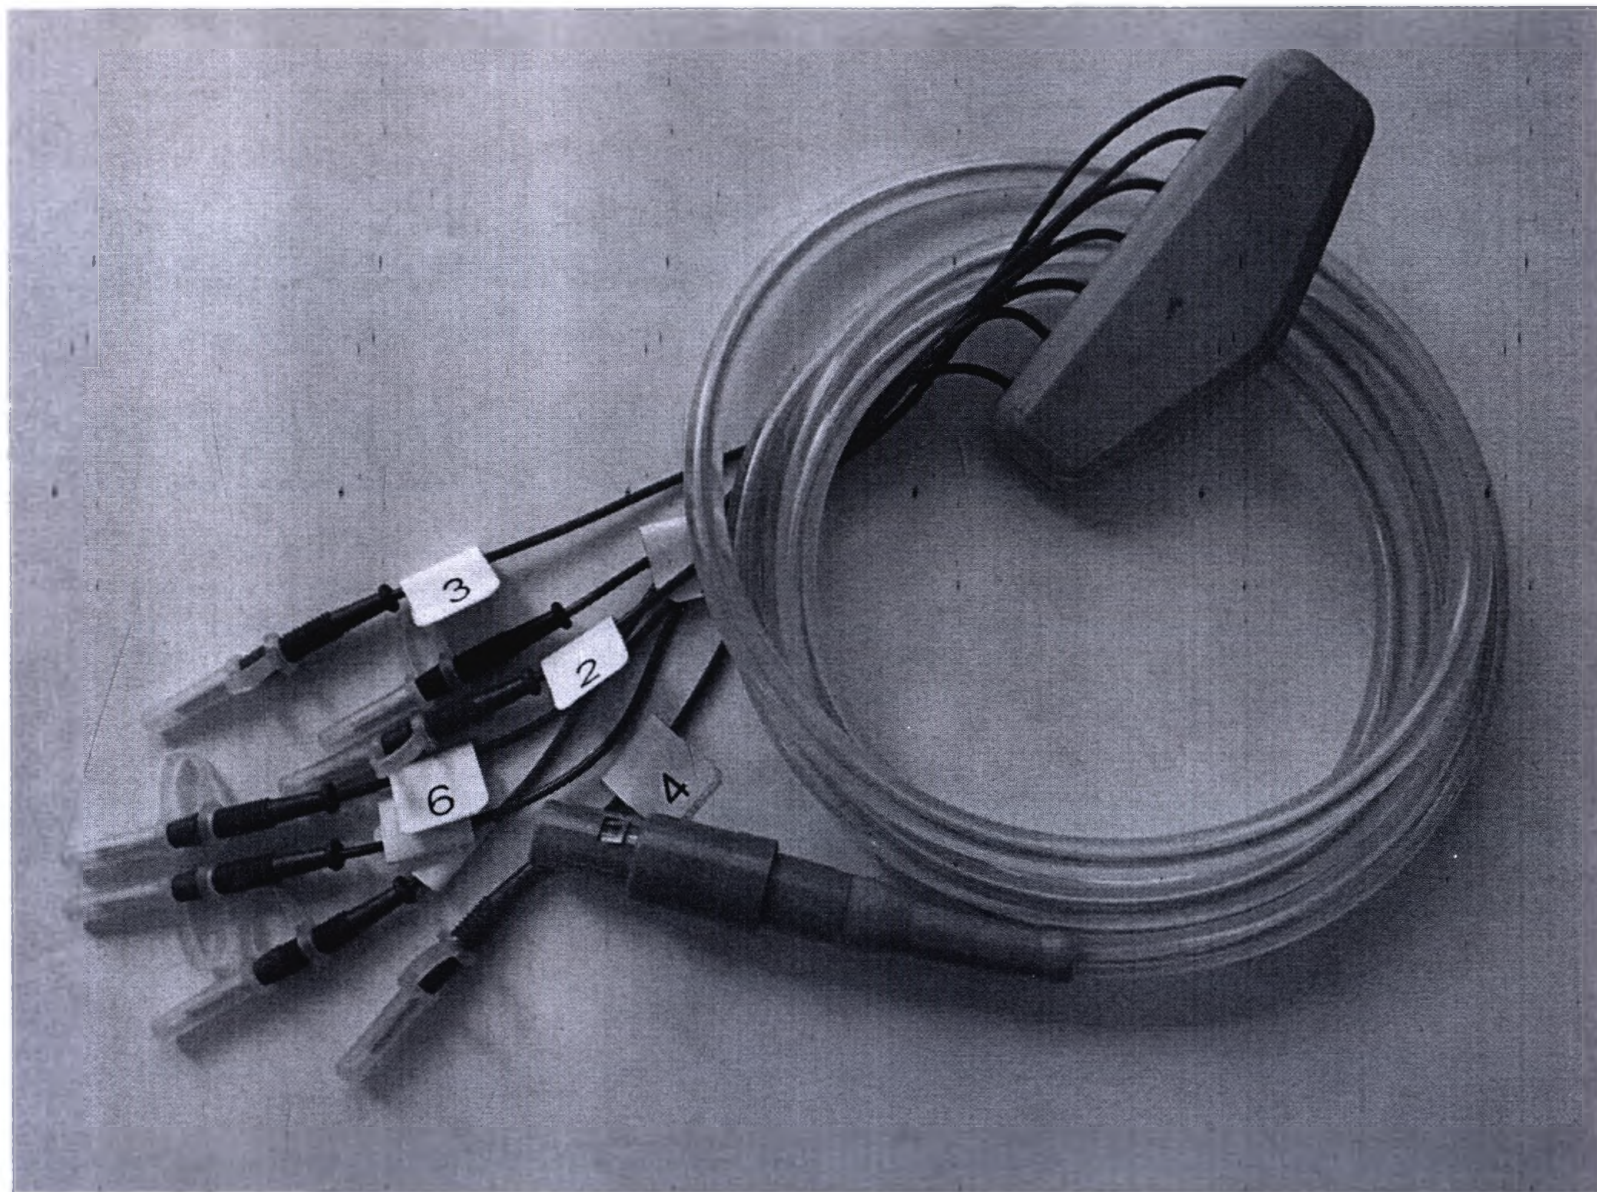


Рис. 10 Система фиксации на стойке



Рис.11 Руководство по эксплуатации

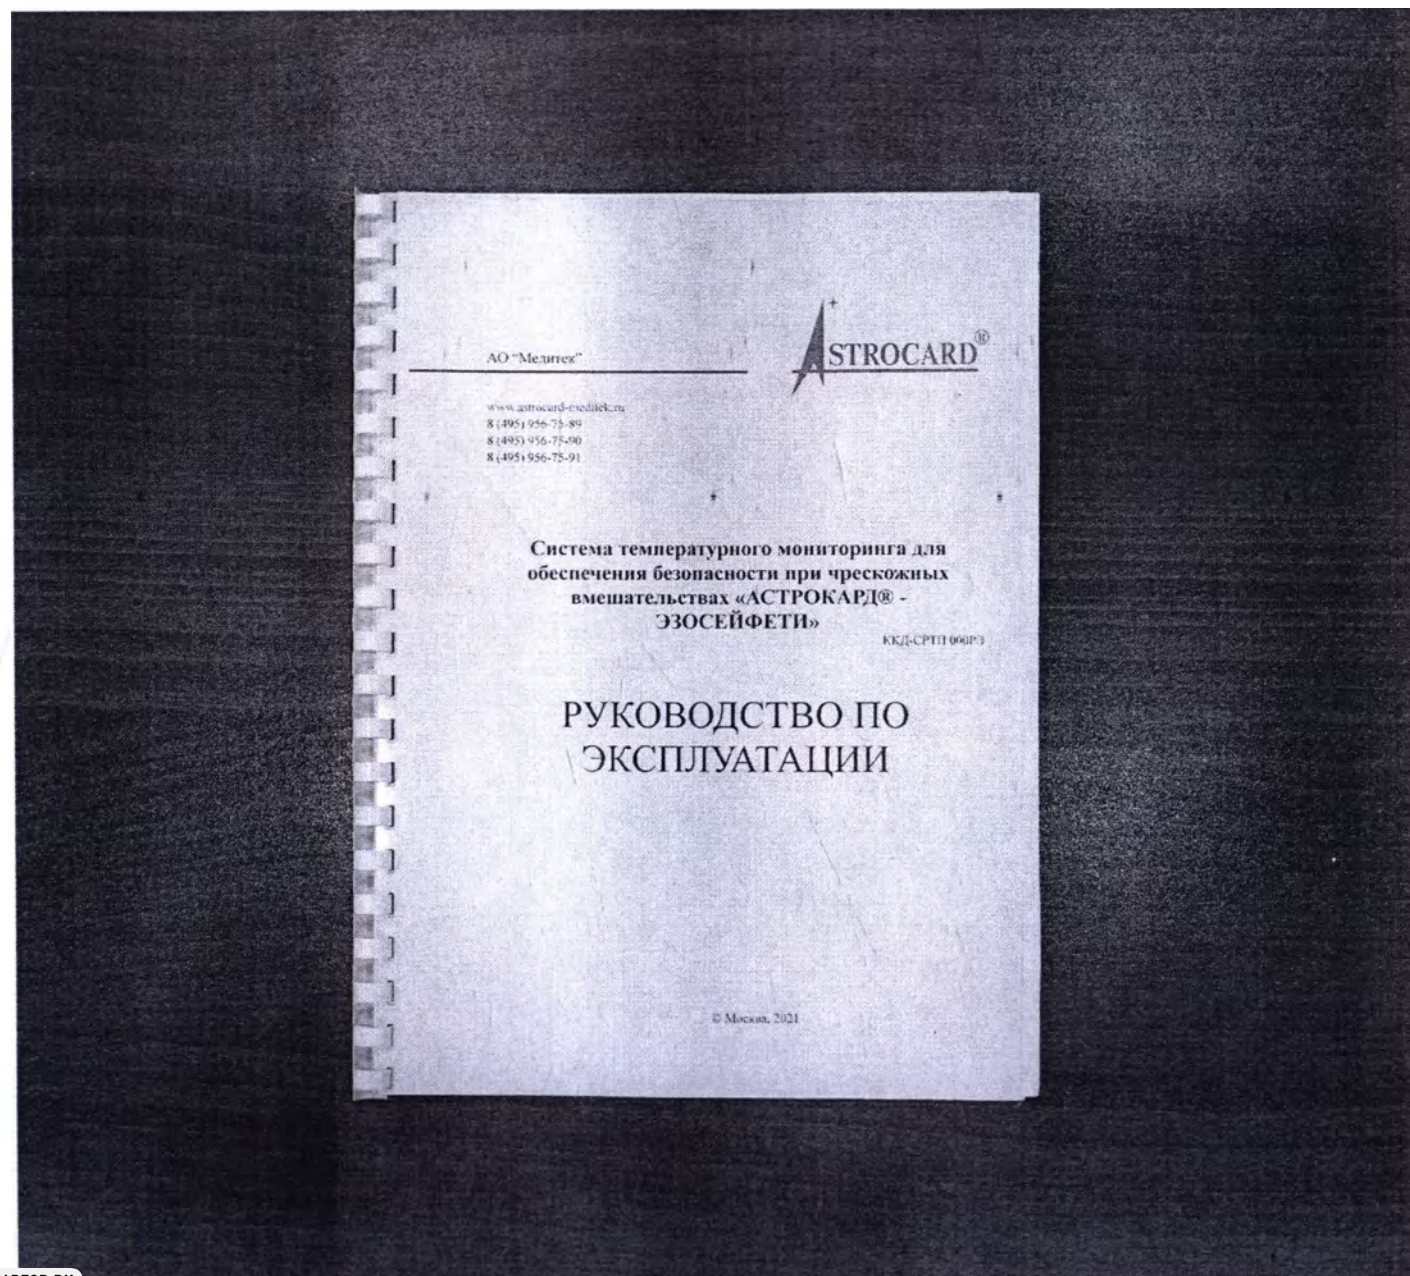

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью организации 12 (

двенадцать) листов.

Ген.директор  Бороздин М.Ю.




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «МЕДИТЕК»

М.Ю. Бороздин

"27" февраля 2023 г.

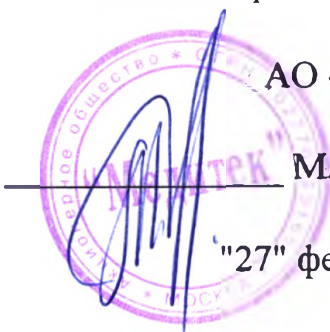

Фотографии маркировки медицинского изделия

**Система температурного мониторинга для обеспечения
безопасности при чрескожных вмешательствах
«АСТРОКАРД® - ЭЗОСЕЙФЕТИ»**

Рис. 1 Маркировка блока управления и индикации



Рис. 2 Маркировка блока регистрации температуры

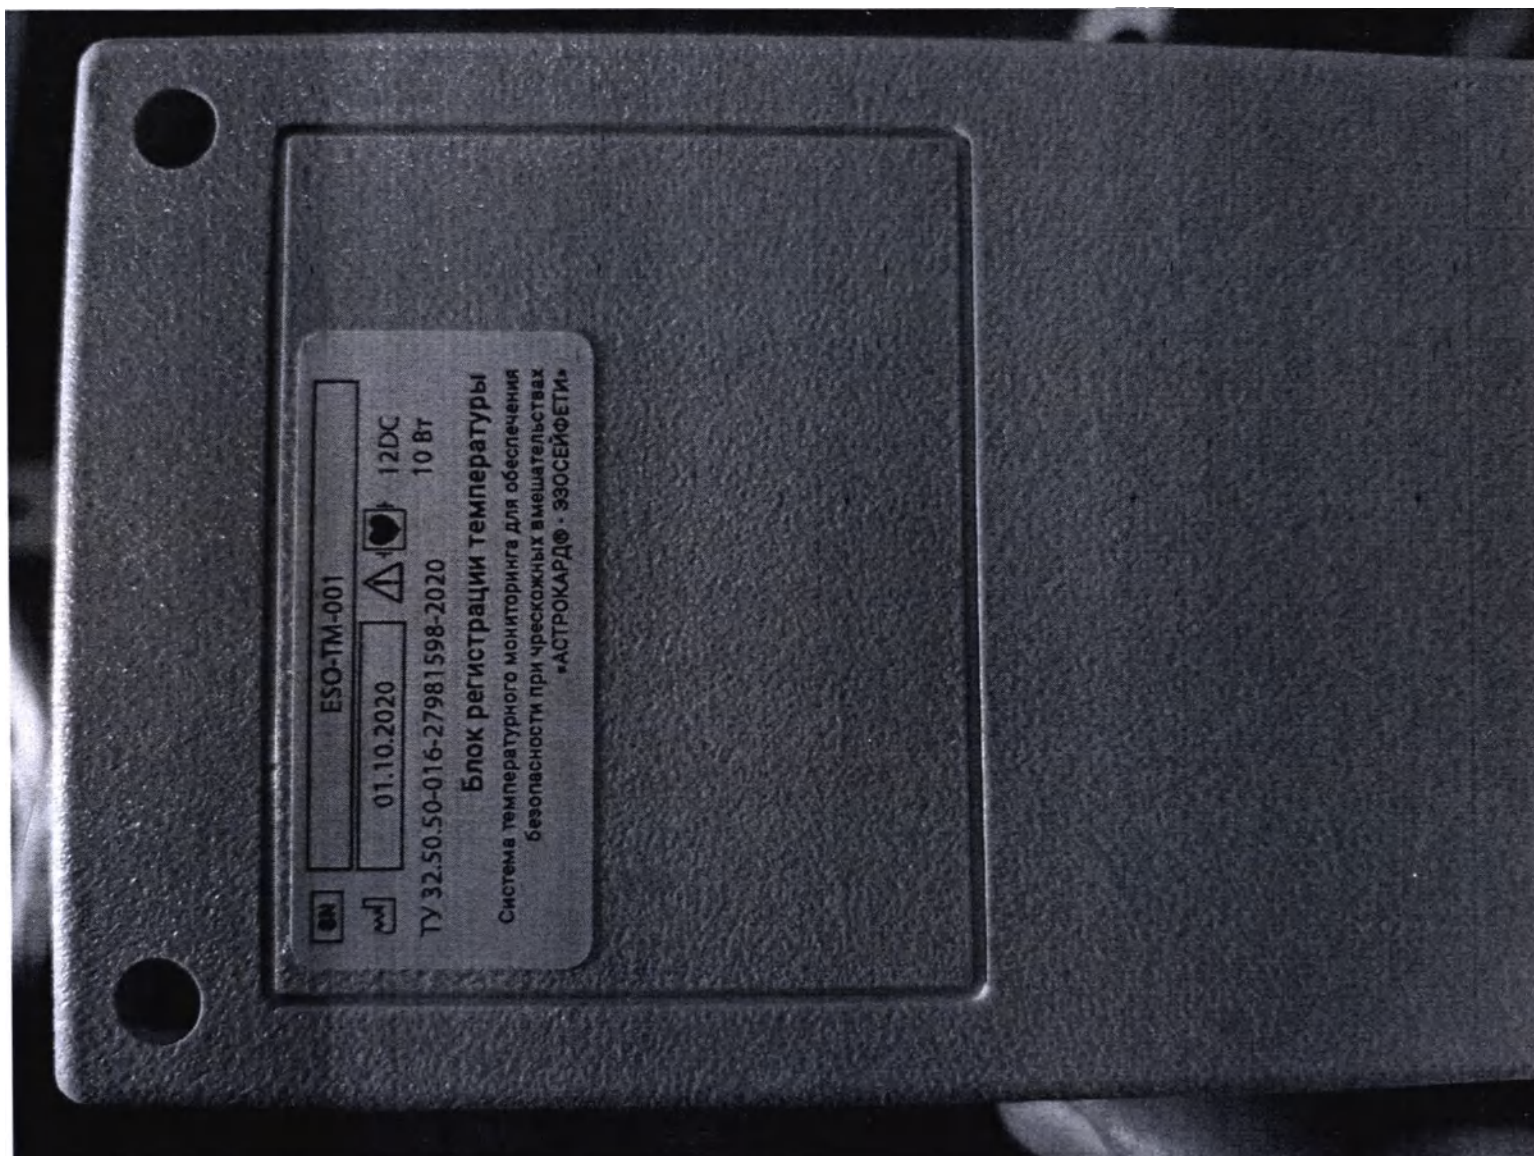


Рис. 3 Маркировка упаковки

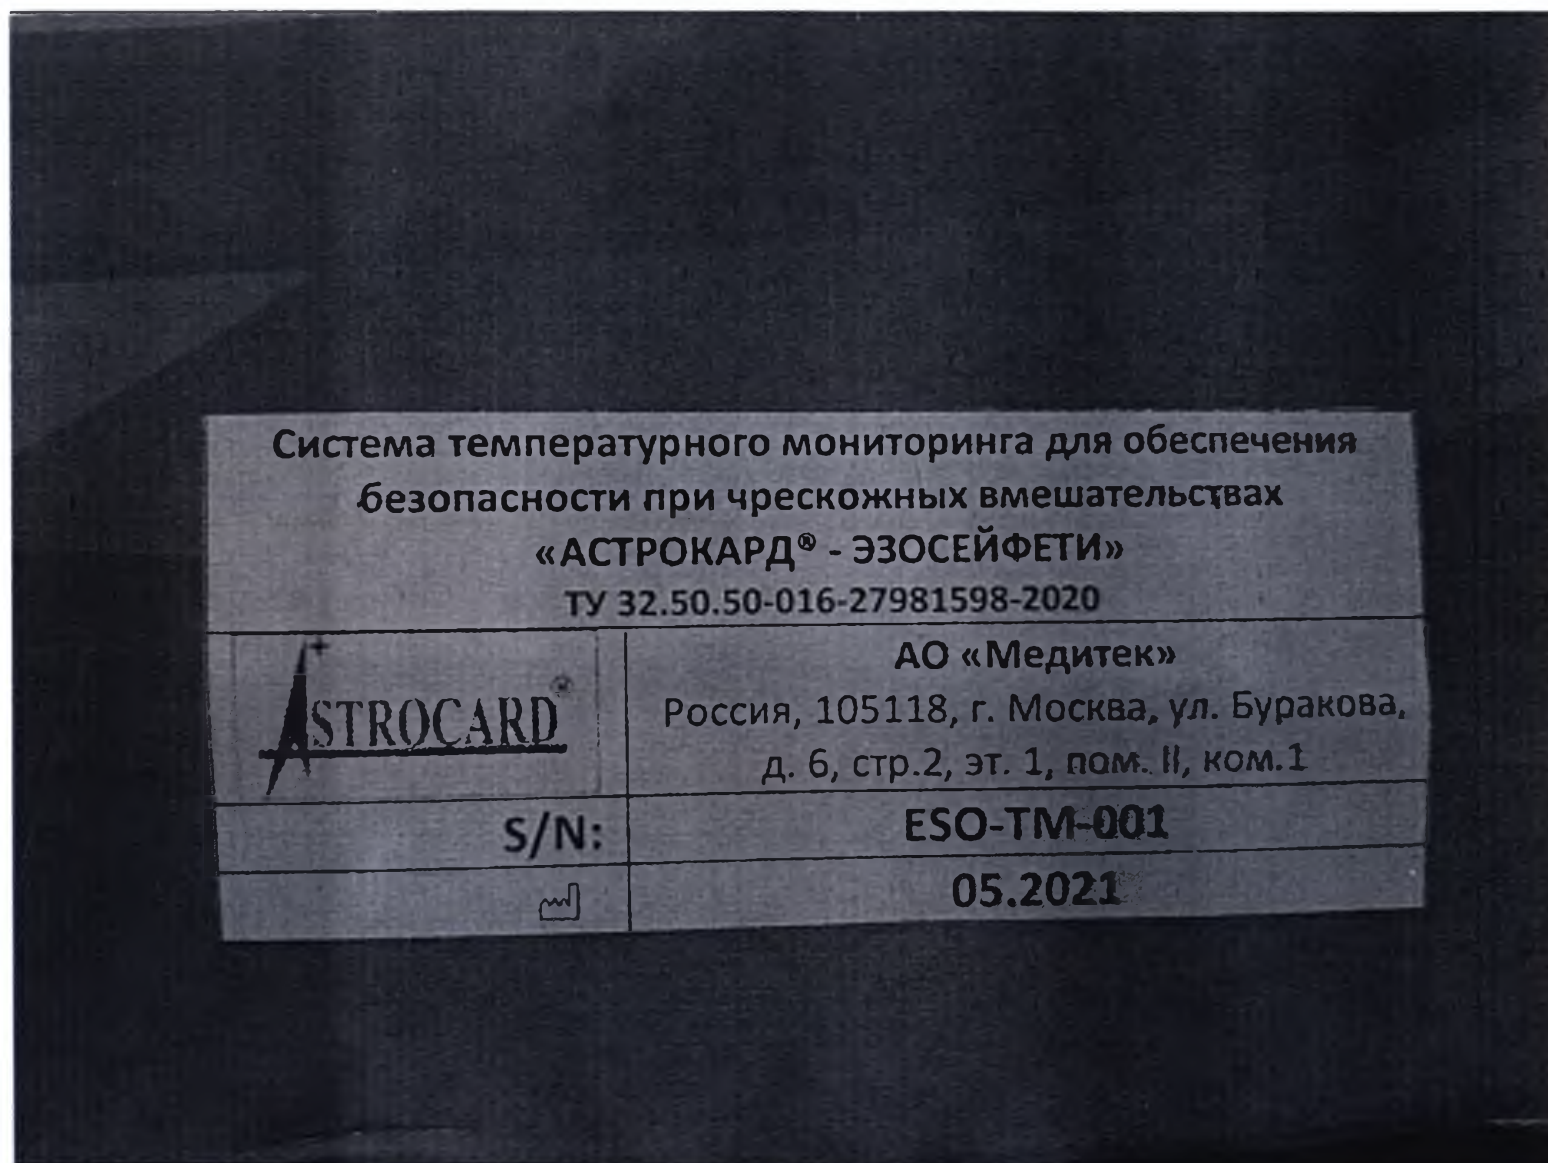


Рис. 4 Маркировка упаковки катетера пищеводного



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью организации, 5 (

пять

) листов

Ген.директор

Бороздин М.Ю

