

**Система инфракрасной коагуляции тканей
«Юни-тек»
по ТУ 26.60.12-001-06761148-2017,
в составе, с принадлежностями**

Фотографические изображения

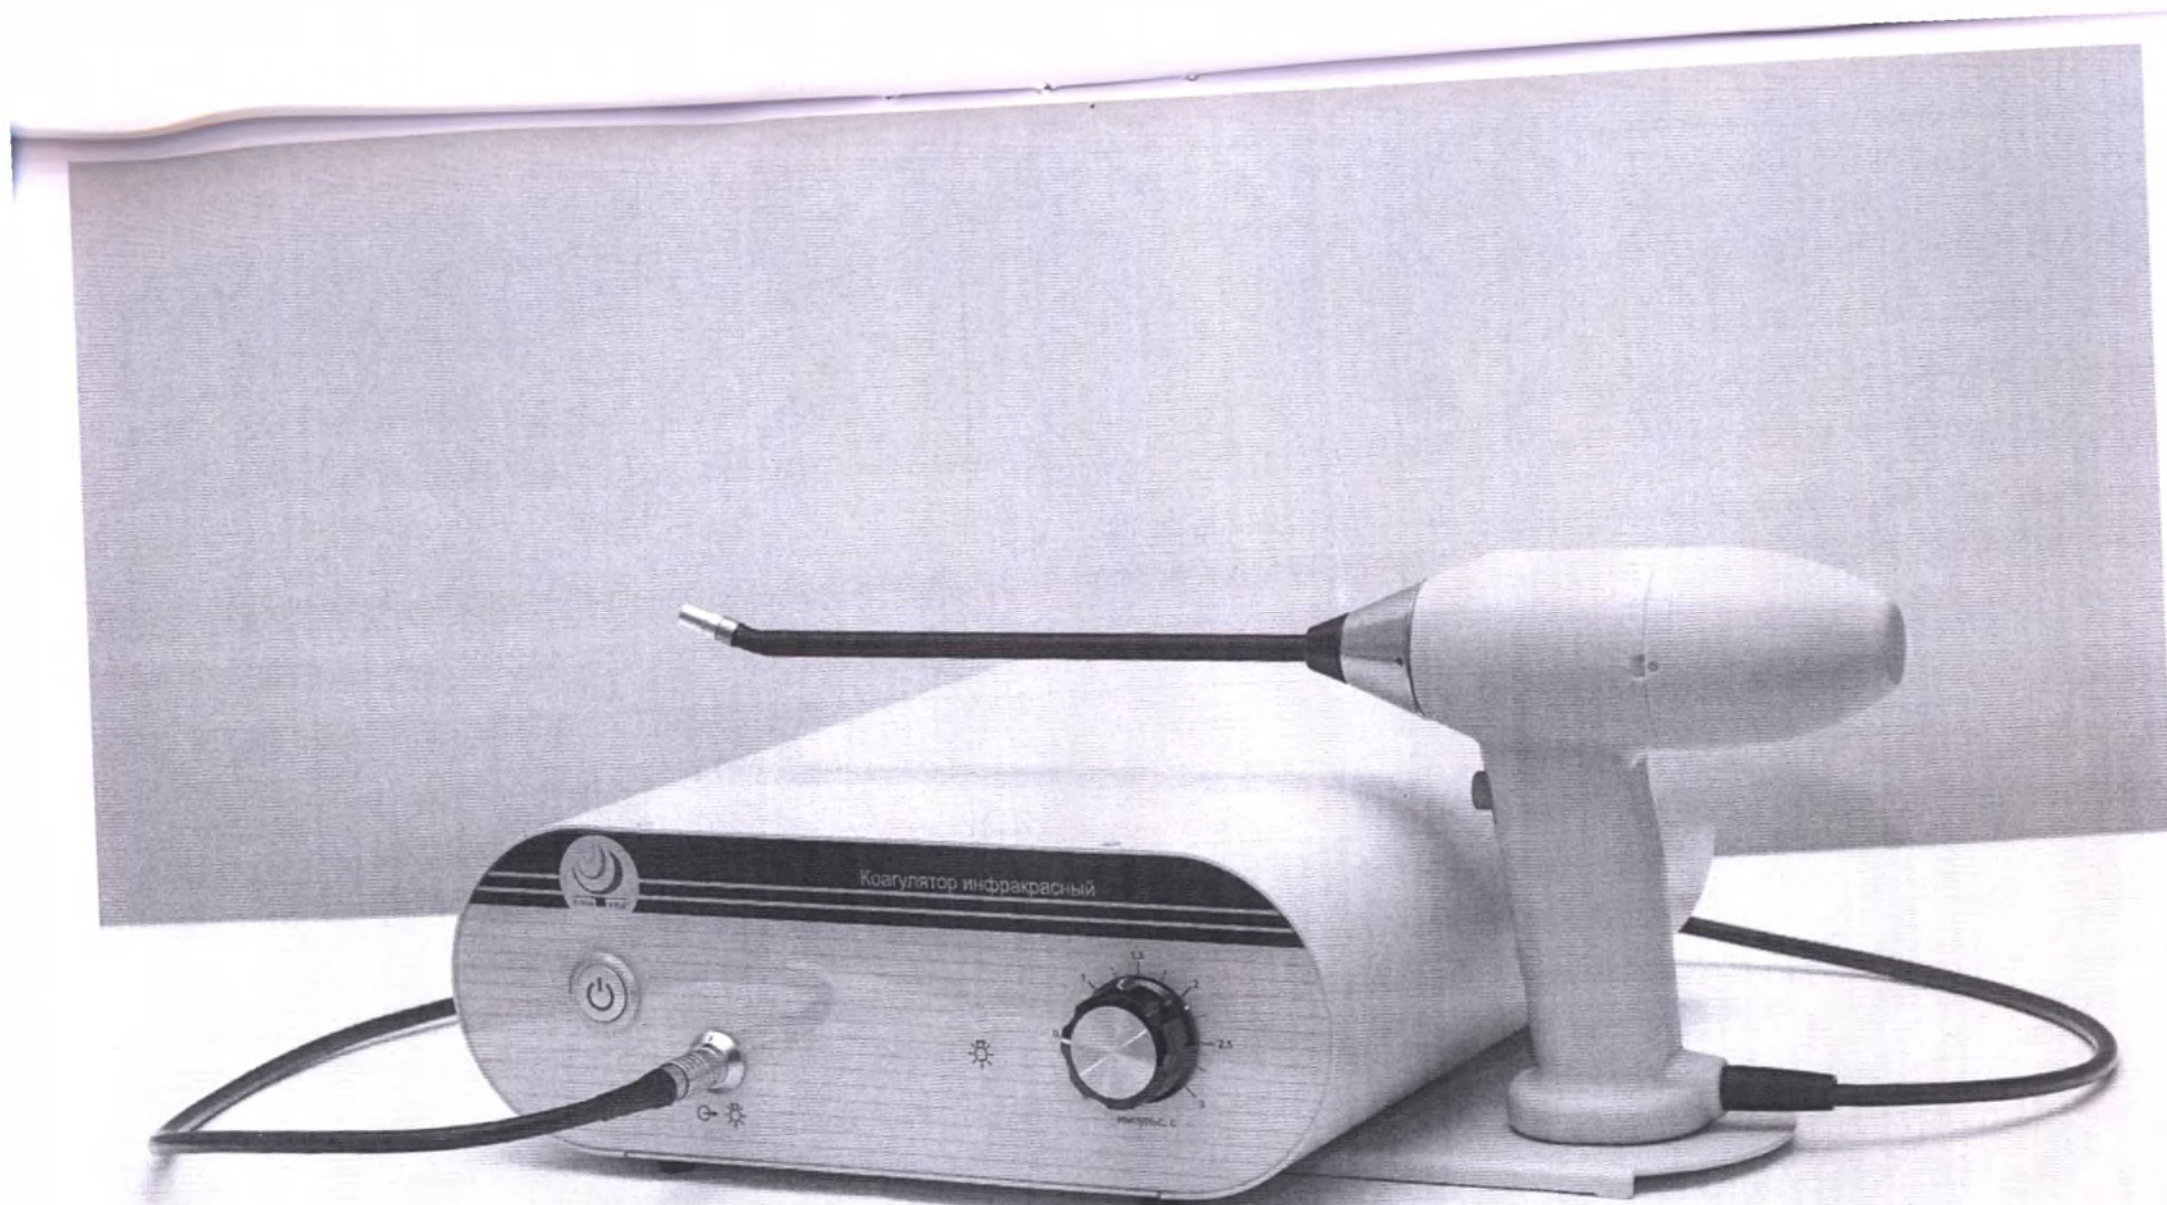


Рис. 1 – Система инфракрасной коагуляции тканей «Юни-тек» по ТУ 26.60.12-001-06761148-2017, в составе, с принадлежностями

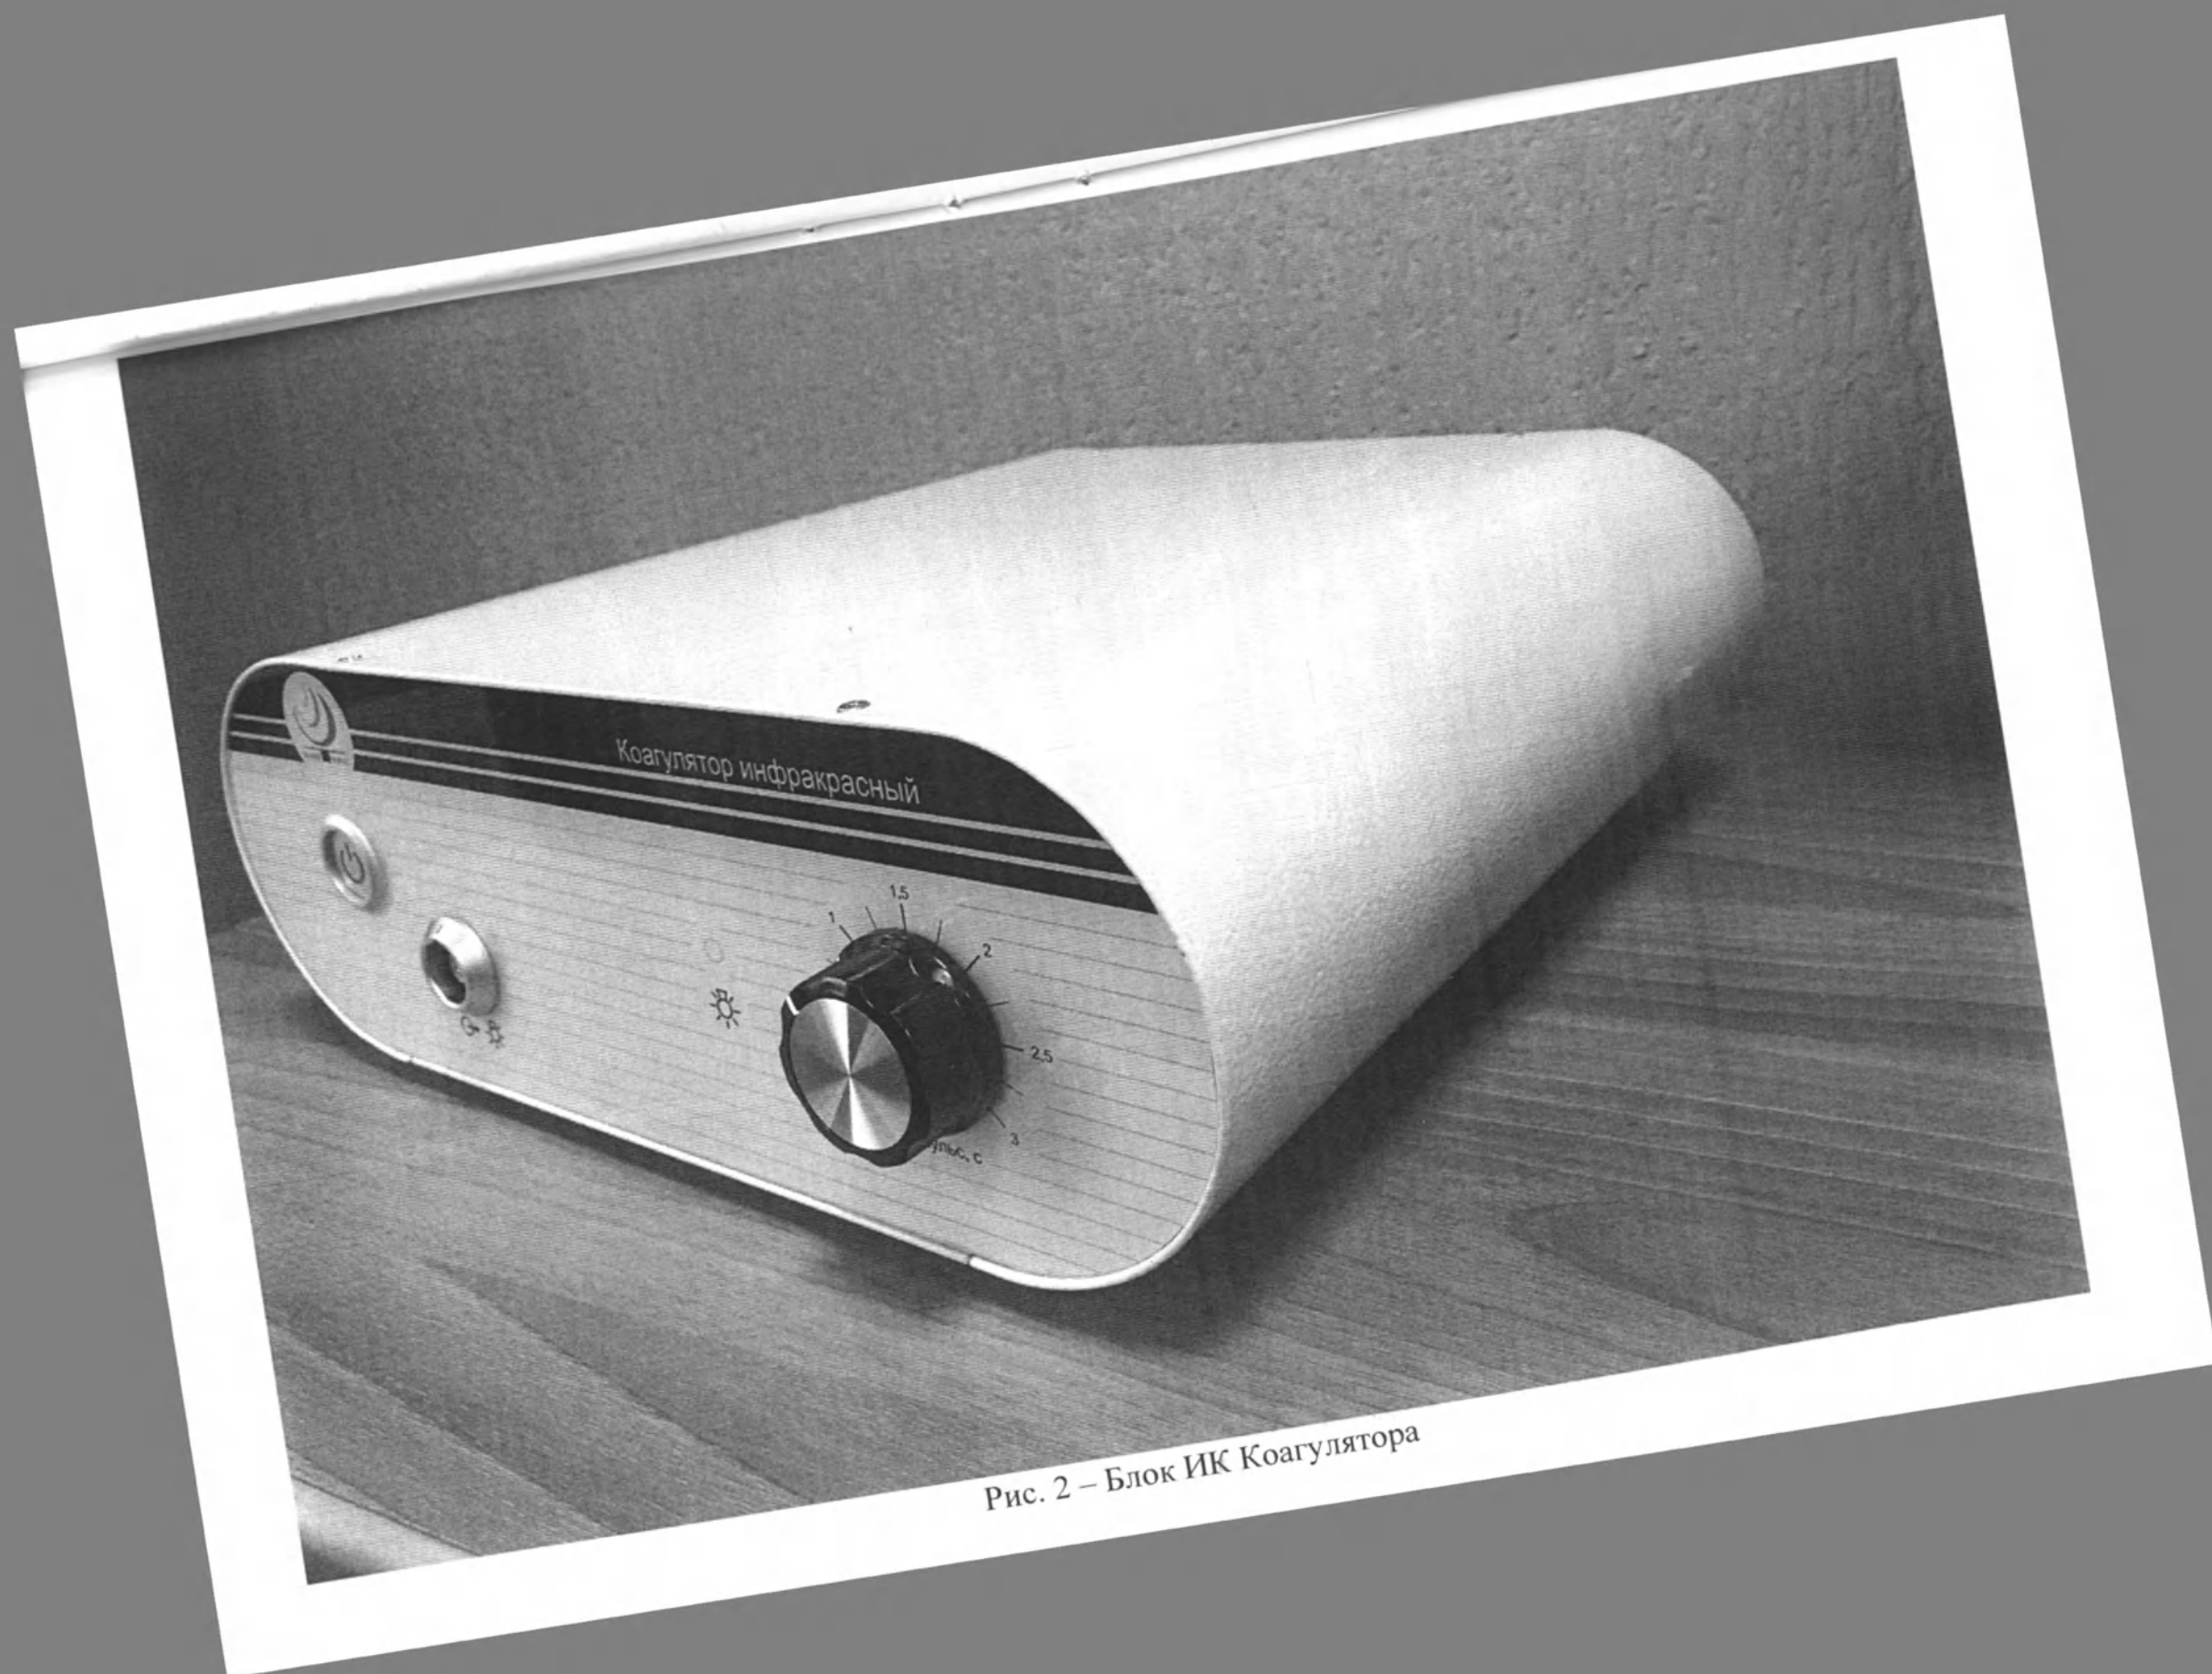


Рис. 2 – Блок ИК Коагулятора



Рис. 3 – Аппликатор ручной

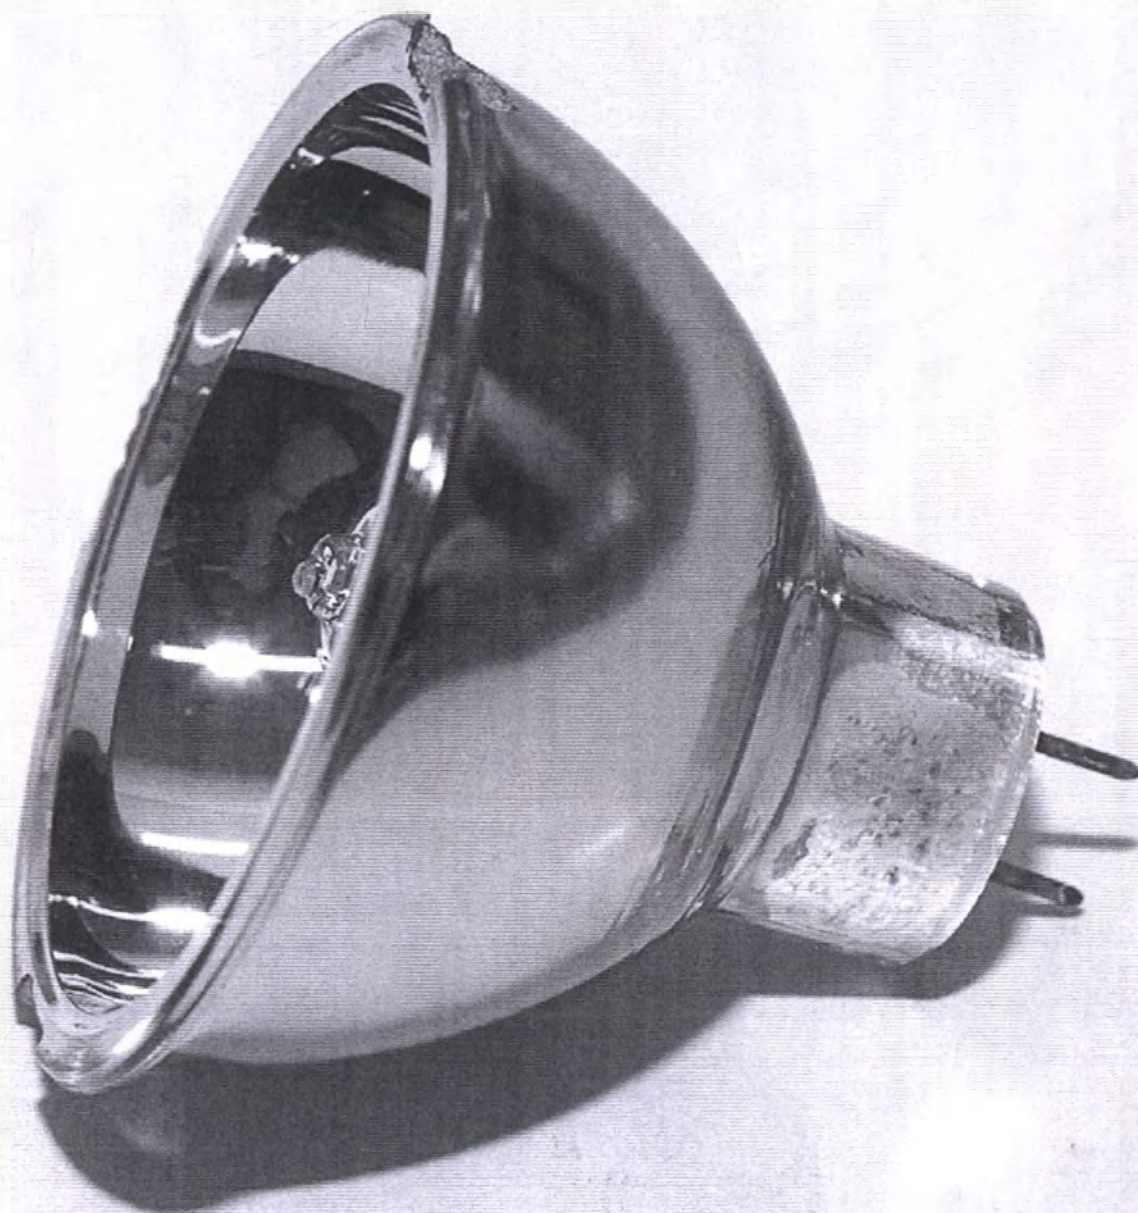


Рис. 4 – Лампа

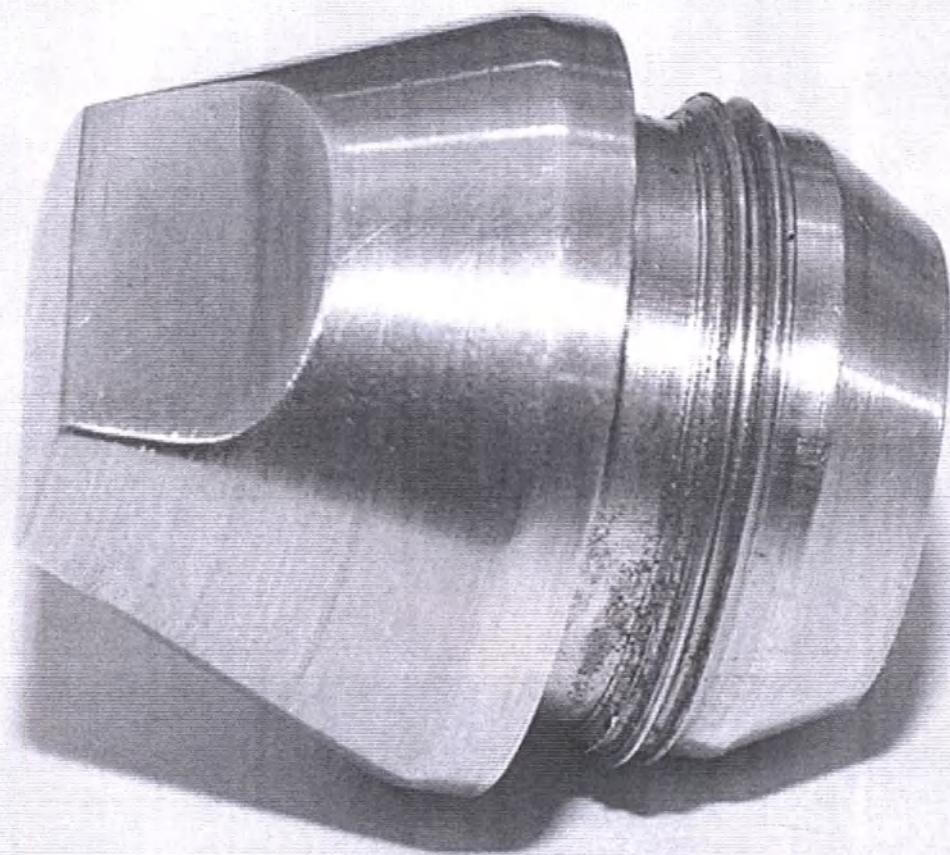


Рис. 5 – Колпачок

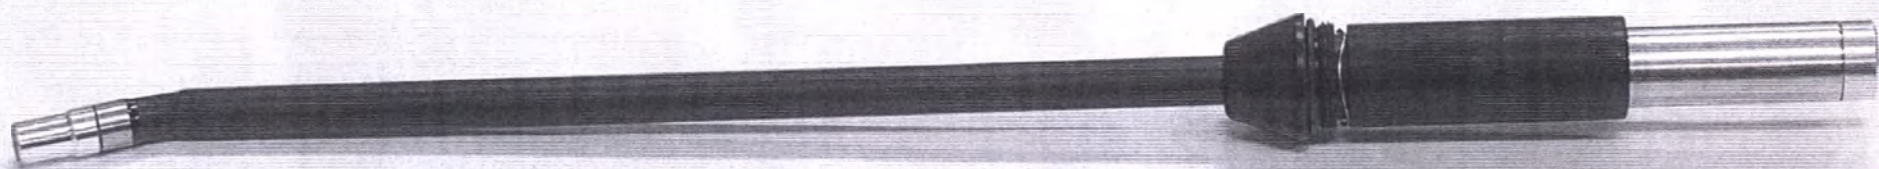


Рис. 6 – Световод жесткий $\varnothing$ 2 мм, 4 мм, 6 мм, 10 мм.

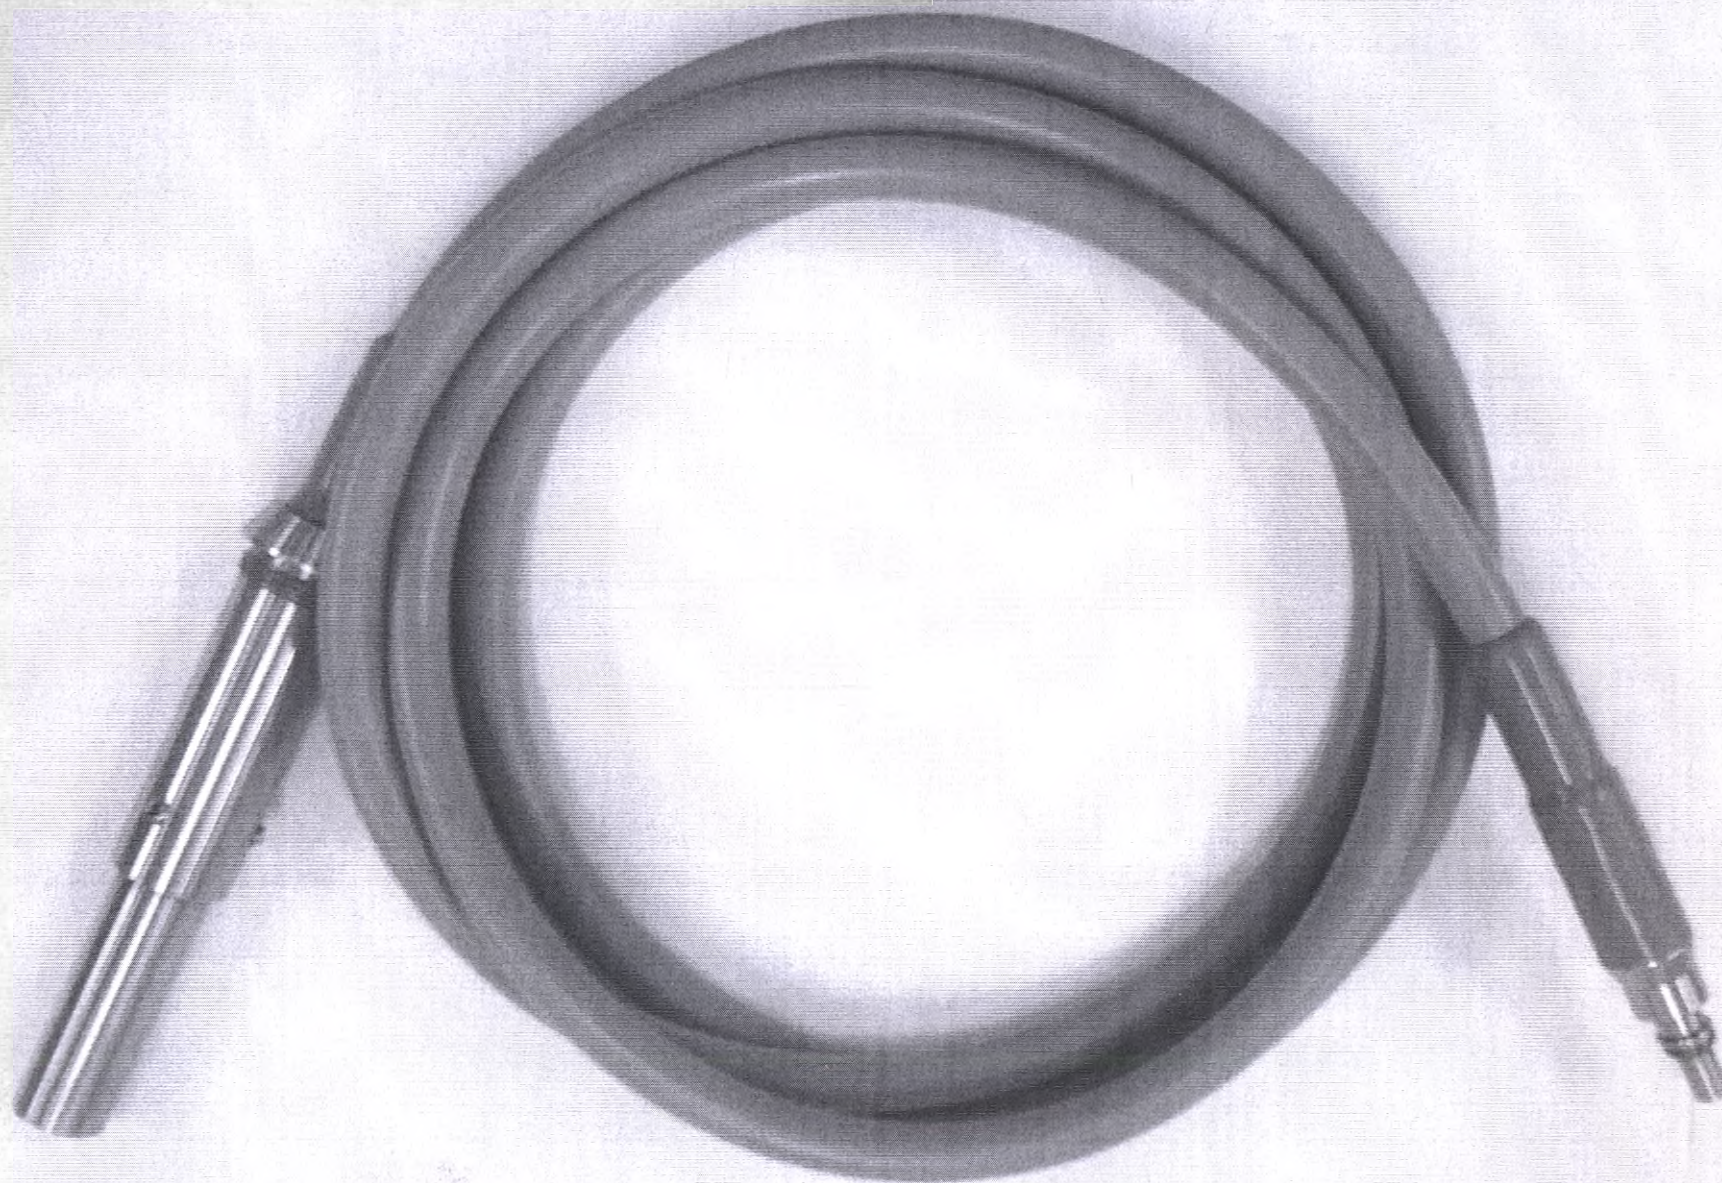
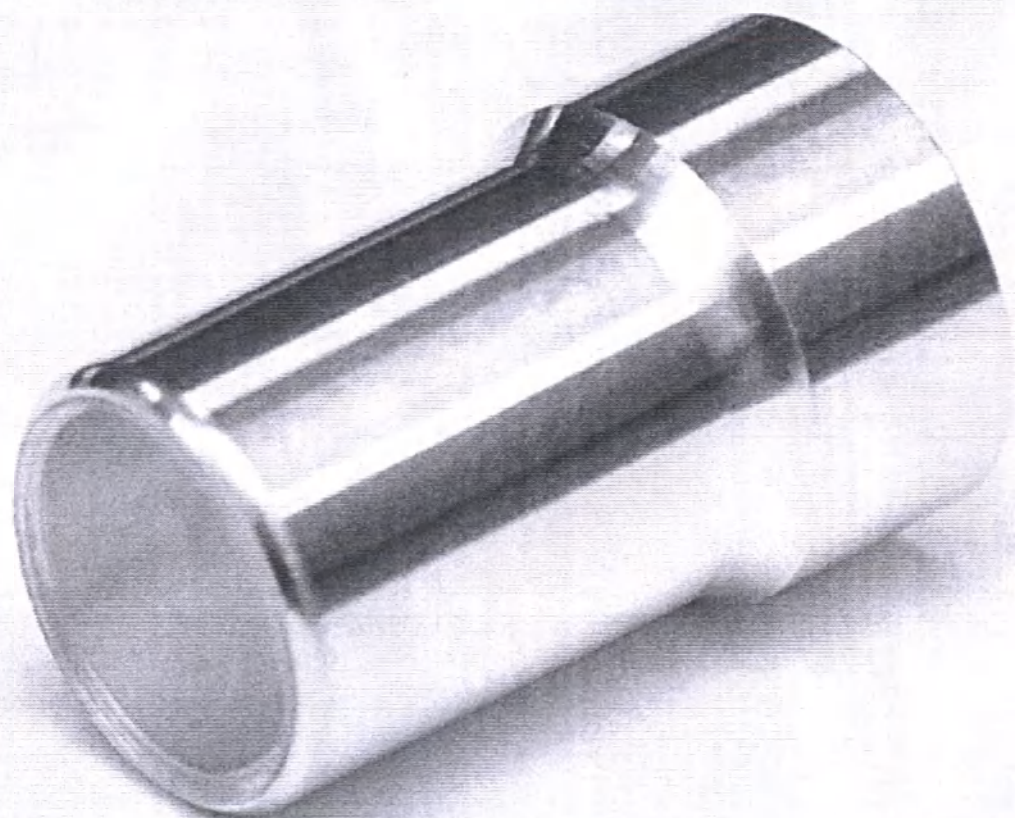


Рис. 7 – Световод фиброволоконный $\varnothing$ 3,5 мм, 5 мм



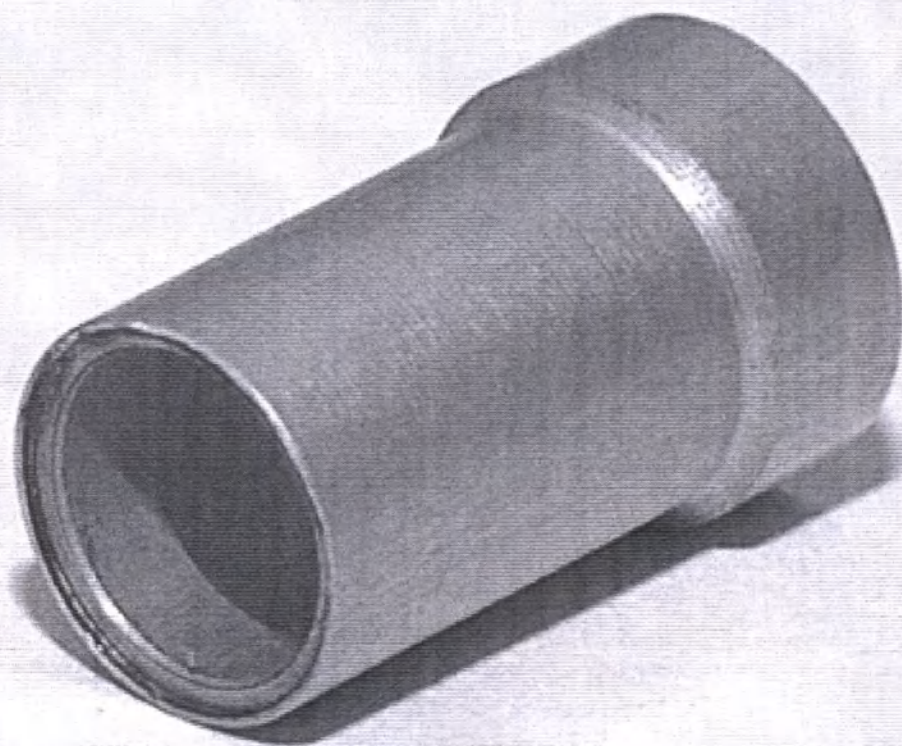


Рис. 9 – Наконечник для световода сапфировый $\varnothing$ 2 мм, 4 мм, 6 мм, 10 мм

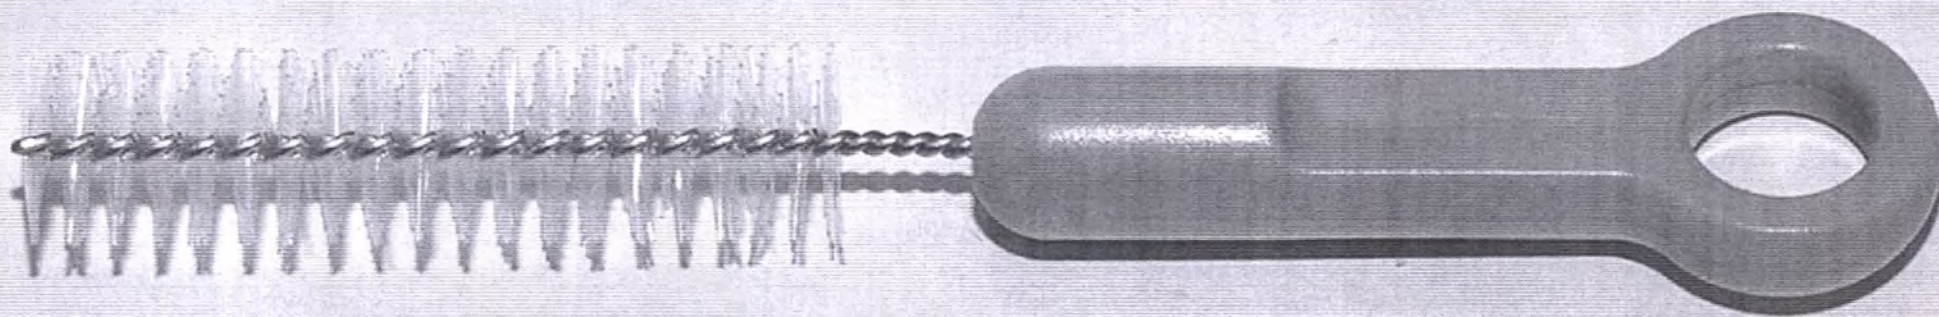


Рис. 10 – Щетка

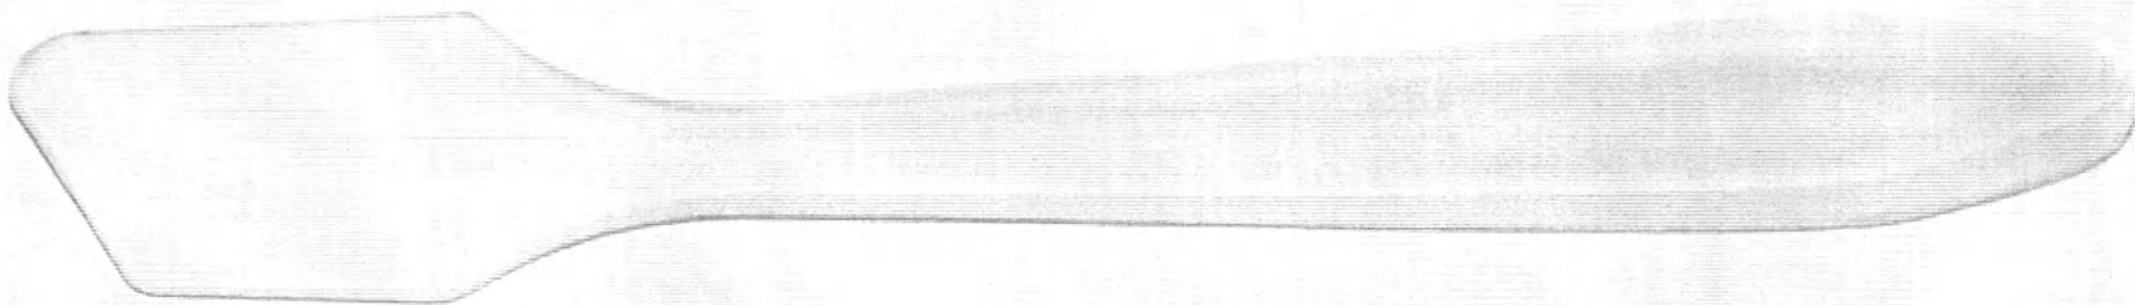


Рис. 11 – Лопатка

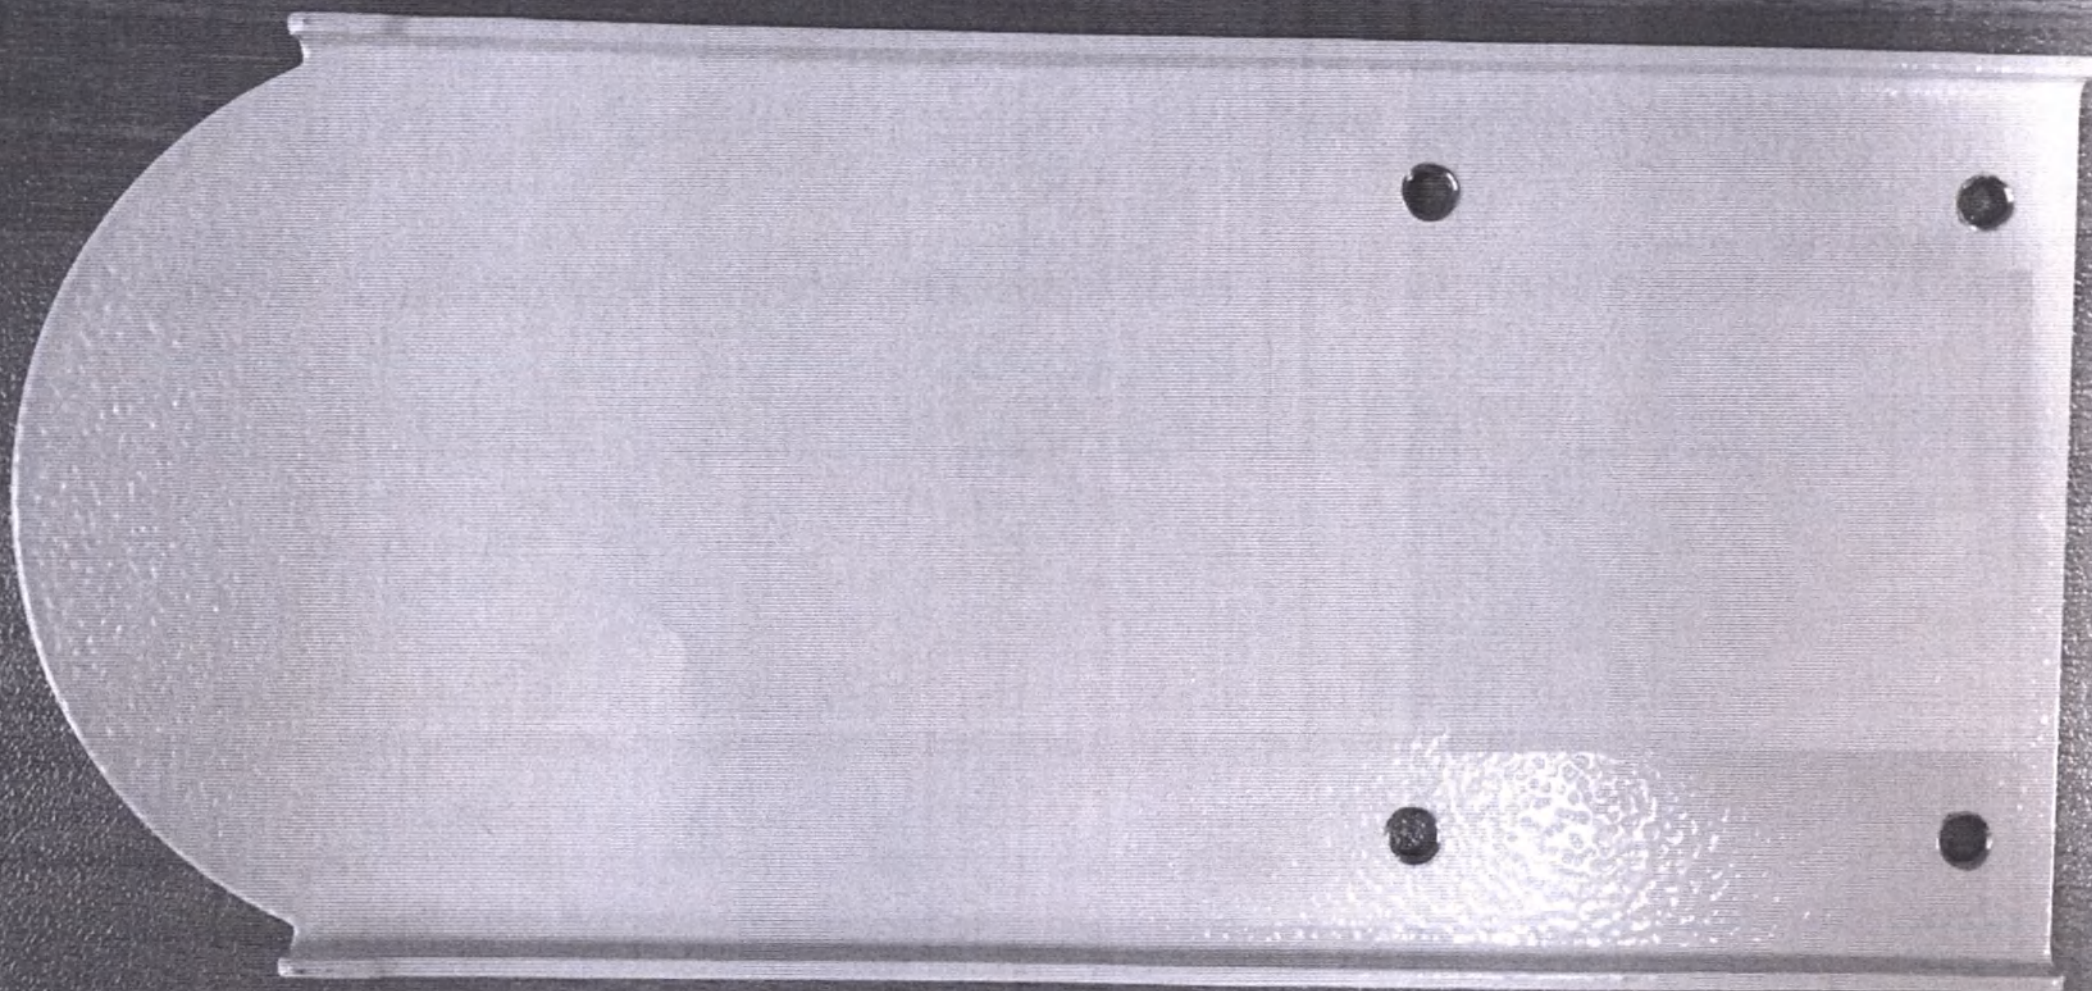


Рис. 12 – Держатель аппликатора

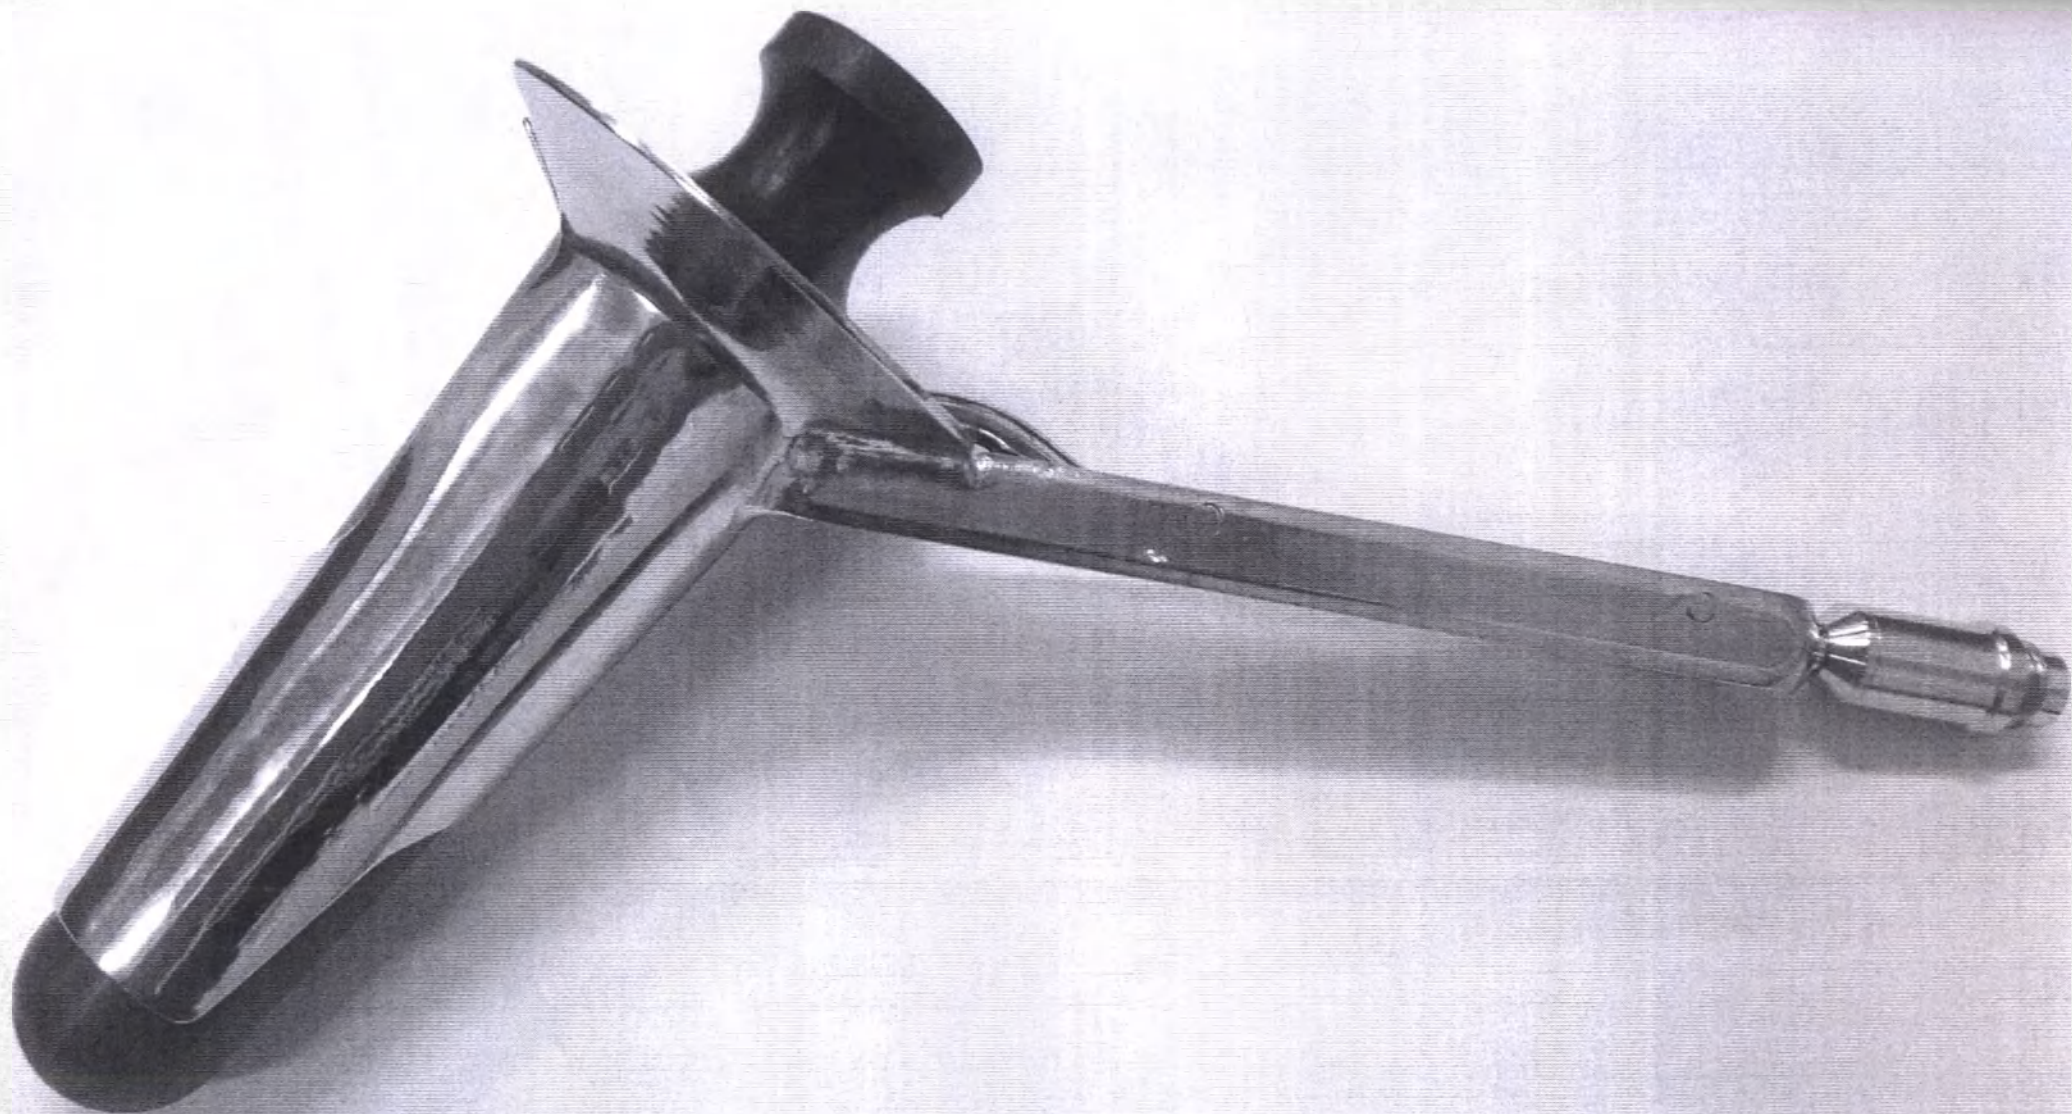
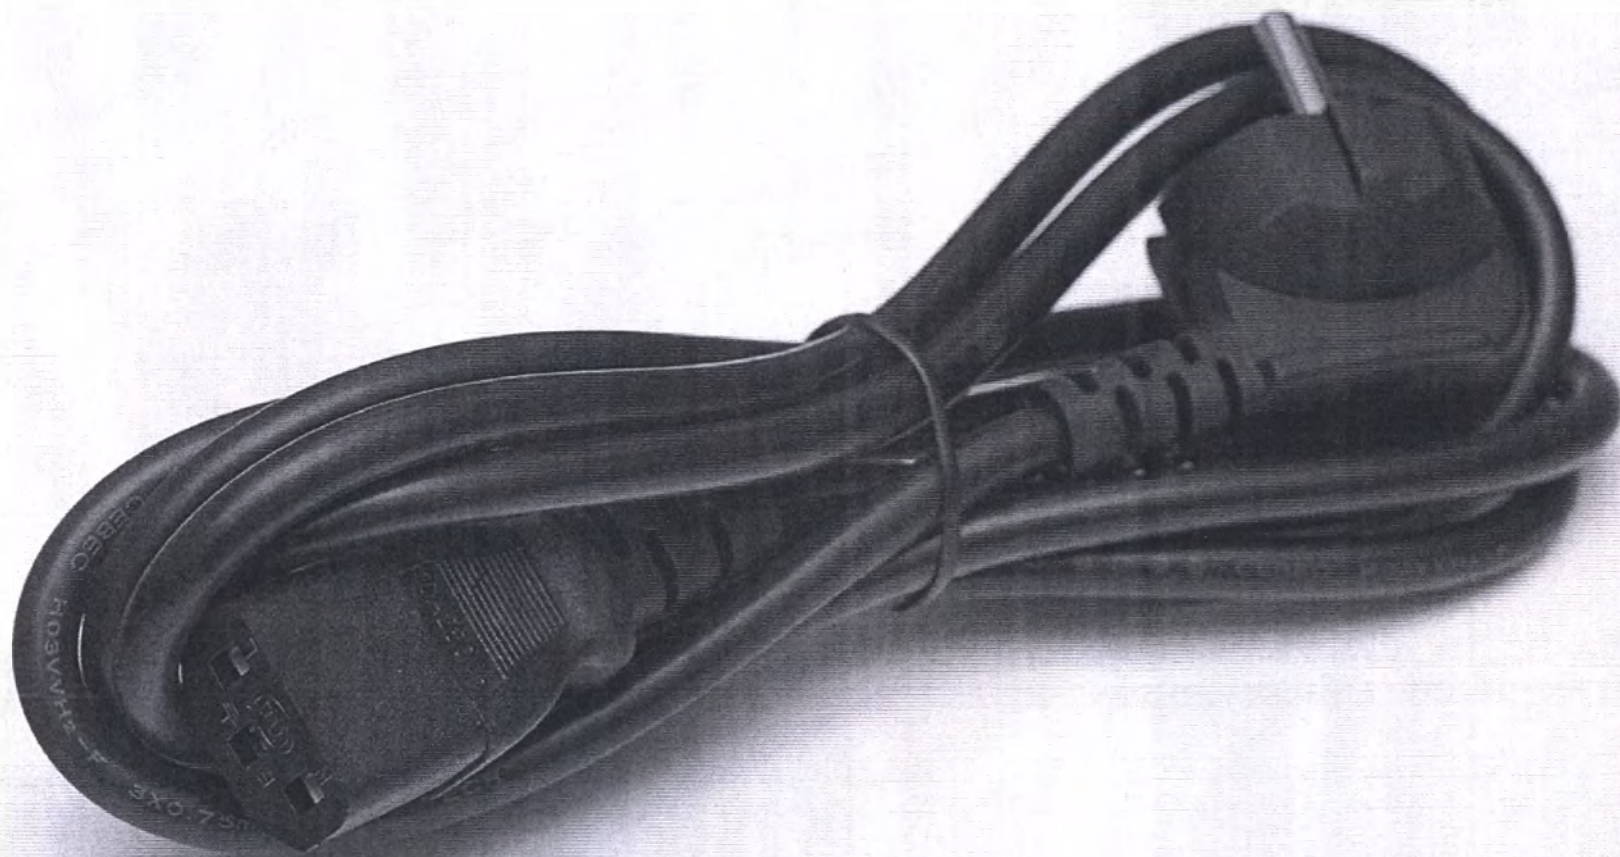


Рис. 13 – Аноскоп



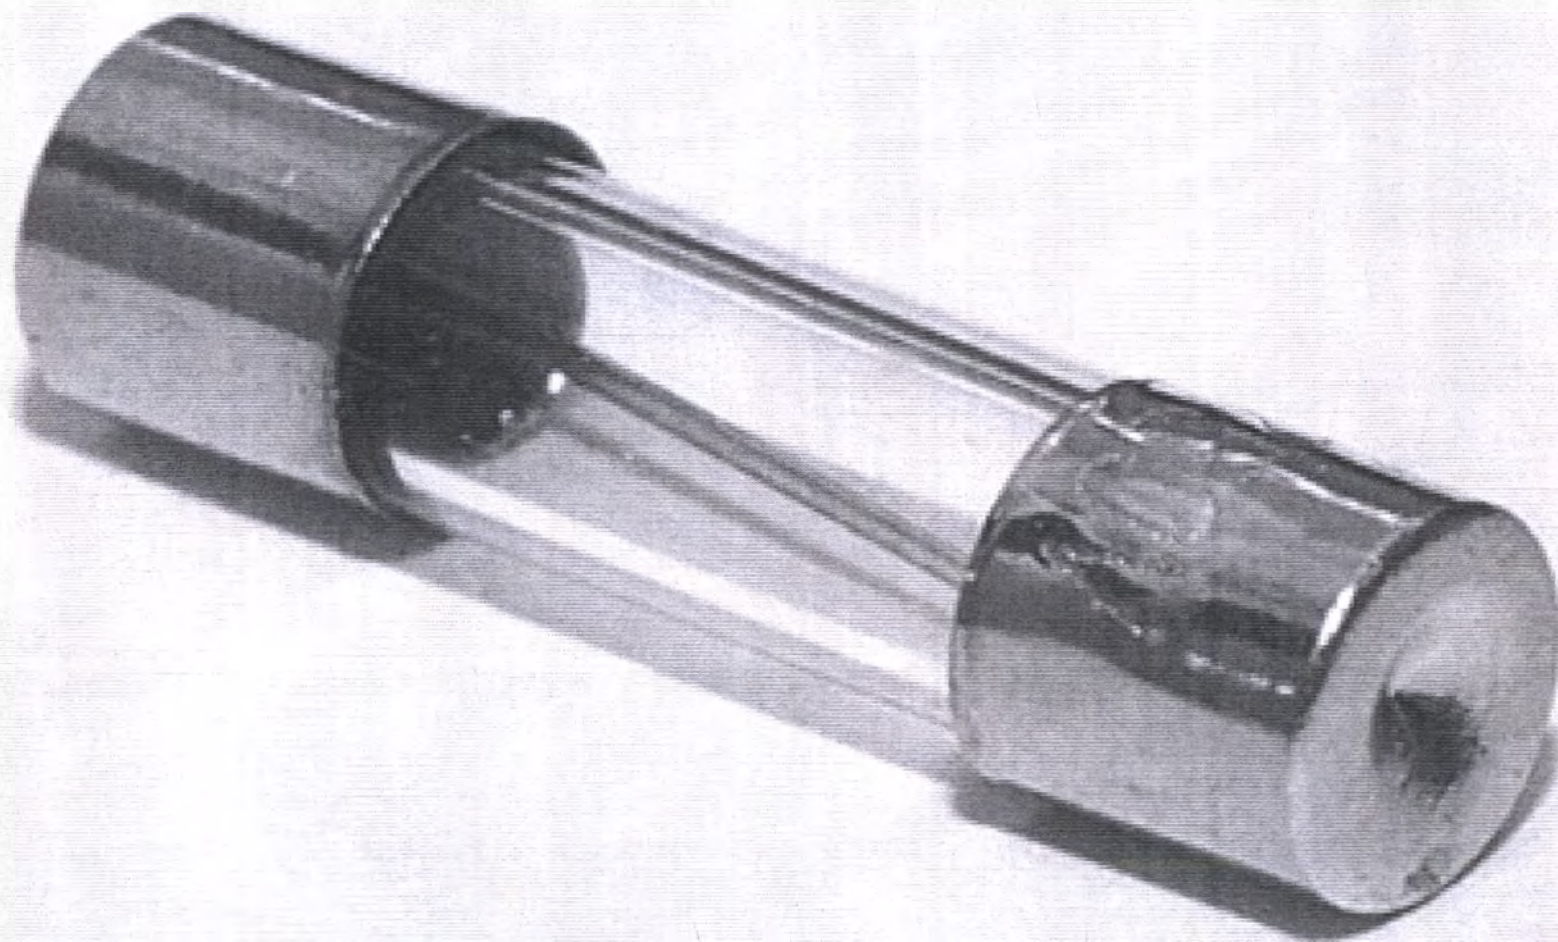


Рис. 15 – Предохранитель ВП1-2 (1,6А)

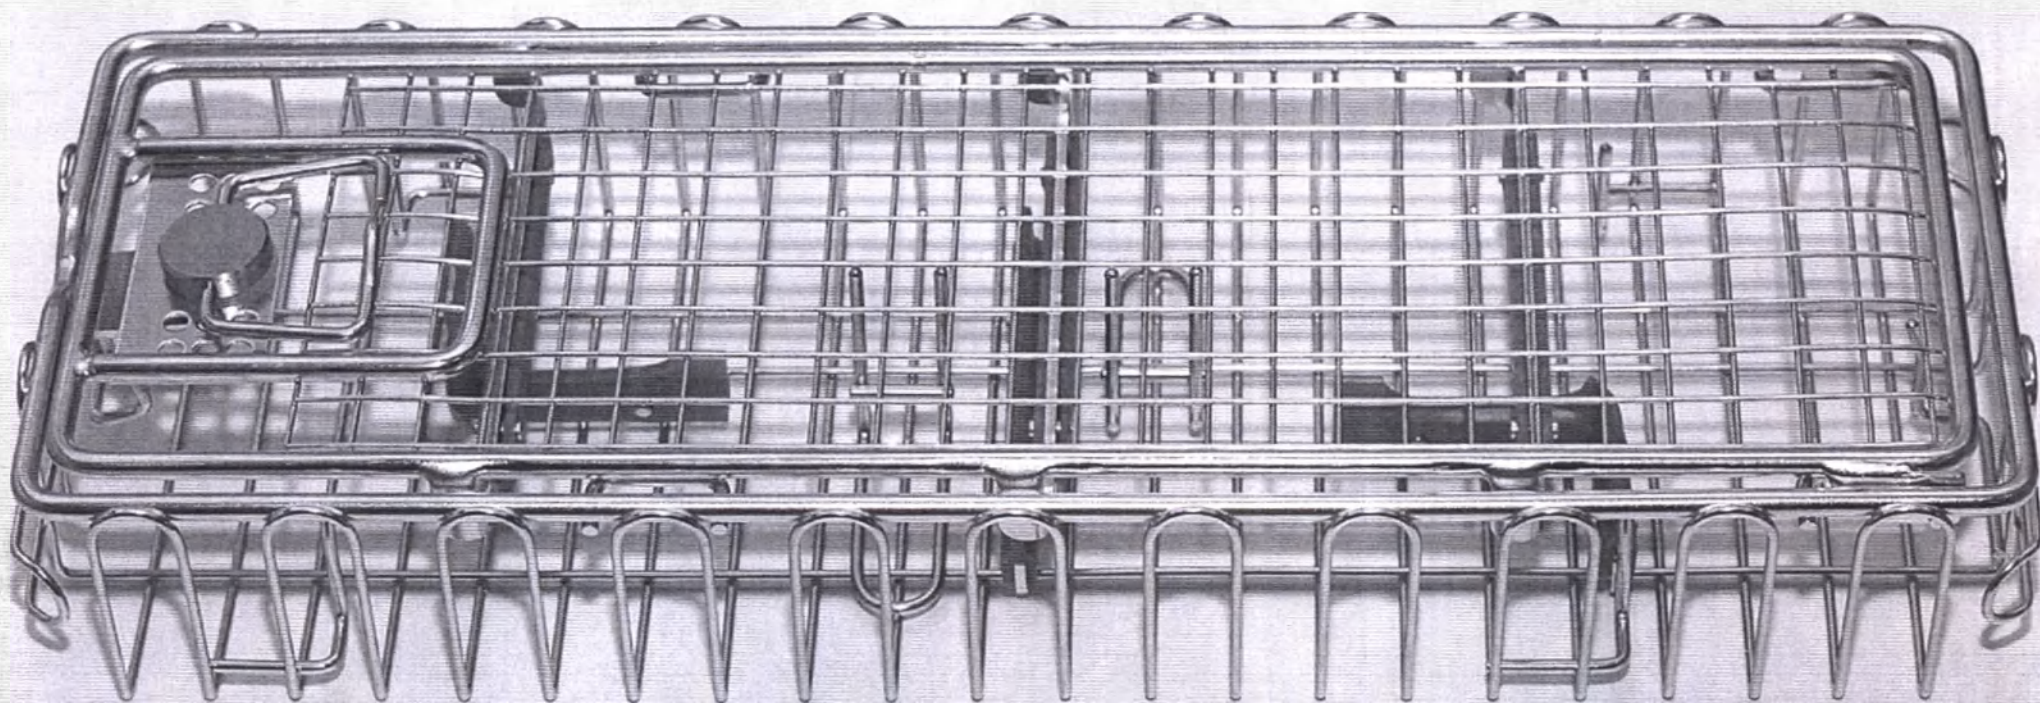


Рис. 16 – Камера-укладка



Рис. 17 – Кольца латексные


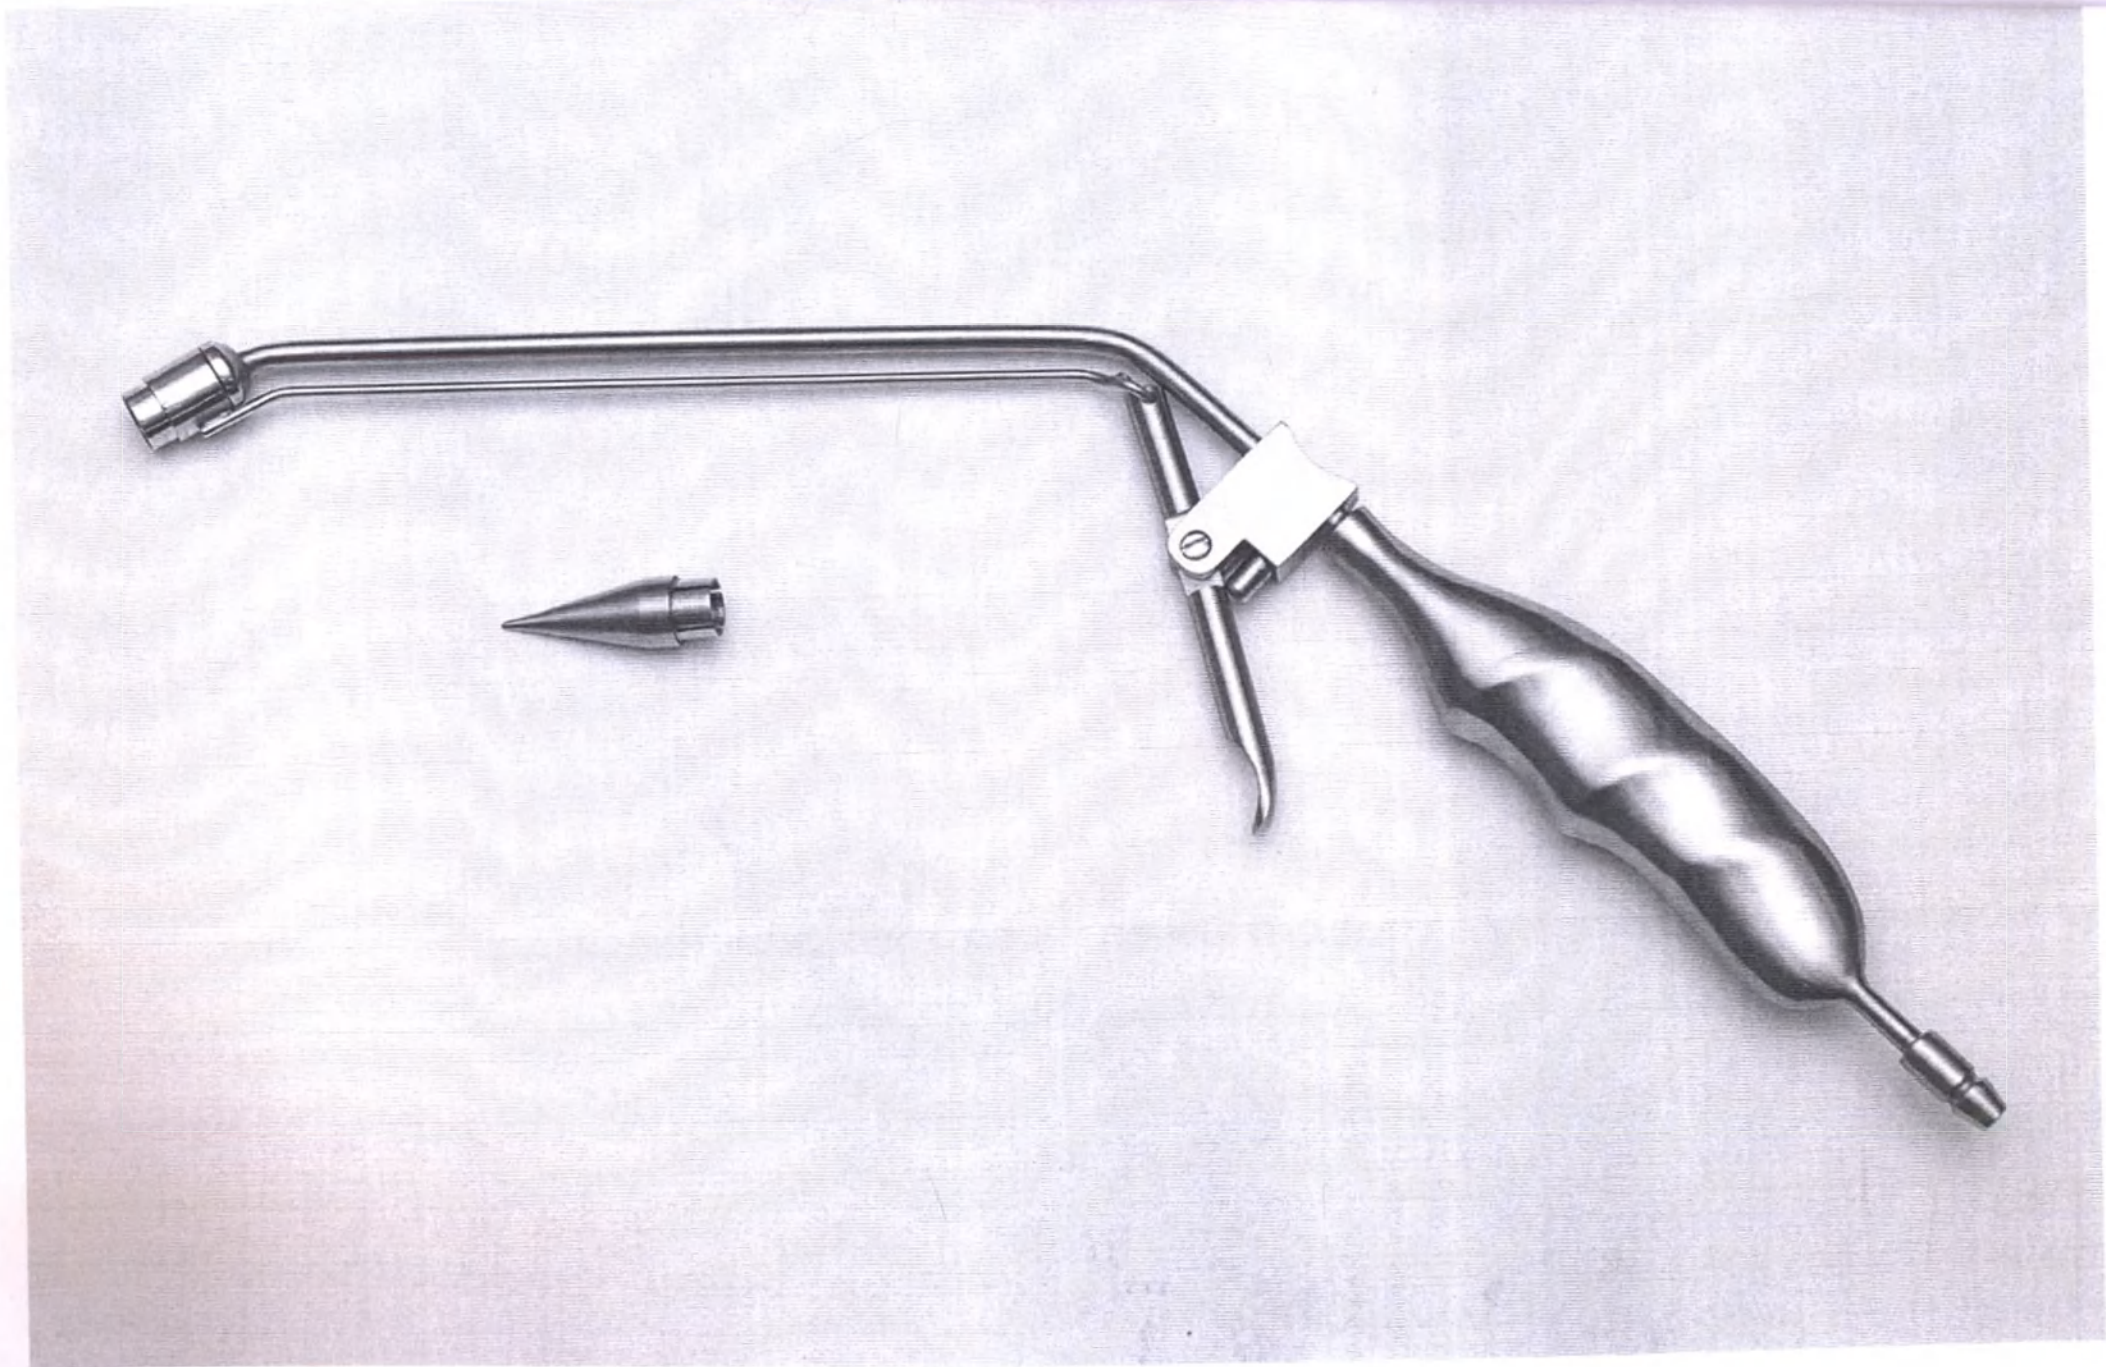


Рис. 18 – Аппликатор для наложения колец

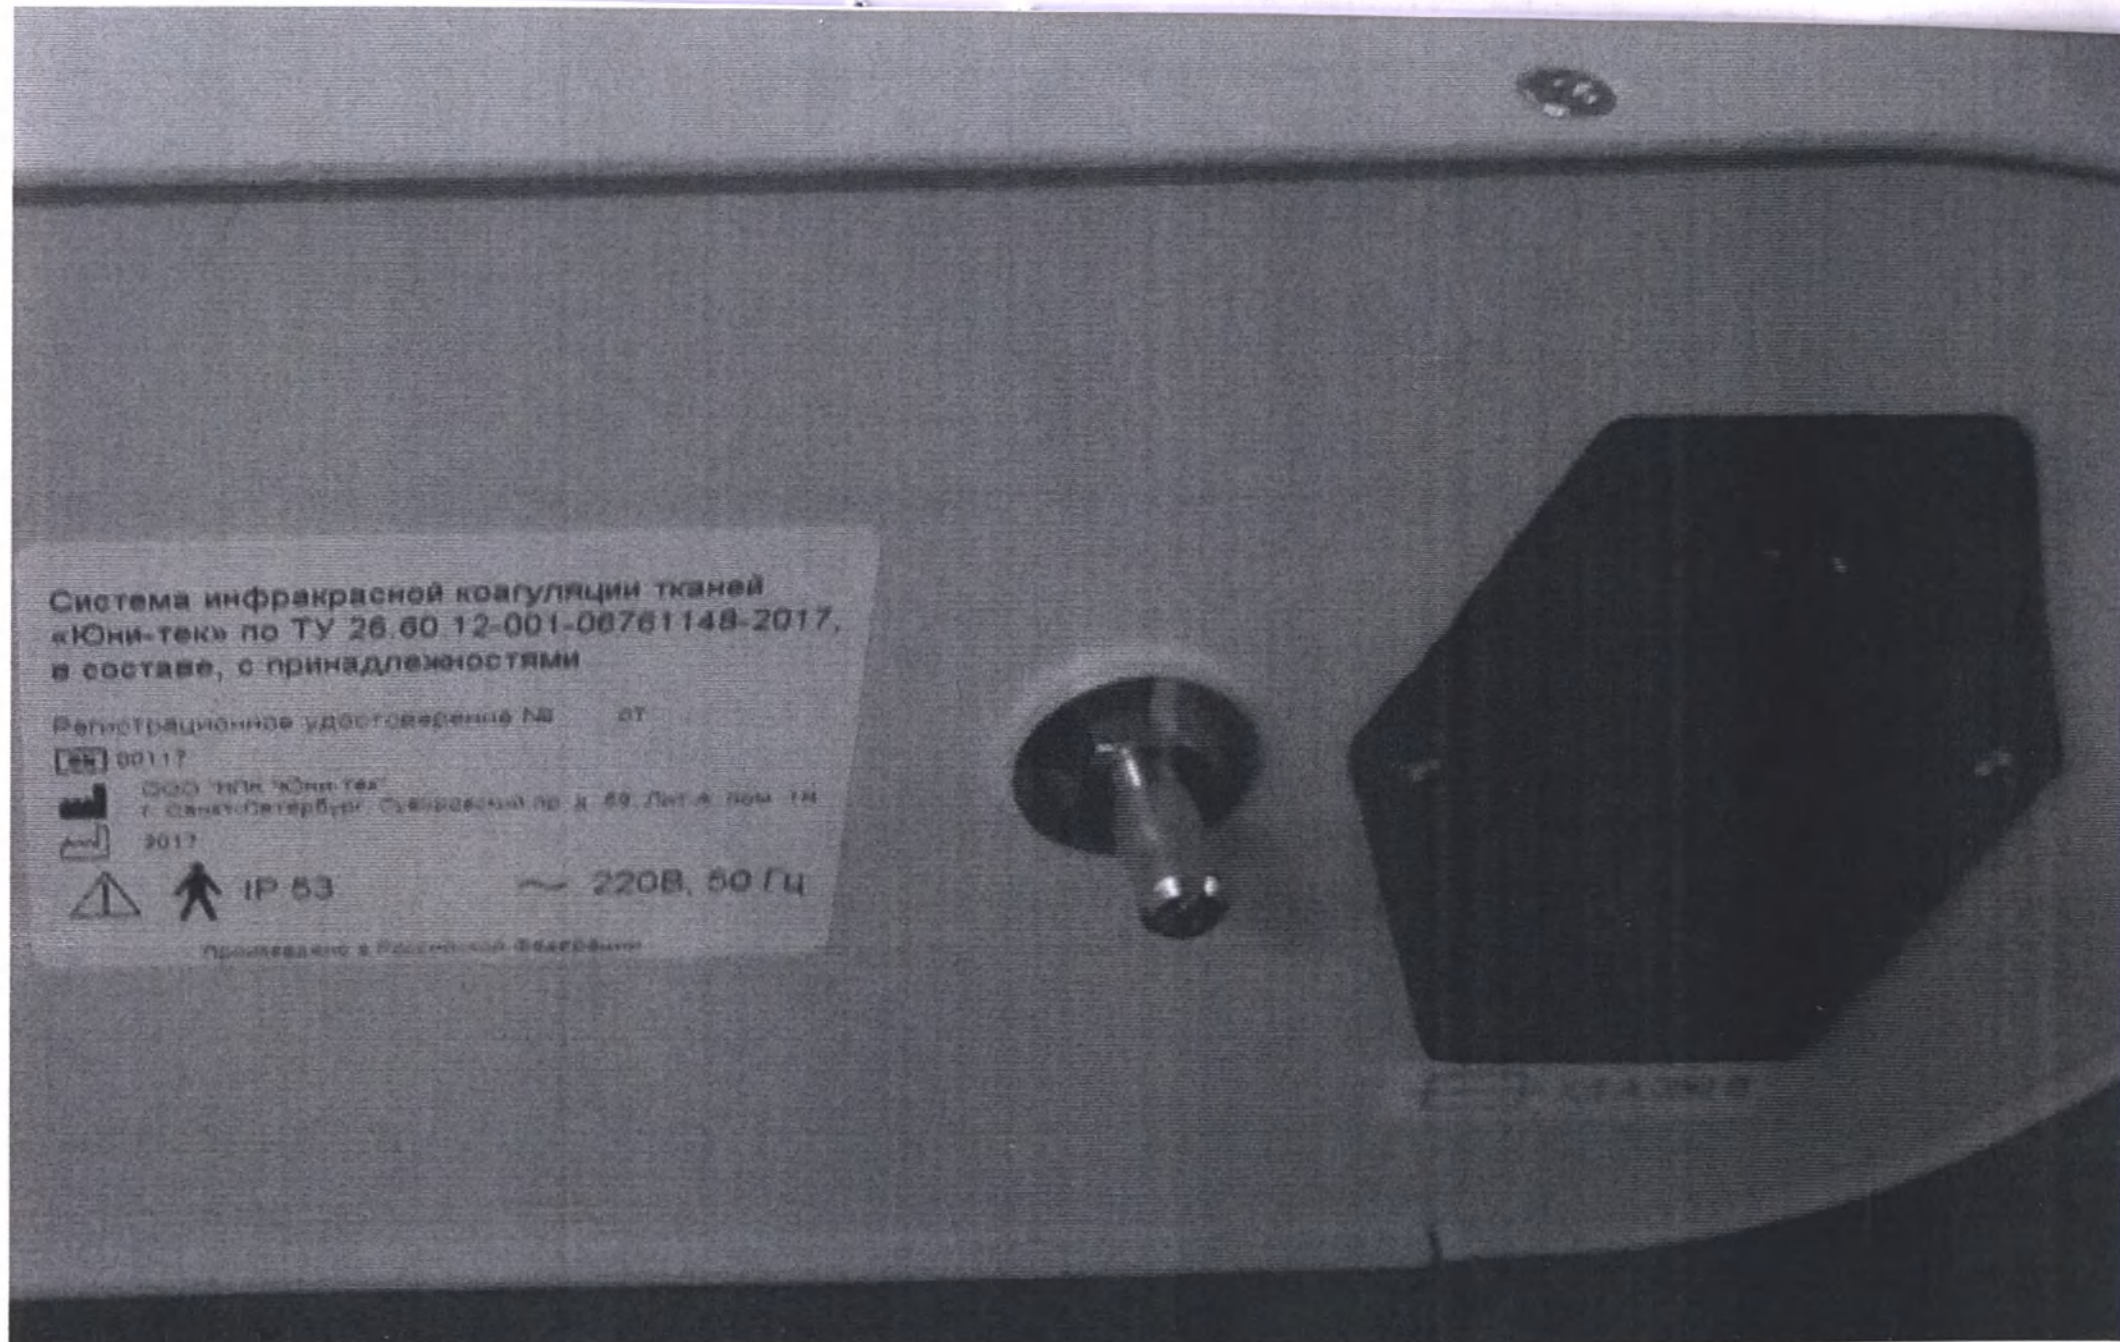

Система инфракрасной коагуляции тканей
«Юни-тек» по ТУ 26.60.12-001-06761148-2017,
в составе, с принадлежностями

Регистрационное удостоверение № 01

00117

ООО «Юни-тек»
г. Санкт-Петербург, Суворовский пр. д. 69, Лит. а пом. 14
2017

IP 63 ~ 220В, 50 Гц

Произведено в Российской Федерации

Рис. 19 – Маркировка на задней стенке «Система инфракрасной коагуляции тканей «Юни-тек» по ТУ 26.60.12-001-06761148-2017, в составе, с принадлежностями»

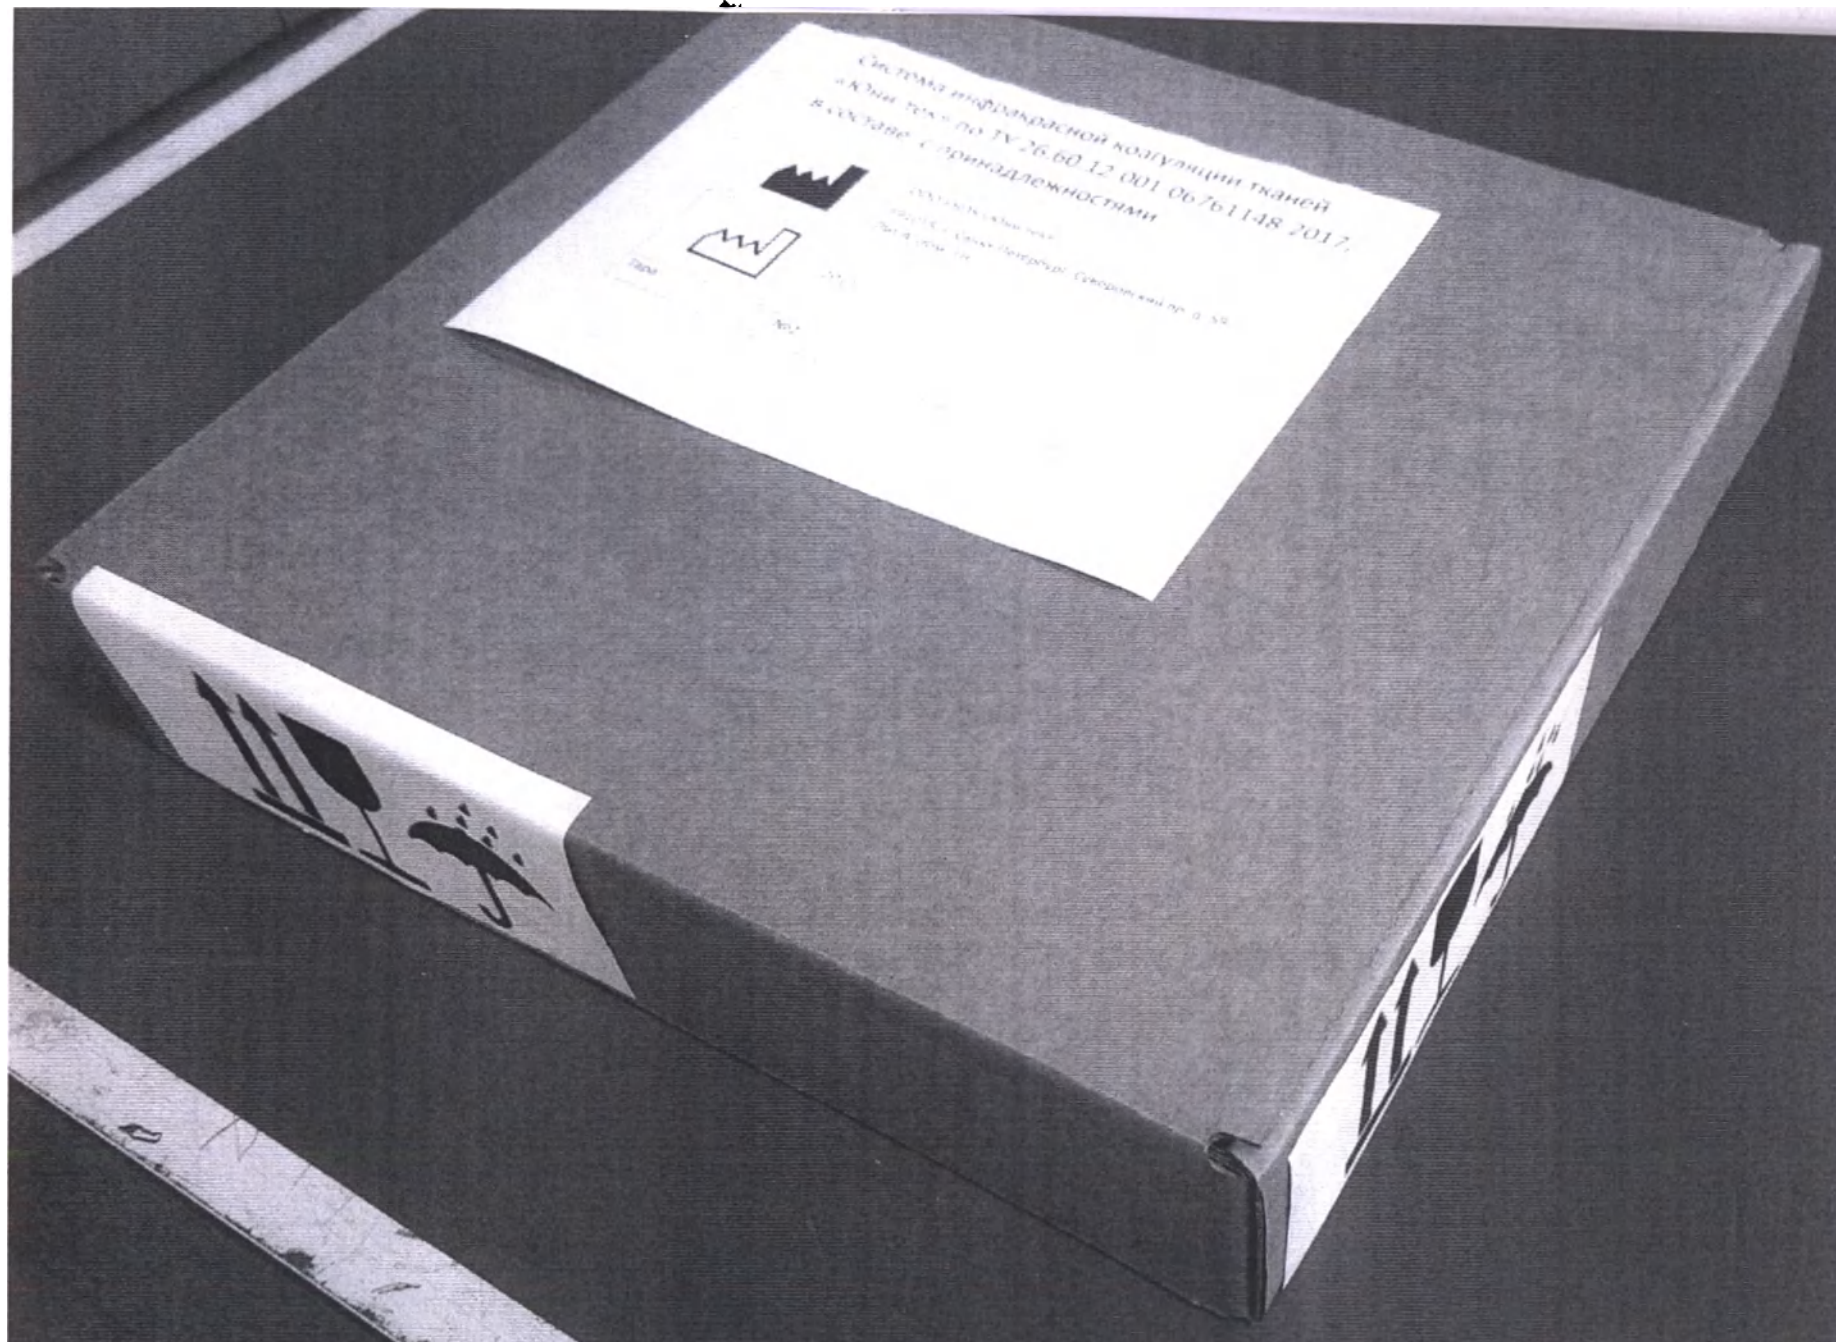


Рис. 20 – Маркировка потребительской упаковки «Система инфракрасной коагуляции тканей «Юни-тек» по ТУ 26.60.12-001-06761148-2017, в составе, с принадлежностями»

		
____ × ____ × ____ CM	БРУТТО _____ КГ НЕТТО _____ КГ	ООО «НПК «Юни-тек» 191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 59, литер А, пом. 1Н



Рис. 21 – Макет маркировки транспортной упаковки

Всего прошнуровано, пронумеровано и

скреплено 22 (двадцать два) листа

Генеральный директор

Ценеков Н.В.

