

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Медтроник»

Плясунова Е.В.

26 «июня» 2020 г.



**Фотографические изображения
медицинского изделия**

«Кардиовертер-дефибриллятор цифровой имплантируемый двухкамерный Evera»,

производства:


"Медтроник Инк.", США / Medtronic Inc., USA




рис. 1 Кардиовертер-дефибриллятор цифровой имплантируемый двухкамерный Evera MRI XT DR с технологией SureScan, модель DDMB2D1 (Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ключ с тарированным усилением; заглушка коннекторной части Medtronic DF-1; документация по продукции на бумажном носителе и CD)



Рис. 2 Коробка для хранения – вторичная упаковка Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI XT DR с технологией SureScan, модель DDMB2D1



DF-1 Evera MRI™ XT DR SureScan™ DDMB2D1 DDE-DDDR



Adaptive

AAI $\Leftrightarrow$ DDD

Upper tracking rate and lower rate
 $\uparrow 130 \text{ min}^{-1}$
 $\downarrow 60 \text{ min}^{-1}$

0.3 mV
Sensitivity RA

0.3 mV
Sensitivity RV

180 ms
150 ms
A-V interval (paced and sensed)

3.5 V
0.4 ms
Amplitude and pulse width RA

3.5 V
0.4 ms
Amplitude and pulse width RV

OFF
Detection VT, FVT, VF

OFF
Therapies (RV): VT, FVT

35/42 J
Therapies (delivered and stored) VF

ON
Active Can™

OFF
Therapies AT, AF

OFF
Intervention AT, AF

55 °C
131 °F
-18 °C
0 °F

FCC ID: LFSMICSIMPLANT3
IC: 3408D-MIMPLANT3
Model: Evera MRI



SN CWB606469S

2020-10-14
YYYY-MM-DD

2019-04
YYYY-MM

STERILE EO



www.medtronic.com/manuals

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA

Manufactured in
Tolochenaz, Switzerland

EC REP Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10
5422 PJ Heerlen, The Netherlands

Product of Switzerland

www.medtronic.com

CE0123

M962323A001 A - M964488A001 A




Рис. 3 Маркировка коробки для хранения – вторичной упаковки Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI XT DR с технологией SureScan, модель DDMB2D1



Рис. 4 Стерильная упаковка Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI XT DR с технологией SureScan, модель DDMB2D1




Medtronic



DF-1 Evera MRI™ XT DR SureScan™ DDMB2D1 DDE-DDDR



IS-1 BI
DF-1



ICD (dual chamber)




SureScan™


MR Conditional




Defibrillation




AV cardioversion




Burst RV



Burst+ RA




Ramp PA, RV



Ramp+ RV




50 Hz Burst RA




Adaptive


AAI <=> DDD



Upper tracking rate and lower rate




0.3 mV
Sensitivity RA




0.3 mV
Sensitivity RV




180 ms
150 ms
A-V interval (paced and sensed)




3.5 V
0.4 ms
Amplitude and pulse width RA




3.5 V
0.4 ms
Amplitude and pulse width RV




OFF
Detection VT, FVT, VF




OFF
Therapies (RV) VT, FVT




35/42 J
Therapies (delivered and stored) VF




ON
Active Can™



OFF
Therapies AT, AF



OFF
Intervention AT, AF



55 °C
131 °F
-18 °C
0 °F

FCC ID: LF5MICSIMPLANT3
IC: 3408D-MIMPLANT3
Model: Evera MRI



SN CWB6064698

2020-10-14
YYYY-MM-DD



www.medtronic.com/manuals



Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA

Manufactured in
Tolochenaz, Switzerland
www.medtronic.com

STERILE EO

2019-04
YYYY-MM

C E0123

M962323A001 A - M964488A001 A

Рис. 5 Маркировка стерильной упаковки Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI XT DR с технологией SureScan, модель DDMB2D1



Рис. 6 Кардиовертер-дефибриллятор цифровой имплантируемый двухкамерный Evera MRI XT DR с технологией SureScan, модель DDMB2D1 (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ключ с тарированным усилием; заглушка коннекторной части Medtronic DF-1)



Medtronic
Evera MRI™ XT DR
SureScan™
DDMB2D1
SN CWB606469S
DDE-DDDR
CH

Рис. 7 Общий вид Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI XT DR с технологией SureScan, модель DDMB2D1

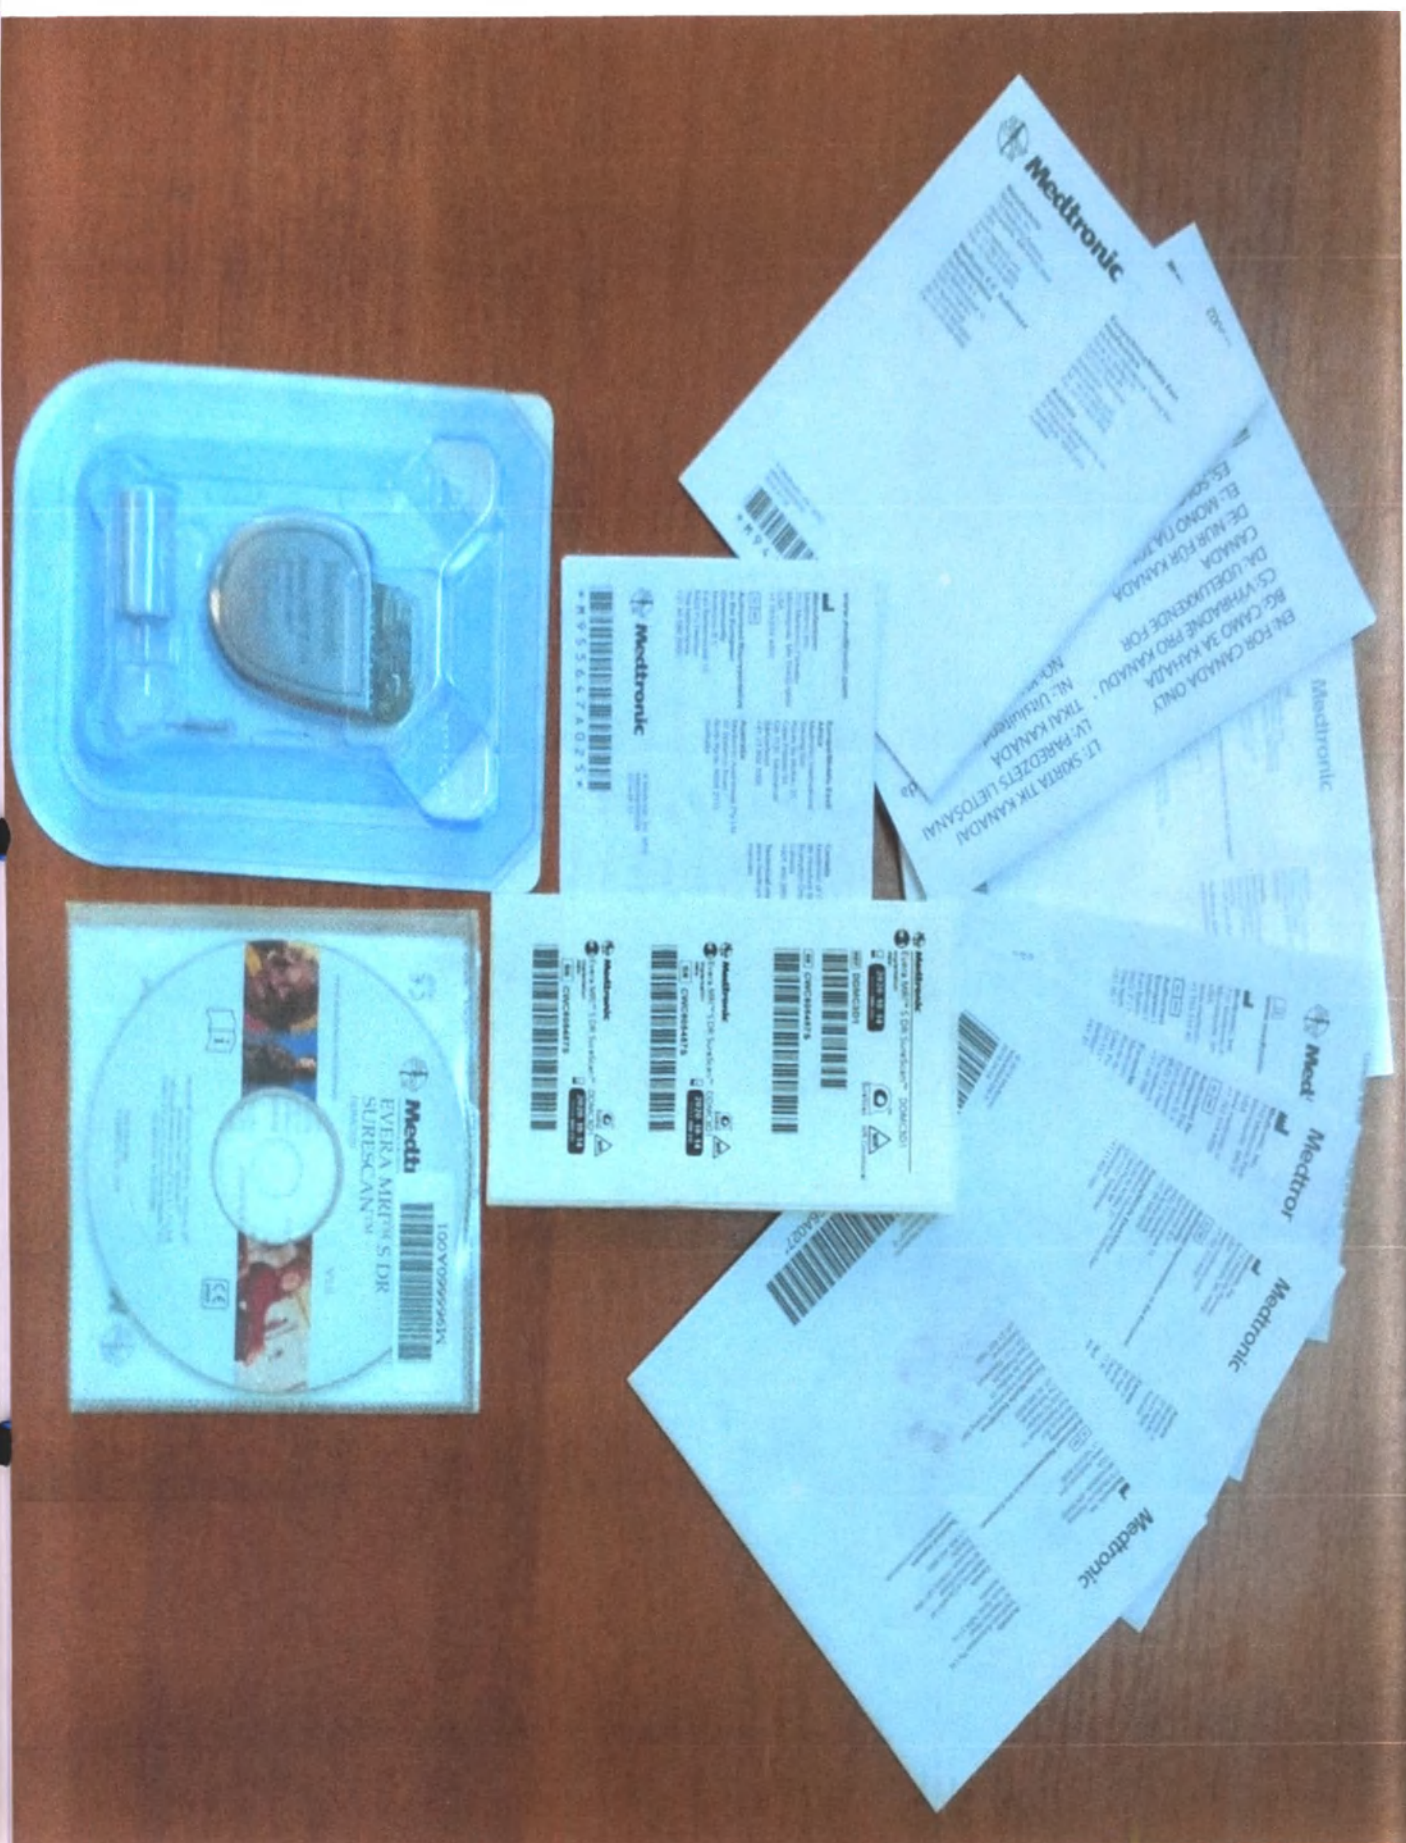


Рис. 8 Кардиовертер-дефибриллятор цифровой имплантируемый двухкамерный Evera MRI S DR с технологией SureScan, модель DDMC3D1 (Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ключ с тарированным усилением; заглушка коннекторной части Medtronic DF-1; документация по продукции на бумажном носителе и CD)





Рис. 9 Коробка для хранения – вторичная упаковка Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI S DR с технологией SureScan, модель DDMC3D1






DF-1 Evera MRI™ S DR SureScan™ DDMC3D1

DDE-DDDR



ICD (dual chamber)



Defibrillation



AV cardioversion



Burst RV



Burst+ RA




Ramp RA, RV




Ramp+ RV




50 Hz Burst RA




AAI <=> DDD




Upper tracking rate and lower rate




Sensitivity RA




Sensitivity RV




A-V interval (paced and sensed)



Amplitude and pulse width RA




Amplitude and pulse width RV




Detection VT, FVT, VF




Therapies (RV) VT, FVT



Therapies (delivered and stored) VF



Active Can™




Therapies AT, AF



Intervention AT, AF



STERILE EO



www.medtronic.com/manuals

Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA

Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen, The Netherlands

www.medtronic.com

Manufactured in
Tolochenaz, Switzerland

Product of Switzerland

SN CWC605457S

2020-10-14
YYYY-MM-DD

2019-04
YYYY-MM

CE0123


M962323A001 A - M964489A001 A




Рис. 10 Маркировка коробки для хранения – вторичной упаковки Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI S DR с технологией SureScan, модель DDMC3D1



Рис. 11 Стерильная упаковка Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI S DR с технологией SureScan, модель DDMC3D1



Medtronic




DF-1

Evera MRI™ S DR SureScan™ DDMC3D1

DDE-DDDR



IS-1 BI
DF-1



ICD (dual
chamber)



SureScan



MR Conditional



Defibrillation




AV cardioversion




Burst RV



Burst+ RA



Ramp RA, RV



Ramp+ RV



50 Hz Burst+ RA

Adaptive

AAI <=> DDD

↑ 130 min⁻¹
↓ 60 min⁻¹
Upper tracking rate and lower rate

0.3 mV
Sensitivity RA

0.3 mV
Sensitivity RV

180 ms
150 ms
A-V interval (paced and sensed)

3.5 V
0.4 ms
Amplitude and pulse width: RA

3.5 V
0.4 ms
Amplitude and pulse width: RV

OFF
Detection: VT, FVT, VF

OFF
Therapies (RV): VT, FVT

36/42 J
Therapies (delivered and stored): VF

ON
Active Can™

OFF
Therapies: AT, AF

OFF
Intervention: AT, AF

55 °C
131 °F
-18 °C
0 °F

FCC ID: LF5MICSIMPLANT3
IC: 3408D-MIMPLANT3
Model: Evera MRI



SN CWC605457S

2020-10-14
YYYY-MM-DD



www.medtronic.com/manuals



Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA

Manufactured in
Tolochenaz, Switzerland
www.medtronic.com

STERILE EO

2019-04
YYYY-MM

C E0123



M962323A001 A · M964489A001 A

Рис. 12 Маркировка стерильной упаковки Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI S DR с технологией SureScan, модель DDMC3D1



Рис. 13 Кардиовертер-дефибриллятор цифровой имплантируемый двухкамерный Evera MRI S DR с технологией SureScan, модель DDMC3D1 (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор; ключ с тарированным усилием; заглушка коннекторной части Medtronic DF-1)



Рис. 14 Общий вид Кардиовертера-дефибриллятора цифрового имплантируемого двухкамерного Evera MRI S DR с технологией SureScan, модель DDMC3D1

	Производитель:	Код UPN
	Страна происхождения:	Код CFN
Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник»		
Регистрационное Удостоверение № ____ от ____		
Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку		См. Инструкцию См. символы на упаковке

Рис. 15. Проект стикера на русском языке



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Медтроник»

16 листа(ов)

