





Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**


**Калибратор для обеспечения правильности качественного определения
антител к Т-лимфотропному вирусу человека I и II типа
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i "rHTLV-I/II Калибратор
(Alinity i rHTLV-I/II Calibrator)"**

Фотографическое изображение МИ rHTLV-I/II Калибратор (Alinity i rHTLV-I/II Calibrator), упаковка, вид снаружи

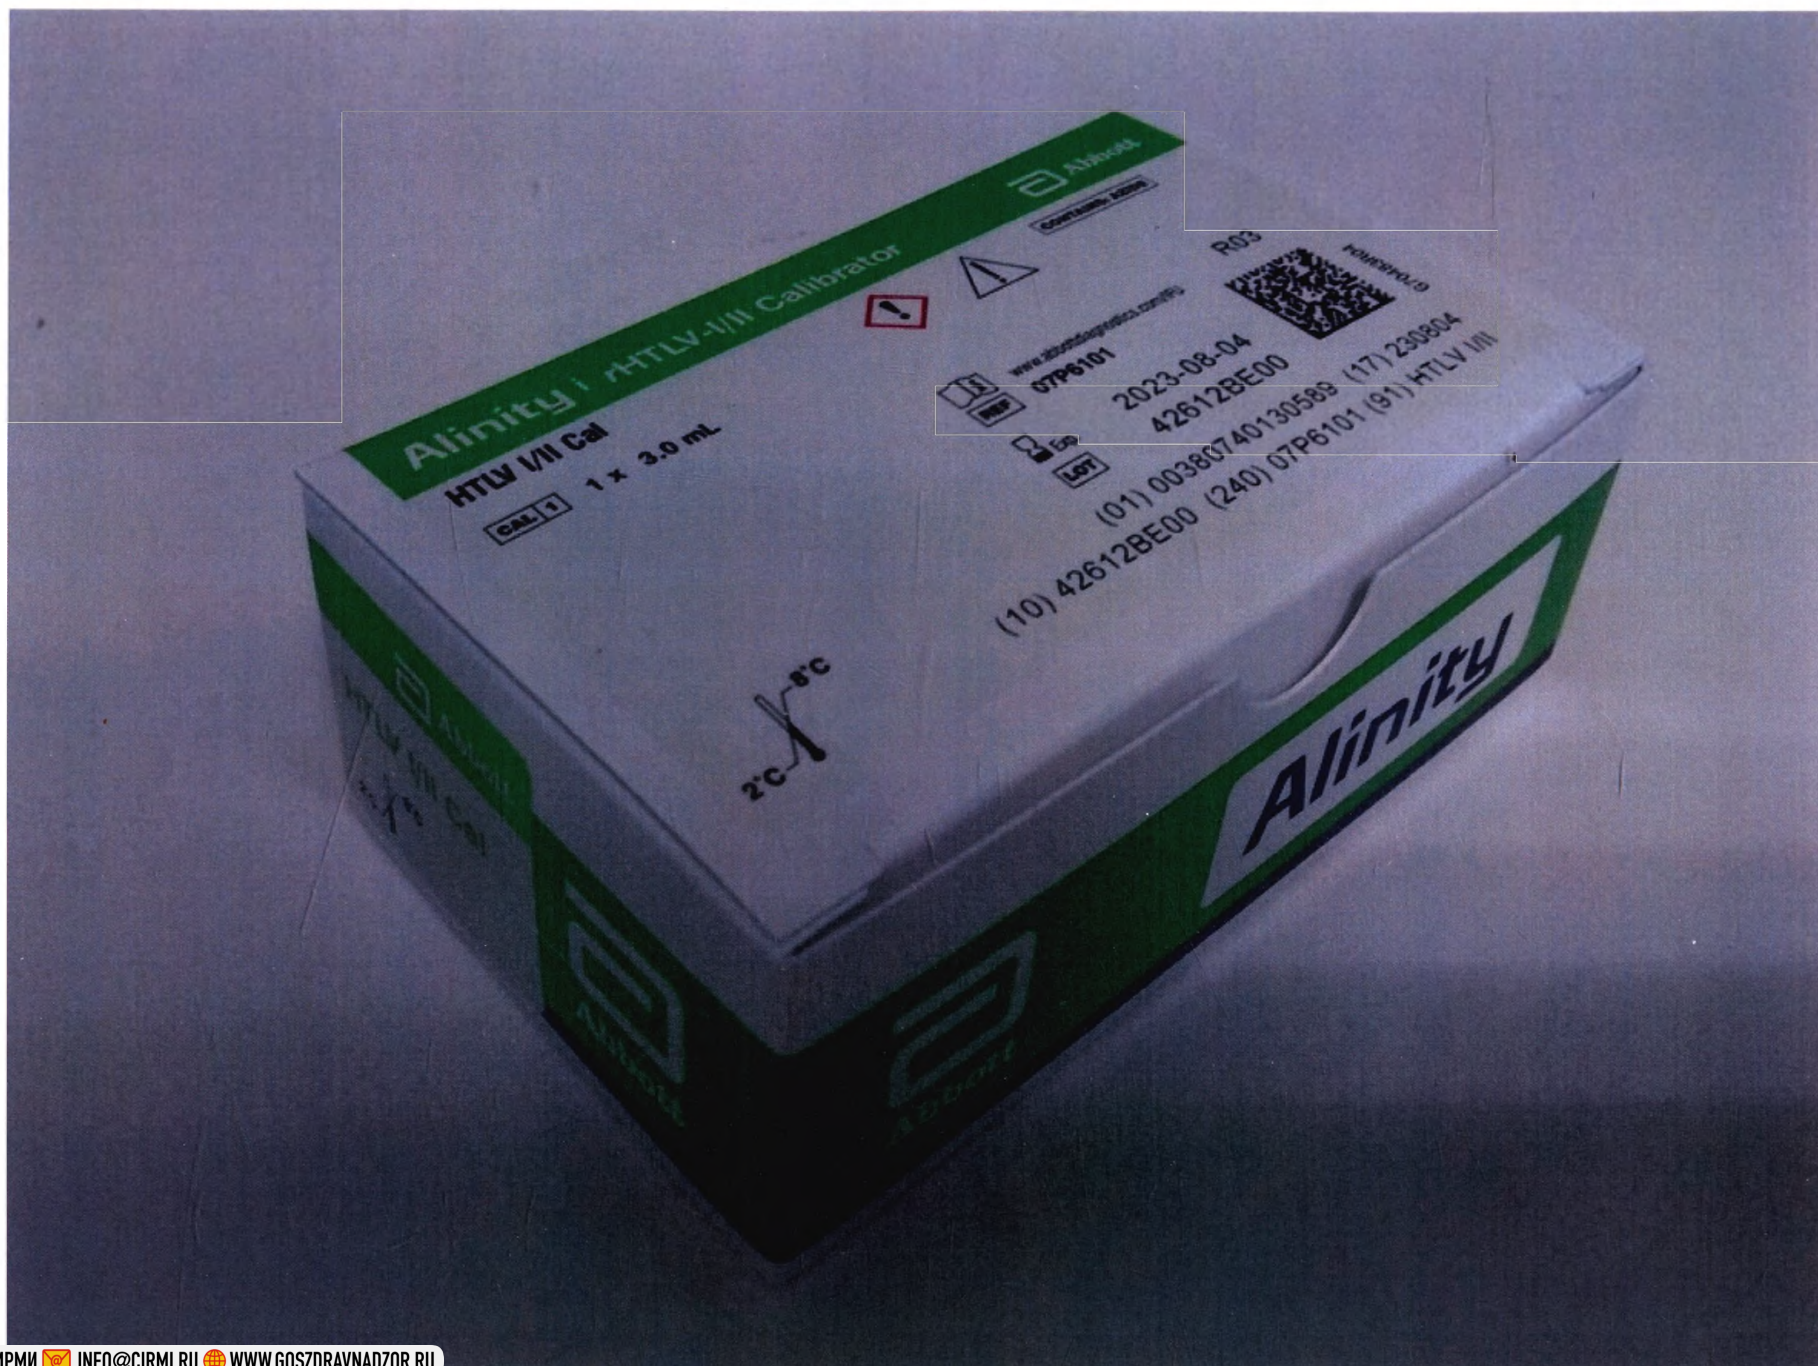


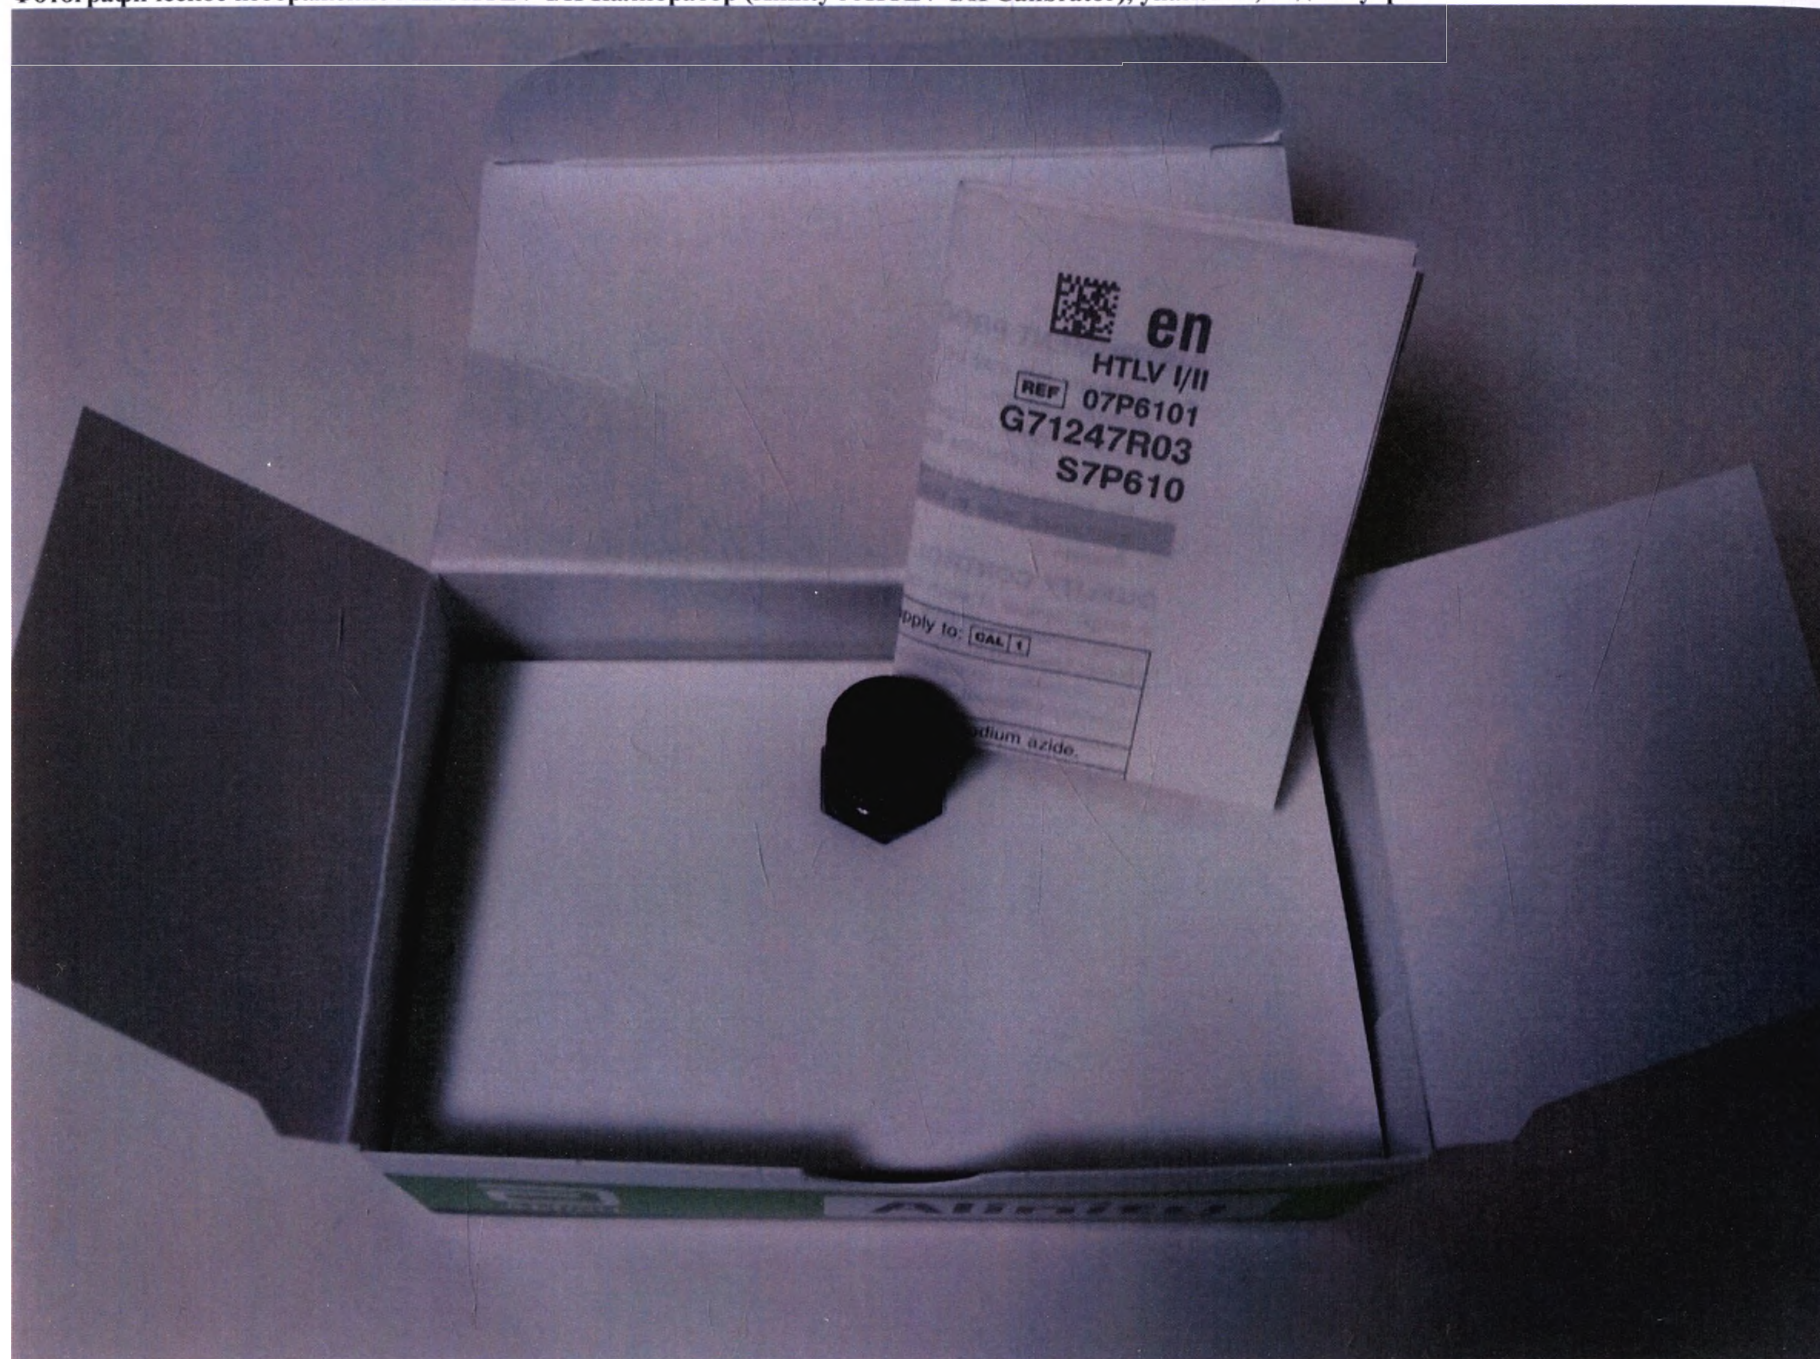

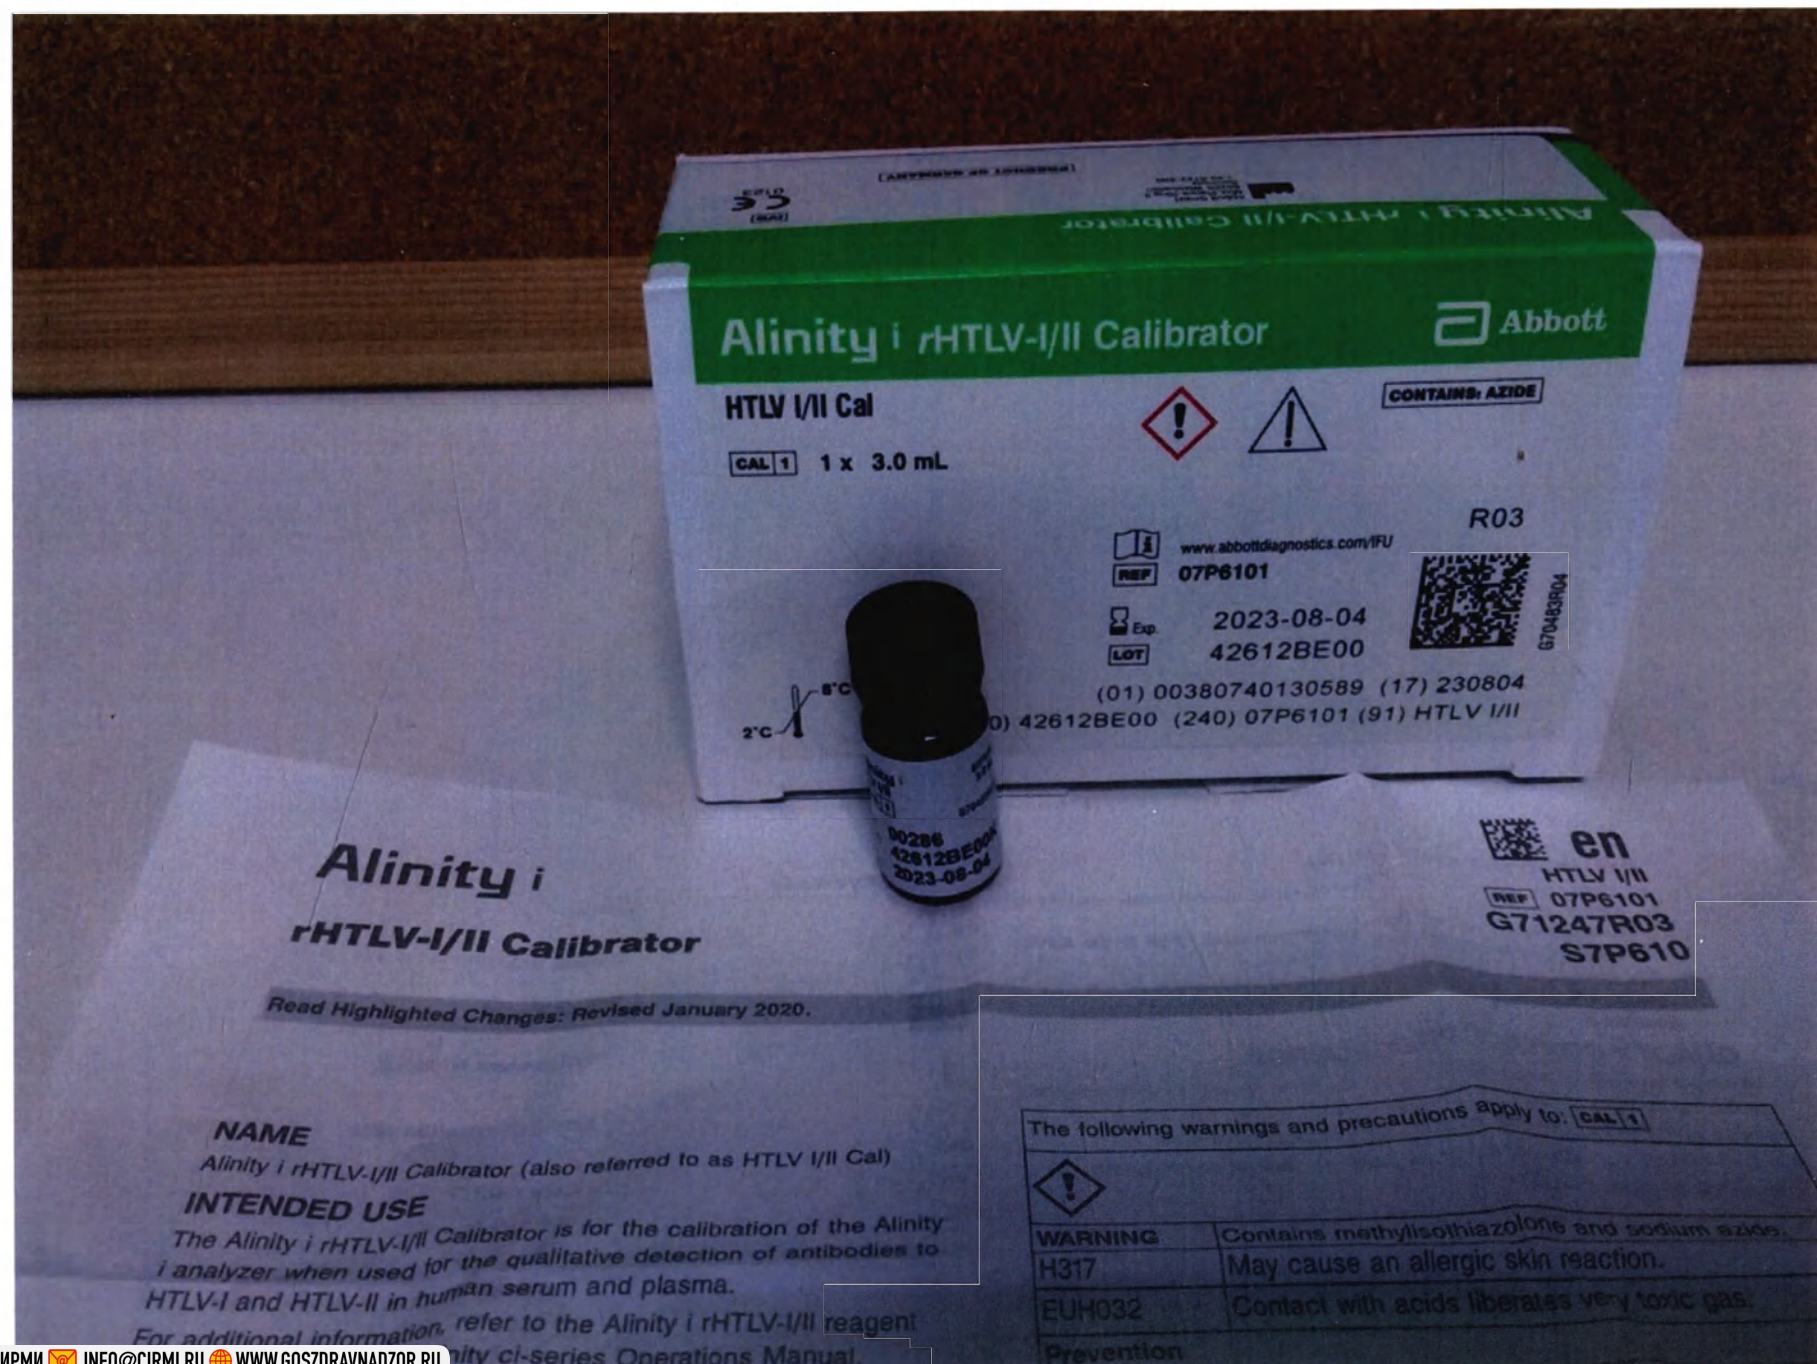

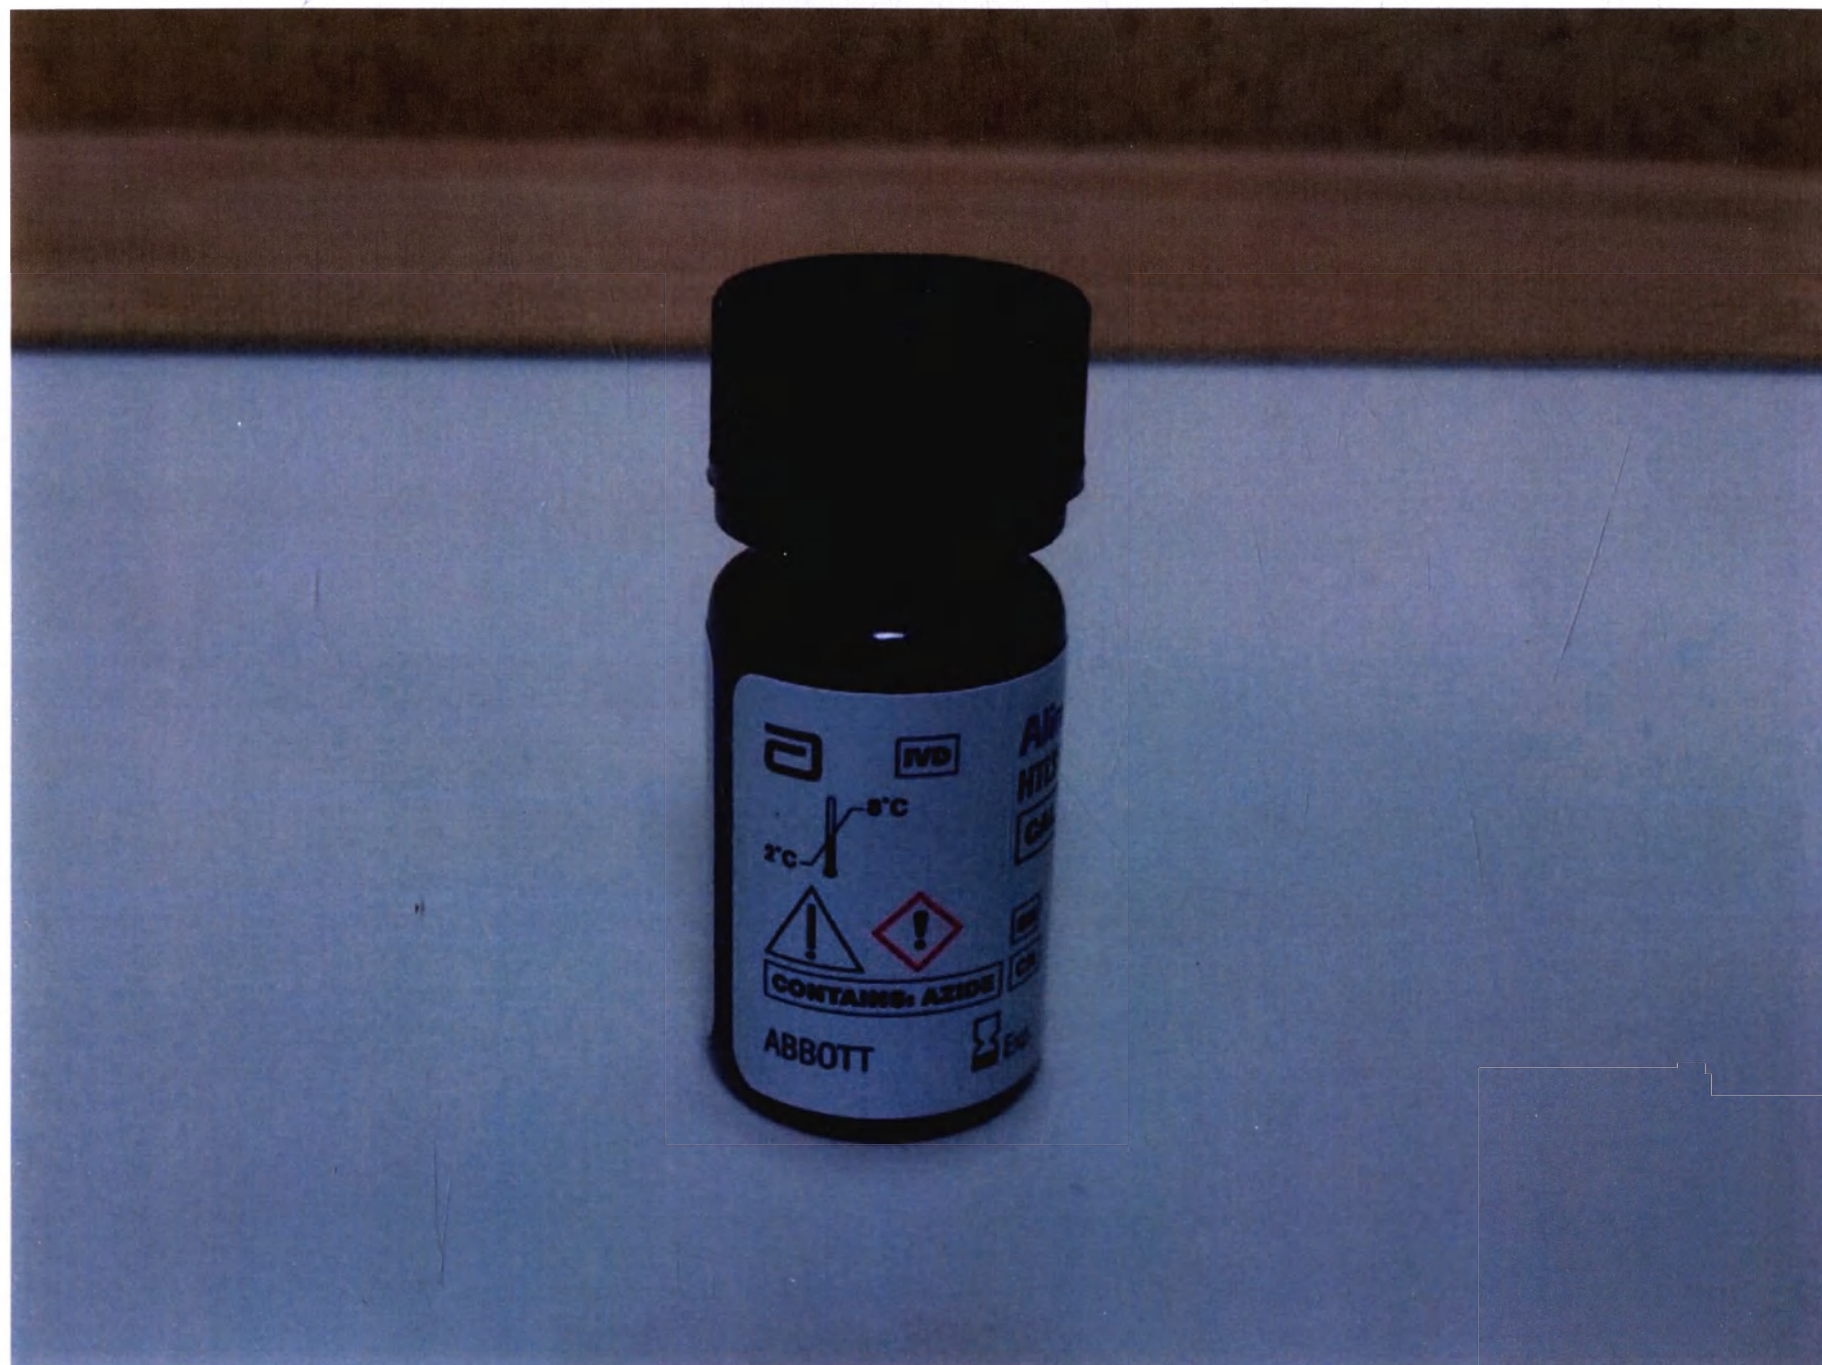

Фотографическое изображение МИ rHTLV-I/II Калибратор (Alinity i rHTLV-I/II Calibrator), флакон, вид 2

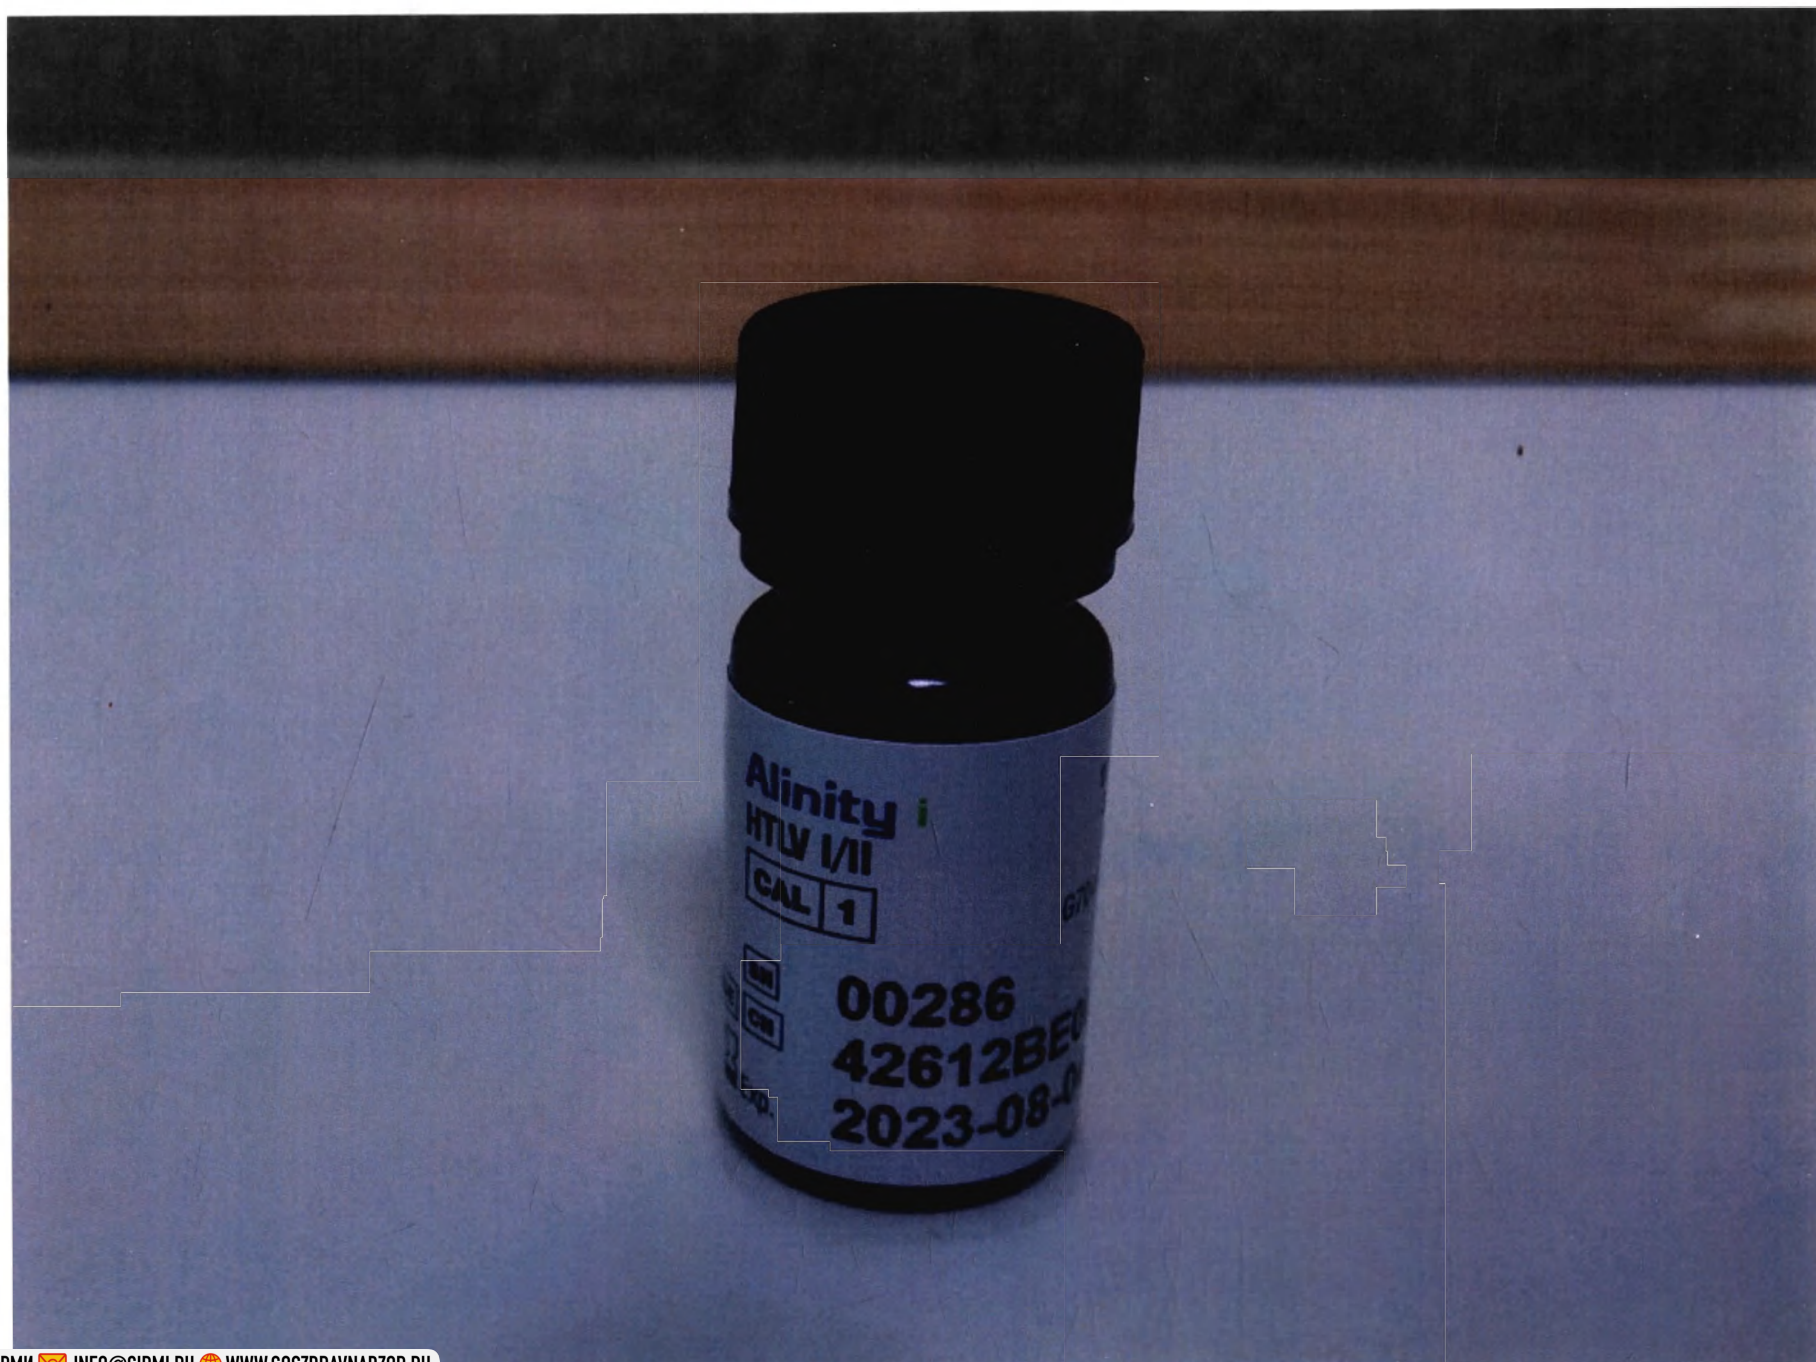

Подпись





Общество с ограниченной
ответственностью "Эбботт
Лабораториз"
125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 16 А., стр 1,
БЦ Метрополис
Тел: (495) 258 42 80

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибратор для обеспечения правильности качественного определения
антител к Т-лимфотропному вирусу человека I и II типа
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i «rHTLV-I/II Калибратор (Alinity
i rHTLV-I/II Calibrator)»**

Макет маркировки медицинского изделия rHTLV-I/II Калибратор (Alinity i rHTLV-I/II Calibrator), кат № 07P6101 для пользователей Российской Федерации



07P6101



Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител к Т-лимфотропному вирусу человека I и II типа иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «rHTLV-I/II Калибратор (Alinity i rHTLV-I/II Calibrator)»

В составе: - Калибратор 1 (Alinity i rHTLV-I/II CAL 1) – 1 флакон х 3,0 мл; - Инструкция по применению.

Производитель: «Эбботт ГмбХ» (Abbott GmbH), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / Место производства: «Эбботт ГмбХ» (Abbott GmbH), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / Страна происхождения: Германия / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott / LFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия rHTLV-I/II Калибратор (Alinity i rHTLV-I/II Calibrator), кат № 07P6101

670463R04

LOT

Exp

REF

www.abbottdiagnostics.com/ifu

07P6101

2°C

8°C

1 x 3.0 mL

HTLV I/II Cal

CONTAINS AZIDE

!

!

Alinity i rHTLV-I/II Calibrator

Abbott

Abbott GmbH

Max-Planck-Ring 2

65205 Wiesbaden

Germany

+49-6122-580

IVD

CE

0123

HTLV I/II Cal


2°C

8°C

PRODUCT OF GERMANY

Маркировка компонентов медицинского изделия rHTLV-I/II Калибратор (Alinity i rHTLV-I/II Calibrator), кат № 07P6101

Калибратор 1 (Alinity i rHTLV-I/II Calibrator 1):

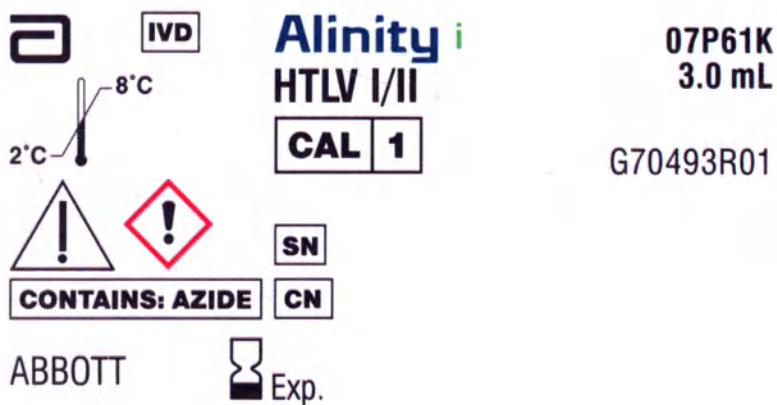

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

Подпись

