



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «МИТ»)

143987, Россия, Московская область, г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный, ул. Советская, владение 61, строение 5
т/ф (495) 522-7034, 522-1625, 522-4474; e-mail: mit@mit-ltd.ru, mit_ltd@mail.ru

ПАО Сбербанк, г. Москва, р/с 40702810640040107168, к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ИНН 5012013927/501201001, ОКПО 42237874

« 17 » апреля 2023

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Минимально инвазивные технологии»




Андреев Ю.Г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

по ТУ 9437-007-42237874-2011

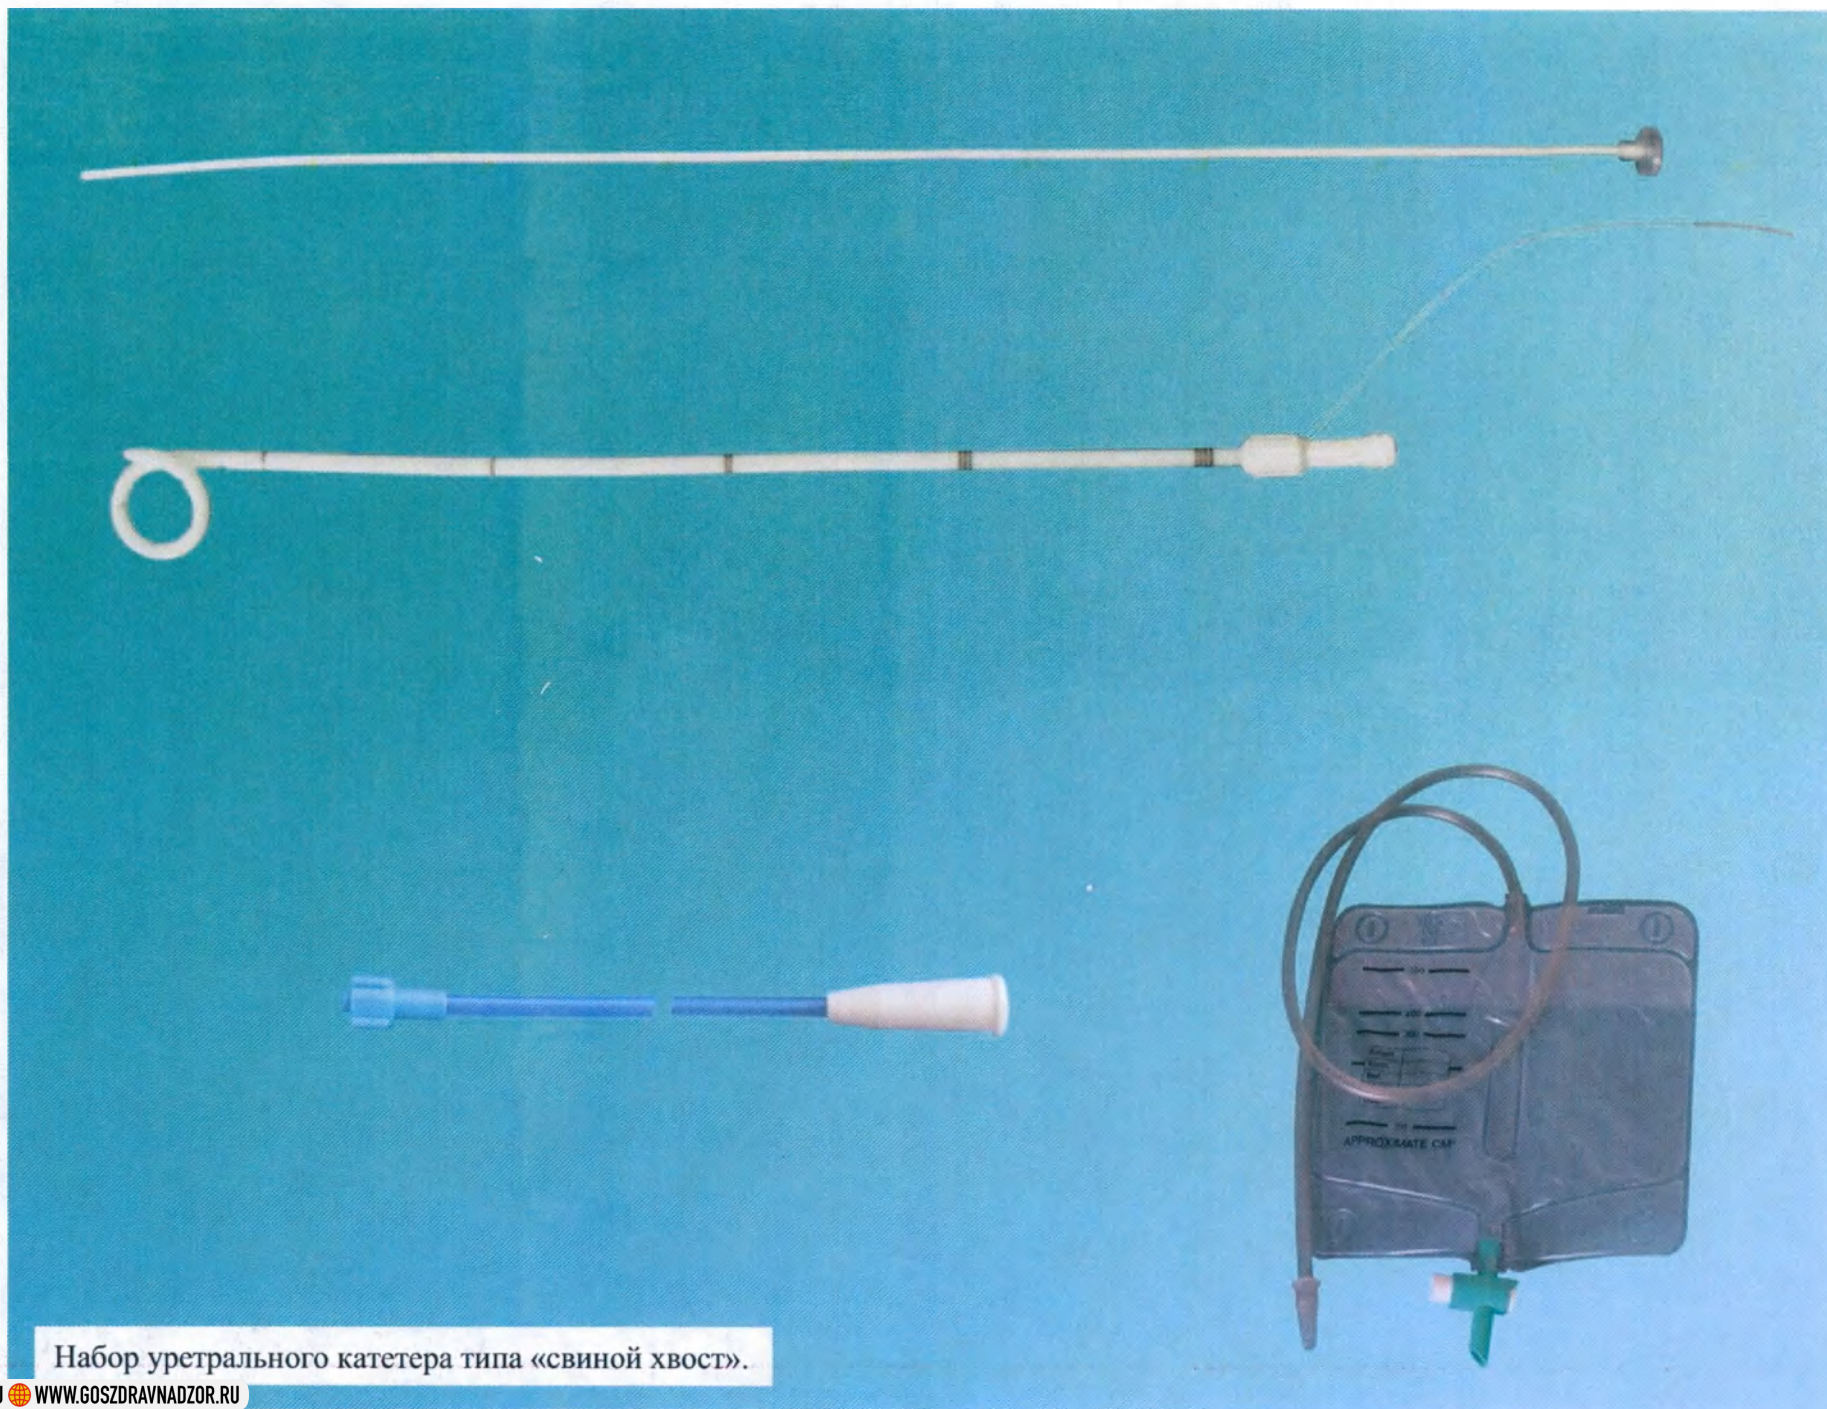

Набор уретрального катетера типа «свиной хвост».



Набор уретрального катетера типа «свиной хвост», в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

**НАБОР УРЕТРАЛЬНОГО КАТЕТЕРА
ТИПА «СВИНОЙ ХВОСТ»**

REF 1231208

Катетер уретральный типа «свиной хвост» диаметр 8СН, длина 30см,
полиуретан рентгеноконтрастный
В набор входит: установочная канюля, удлинитель, мочеприемник


Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор уретрального катетера типа «свиной хвост». Маркировка потребительской упаковки.

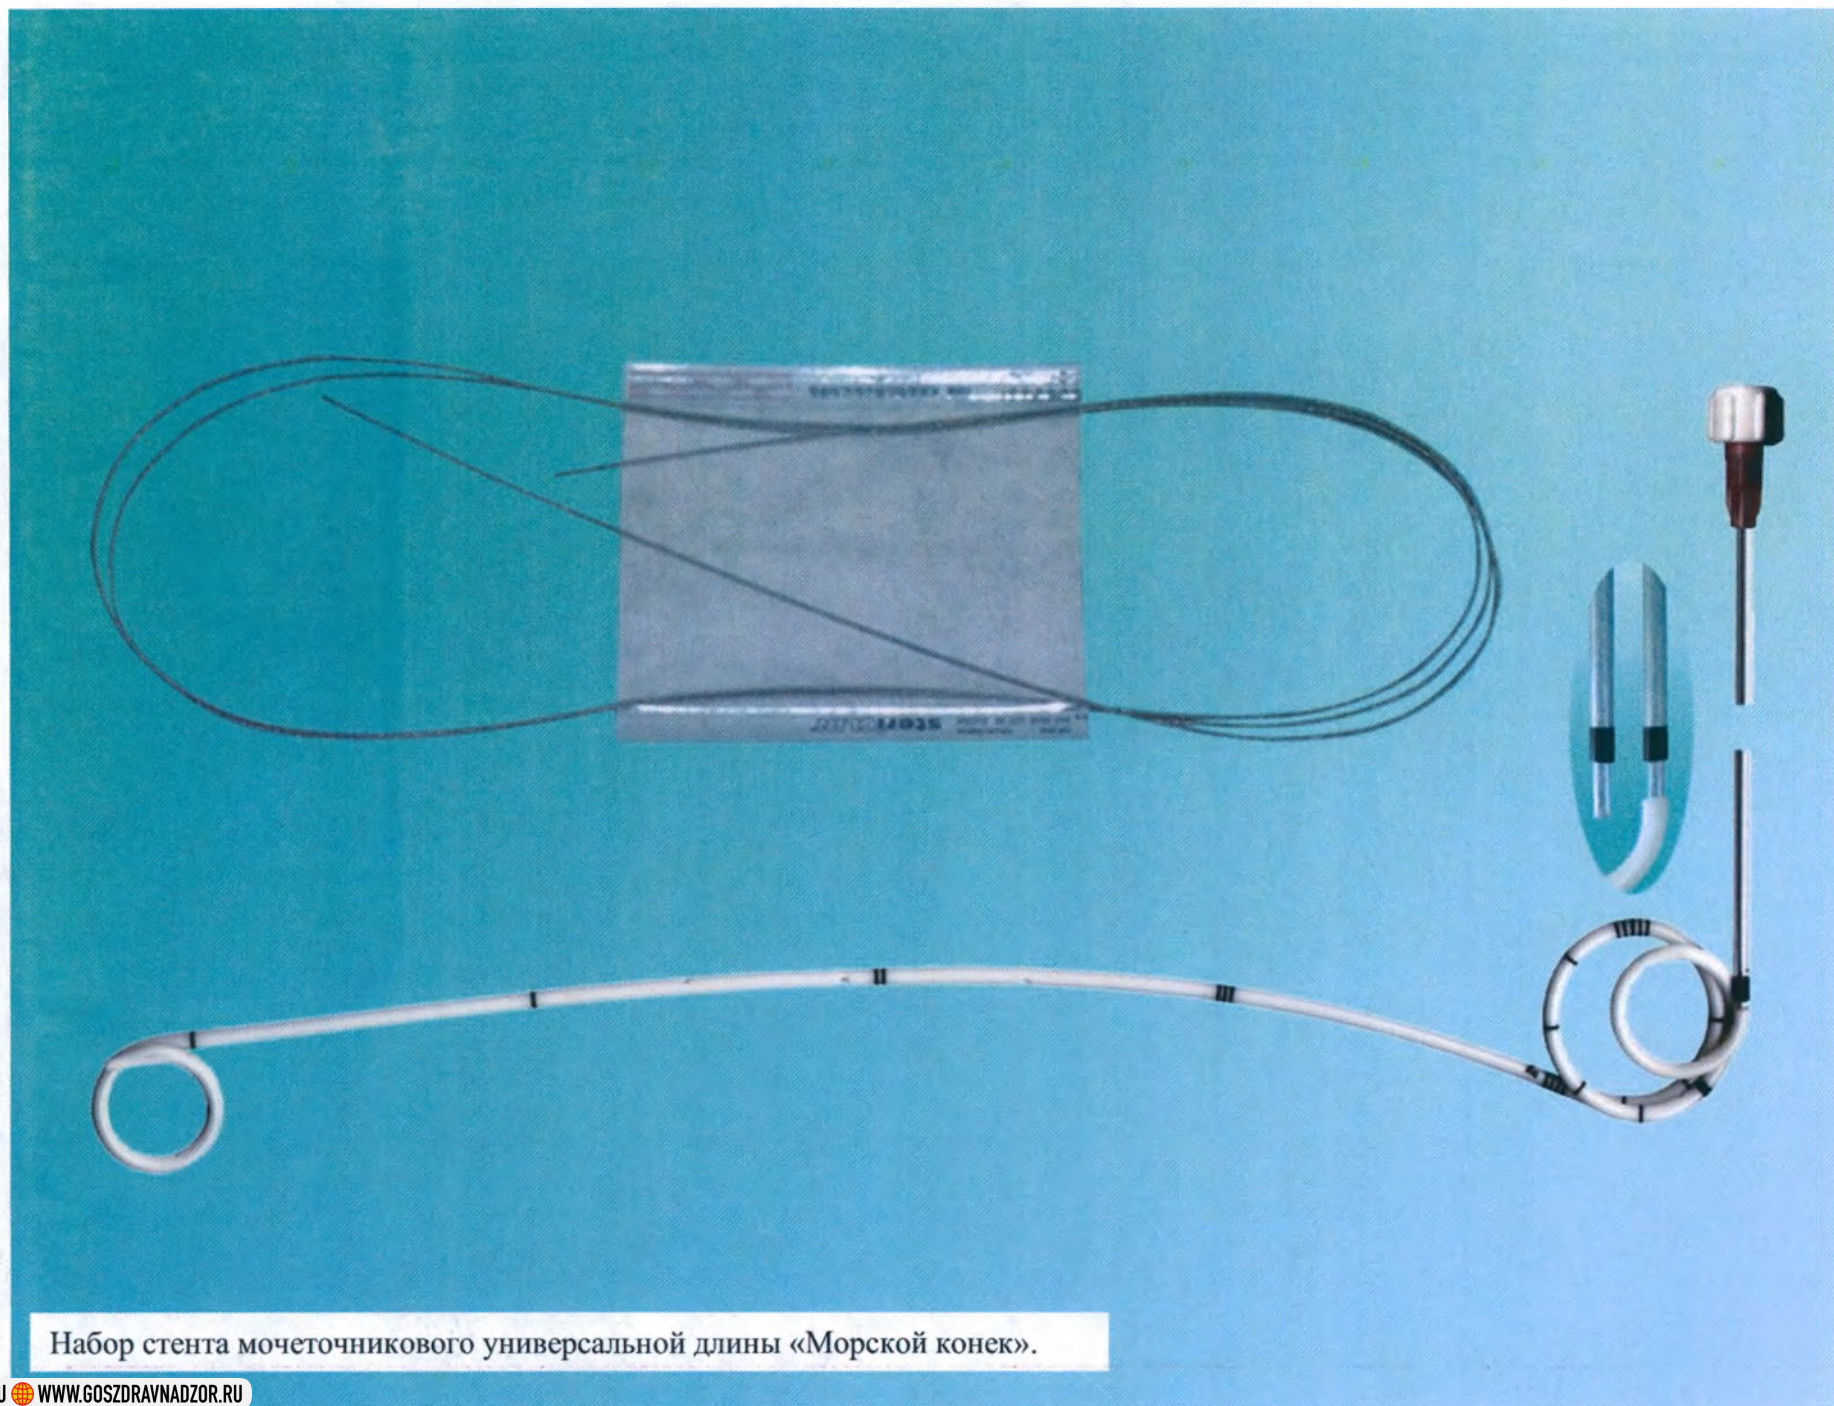



Набор медицинского для минимально инвазивной хирургии
в комплекте с набором диагностическим «Заро-801-18»
НАБОР СТЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ДЛИНЫ «МОРСКОЙ КОНЕК»

REF 131105-18-30

Стект мочеточниковый универсальной длины «Морской конек»
диаметр БСН, длина 180 см
Применение: прямой диаметр 0,832", длина 180 см
Таблетка (с фиксацией) диаметр БСН

Стерильно, асептически, нестерильно
не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-4223/874-2011
РД № Р-94 2012/1308 от 28.03.2018

STERILE



ООО «Медицинское инновационное предприятие»
141067, Россия, Московская обл., г. Балашиха пер. Железнодорожный, ул. Спасская,
44/1, стр. 5. Тел: 8(495)943-4622, 522-7234, факс: 8(495)943-4622, 522-7234, e-mail: info@med-innov.ru

Набор стента мочеточникового универсальной длины «Морской конек», в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»



НАБОР СТЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ДЛИНЫ «МОРСКОЙ КОНЕК»

REF 131105-18-30

Стент мочеточниковый универсальной длины «Морской конек»
диаметр 5СН, длина 18см
Проводник прямой диаметр 0,032", длина 150см
Толкатель (с фиксацией) диаметр 5СН

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор стента мочеточникового универсальной длины «Морской конек». Маркировка потребительской упаковки.

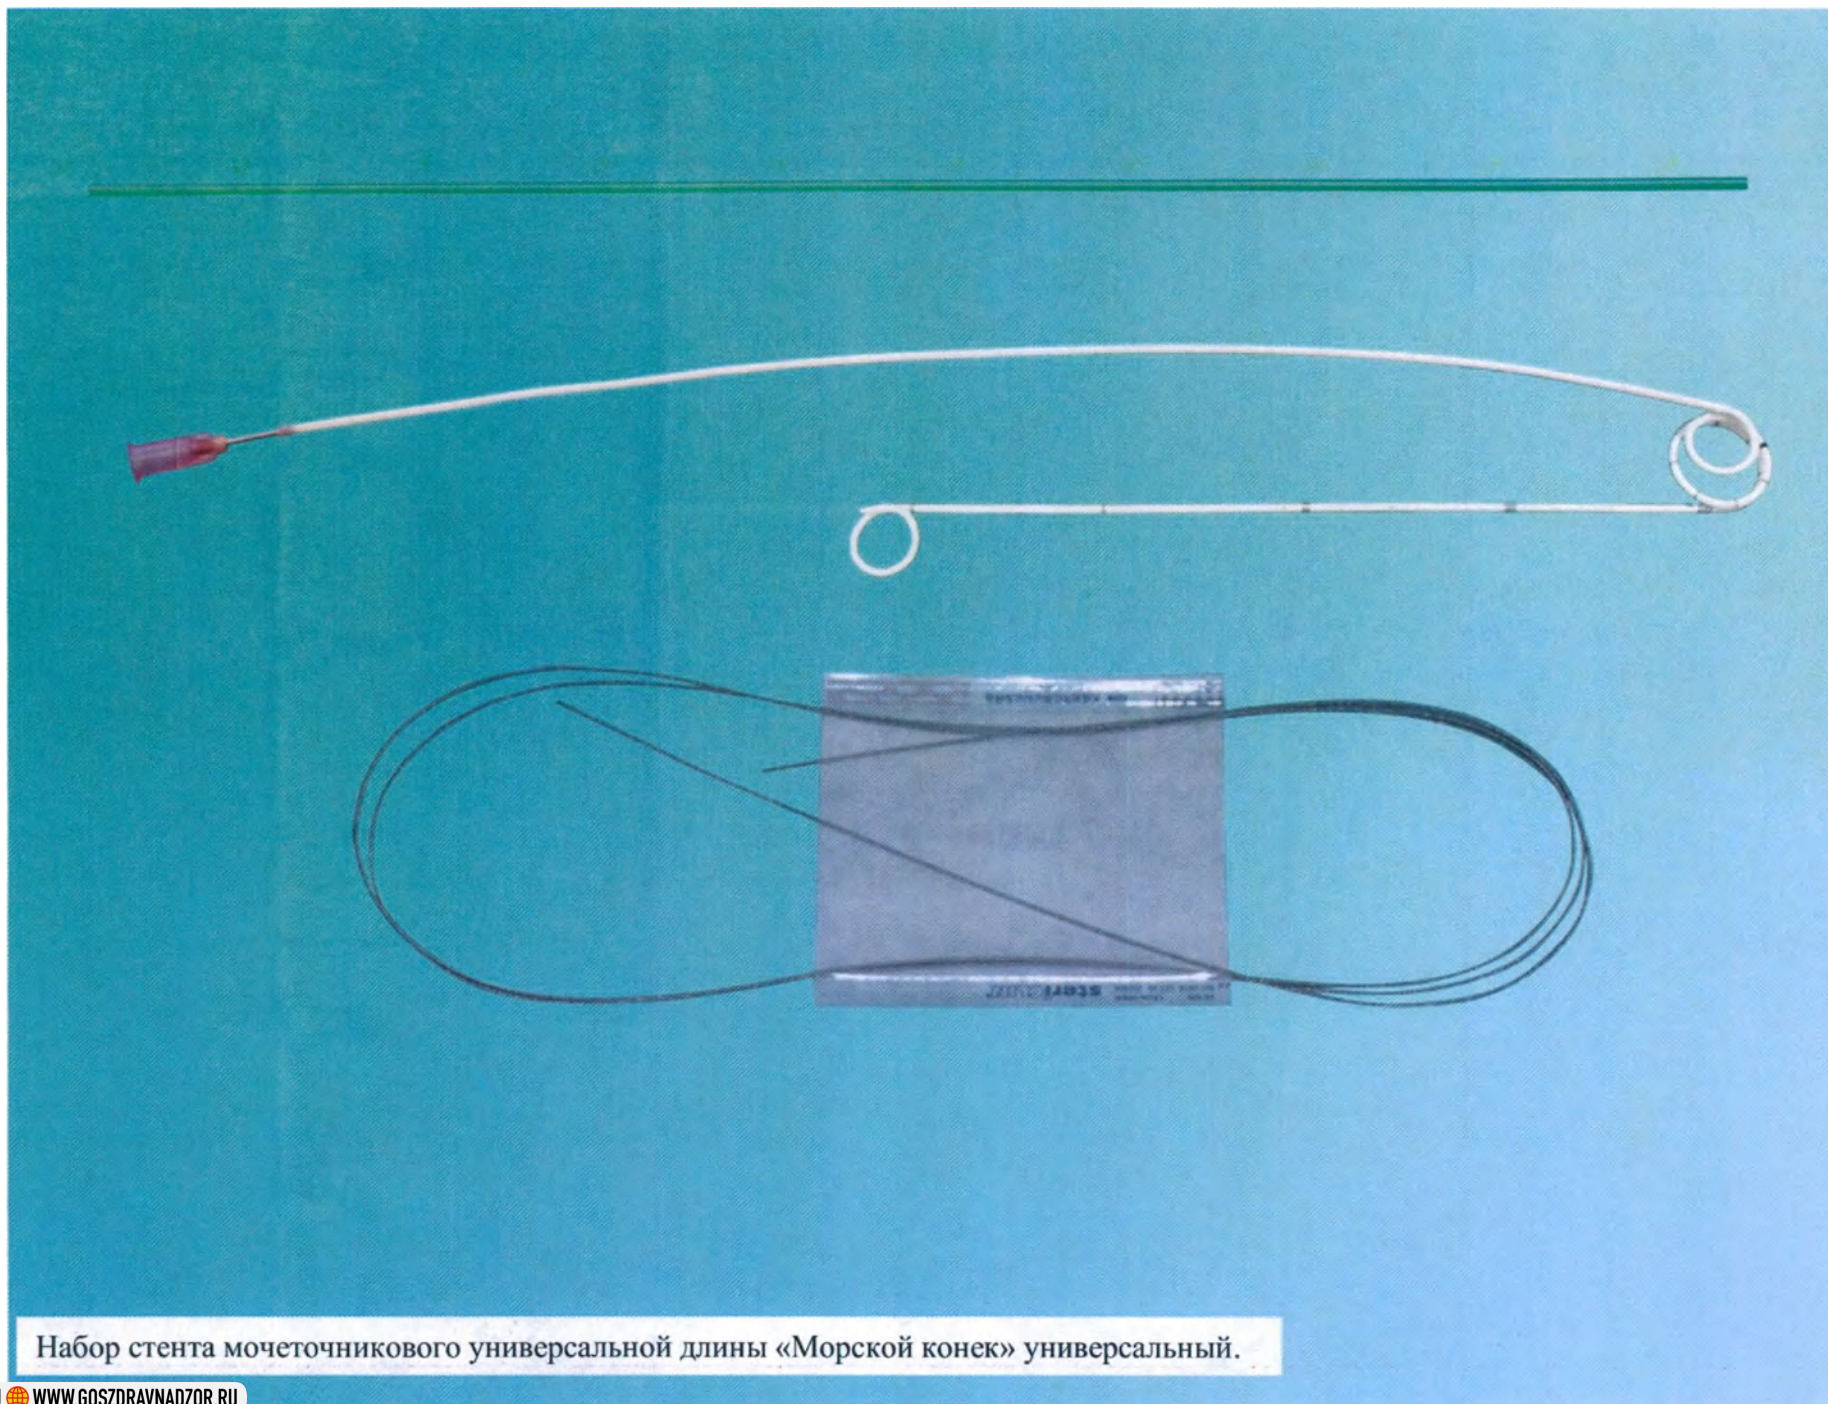

Набор стента мочеточникового универсальной длины «Морской конек» универсальный.

Наборы медицинских для минимально инвазивных вмешательств
в капсулу лапароскопическому «Финиш»
НАБОР СЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ДЛИНЫ «МОРСКОЙ КОНЕК» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

REF 135105-6

Сетчатый мочеточниковый универсальный длины «Морской конек»
универсальный (с охватом наружу) диаметр 5СН, длина 60см
Прокладка диаметр 0.032"
Толщина диаметр 5СН

Стерильно, изотонично, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 0437-007-4223/074-2011
РТУ на РСТ 2013/120 от 28.03.2018



ООО «Минимально инвазивные технологии»

140587, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Индустриальный, ул. Советская,
зд.61, стр.3 Тел: 8(495)522-6425, 522-7204, email: info@mit.ru, www.mit.ru

STERILE



Набор сента мочеточникового универсальной длины «Морской конек» универсальный, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»



**НАБОР СТЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ДЛИНЫ «МОРСКОЙ КОНЕК» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

REF 135105-6

Стент мочеточниковый универсальной длины «Морской конек»
универсальный (с выводом наружу) диаметр 5CH, длина 60мм
Проводник диаметр 0,032"
Толкатель диаметр 5CH

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор стента мочеточникового универсальной длины «Морской конек» универсальный. Маркировка потребительской упаковки.

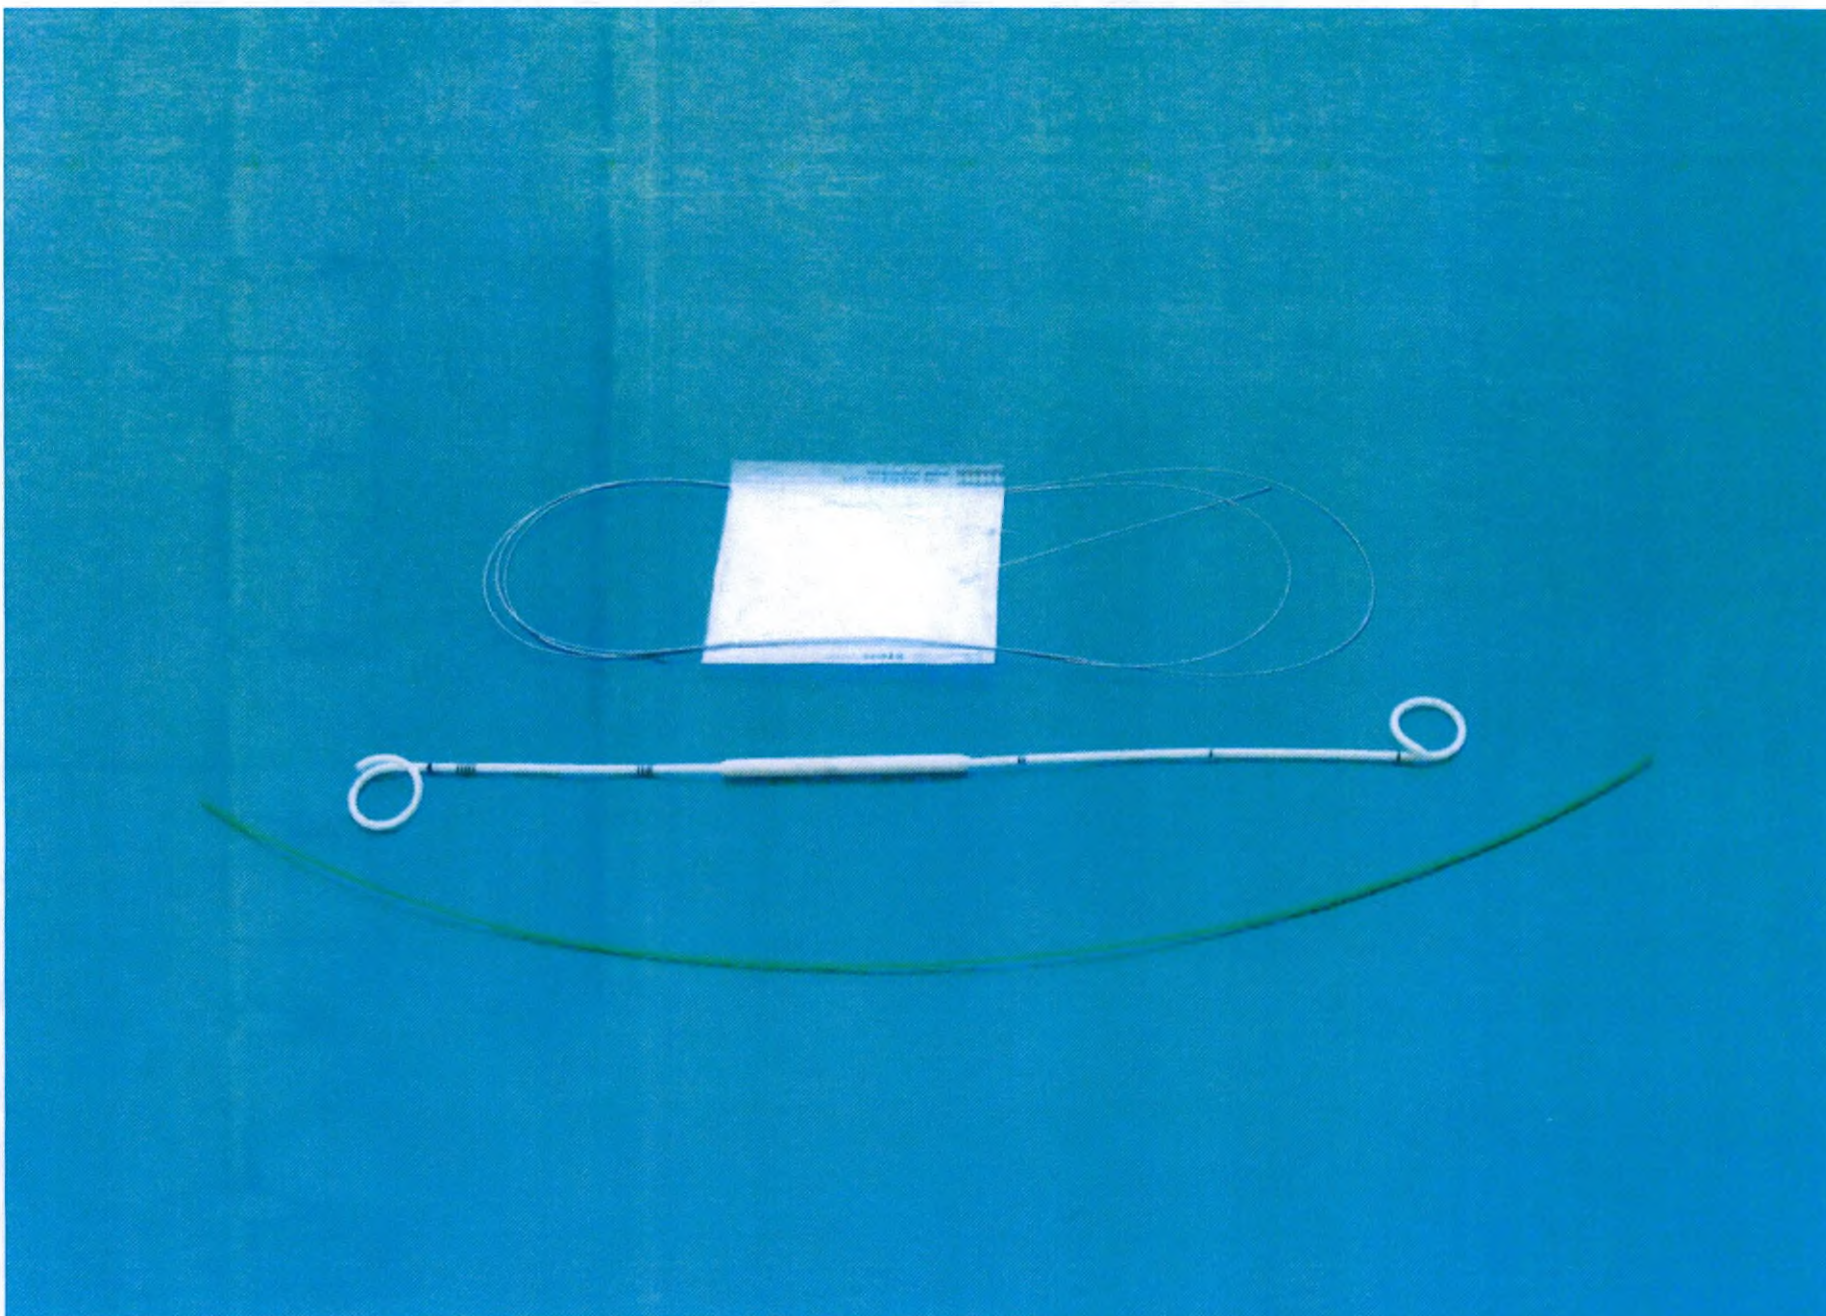

Набор стента для дренирования стриктур мочеочника с расширителем.



Набор медицинского для минимально инвазивных вмешательств
в комплексную лечебно-диагностическую «Эндо-БОП-М»

НАБОР СЕНТА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ СТРИКТУР
МОЧЕТОЧНИКА С РАСШИРИТЕЛЕМ

REF 118127-18

Сент для дренирования стриктур мочеоточника с расширителем
диаметр 7СН, длина 18См, расширитель 12СН
материал - латекс с контрастным наполнителем
Продолжение стриктур: диаметр 0,83См, длина 150См
Толщина: диаметр 7СН

Стерильно, герметично, нестерилизуемо
не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-0011
ТУ № РЭН 20/13/309 от 28.03.2018

STERILE



ООО «Минимално инвазивные технологии»
401087, Россия, Москва, ул. Басманная, пер. Мясницкий, д. 10
ИНН: 50/0552-0520, ОГРН: 5027054, email: info@mit.ru, website: mit.ru

Набор сента для дренирования стриктур мочеточника с расширителем, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

**НАБОР СТЕНТА ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ СТРИКТУР
МОЧЕТОЧНИКА С РАСШИРИТЕЛЕМ**

REF 118127-18

Сtent для дренирования стриктур мочеточника с расширителем
диаметр 7CH, длина 18см, расширитель 12CH
материал - полиуретан рентгеноконтрастный
Проводник прямой: диаметр 0,038", длина 150см
Толкатель: диаметр 7CH

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор стента для дренирования стриктур мочеточника с расширителем. Маркировка потребительской упаковки.

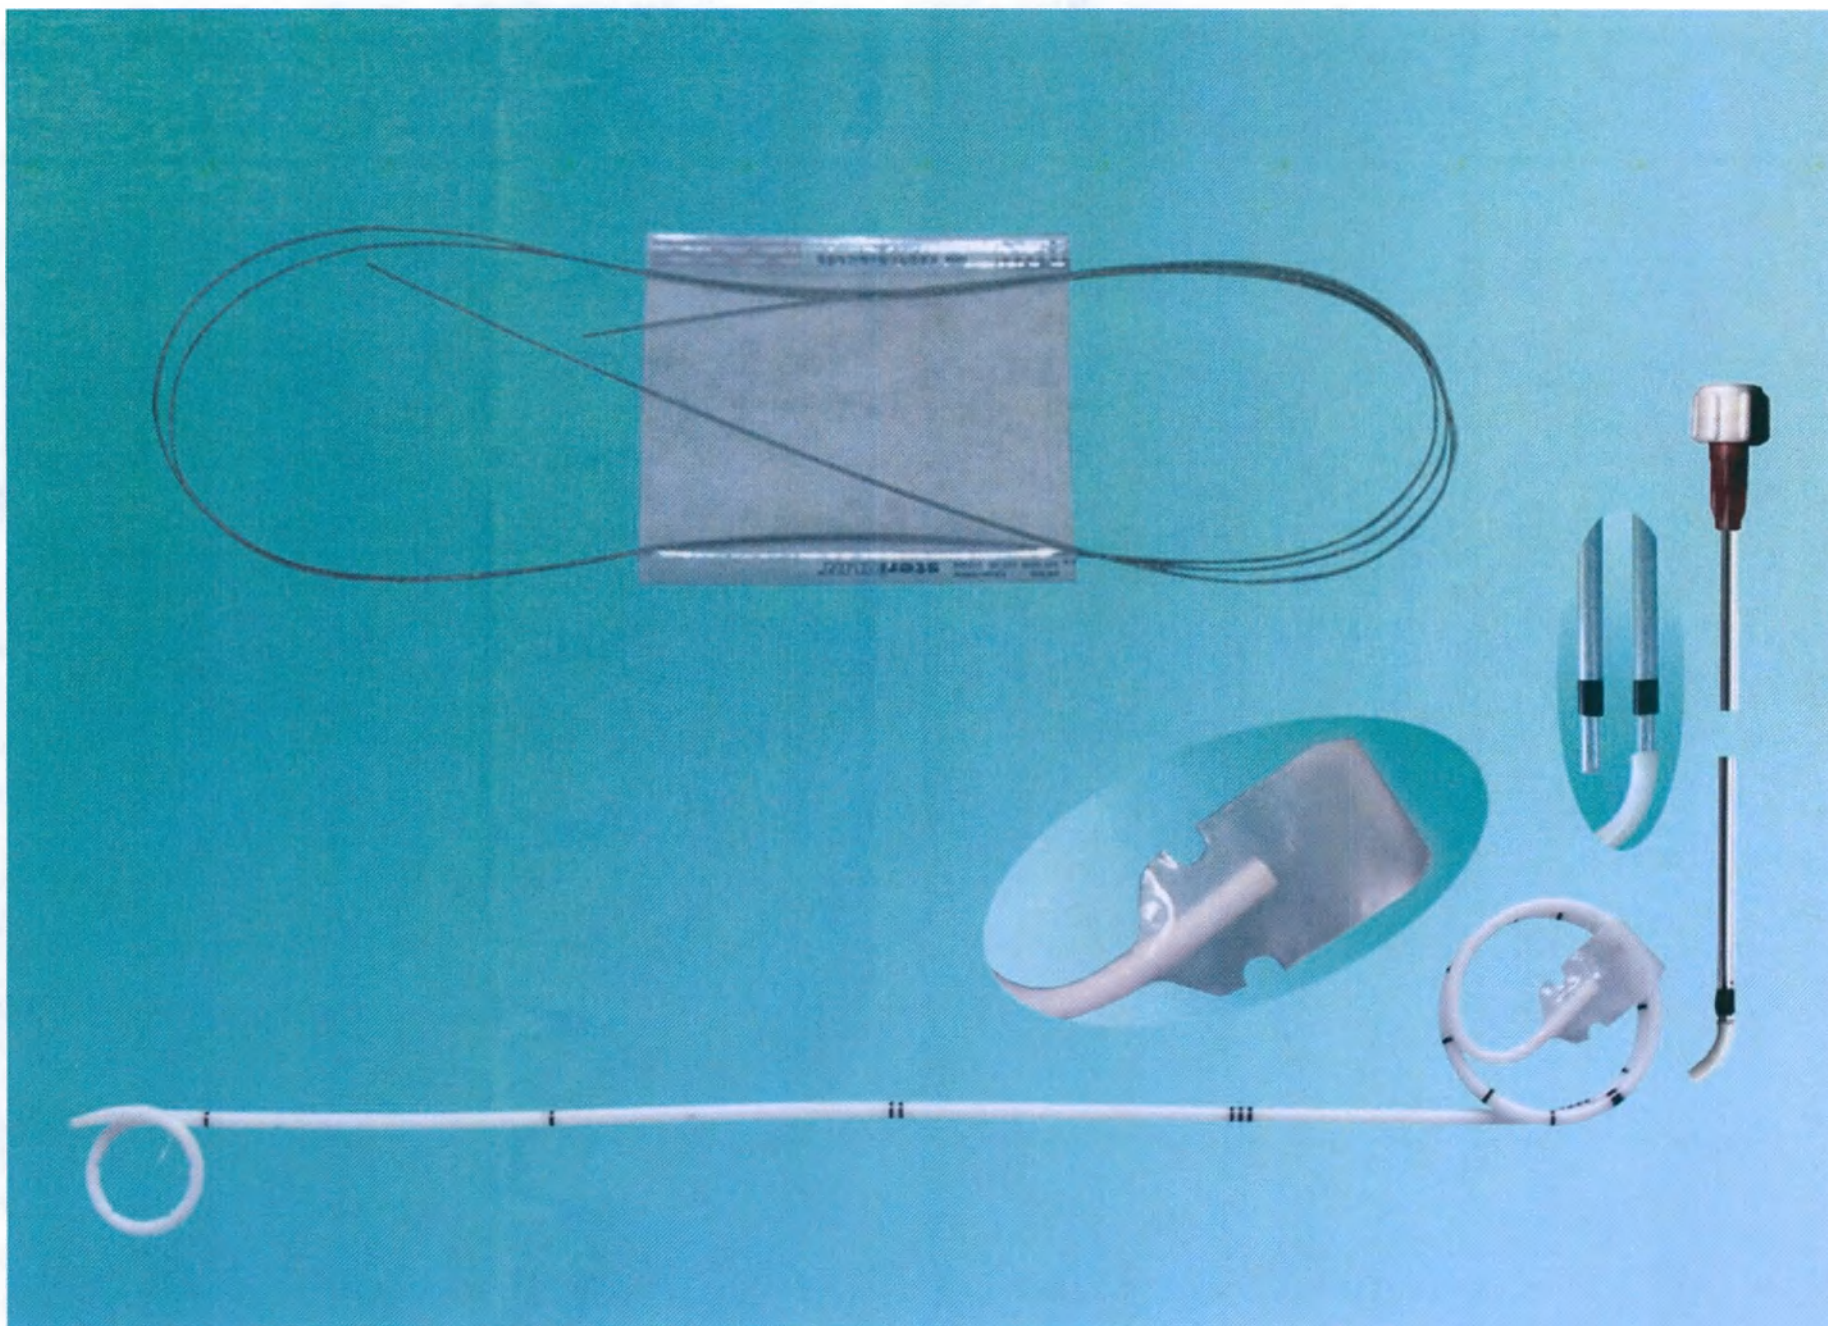

Набор стента мочеточникового универсальной длины «Морской конек» с антирефлюксным клапаном.

Наборы изделий для оказания медицинской помощи
в комплексе лечебно-диагностическому «Экспресс-М»
НАБОР СТЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ДЛИНЫ «МОРСКОЙ КОНЕК» С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ

REF 105115-18-30

Стект мочеточниковый универсальной длины «морской конек» с
антирефлюксным клапаном диаметром 9СН, длина 18-30см
Проломки: диаметр 0,032", длина 150см
Толщина: диаметр 9СН

Стерильно, в вакууме, «открыто»
На применение для наружного использования упаковки
ТУ 9437-007-42327674-2011
РЧ на РДН 20.13/1309 от 26.03.2018

STERILE



ООО «Минимедиа медицинская технология»
143907, Россия, Московская обл., г. Солнечногорск, Железнодорожный (п. Савинское)
ул. Л. Ткач, д. 10. Тел.: 8 (800) 522-1628, 522-7000, email: info@minimedia.ru, www.minimedia.ru

Набор стента мочеточникового универсальной длины «Морской конек» с антирефлюксным клапаном, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

**НАБОР СТЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ДЛИНЫ «МОРСКОЙ КОНЕК» С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ**

REF 105115-18-30

Стент мочеточниковый универсальной длины «морской конек» с
антирефлюксным клапаном диаметр 5СН, длина 18-30см
Проводник прямой: диаметр 0,032", длина 150см
Толкатель: диаметр 5СН


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

PV № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор стента мочеточникового универсальной длины «Морской конек» с антирефлюксным клапаном. Маркировка
потребительской упаковки.

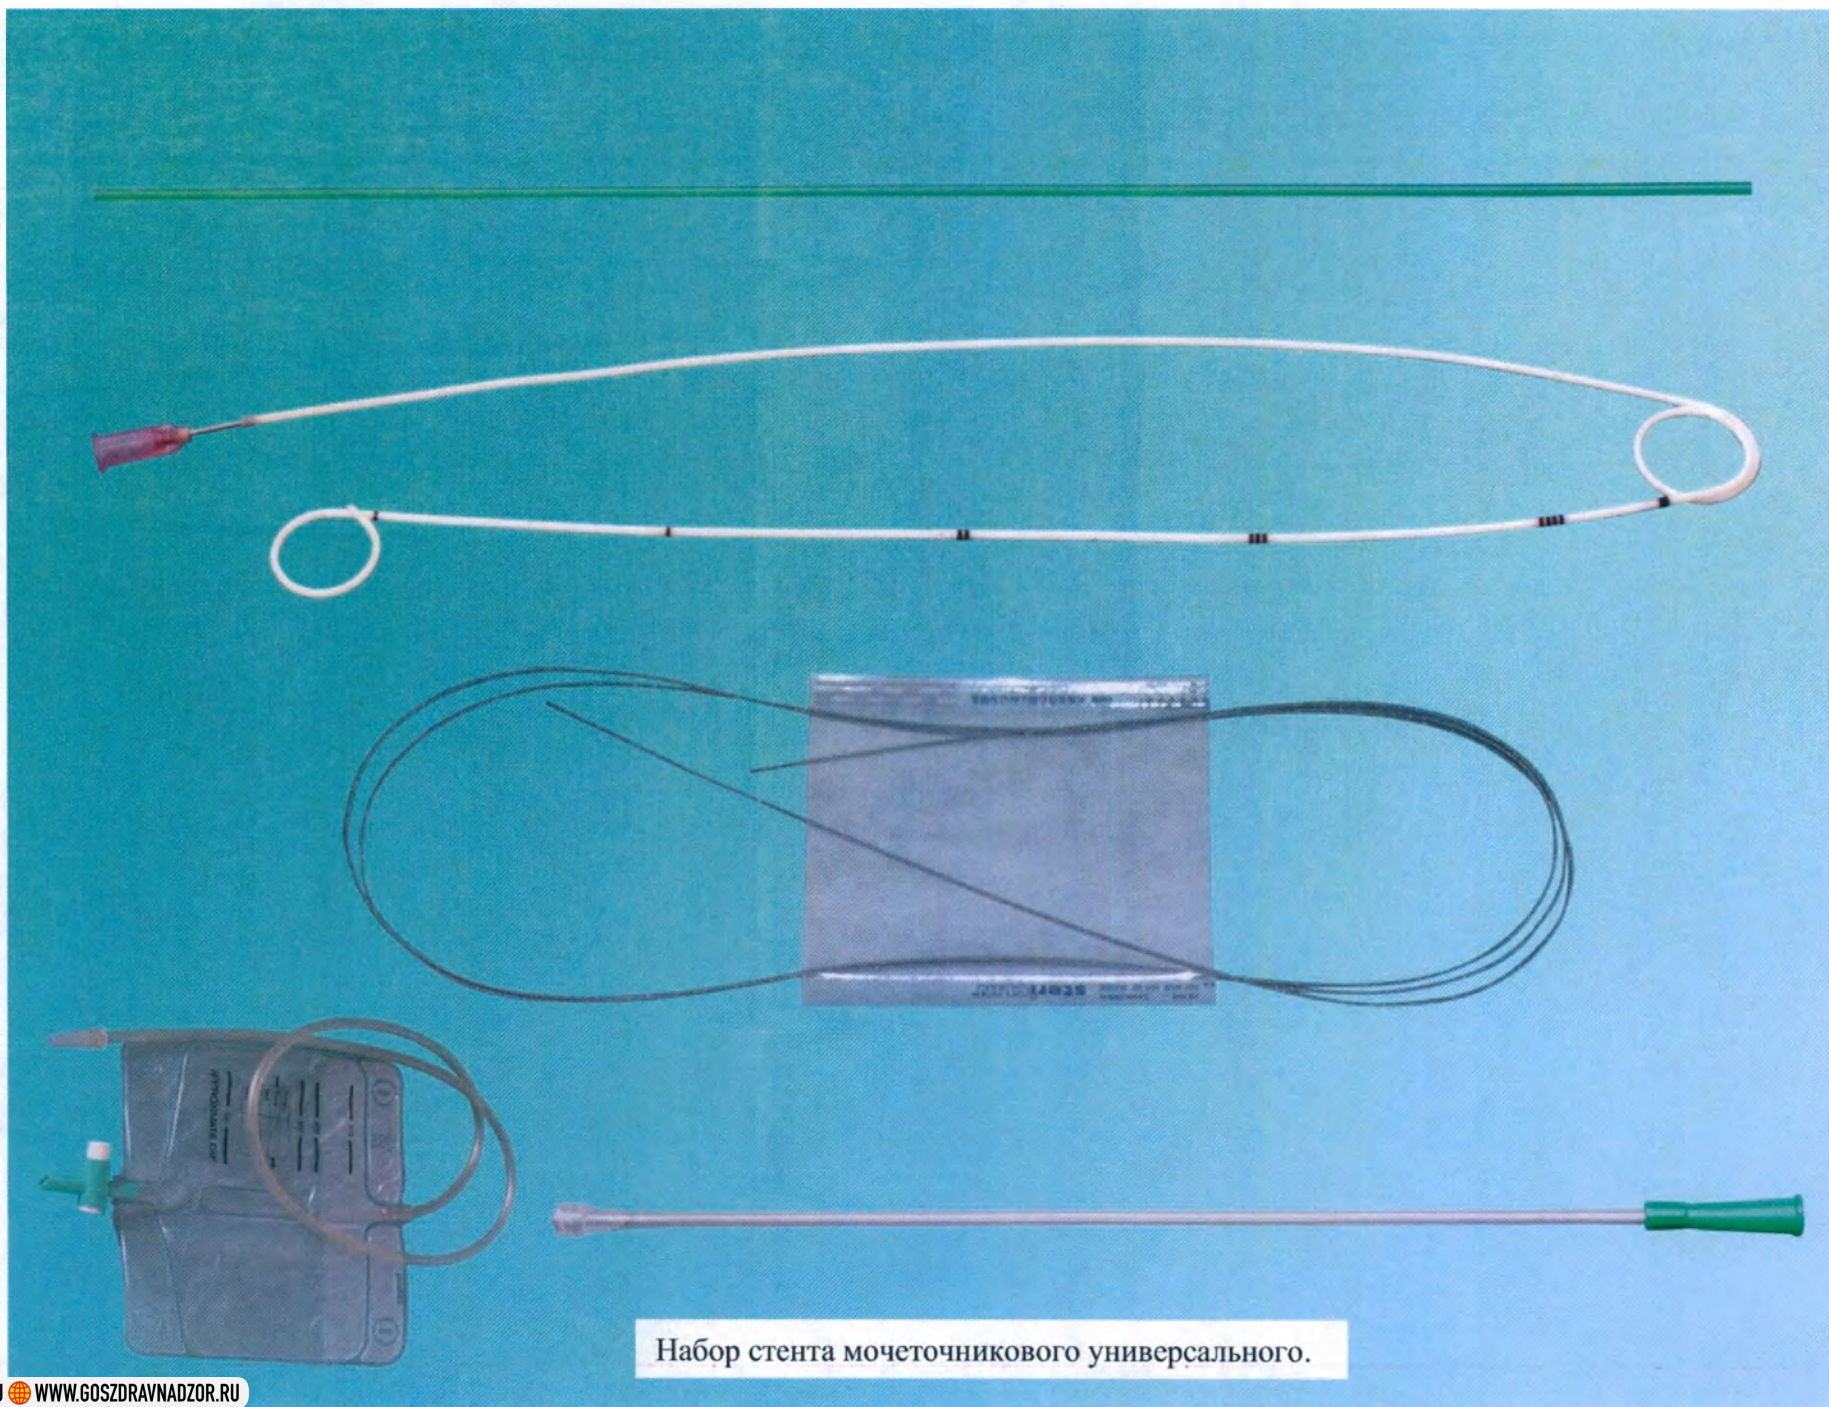

Набор стента мочеточникового универсального.

Наборы инструментов для минимально инвазивной хирургии
в отоларингологии и оториноларингологии «Лидо-МедТех»
НАБОР СТЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
REF 119215-06

Степт мочеточниковый универсальный (с выносом петлею) диаметр 5CH
длина 6см
материал - полиуретан рентгеноконтрастный
Проводник диаметр 0,032"
Толкатель диаметр 5CH
Адаптер, удлинитель

Стерильно, асептично, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-4223/874-2011
РУ № РОИ 2013/1308 от 26.03.2018

STERILE R

ООО «Минимально инвазивные технологии»
143687, Россия, Московская обл., г. Балашиха, пер. Железнодорожный, д. 3, Соколики,
ит. 67, стр. 5. Тел.: 8 (495) 622-1025, 522-7034, email: info_mit@yandex.ru, www.mit.ru

Набор стента мочеточникового универсального, в потребительской упаковке.


Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»
НАБОР СЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО

REF 119215-06

Сент мочеточниковый универсальный (с выводом наружу) диаметр 5CH,
длина 6см
материал - полиуретан рентгеноконтрастный
Проводник диаметр 0,032"
Толкатель диаметр 5CH
Адаптер, удлинитель

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор сента мочеточникового универсального. Маркировка потребительской упаковки.

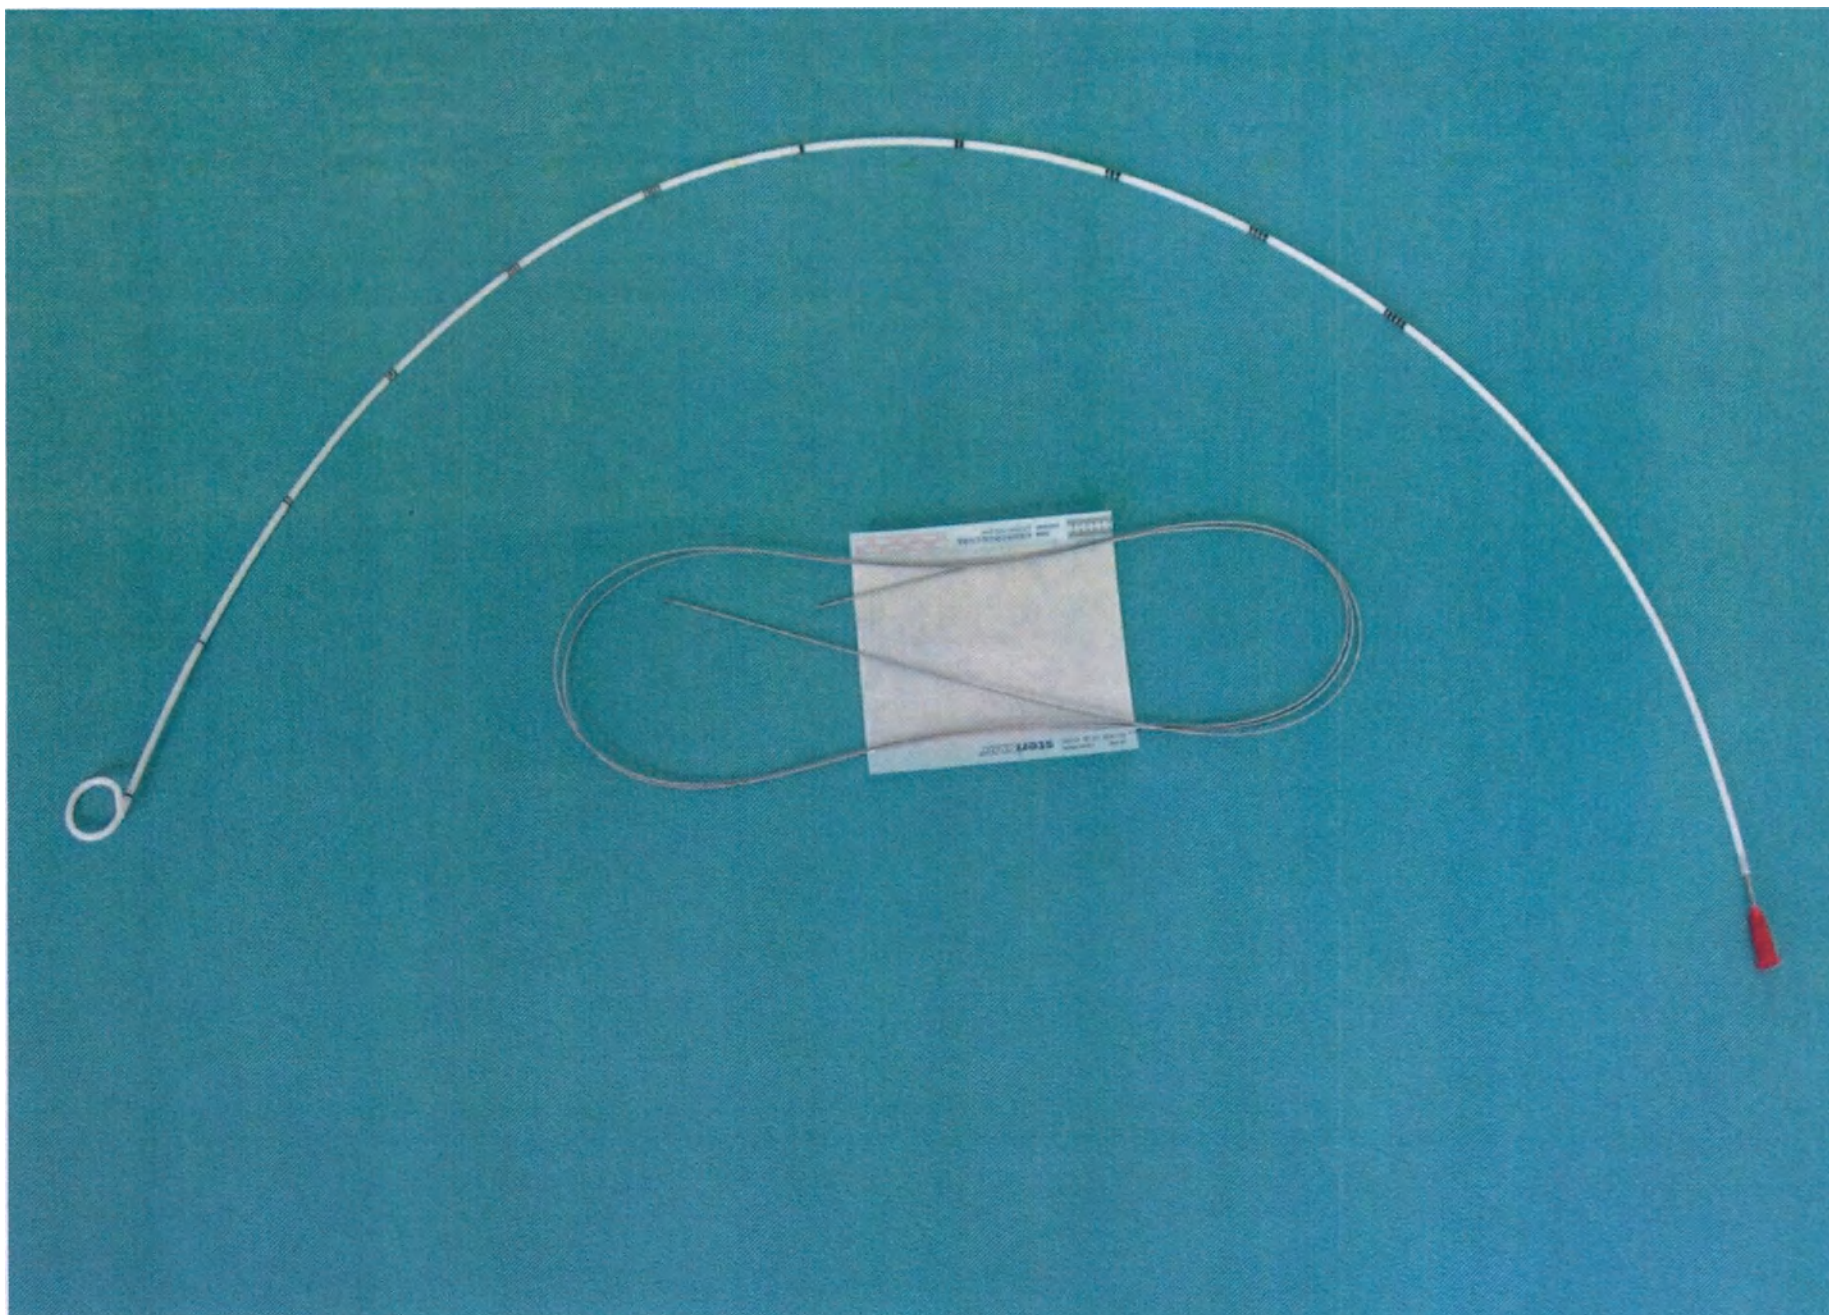

Набор стента наружного мочеточникового типа «свиной хвост».

Наборы инструментов для минимально инвазивных вмешательств
в урологии лечебно-диагностическому «Эндо-300Т-86»
**НАБОР СТЕНТА НАРУЖНОГО МОЧЕТОЧНИКОВОГО
ТИПА «СВИНОЙ ХВОСТ»**

REF 141105

Стект наружный мочеточниковый типа свиной хвост диаметр 9См,
длина 78см, полиуретан рентгеноконтрастный
Прокладка диаметр 8,832", длина 198см
Адаптер

Стерильно, асептично, изопакетно
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-067-42337814-2711
РУ № РЭН 2013/1308 от 26.03.2018

STERILE II



ООО «Медикально-технические технологии»

143980, Россия, Москва, обл., г. Балашиха, пер. Холмогоровский, д. 3, Строитель,
тел: 8 (495) 522-1622, 522-2754, email: mtg@mtg.ru, www.mtg.ru

Набор стента наружного мочеточникового типа «свиной хвост», в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


**НАБОР СТЕНТА НАРУЖНОГО МОЧЕТОЧНИКОВОГО
ТИПА «СВИНОЙ ХВОСТ»**

REF 141105

Стент наружный мочеточниковый типа «свиной хвост» диаметр 5CH,
длина 70см, полиуретан рентгеноконтрастный
Проводник диаметр 0,032", длина 150см
Адаптер

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор стента наружного мочеточникового типа «свиной хвост». Маркировка потребительской упаковки.

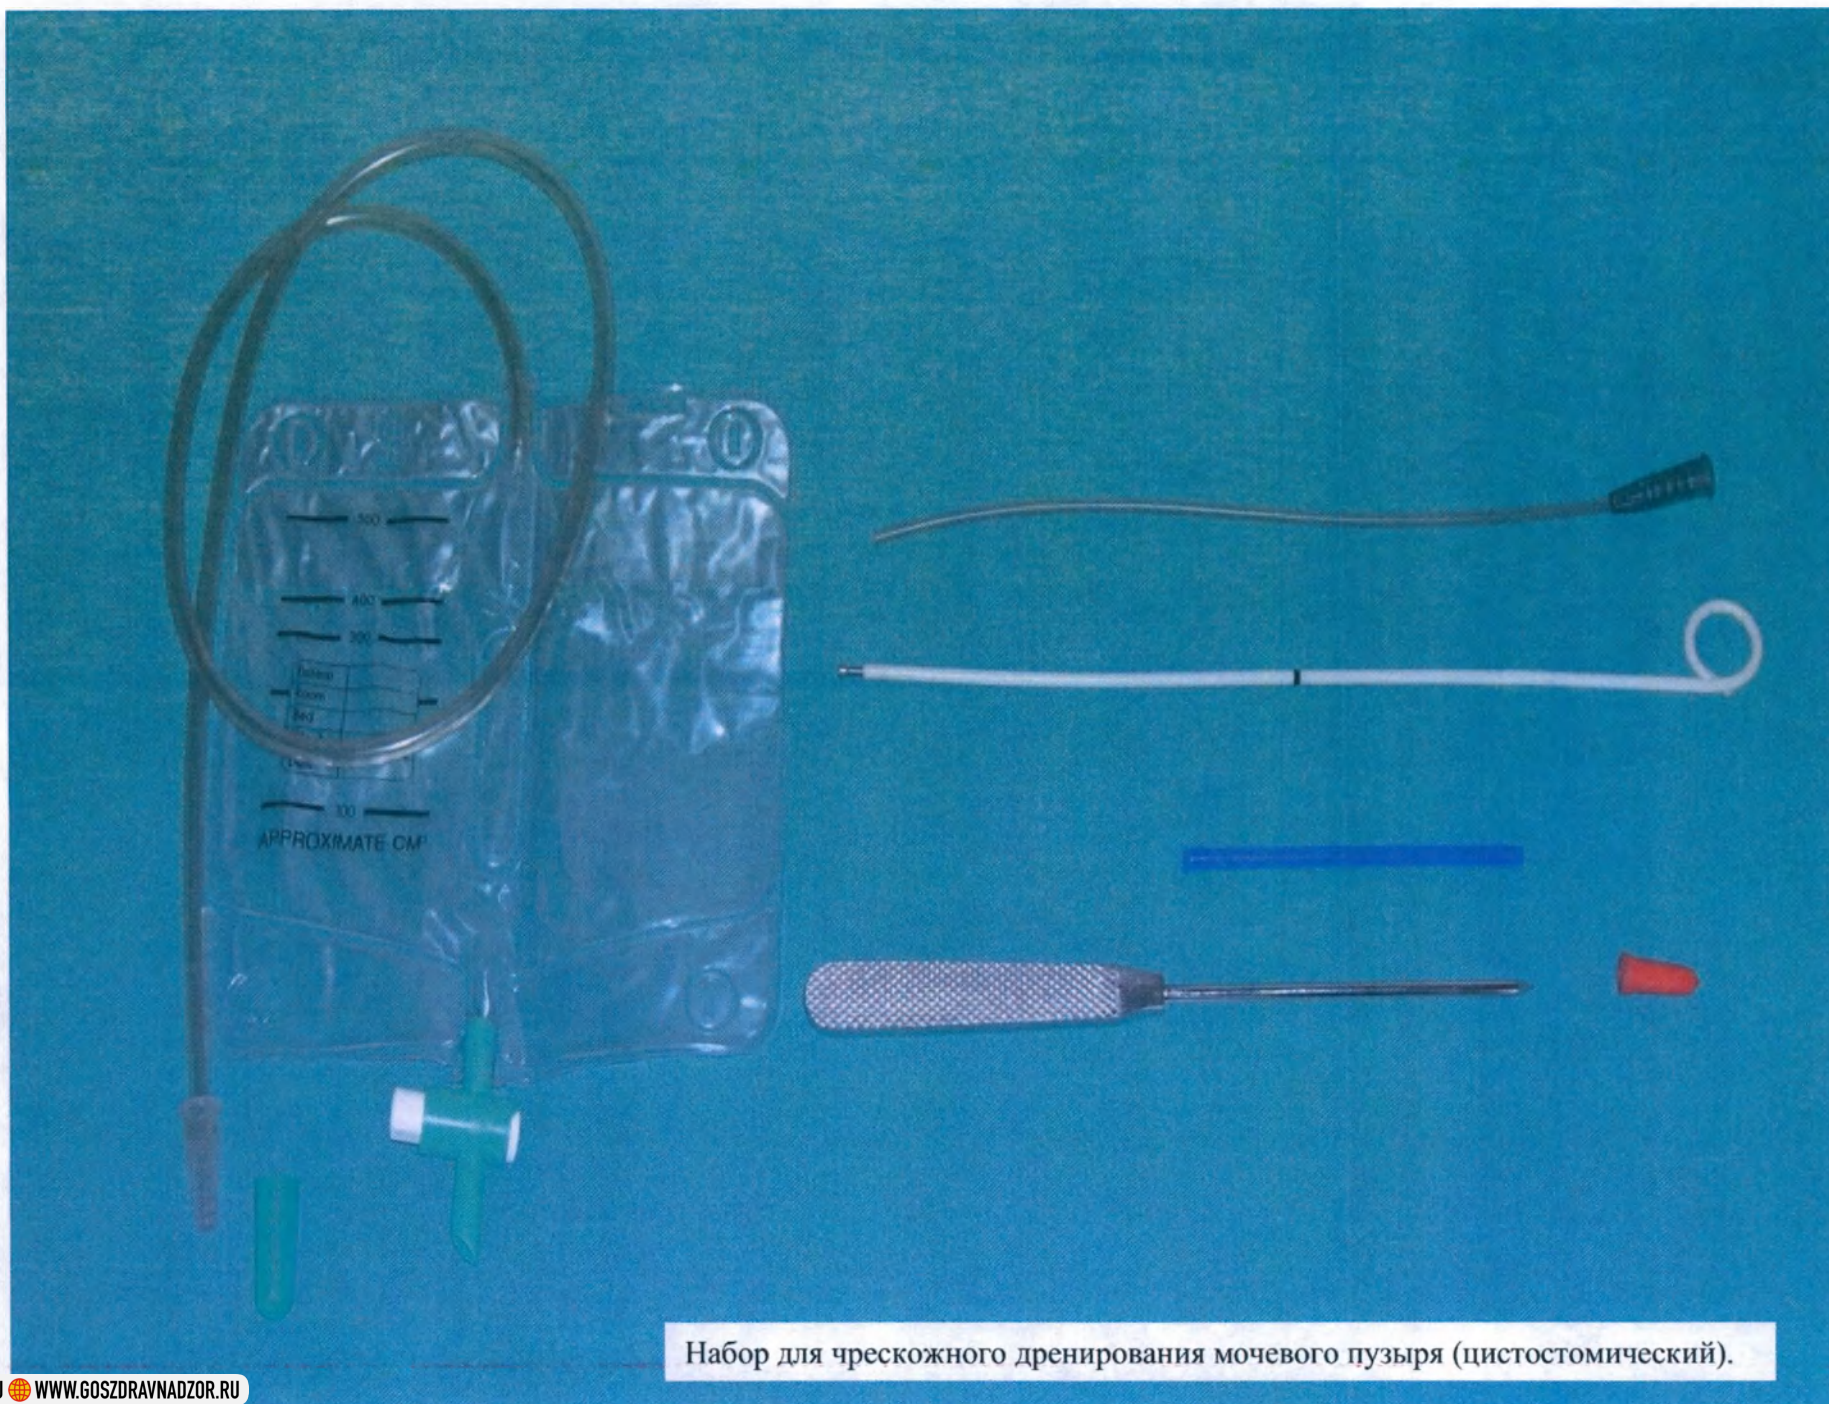

Набор для чрескожного дренирования мочевого пузыря (цистостомический).



Наборы медицинские для минимально инвазивной хирургии
в комплексе лечебно-диагностическому «Экзо-Med 88»

НАБОР ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (ЦИСТОСТОМИЧЕСКИЙ)

REF 130012

Катетер цистостомический диаметр 120H

Тренинг

Иригатор

Удалитель

Мочеприемник

Стерильно, асептично, нестерильно

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-017-42337874-2011

РР № 9/24 2913/1309 от 26.03.2018

STERILE



ООО «Минимед» минимально инвазивная хирургия

43001, Россия, Москва, м.п. «Богородица», ул. Железнодорожная, д. 10

Набор для чрескожного дренирования мочевого пузыря (цистостомический), в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


**НАБОР ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (ЦИСТОСТОМИЧЕСКИЙ)**

REF 130012

Катетер цистостомический диаметр 12СН
Троакар
Интродюсер
Удлинитель
Мочеприемник

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R




ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
--- 04 --- 5 Тел. 8 (495) 500 4005 500 7004

Набор для чрескожного дренирования мочевого пузыря (цистостомический). Маркировка потребительской упаковки.

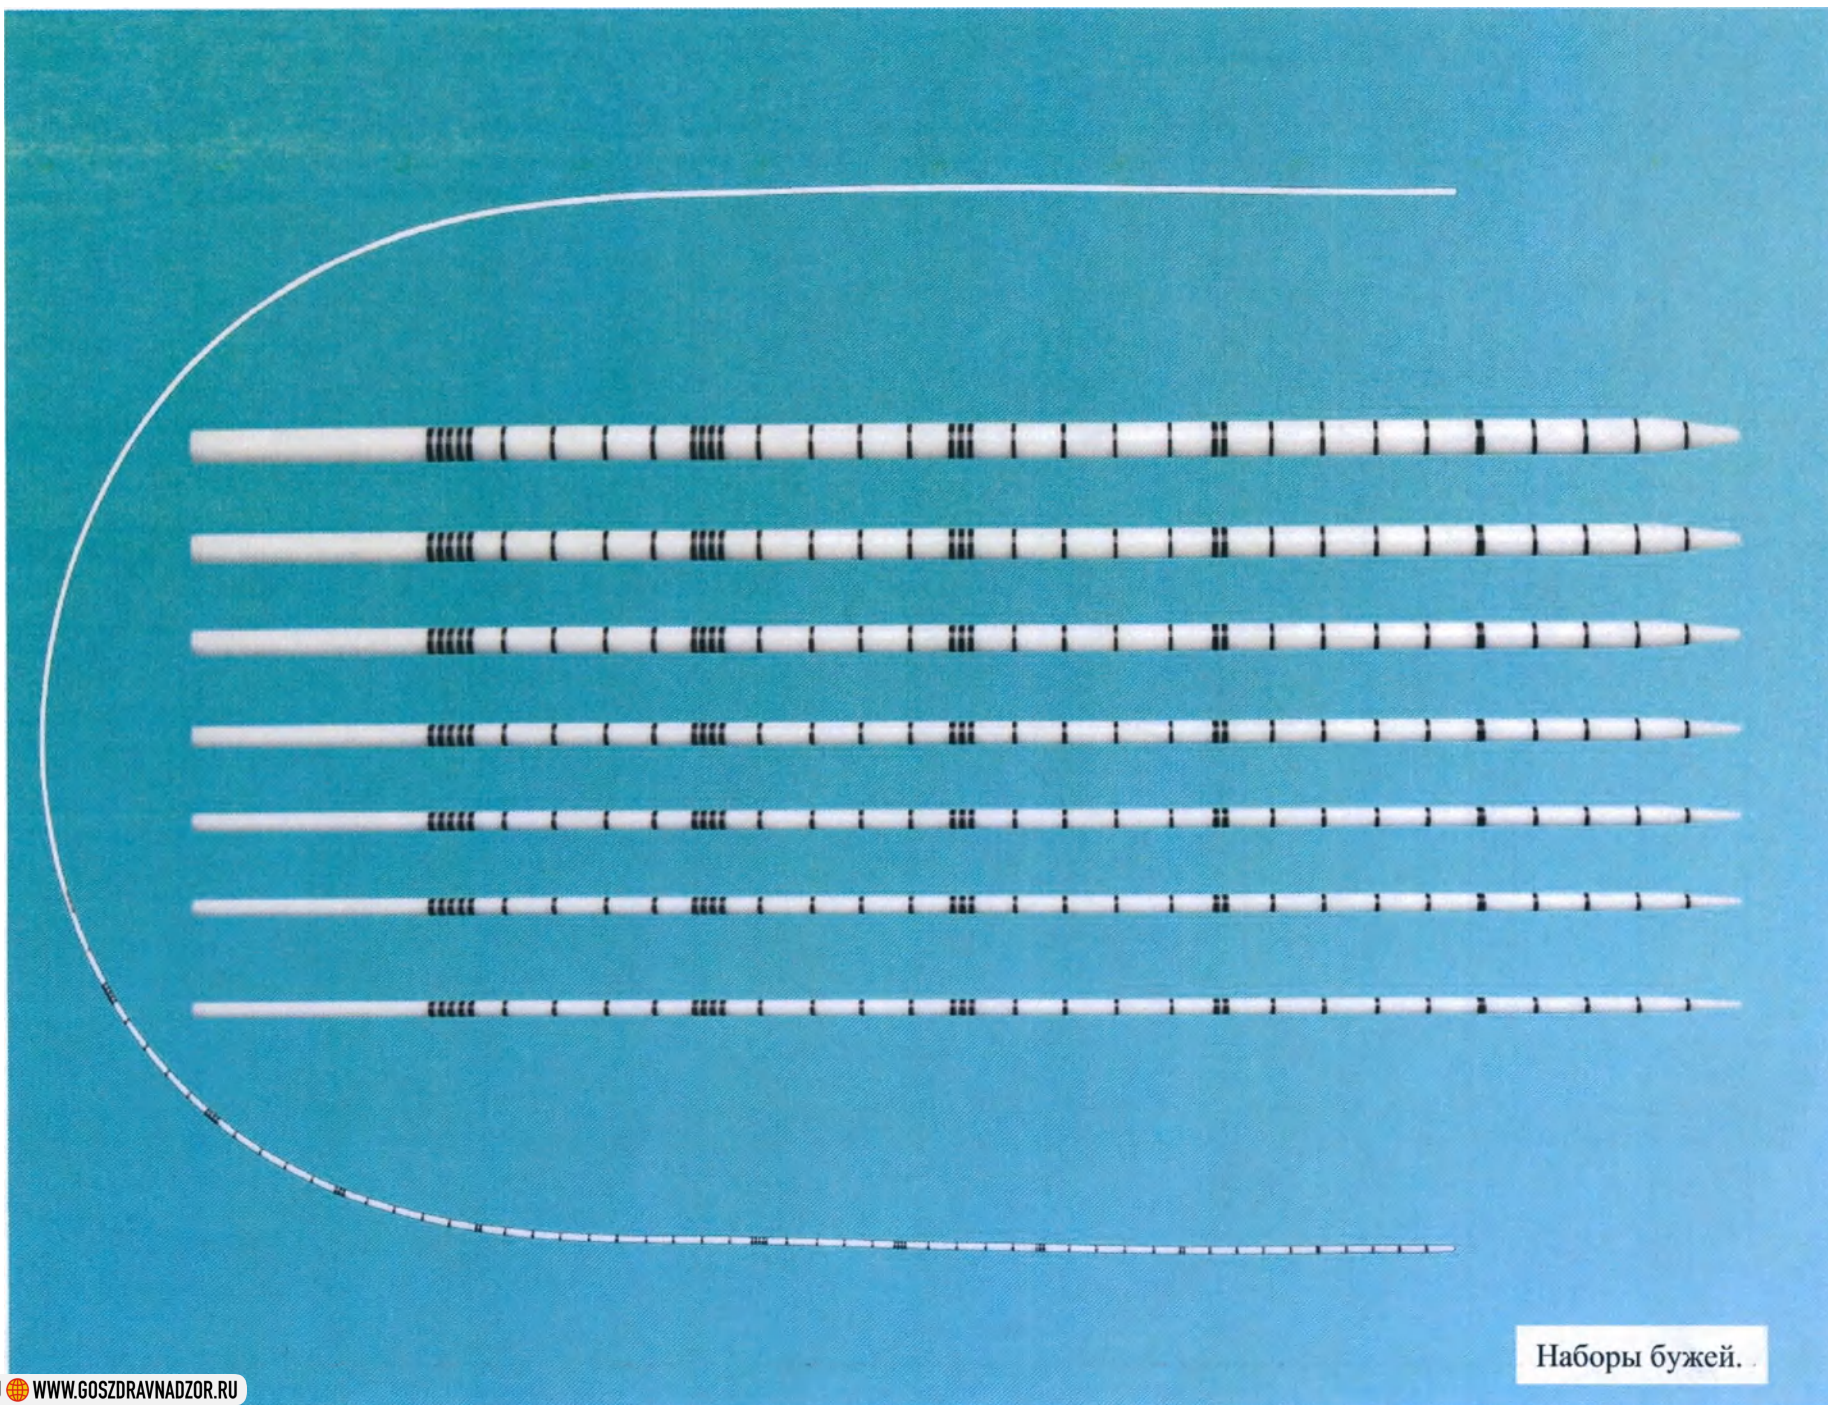

Наборы бужей.

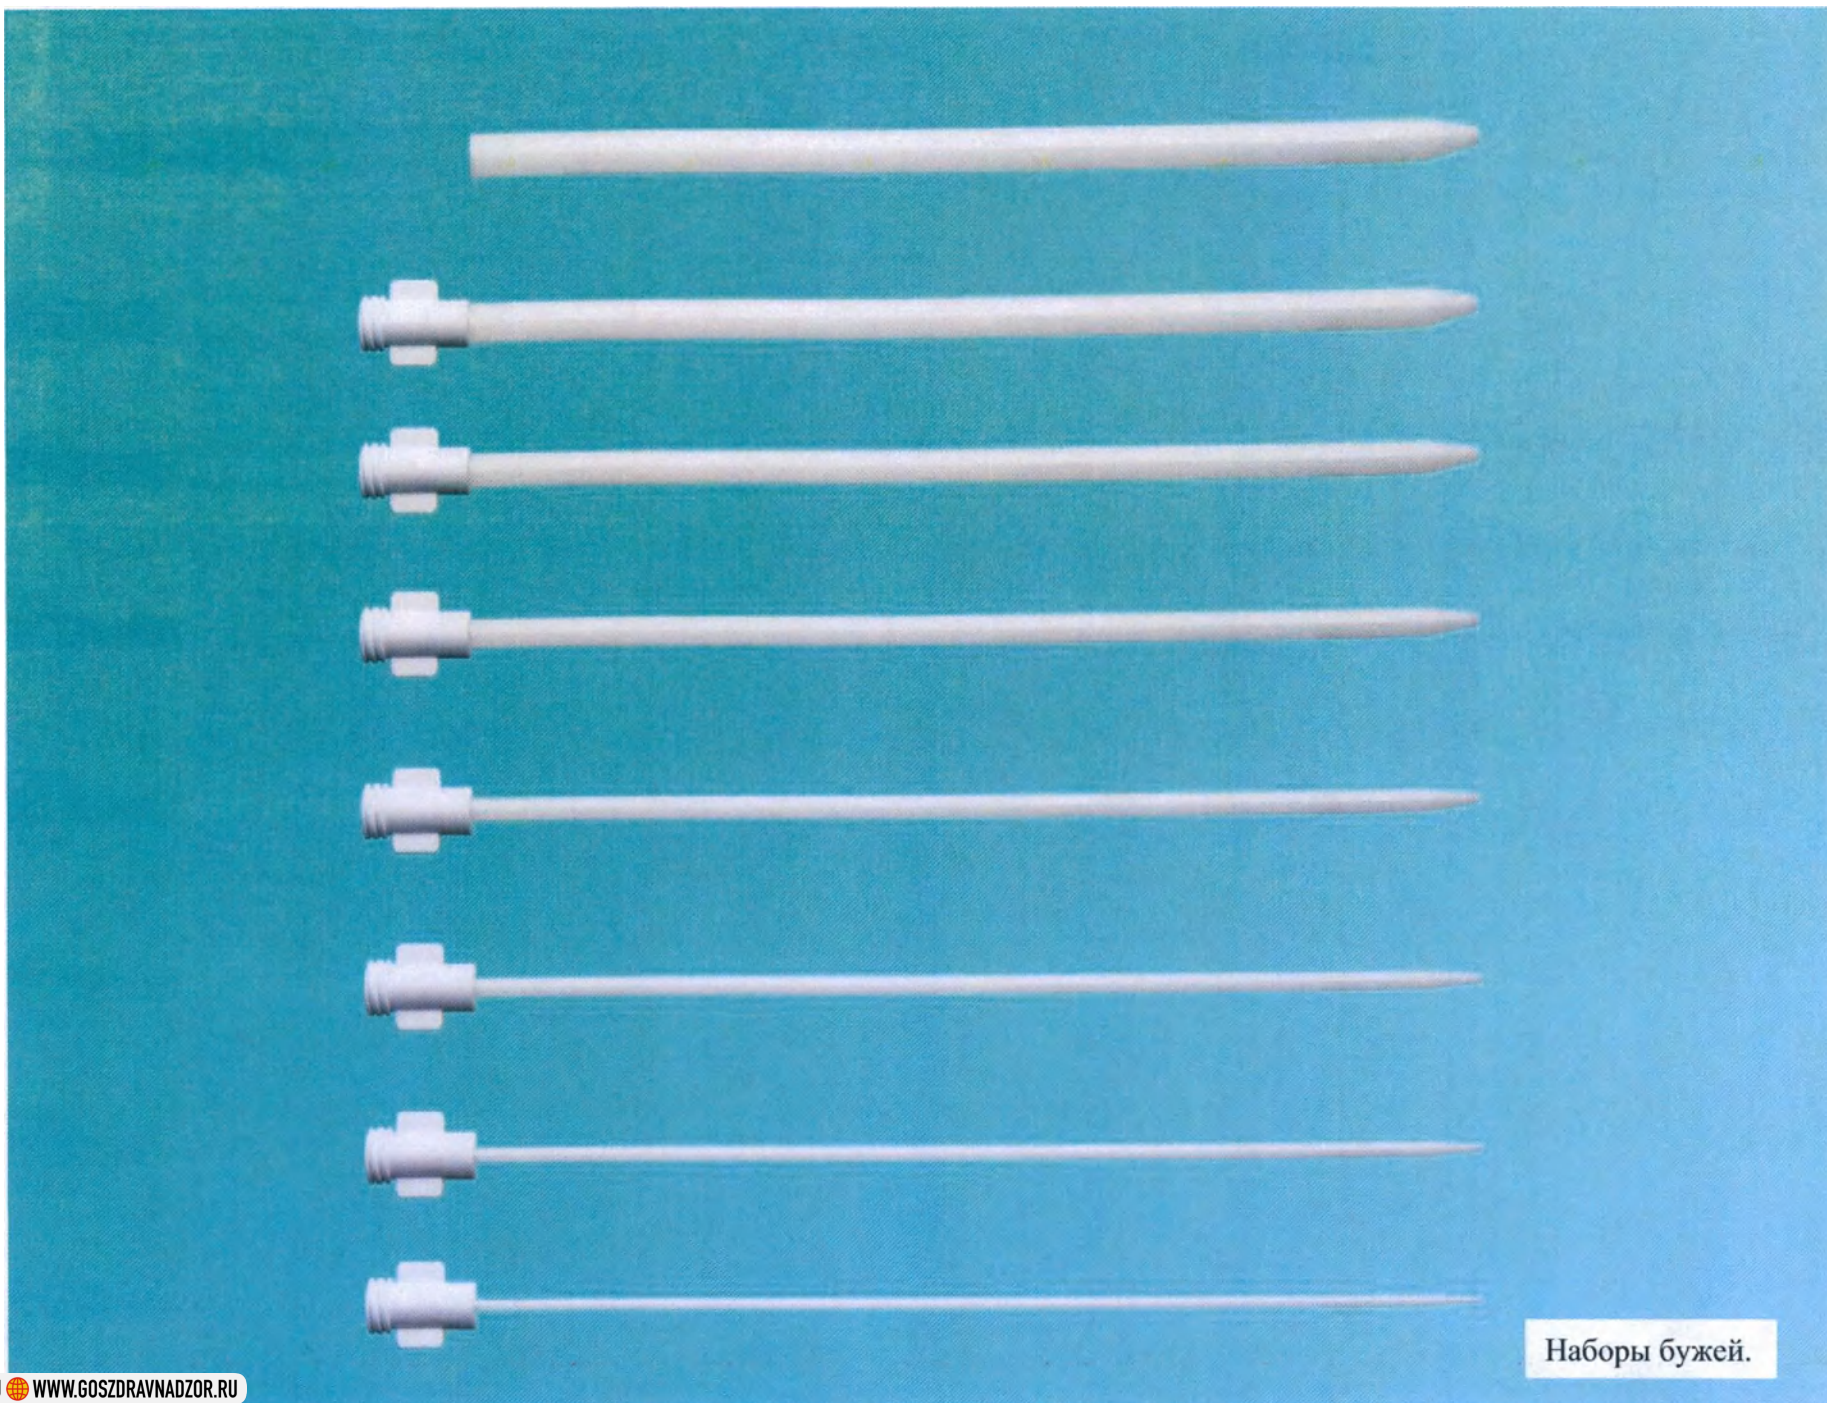

Наборы бужей.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-MHT-И»

НАБОР БУЖЕЙ

REF 116102

Буж: диаметр 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14CH, длина 25см,
Буж: диаметр 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14CH, длина 55см,
материал - полиуретан рентгеноконтрастный

Стерильно, асептично, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РД № РЗН 2013/1309 от 28.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143587, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл. 61, стр. 5. Тел.: 8(495)523-1625, 523-7034 email: ml_nbt@mail.ru, www.mni.ru

Наборы бужей, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР БУЖЕЙ

REF 116102

Бужи: диаметр 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14СН, длина 25см,
Бужи: диаметр 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14СН, длина 55см,
материал - полиуретан рентгеноконтрастный


Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Наборы бужей. Маркировка потребительской упаковки.

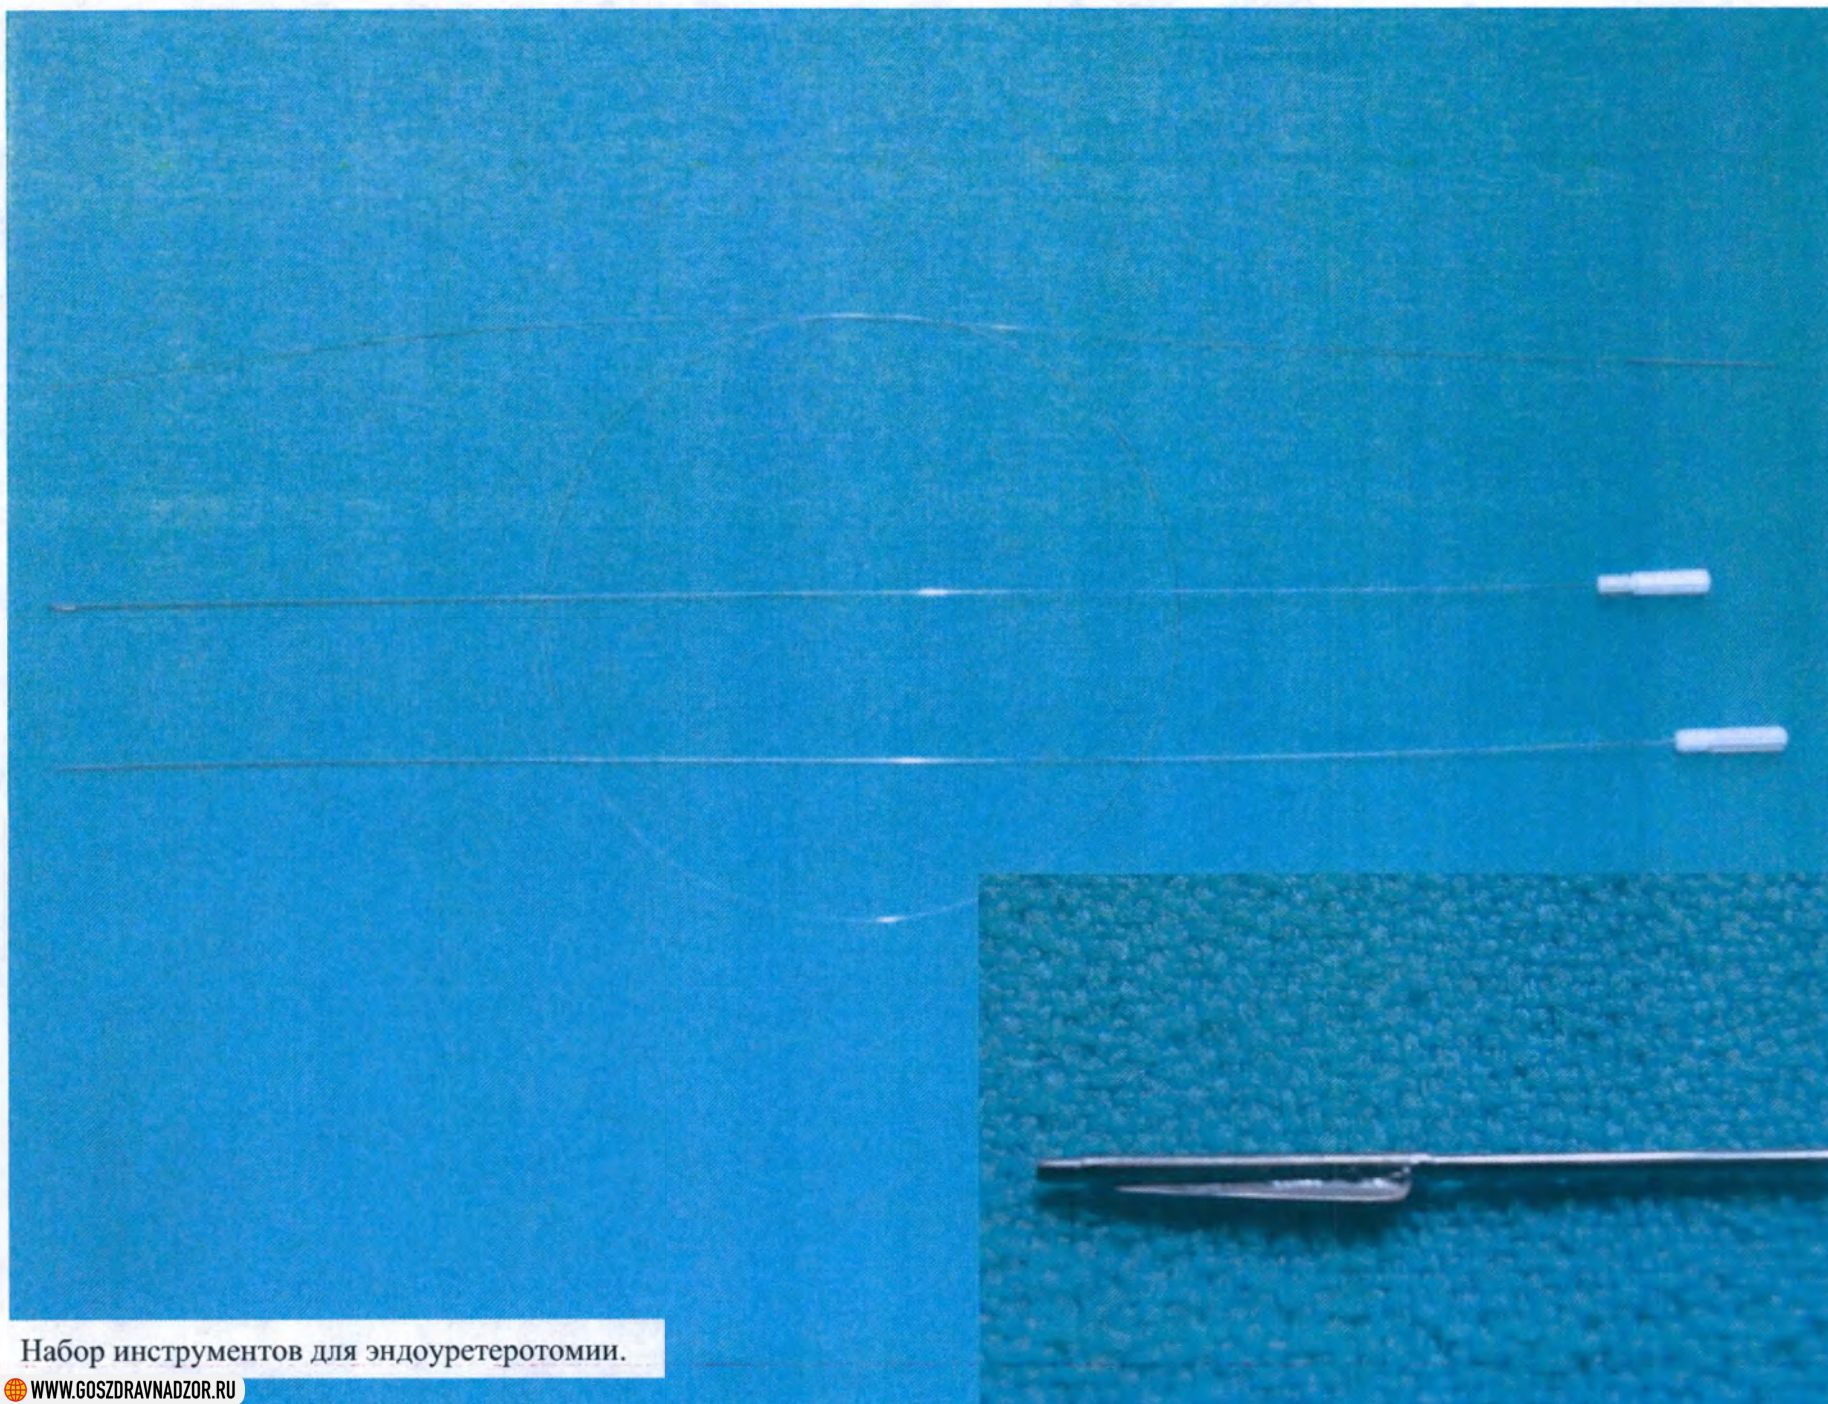

Набор инструментов для эндоуретеротомии.



Информация для медицинского персонала
и пациентов о стерилизации и упаковке
набора инструментов для эндоентомологии

Внимание! Для стерилизации и упаковки
набора инструментов для эндоентомологии
используйте только стерильные материалы.

Стерилизация, упаковка, хранение
наборов инструментов для эндоентомологии
по ГОСТ 28540-90 и ГОСТ 28541-90.

Внимание! Для стерилизации и упаковки
набора инструментов для эндоентомологии
используйте только стерильные материалы.

Набор инструментов для эндоентомологии, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭНДОУРЕТЕРОТОМИИ

REF

Нож: диаметр 5СН, длина 65см
Проводник (составной сверхжесткий)
Толкатель

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор инструментов для эндоуретеротомии. Маркировка потребительской упаковки.

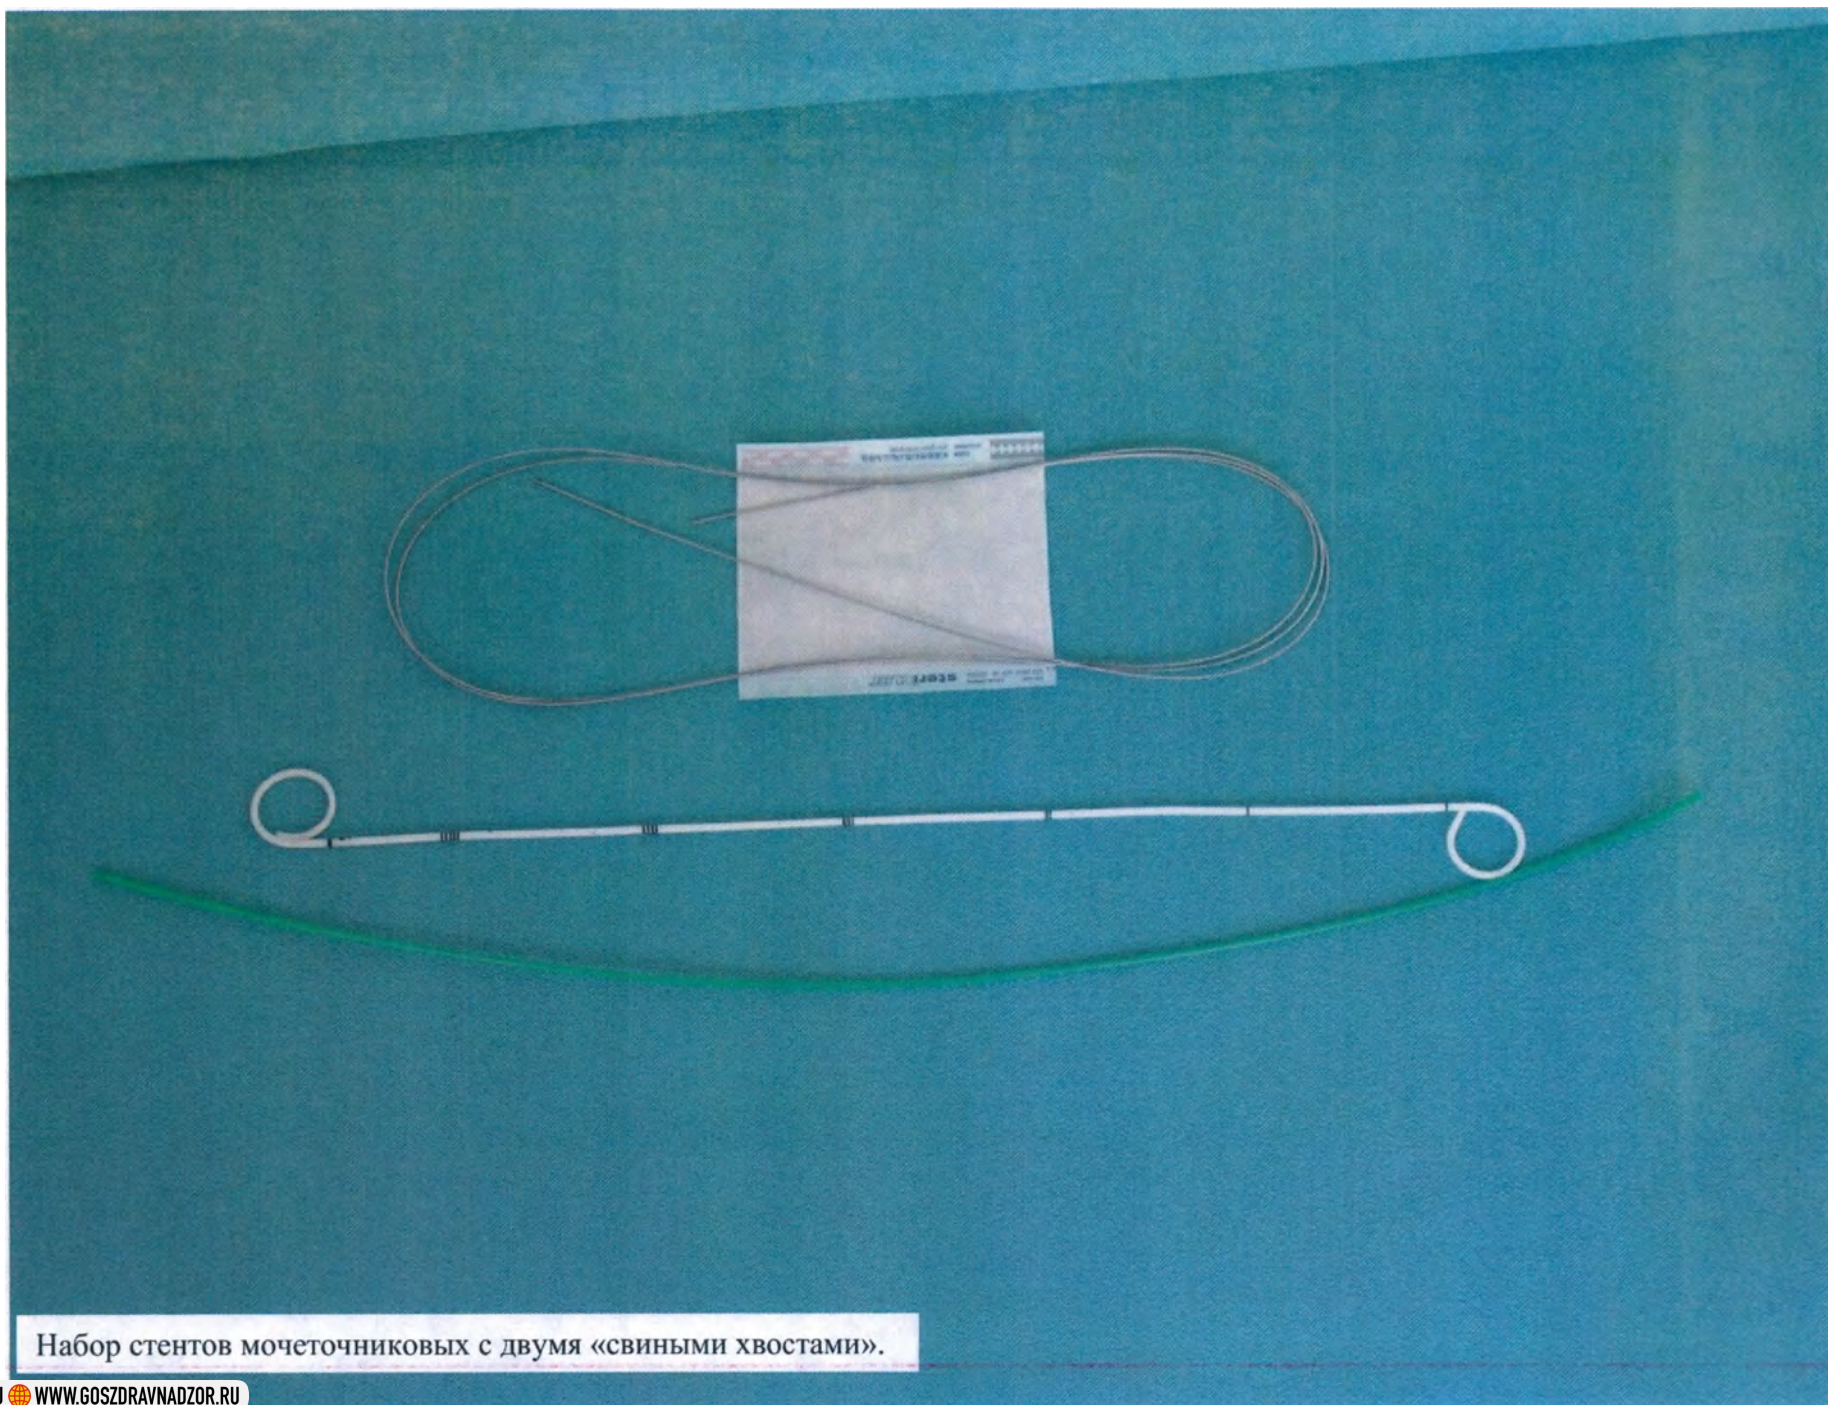

Набор стентов мочеточниковых с двумя «свиными хвостами».

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу печеночно-диагностическому «Эндо-МНТ-М»

**НАБОР СТЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО
С ДВУМЯ «СВИНЫМИ ХВОСТАМИ»**

REF 131108-26

Сtent мочеточниковый с двумя «свиными хвостами» диаметр 9 FCN,
длина 26см
материал - полиуретан рентгеноконтрастный
Проводник диаметр 0,318", длина 150см
Толкатель диаметр 9CN

Стерильно, асептично, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РОИ 2013/1309 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143087, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
кв. 61, стр. 5. Тел.: 8(495)522-1825, 522-7534, email: mti_80@mail.ru, www.ooo-mti.ru

Набор стентов мочеточниковых с двумя «свиными хвостами», в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

**НАБОР СТЕНТА МОЧЕТОЧНИКОВОГО
С ДВУМЯ «СВИНЫМИ ХВОСТАМИ»**

REF 131108-26

Стент мочеточниковый с двумя «свиными хвостами» диаметр 9 CH,
длина 26см

материал - полиуретан рентгеноконтрастный

Проводник диаметр 0,038", длина 150см

Толкатель диаметр 9CH


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор стентов мочеточниковых с двумя «свиными хвостами». Маркировка потребительской упаковки.

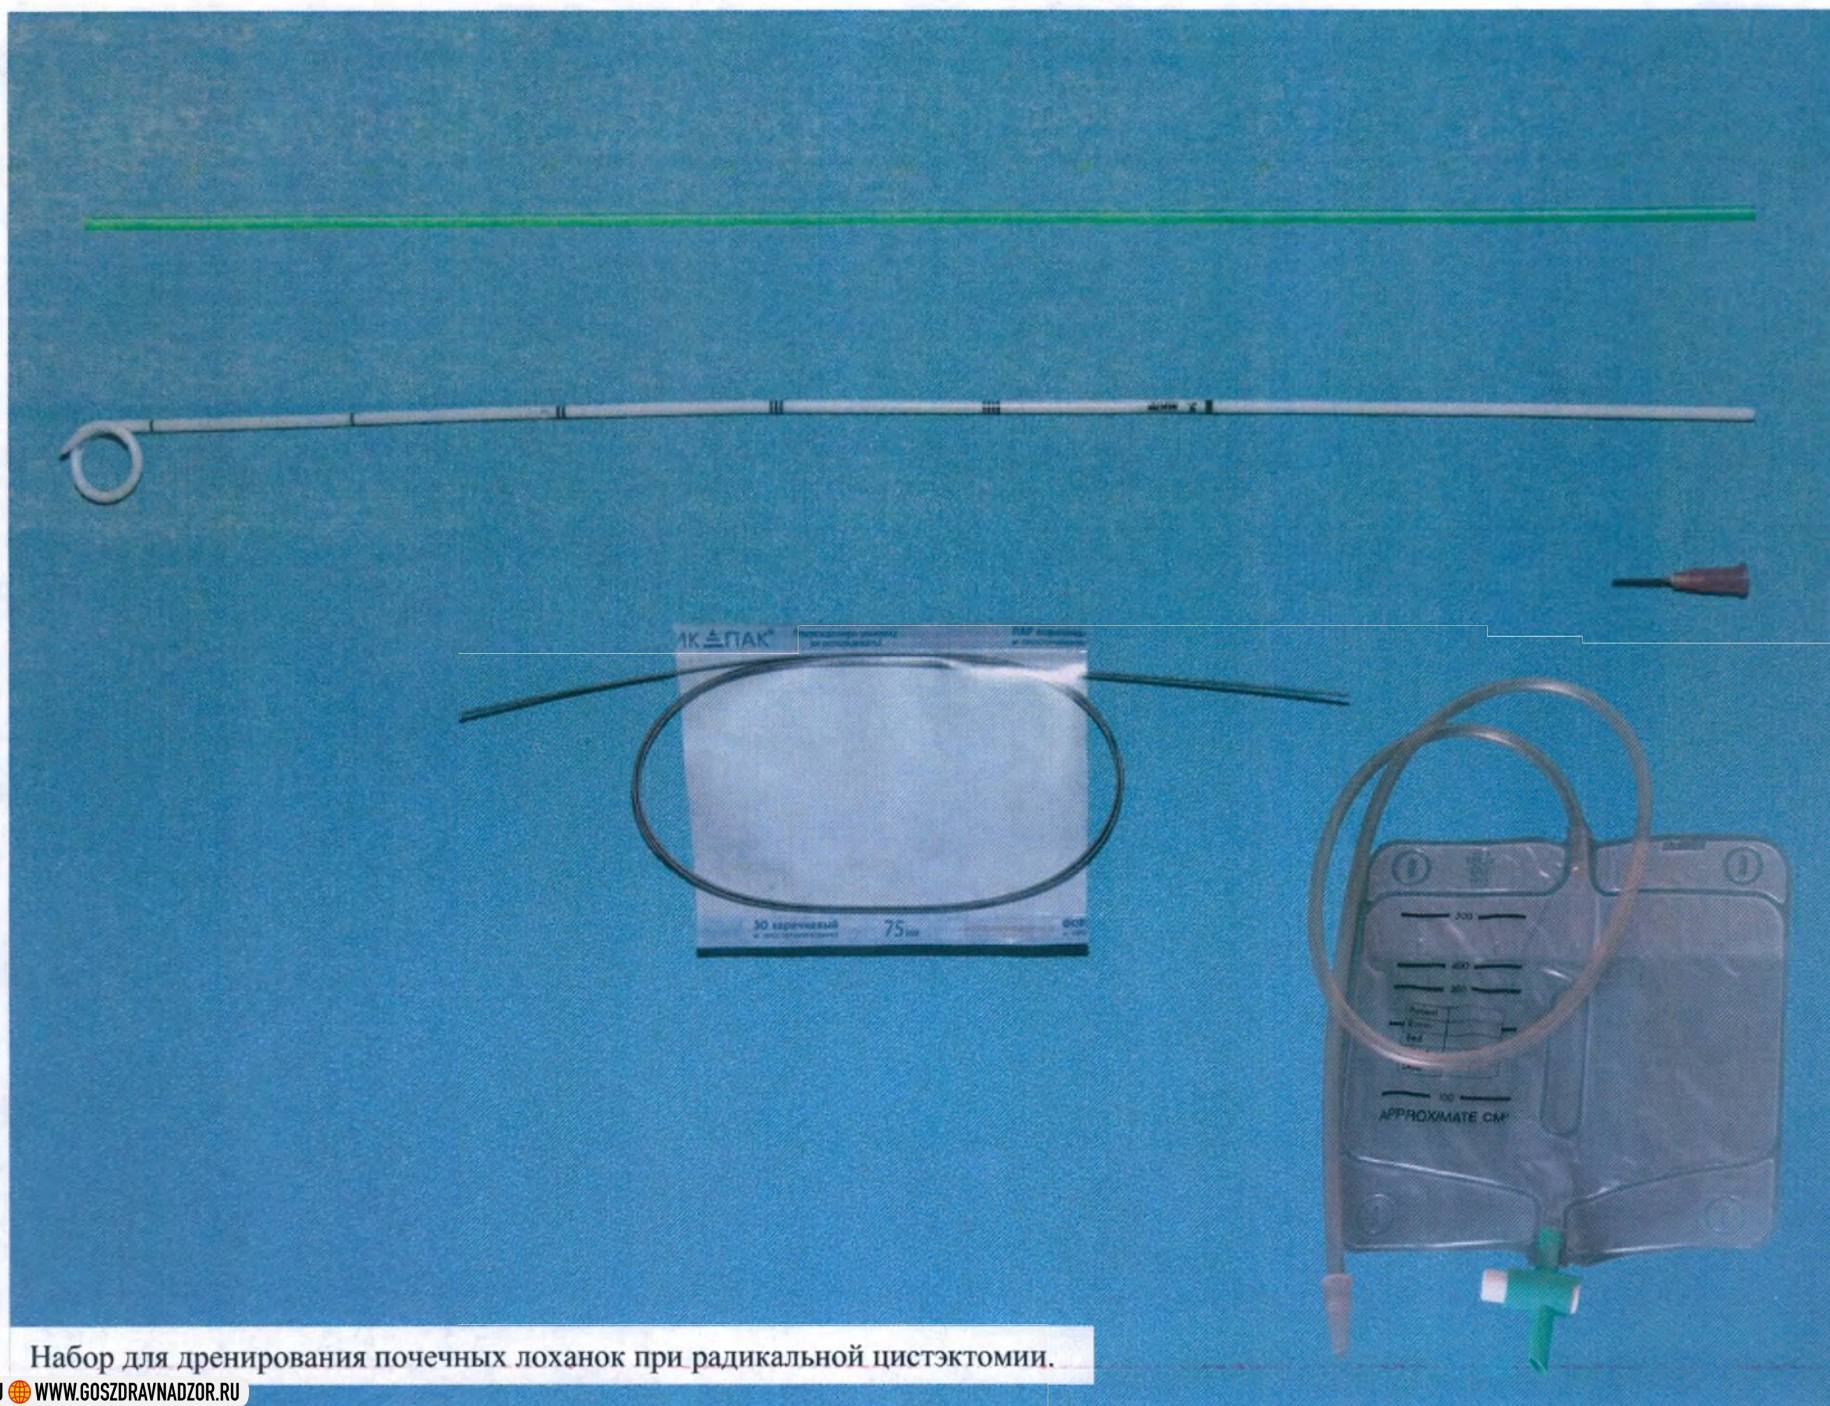

Набор для дренирования почечных лоханок при радикальной цистэктомии.

Набор инструментов для минимально инвазивных вмешательств
в лечении доброкачественных заболеваний «Здра-МНТ 3М»

НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНЫХ ЛОХАНОК ПРИ
РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ

REF 140107П

Дренаж диаметр РСН – 2 шт.
Проводник – 1 шт.
Удлинитель – 2 шт.
Мат-привинки – 2 шт.

Стерильно, одноразово, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-001-4237874-2011
РЧ № Р216 2013/1206 от 28.03.2018

STERILE R



ООО «БЕЛНАЗДНО МЕДИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

142967, Россия, Моск. обл., г. Балашиха пер. Машиностроительный, д. 3, Строитель,
кв. 61, стр. 5. Тел. 8(495)525-1625, 525-7074, email: info_bel@med.ru, www.bel-med.ru

Набор для дренирования почечных лоханок при радикальной цистэктомии, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

**НАБОР ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНЫХ ЛОХАНОК ПРИ
РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ**

REF

140107П

Дренаж диаметр 7СН – 2 шт.

Проводник – 1 шт.

Удлинитель – 2 шт.

Мочеприемник – 2 шт.


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для дренирования почечных лоханок при радикальной цистэктомии. Маркировка потребительской упаковки.

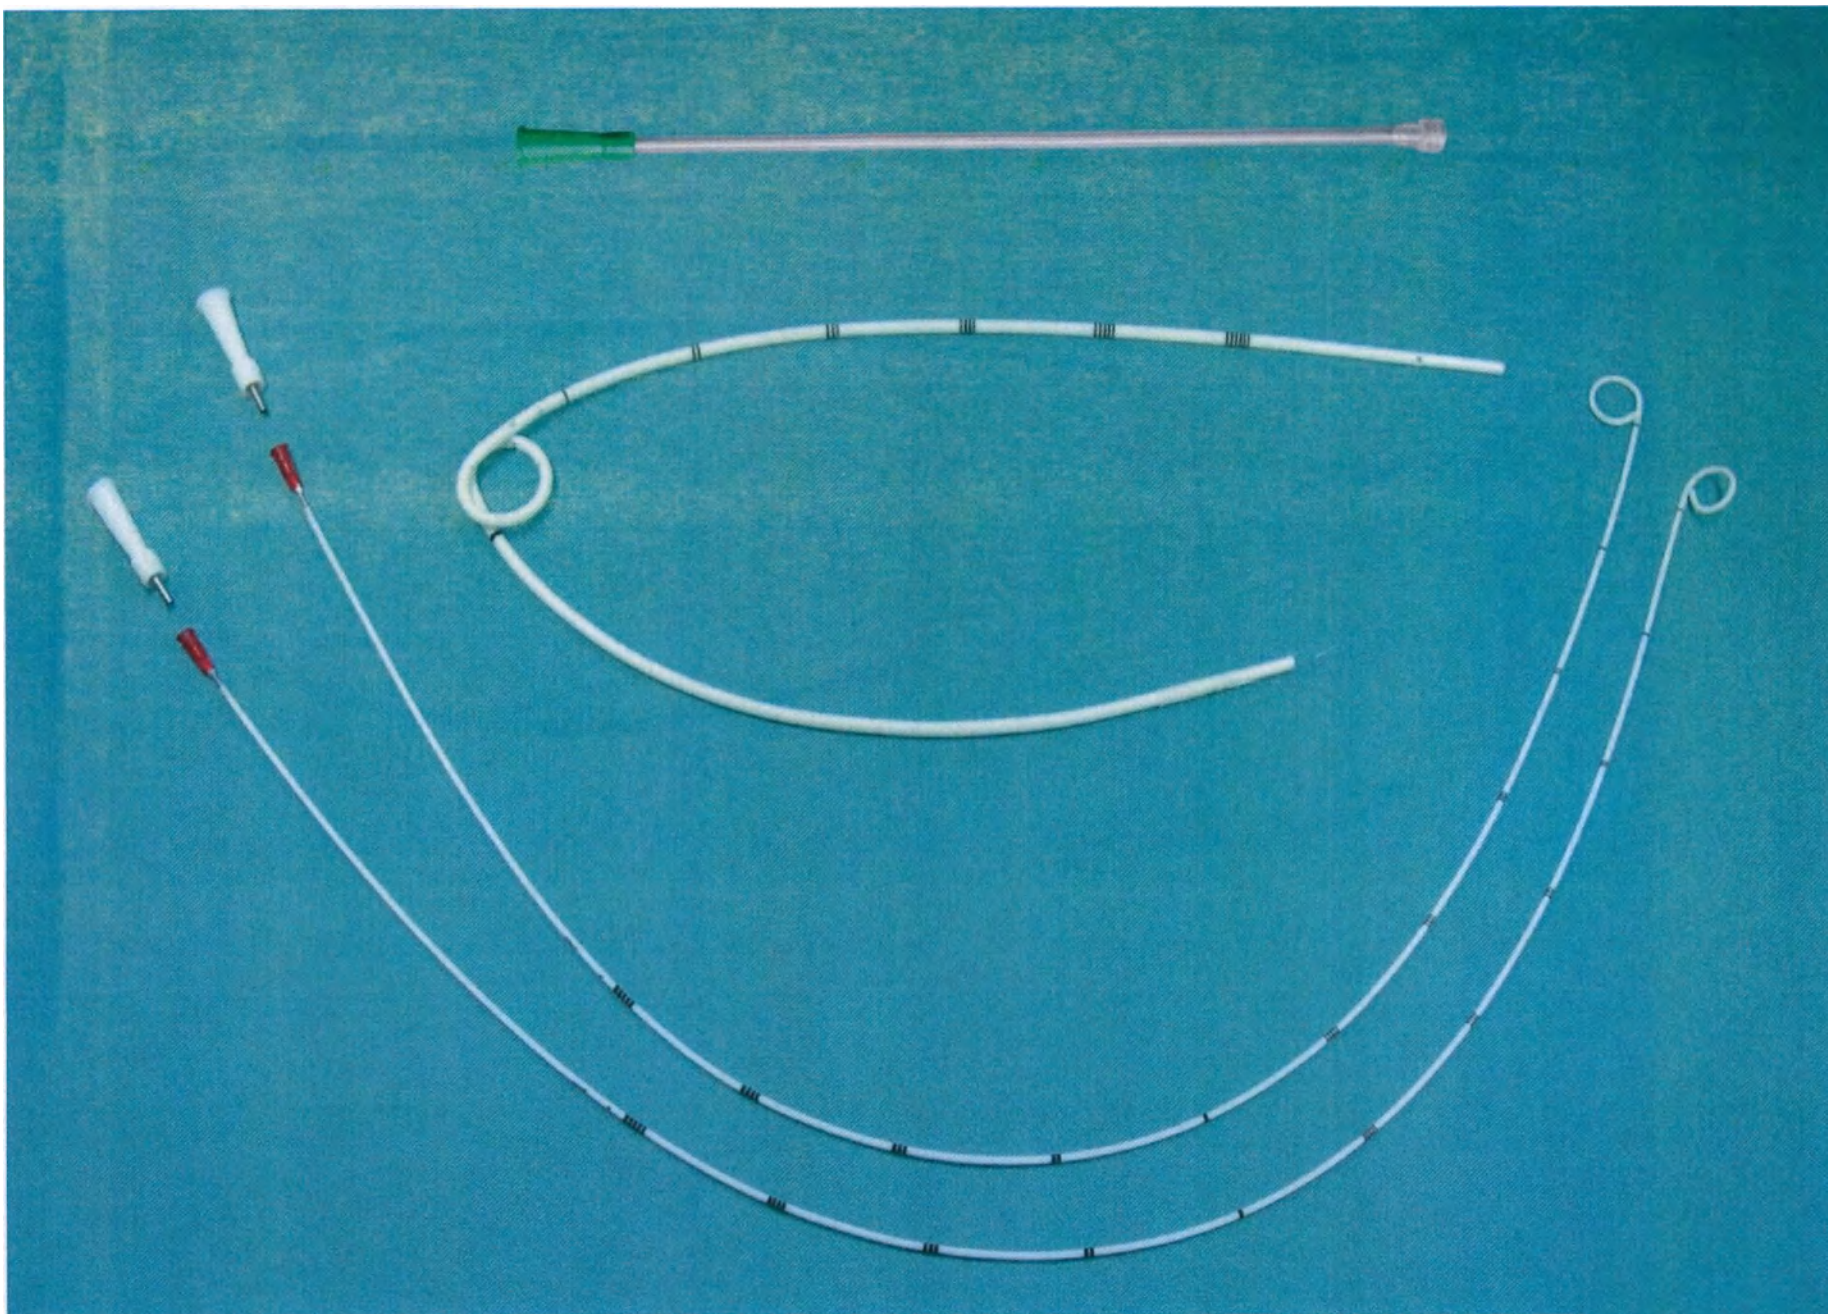

Набор цистостомического универсального катетера для дренирования при кишечной пластике мочевого пузыря.



Набор цистостомического универсального катетера для дренирования при кишечной пластике мочевого пузыря, в потребительской упаковке.


Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»
**НАБОР ЦИСТОСТОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО КАТЕТЕРА
ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПРИ КИШЕЧНОЙ ПЛАСТИКЕ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ**

REF 150001

Катетер диаметр 14СН
Стент мочеточниковый диаметр 7СН – 2шт
Адаптер (малый)
Адаптер
Удлинитель

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_1td@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор цистостомического универсального катетера для дренирования при кишечной пластике мочевого пузыря.
Маркировка потребительской упаковки.

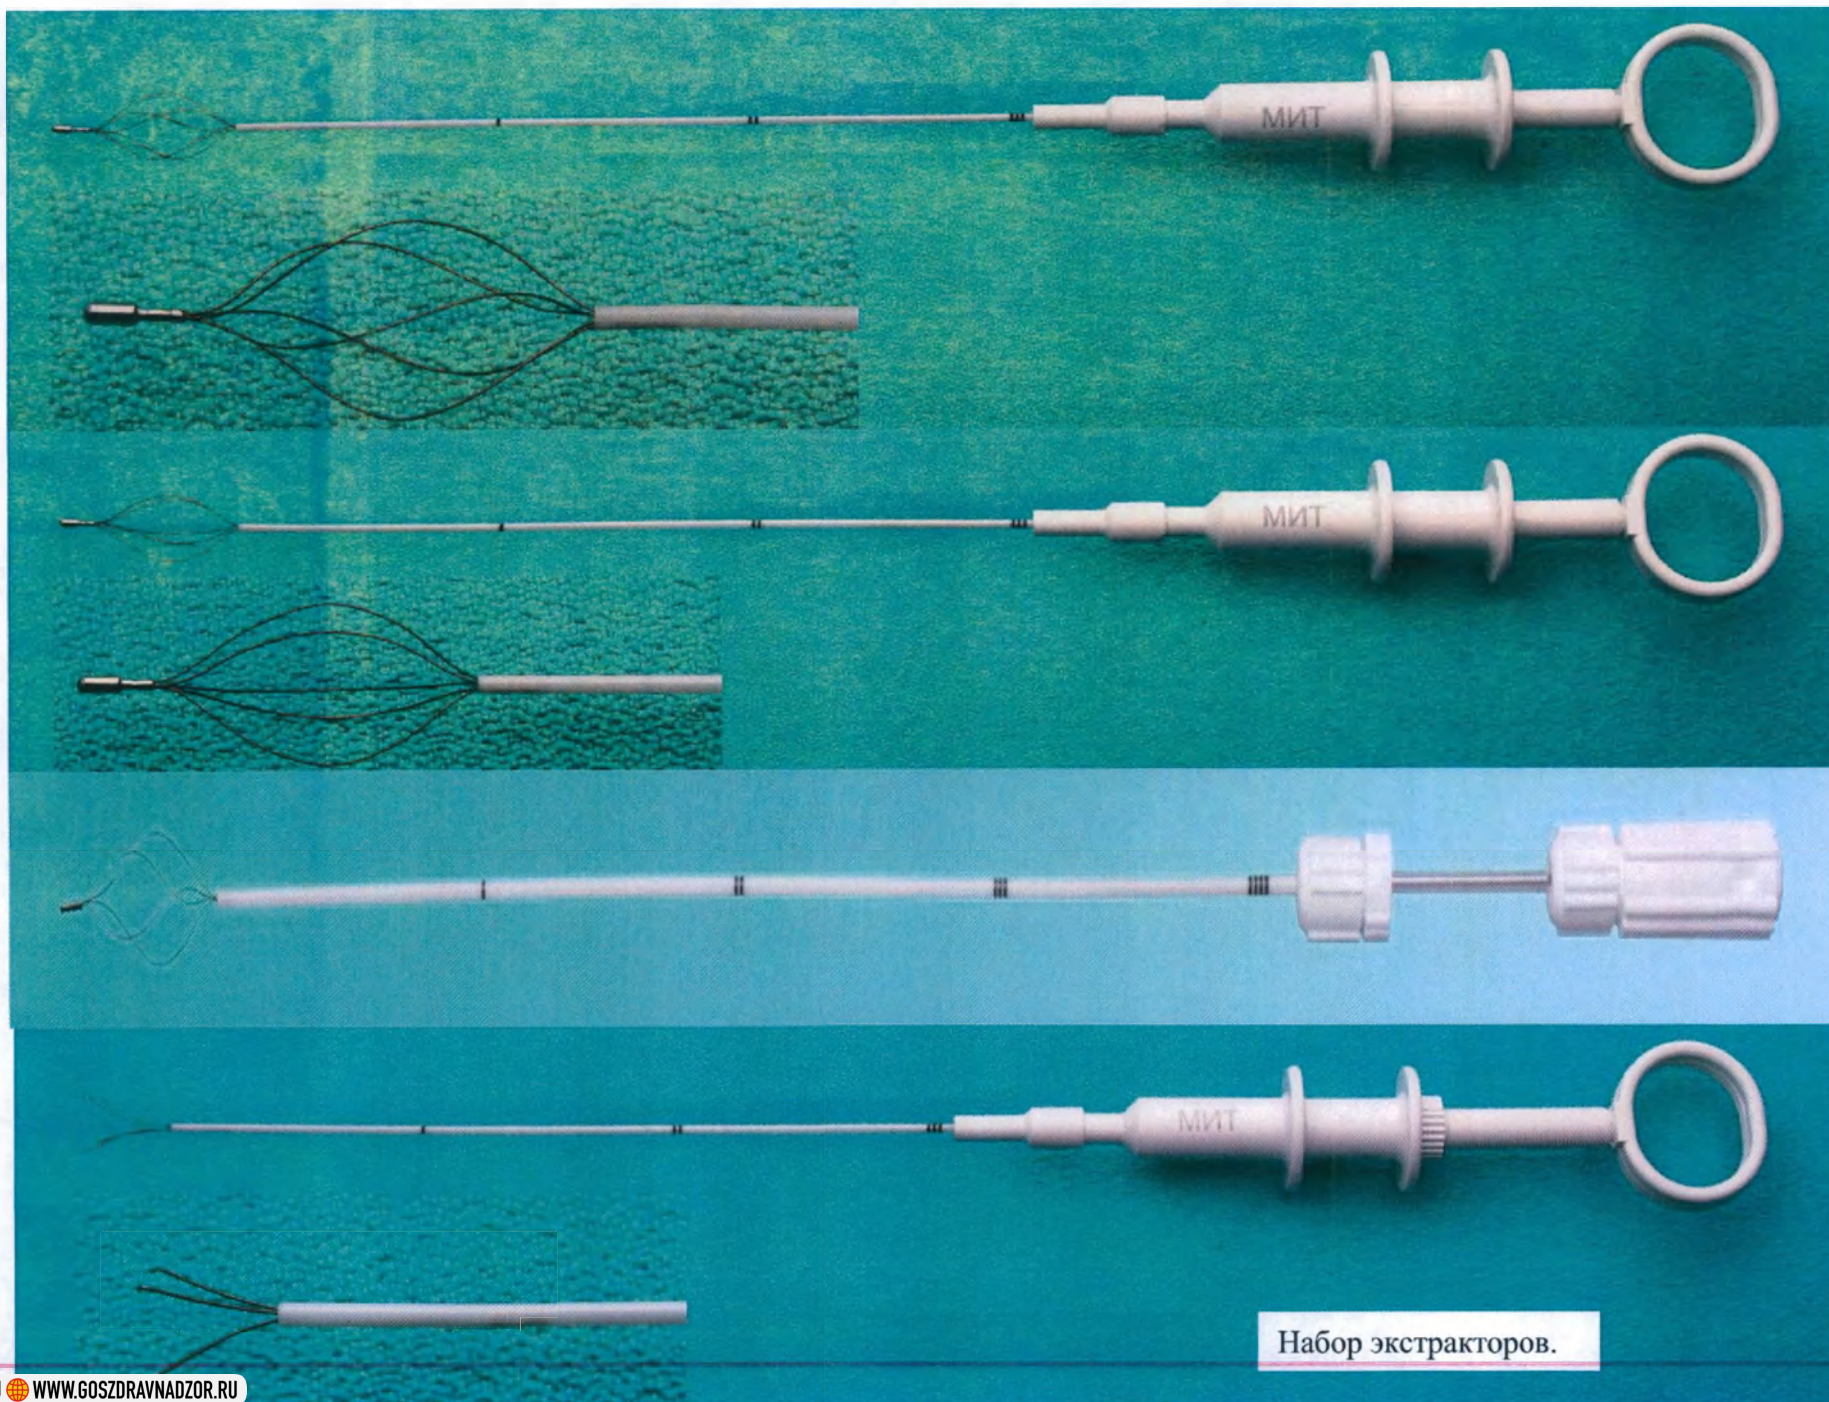

Набор экстракторов.



Набор экстракторов, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ

REF 011521

Экстрактор спиральный с катетером 5CH, 65см

Экстрактор плоский с катетером 5CH, 65см

Экстрактор торцевой с катетером 5CH, 65см

Экстрактор с извлекаемой корзинкой спиральный с катетером 5CH, 65см

Экстрактор с извлекаемой корзинкой плоский с катетером 5CH, 65см

материал корзинки – сталь нержавеющей


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R




ООО «Минимально инвазивные технологии»

143967, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор экстракторов. Маркировка потребительской упаковки.

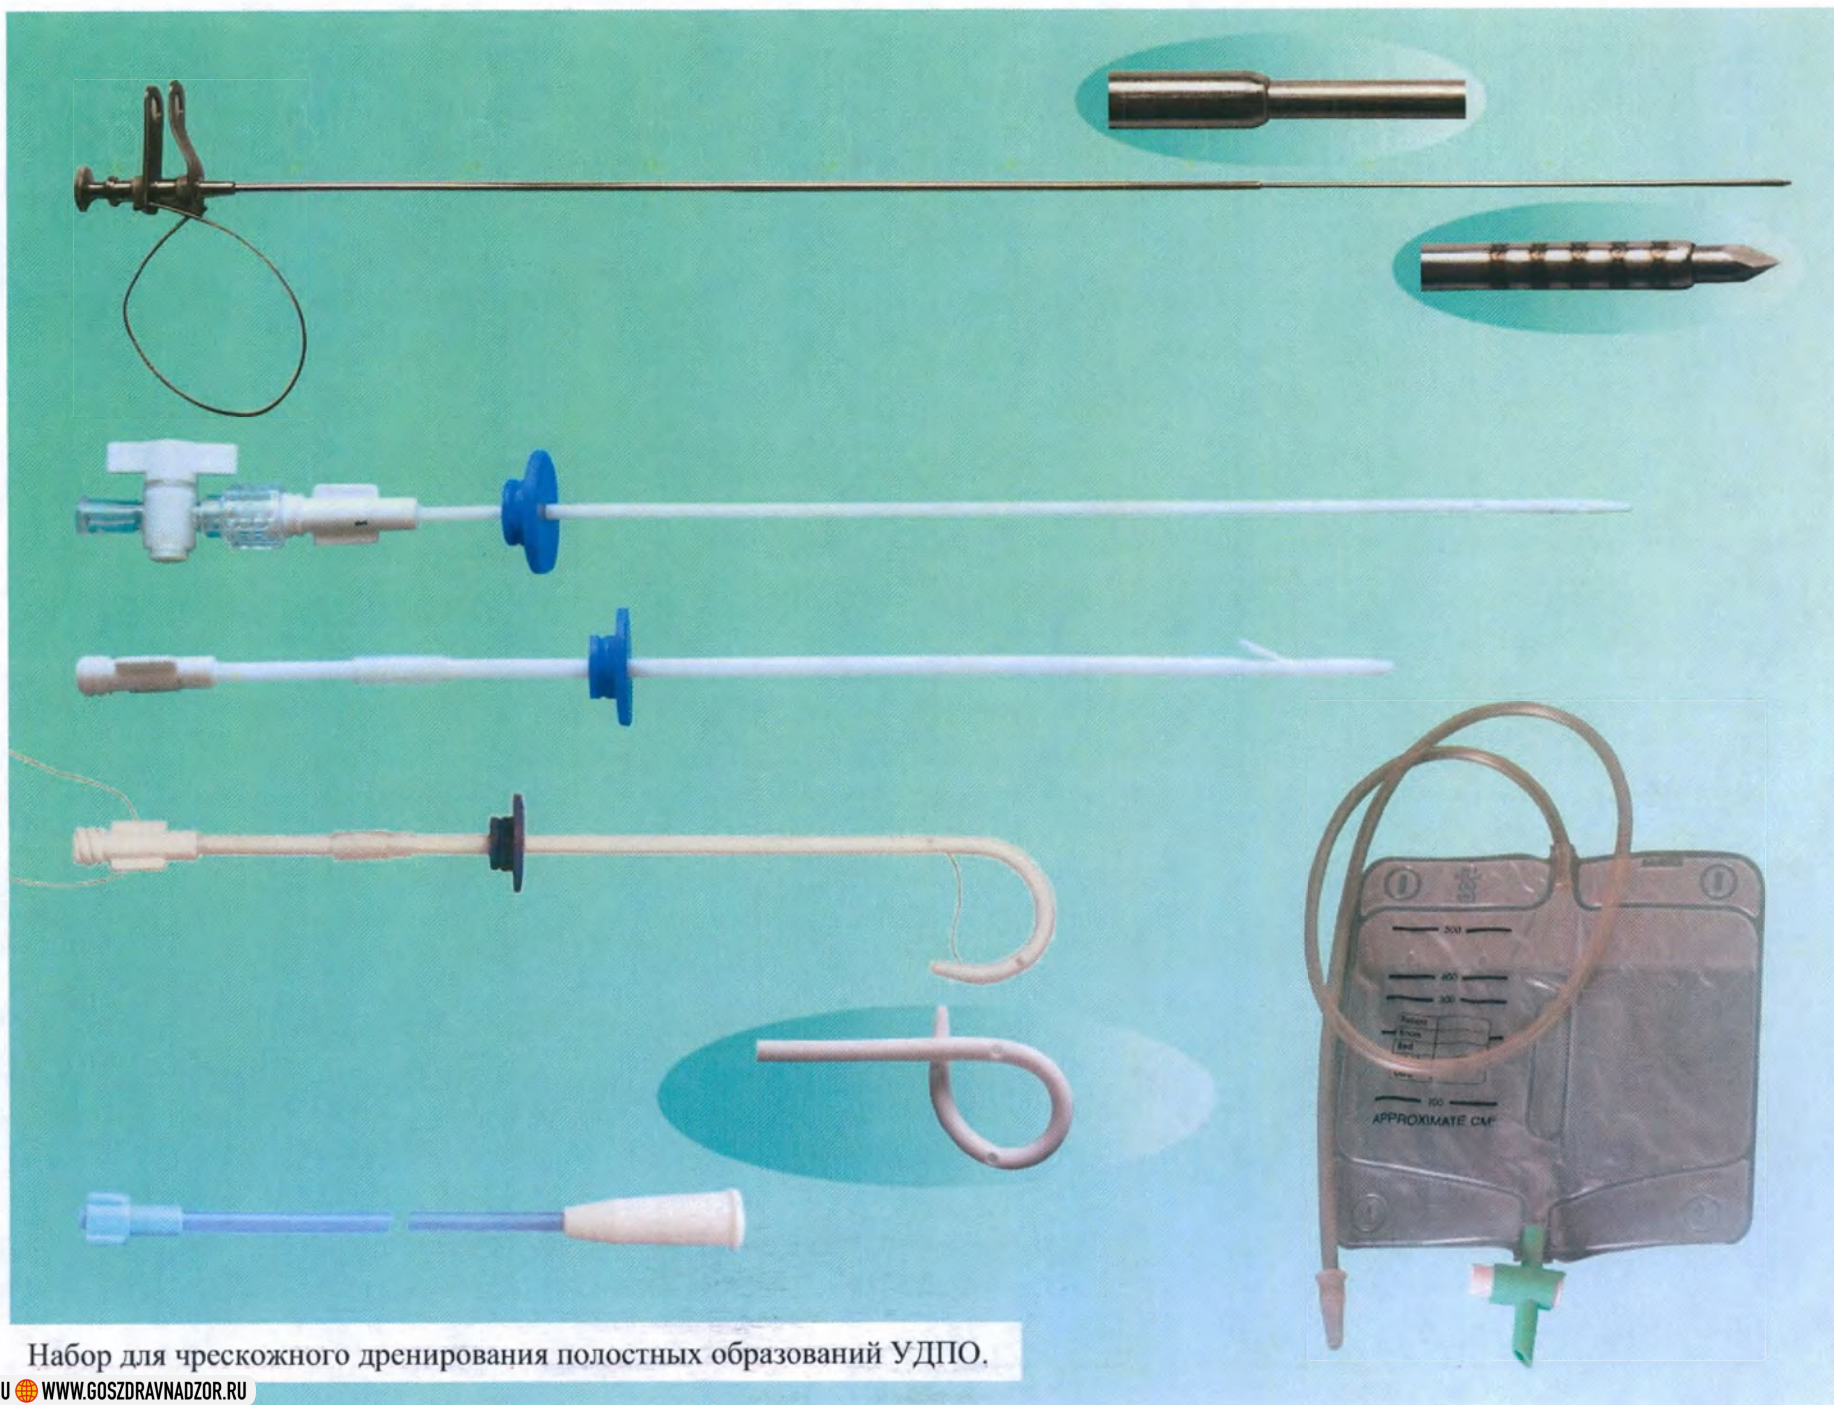


Набор для чрескожного дренирования полостных образований УДПО.

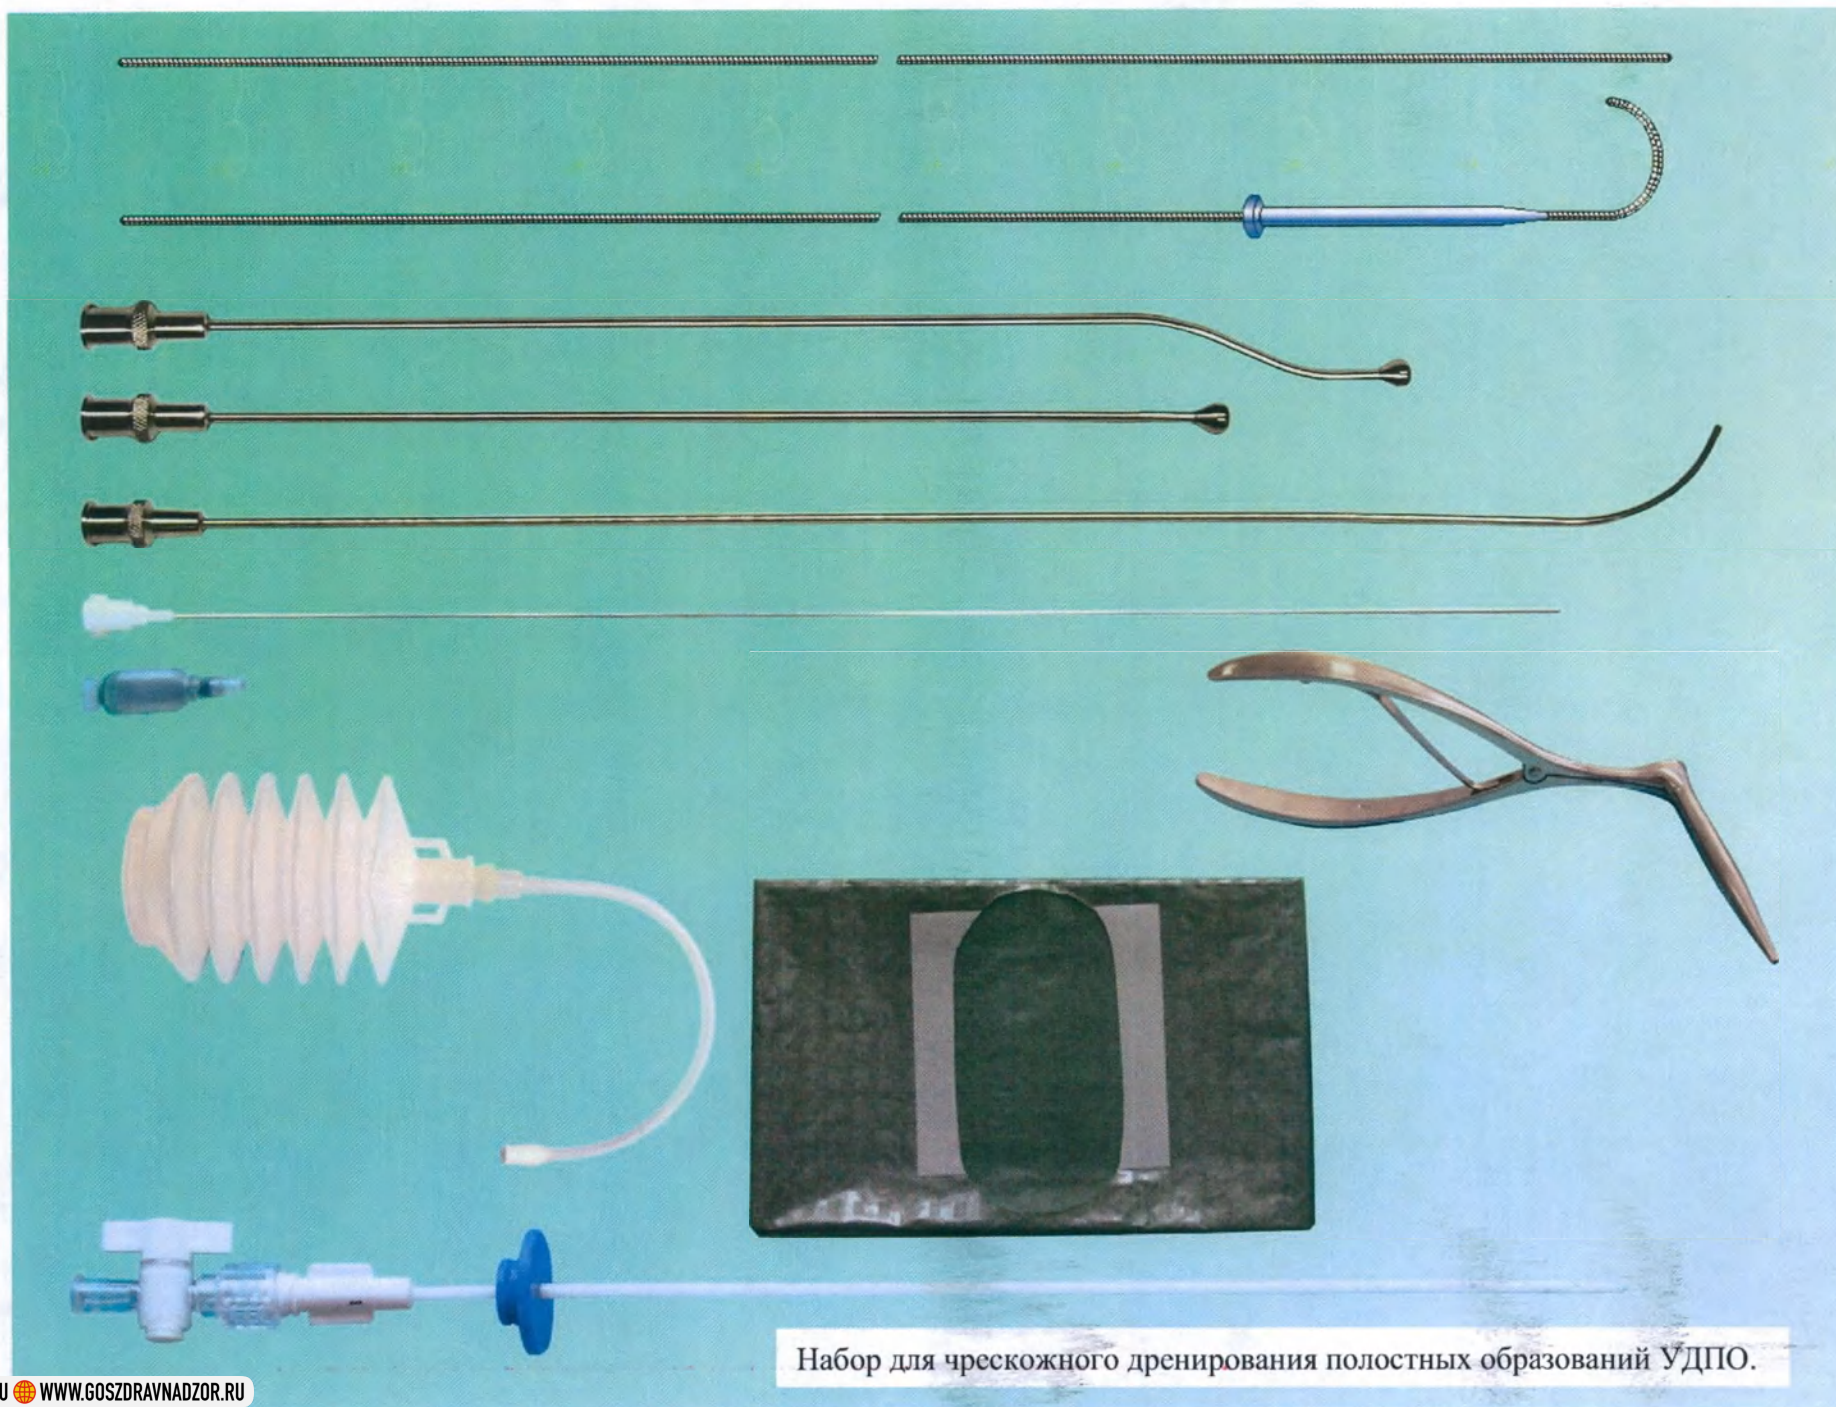

Набор для чрескожного дренирования полостных образований УДПО.

Набор для чрескожного дренирования полостных образований УДПО.

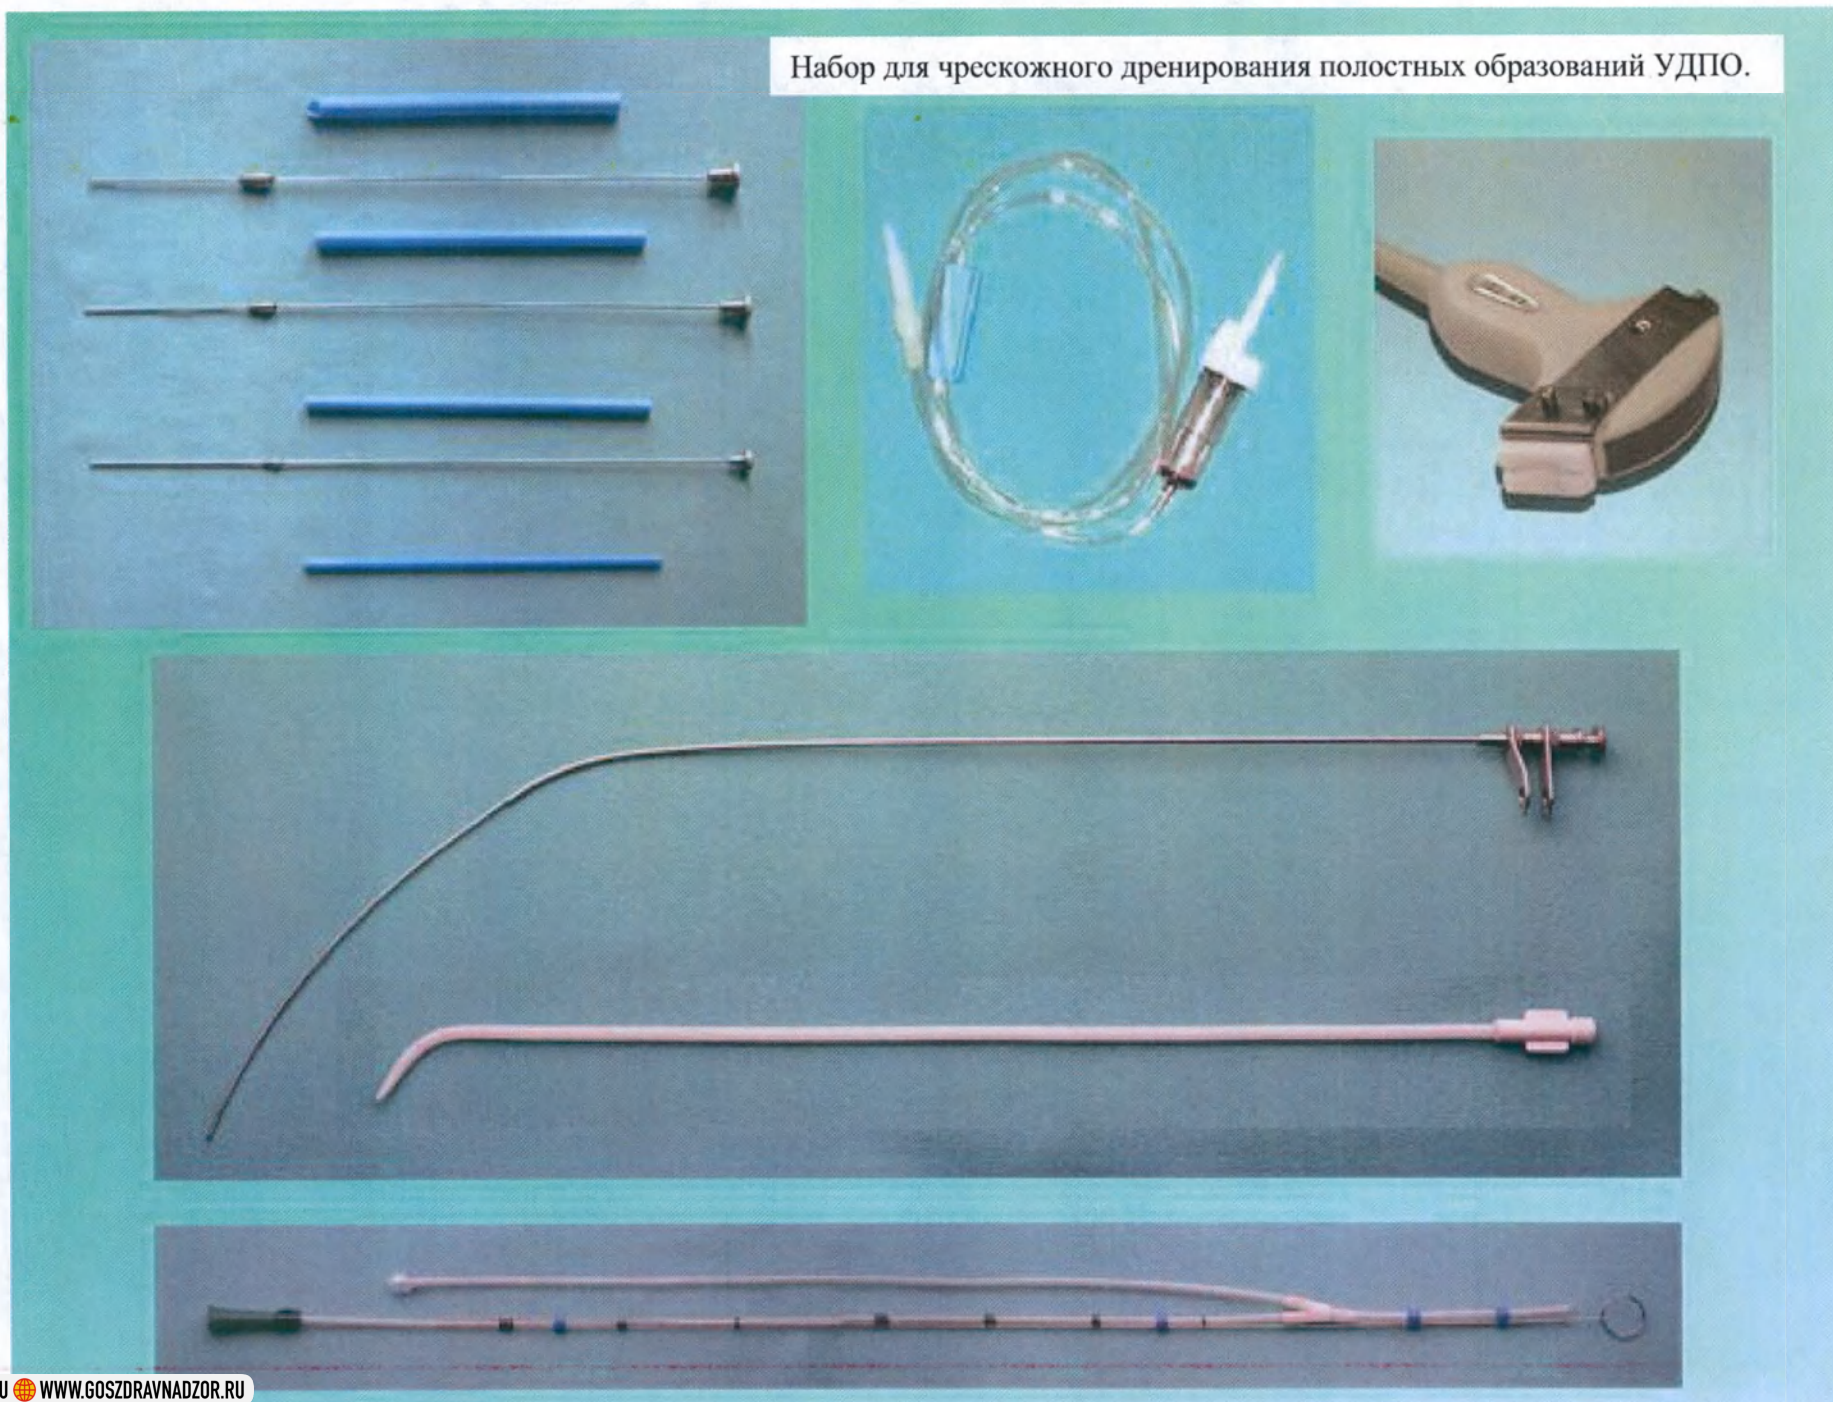

CE LOTC2073 300x200m

CE LOTC2073 300x200m

CE LOTC2073 300x200m

Набор для чрескожного дренирования
полостных образований УДПО

REF 122010

- Устройство для дренирования полостных образований УДПО диаметром 1,0мм
- Устройство для дренирования полостных образований ригидное
- Катетер изогнутый диаметром 9 CH
- Катетер прямой диаметром 9 CH
- Проводник прямой диаметром 0,835"
- Проводник изогнутый диаметром 0,985"
- Отсасывающая трубка
- Катетер прямой с регулирующим просветом диаметром 9 CH
- Катетер прямой с регулирующим фланцем
- Устройство расширения катетера (жесткий конец 100")
- Устройство расширения катетера по диаметру изгибу (прямой и изогнутый)
- Устройство компрессии пневмического катетера
- Набор устройств замены катетера со сменными катетерами
- Воздушный аспиратор
- Рассекатель пневмического катетера
- Пневмическая насадка для ультразвукового датчика
- Устройство для маркировки маркуемых растворов
- Дренаж для резекции кистозных протоков (жесткий конец 110")
- Полостная игла операционная с литым слесем
- Микроинъекция
- Удлинитель

Стерильно, в вакуумной упаковке
Не применять при нарушении целостности упаковки

TU 9437-007-42331874-2015
RU 16 PCH 20131308 от 26.03.2018



ООО «Медицинские Инновационные Технологии»
143007, Россия, Москва, обл., г. Балашиха, мкр. Жилищно-строительный, ул. Советская,
кв. 107, стр. 5. Тел.: 8(495)533-9026, 8(495)533-9027, email: info@mit.ru, www.mit-ru.ru

STERILE



Набор для чрескожного дренирования полостных образований УДПО, в потребительской упаковке.


Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

**НАБОР ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ
ПОЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УДПО**

REF 122010

Устройство для дренирования полостных образований УДПО диаметром 1,6мм
Устройство для дренирования полостных образований изогнутое
Катетер изогнутый диаметром 9 СН
Катетер прямой диаметром 9 СН
Проводник прямой диаметром 0,035"
Проводник изогнутый диаметром 0,035"
Отводящая трубка
Катетер прямой с регулируемым просветом диаметром 9 СН
Катетер прямой с регулируемым фиксатором
Устройство разворота катетера (изгиб конца 100°)
Устройство восстановления катетера по свищевому ходу (прямое и изогнутое)
Устройство пломбирования пункционного канала
Набор устройств замены катетеров со сменными катетерами
Вакуумный аспиратор
Расширитель пункционного канала
Пункционная насадка для ультразвукового датчика
Устройство для переливания инфузионных растворов
Дренаж для реканализации желчных протоков (изгиб конца 110°)
Простыня малая операционная с липким слоем
Мочеприемник
Удлинитель

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018




STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для чрескожного дренирования полостных образований УДПО. Маркировка потребительской упаковки.

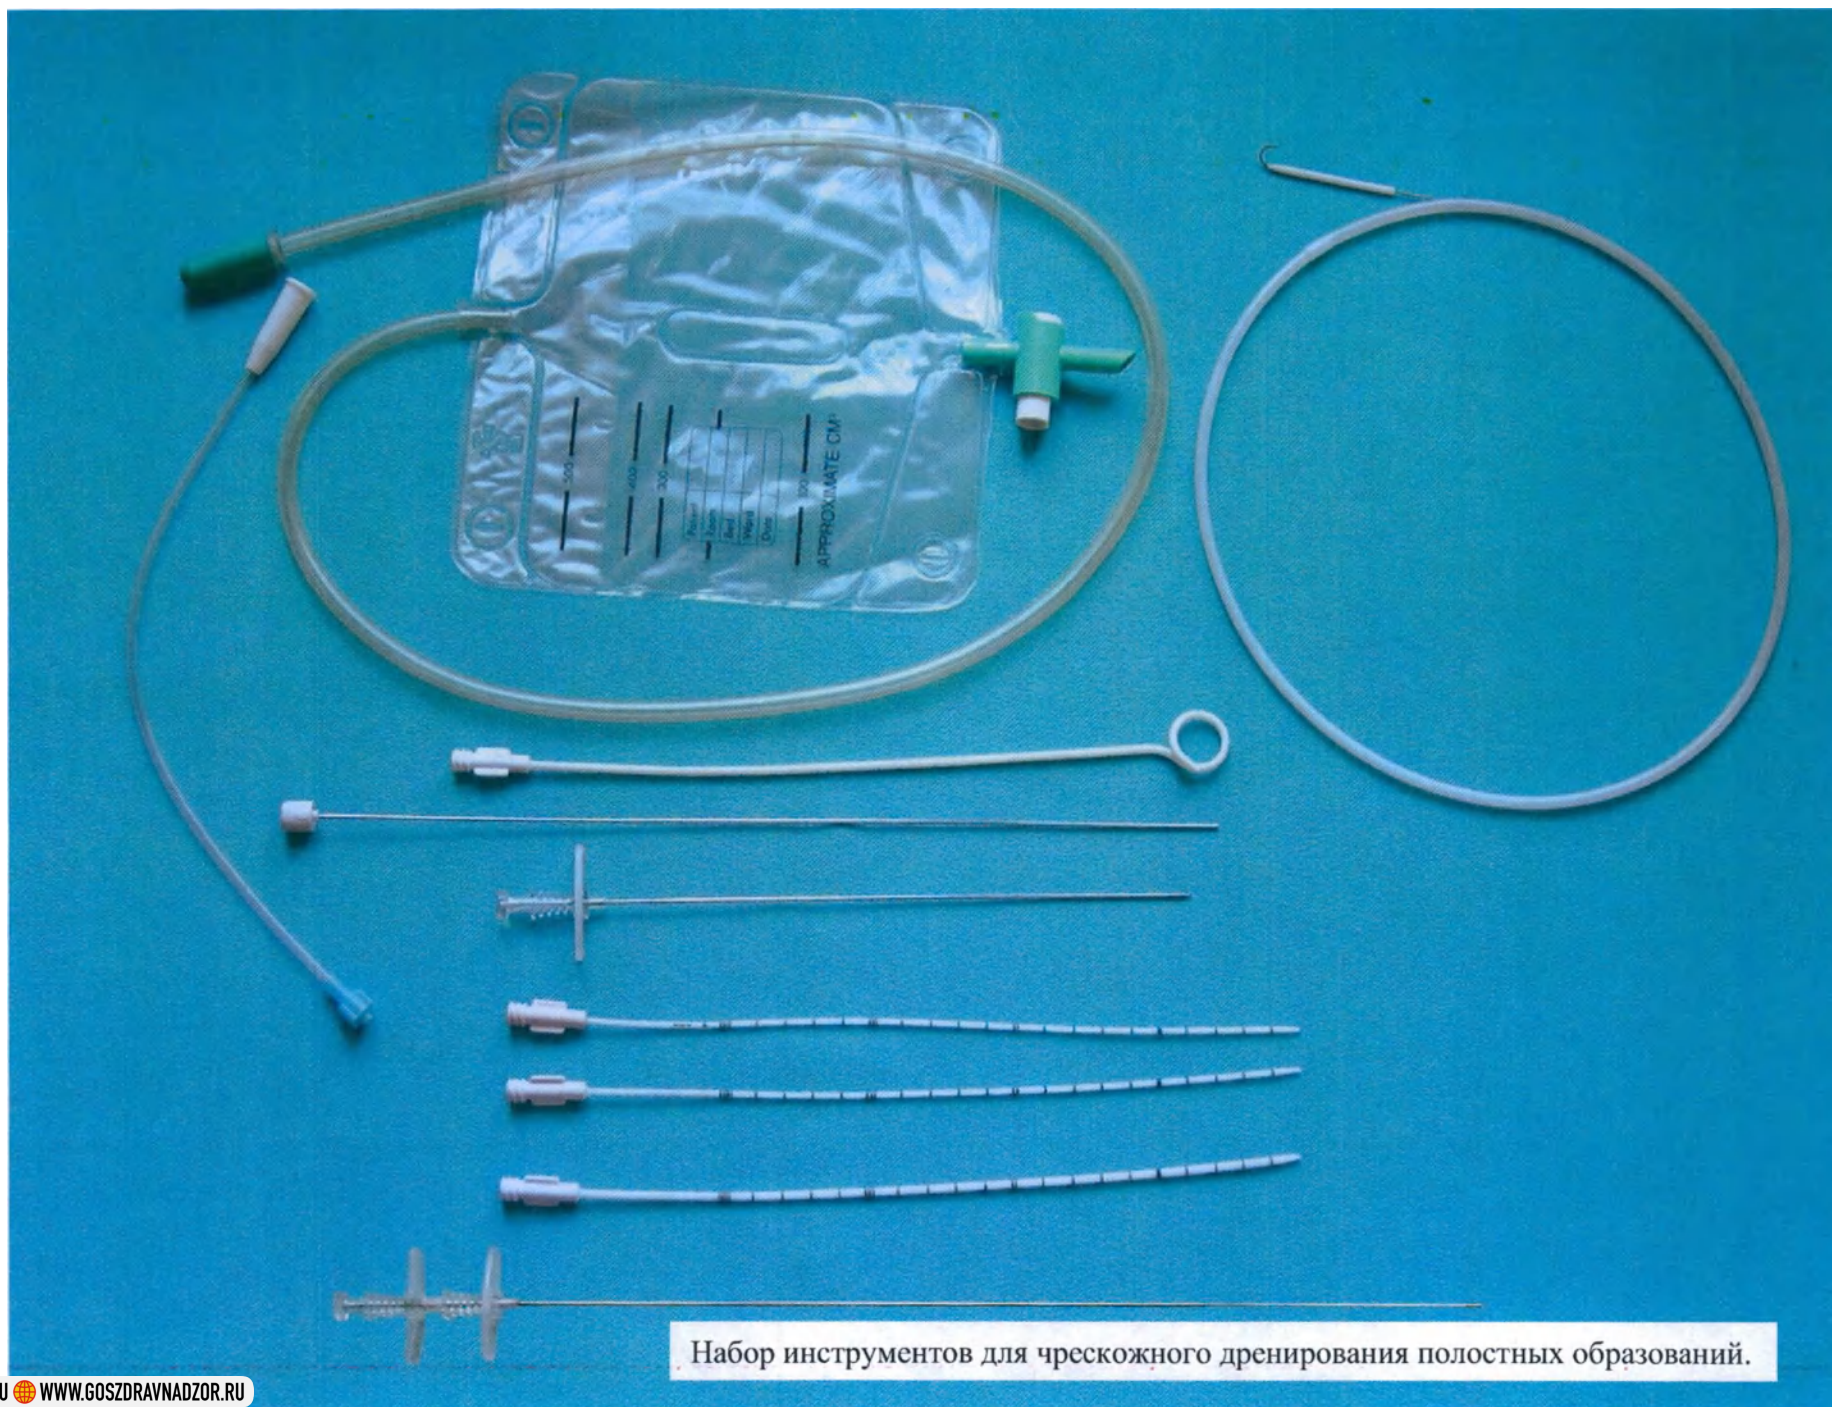

Набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований.



Набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований, в потребительской упаковке.

наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ
ПОЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ**

REF 10807П

Дренаж типа «Свиной хвост» диаметр 7СН, длина 30см, с фиксатором
материал - полиэтилен рентгеноконтрастный

Буж 7СН

Игла: диаметр 1,35 мм длиной 120 мм

Проводник изогнутый сверхжесткий диаметр 0,032", длина 100см

Канюля установочная, мочеприемник (желчеприемник), удлинитель


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований. Маркировка потребительской упаковки.

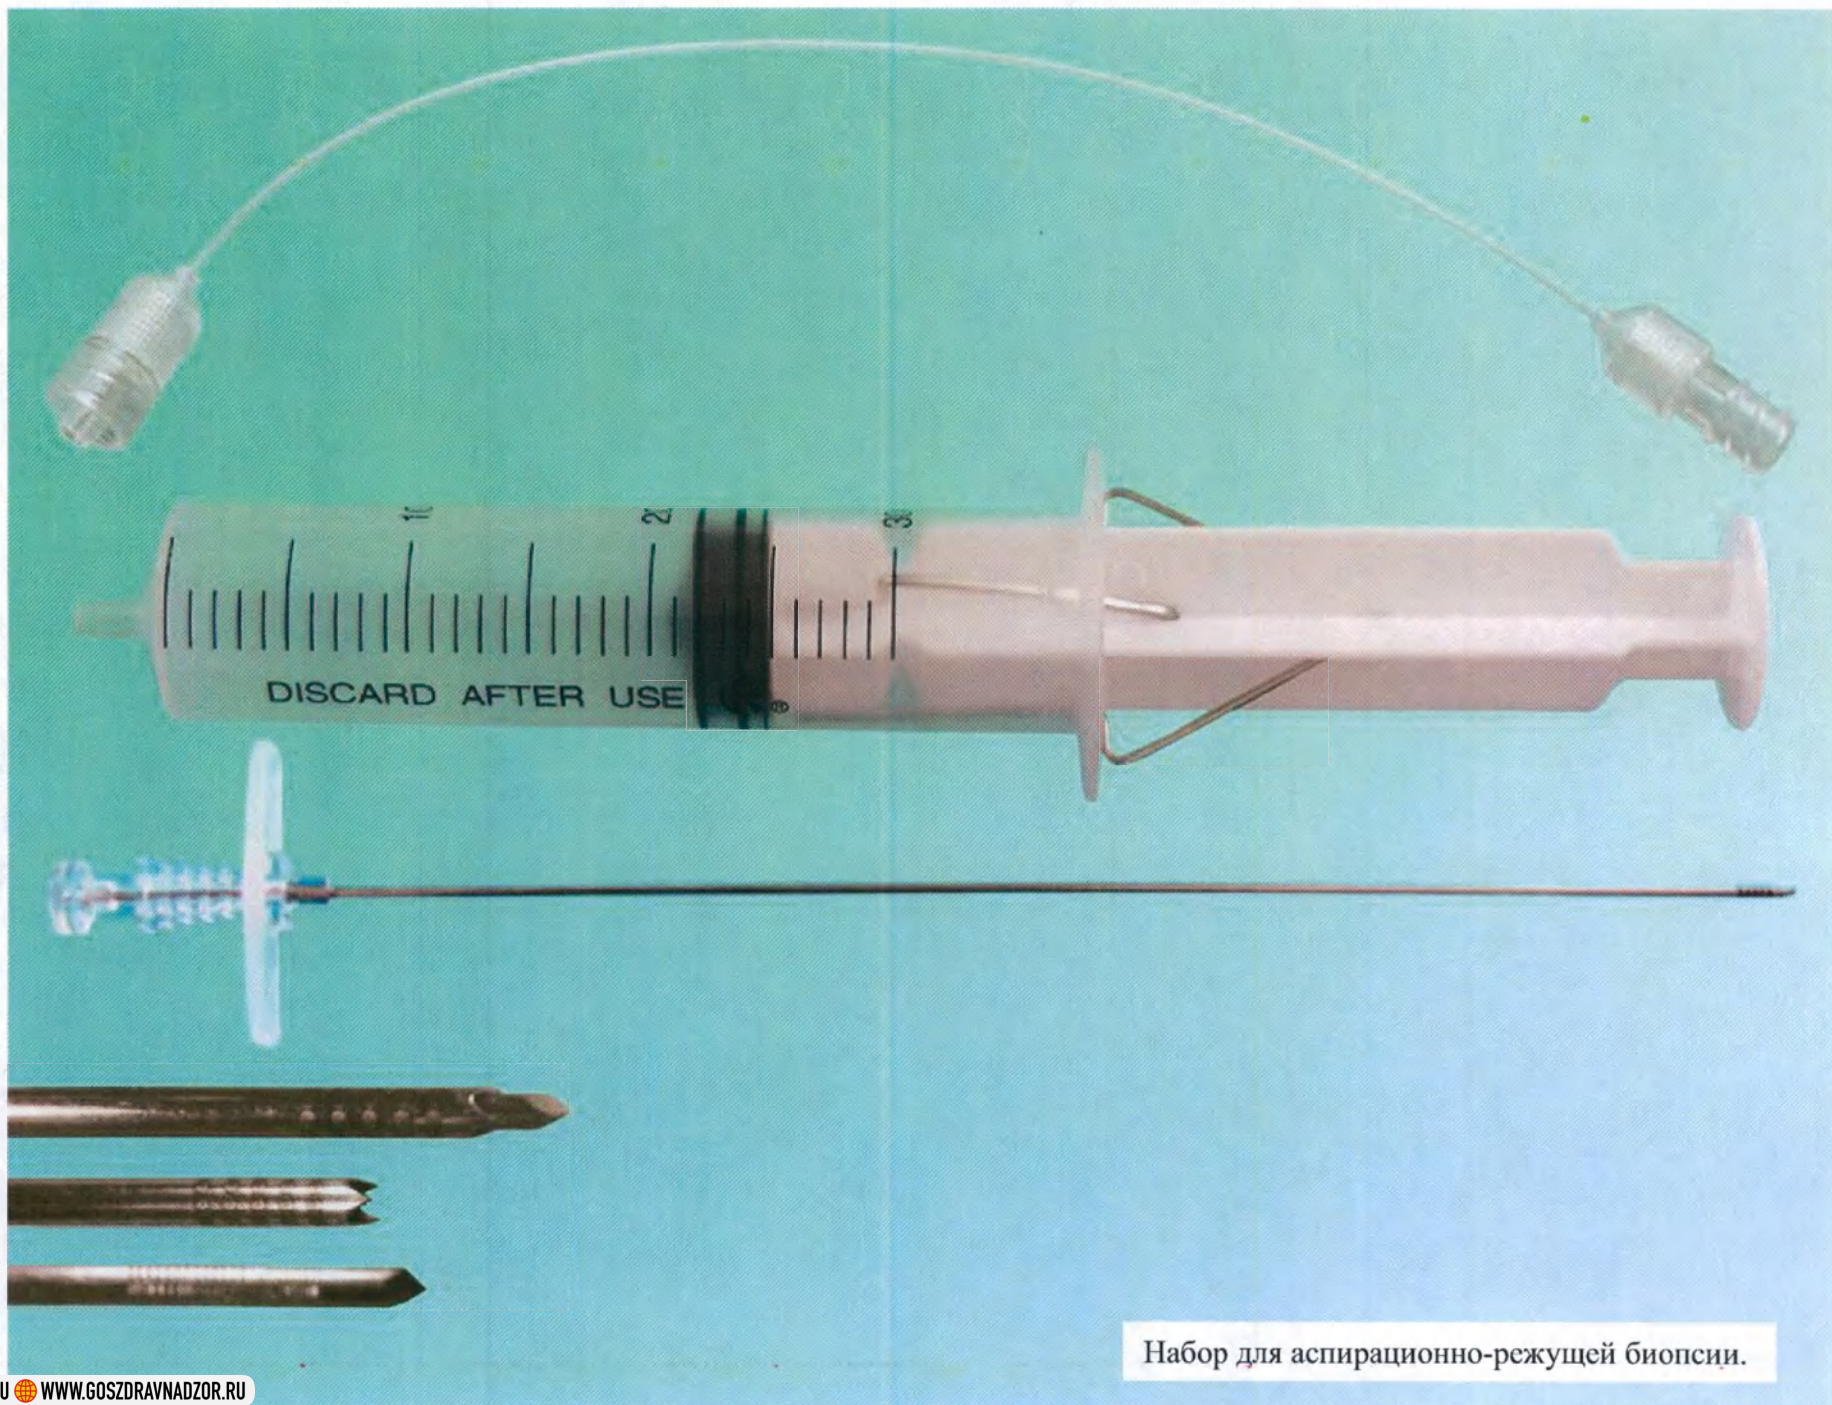

Набор для аспирационно-режущей биопсии.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
в рамках лечебно-диагностической «Эндо-ММТ-8»
НАБОР ДЛЯ АСПИРАЦИОННО-РЕЖУЩЕЙ БИОПСИИ

REF 408180-12

Аспирационно-режущая игла диаметром 1,8мм
Внутренний диаметр с держателем фиксацией
Удлинитель

Стерильно, асептично, неоскочено
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 0437-007-4237874-2011
РД № РОН 2013/1204 от 28.03.2018

STERILE



ООО «Максимально инвазивные вмешательства»

151087, Россия, Москва, г. Балашиха, мкр. Инженерный, д. 1, Строитель,
4181, этаж 3. Тел. 8(495)342-9425, 522-7344, e-mail: info_max@max-iv.ru, max-iv@max-iv.ru

Набор для аспирационно-режущей биопсии, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


НАБОР ДЛЯ АСПИРАЦИОННО-РЕЖУЩЕЙ БИОПСИИ

REF 408180-12

Аспирационно-режущая игла диаметр 1,6мм
Вакуумный шприц с двойной фиксацией
Удлинитель

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для аспирационно-режущей биопсии. Маркировка потребительской упаковки.

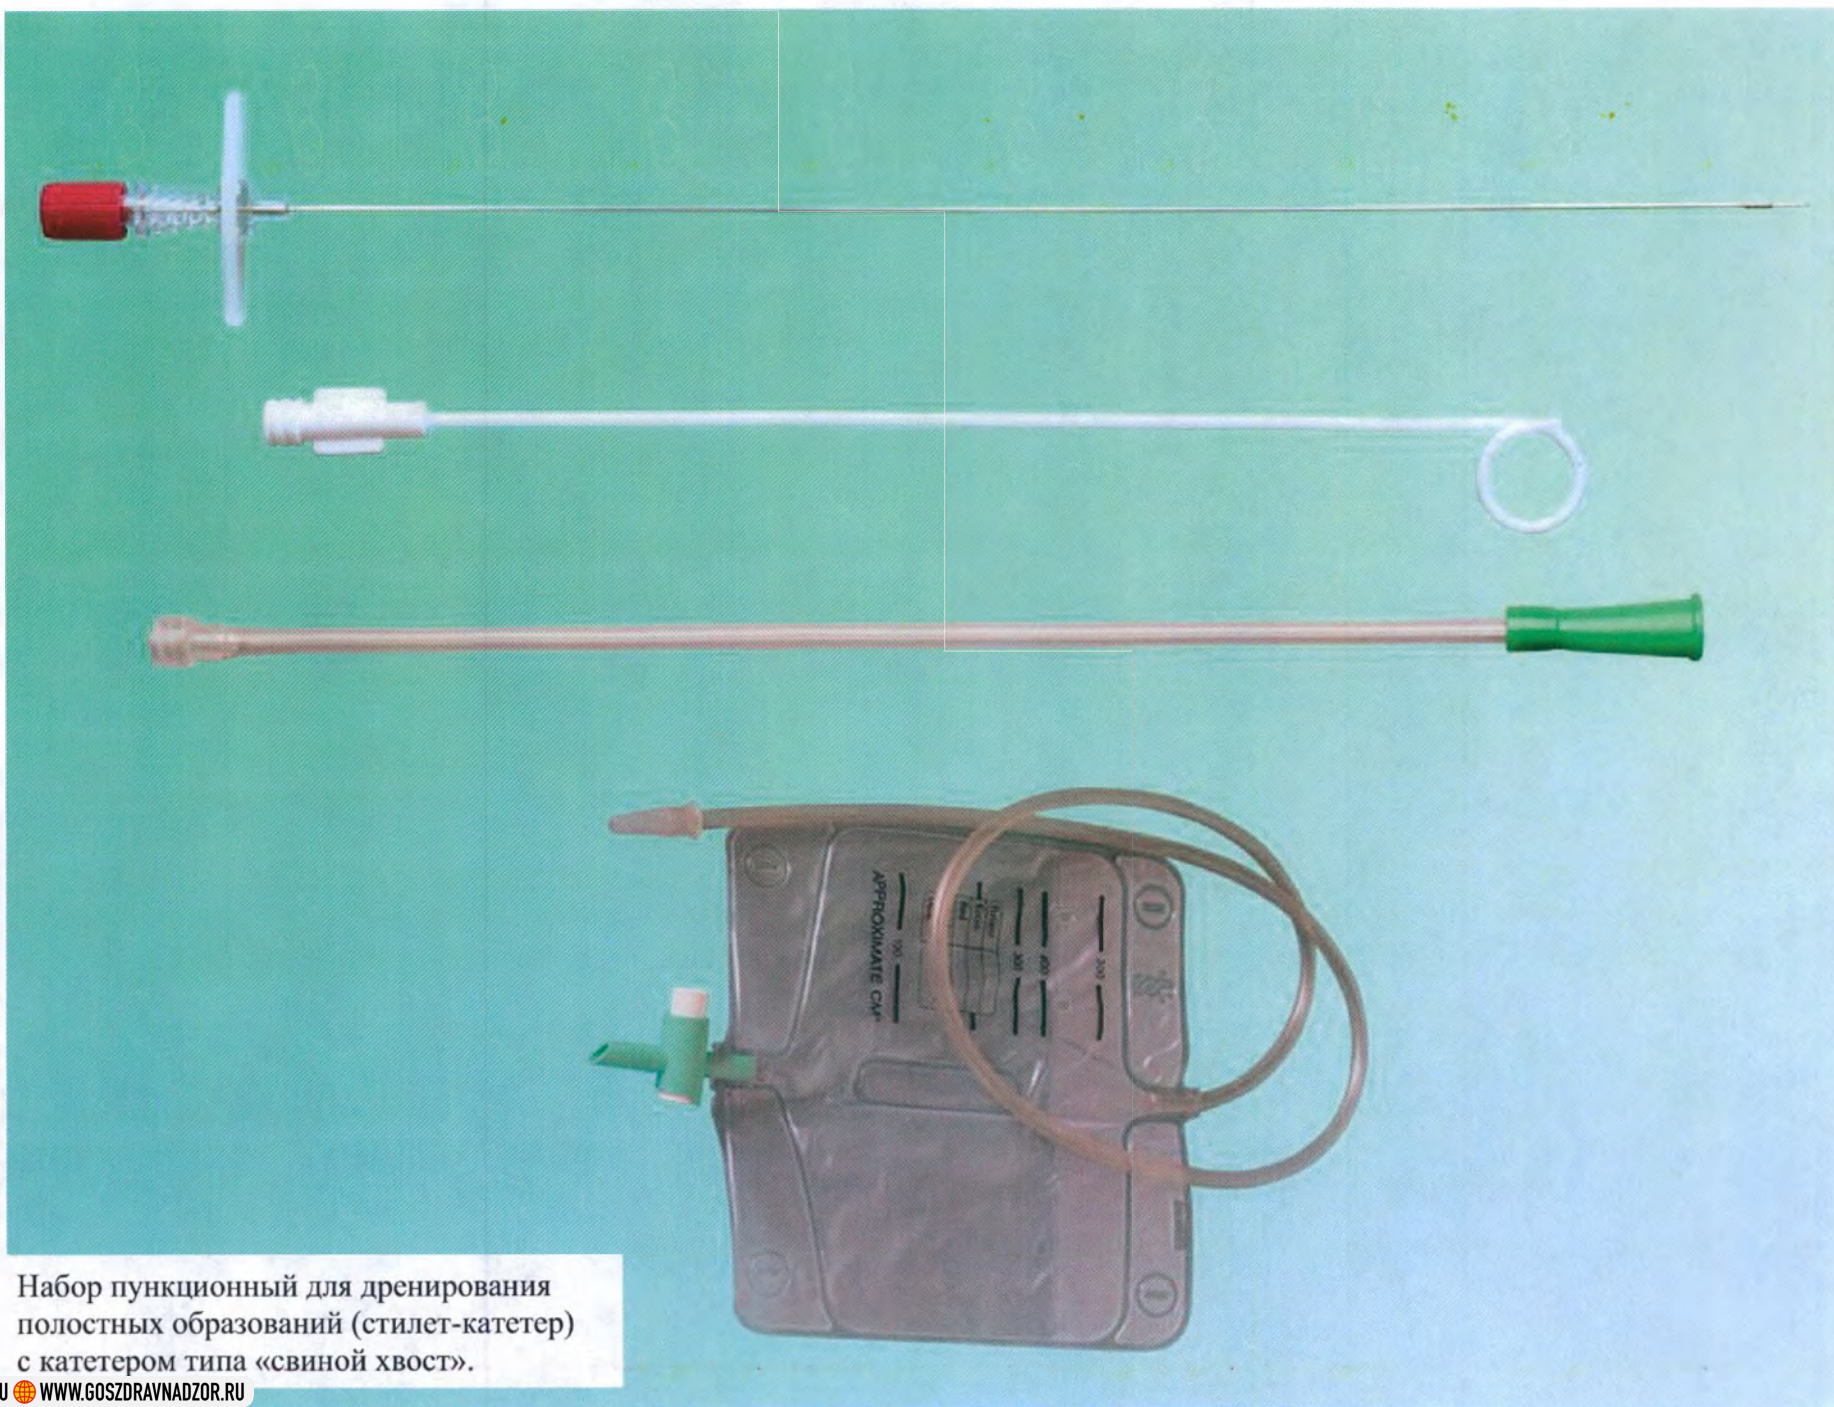

Набор пункционный для дренирования
полостных образований (стиллет-катетер)
с катетером типа «свиной хвост».


Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
в комплексе лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»
НАБОР ПУНКЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОЛОСТНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ (СТИЛЕТ-КАТЕТЕР) С КАТЕТЕРОМ
ТИПА «СВИНОЙ ХВОСТ»

REF 107201208

Стилет с катетером (с фиксатором) диаметр ВСН, длина 28см
материал - полиуретан рентгеноконтрастным
Мочеприемник, удлинитель

Стерильно, асептично, неокислено
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9432-007-42237674-2011
РУ № РОС 2013/1303 от 25.03.2018

STERILE



ООО «Минимально инвазивные технологии»

141987, Россия, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
60/51, стр.5. Тел: 8(495)522-1625, 522-7034, email: info_mit@mit.ru, www.mit.ru

Набор пункционный для дренирования полостных образований (стилет-катетер) с катетером типа «свиной хвост»,
потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


**НАБОР ПУНКЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОЛОСТНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ (СТИЛЕТ-КАТЕТЕР) С КАТЕТЕРОМ
ТИПА «СВИНОЙ ХВОСТ»**

REF 107201208

Стилет с катетером (с фиксатором) диаметр 8СН, длина 20см
материал - полиуретан рентгеноконтрастный
Мочеприемник, удлинитель

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор пункционный для дренирования полостных образований (стилет-катетер) с катетером типа «свиной хвост».
Маркировка потребительской упаковки.

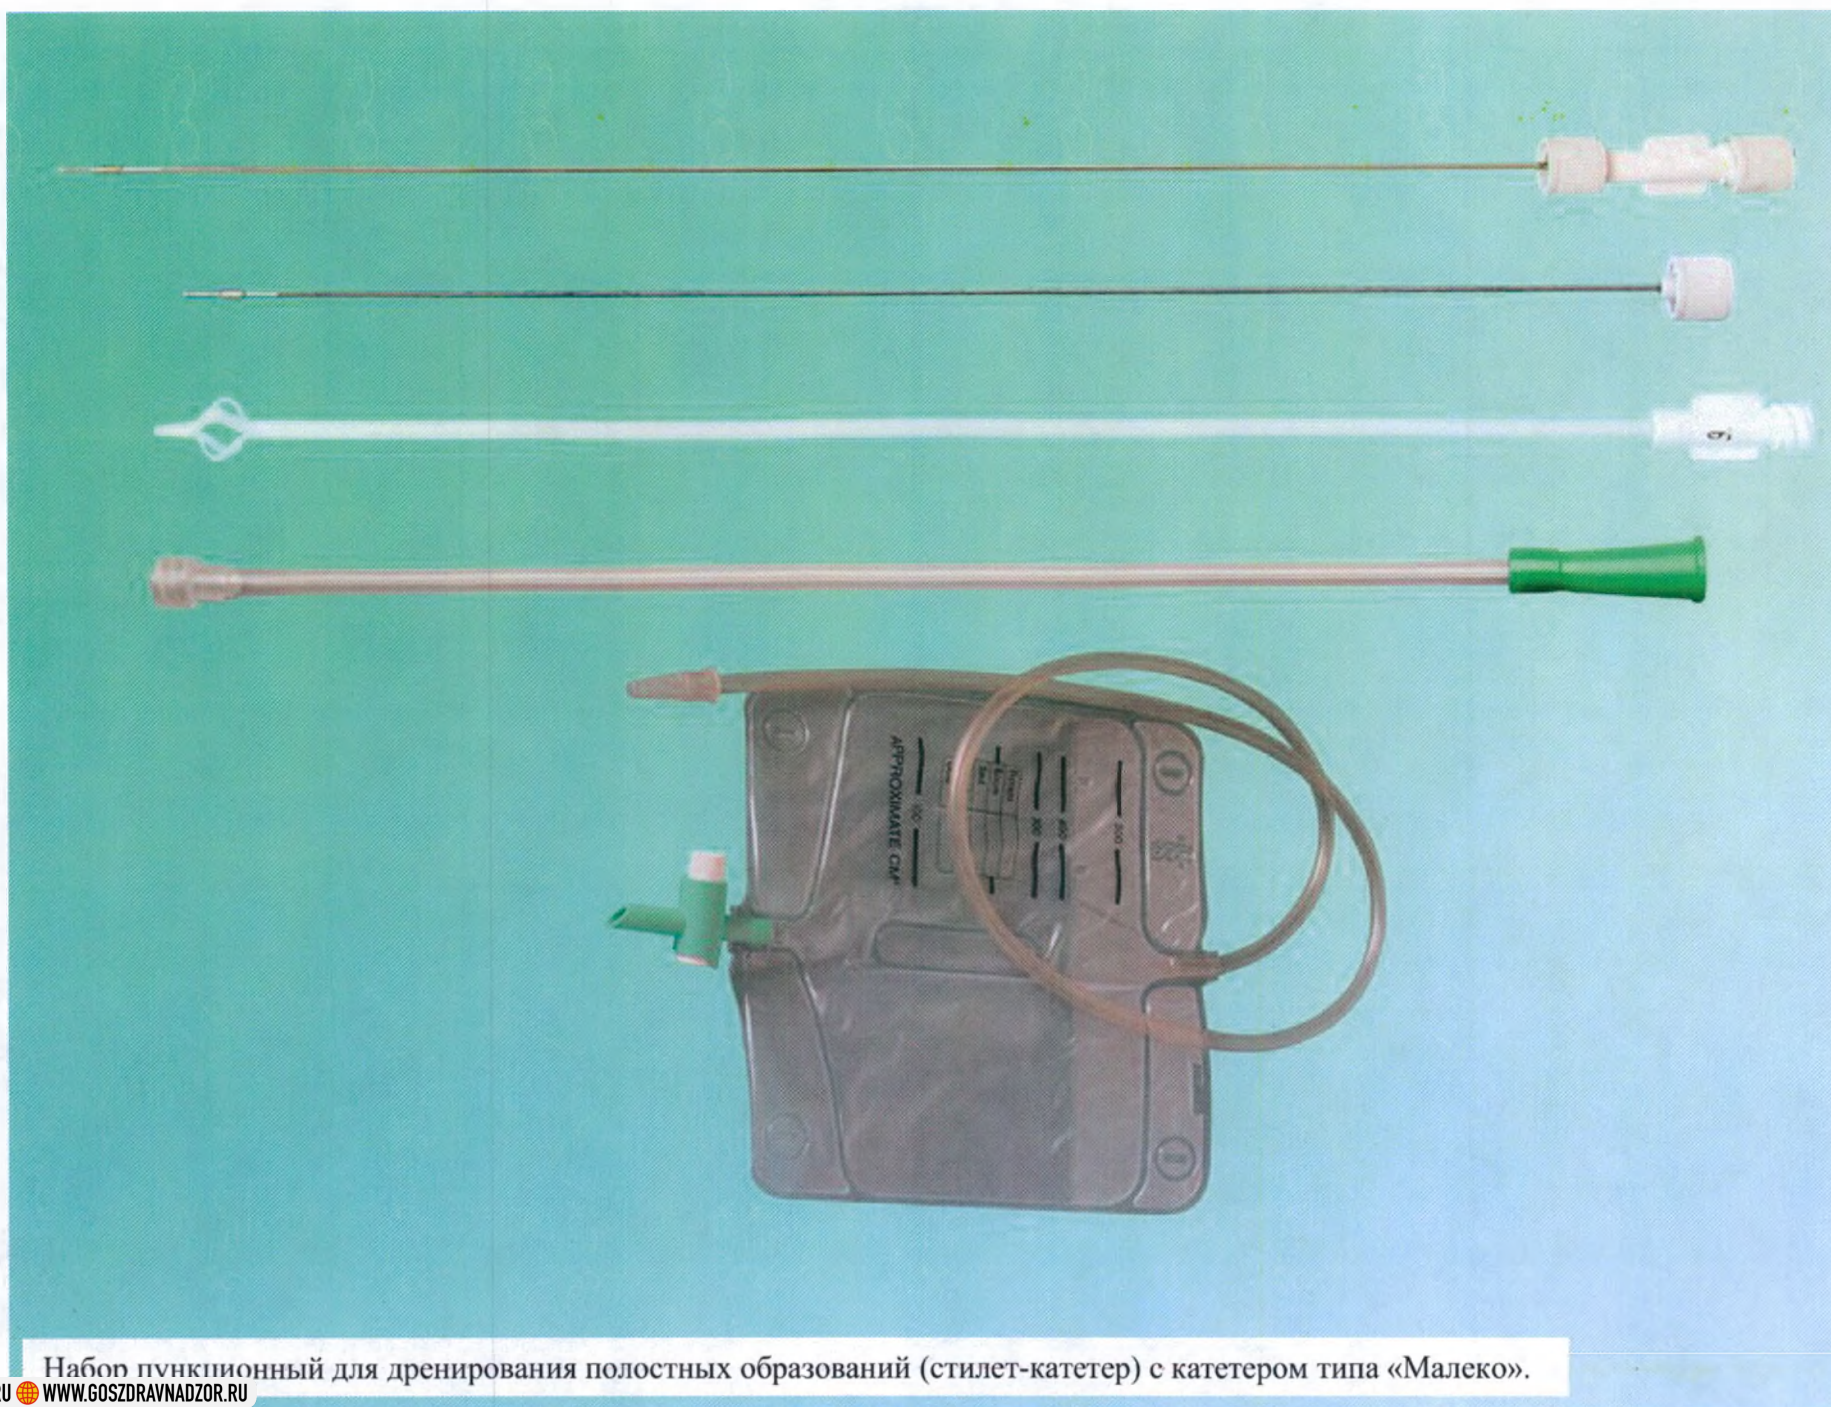

Набор пункционный для дренирования полостных образований (стиллет-катетер) с катетером типа «Малеко».

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
в комплексно лечебно-диагностическую «Экзо-ИИТ-М»
НАБОР ПУНКЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ
ПОЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (СТИЛЕТ-КАТЕТЕР)
С КАТЕТЕРОМ ТИПА «МАЛЕКО»

REF 117241209

Стилет с катетером «Малеко» (с фиксатором) диаметр 9SH, длина 24см
материал - полиуретан рентгеноконтрастный
Мочеприемник, удлинитель, катетер коагулирующий

Стерильно, асептично, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

TU 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЭН 2013/1309 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

142087, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, пер. Железнодорожный, ул. Саваткина,
вл. 01, стр. 5. Тел.: 94851502-9628, 922-7034, email: info@mit.ru, www.mit.ru

Набор пункционный для дренирования полостных образований (стилет-катетер) с катетером типа «Малеко»,
в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


**НАБОР ПУНКЦИОННЫЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ
ПОЛОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (СТИЛЕТ-КАТЕТЕР)
С КАТЕТЕРОМ ТИПА «МАЛЕКО»**

REF 117241209

Стилет с катетером «Малеко» (с фиксатором) диаметр 9СН, длина 24см
материал - полиуретан рентгеноконтрастный
Мочеприемник, удлинитель, канюля извлекающая

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор пункционный для дренирования полостных образований (стилет-катетер) с катетером типа «Малеко».
Маркировка потребительской упаковки.

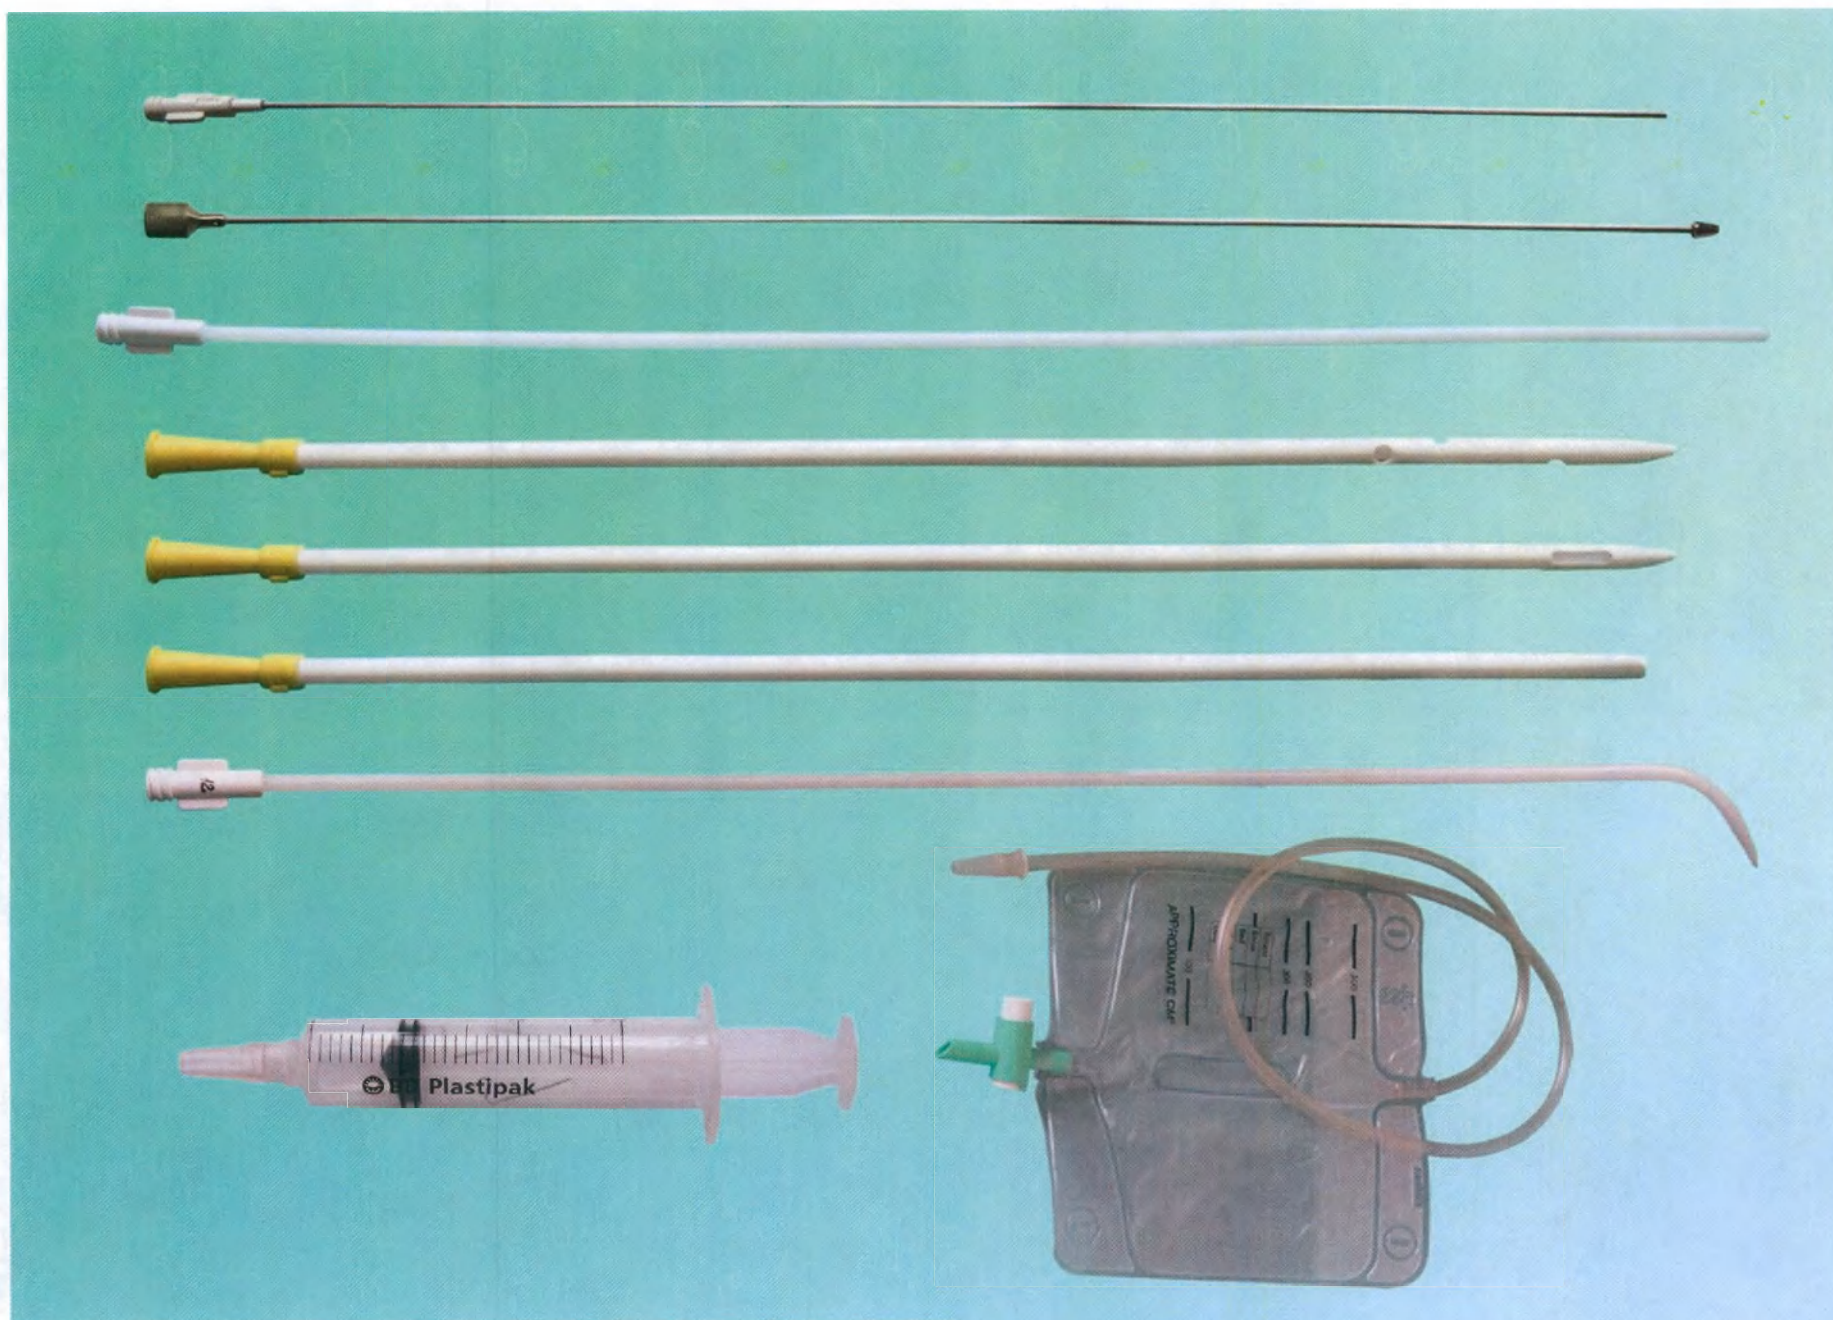

Набор для чрескожного дренирования абсцессов, флегмон и кист.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
в комплексе лечебно-диагностическому «Экспресс-МТ-М»
НАБОР ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССОВ,
ФЛЕГМОН И КИСТ

122218-4

Катетер крайний диаметр 13CH
Катетер установочный концевой диаметр 13CH
Канюля установочная (с канюлей)
Щипцы 30см
Канюли 12, 40CH
Устройство всасывающее дренажа по принципу вакуума (с конической формой)
Многоразовое

Стерильный, одноразовый, нестерилизуемый
Подтвердить при маркировке целостности упаковки

ТУ 8417-007-42237674-2011

РР № РЗН 2012/1309 от 28.03.2018

СТЕРИЛЬНЫЙ

ООО «Медиагил» производственная компания
142017, Россия, Московская обл., г. Балашиха, пер. Угличский, д. 1, С/здание,
4-й этаж. Тел.: 8(495)223-1623, 322-7134, email: mt_81@mail.ru, www.mt-81.ru

Набор для чрескожного дренирования абсцессов, флегмон и кист, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ АБСЦЕССОВ,
ФЛЕГМОН И КИСТ

REF **122218-4**

Катетер прямой диаметр 12CH

Катетер установочный изогнутый диаметр 12CH

Канюля установочная (с оливой)

Шприц 30мл

Катетеры 12...60CH

Устройство восстан. дренажа по свищевому ходу (с изменяемой формой)

Мочеприемник


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для чрескожного дренирования абсцессов, флегмон и кист. Маркировка потребительской упаковки.

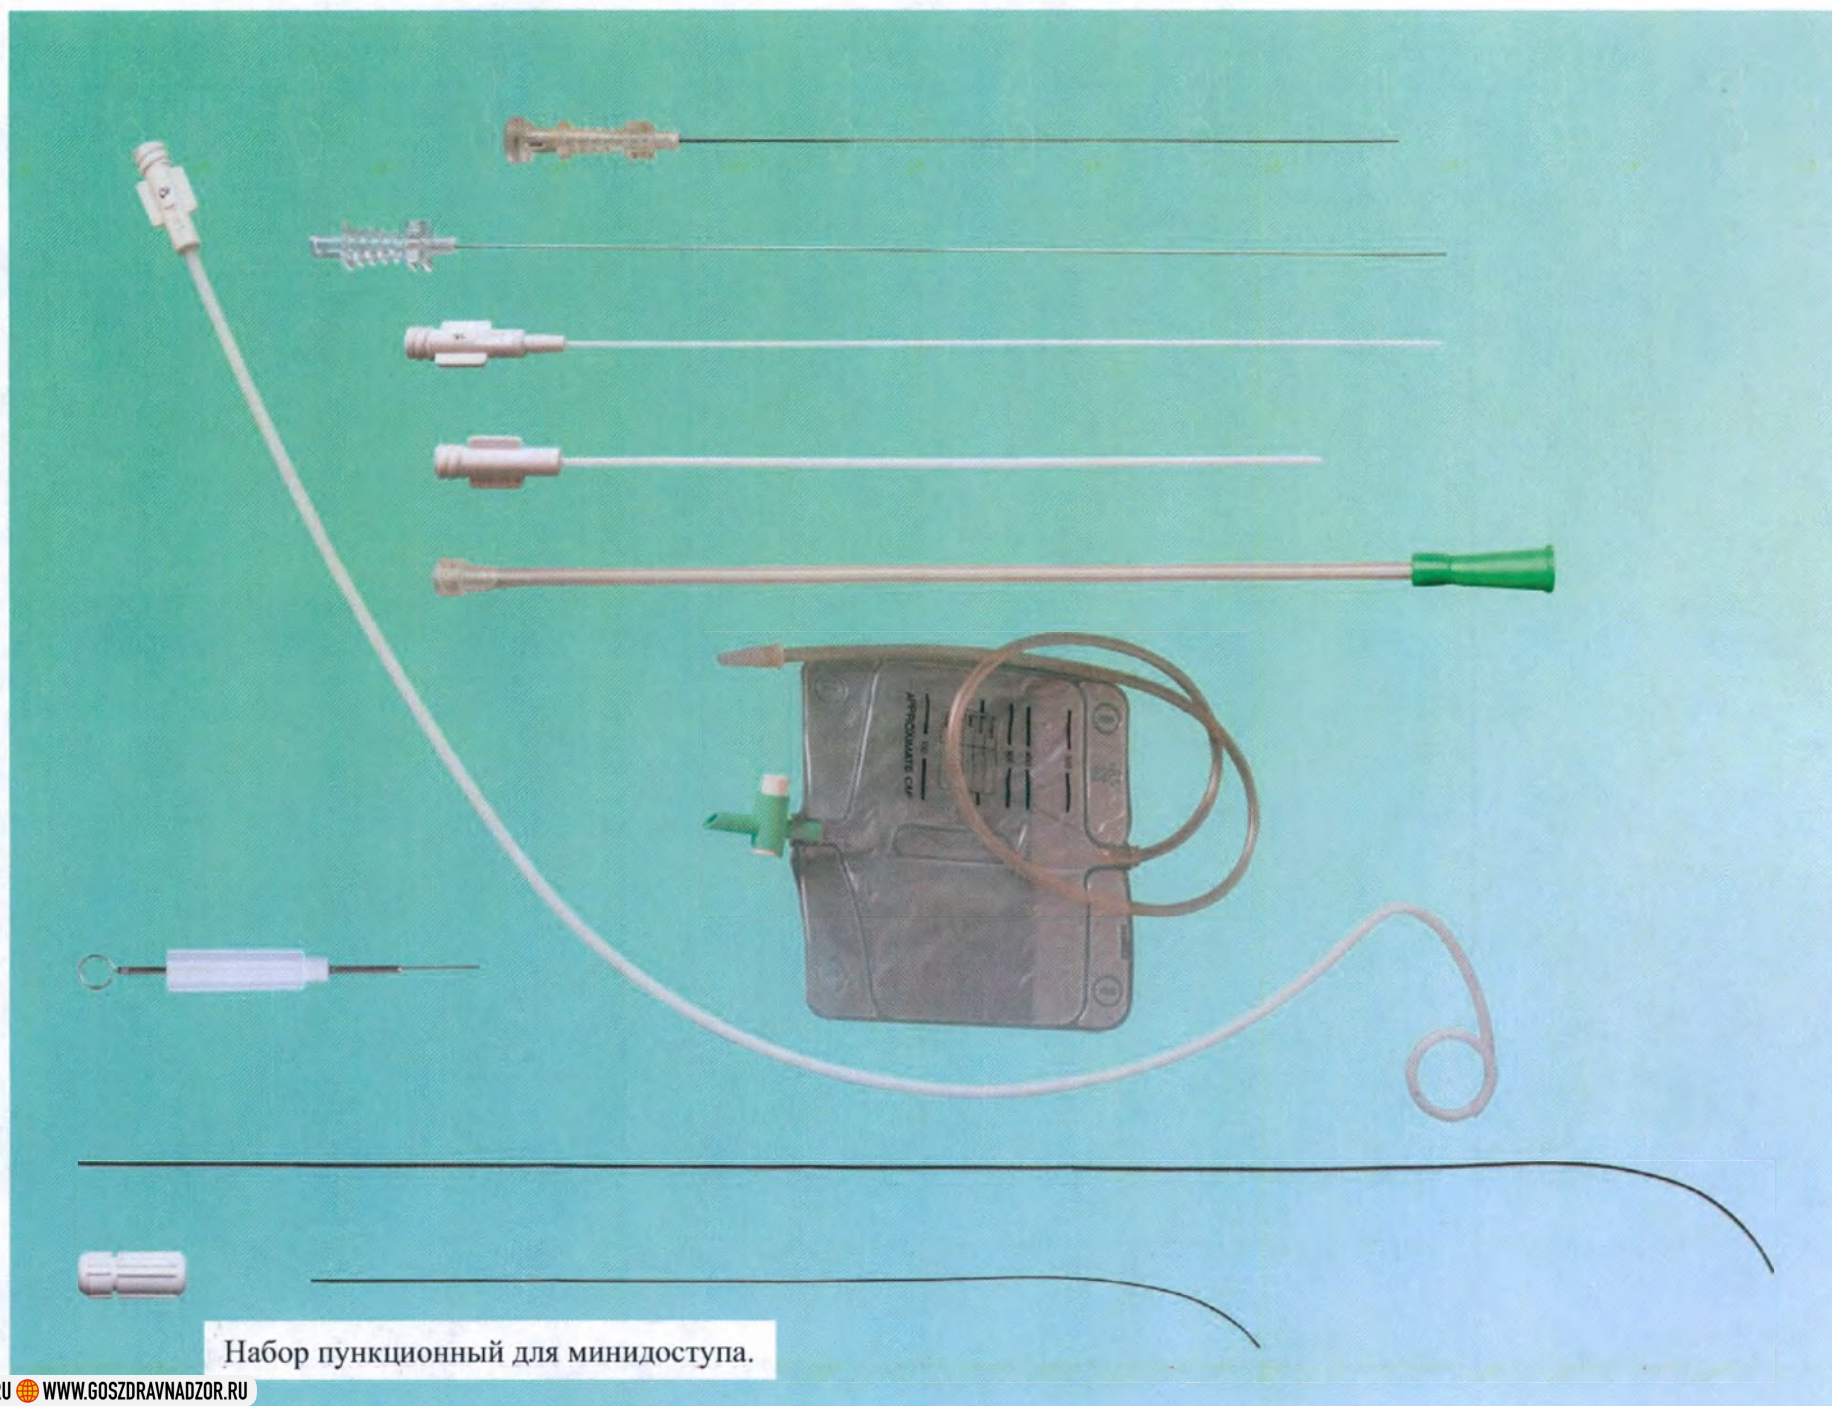

Набор пункционный для минидоступа.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
в комплексе лечебно-диагностическому «Эндо-MIT-M»
НАБОР ПУНКЦИОННЫЙ ДЛЯ МИНИДОСТУПА

REF 124200

Дренаж для наружно-внутреннего дренирования (с фиксатором)
диаметр 10СН
Канюля установочная, проводник минидоступа изогнутый, проводник
сверхжесткий изогнутый, игла пункционная, бура, пробойник
Мониторинговых, удлинитель, ручка

Стерильное, запечатано, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-067-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 28.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»
141067, Россия, Московская область, г. Балашиха, пер. Железнодорожный, д/п, Советская,
зд.01, стр.Б. Тел: 8(495)610-1523, 622-7034, e-mail: mit_m@mit.ru, www.mit-m.ru

Набор пункционный для минидоступа, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР ПУНКЦИОННЫЙ ДЛЯ МИНИДОСТУПА

REF 124200

Дренаж для наружно-внутреннего дренирования (с фиксатором)
диаметр 10CH

Канюля установочная, проводник минидоступа изогнутый, проводник
сверхжесткий изогнутый, игла поисковая, буж, пробойник

Мочеприемник, удлинитель, ручка


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор пункционный для минидоступа. Маркировка потребительской упаковки.

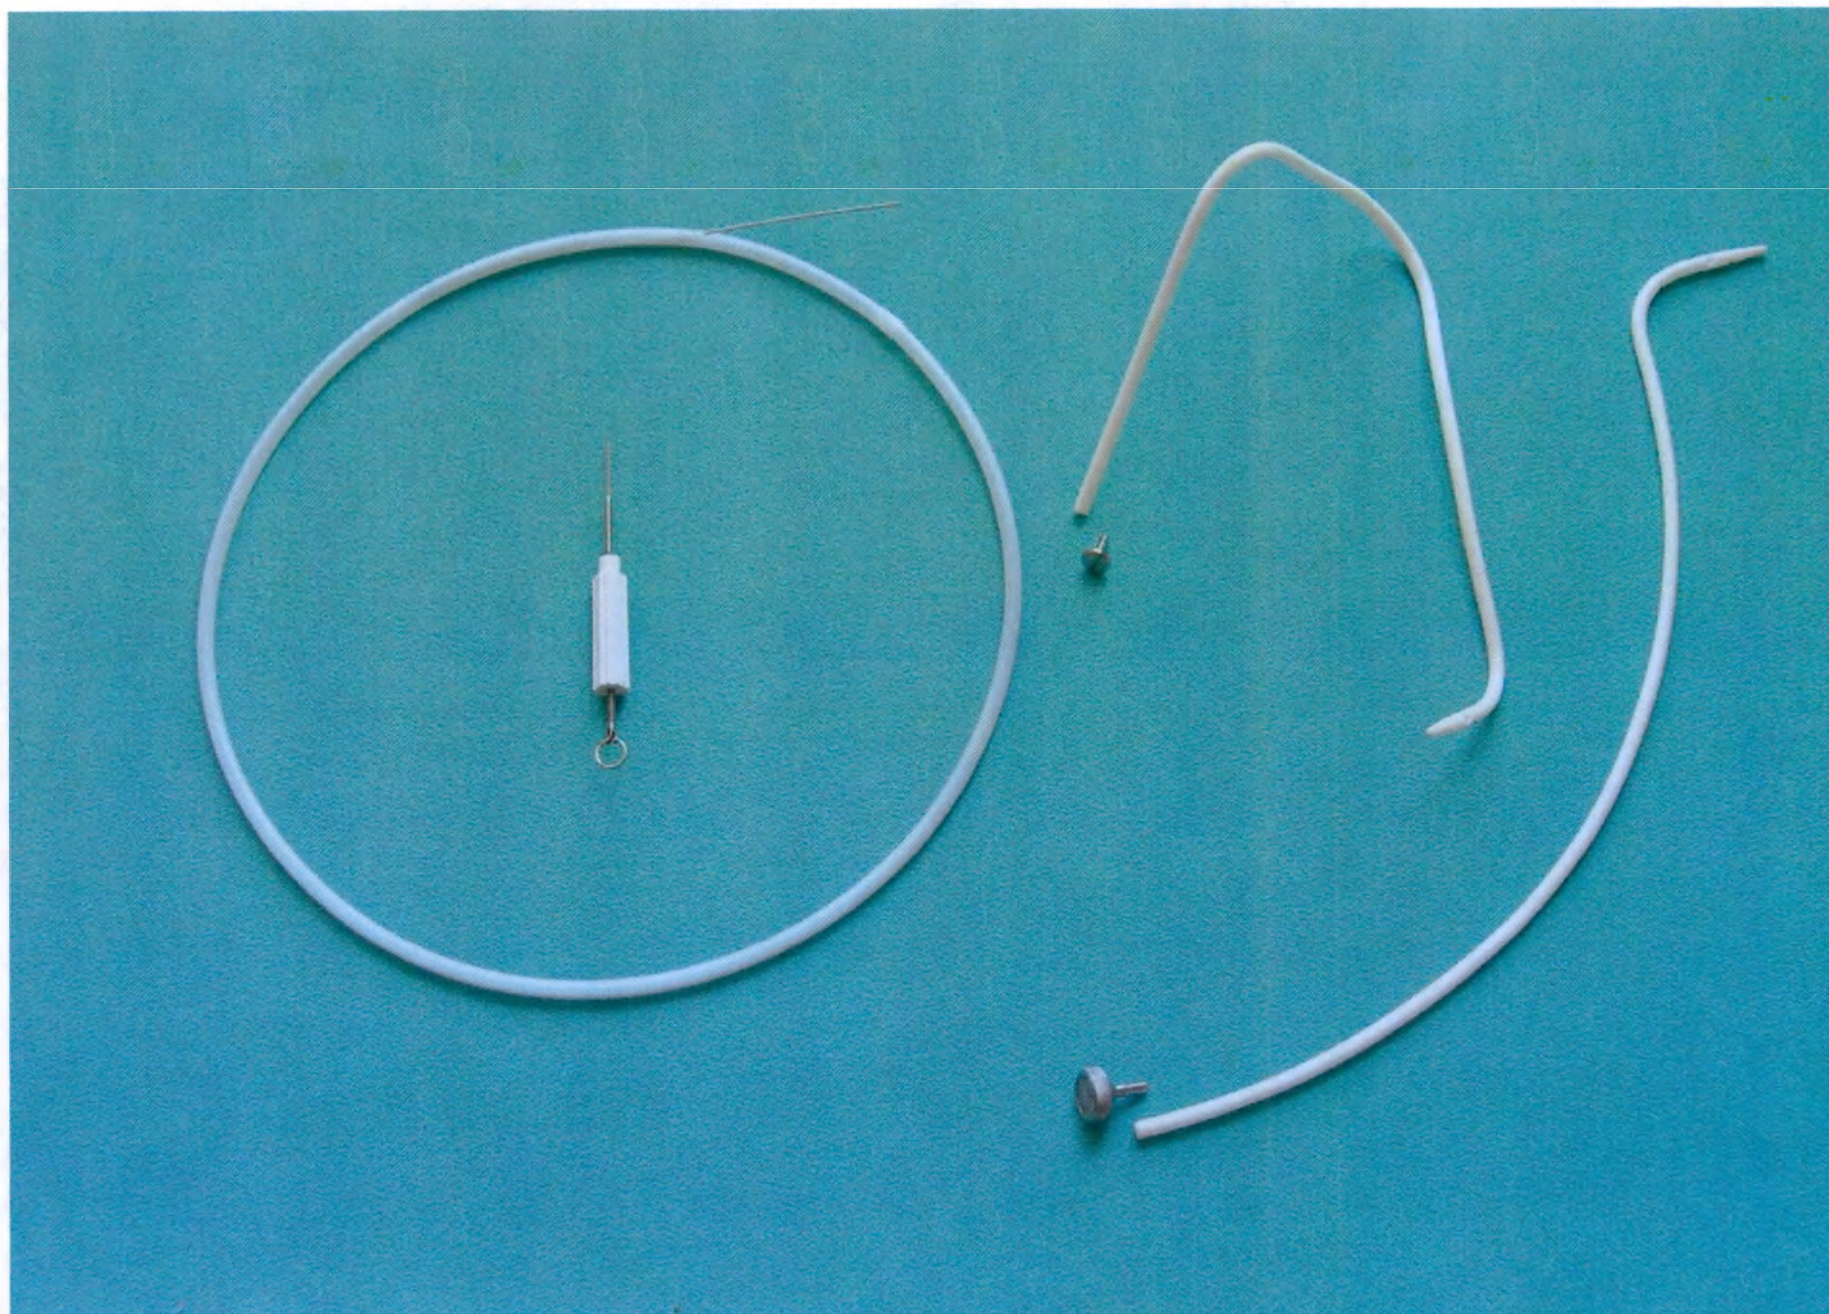

Набор для панкреато-билиарного эндопротезирования.

Набор медицинских для минимально инвазивных вмешательств
в комплексе лечебно-диагностическому «Эндо-MIT-M»
НАБОР ДЛЯ ПАНКРЕАТО-БИЛИАРНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

REF 121051

Эндоскоп для левой доли печени диаметр 12СН с углом загиба конда 80°,
длина 145см, материал - полиуретан рентгеноконтрастный.
Эндоскоп для правой доли печени диаметр 12СН с углом загиба конда 80°,
длина 170см, материал - полиуретан рентгеноконтрастный.
Проводник прямой, диаметр 0,33М, длина 180см.
Пробойник, рентгеноконтрастный элемент, гомеостатизирующий агент.

Стерильно, одноразово, не подлежит
повторному использованию.
ТУ 3437-007-42237874-2011
РР № ИР 2013/1200 от 26.03.2018

STERILE



ООО «Медицинская инновационная технология»
40387, Россия, Москва, область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Солнечная,
д.181, стр.5. Тел: 8(495)622-1425, 8(495)622-1426, e-mail: info_mit@mit.ru, www.mit.ru

Набор для панкреато-билиарного эндопротезирования, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»
НАБОР ДЛЯ ПАНКРЕАТО-БИЛИАРНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

REF 121051

Эндопротез для левой доли печени диаметр 12СН с углом загиба конца 80°,
диной 145мм, материал - полиуретан рентгеноконтрастный

Эндопротез для правой доли печени диаметр 12СН с углом загиба конца 80°,
длиной 290мм, материал - полиуретан рентгеноконтрастный

Проводник прямой: диаметр 0,038", длина 150см

Пробойник, герметизирующий элемент, герметизирующий винт


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для панкреато-билиарного эндопротезирования. Маркировка потребительской упаковки.

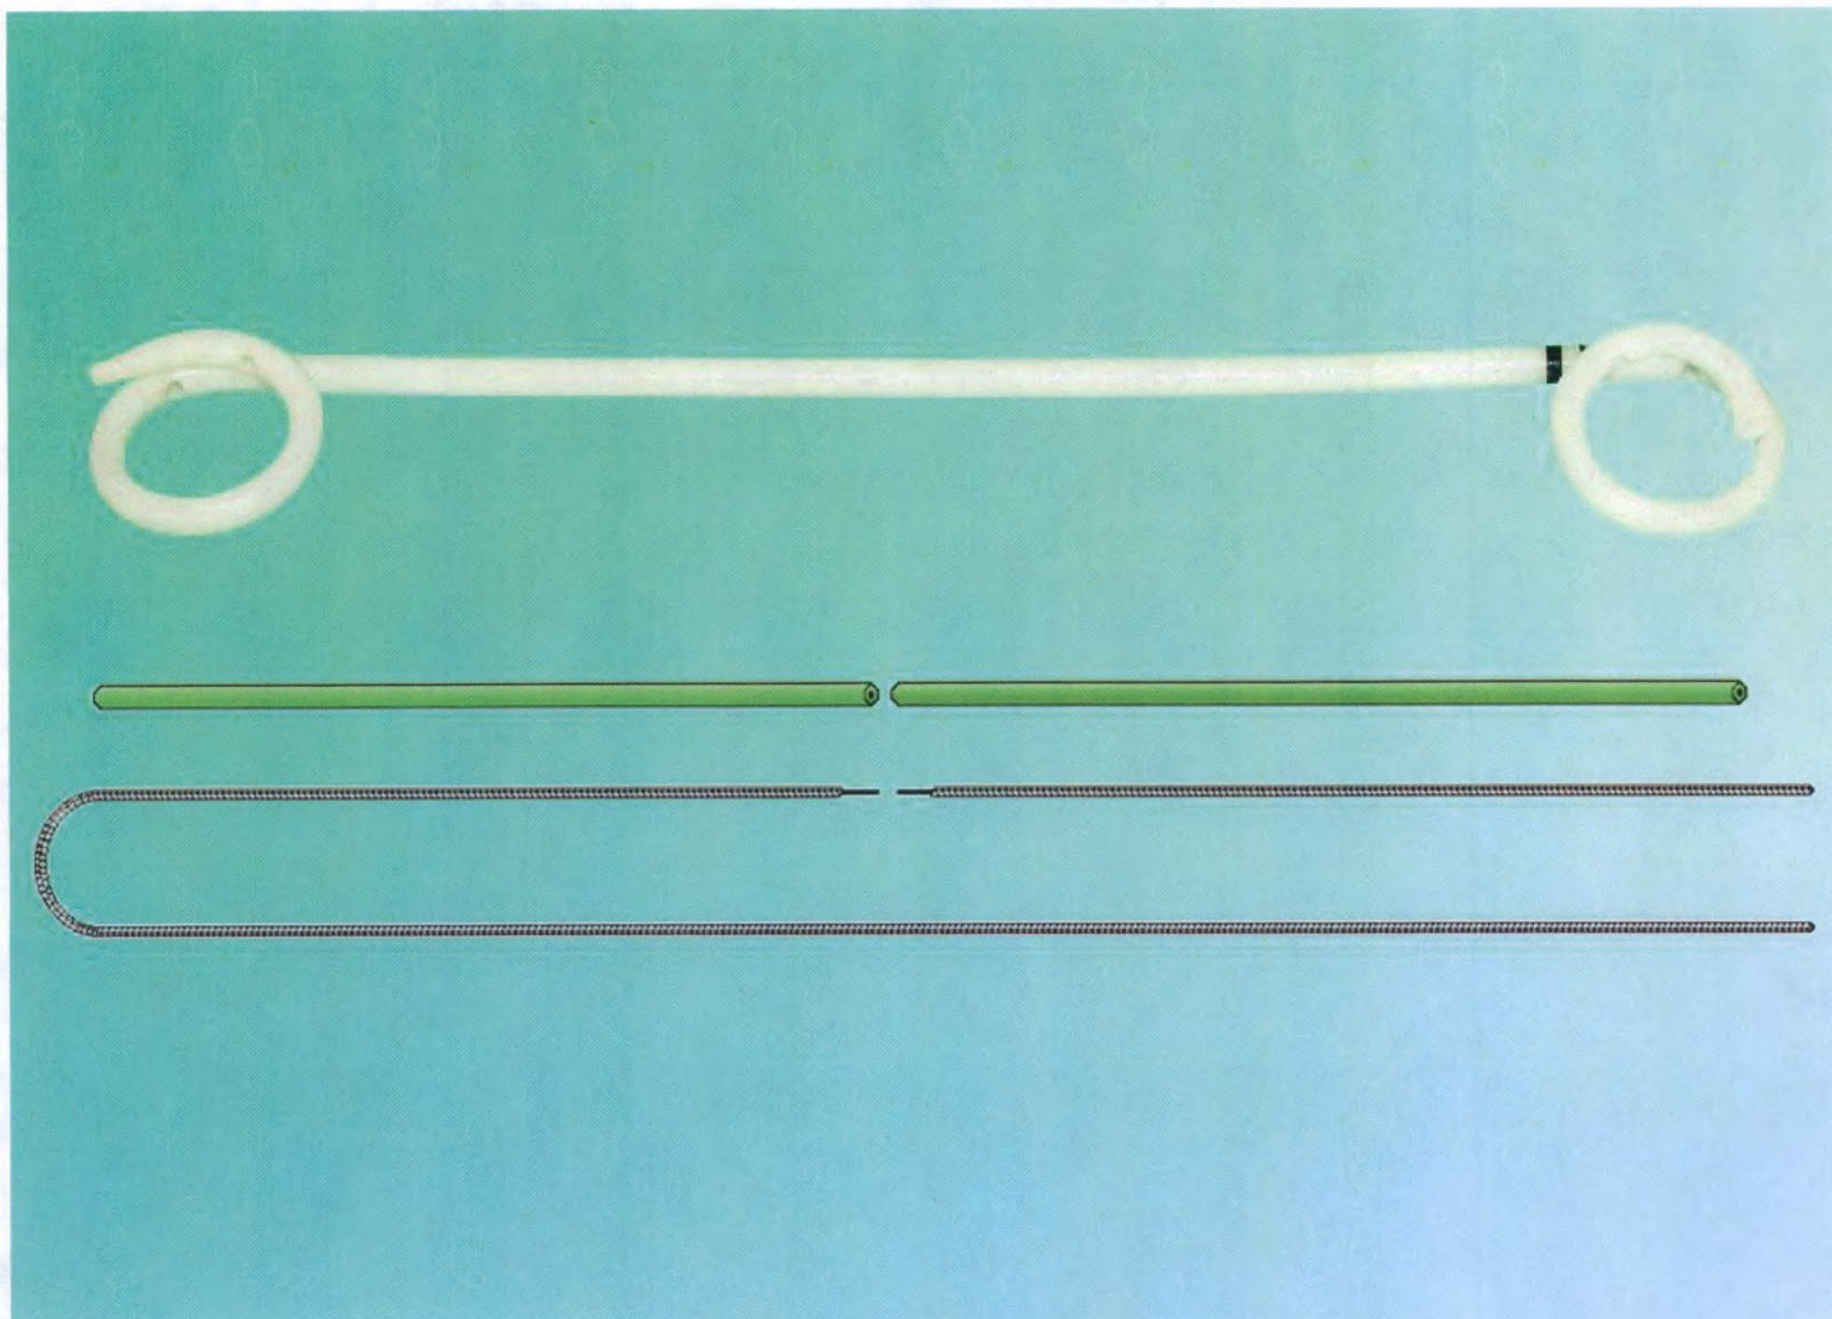

Набор эндопротеза билиарного полимерного.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»
НАБОР ЭНДОПРОТЕЗА БИЛИАРНОГО ПОЛИМЕРНОГО

REF 144107-6

Эндопротез: диаметр 7СН, длина 60 мм
материал - полиуретан рентгеноконтрастный
Проводник прямой: диаметр 0,038", длина 290см
Толкатель: диаметр 7СН, длина 160см

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

14 987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советск. 1,
вл. 61, стр. 5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_its@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор эндопротеза билиарного полимерного, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»
НАБОР ЭНДОПРОТЕЗА БИЛИАРНОГО ПОЛИМЕРНОГО



REF

144107-6

Эндопротез: диаметр 7CH, длина 60 мм
материал - полиуретан рентгеноконтрастный
Проводник прямой: диаметр 0,038", длина 290см
Толкатель: диаметр 7CH, длина 160см

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

14 987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская 1,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор эндопротеза билиарного полимерного. Маркировка потребительской упаковки.

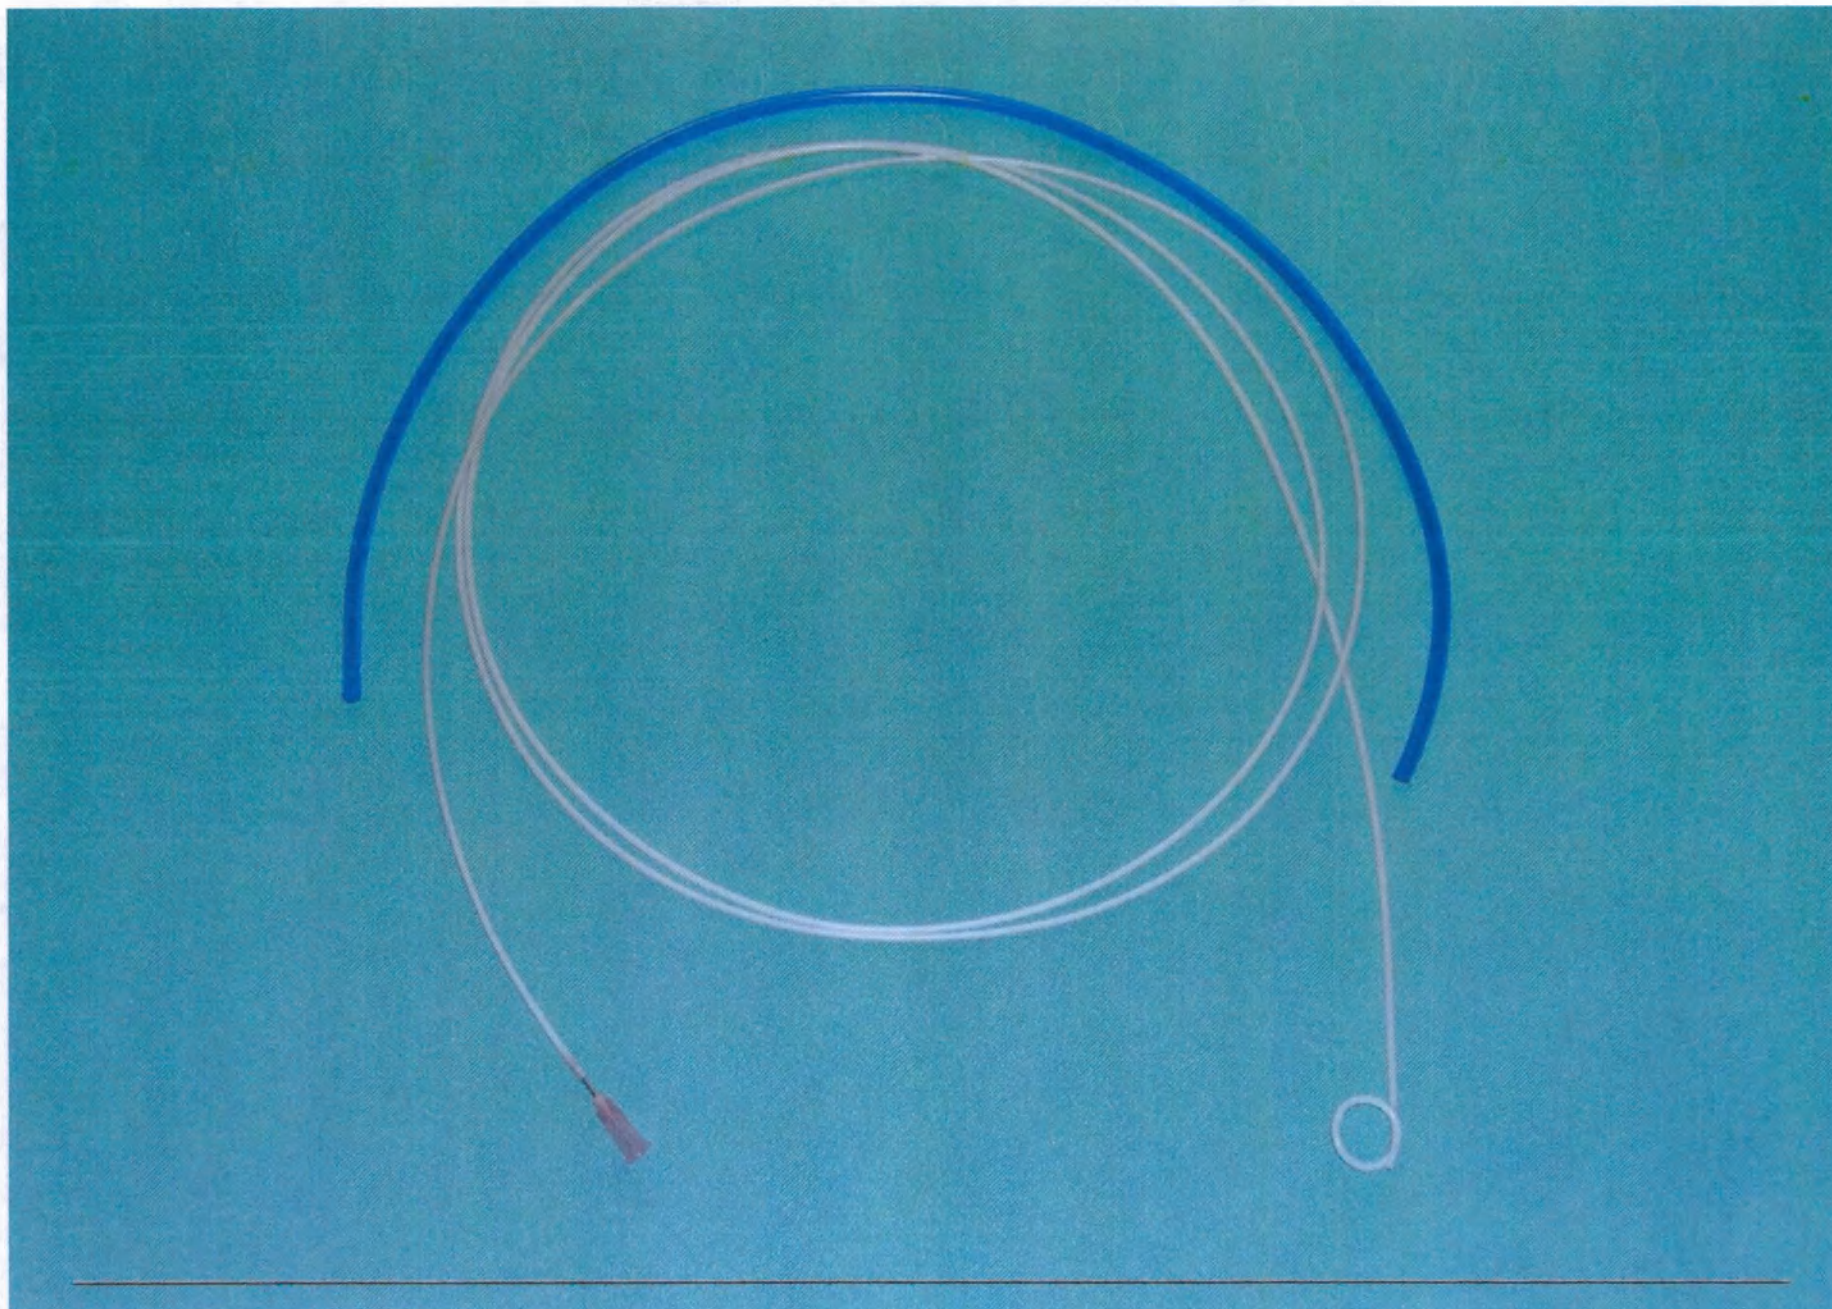

Набор назобилиарного дренажа.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
в комплексе лечебно-диагностическому «Эндо-ABIT-M»

НАБОР НАЗОБИЛИАРНОГО ДРЕНАЖА

REF 143107

Назобилиарный дренаж (с адаптером) диаметр ТСН, длина 250см, материал
– полиэтилен рентгеноконтрастный
Катетер назальный диаметр 14СН, длина 50см
Проводник диаметр 3,038", длина 290см

Стерильно, асептично, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9432-207-4237874-2011
РМ МРЗН 2013/1509 от 20.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

142907, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл. 61, стр. 5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mti_100@mail.ru, www.mti-100.ru

Набор назобилиарного дренажа, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР НАЗОБИЛИАРНОГО ДРЕНАЖА

REF 143107

Назобилиарный дренаж (с адаптером) диаметр 7CH, длина 250см, материал
– полиэтилен рентгеноконтрастный

Катетер назальный диаметр 14CH, длина 50см
Проводник диаметр 0,038", длина 290см


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор назобилиарного дренажа. Маркировка потребительской упаковки.

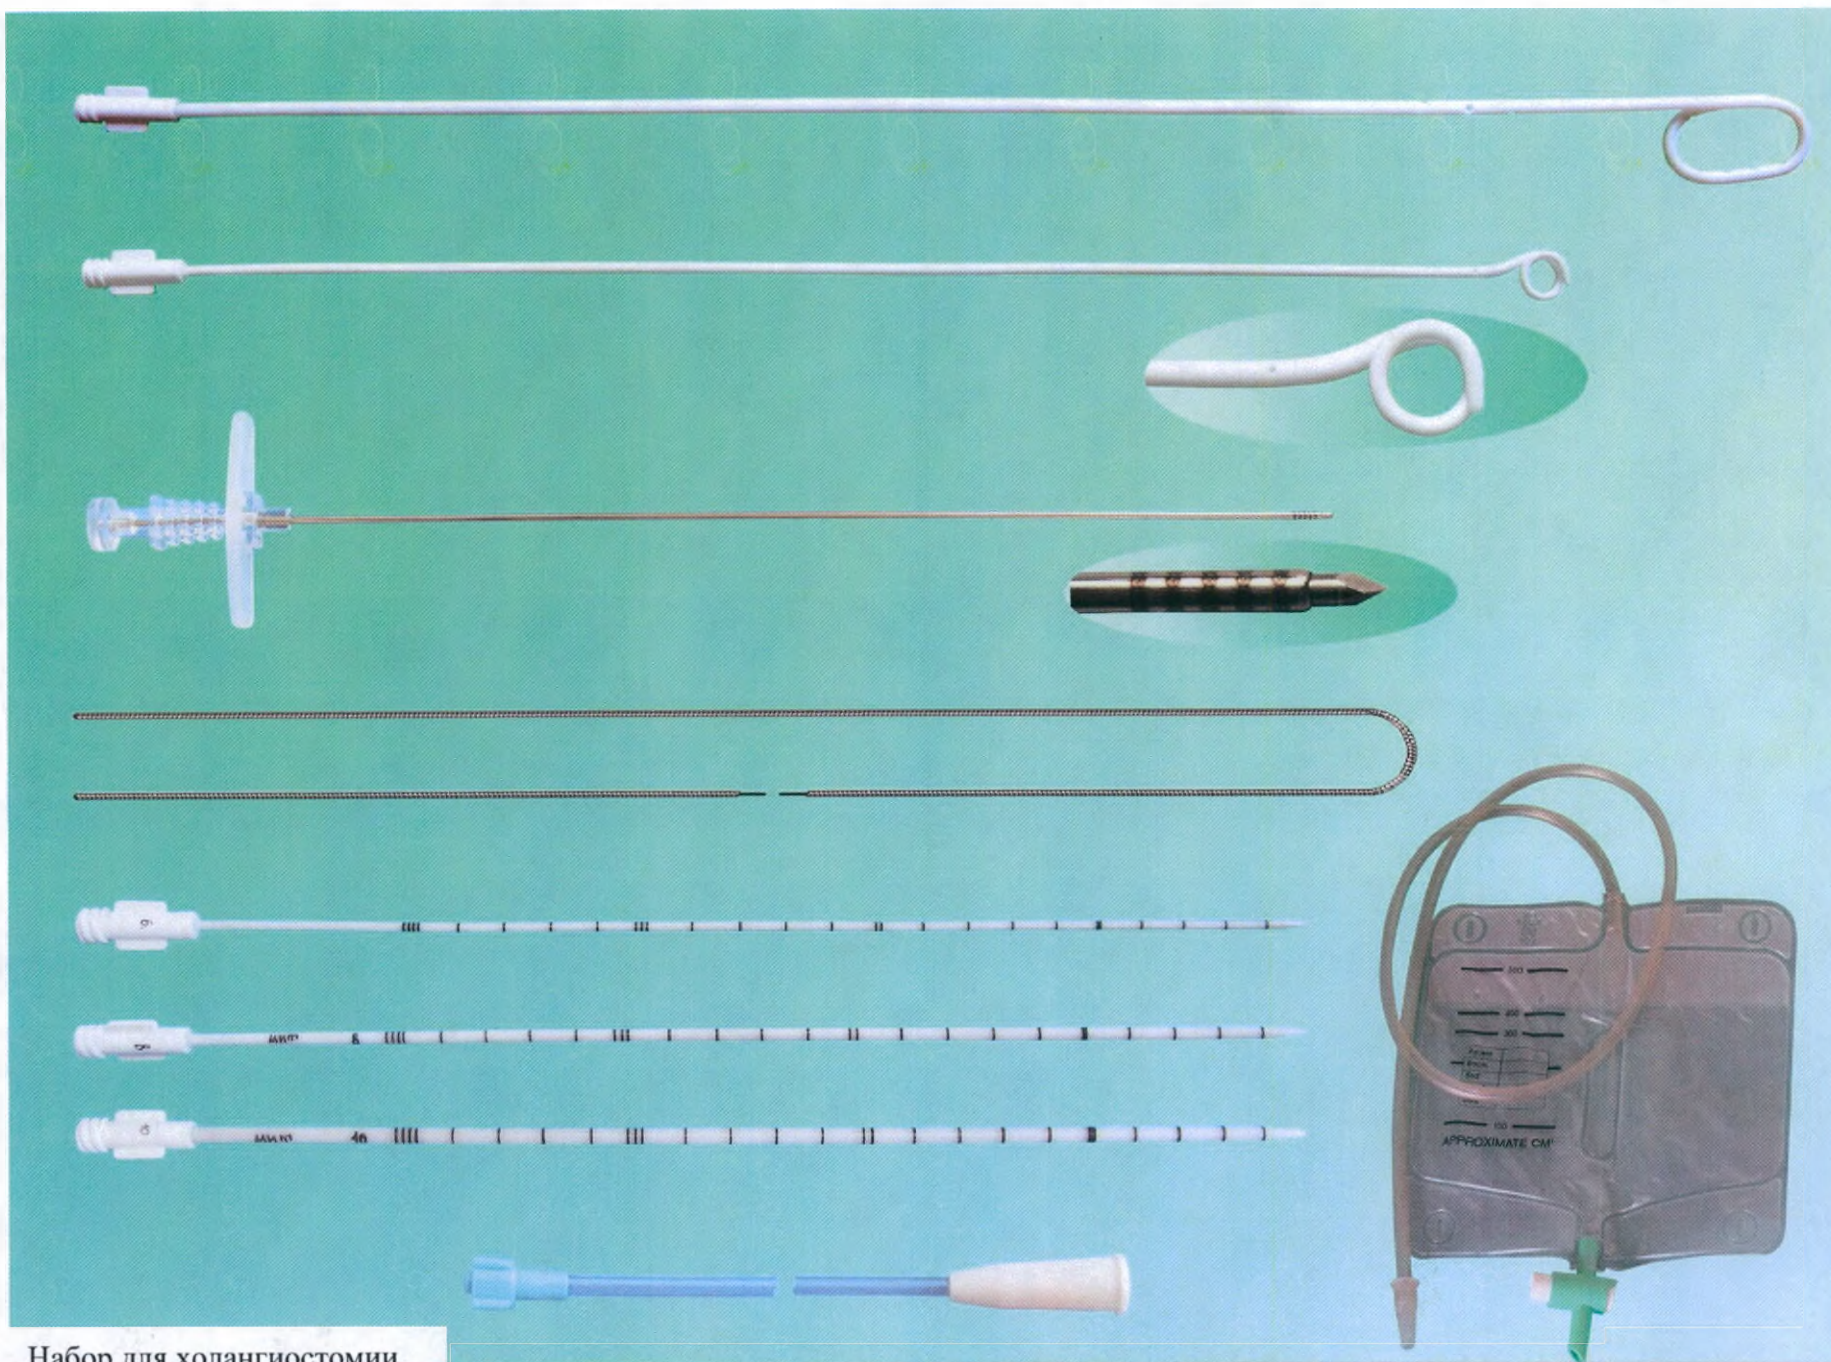

Набор для холангиостомии.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Здра-ВМТ-М»

НАБОР ДЛЯ ХОЛАНГИОСТОМИИ

REF 108509П

Наружная холангистомия 9СН

Наружно-внутренняя холангистомия (с фиксатором) диаметр 19СН

Игла пункционная диаметр 1,35мм, длина 29см

Проводник диаметр 0,635", длина 150см

Бужа диаметр 6СН, 8СН, 10СН

Мочеприемник, удлинитель

Стерильно, асептично, нестерильно

не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 3437-067-42237874-2011

РУ № РОИ 2011/1309 от 26.03.2015



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143607, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Холмаши, ул. Светотек.
ин.п., стр.5. Тел.: 8(495)522-1125, 522-7034, email: info@mit.ru, www.mit.ru

Набор для холангиостомии, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР ДЛЯ ХОЛАНГИОСТОМИИ

REF 108509П

Наружная холангиостома 9СН

Наружно-внутренняя холангиостома (с фиксатором) диаметр 10СН

Игла пункционная диаметр 1,35мм, длина 20см

Проводник диаметр 0,035", длина 150см

Бужи диаметр 6СН, 8СН, 10СН

Мочеприемник, удлинитель


Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для холангиостомии. Маркировка потребительской упаковки.

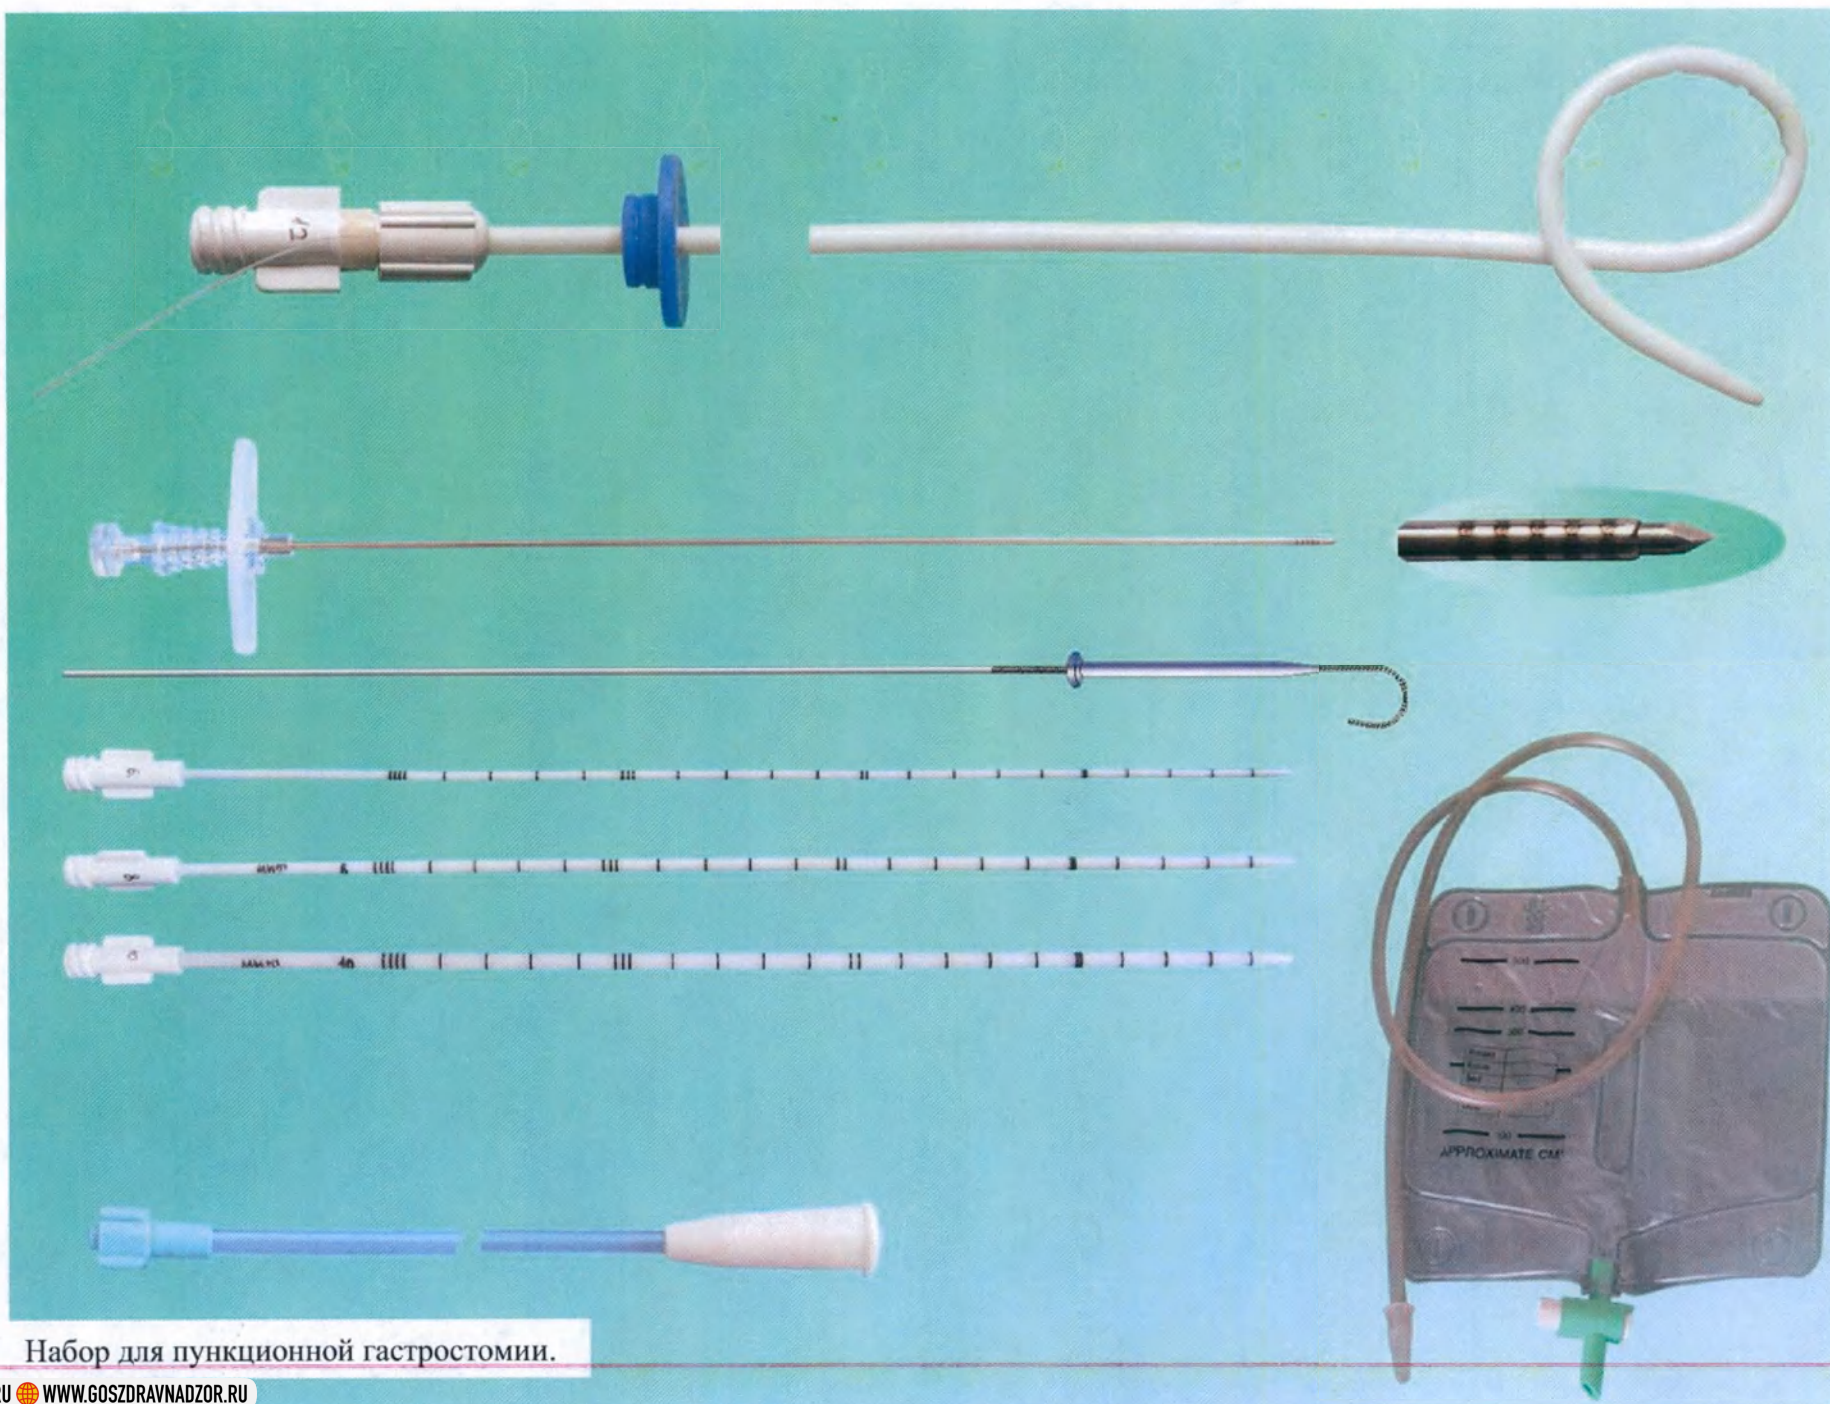

Набор для пункционной гастростомии.


Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Сэндо-МХТ-М»
НАБОР ДЛЯ ПУНКЦИОННОЙ ГАСТРОСТОМИИ

REF 109512П

Гастростома диаметр 12СН с фиссатором
Игла диаметр 1,35мм, длина 28см
Проводник (сферирующий колпачок) диаметр 0,932", длина 190см
Буж диаметр 6,8,10,12СН
Удлинитель, мочеприведения

Стерильно, асепоточно, нетоксично
Испр. при вскрытии при нарушении целостности упаковки
ТУ 9487-007-42237874-2011
РУ на РЭН 2013/1309 от 28.03.2018

STERILE R


ООО «Минимальные инвазивные технологии»
140867, Россия, Московская обл., г. Балашиха, пер. Мичуринский, ул. Свободная
вп.5/1, стр.3. Тел: 8(495)522-1825, 8(20)7034, email: mti_ru@mail.ru, www.mti-ru.ru

Набор для пункционной гастростомии, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР ДЛЯ ПУНКЦИОННОЙ ГАСТРОСТОМИИ

REF 109512П

Гастростома диаметр 12СН с фиксатором

Игла диаметр 1,35мм, длина 20см

Проводник (сверхжесткий изогнутый) диаметр 0,032", длина 150см

Бужи диаметр 6,8,10,12СН

Удлинитель, мочеприемник


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для пункционной гастростомии. Маркировка потребительской упаковки.

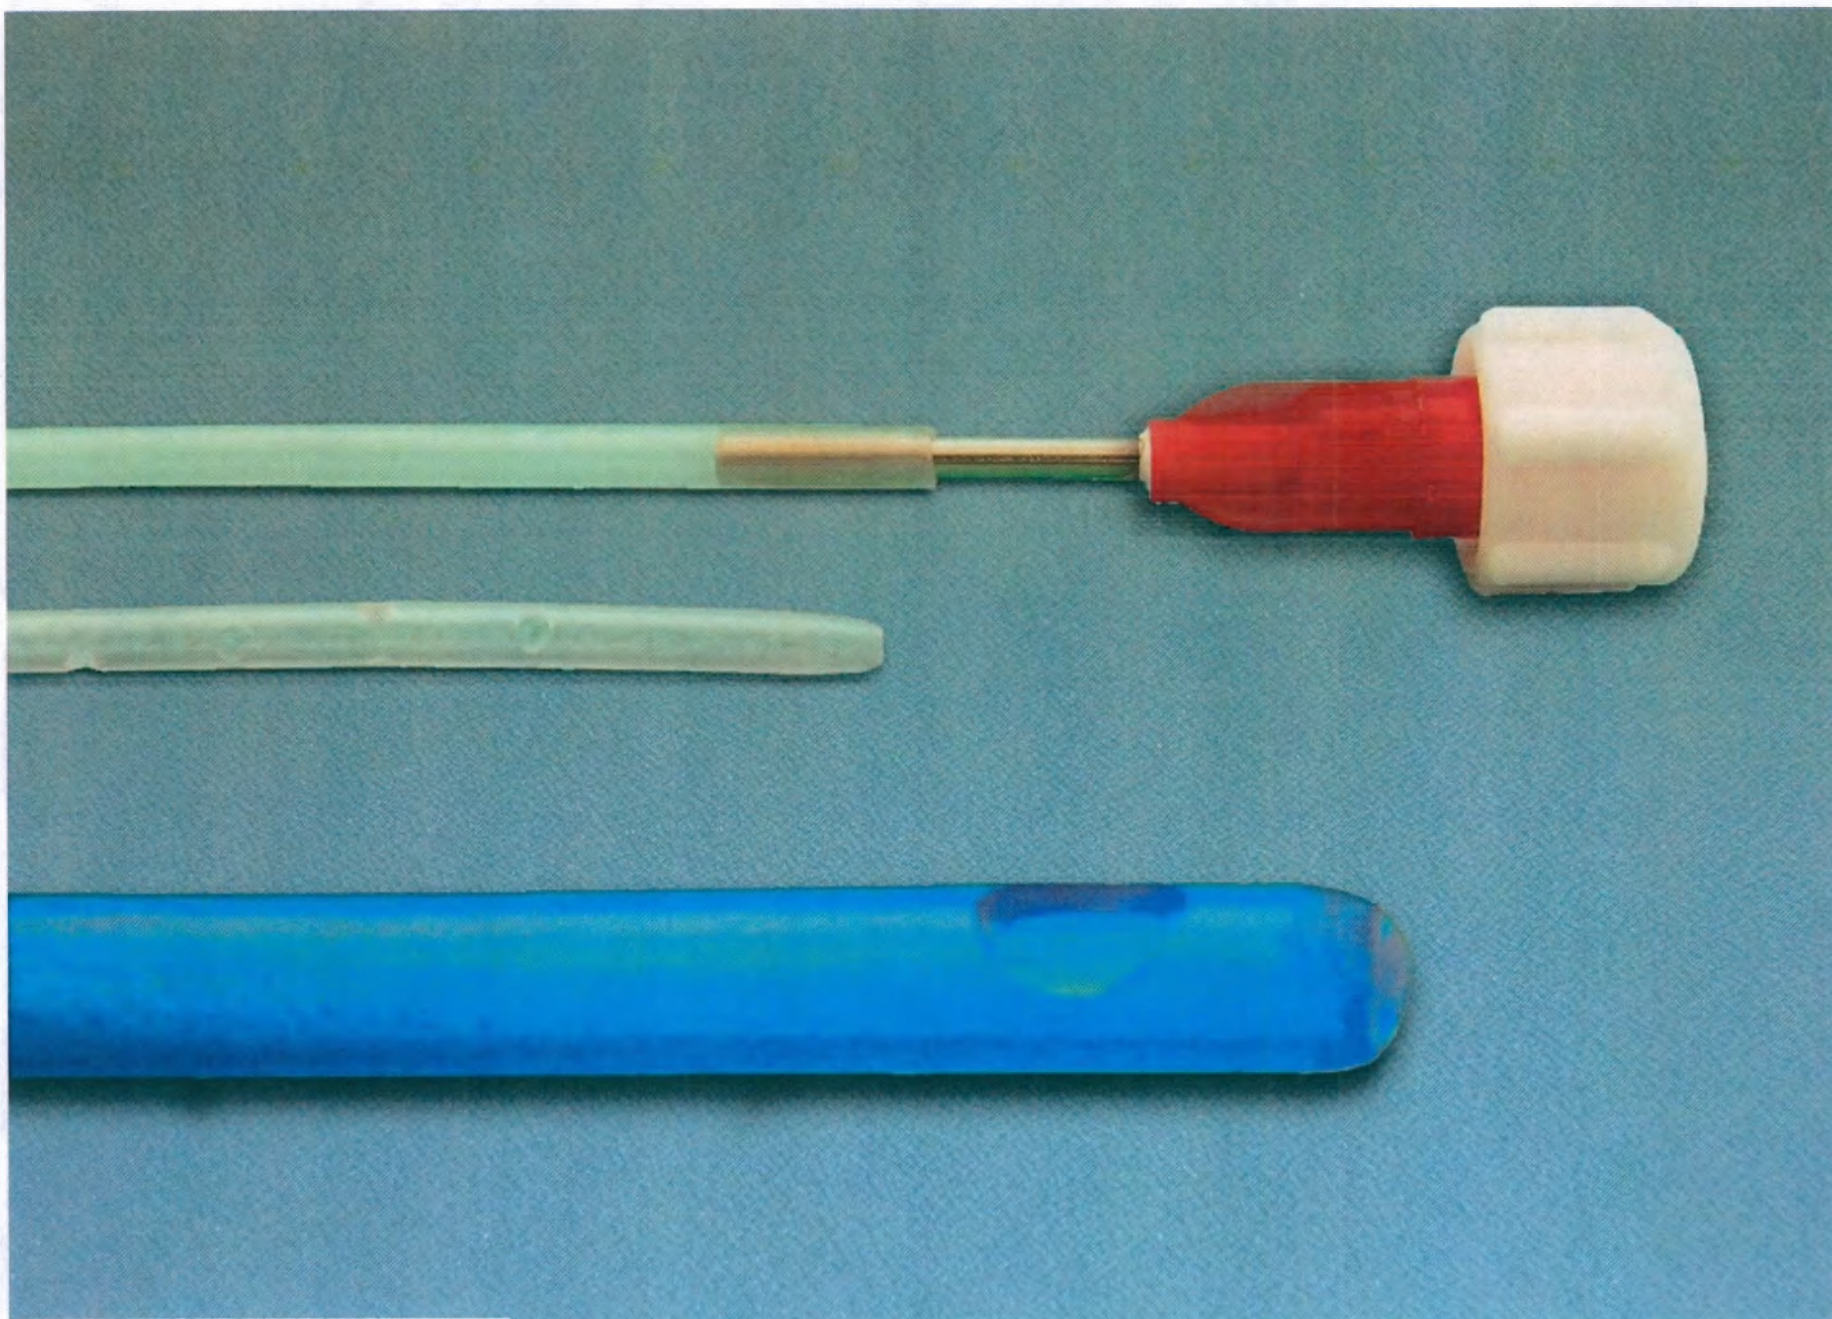

Набор для энтерального питания.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
в комплекс лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-8»
НАБОР ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

REF 606200

Катетер для энтерального питания диаметр 6СН, длина 250см
материал - полиэтилен рентгеноконтрастный
Катетер назальный диаметр 12СН, длина 50см
Заглушка, адаптер

Стерильно, асепотично, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РР № РЭН 2013/1209 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143087, Россия, Моск. обл., г. Егорьевск, пер. Железнодорожный, ул. Советская,
наб. 1, стр. 5. Тел. 8(498)622-1629, 622-7024, email: info@mit.ru, www.mit.ru

Набор для энтерального питания, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

REF 606200

Катетер для энтерального питания диаметр 6СН, длина 250см
материал - полиэтилен рентгеноконтрастный
Катетер назальный диаметр 12СН, длина 50см
Заглушка, адаптер


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для энтерального питания. Маркировка потребительской упаковки.

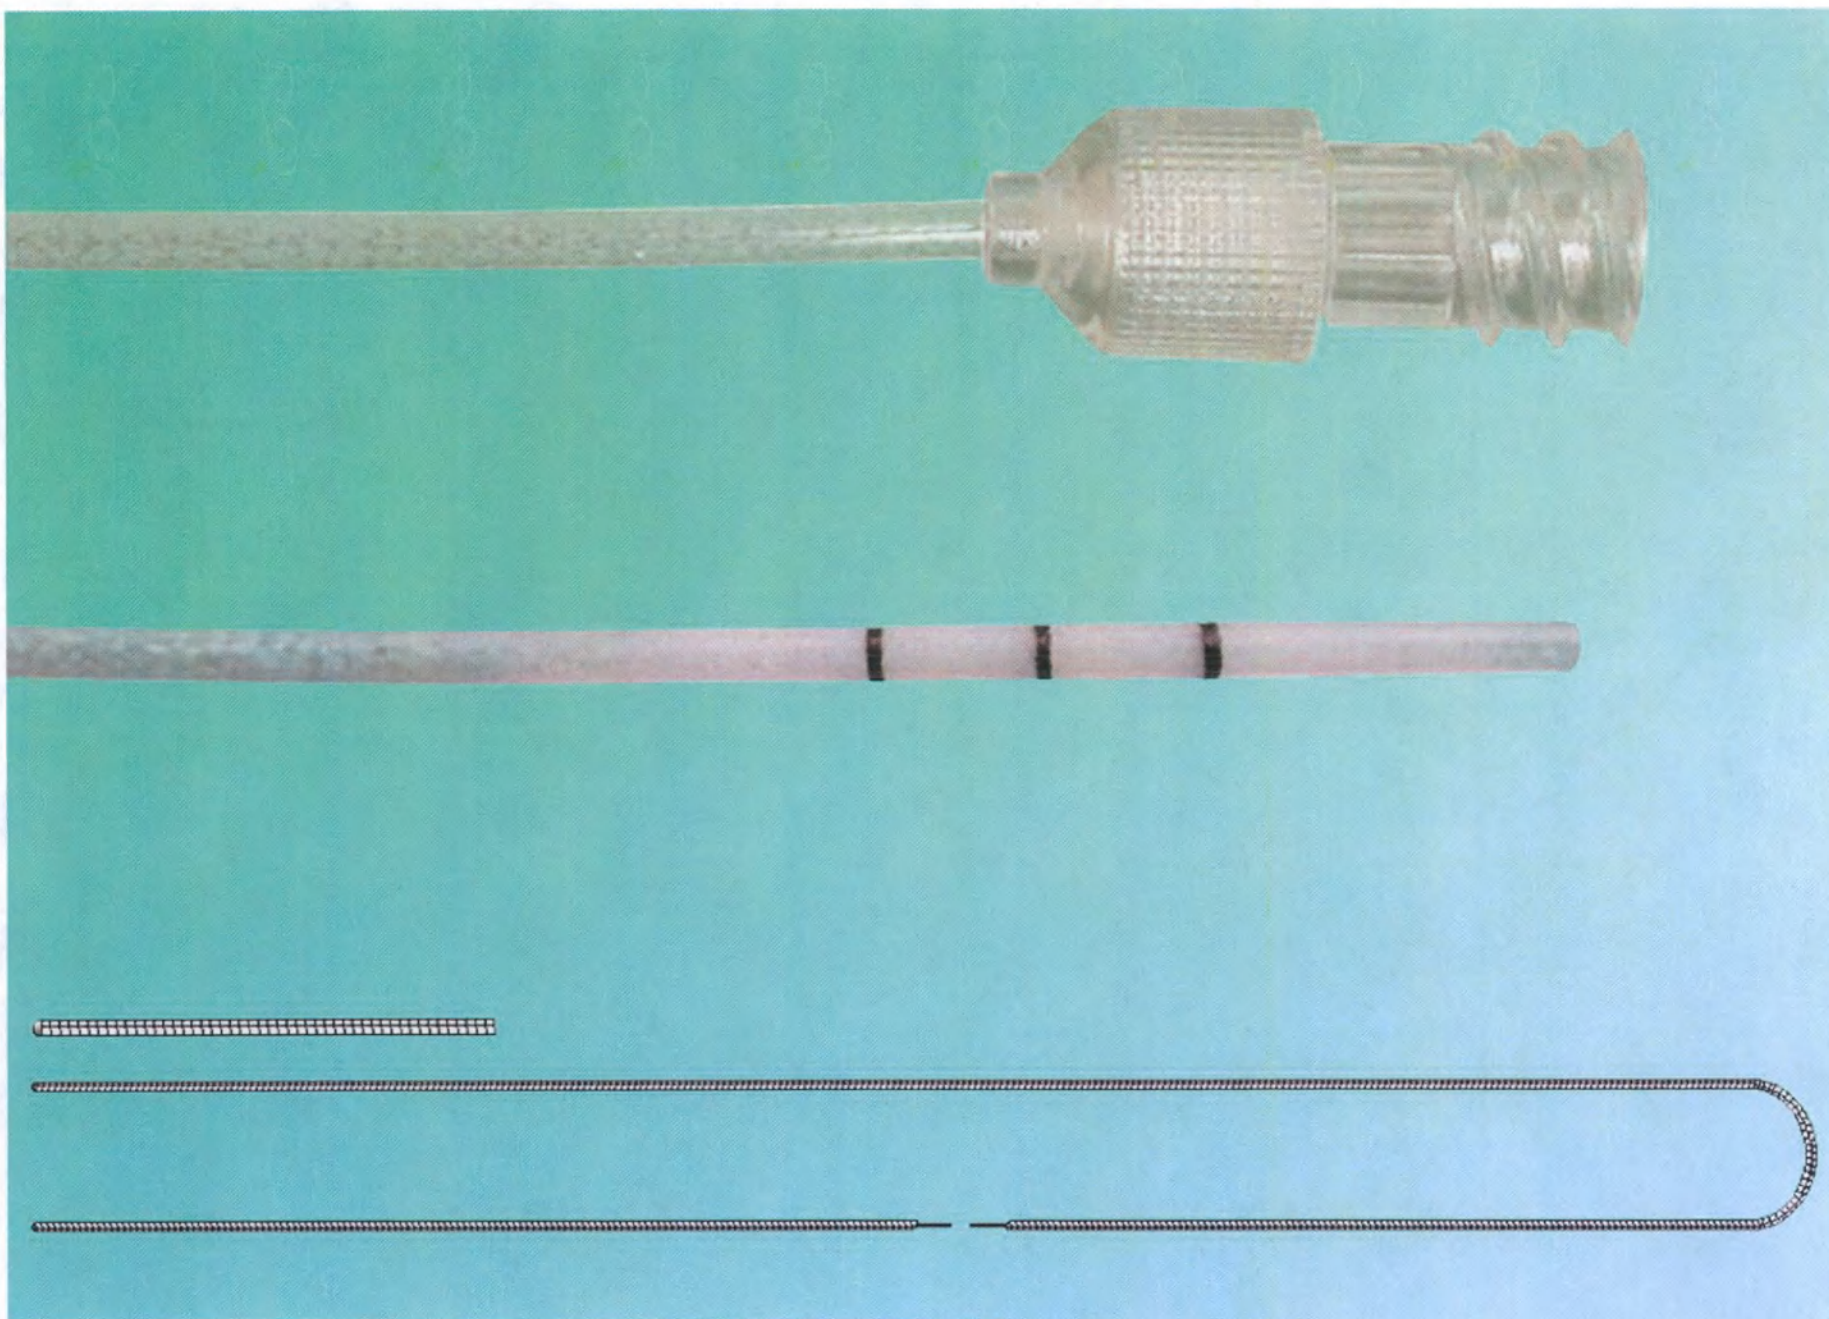

Набор для эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»
**НАБОР ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РЕТРОГРАДНОЙ
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ**

REF 145185

Катетер диаметр 5СН, длина 180см
Проводник диаметр 0,038", длина 290см

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_1ld@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»




**НАБОР ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РЕТРОГРАДНОЙ
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ**

REF 145185

Катетер диаметр 5CH, длина 180см
Проводник диаметр 0,038", длина 290см

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. Маркировка потребительской упаковки.

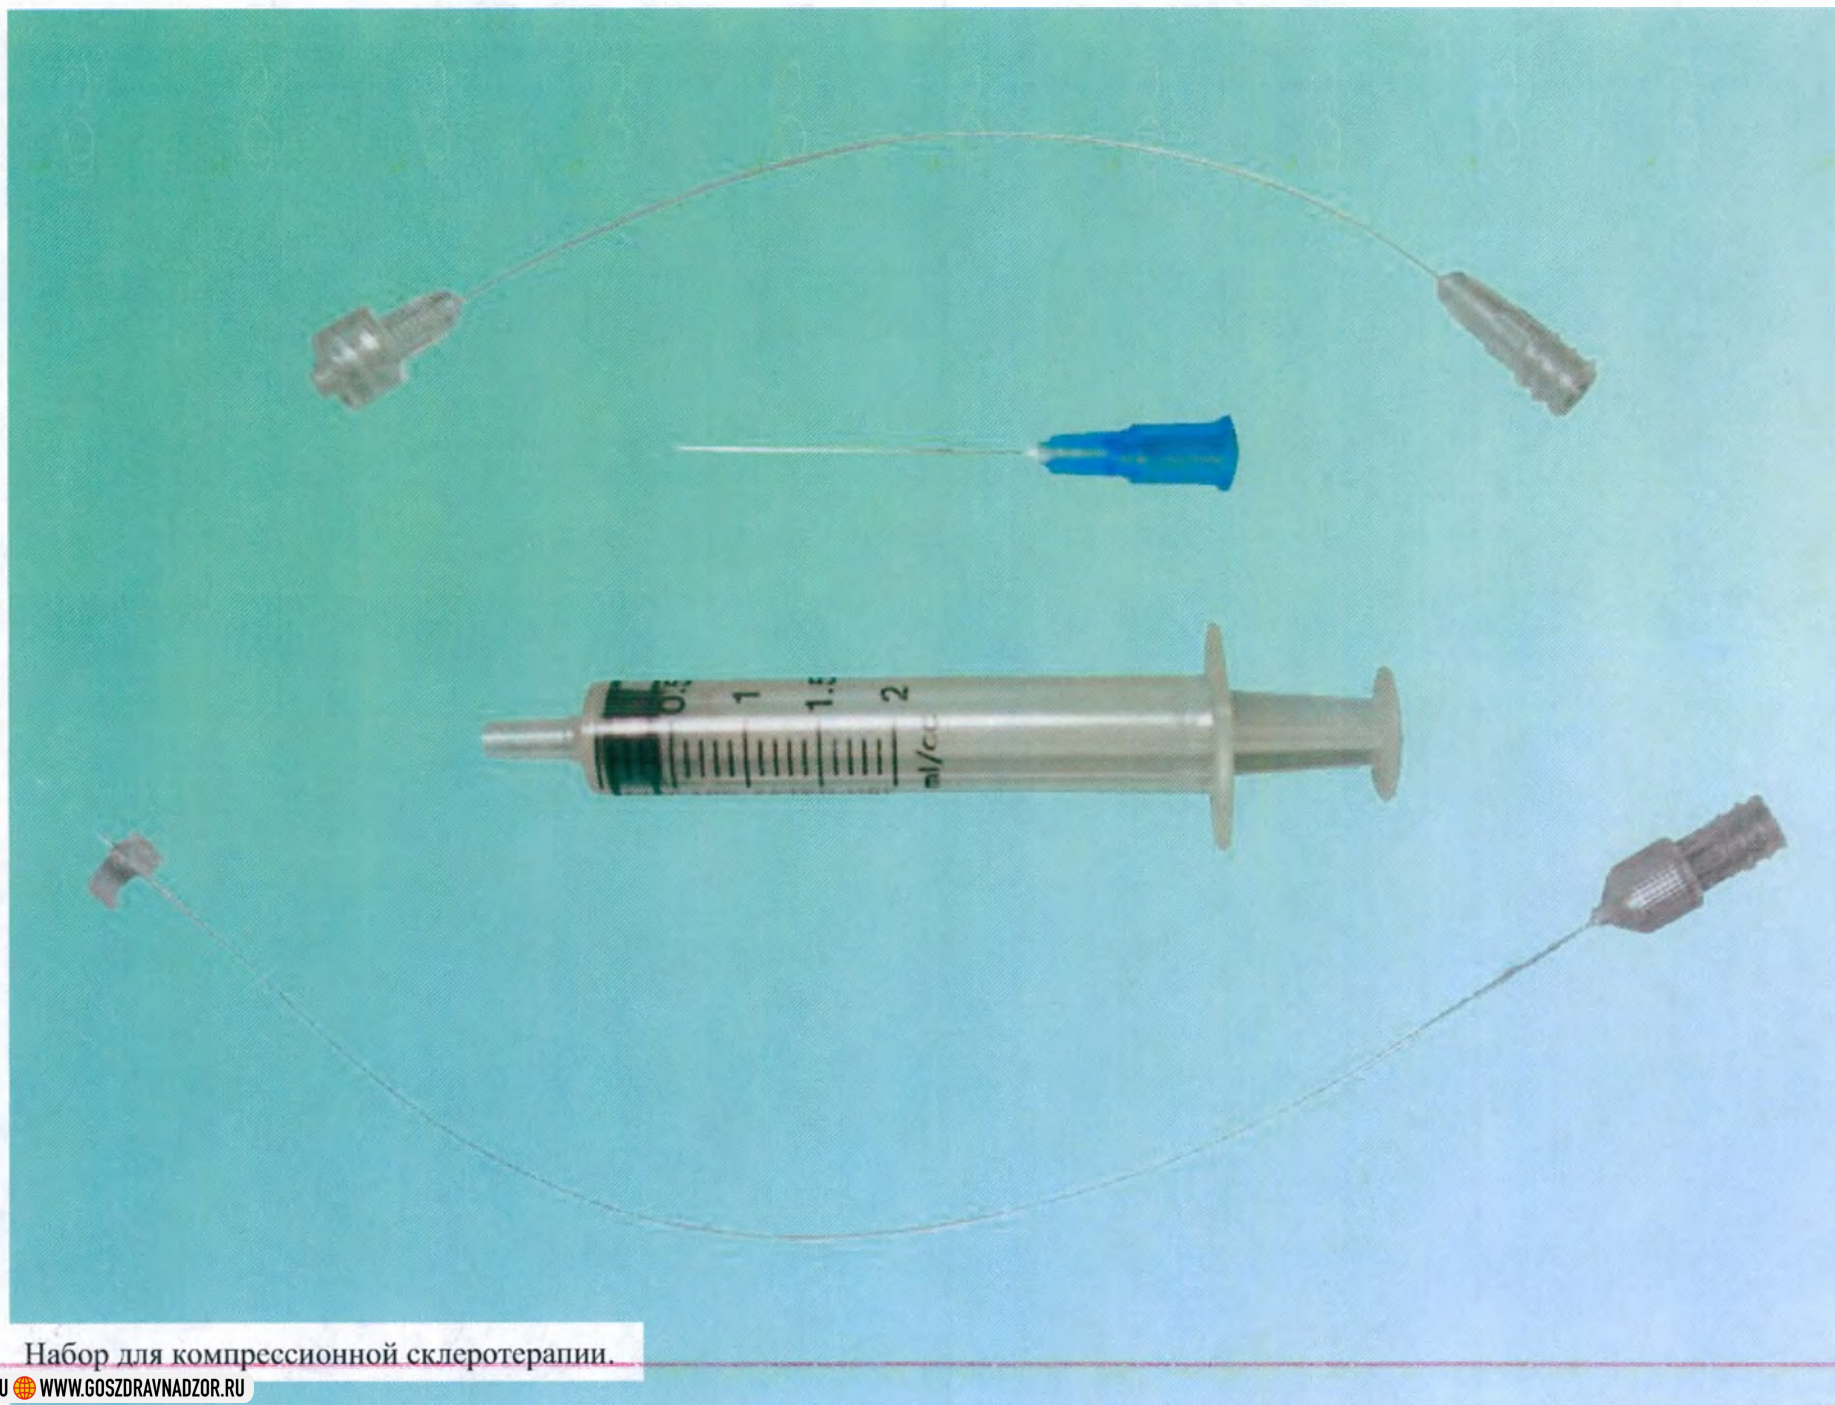

Набор для компрессионной склеротерапии.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР ДЛЯ КОМПРЕССИОННОЙ СКЛЕРОТЕРАПИИ

REF 408331

Игла («бабочка») для микросклеротерапии диаметр 0,3мм
Шприц 2мл

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ld@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для компрессионной склеротерапии, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

НАБОР ДЛЯ КОМПРЕССИОННОЙ СКЛЕРОТЕРАПИИ

REF 408331

Игла («бабочка») для микросклеротерапии диаметр 0,3мм
Шприц 2мл


Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для компрессионной склеротерапии. Маркировка потребительской упаковки.

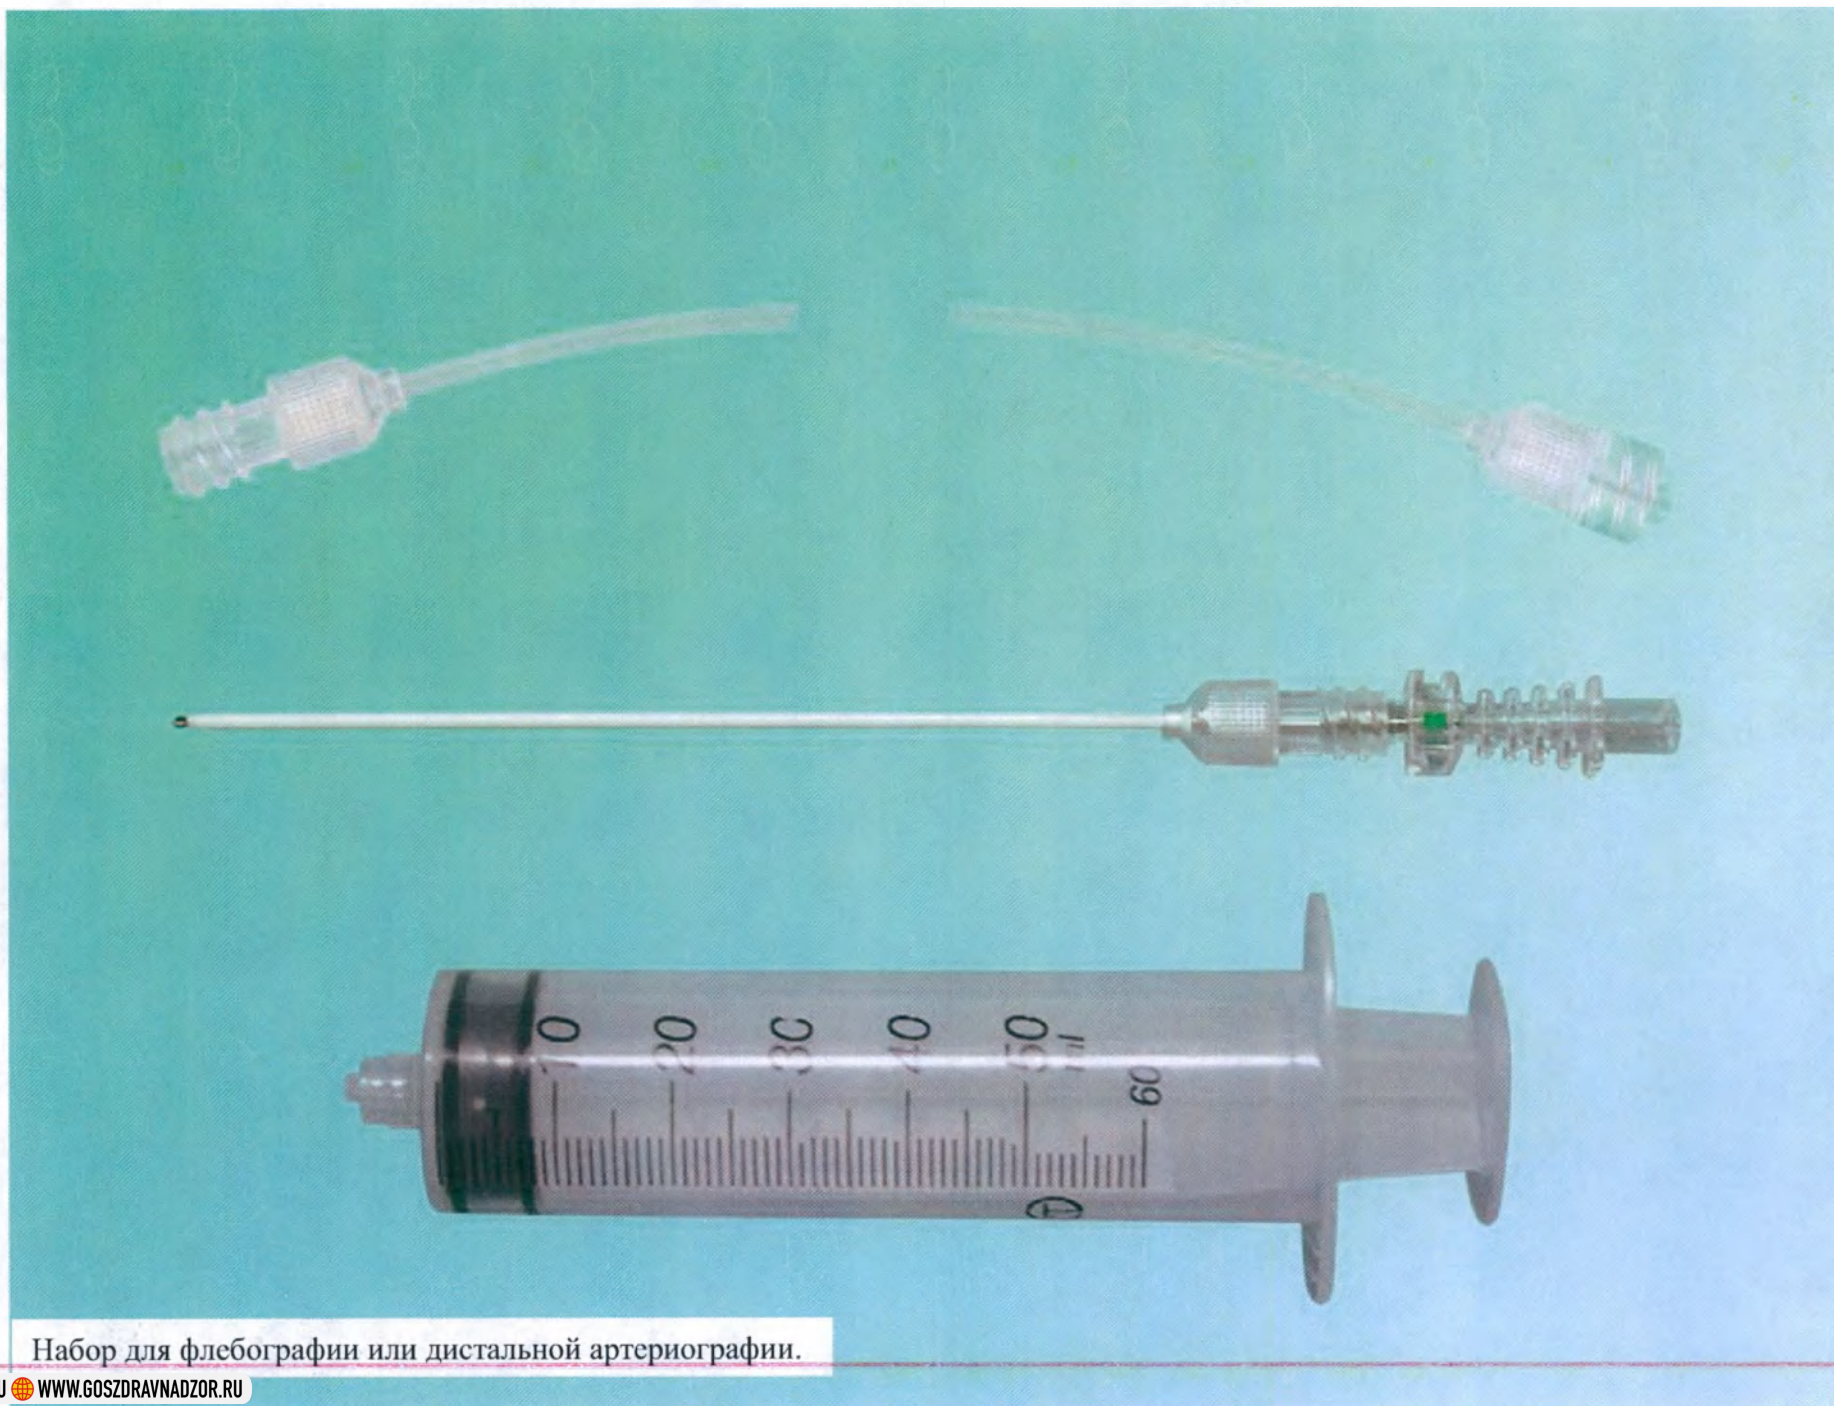

Набор для флебографии или дистальной артериографии.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


**НАБОР ДЛЯ ФЛЕБОГРАФИИ ИЛИ
ДИСТАЛЬНОЙ АРТЕРИОГРАФИИ**

REF 408918

Игла-катетер диаметр 6CH
Шприц 50мл
Удлинитель

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл. 61, стр. 5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для флебографии или дистальной артериографии, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»



**НАБОР ДЛЯ ФЛЕБОГРАФИИ ИЛИ
ДИСТАЛЬНОЙ АРТЕРИОГРАФИИ**

REF 408918

Игла-катетер диаметр 6CH
Шприц 50мл
Удлинитель

Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_1ld@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для флебографии или дистальной артериографии. Маркировка потребительской упаковки.

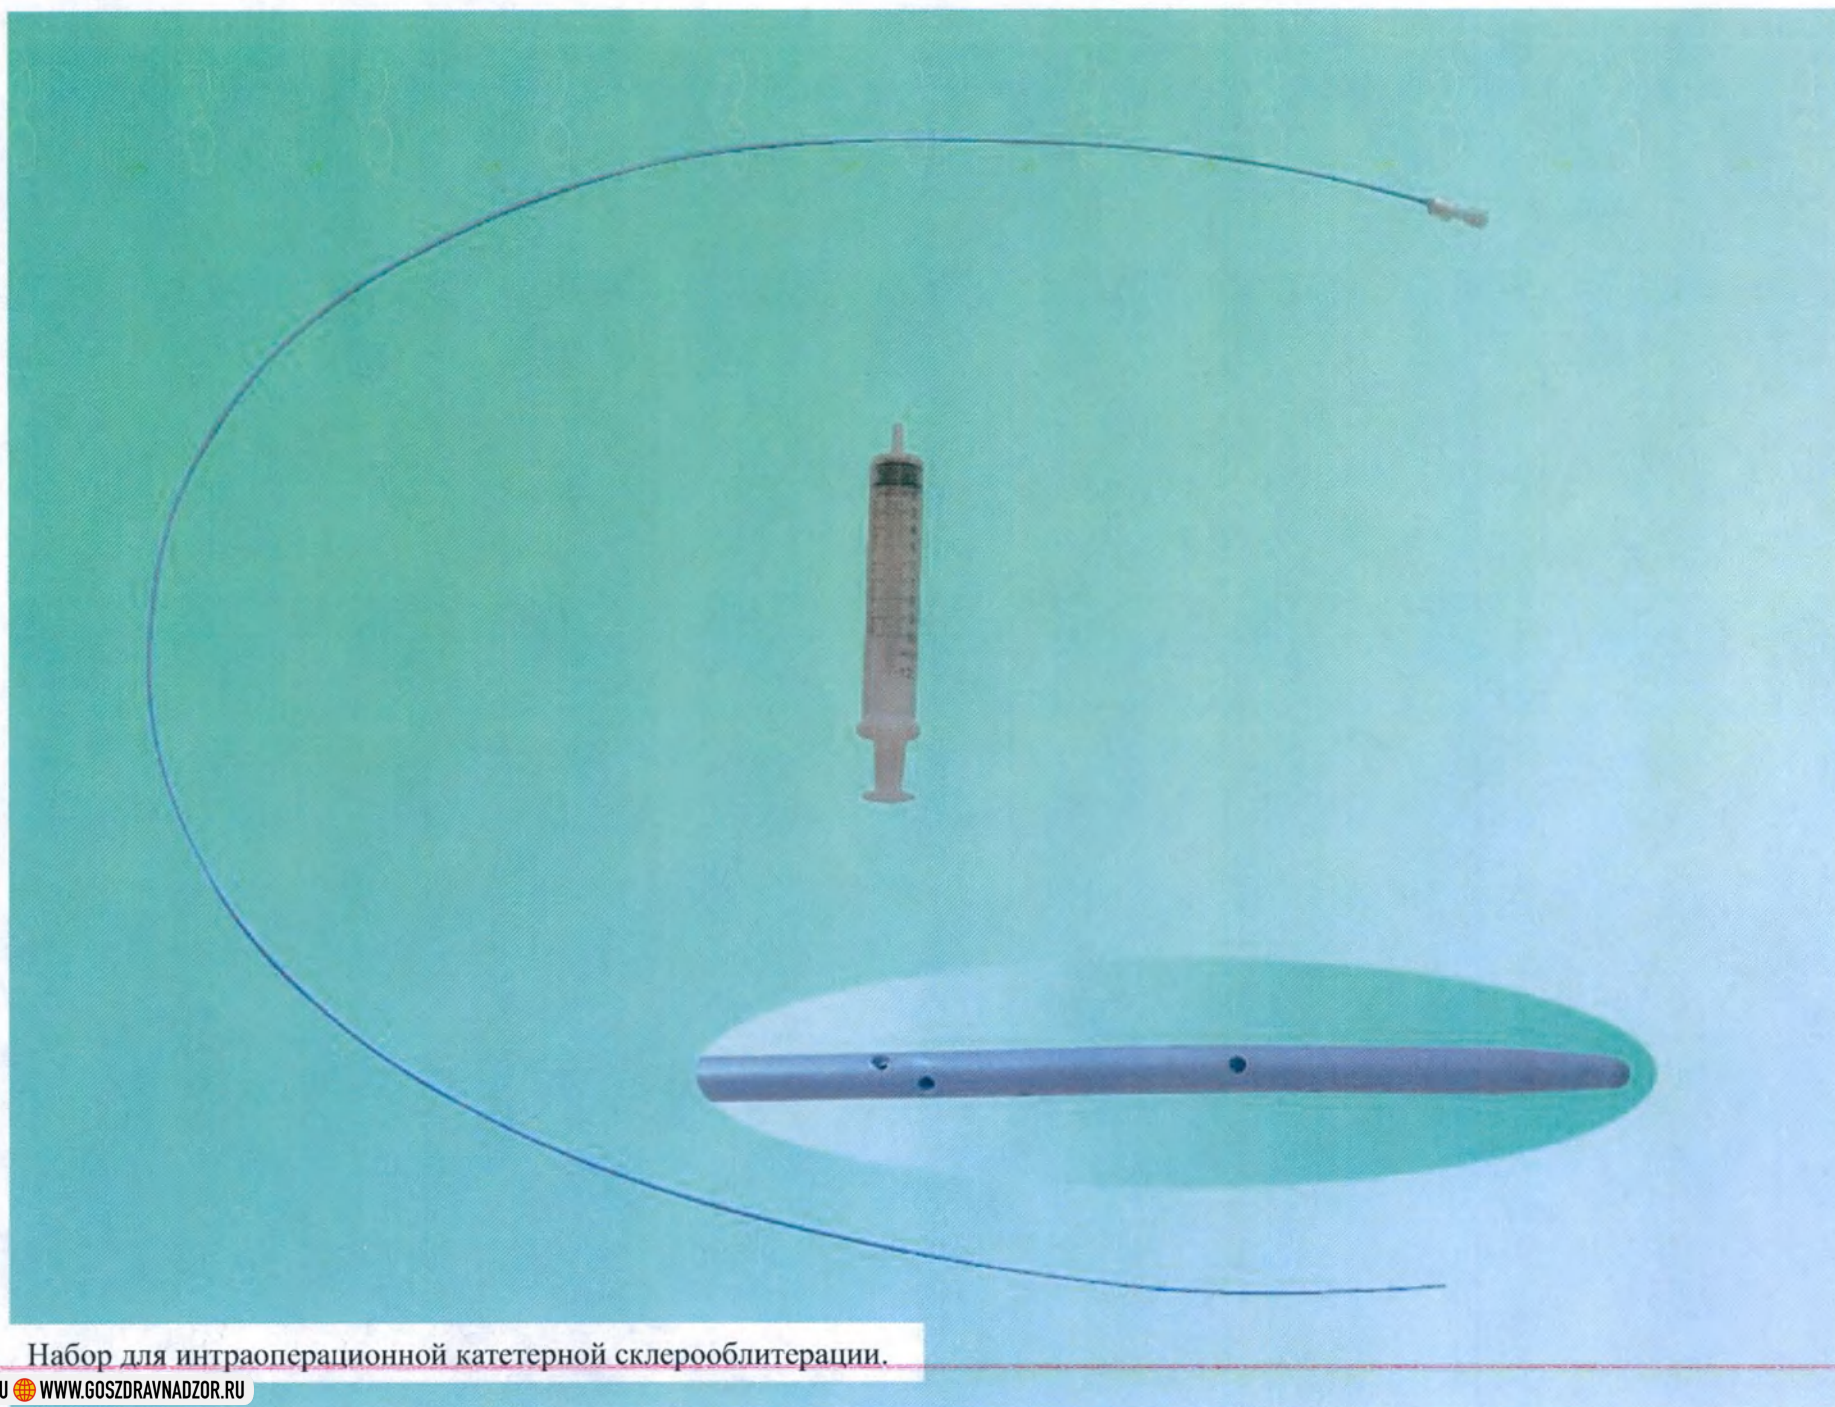

Набор для интраоперационной катетерной склерооблитерации.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

**НАБОР ДЛЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КАТЕТЕРНОЙ
СКЛЕРООБЛИТЕРАЦИИ**

REF 418006

Катетер диаметр 6СН, длина 100см

Шприц 10мл

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

РВ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, вл.51, стр.5

Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, mail: mit_id@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для интраоперационной катетерной склерооблитерации, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

**НАБОР ДЛЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КАТЕТЕРНОЙ
СКЛЕРООБЛИТЕРАЦИИ**

REF 418006

Катетер диаметр 6СН, длина 100см


Шприц 10мл

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

РВ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018




STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, вл.61, стр.5.
Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, mail: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для интраоперационной катетерной склерооблитерации. Маркировка потребительской упаковки.

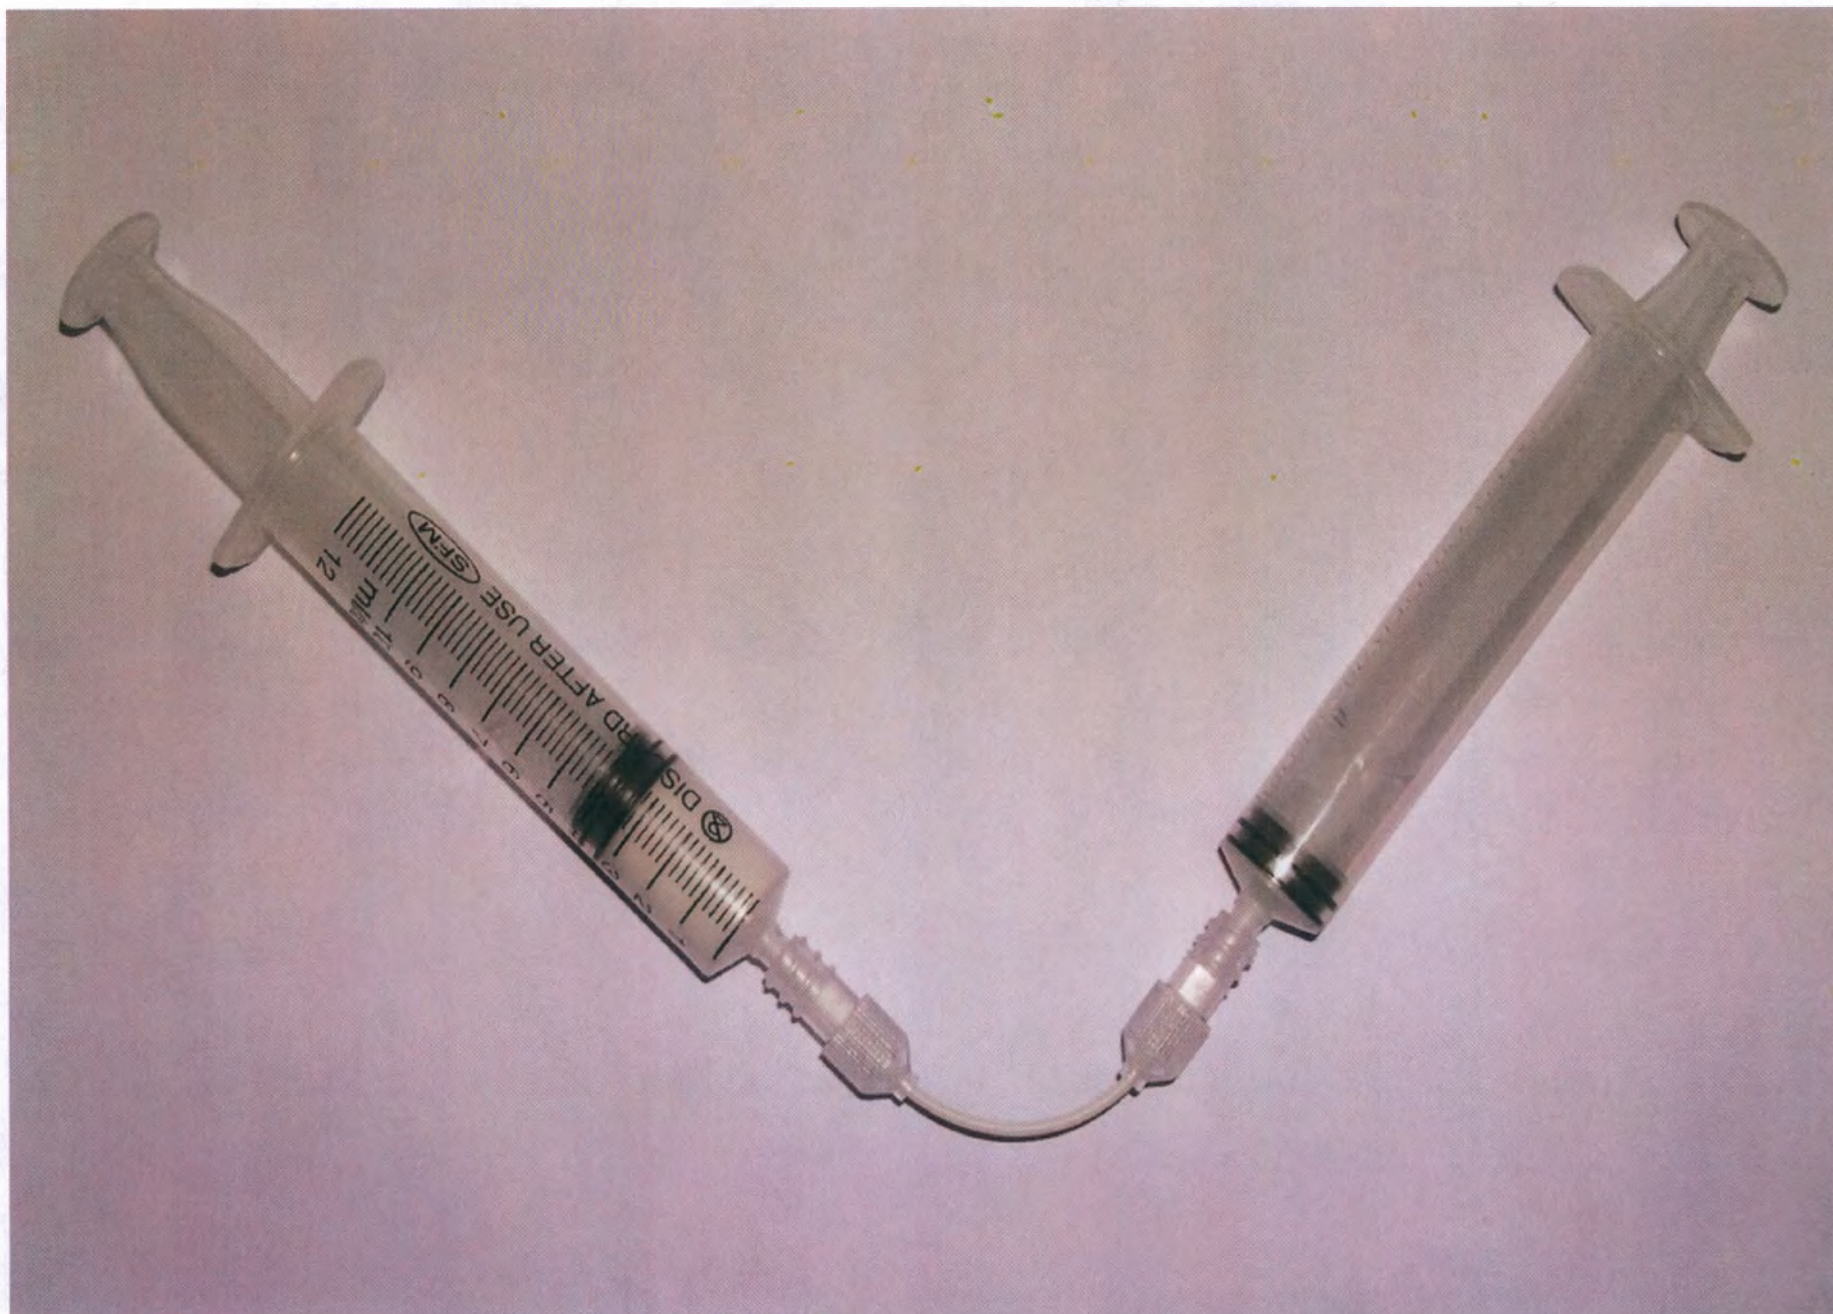

Адаптер для приготовления пенной формы склерозантов.


Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

АДАПТЕР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПЕННОЙ ФОРМЫ СКЛЕРОЗАНТОВ

REF 408005-5

Адаптер для приготовления пенной формы склерозантов – 1 шт.
Шприц 5 мл – 2 шт.
Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл. 61, стр. 5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ild@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Адаптер для приготовления пенной формы склерозантов, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»

АДАПТЕР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПЕННОЙ ФОРМЫ СКЛЕРОЗАНТОВ

REF 408005-5

Адаптер для приготовления пенной формы склерозантов – 1 шт.
Шприц 5 мл – 2 шт.


Стерильно, апирогенно, нетоксично

Не применять при нарушении целостности упаковки

ТУ 9437-007-42237874-2011

РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Адаптер для приготовления пенной формы склерозантов. Маркировка потребительской упаковки.

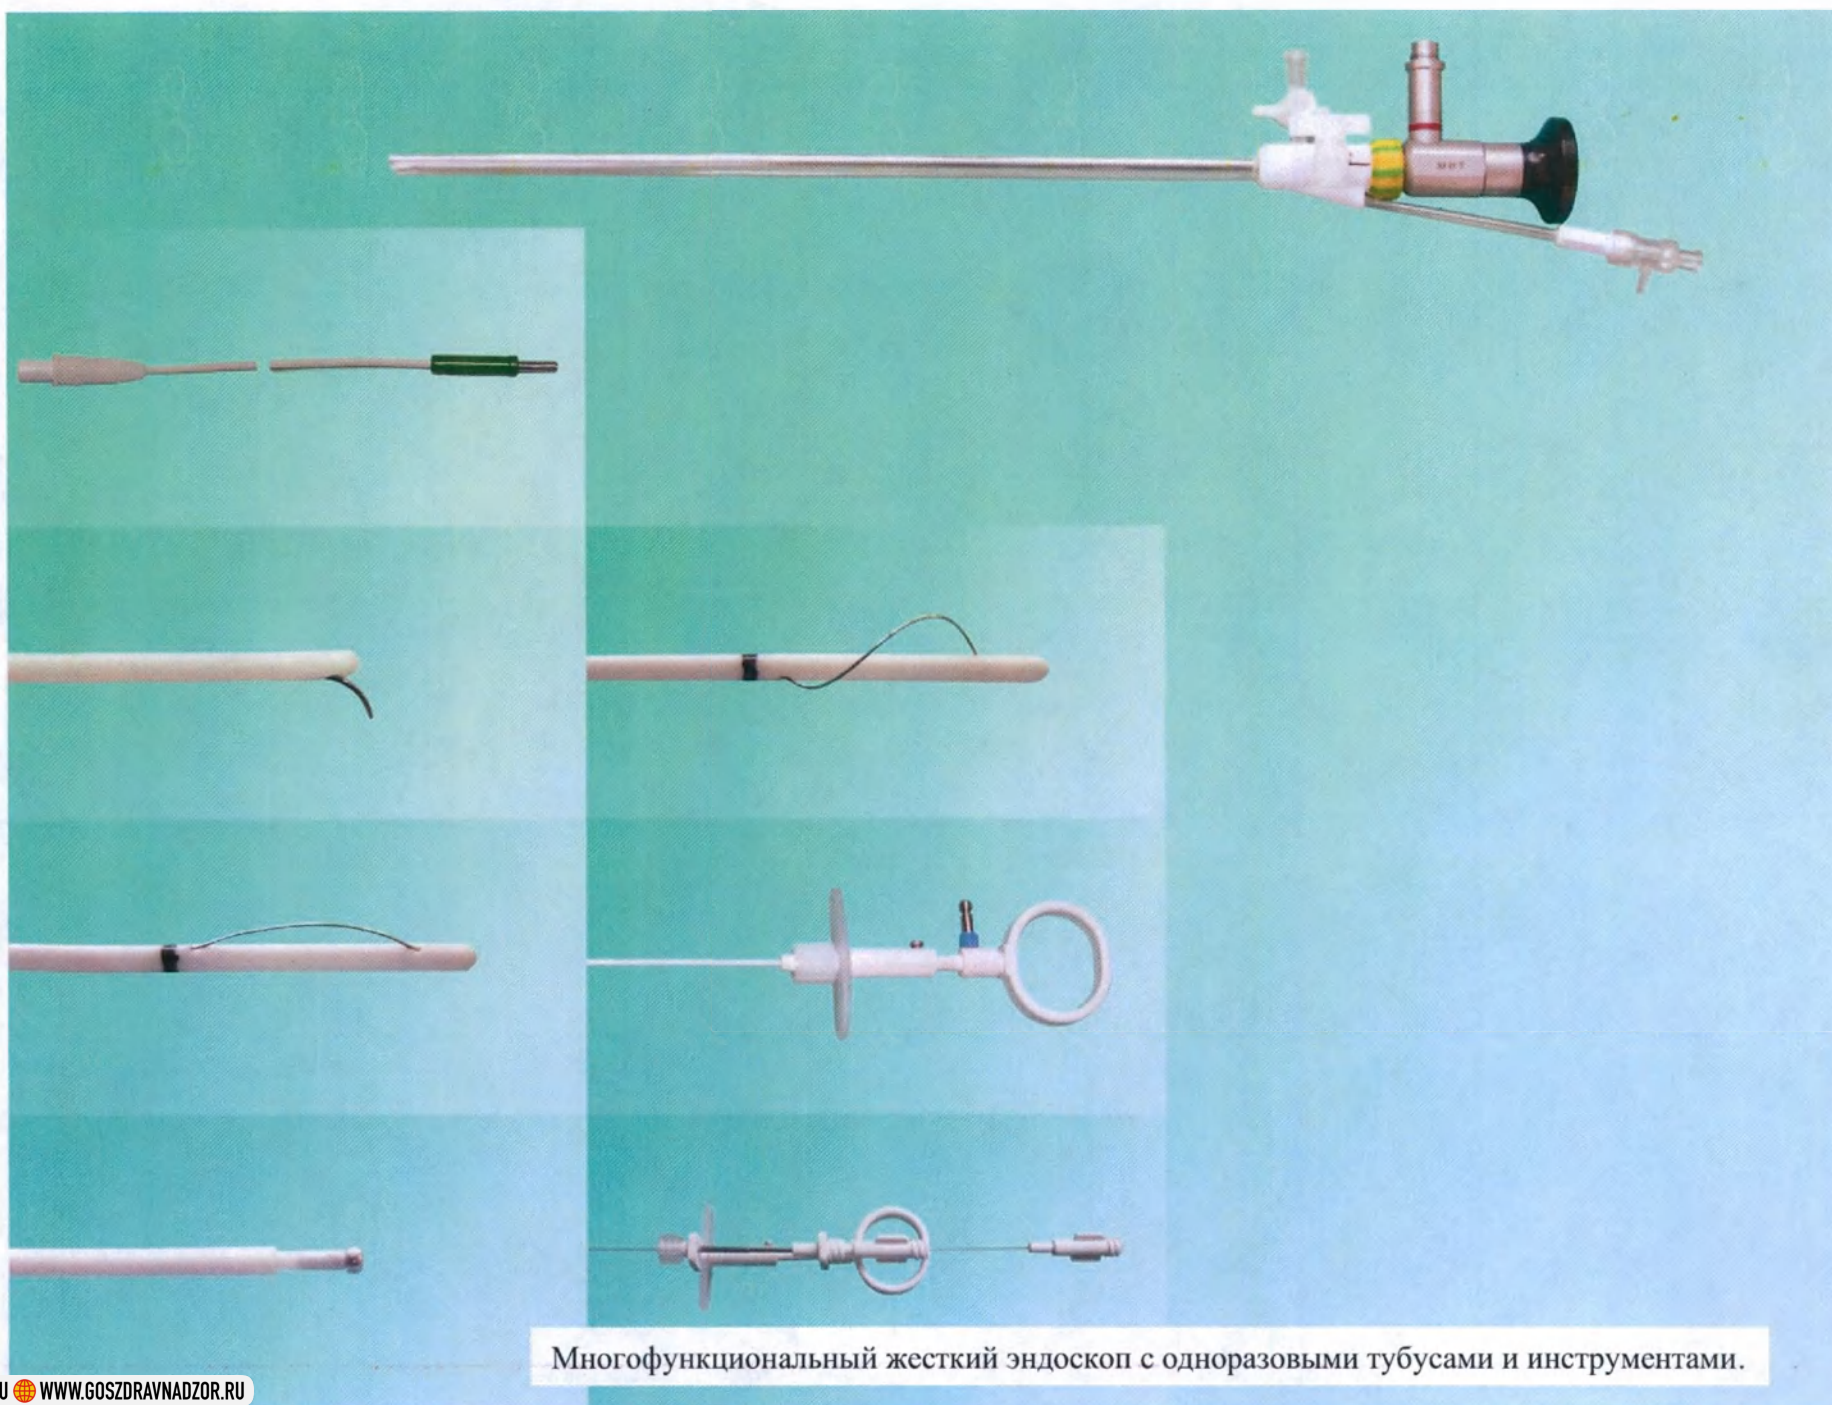

Многофункциональный жесткий эндоскоп с одноразовыми тубусами и инструментами.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к классу лечебно-диагностическому «Эндо-MIT-M»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ЭНДОСКОП
С ОДНОРАЗОВЫМИ ТУБУСАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ

ИФР 0043000

Трубка оптическая диаметр 4мм с углом направления 0°
ТУ 9442-013-4098421-2005 ООО «ИТЖ «Синтез», Россия
Тубус одноразовый длиной 183 мм, диаметром 11СН
Электрод калочный режущий регулируемый диаметром 5СН,
длинной 230 мм
Петля спиральная электрохирургическая регулируемая
Электрокоагулятор диаметром 5СН, длиной 250мм
Электротом электрохирургический регулируемый диаметром 5СН,
длинной 342мм
Манипулятор
Кабель

Стерильно, асептично, натянено
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237674-2011
РР 3И РЗН 20131208 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»
143587, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.51, стр.5. Тел.: 8490552-1629, 522-7034, email: mit_3d@mail.ru, www.mit-3d.ru

Многофункциональный жесткий эндоскоп с одноразовыми тубусами и инструментами, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ЭНДОСКОП
С ОДНОРАЗОВЫМИ ТУБУСАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ**

REF 0043000

Трубка оптическая диаметр 4мм с углом направления 0°
ТУ 9442-013-49985421-2006 ООО «НПК «Азимут», Россия
Тубус одноразовый длиной 153 мм, диаметром 11СН
Электрод язычковый режущий регулируемый диаметром 5СН,
длиной 290 мм
Петля спиральная электрохирургическая регулируемая
Электрокоагулятор диаметром 5СН, длиной 288мм
Электротом электрохирургический регулируемый диаметром 5СН,
длиной 342мм
Манипулятор
Кабель


Стерильно, апирогенно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
РУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»
143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Многофункциональный жесткий эндоскоп с одноразовыми тубусами и инструментами. Маркировка потребительской упаковки.

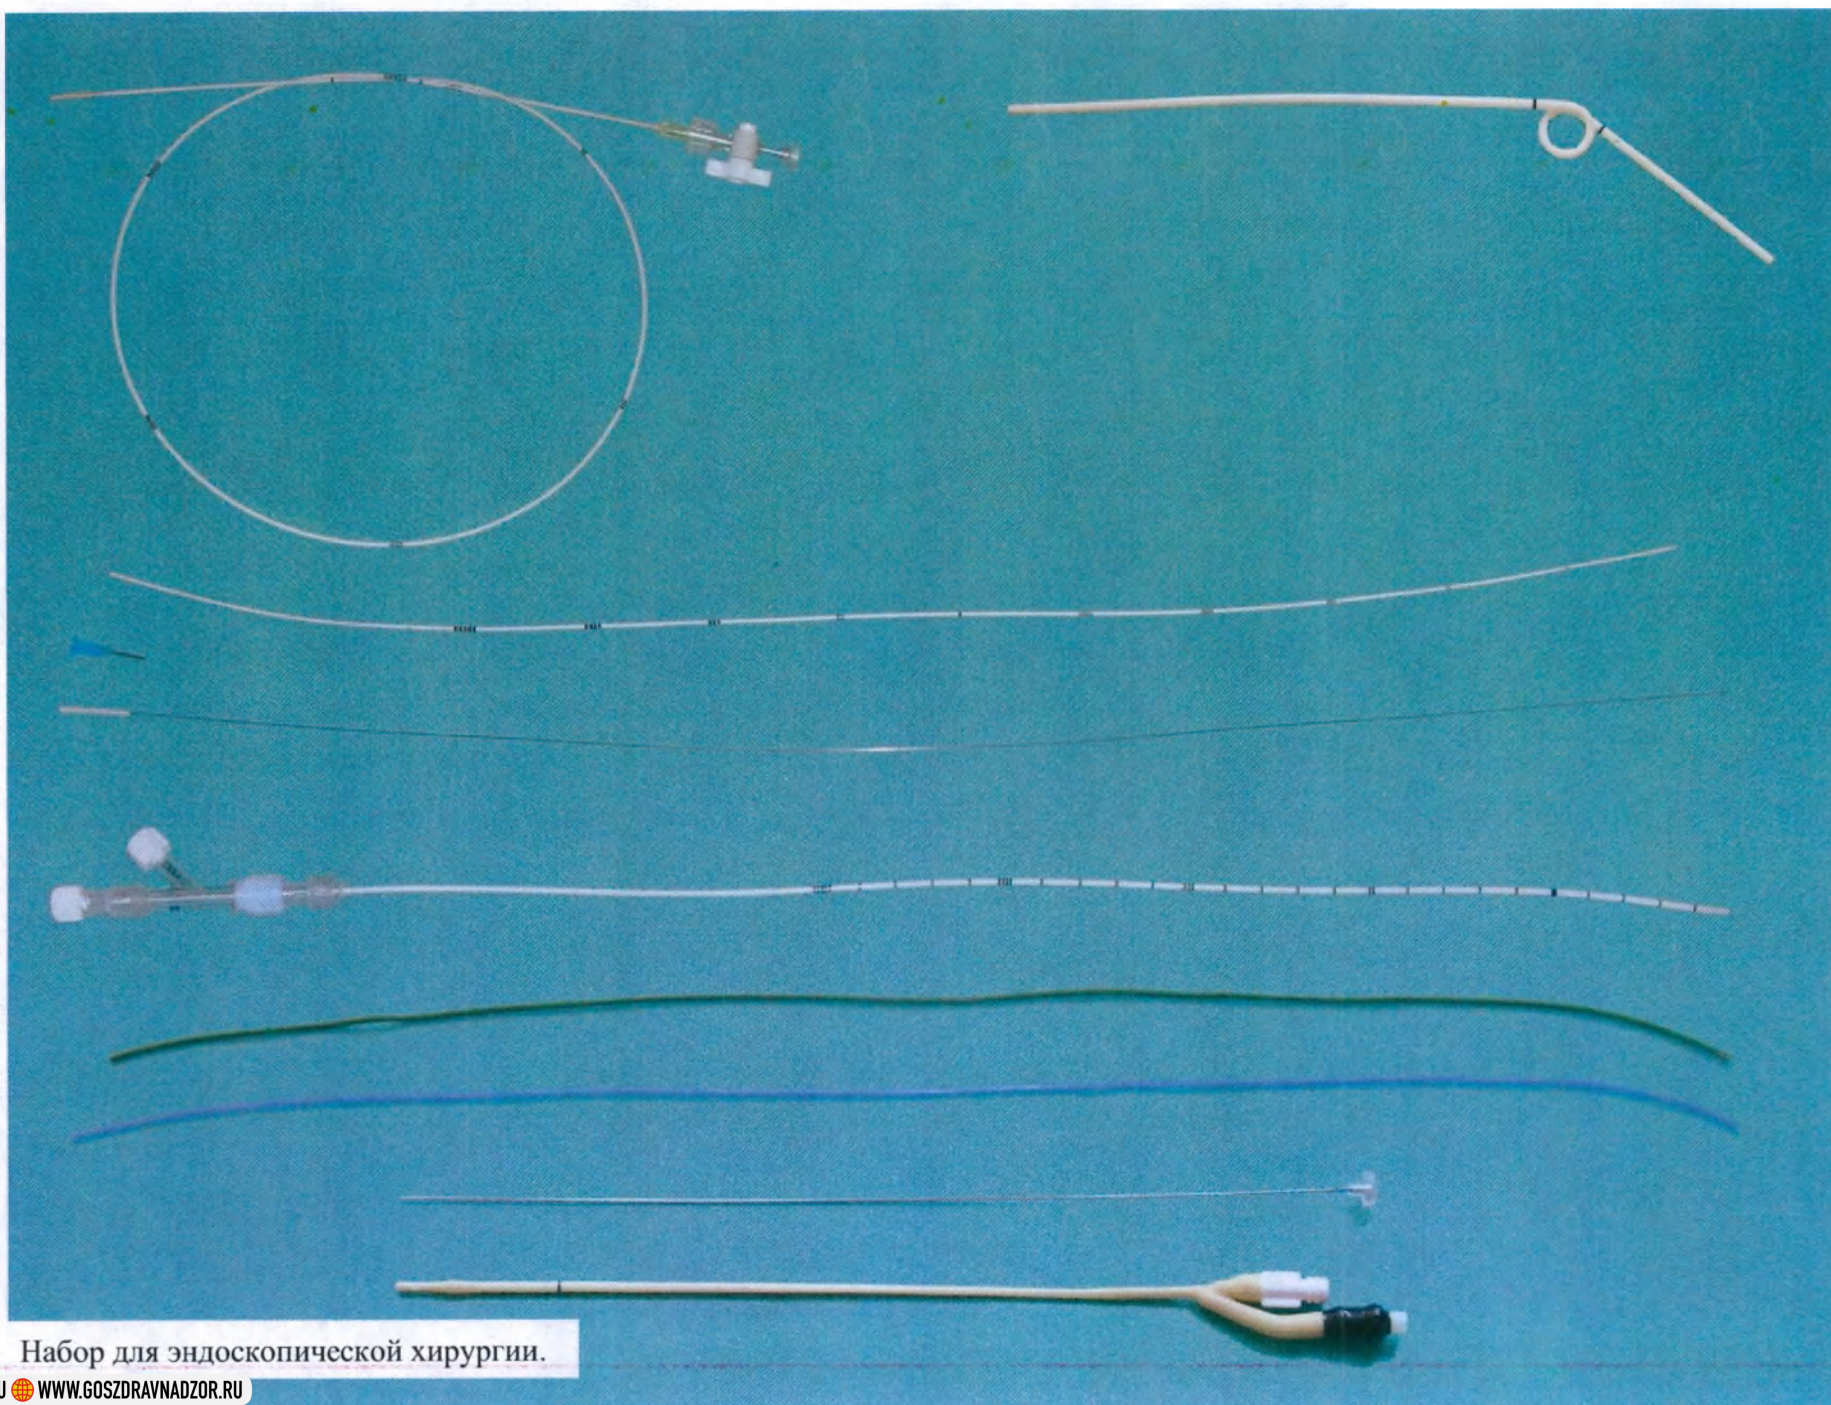

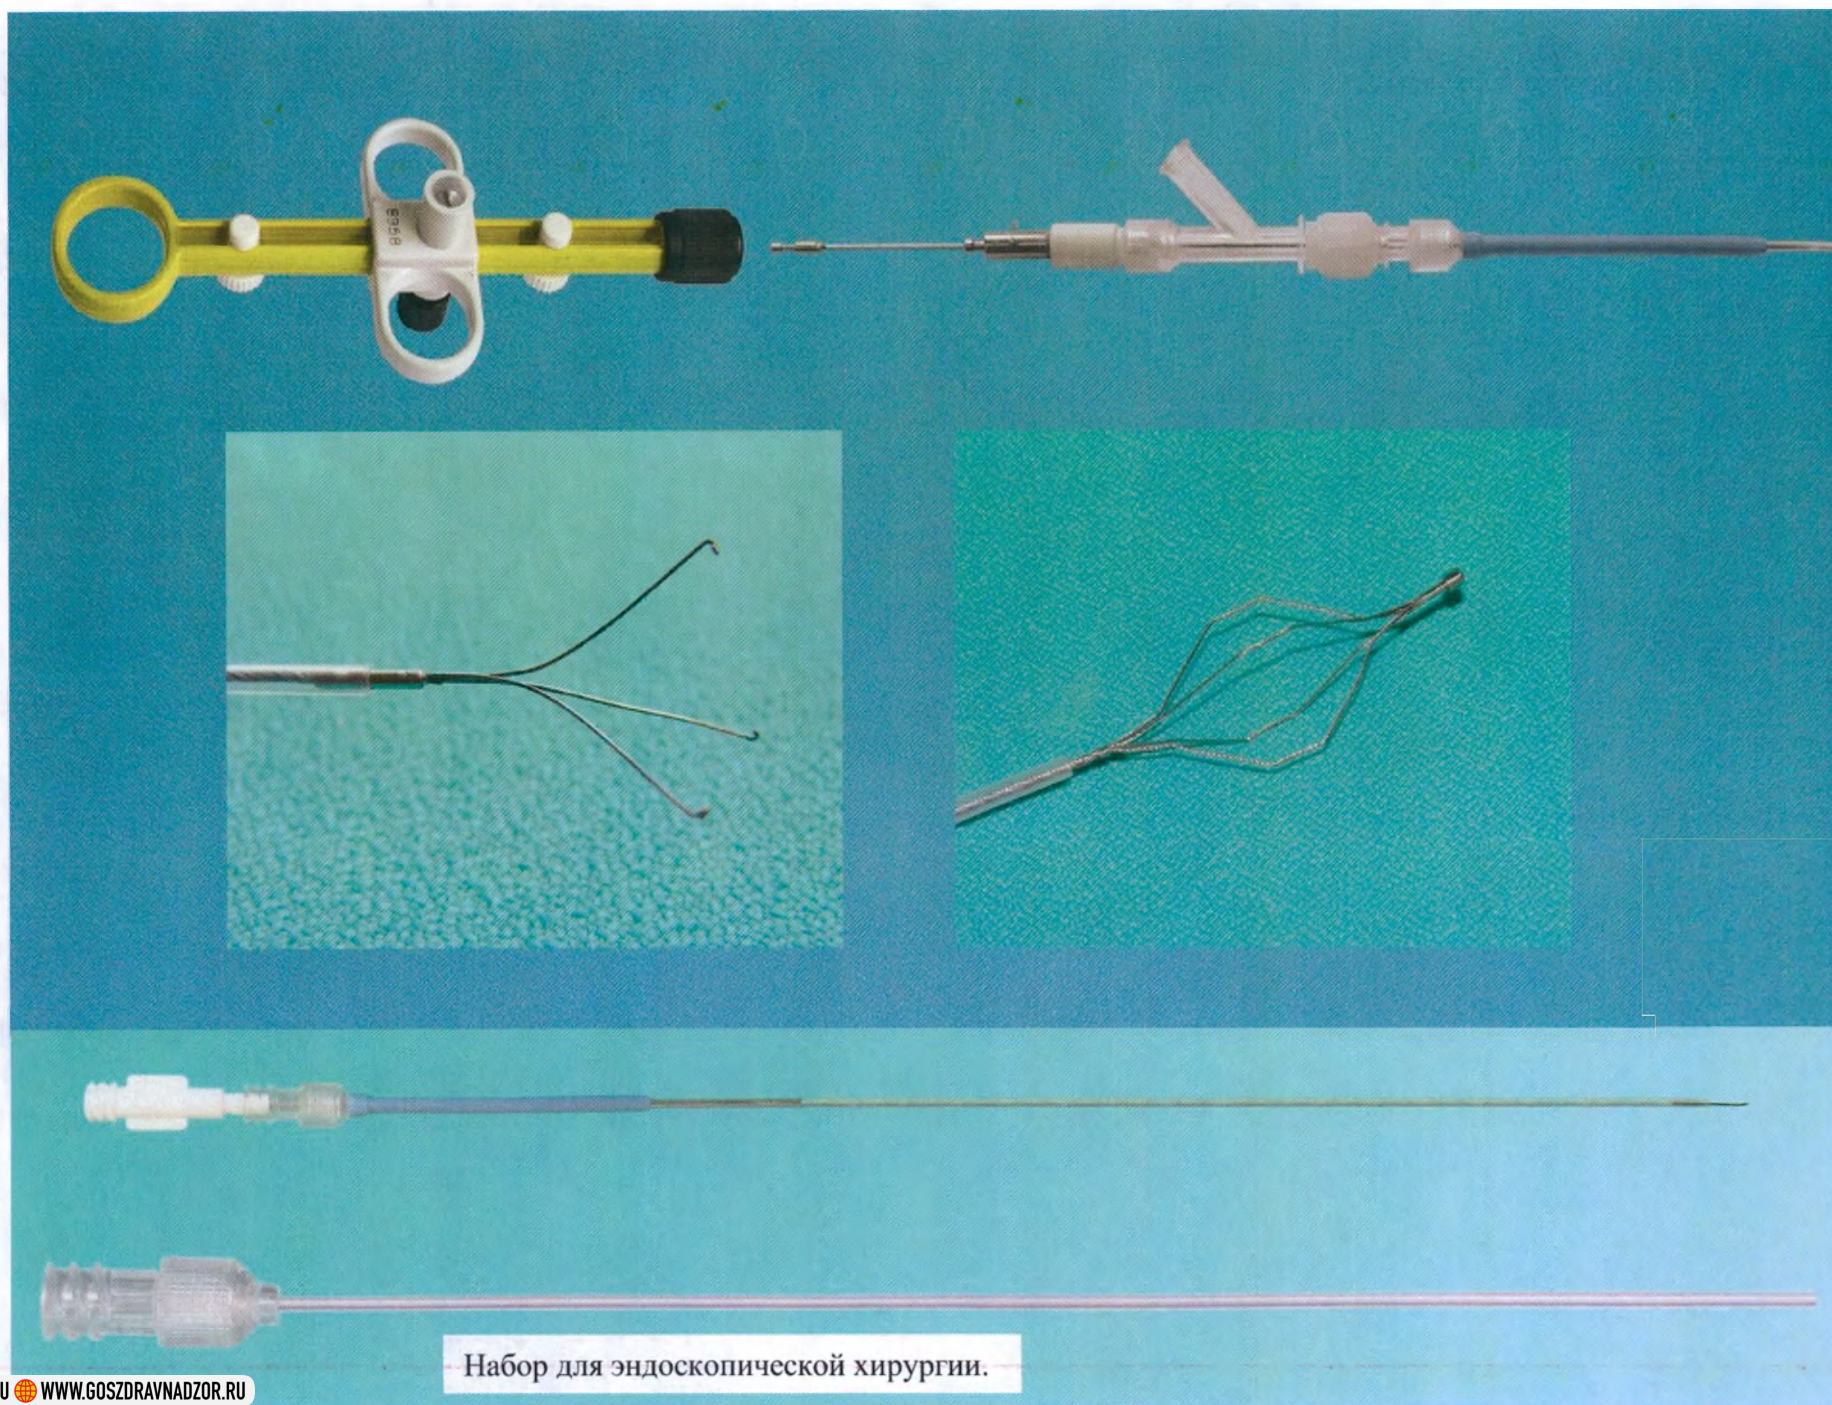

Набор для эндоскопической хирургии.

250x200mm

LOTD1404 250x200mm

CE LOTD1404 250x200mm

CE LOTD

Наборы медицинского назначения для минимально инвазивных вмешательств
в комплексную лечебно-диагностическую систему «Эндо-MIT-M»

НАБОР ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

REF 613530

Стект нефростома (пикелостома) диаметром 8СН
Катетер баллонный диаметром 8СН длина 70см
Катетер уретероцистический уретеральный диаметром 7СН
Катетер мочеочечниковый диаметром 8СН
Турникеты
Экстрактор торсионный атравматический эндоскопический диаметром 8СН для
1600 мм (рабочая часть)
Экстрактор эндоскопический диаметром 8СН длина 1600мм (рабочая часть)
Катетер промывочный диаметром 8СН длина 1600мм
Игла иглокационная эндоскопическая диаметром 8СН
Катетер для электистероскопии
Ручка

Стерильно, асептично, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 0427-007-42237874-2011
РР № РЭН 2013/1308 от 28.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивная технология»

143987, Россия, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Яковлево-Солонихинский, ул. Советская,
вл.6/1, стр.3. Тел.: 8 (495) 622-7623, 8 (495) 622-7034, email: info_mit@mail.ru, www.mit-nis.ru

Набор для эндоскопической хирургии, в потребительской упаковке.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


НАБОР ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

REF 613530

Стент нефростома (пиелостома) диаметр 6CH
Катетер баллонный диаметр 2CH длина 70см
Катетер уродинамический уретральный диаметром 7CH
Катетер мочеточниковый диаметром 5CH
Турникеты
Экстратор торцевой атравматический эндоскопический диаметром 6CH дл
1600 мм (рабочая часть)
Экстратор эндоскопический диаметром 6CH длина 1600мм (рабочая часть)
Катетер промывочный диаметр 5CH длина 1600мм
Игла инъекционная эндоскопическая диаметр 6CH
Катетер для эхогистеросальпингоскопии
Ручка

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018


STERILE R




ООО «Минимально инвазивные технологии»

143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru




Набор для эндоскопической хирургии. Маркировка потребительской упаковки.

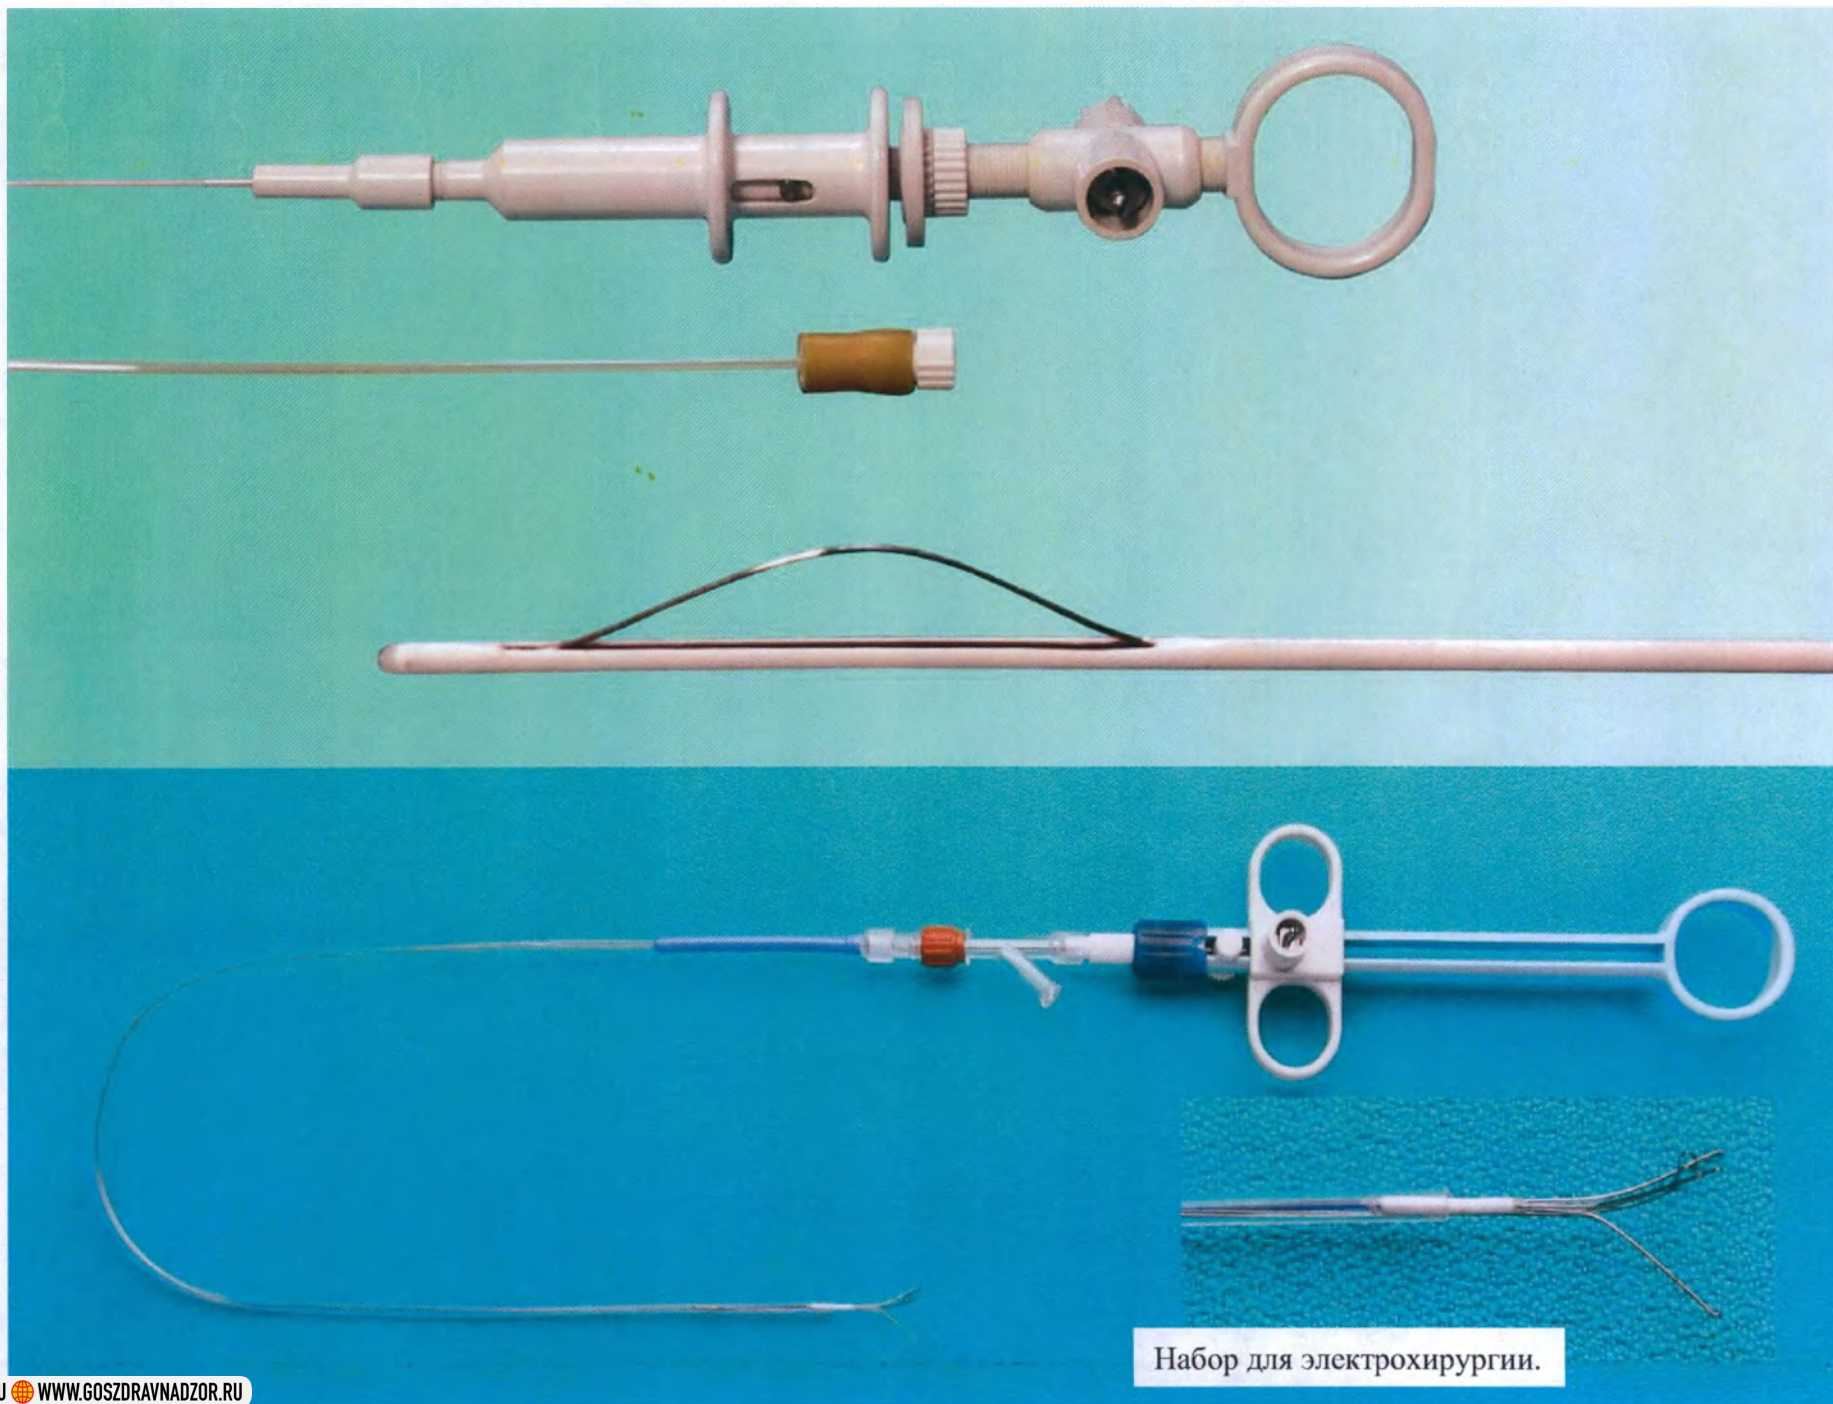

Набор для электрохирургии.

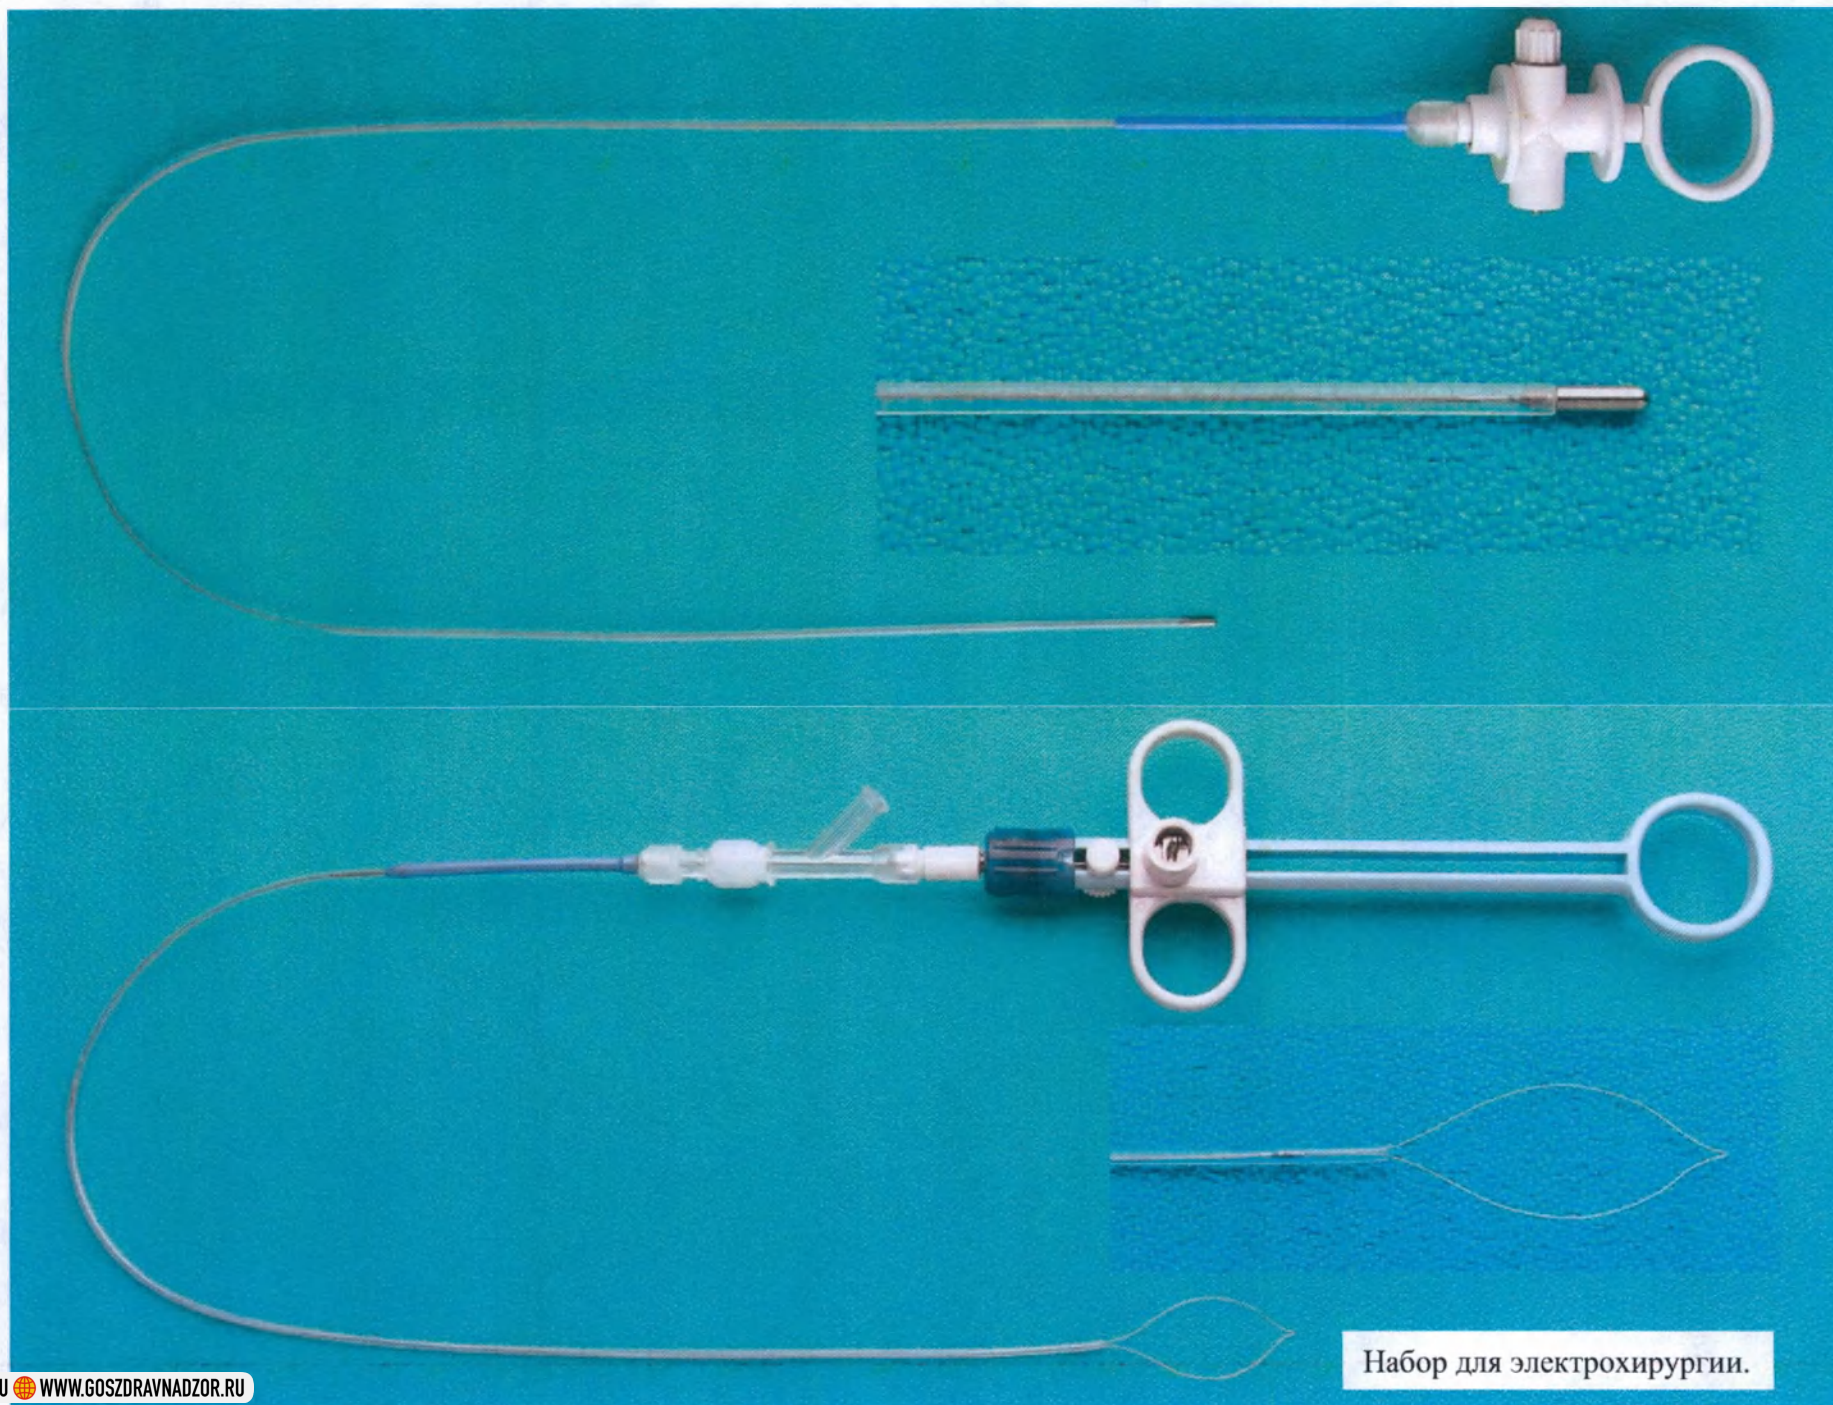

Набор для электрохирургии.

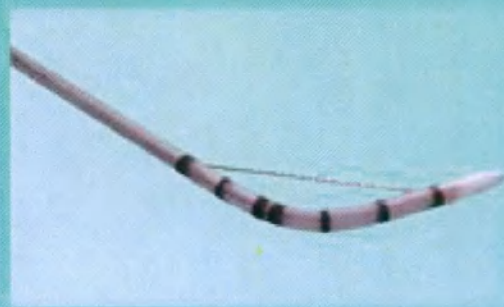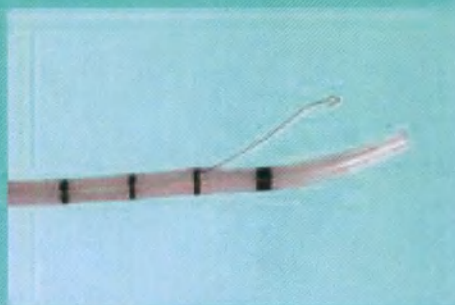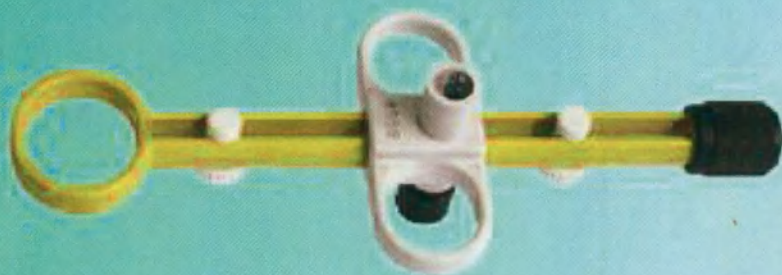

Набор для электрохирургии.

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
в комплексе лечебно-диагностическому «Эндо-MHT-3»


НАБОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

REF 016003

Электроутеротом регулируемый с тубусом
Петли для полиэтомии радиоволновой длина 1600мм
Панциклом конический радиоволновой (рабочая часть)
Зажим биопсийный радиоволновой (рабочая часть)
Электрод коагуляционный монополярный радиоволновой длина 1600мм
Петли для полиэтомии эндоскопическая диаметр тросика 0,3мм, диаметр
катетера 6СН, длина 1600мм
Электрод коагуляционный монополярный (с цилиндрической и сферической
поверхностью) диаметр 7СН длина 1600мм
Панциклом торцевой эндоскопический диаметр 6СН длина 1600мм
(рабочая часть)
Панциклом эндоскопический диаметр 5СН длина 1600мм (рабочая часть)
Ручка

Стерилично, асептично, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-4223/874-2011
РУ № РЭН 2013/326 от 26.03.2010

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»

143567, Россия, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Электрондорский, ул. Советская,
д.61, стр.6. Тел. 8(495)522-1623, 522-7034, email: info@mit.ru, info@mit.ru

Наборы медицинские для минимально инвазивных вмешательств
к комплексу лечебно-диагностическому «Эндо-МИТ-М»


НАБОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

REF 016003

Электроуретеротом регулируемый с тубусом
Петля для полипэктомии радиоволновая длина 1600мм
Папиллотом клювовидный радиоволновой (рабочая часть)
Захват биопсийный радиоволновой (рабочая часть)
Электрод коагуляционный монополярный радиоволновой длина 1600мм
Петля для полипэктомии эндоскопическая диаметр тросика 0,3мм, диаметр катетера 6СН, длина 1600мм
Электрод коагуляционный монополярный (с цилиндрической и сферической головкой) диаметр 7СН длина 1600мм
Папиллотом торцевой эндоскопический диаметр 5СН длина 1600мм (рабочая часть)
Папиллотом эндоскопический диаметр 5СН длина 1600мм (рабочая часть)
Ручка

Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Не применять при нарушении целостности упаковки
ТУ 9437-007-42237874-2011
ПУ № РЗН 2013/1309 от 26.03.2018

STERILE R



ООО «Минимально инвазивные технологии»
143987, Россия, Моск. обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская,
вл.61, стр.5. Тел.: 8(495)522-1625, 522-7034, email: mit_ltd@mail.ru, www.ooo-mit.ru

Набор для электрохирургии. Маркировка потребительской упаковки.

Пронумеровано,
Прошнуровано и
Скреплено печатью

112 (Сито двенадцать) лист 06

