

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова
2023 г.



Образцы маркировки

Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена *Giardia lamblia* в суспензии фекалий «Лямблия Ag-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-475-41390295-2022

1. Образцы этикеток компонентов набора «Лямблия Ag-ИМБИАН-ИФА»

Наименование компонента	Этикетка
Иммуносорбент	
К(+) – инактивированный положительный контрольный образец	
К(-) – инактивированный отрицательный контрольный образец	
ФСБ-Т(х26) – концентрат промывочного раствора	
РК – раствор конъюгата	
РРО(х10) – концентрат раствора для разведения образцов	

ТМБ – раствор тетраметилбензидина	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток шоу-бокса набора «Лямблия Ag-ИМБИАН-ИФА»

2.1. Образец боковой этикетки

**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. Рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещение 2**

**IMBIAN LAB LLC, 2/7 Sadovaya street, 2nd floor, room 2,
Work settlement of Koltsovo, Urban district of the Work
settlement of Koltsovo, Novosibirsk Oblast, Russia, 630559**

**8-800-600-90-77
8 (383) 209-34-54**

**Место: производства:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская
область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7**

**www.imbian.ru
info@imbian.ru**

**Site of Manufacture: MBIAN LAB LLC, 2/7 Sadovaya street,
Work settlement of Koltsovo, Novosibirsk Oblast, Russia, 630559**

2.2. Образец основной этикетки

Лямблия Ag- ИМБИАН-ИФА

**Набор реагентов для иммуноферментного выявления
антигена Giardia lamblia в суспензии фекалий
«Лямблия Ag-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-475-41390295-2022**

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

Набор реагентов содержит:

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (2,0 мл)
- 3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (3,0 мл)
- 4 ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (50,0 мл)
- 5 РРО(х10) - концентрат раствора для разведения образцов (20,0 мл)
- 6 РК - раствор конъюгата (13,0 мл)
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина (13,0 мл)
- 8 Стоп-реагент (13,0 мл)
- 9 Пленка для заклеивания планшета
- 10 Ванночки для реагентов
- 11 Наконечники для пипеток
- 12 Инструкция по применению набора реагентов

Для клинической лабораторной диагностики
Для профессионального применения
Запрещено использование

1 шт.	ПУ №
1 флакон	
1 флакон	
1 флакон	LOT
1 флакон	REF PE-024/96
1 флакон	
1 флакон	
3 шт.	
3 шт.	
24 шт.	
1 шт.	

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
 630559, Новосибирская область,
 р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
 8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
 info@imbian.ru

Прошнуровано, пропущено
и скреплено печатью

2022/11 лист 1

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Ов


01/03 2023



Фотографическое изображение

Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена *Giardia lamblia* в суспензии фекалий «Лямблия Ag-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-475-41390295-2022

Общий вид

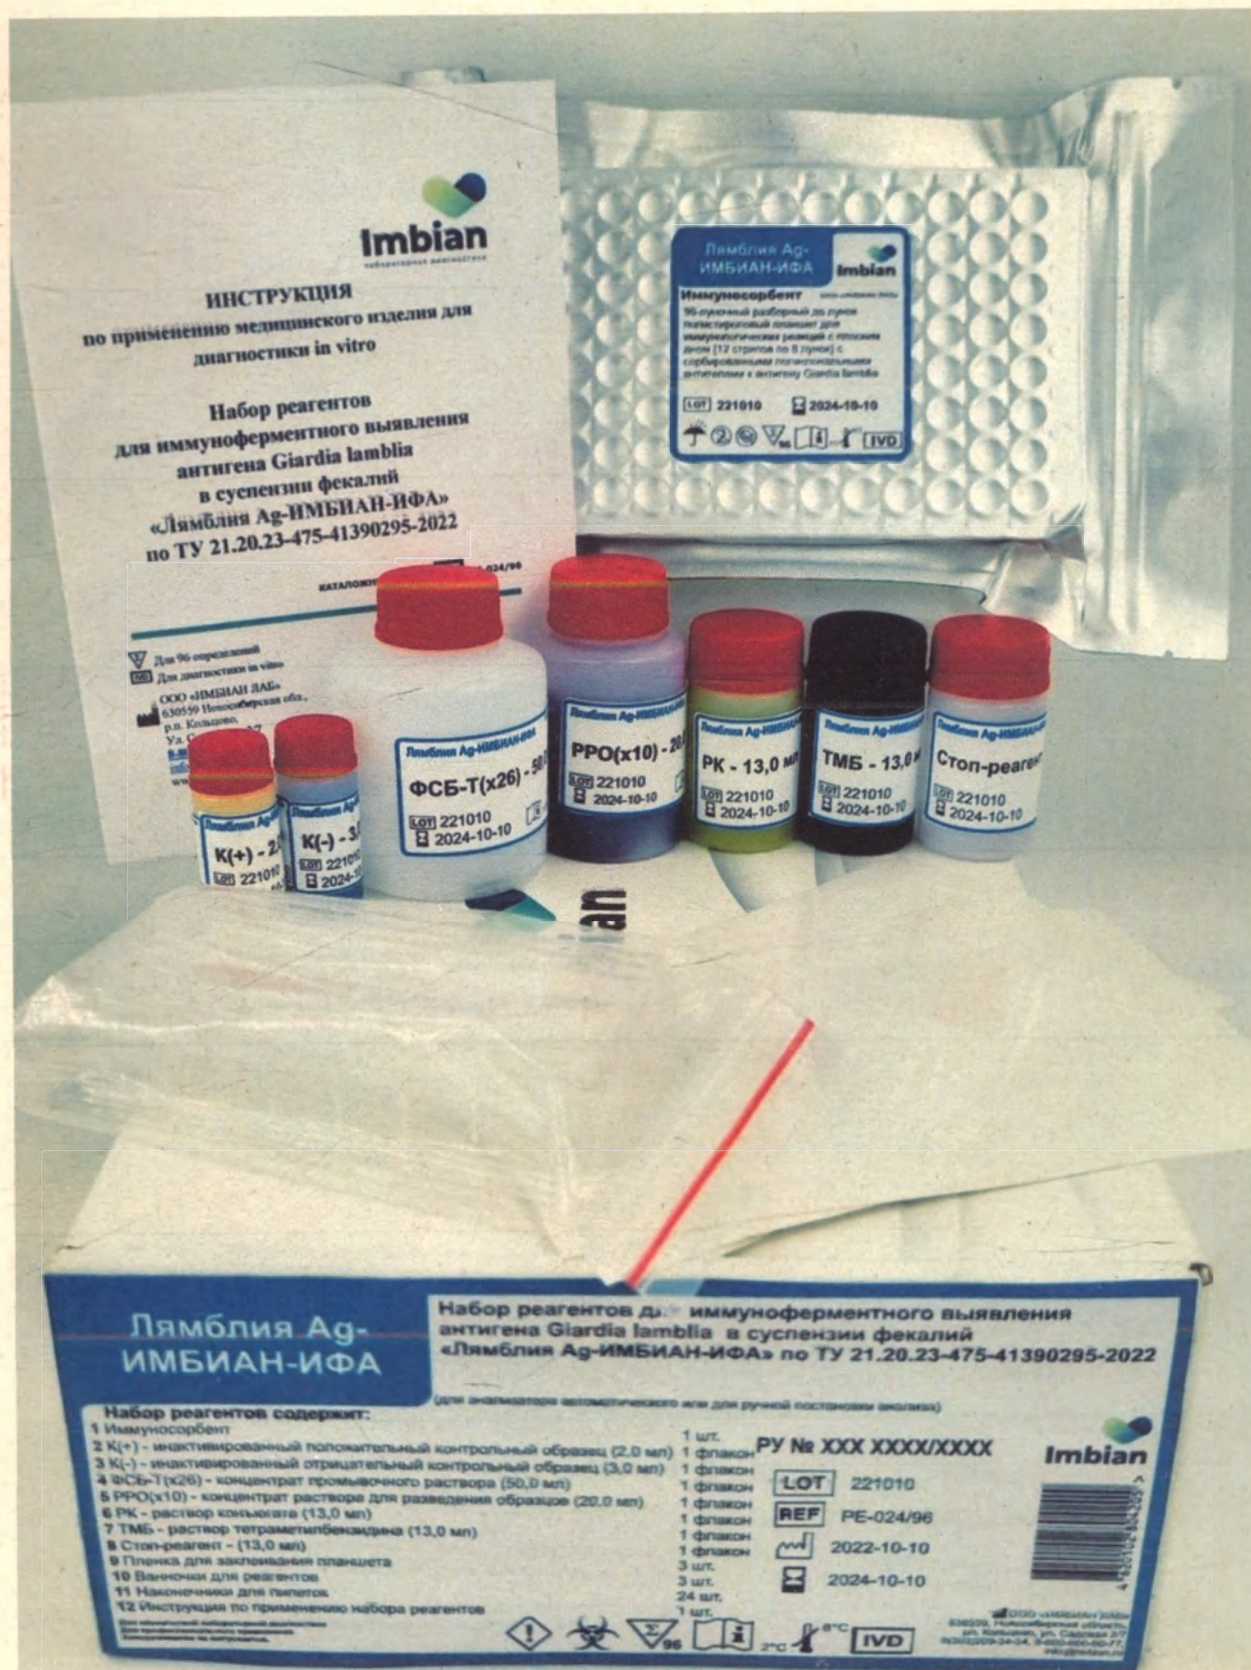



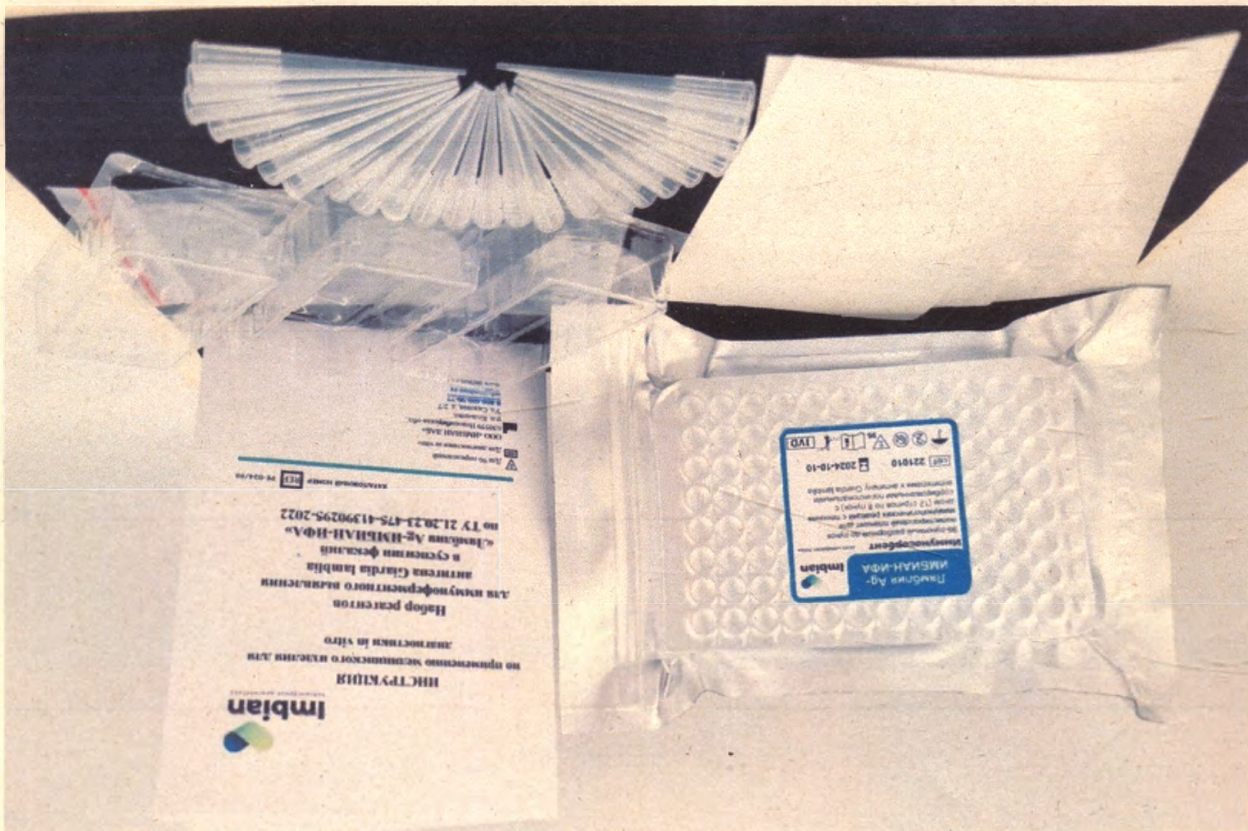


Фото упаковки

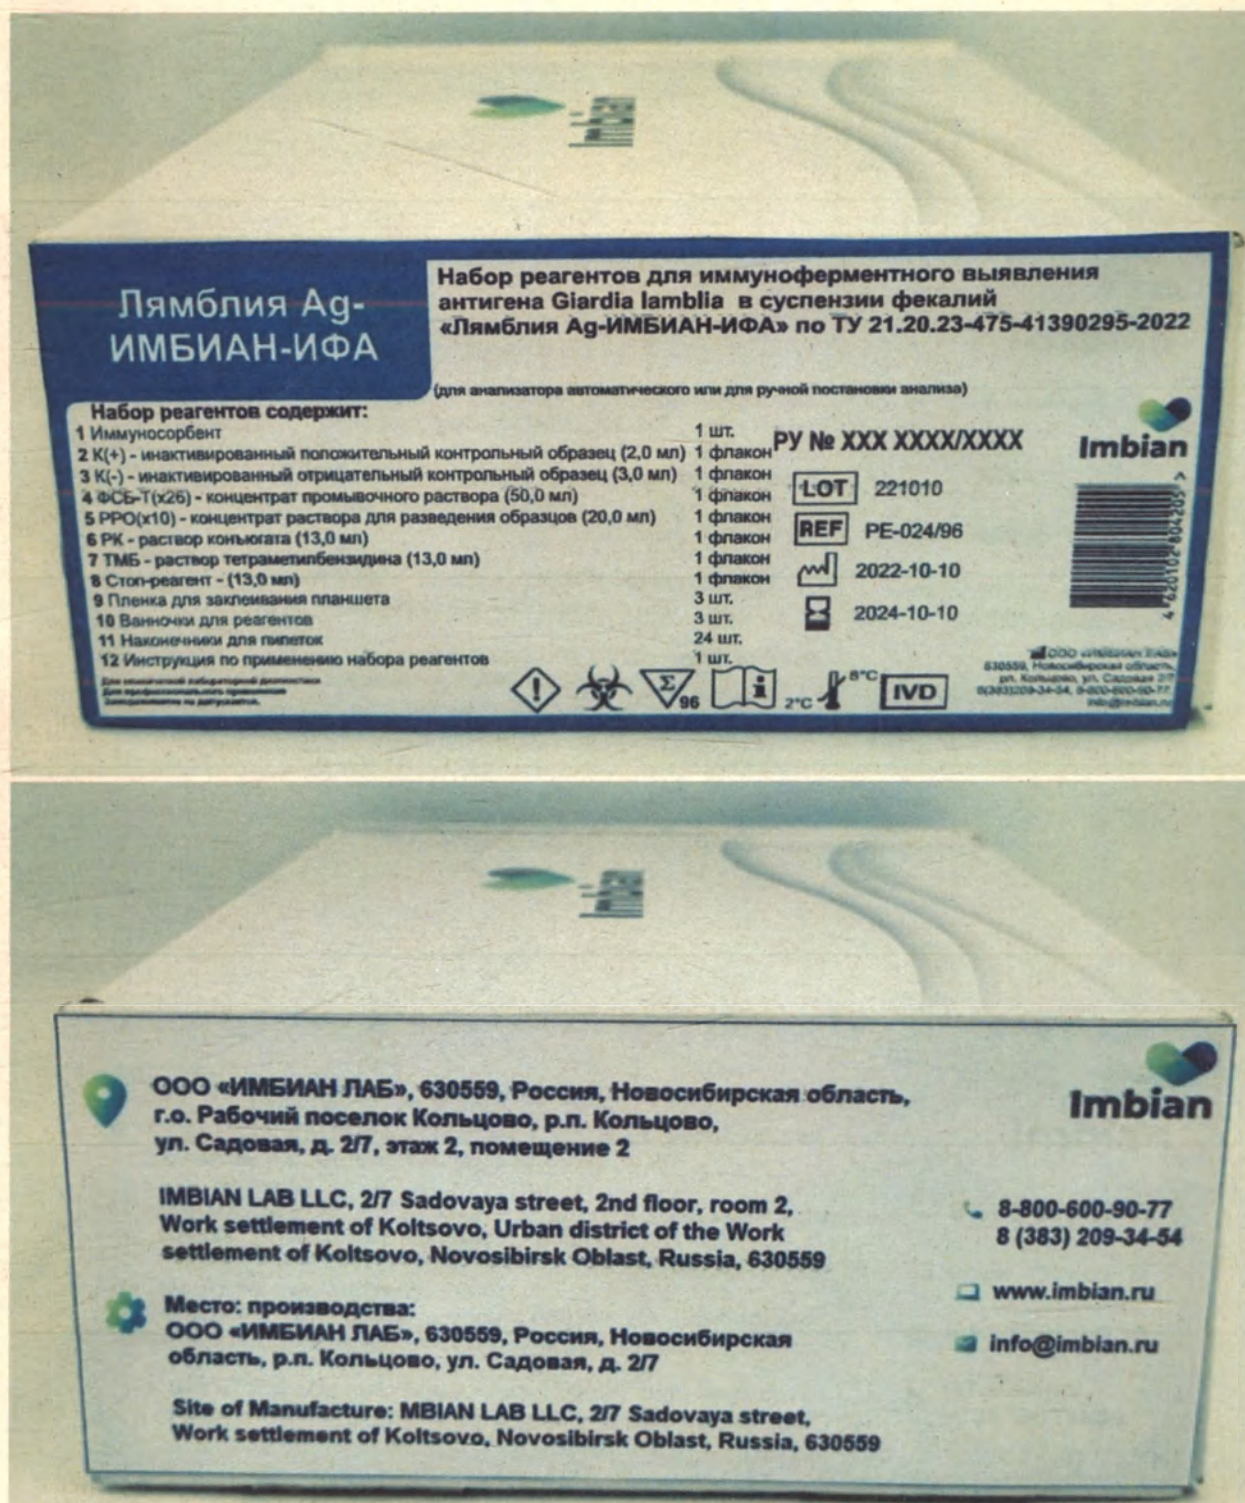

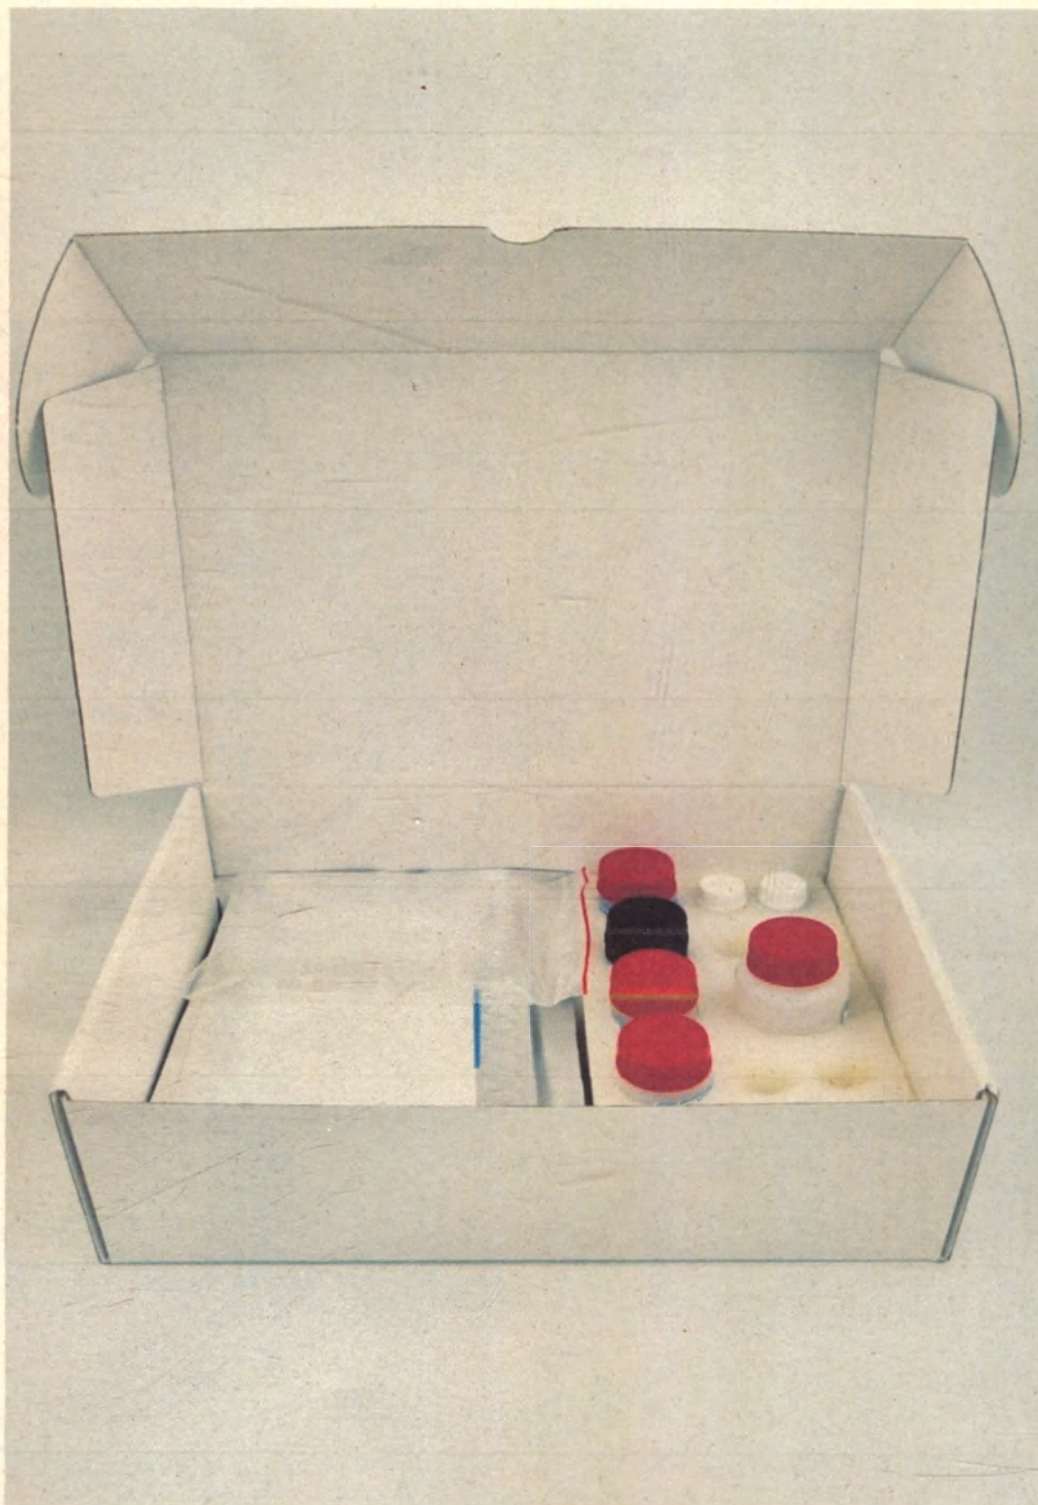

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

«01» МАРТА 2023 г.



В.В. Осипова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

414000000 лист 2

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

12 " 08 2023 г

