

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сысоева Сюн Вэй

«17» апреля 2023 г.

по доверенности от 30.11.22г
СЫСоева Н.В.
руководитель отдела
регистрации

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Автозагрузчик CAL 8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80»

Шильд Автозагрузчик CAL 8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80



Макет русскоязычного стикера «Автозагрузчик CAL 8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80»

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80.

SN



XX.XXXX

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Здание «Миндрей», Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская
Народная Республика

Страна происхождения:

Китай

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а

Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение транспортной упаковки загрузочного модуля



Sample Processing System

Loading Module, Unloading Module

Model: CAL 8000

Size: 1220mmx1000mmx1500mm

Qty.: Loading Module 1; Unloading Module 1

N.W.: 178.5kg

G.W.: 294.8 kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

EC REP

Shanghai International Holding Corp GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



SN



TS-33001805



2023-03-27

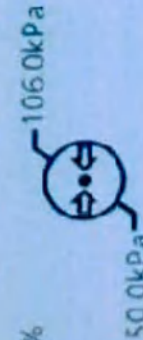

mindray

(1 OF 11)



(01)06944904048550

(11)230327

(21)TS-33001805

W#



96506724

P/N



3207B-PA00102

Ordering No.



5300326280 30

CE



047.017378-00(4.0)

1. Загрузочный модуль – 1 шт.



mindray

IVD


CE

Model: Loading Module

SN



SVA28003057



2022-08-29



100-240V ~ 50/60Hz 100VA

047-036128-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Маркировка загрузочного модуля.

mindray

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:

1. Загрузочный модуль

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
д. 16, стр. 5, ан./пом 4/Д, ком. 7, 11а
Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение транспортной упаковки разгрузочного модуля



Маркировка транспортной упаковки разгрузочного модуля

Sample Processing System

Loading Module, Unloading Module

Model: CAL 8000

Size: 1220mmx1000mmx1500mm

Qty.: Loading Module 1; Unloading Module 1

N.W.: 178.5kg G.W.: 294.8 kg

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

SN TS-33001805 2023-03-27

-10°C 40°C 10% 90% 50.0kPa 106.0kPa

mindray

(1 OF 11)

(01)06944904048550
(11)230327
(21)TS-33001805


 W#  96506724

P/N  3207B-PA00102

Ordering No.  5300325280 30

 **CE** 047 017378-00(4 0)

2. Разгрузочный модуль – 1 шт.

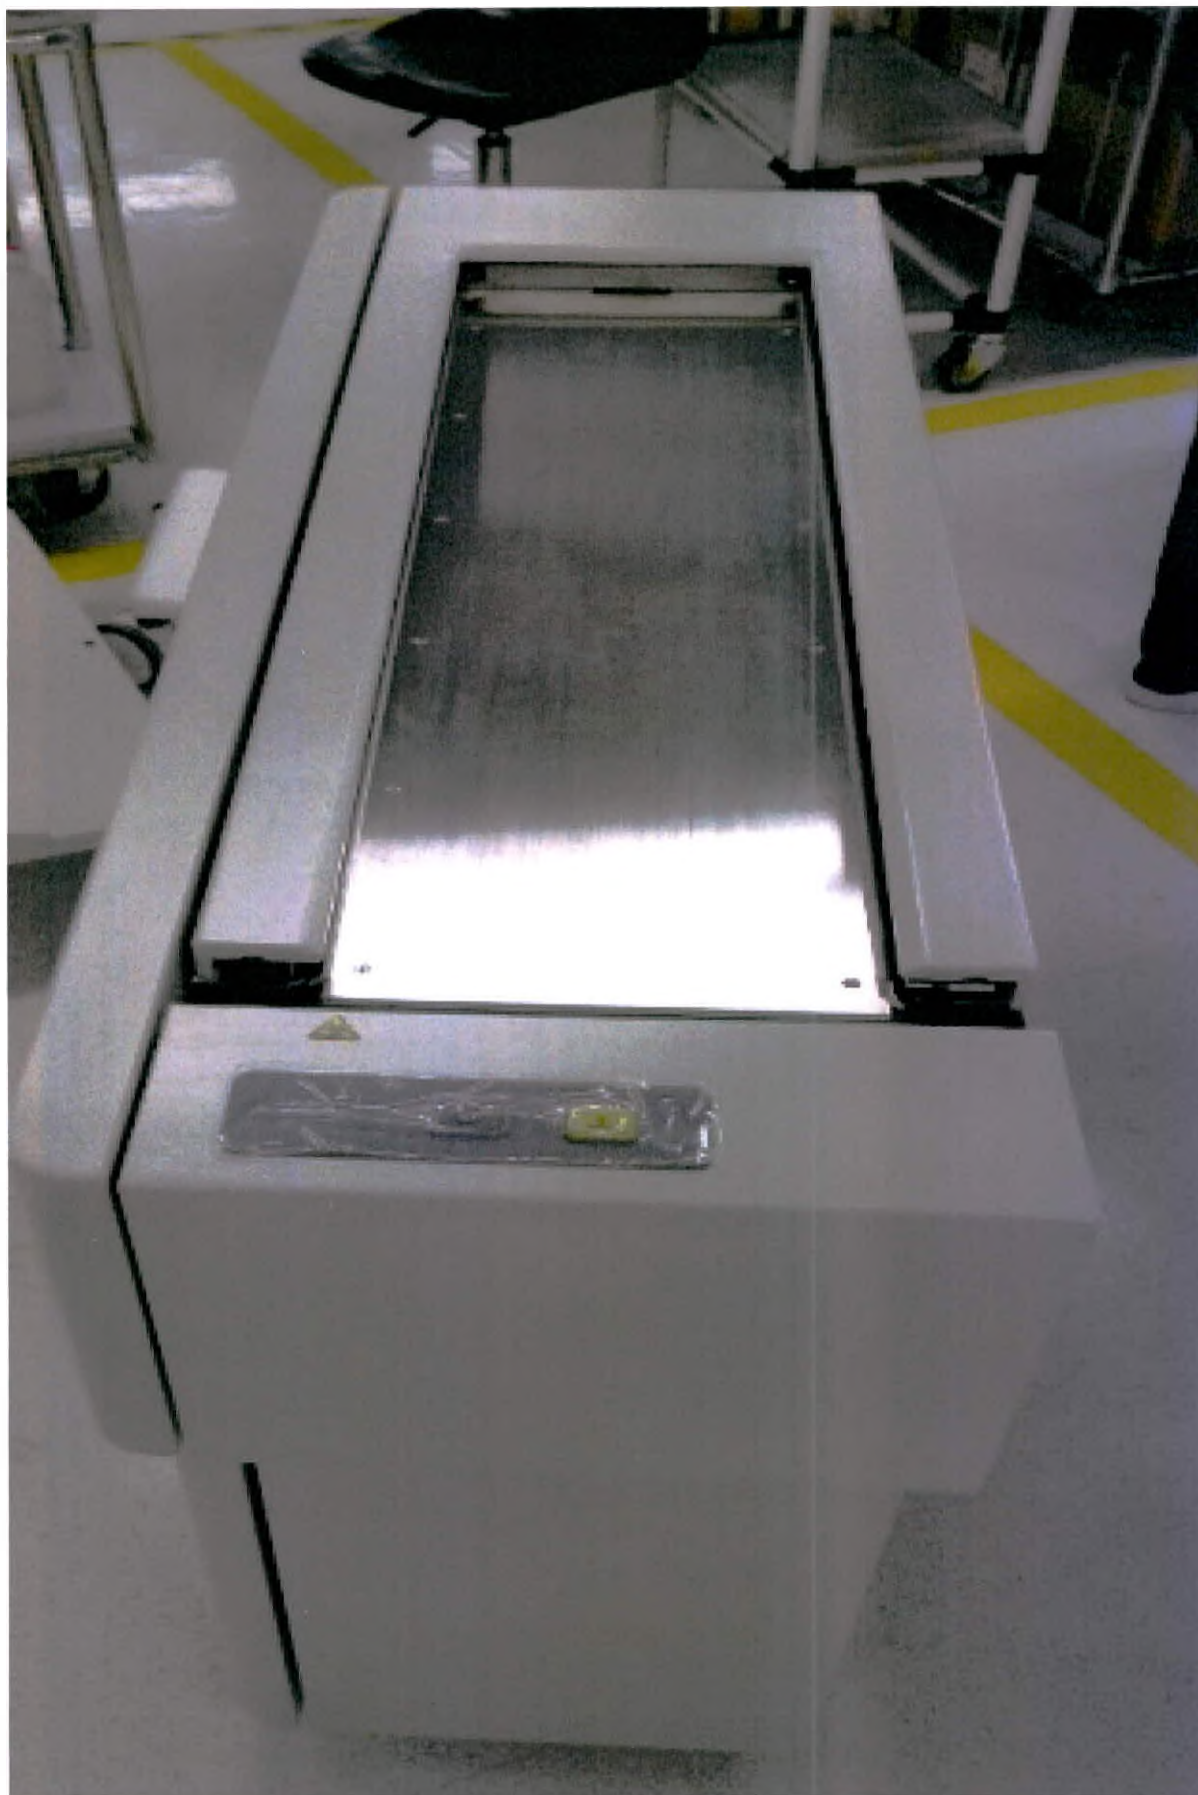

mindray

IVD

CE

Model: Unloading Module

SN



TSK28008114



2022-08-20




100-240V ~ 50/60Hz 100VA

047-036127-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:

2. Разгрузочный модуль

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика

Уполномоченный

представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн
тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а
Тел. +7 (499) 553-60-36

Регистрационное

удостоверение

№ 07

Фотографическое изображение транспортной упаковки модуля транспортировки для анализатора гематологического



Hematology Analyzer Track Module

mindray

DATE: 2018-09-17

SN:



TS-89000368

P/N:



115-035157-00

W#:



73105429

Ordering NO:



21324373.10



Size : 1220mmx1100mmx1200mm


Qty : 1 N.W. : 121 kg G.W. : 213 kg






SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

TEL: +86 755 81888998 FAX: +86 755 26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

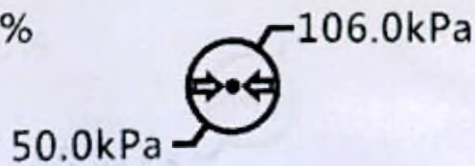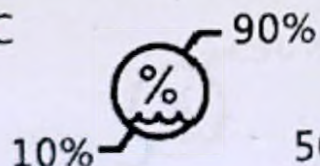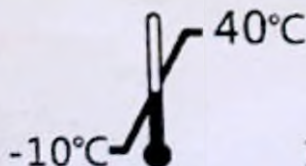

047-017379-00-2.0

(3 OF 7)

Маркировка, наносимая на транспортную упаковку модуля транспортировки для анализатора гематологического

mindray

3. Модуль транспортировки для анализатора гематологического – не более 4 шт. (при необходимости).



mindray

IVD

CE

Model: Hematology Analyzer Track Module

SN



TSA28008142



2022-08-29



100-240V ~ 50/60Hz 100VA

047-036125-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Маркировка модуля транспортировки для анализатора гематологического.

mindray

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:
3. Модуль транспортировки для анализатора гематологического

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
 Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
 высоких технологий Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
 Китайская Народная Республика
 ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
 тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
 д. 16, стр. 5, ая./пом 4/1, ком. 7, 11а
 Тел. +7 (499) 553-60-36

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение транспортной упаковки модуля транспортировки для прибора SC-120.



Маркировка, наносимая на транспортную упаковку модуля транспортировки для прибора SC-120.

(4 OF 11)

mindray

Ordering No.:  5300326280 30

W#:  96506724

P/N:  3207B-PA00102

SN:  TS-33001805

 2023-03-27

 047-036112-00(1 0)

Slide Maker & Stainer Track Module

HSF

Size: 1315mmx1220mmx1200mm

N.W.: 151.5 kg G.W.: 238.3 kg


Qty.: 1

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keyi 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81600068 Fax: +86-755-26582080

 Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Elbstraße 80, 20537 Hamburg, Germany



10°C 40°C




10% 90%



50.0kPa 106.0kPa

CE

4. Модуль транспортировки для прибора SC-120 – не более 2 шт. (при необходимости).

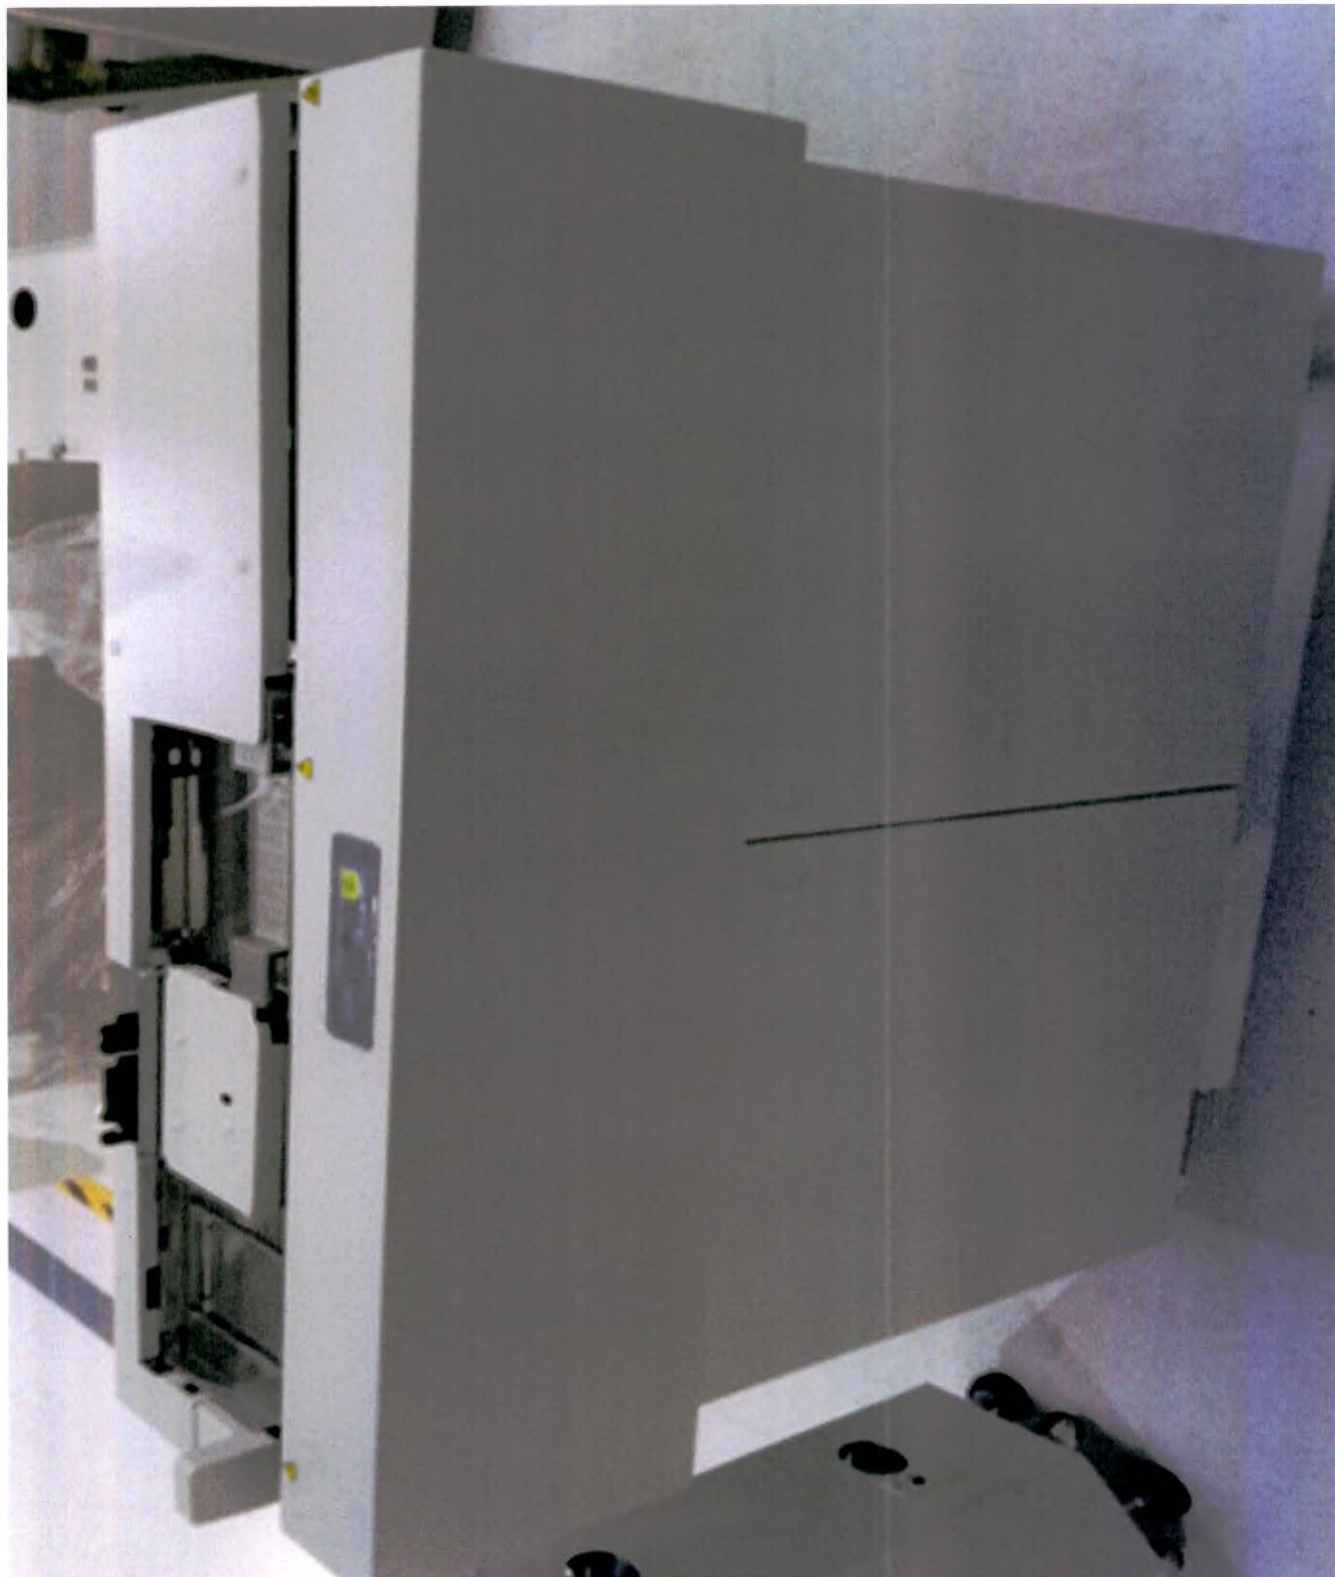

mindray

IVD


CE

Model: Slide Maker & Stainer Track Module

SN



TSB28008146



2022-08-29



100-240V ~ 50/60Hz 100VA

047-036123-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Маркировка модуля транспортировки для прибора SC-120.

mindray

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:
4. Модуль транспортировки для прибора SC-120

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
 Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
 высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
 Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
 тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
 д. 16, стр. 5, ан/пом 4/1, ком. 7, 11а
 Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение транспортной упаковки промежуточного резервного модуля



Маркировка транспортной упаковки промежуточного резервного модуля

Intermediate Buffer Module

Size: 1220mmx865mmx1100mm

N.W.: 90 kg G.W.: 163.0 kg

Qty.: 1

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

40°C 90% 106.0kPa
-10°C 10% 50.0kPa

CE

mindray (5 OF 11)

Ordering No.:
5300326280.30

W#:
96506724

P/N:
3207B-PA00102

SN
TS-33001805

2023-03-27

047-036113-00(1.0)

BC23040800140

TOP SN: UU-33001310
BOX QTY: 18

5. Промежуточный резервный модуль – не более 4 шт. (при необходимости).



mindray



Model: Intermediate Buffer Module

SN



TSF25007671



2022-05-22




100-240V ~ 50/60Hz 100VA

047-036124-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Маркировка промежуточного резервного модуля.

mindray

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:

5. Промежуточный резервный модуль

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
высоких технологий Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика

Уполномоченный

представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
д. 16, стр. 5, ан./пом 4/1, ком 7, 11а
Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение транспортной упаковки правого углового поворотного модуля



Right-angle Turning Module

Size: 1050mmx440mmx460mm


N.W.: 40 kg

G.W.: 47.5 kg


Qty.: 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

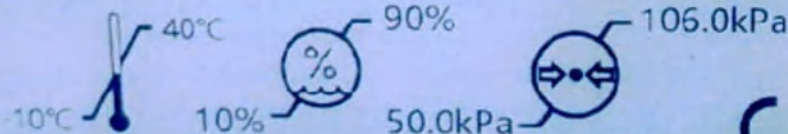

mindray

(2 OF 10)

Ordering No.:



5300296069.30

W#:



96505924

P/N:



3207B-PA00092

SN



TS-29001632



2022-09-08



047-036109-00(1.0)

Маркировка транспортной упаковки правого углового поворотного модуля

mindray

6. Правый угловой поворотный модуль – не более 2 шт. (при необходимости).



mindray

IVD


CE

Model: Right-angle Turning Module


SN



TSE29008220



2022-09-14



047-036120-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Маркировка правого углового поворотного модуля.

mindray

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:
б. Правый угловой поворотный модуль

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
 Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
 высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
 Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
 гер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
 д. 16, стр. 5, ян./пом 41, ком. 7, 11а
 Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение левого углового поворотного модуля



(6 OF 10)

mindray

Left-angle Turning Module

Size: 1050mmx440mmx460mm


N.W.: 40 kg

G.W.: 47.5 kg


Qty.: 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

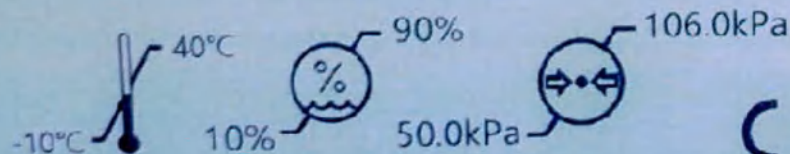

Ordering No.:



5300296069.30

W#:



96505924

P/N:



3207B-PA00092

SN



TS-29001636




2022-09-08



047-036109-00(1.0)

7. Левый угловой поворотный модуль – не более 2 шт. (при необходимости).

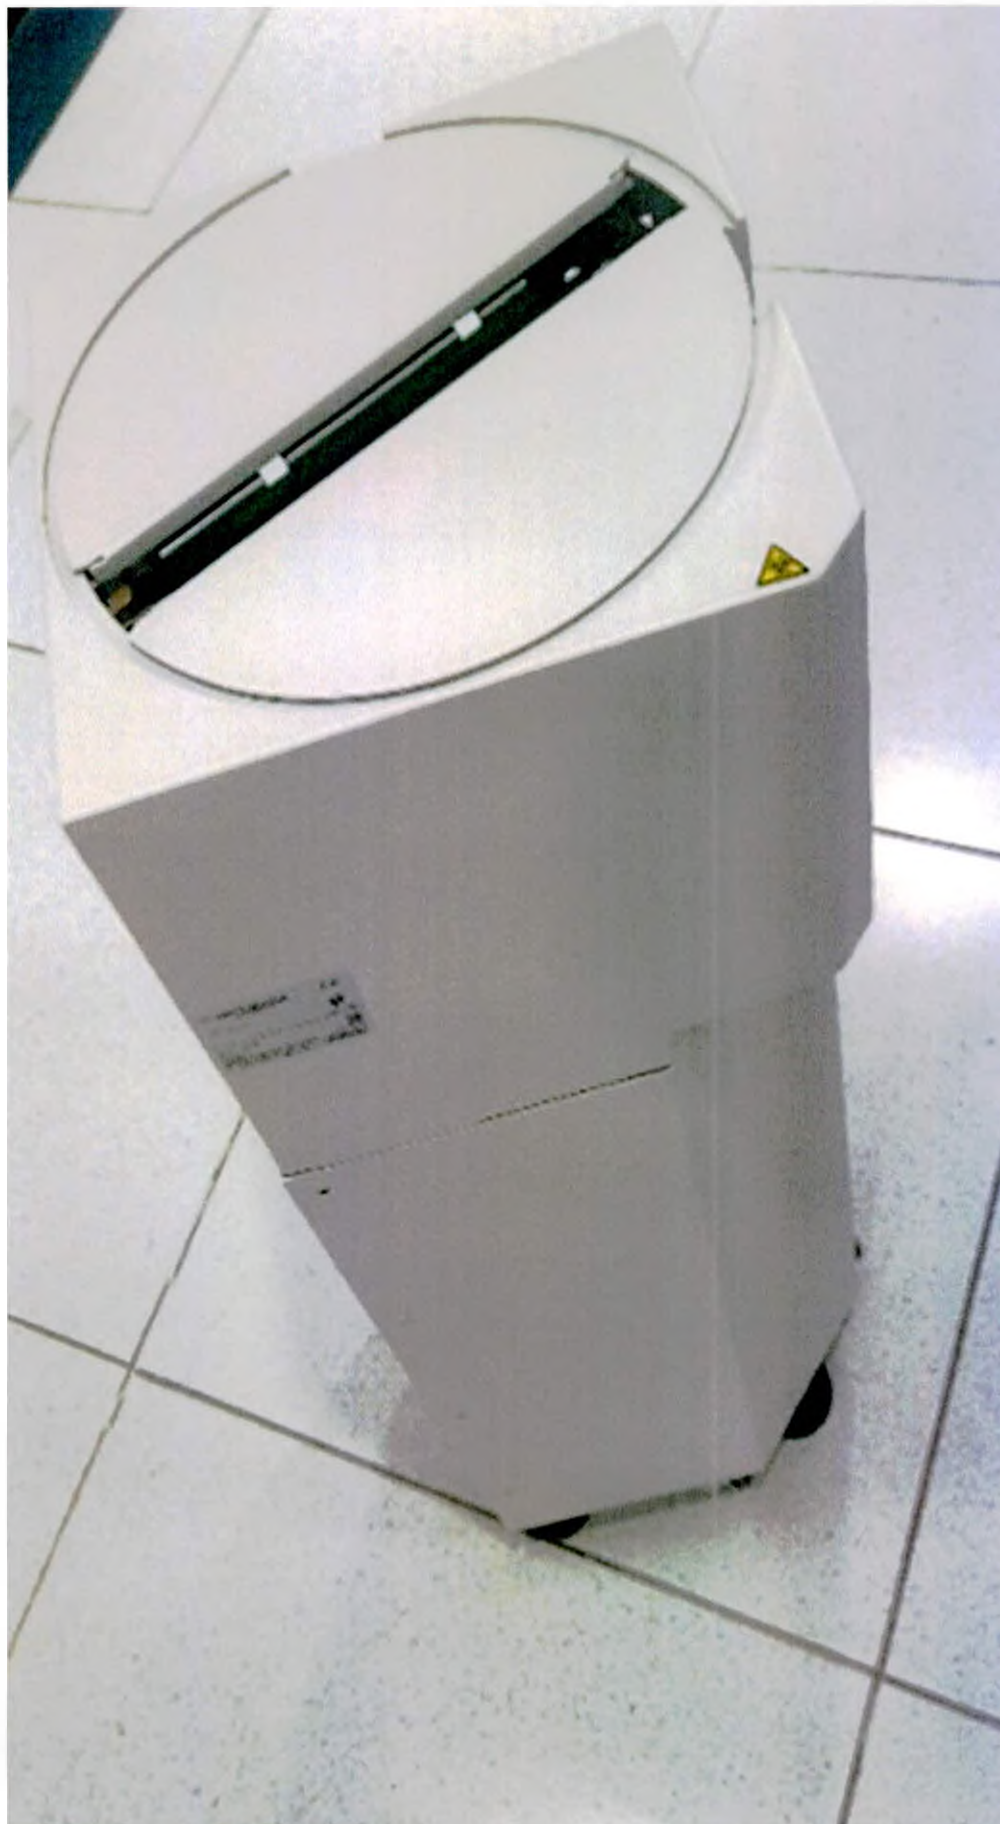

mindray

IVD


CE

Model: Left-angle Turning Module

SN



TSE29008222



2022-09-14



047-036120-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80- 20537 Hamburg. Germany

Маркировка левого углового поворотного модуля.

mindray

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе 7. Левый угловой поворотный модуль

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Кецзи 12 Род Саун, Промышленный парк
высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн
тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
д. 16, стр. 5, ан./пом 4А, ком 7, 11а
Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение транспортной коробки модуля обхода колонны (малого)



Маркировка модуля обхода колонны (малого)

Pillar Bypassing Module (Short)

Size: 995mmx960mmx475mm

N.W.: 38.5 kg



G.W.: 57.1 kg

Qty.: 1

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. (Mindray Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

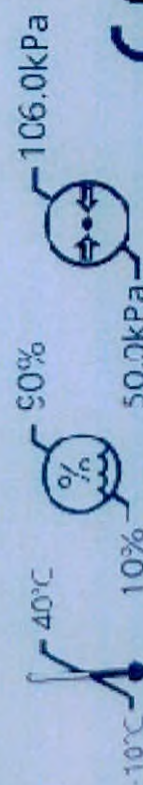

(3 OF 10)

mindray

Ordering No.:



5300296069.30

W#:



95505924

P/N:



32073-PA00092

SN



TS 2900' 632

2022-09-08



647-936197-C0(1.0)

8.Модуль обхода колонны (малый) – не более 2 шт. (при необходимости).



mindray




Model: Pillar Bypassing Module (Short)

SN



TSG25007625



2022-05-20




047-036118-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:
8. Модуль обхода колонны (малый)

Производитель:	Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан/пом 4/1, ком. 7, 11а Тел. +7 (499) 553-60-36
Регистрационное удостоверение	№ _____ от _____

Фотографические изображения транспортной упаковки модуля обхода колонны (большой)



Маркировка транспортной упаковки модуля обхода колонны (большой)

(1 OF 10)

mindray

Ordering No.:  5300296069 30

W#:  96505924

P/N:  3207B-PA00092

SN:  TS-29001632

 2022-09-08

047-036108-C0(1.0)


Pillar Bypassing Module (Long)


Size: 1260mmx995mmx475mm

N.W.: 70 kg G.W.: 96.9 kg

Qty.: 1

 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

 Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Elftestraße 60, 20537 Hamburg, Germany

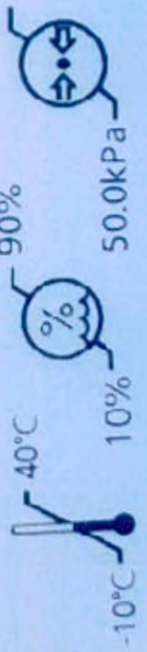 -10°C 40°C 90% 106.0kPa
10% 50.0kPa



9.Модуль обхода колонны (большой) – не более 2 шт. (при необходимости).



mindray

IVD


CE

Model: Pillar Bypassing Module (Long)

SN



TSH29008221



2022-09-14



047-036119-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Маркировка модуля обхода колонны (большого).

mindray

Макет русскоязычной маркировки модуля обхода колонны (большого).

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:
9. Модуль обхода колонны (большой)

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
 Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
 вьсокх технологй, Шэньчжэнь, 518057 Шэньчжэнь,
 Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
 тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
 д. 16, стр. 2, ан./пом 4/1, ком. 1, 11а
 Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение транспортной упаковки расширенного разгрузочного модуля



Маркировка транспортной упаковки расширенного разгрузочного модуля

Expanded Unloading Module

Size: 1220mmx865mmx1100mm

N.W.: 57 kg G.W.: 139.3 kg

Qty.: 1

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81888938 Fax: +86-755-25582680

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Effestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray (6 OF 11)

Ordering No.:  5300326280 30

W#:  96506724

P/N:  3207B-PA00102

SN:  TS-33001805


 2023-03-27

 047036115-001101


-10°C 40°C 10% 90% 50.0kPa 106.0kPa



10. Расширенный разгрузочный модуль – не более 4 шт. (при необходимости).

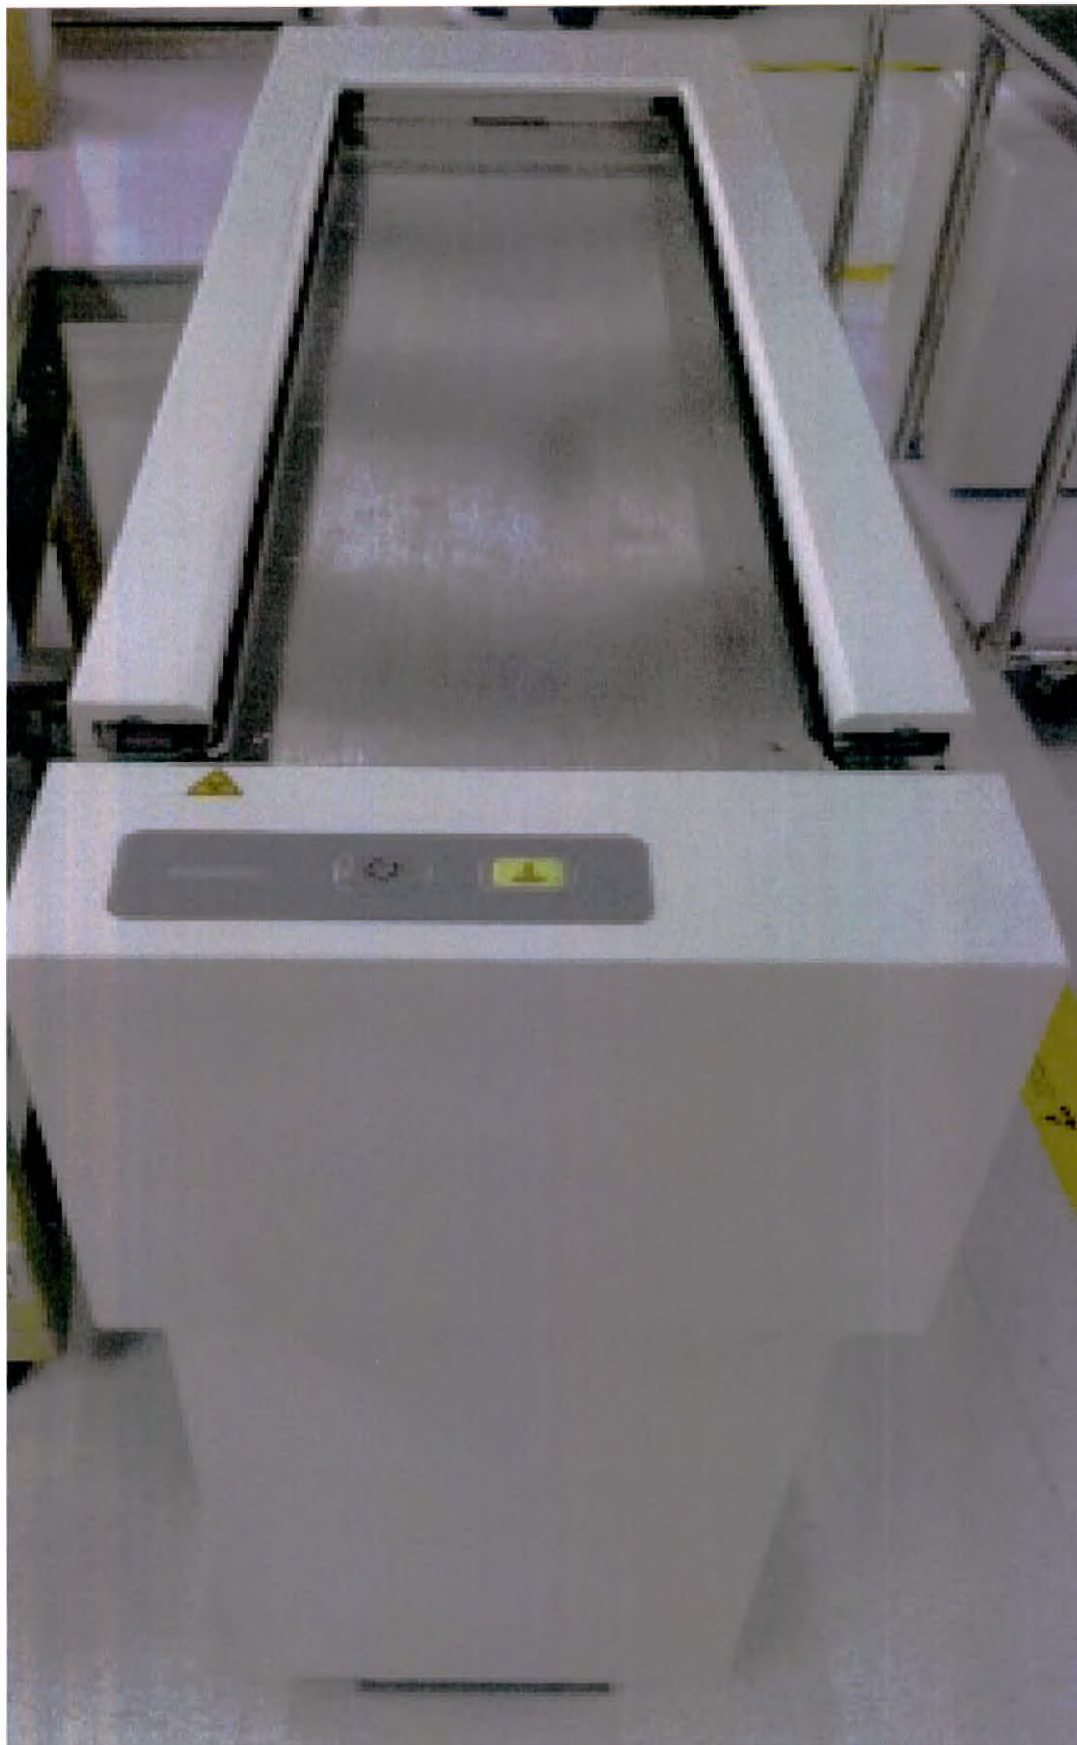

mindray

IVD

CE

Model: Expanded Unloading Module

SN



TSJ25007668



2022-05-22



WASTE



100-240V ~ 50/60Hz 100VA

047-036126-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Маркировка расширенного разгрузочного модуля.

mindray

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:
10. Расширенный разгрузочный модуль

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
 Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Сауд, Промышленный парк
 высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
 Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн-
 тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
 д. 16, стр. 5, ан/пом 4/1, ком. 7, 11а
 Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение транспортной упаковки загрузочного резервного модуля



Sample Processing System

Loading buffer module

Model: CAL 8000

Size: 1220mmx865mmx1100mm

Qty.: 1

N.W.:90kg

G.W.:186kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel.: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany




SN



TS-29001632



2022-09-08

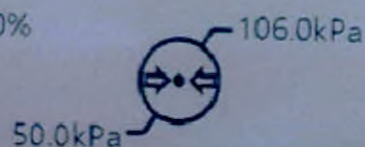

mindray

(4 OF 10)

UDI



(01)06944904048550
(11)220908
(21)TS-29001632

W#:



96505924

P/N:



3207B-PA00092

Ordering No.:



5300296069.30

IVD


CE



047-042105-00(2.0)

mindray

11. Загрузочный резервный модуль – не более 4 шт. (при необходимости).

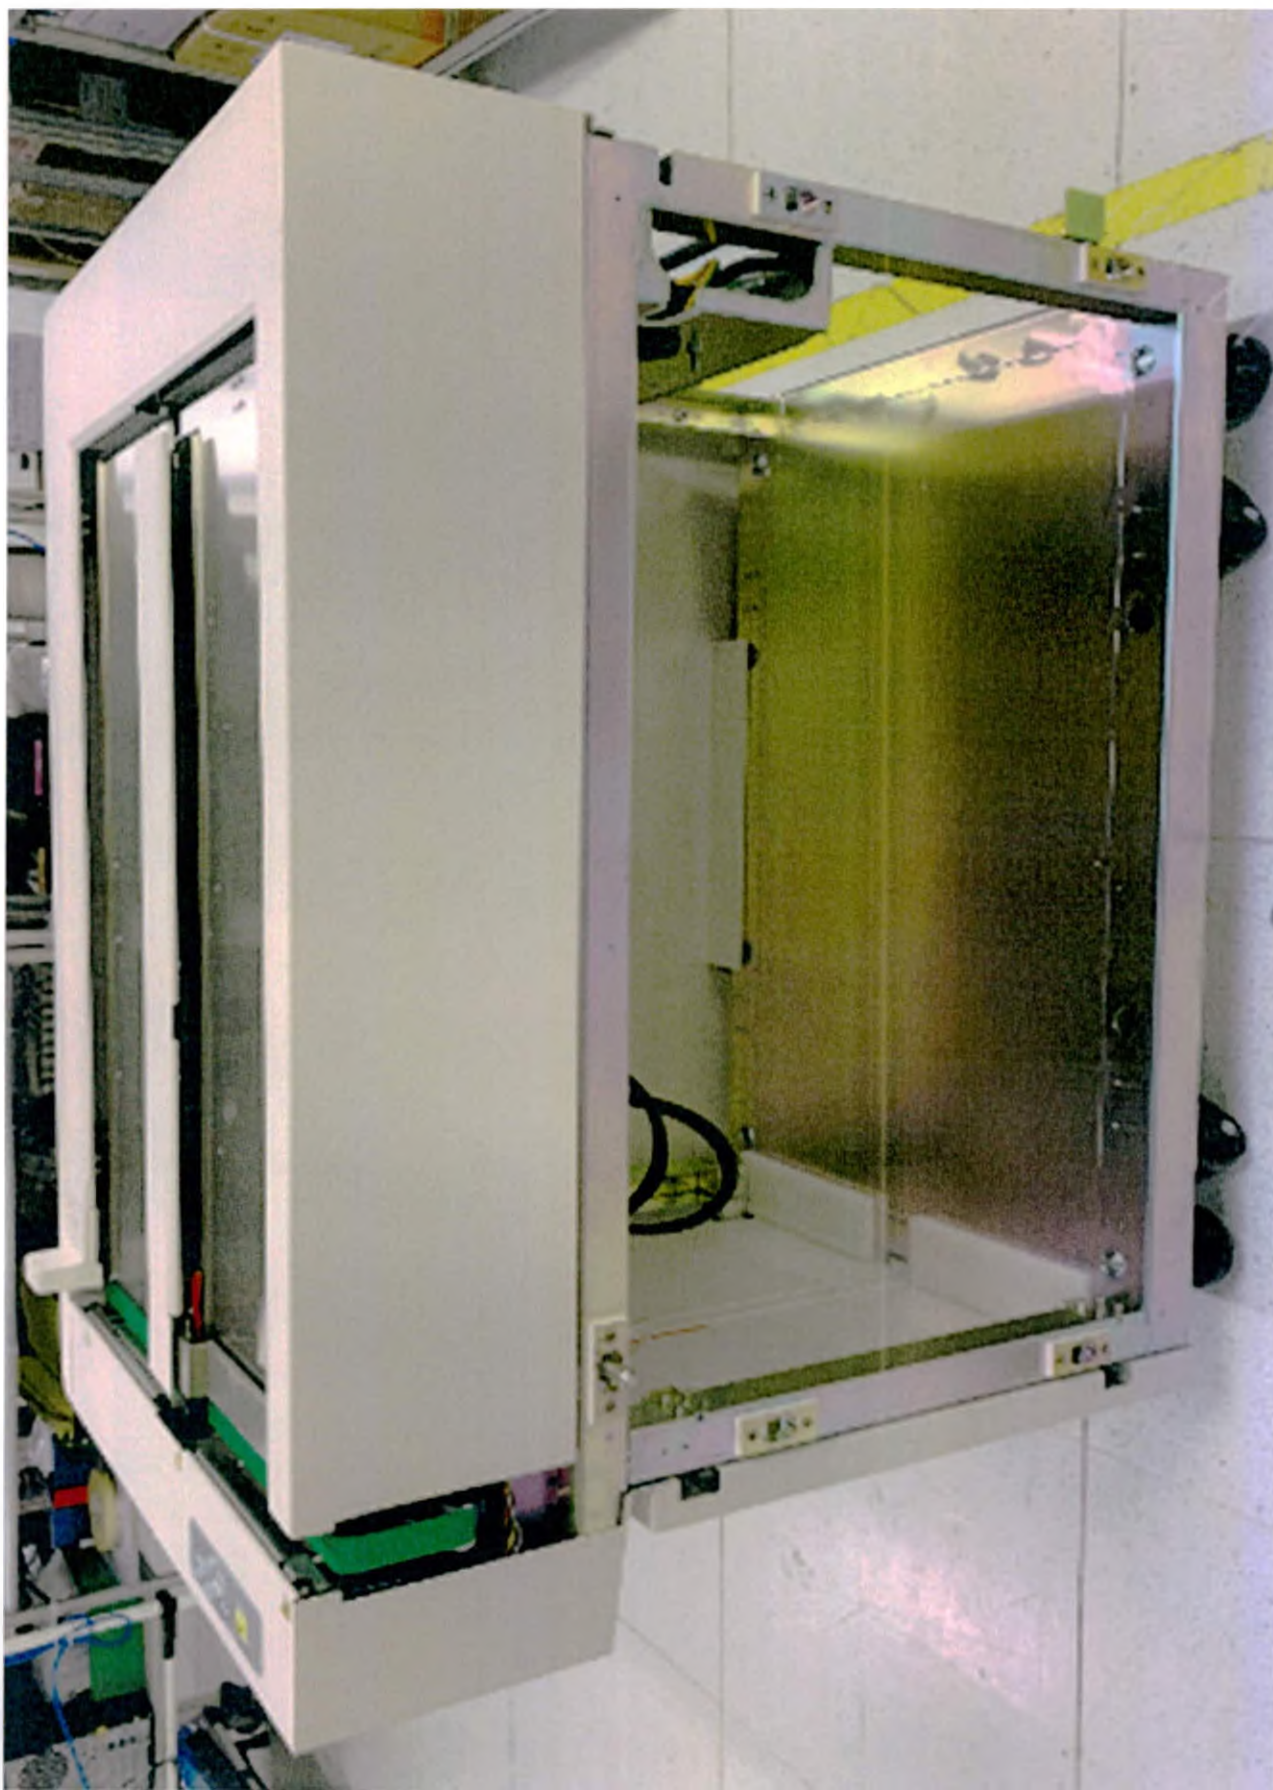


Model: Loading buffer module

SN



TSM28008180

mindray



2022-08-29

100-240V ~ 50/60Hz 100VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



047-042103-00(1.0)

CE



IVD

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:
11. Загрузочный резервный модуль

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
 Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
 высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
 Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
 тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
 д. 16, стр. 5, ан./пом 4/1, ком. 7, 11а
 Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографические изображения транспортной упаковки модуля транспортировки кассет для предметных стекол для анализатора MC-80



(3 OF 4)

mindray

SPL connector module 1

(used with Automated Digital Cell Morphology Analyzer)

Size: 1220mm x1100mm x 1200mm

Qty: 1

N.W.: 130.5 kg

G.W.: 229.1 kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

SN



DC8-25000004T

W#:



96505629

P/N:



TCN22-J03-AF


Ordering No.:



5300279582.20



2022-05-11



047-039412-00(1.0)

12. Модуль транспортировки кассет для предметных стекол для анализатора МС-80 – не более 2 шт. (при необходимости).



mindray

IVD

CE

Model: SPL connector module

SN



TSS2A003131



2012-10-10



100-240V ~ 50/60Hz 100VA

047-036128-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Fifffestraße 80 20537 Hamburg, Germany

Маркировка модуля транспортировки кассет для предметных стекол для анализатора MC-80.

mindray

Макет русскоязычной маркировки модуля транспортировки кассет для предметных стекол для анализатора MC-80.

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов RC-6800Plus или RC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе: 12. Модуль транспортировки кассет для предметных стекол для анализатора MC-80

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
высоких технологий Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика
ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, пл
тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
д. 16, стр. 5, ан./пом 4/1, ком. 7, 11а
Тел. +7 (499) 553-60-36

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Фотографическое изображение транспортной упаковки модуля CR-30[H] для разбавления концентрированного реагента



Concentrated Reagent Delivery System

mindray

(1 OF 2)

Model: CR-30[H]

Size: 865mm x 612mm x 685mm

Qty.: 1

N.W.: 35kg

G.W.: 56.7 kg



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany




SN



DE8-25000010T



2022-05-26

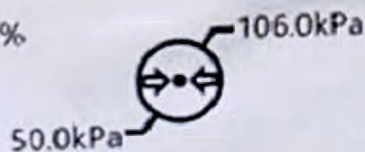

UDI



(01)06903053024181

(11)220526

(21)DE8-25000010T

W#:



96505701

P/N:



TCN22-J03-AD

Ordering No.:



5300281342.10

CE



047-038835-00(2.0)

Маркировка транспортной упаковки модуля CR-30[H] для разбавления концентрированного реагента

mindray

13. Модуль CR-30[H] для разбавления концентрированного реагента – 1 шт. (при необходимости), в составе:

13.1. Основной блок – 1 шт.



Concentrated Reagent Delivery System


mindray

Model: CR-30[H]

SN



DE8-25000010T



2022-05-26

100-240V ~ 50/60Hz 200VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



047-038833-00(2.0)


UDI



(01)06903053024181

(11)220528

(21)DE8-25000010T



IVD

Маркировка основного блока модуля CR-30[H] для разбавления концентрированного реагента

mindray

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан.пом. 4/1, ком. 7, 11а
ИНН 7705815069 КПП 770201001

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:
13. Модуль CR-30[H] для разбавления концентрированного реагента

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
 Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
 высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
 Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн-
 тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
 д. 16, стр. 5, ан/пом 4/1, ком 7, 11а
 Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

13.2. Буферная ёмкость для хранения готового реагента – 1 шт.



13.3. Фильтр для очистки воды – не более 5 шт. (при необходимости).



13.4. Поплавковый датчик определения уровня воды — не более 2 шт. (при необходимости).




13.5. Трубка для подачи готового реагента – не более 10 шт. (при необходимости).



13.6. Трубка для подачи готового реагента с разветвлением линии подачи— не более 10 шт. (при необходимости).



13.7. Дополнительная трубка для основного блока – не более 10 шт. (при необходимости).

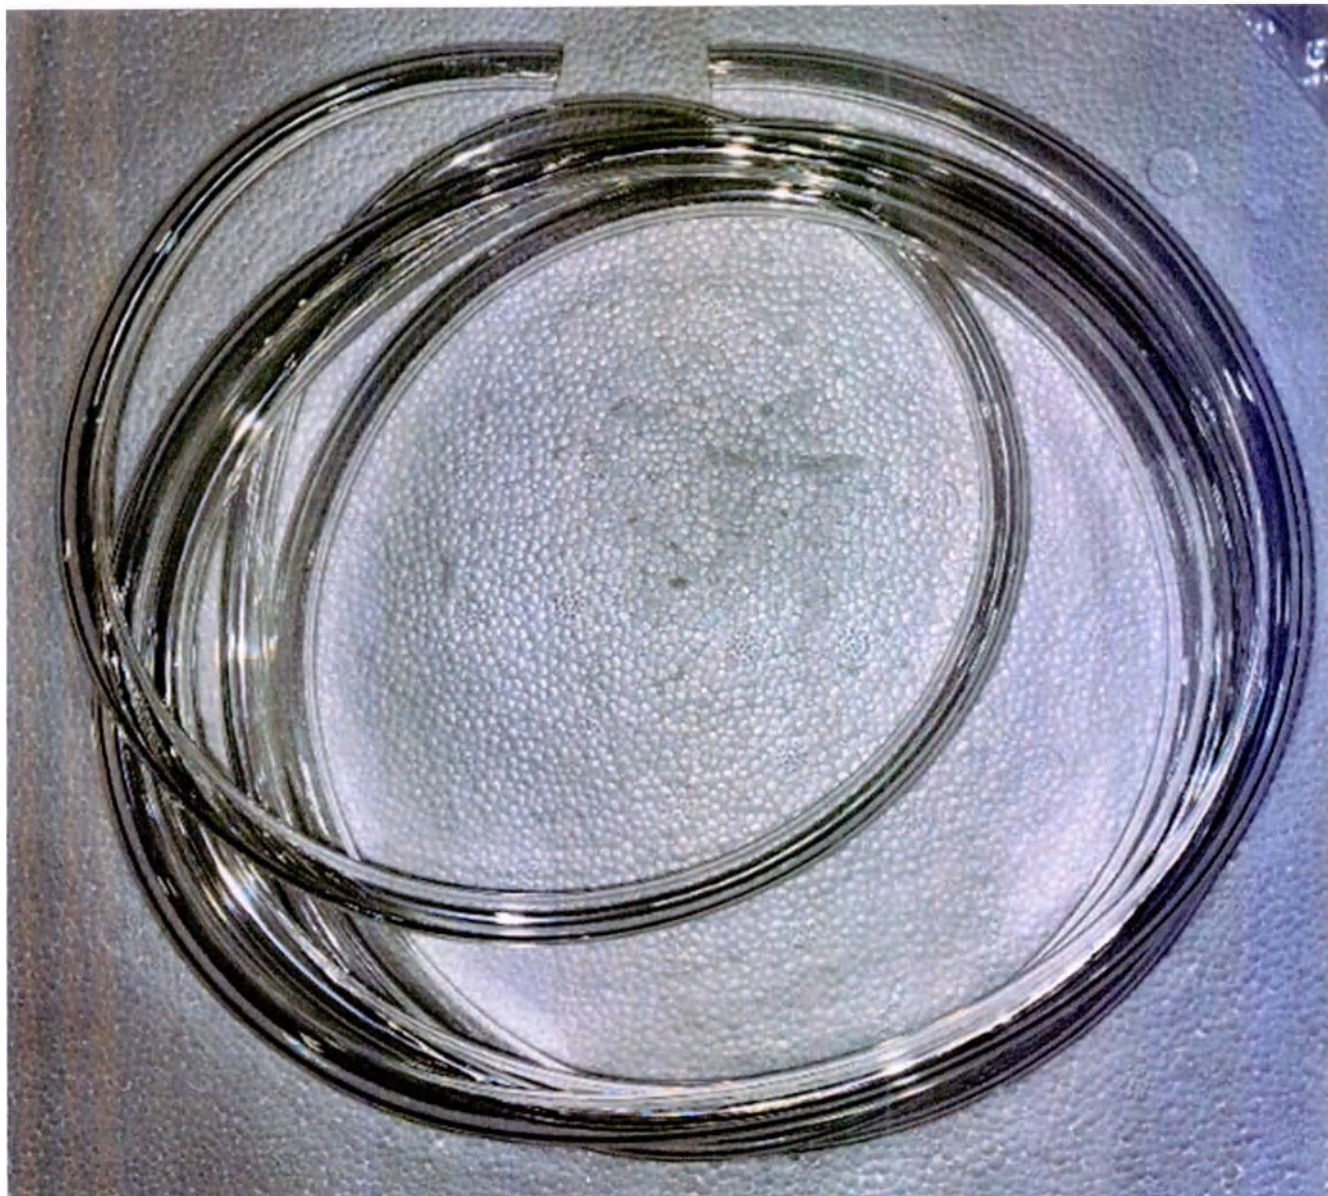

13.8. Трубка для слива – не более 2 шт. (при необходимости).



13.9. Хомут фиксации трубок малый – не более 10 шт. (при необходимости).




13.10. Хомут для фиксации трубок большой – не более 10 шт. (при необходимости).




13.11. Быстросъемный фитинг для трубок пневматической линии – не более 10 шт. (при необходимости).



13.12. Держатель угловой для фиксации трубок – не более 4 шт. (при необходимости).

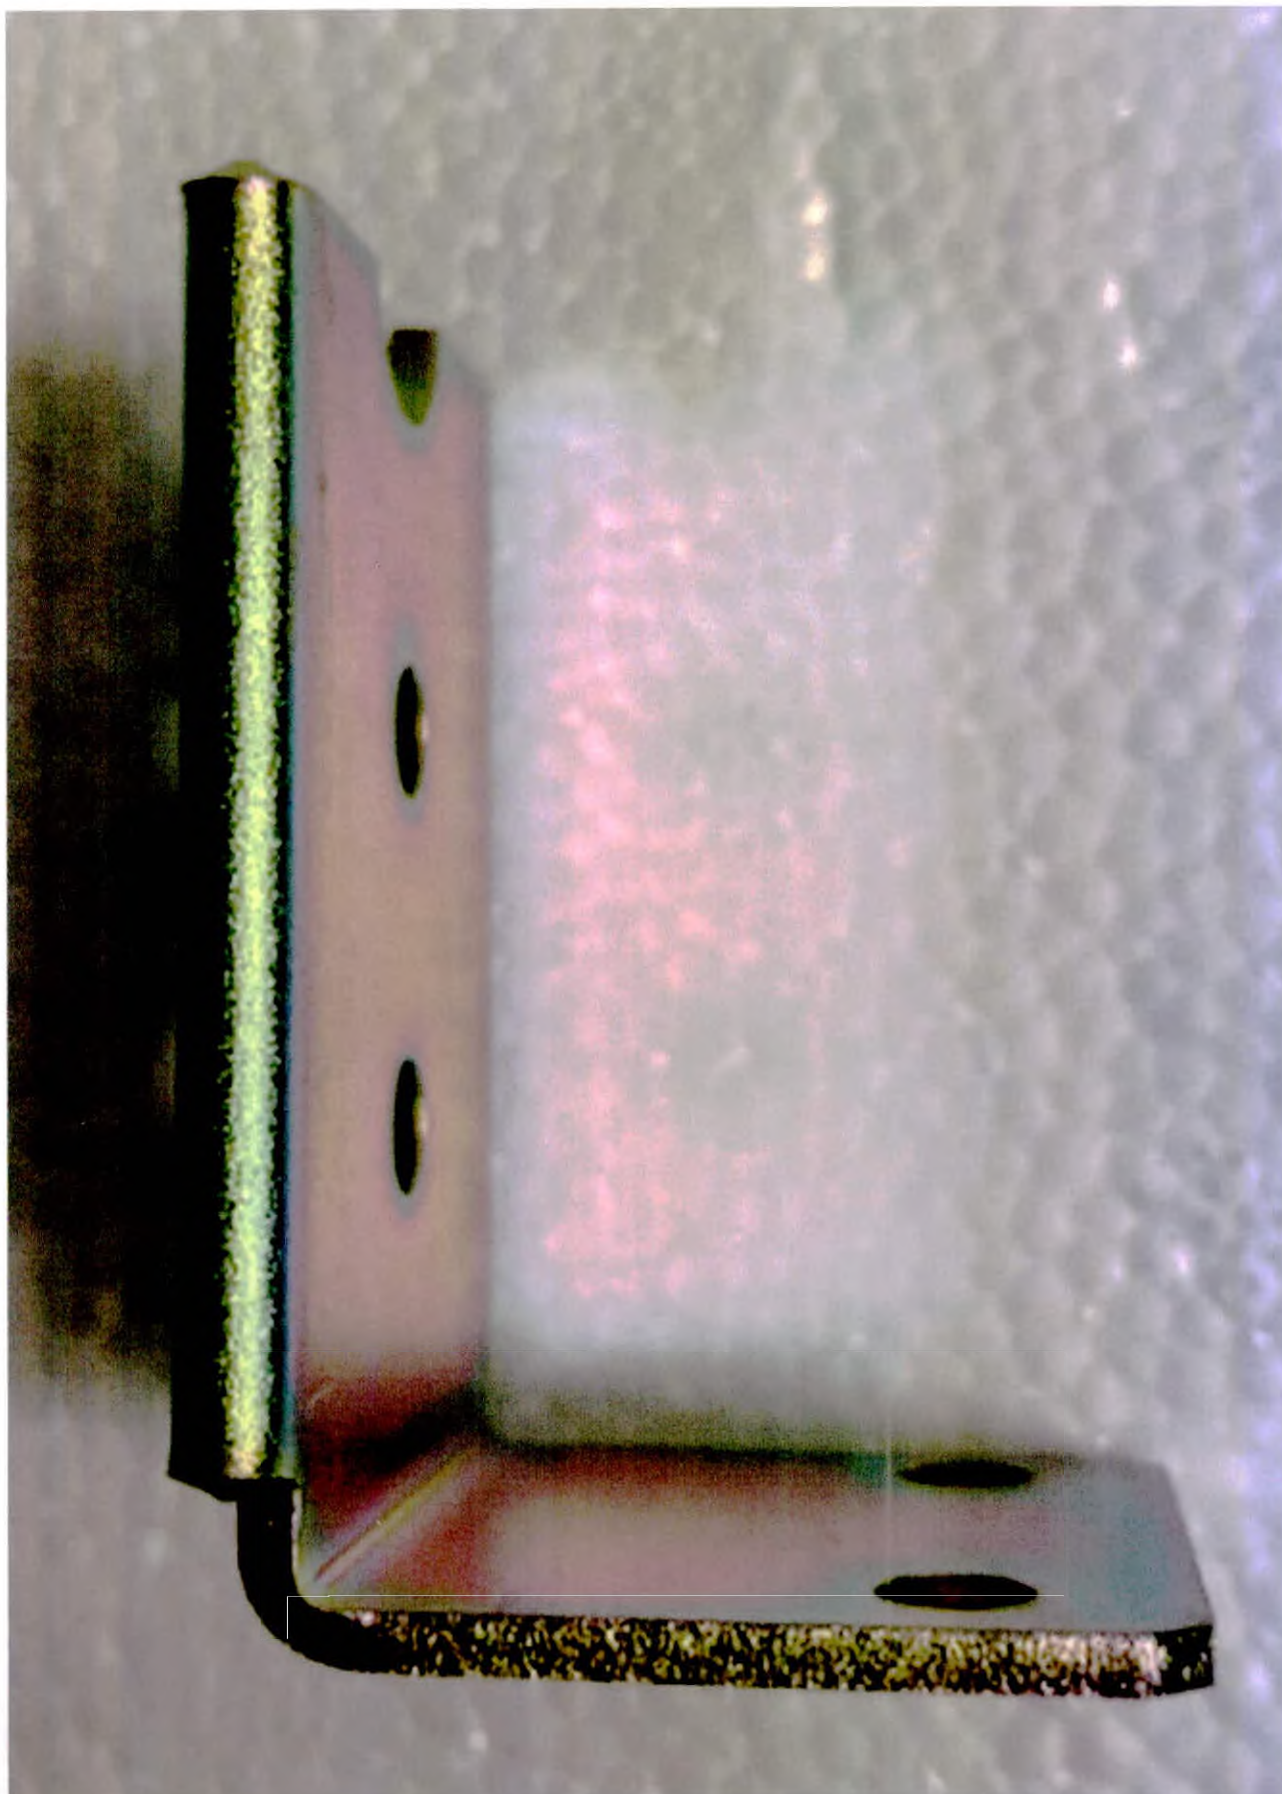


13.13. Скоба защитная для трубок – не более 10 шт. (при необходимости).

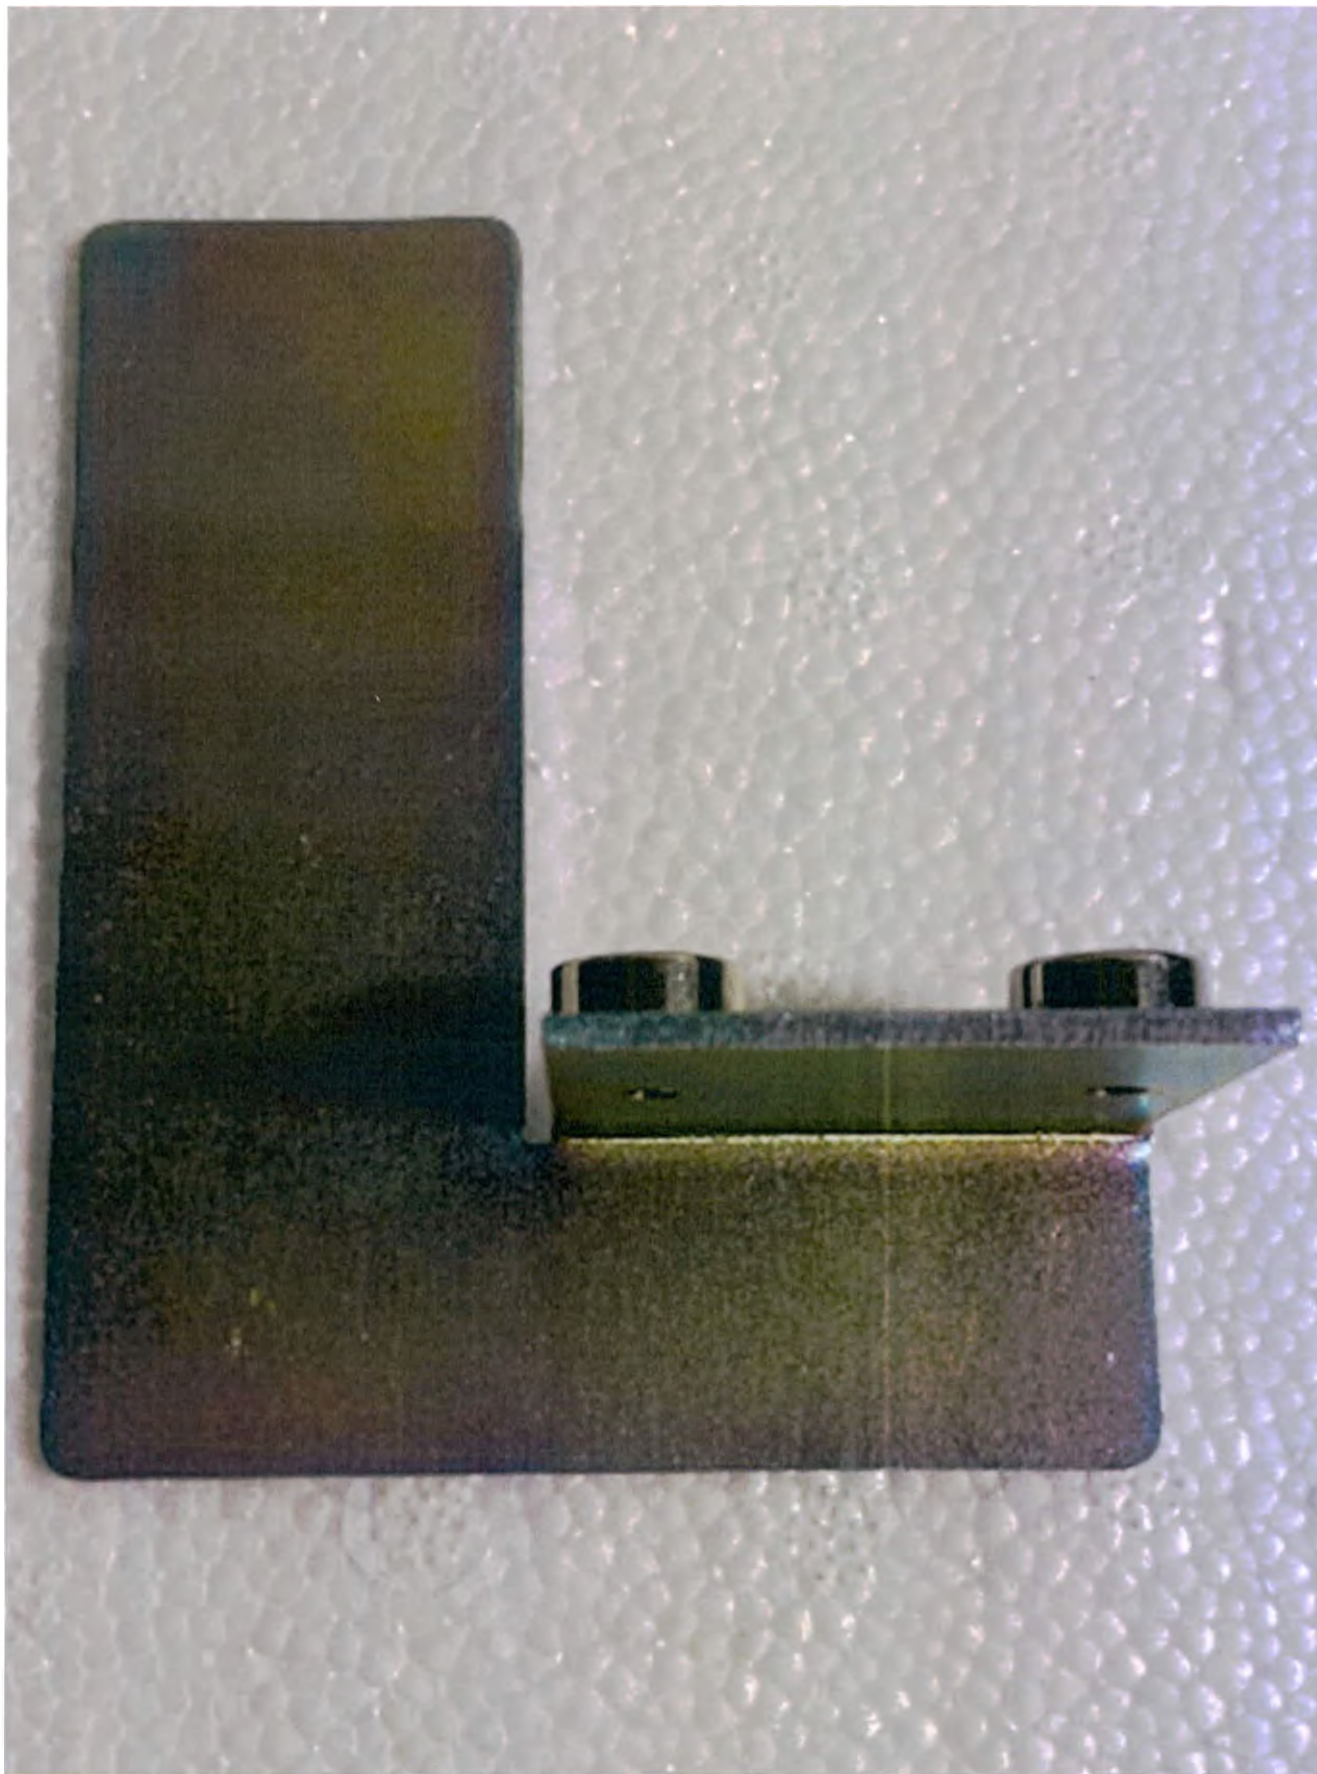


13.14. Полка для лизирующих реагентов – 1 шт. (при необходимости).




13.15. Полка для буферной емкости – 1 шт. (при необходимости).

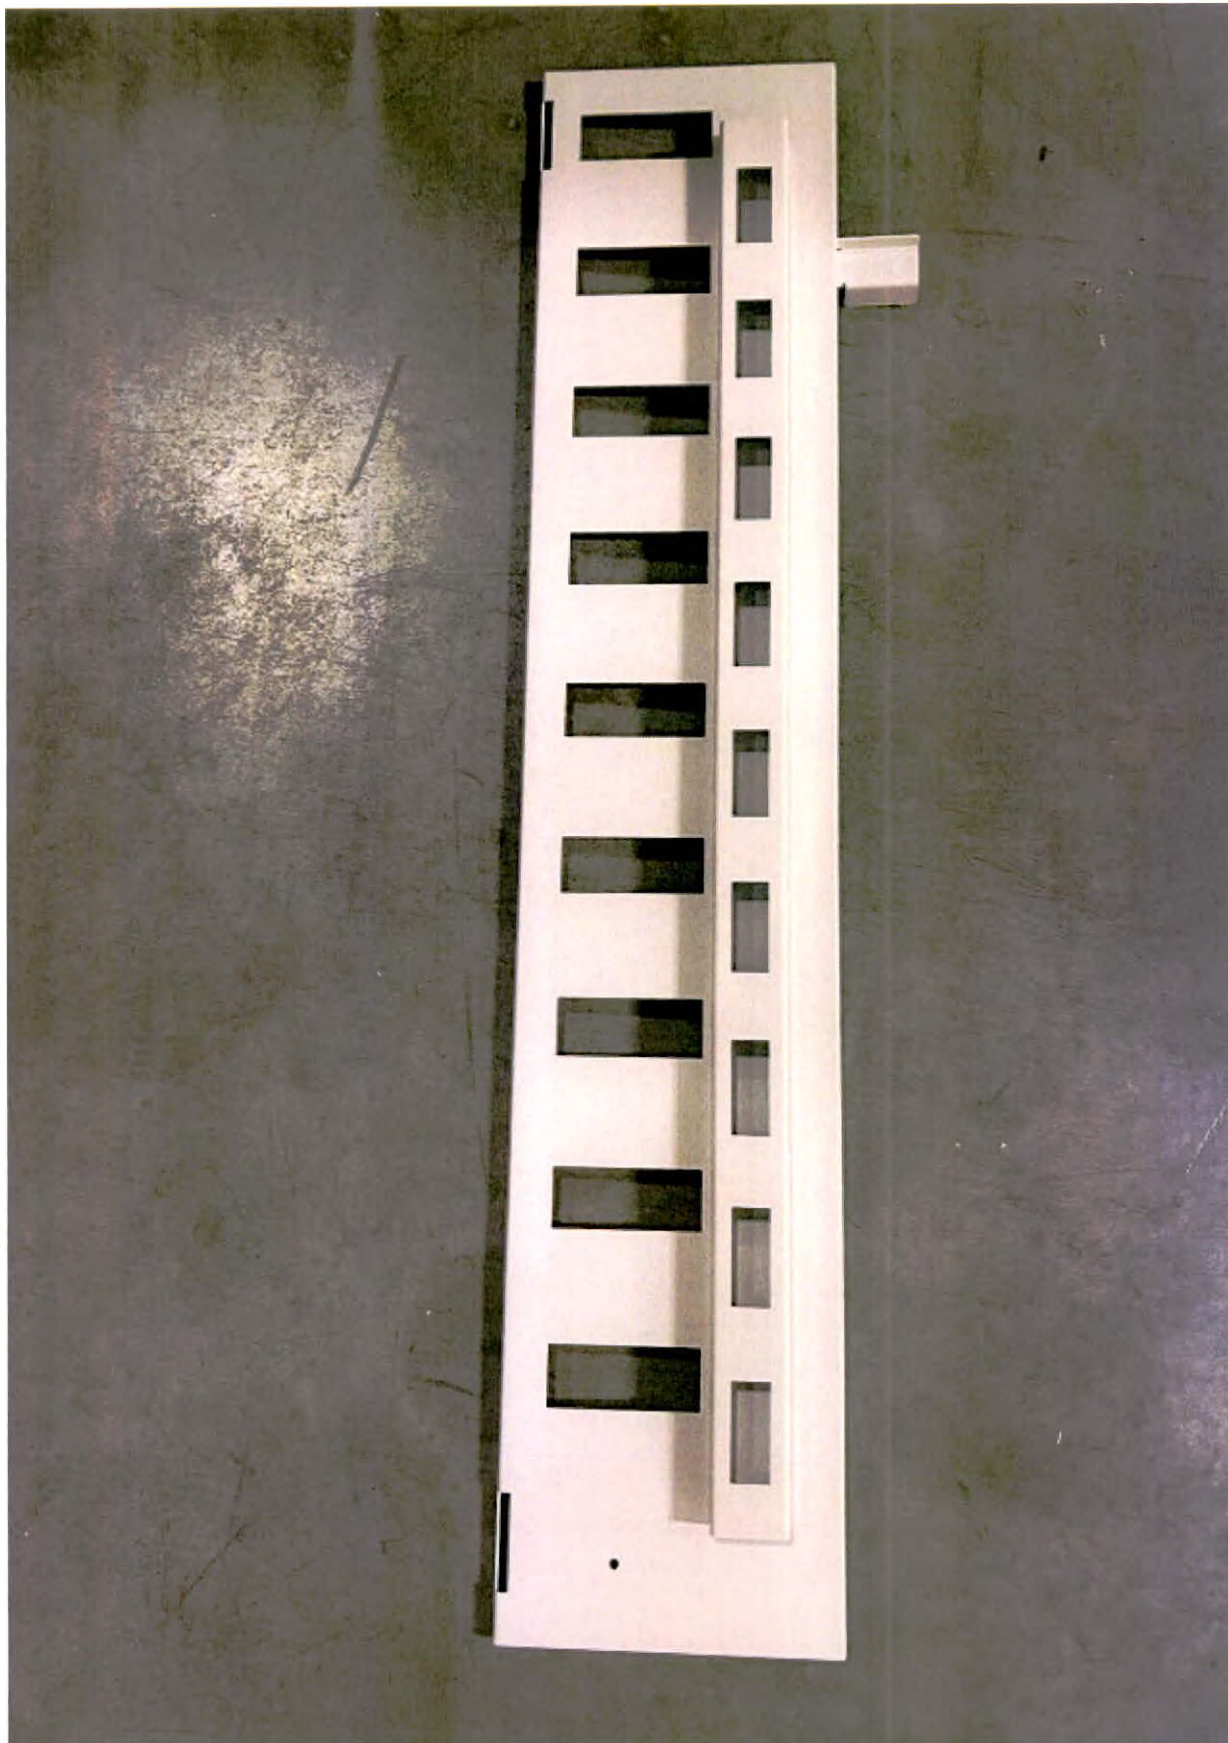

13.16. Полка для пневматических блоков – 1 шт. (при необходимости).

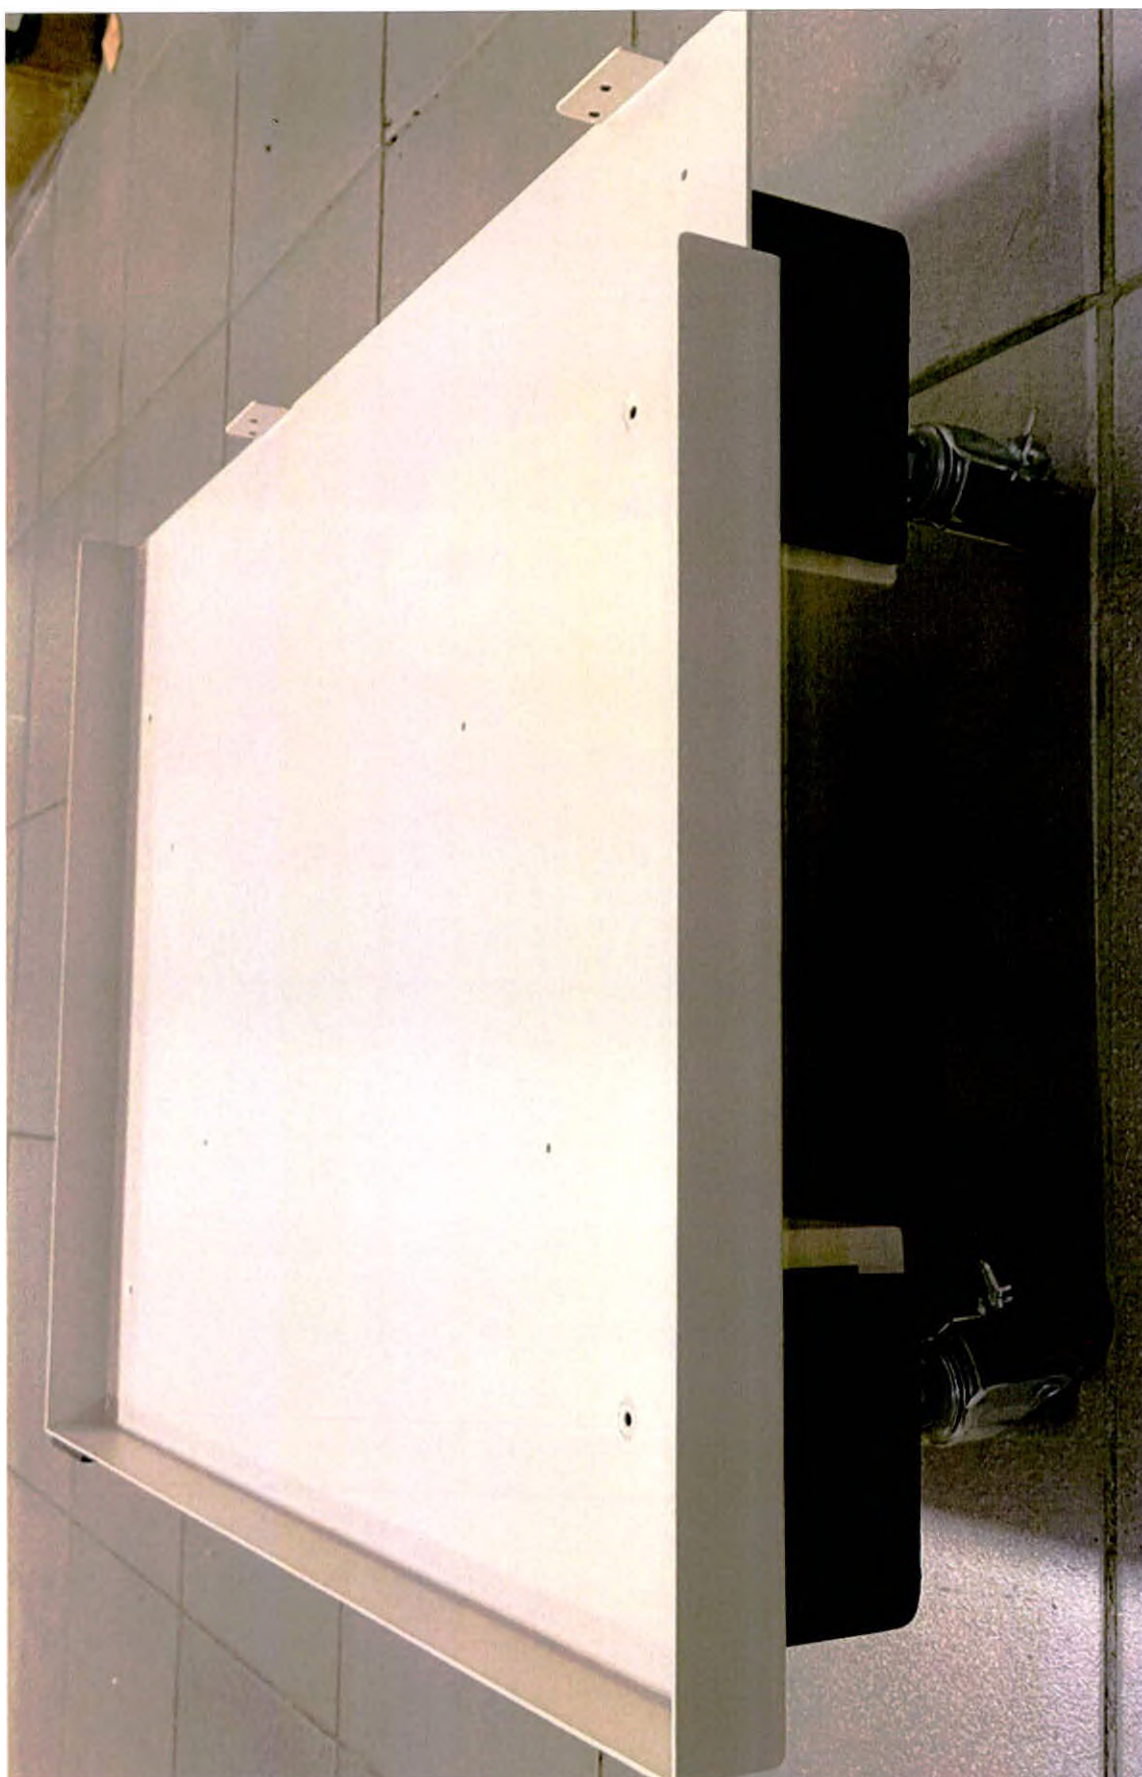


13.17. Полка для реагентов – 1 шт. (при необходимости).

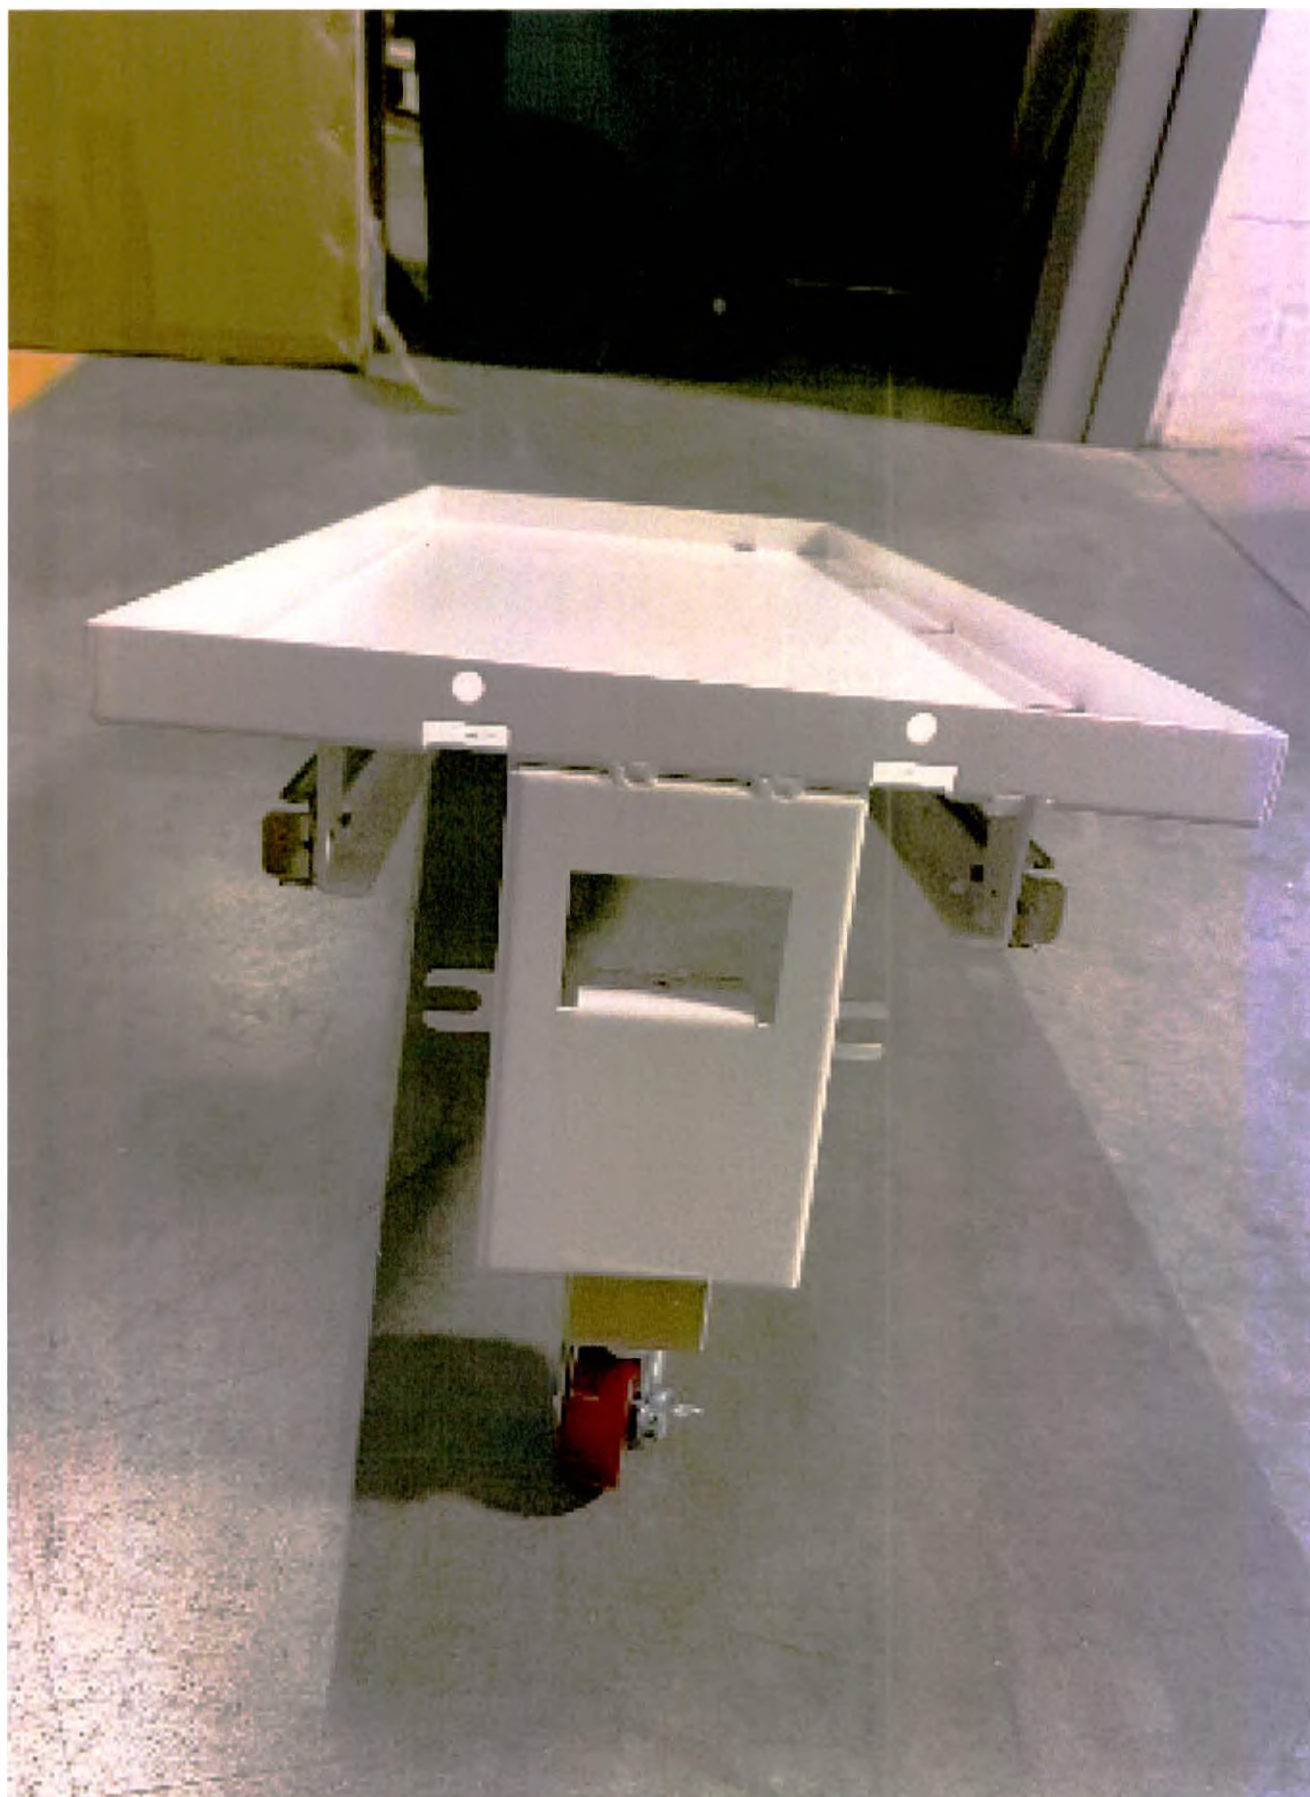

13.18. Полка для модуля CR-30[H] и емкостей концентрированного реагента – 1 шт. (при необходимости).




13.19. Рама для полок – 1 шт. (при необходимости).

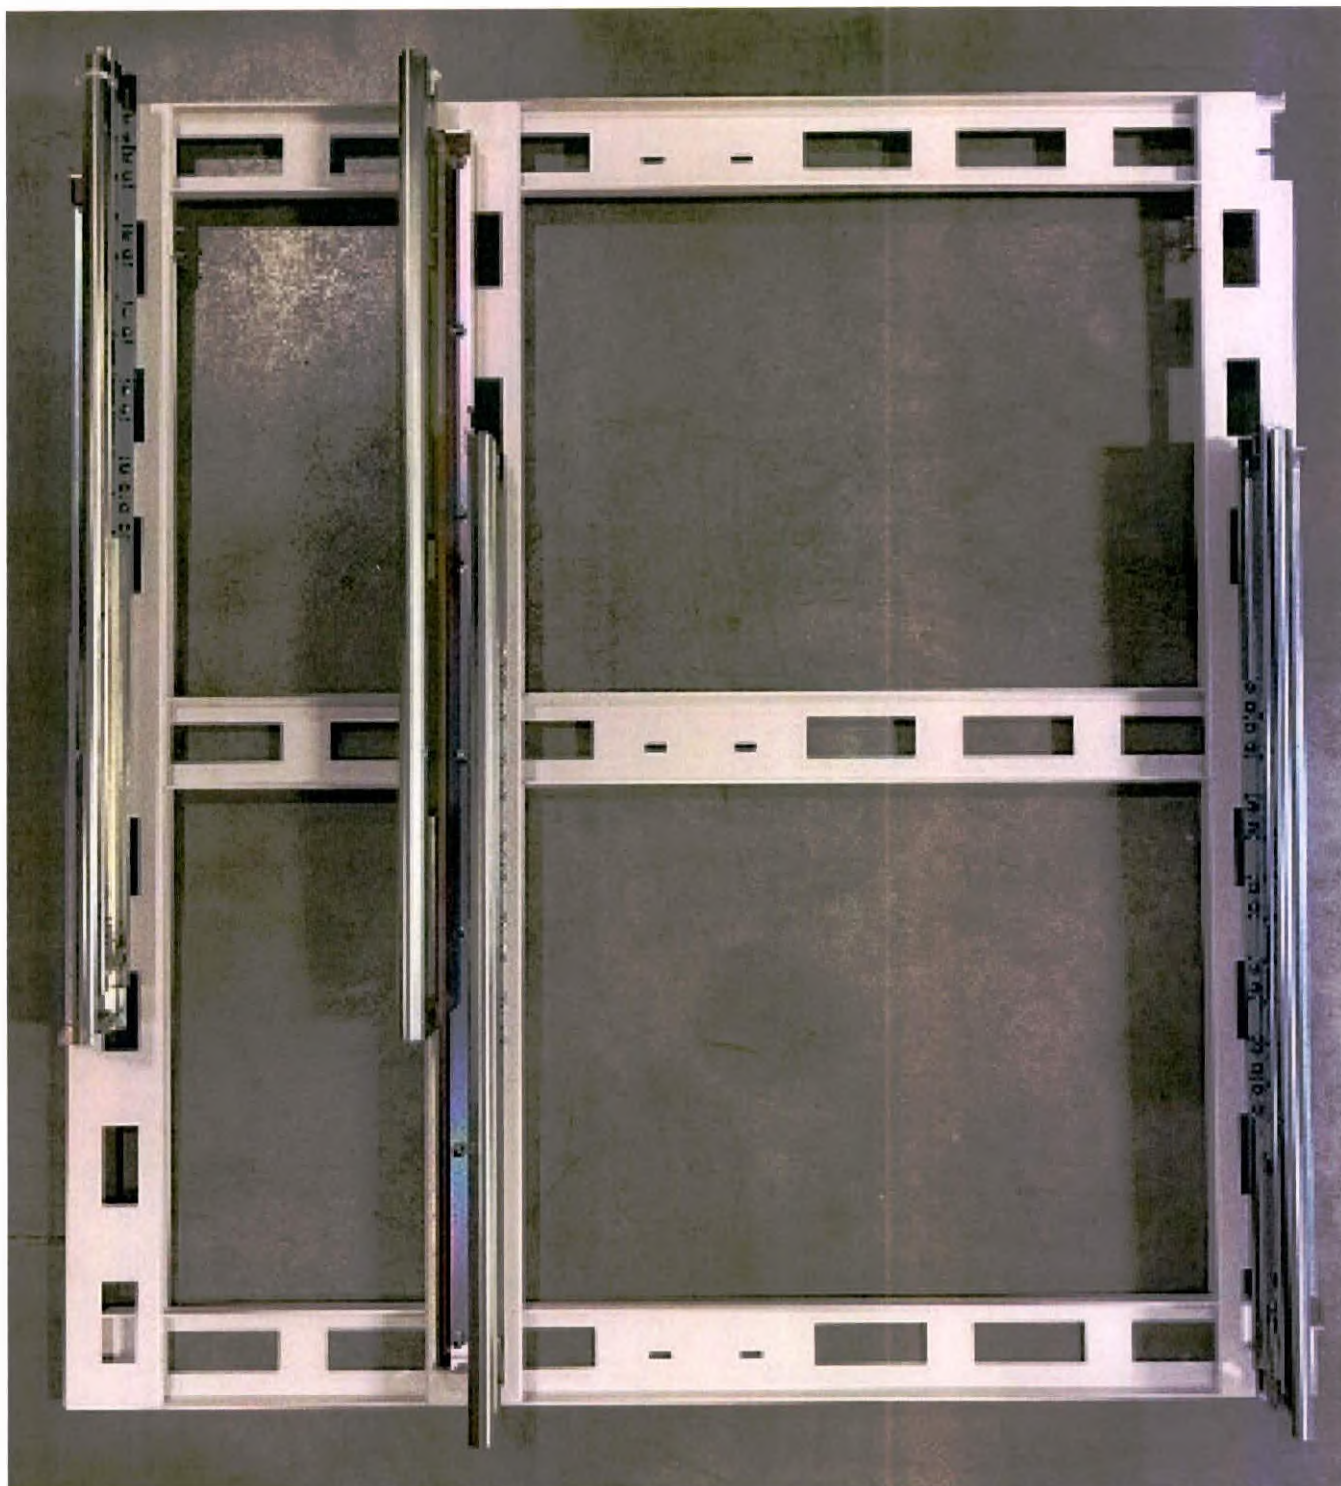

13.20. Рукоятка для перемещения полок – 1 шт. (при необходимости).




13.21. Рукоятка для перемещения полок увеличенная – 1 шт. (при необходимости).

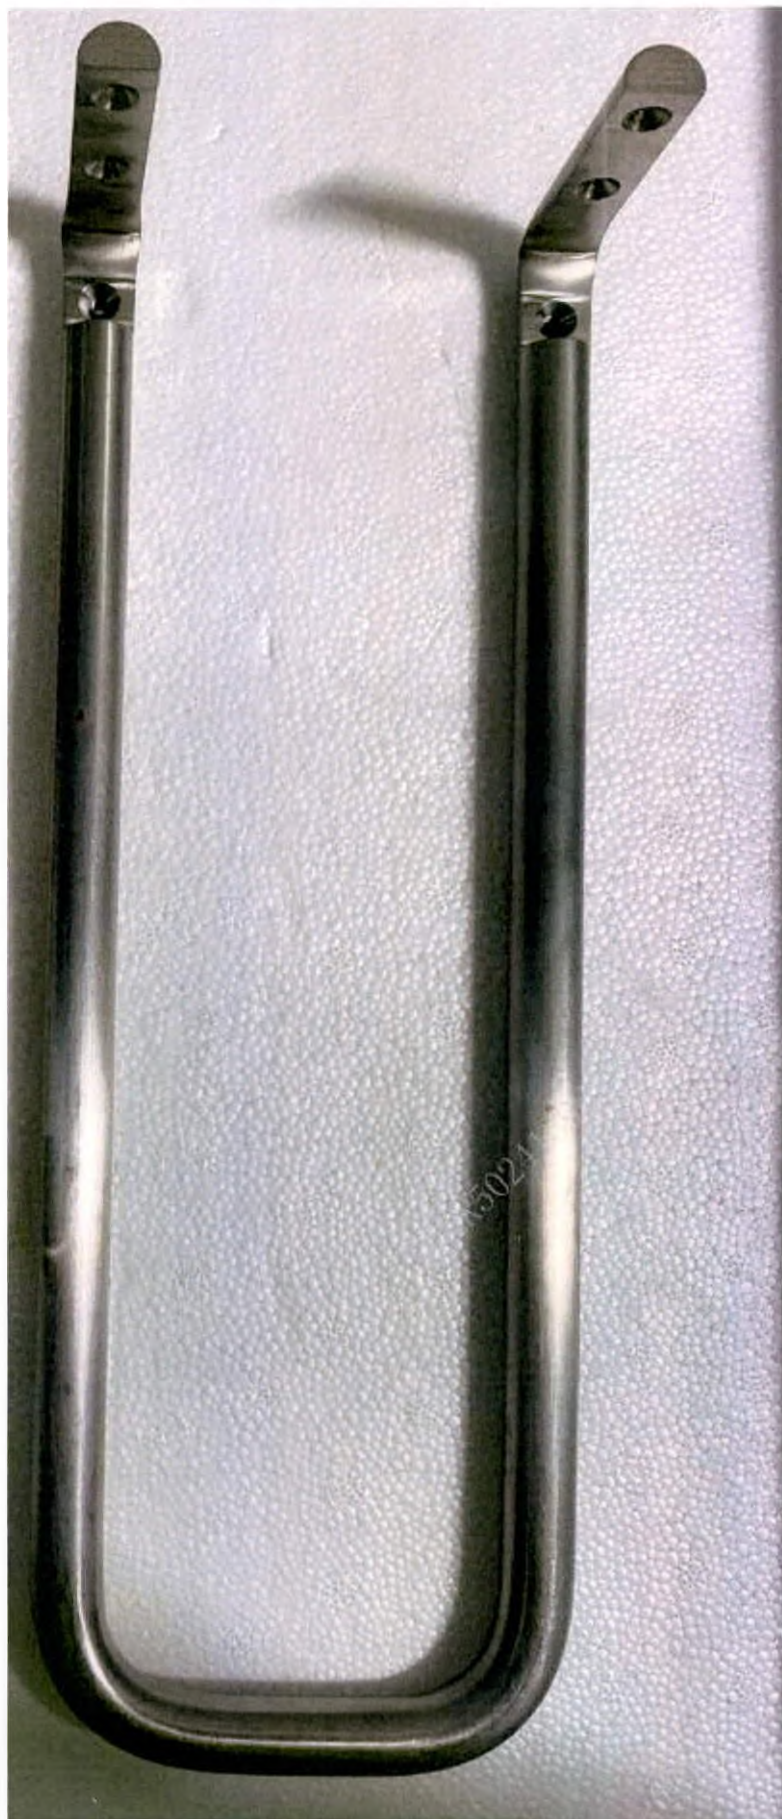

13.22. Кабель поплавкового датчика – 1 шт. (при необходимости).




13.23. Кабель для соединения модуля CR-30[H] и пневматического блока – 1 шт. (при необходимости).

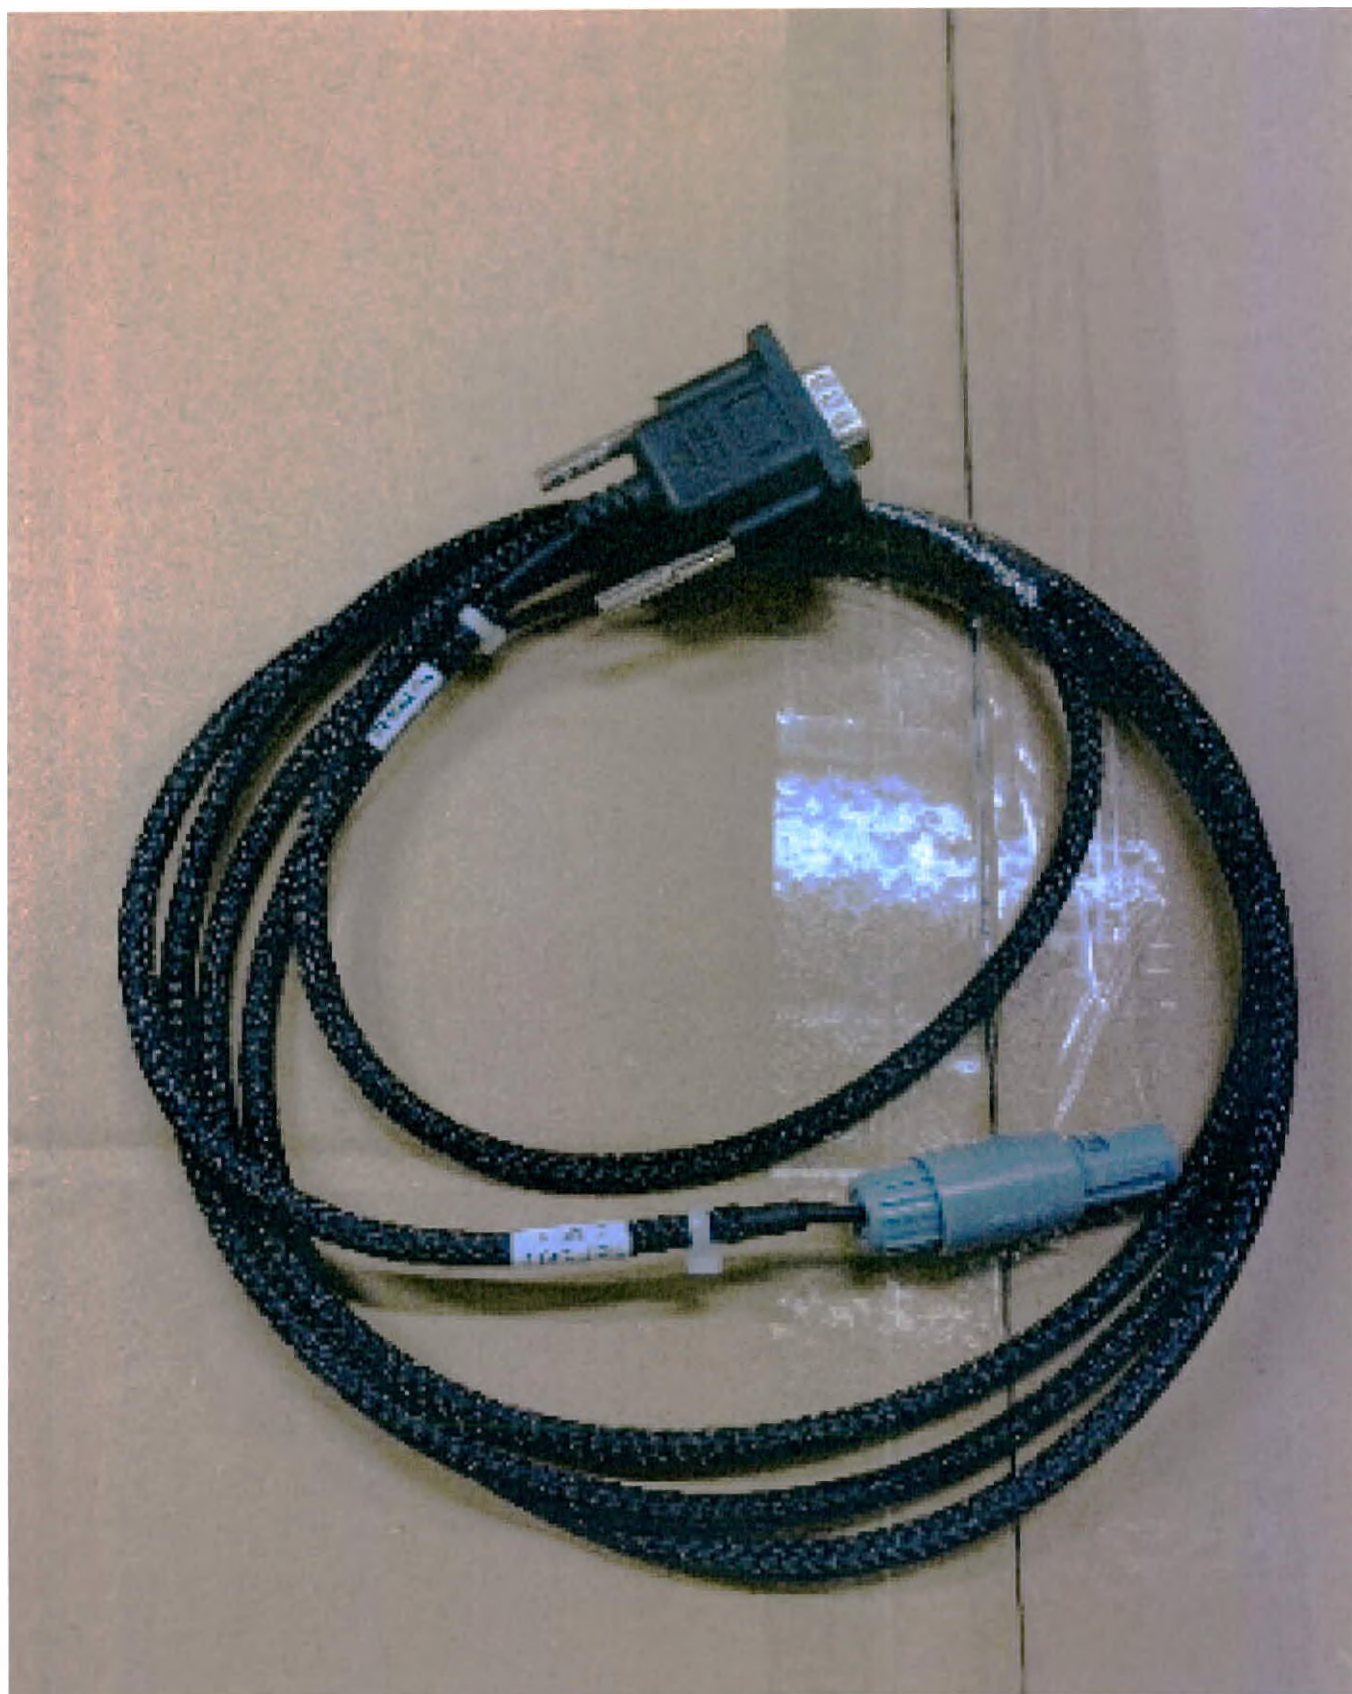

13.24. Кабель поплавкового датчика для прибора SC-120 – 1 шт. (при необходимости).



13.25. Разветвитель кабеля поплавкового датчика – 1 шт. (при необходимости).

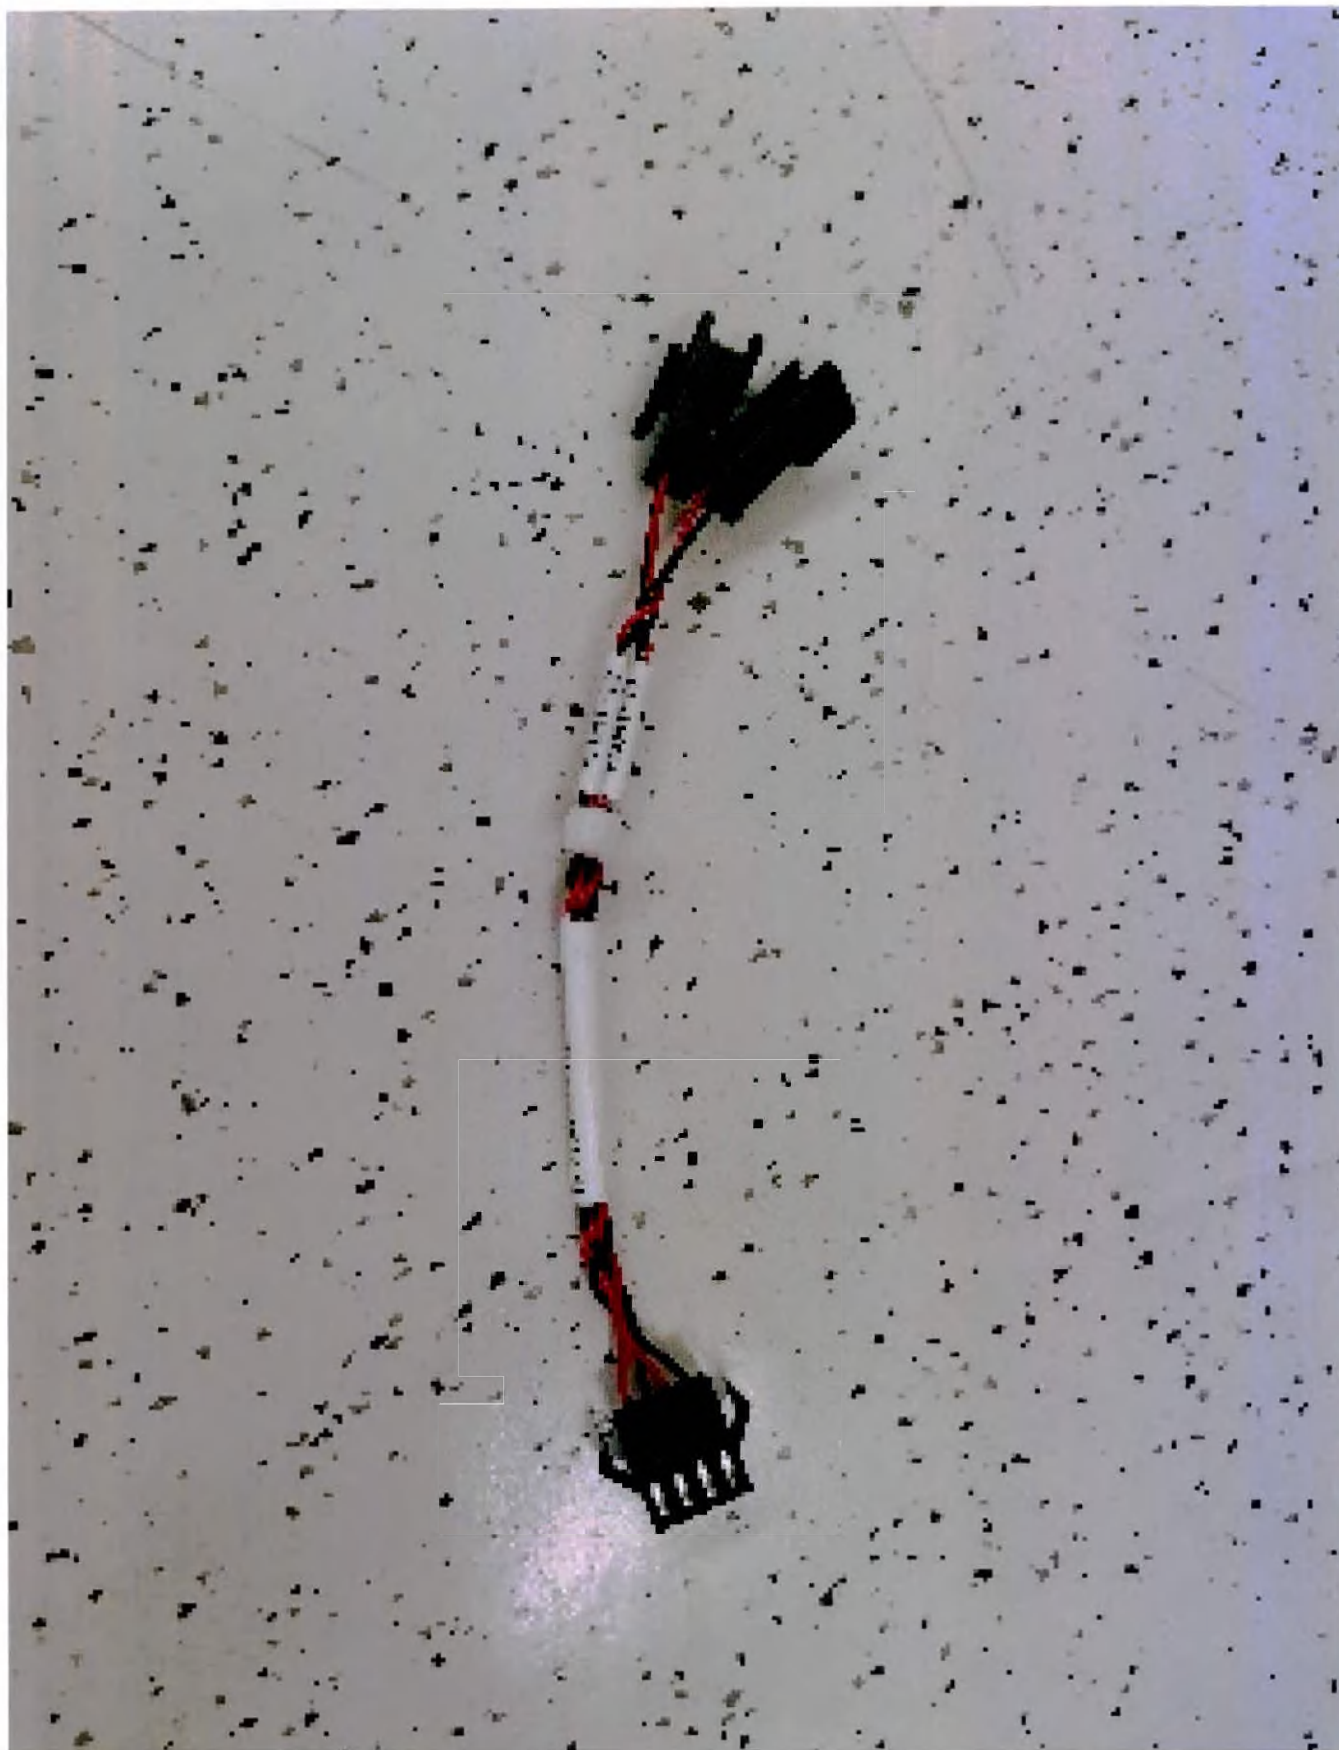

Фотографическое изображения транспортной упаковки монитора загрузочного модуля



mindray

Date: 2023-03-27

SN:



TS-33001805

P/N:



021-000128-00

W#:



96506724

Ordering NO:



5300326280 30

(11 OF 11)



Monitor

Model: CAL 8000

Size: 600mmx260mmx470mm

N.W.: 5.0kg

G.W.: _ Б Б _ kg

Qty: 1

Tel: +86-755-81888998

Fax: +86-755-26582680



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

14. Монитор грузозночного модуля – 1 шт. (при необходимости).



Маркировка монитора загрузочного модуля

LCD Monitor 液晶显示器


Model 型号: C22WT

Input 输入电源: 12V == 5.0A

S/N 序列号:



C22WTB23090058



WaiKang Ltd.
Suite 8
20 Hakeby Street
London, W1G 8QS
United Kingdom



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

制造商: 深圳市巨烽显示科技有限公司
Manufacturer: Shenzhen Beazon Display Technology Co., Ltd.

地址: 深圳市福田区华强北路1001号南山智园东1座12楼
Address: 12F, Block B1, Nanshan Zhuyuan, No.1001 Eeruyuan Road,
Fushan District, Shenzhen, 518055 China
中国深圳 MADE IN CHINA

Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:

14. Монитор загрузочного модуля

Производитель:

Шэньчжэнь МайндрэйБио-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**


ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
д. 16, стр. 5, ан./пом 4М, ком. 7, 11а

Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

15. Кронштейн для монитора загрузочного модуля – 1 шт. (при необходимости).

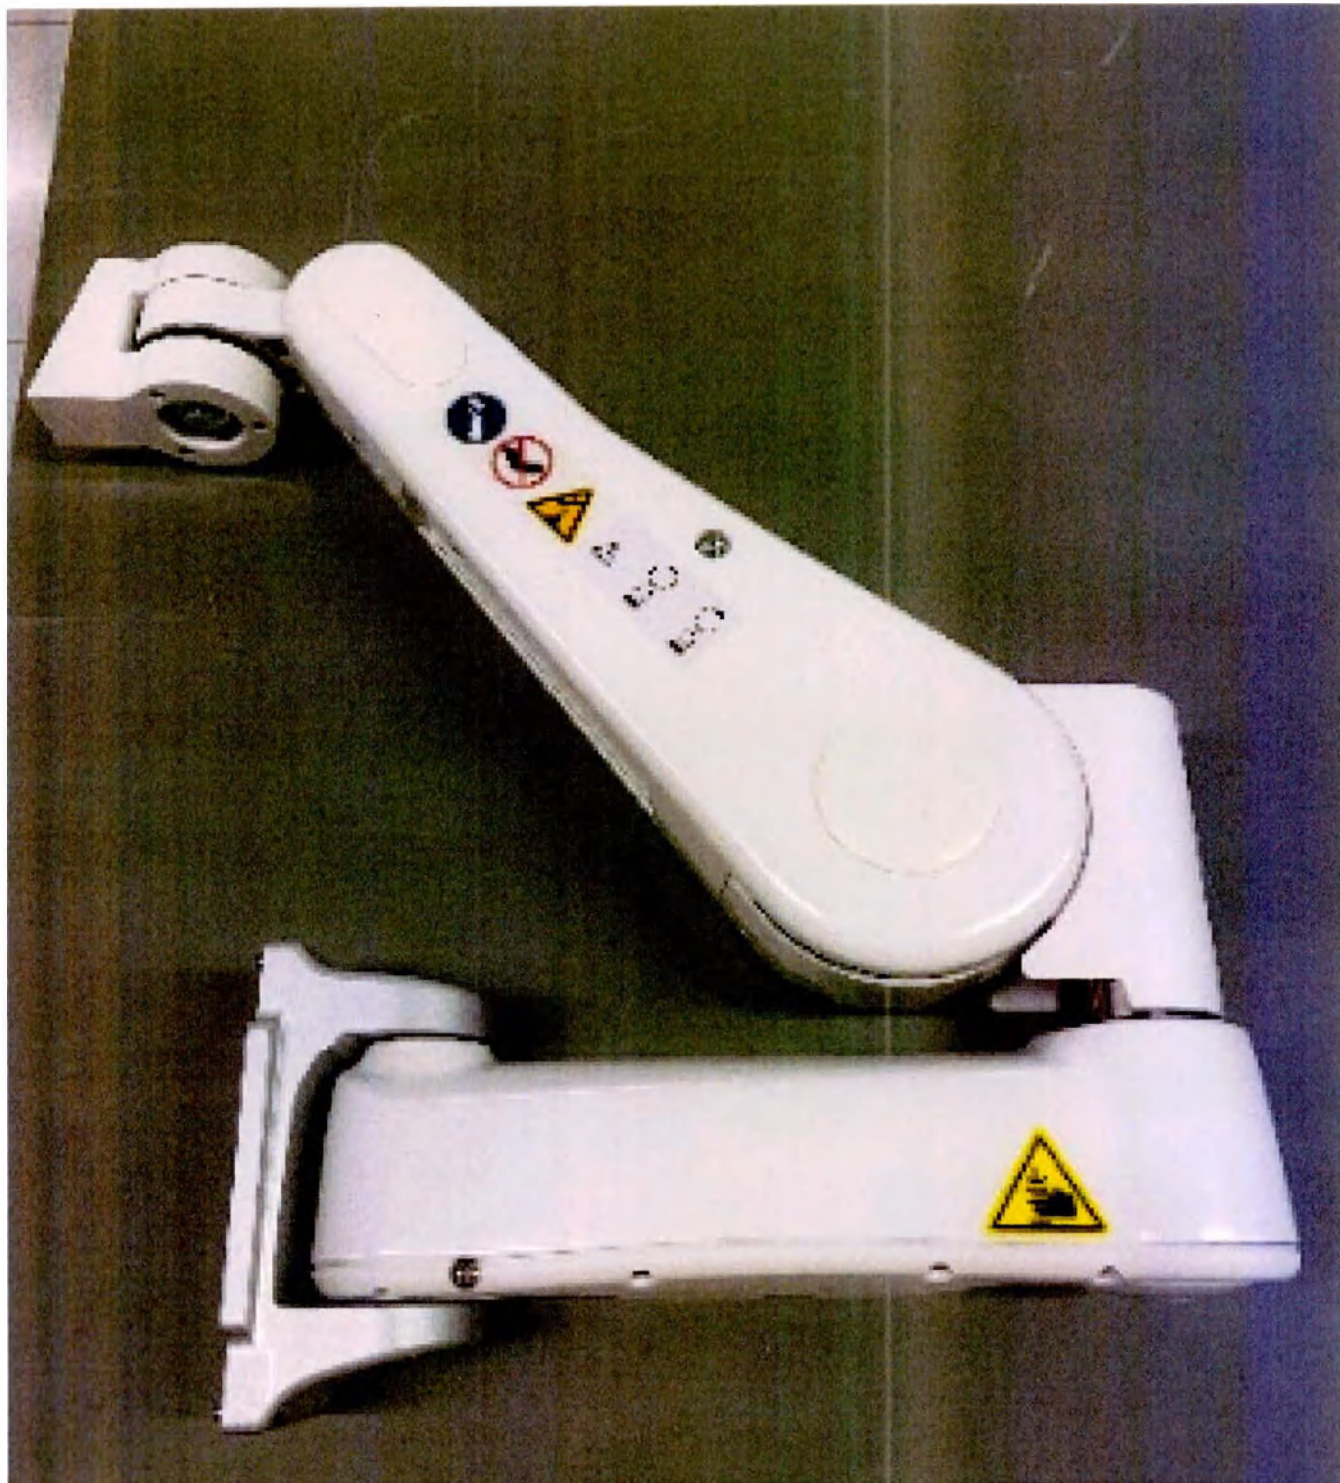


16. Штатив для пробирок – не более 60 шт. (при необходимости).




Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»

17. Штатив для пробирок для контроля качества (QC) – не более 3 шт. (при необходимости).

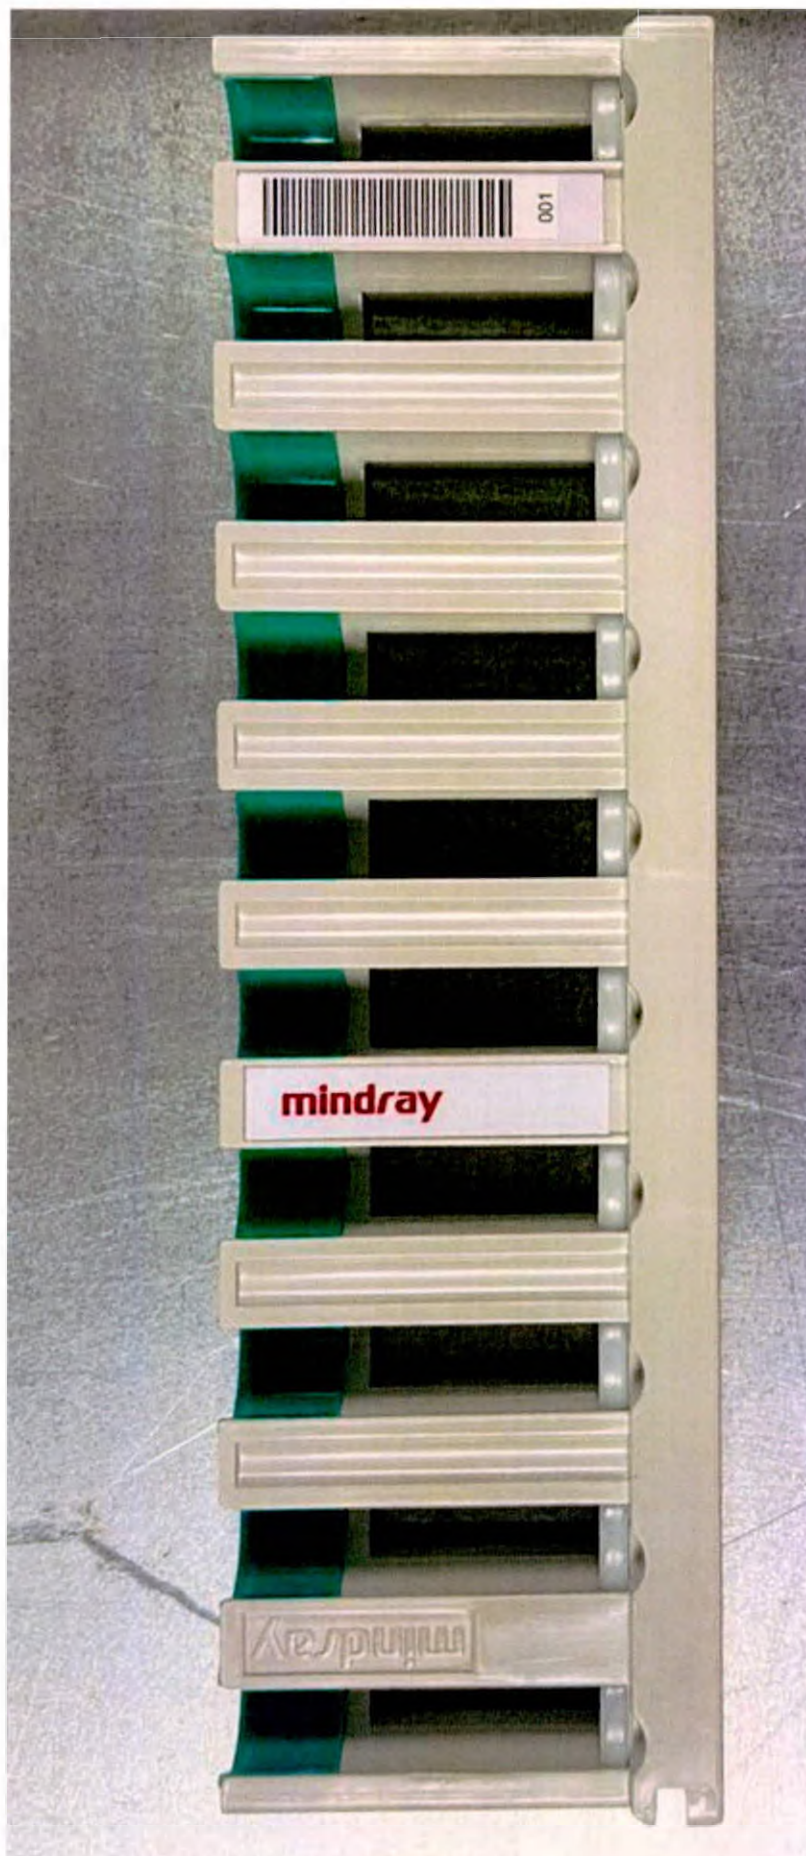

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»

18. Штатив для пробирок для нанесения мазка – не более 20 шт. (при необходимости).

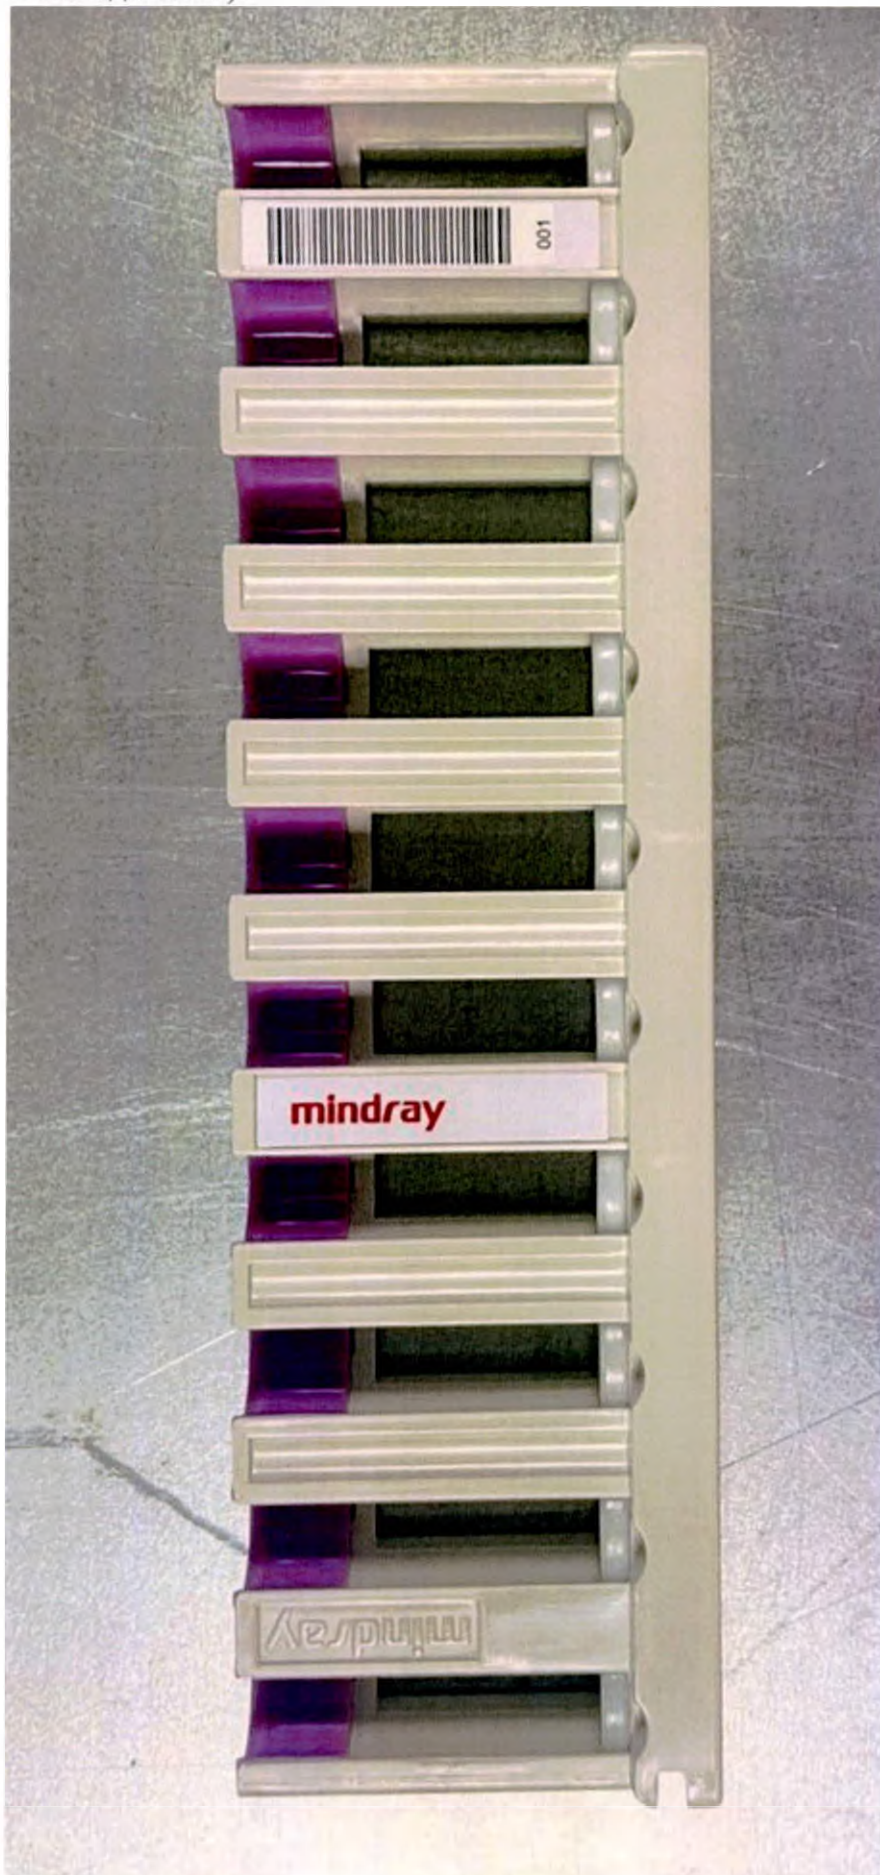

19. Верхняя правая панель кабинета модуля анализатора гематологического – не более 4 шт. (при необходимости).




20. Верхняя левая панель кабинета модуля анализатора гематологического – не более 4 шт. (при необходимости).




21. Задняя верхняя панель кабинета модуля анализатора гематологического – не более 4 шт. (при необходимости).



22. Правая верхняя панель кабинета модуля прибора SC-120 – не более 2 шт.
(при необходимости).

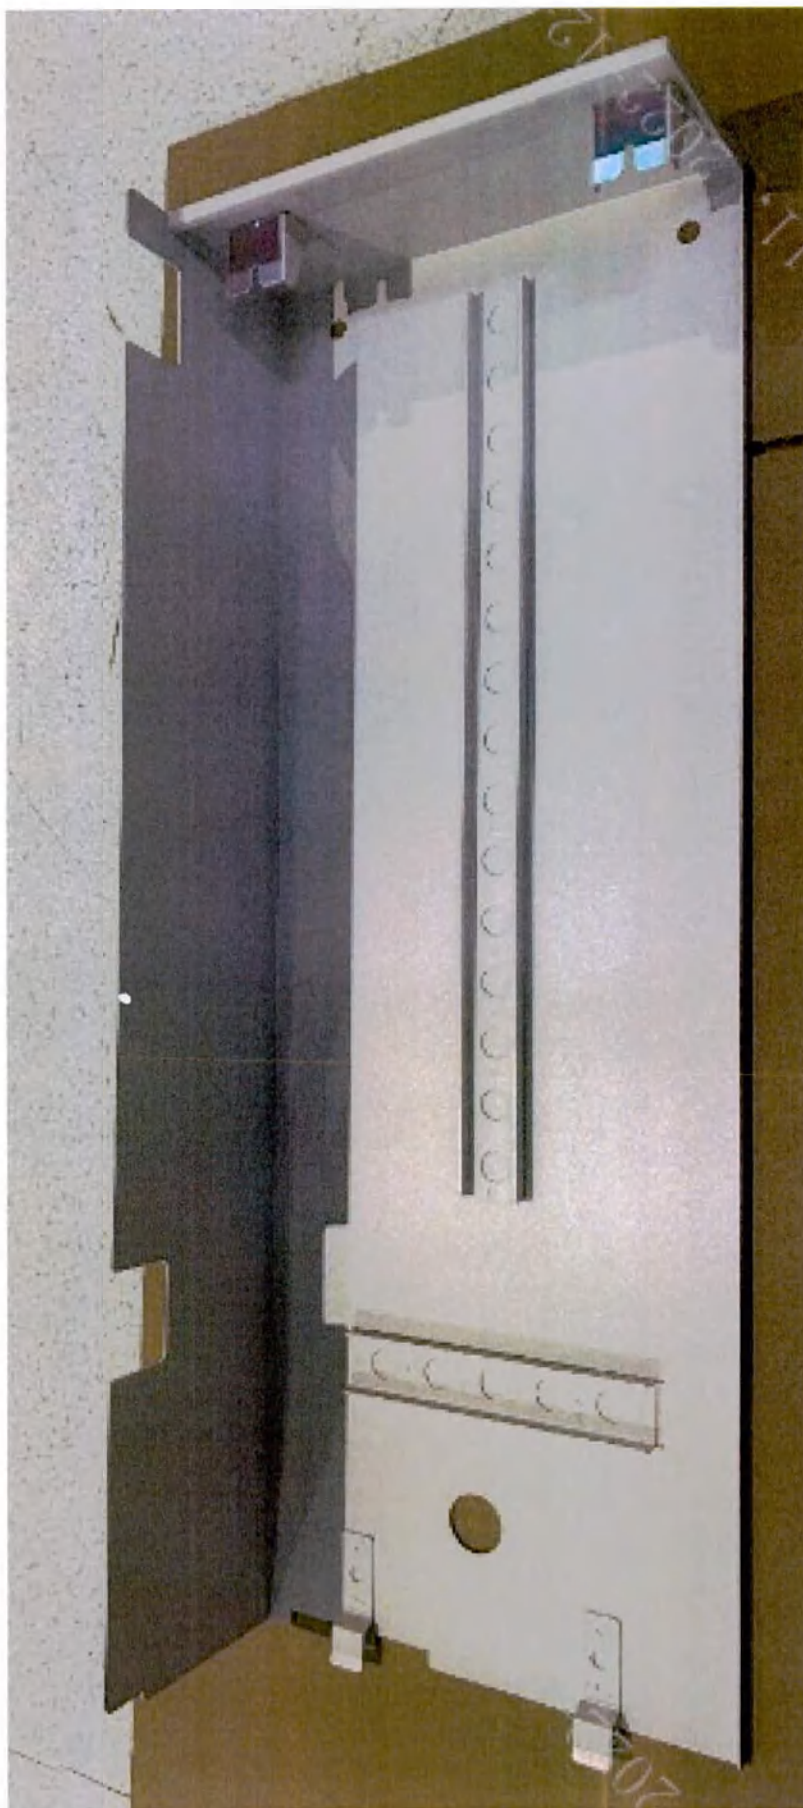

23. Левая верхняя панель кабинета модуля прибора SC-120 – не более 2 шт.
(при необходимости).

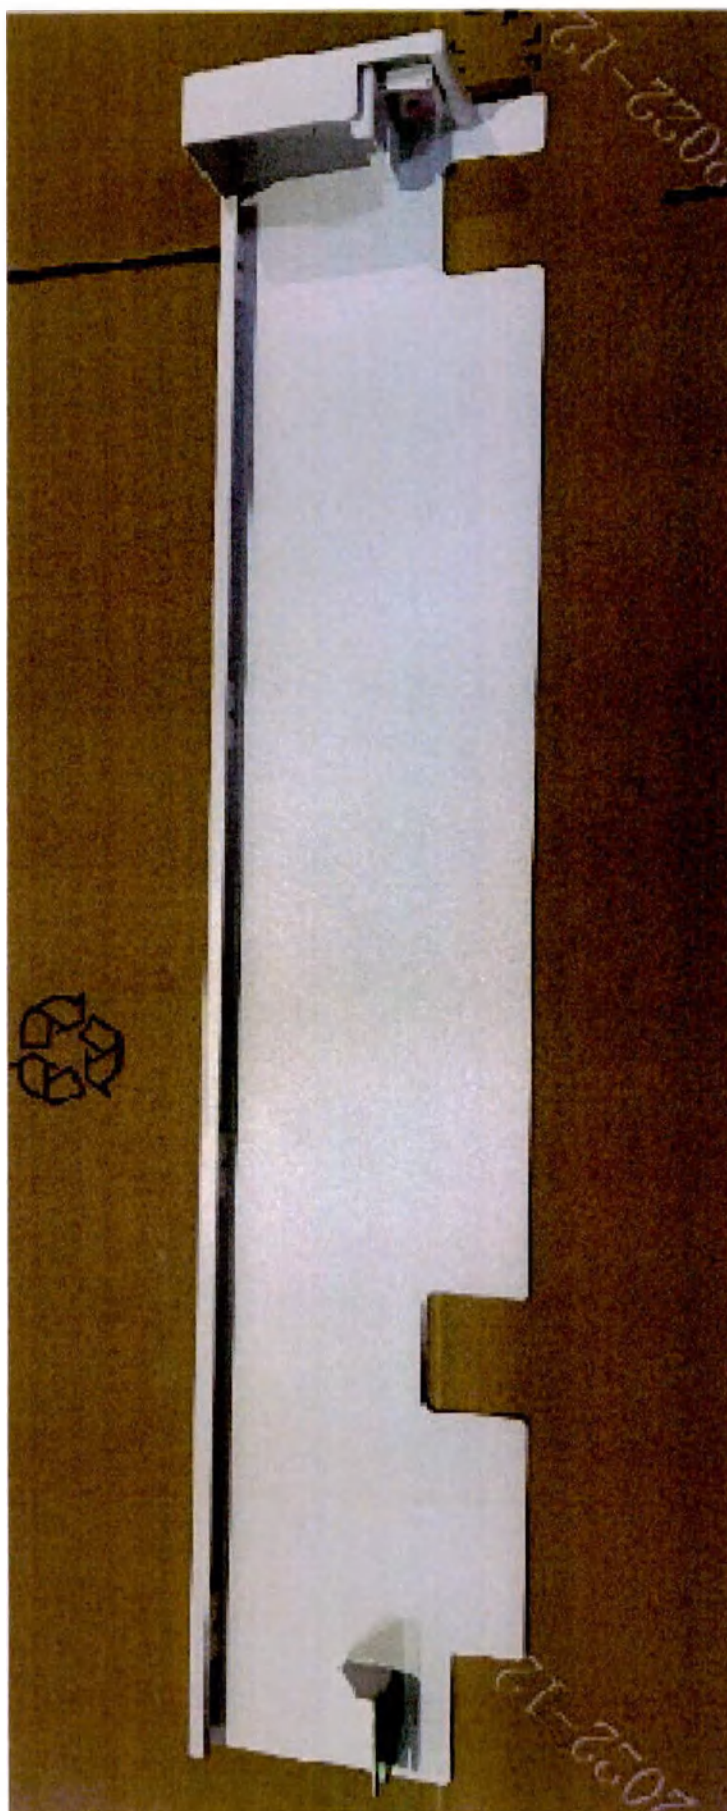


24. Задняя верхняя панель кабинета модуля прибора SC-120 – не более 2 шт. (при необходимости).



25. Торцевая панель – не более 4 шт. (при необходимости).



26. Передняя панель внутренней электропроводки удлиненная – не более 2 шт.
(при необходимости).

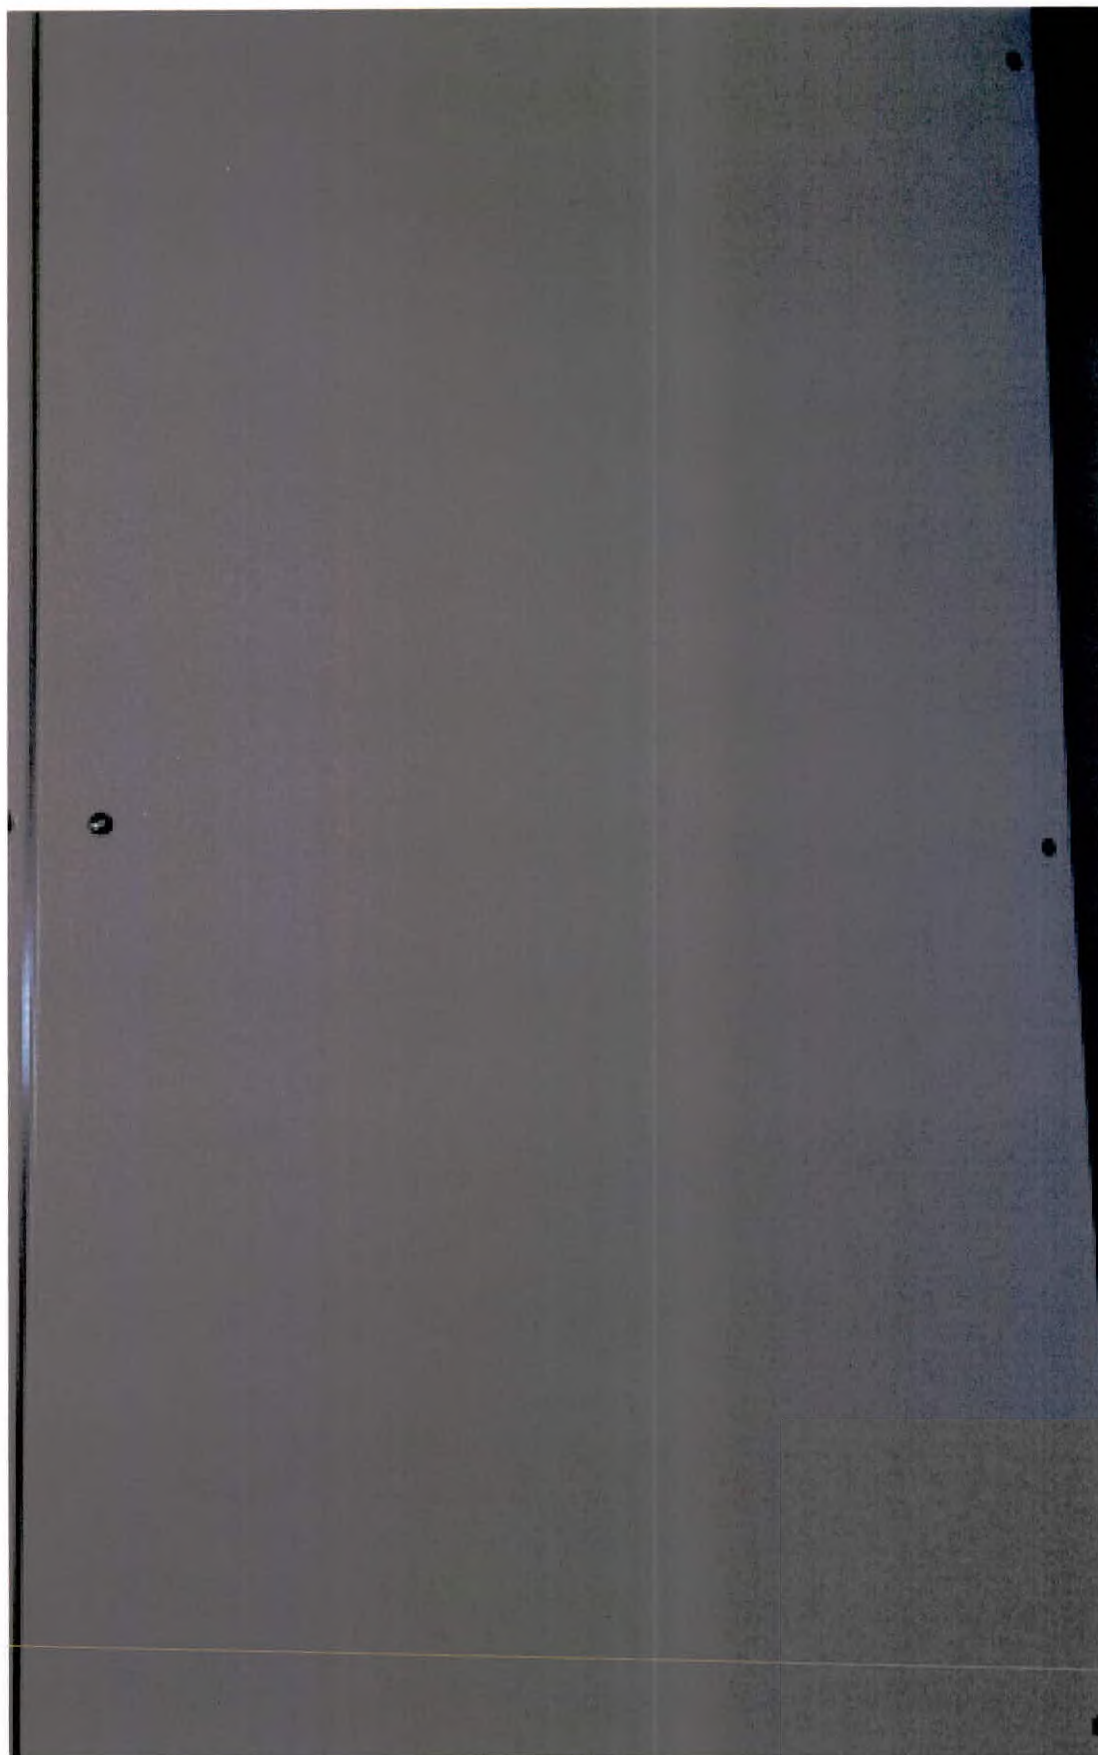

27. Передняя панель внутренней электропроводки – не более 2 шт. (при необходимости).



28. Средняя правая панель— не более 4 шт. (при необходимости).




29. Средняя левая панель – не более 4 шт. (при необходимости).




30. Защитная панель для ВС-6800 – не более 8 шт. (при необходимости).




31. Панель сканера – не более 8 шт. (при необходимости).

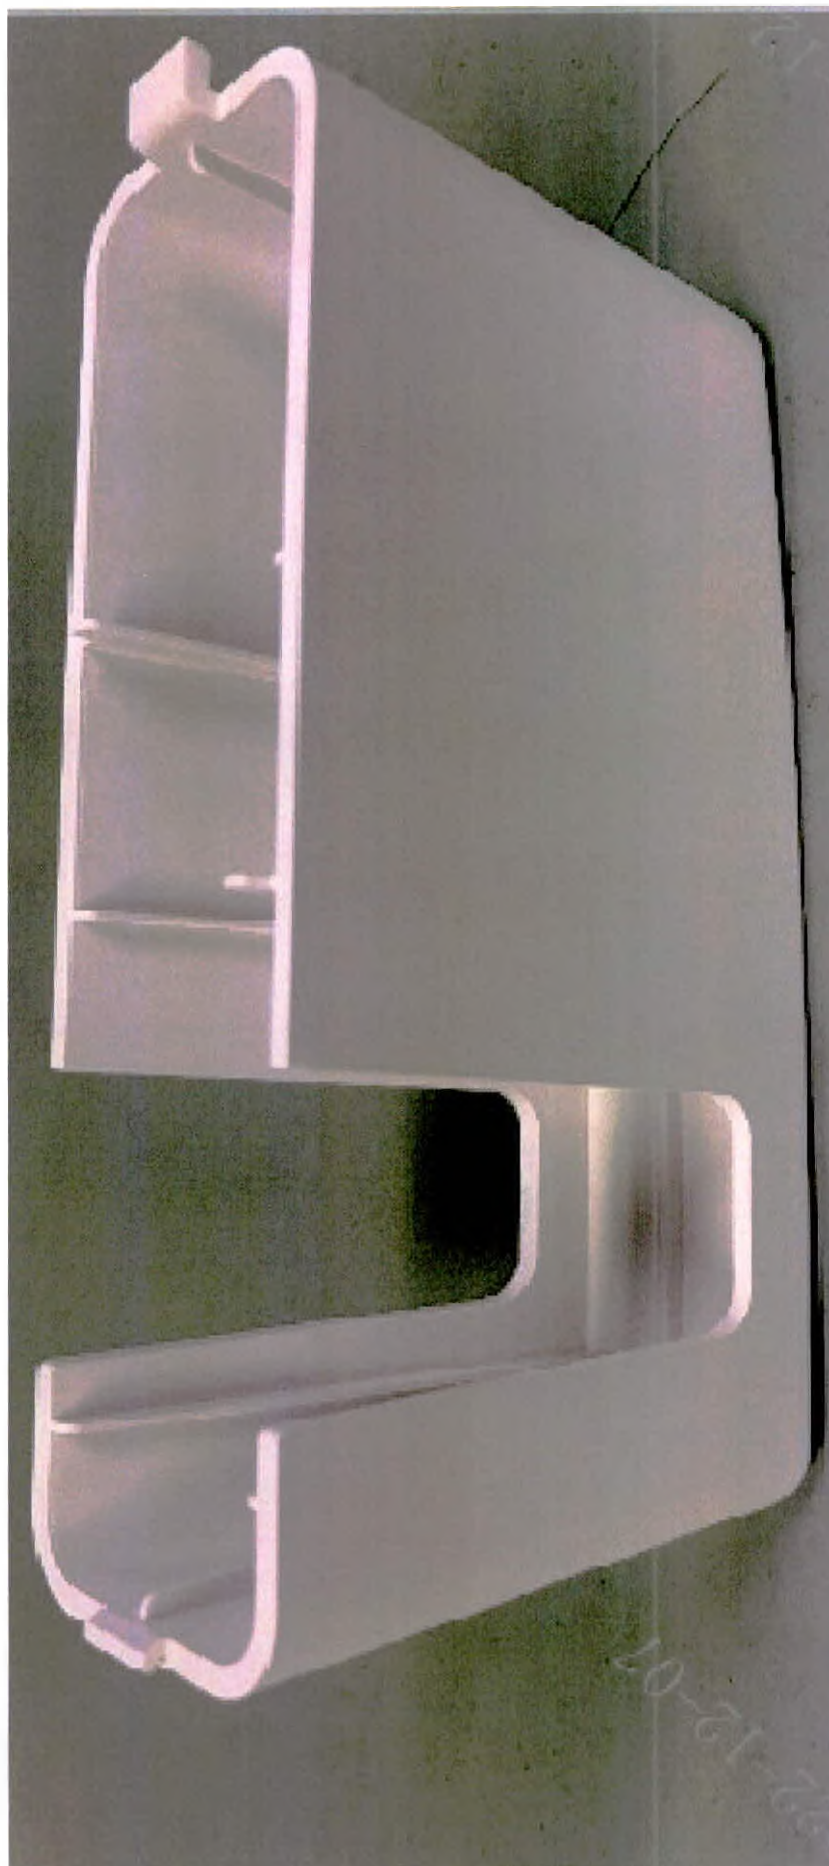


32. Передняя верхняя защитная панель для модуля транспортировки кассет
– не более 2 шт. (при необходимости).

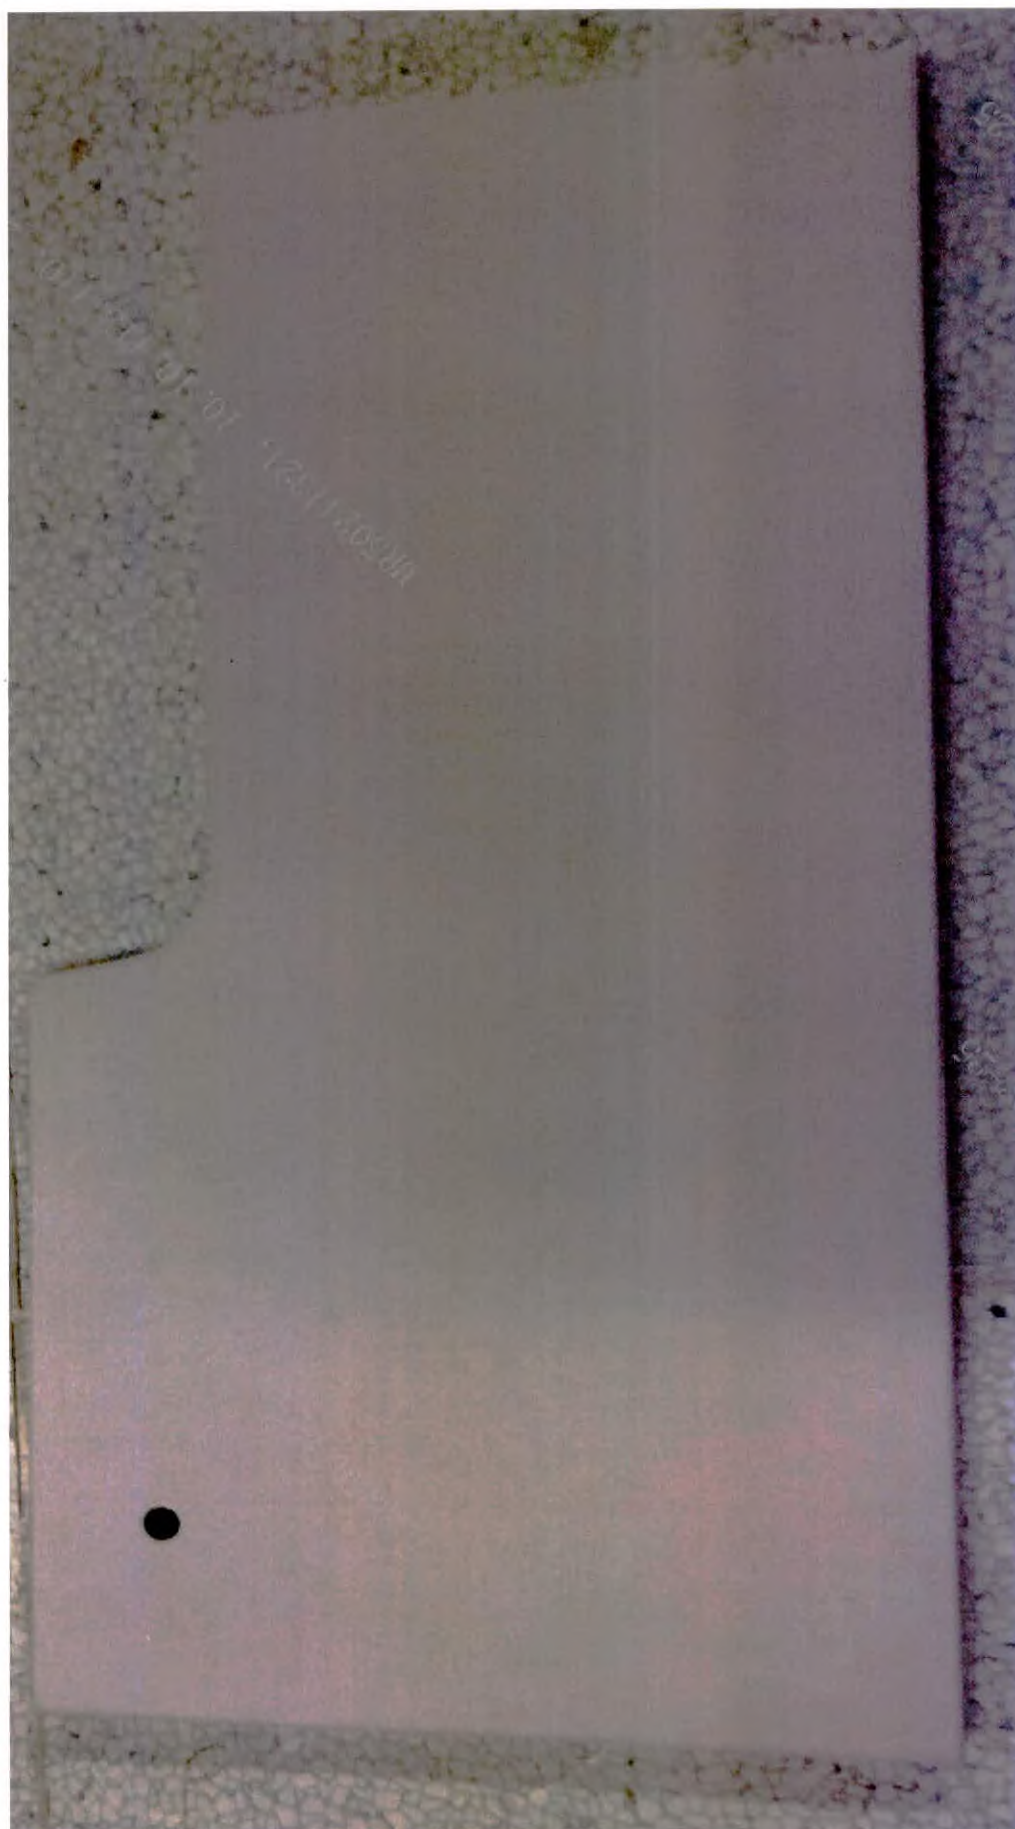


33. Панель разгрузочной области прибора SC-120 – не более 2 шт. (при необходимости).

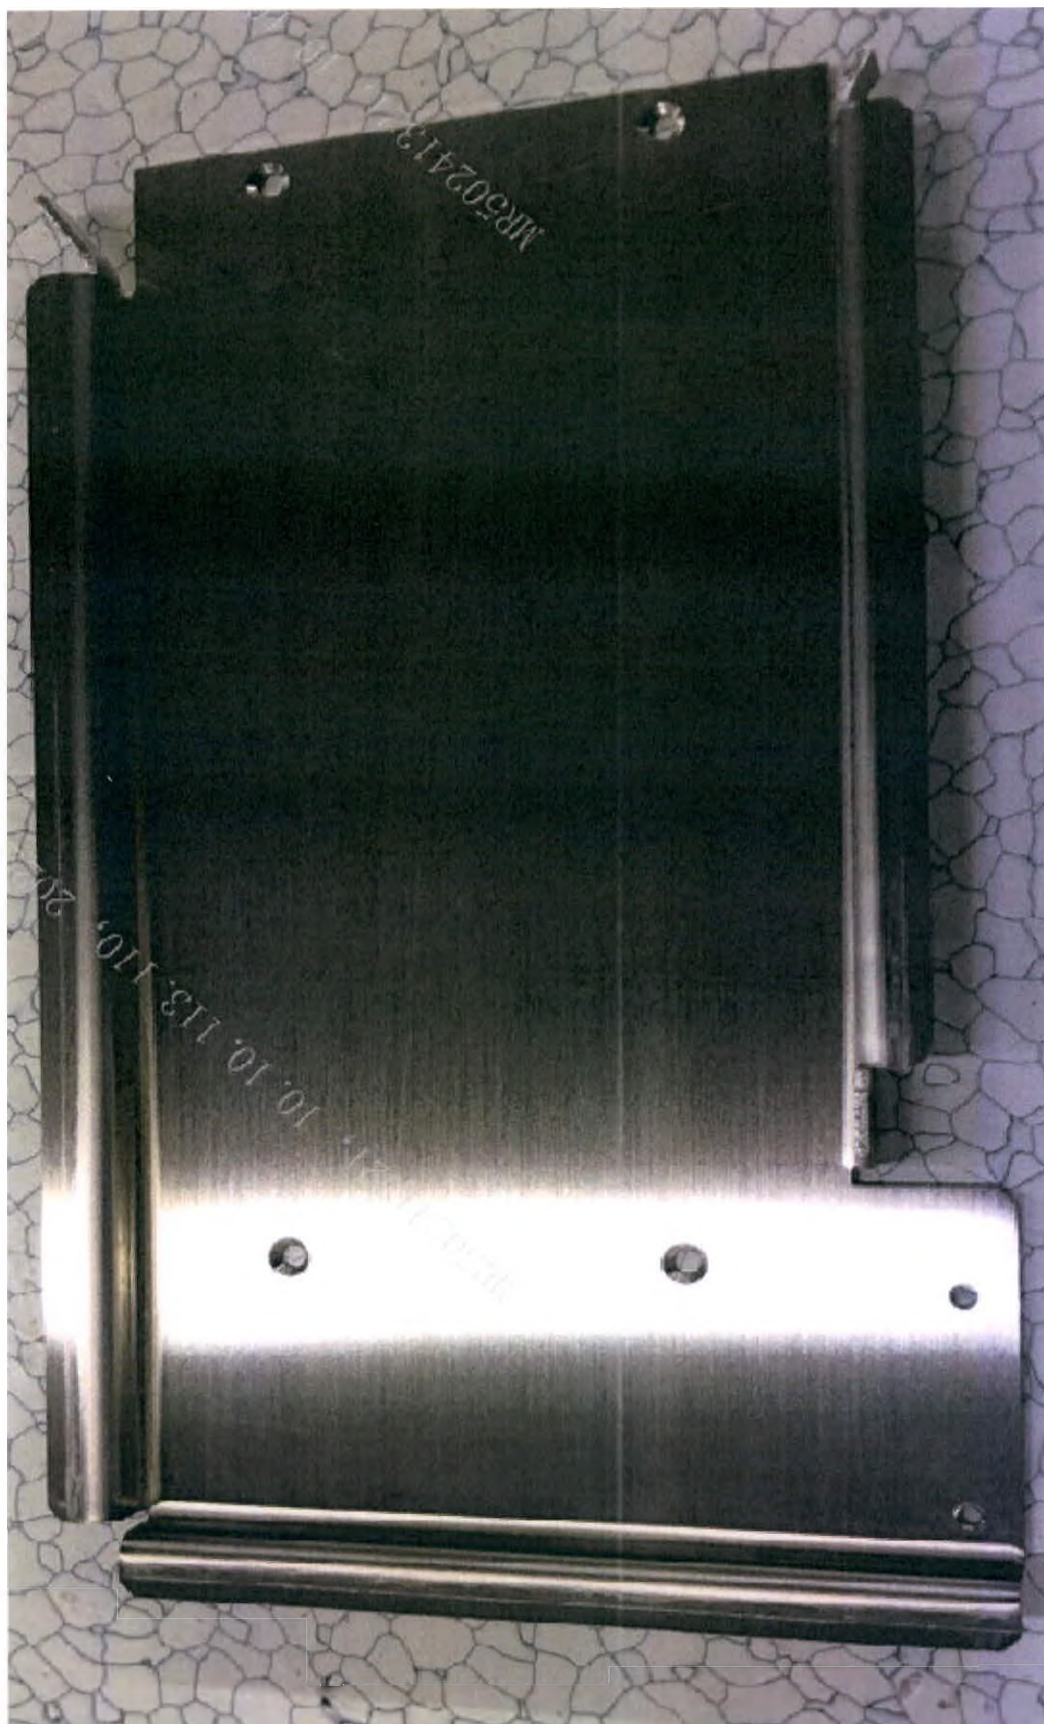


34. Боковая защитная панель стола для установки анализатора MC-80 – не более 2 шт. (при необходимости).

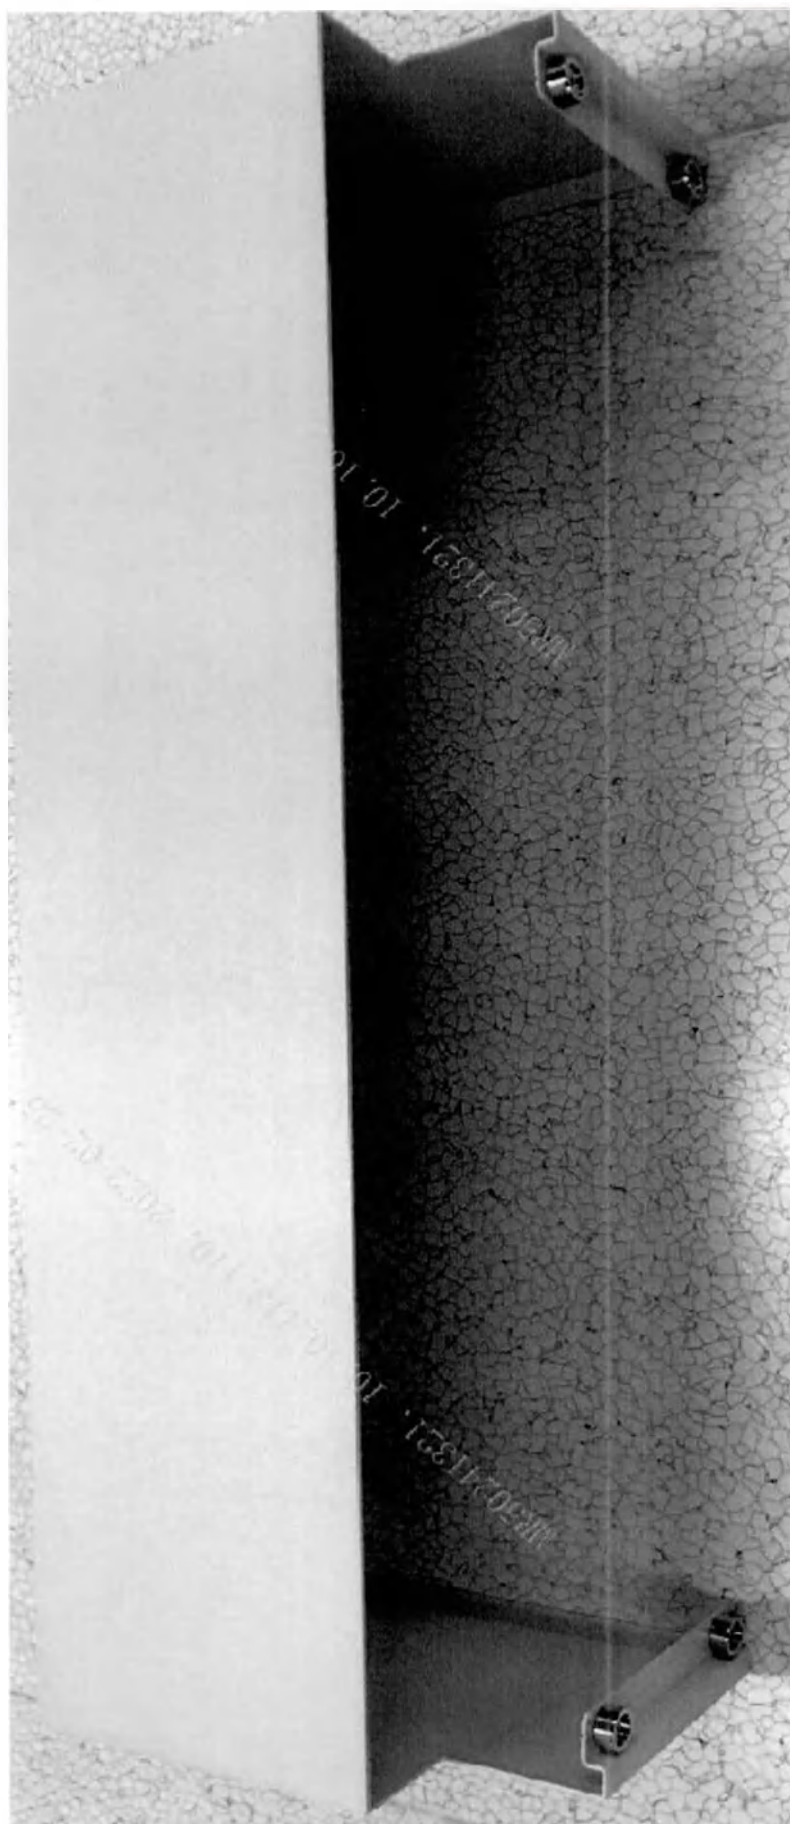


35. Боковая защитная панель прибора SC-120 – не более 2 шт. (при необходимости).

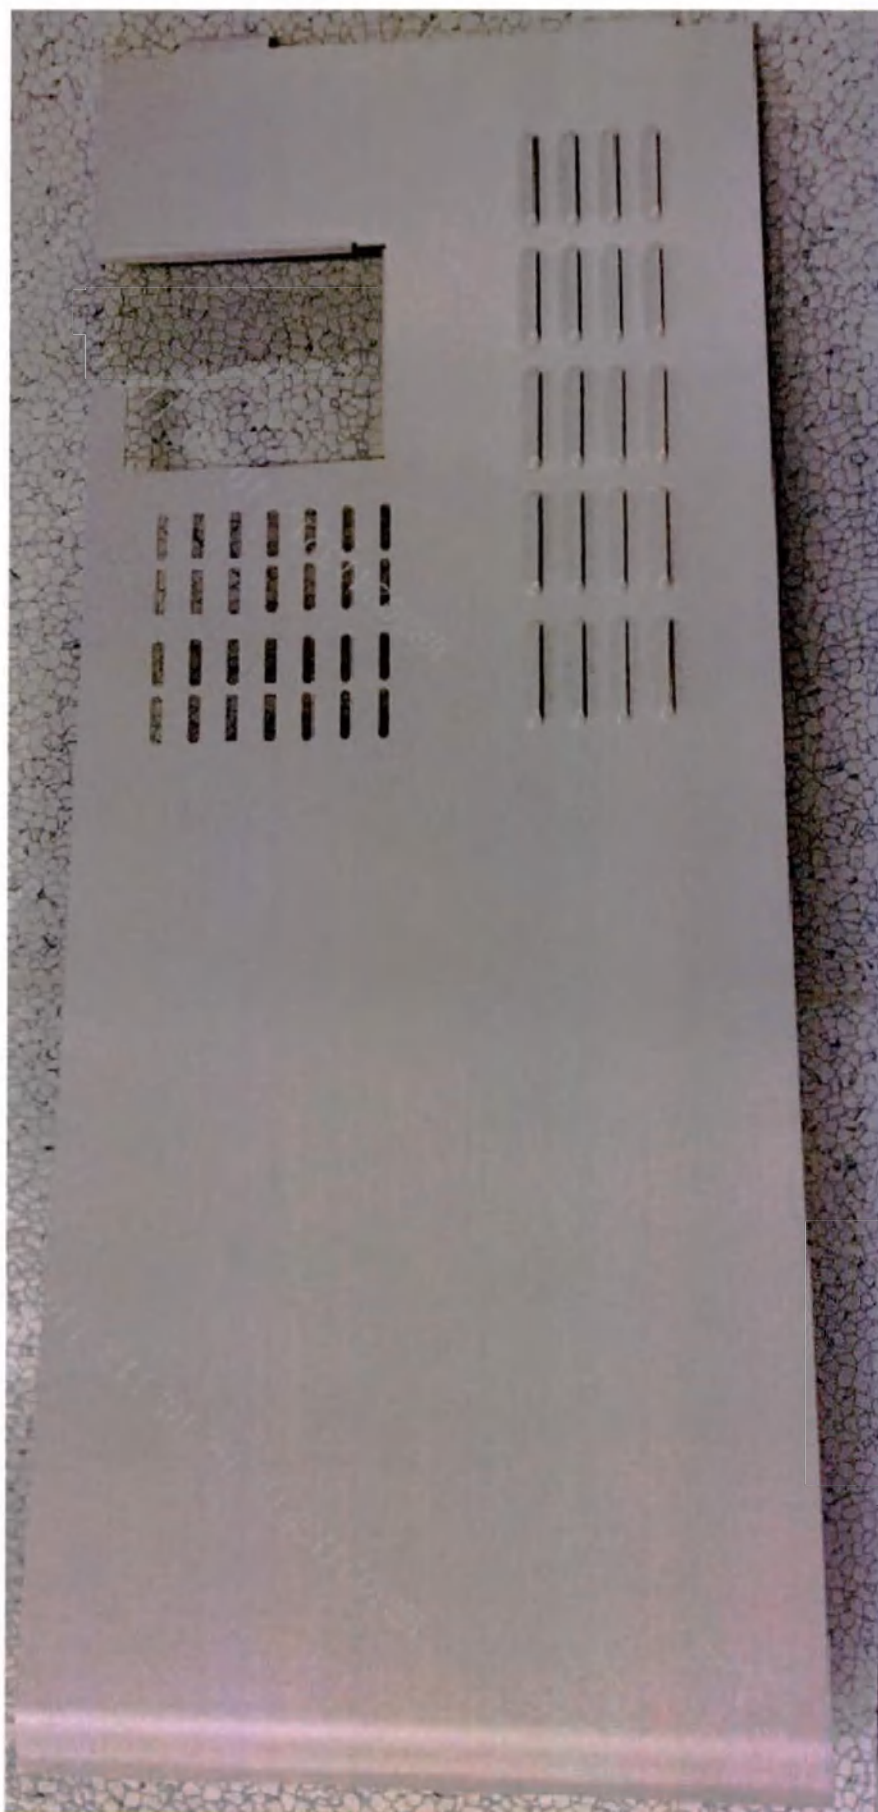


36. Задняя декоративная панель стола для установки анализатора МС-80 – не более 2 шт. (при необходимости).

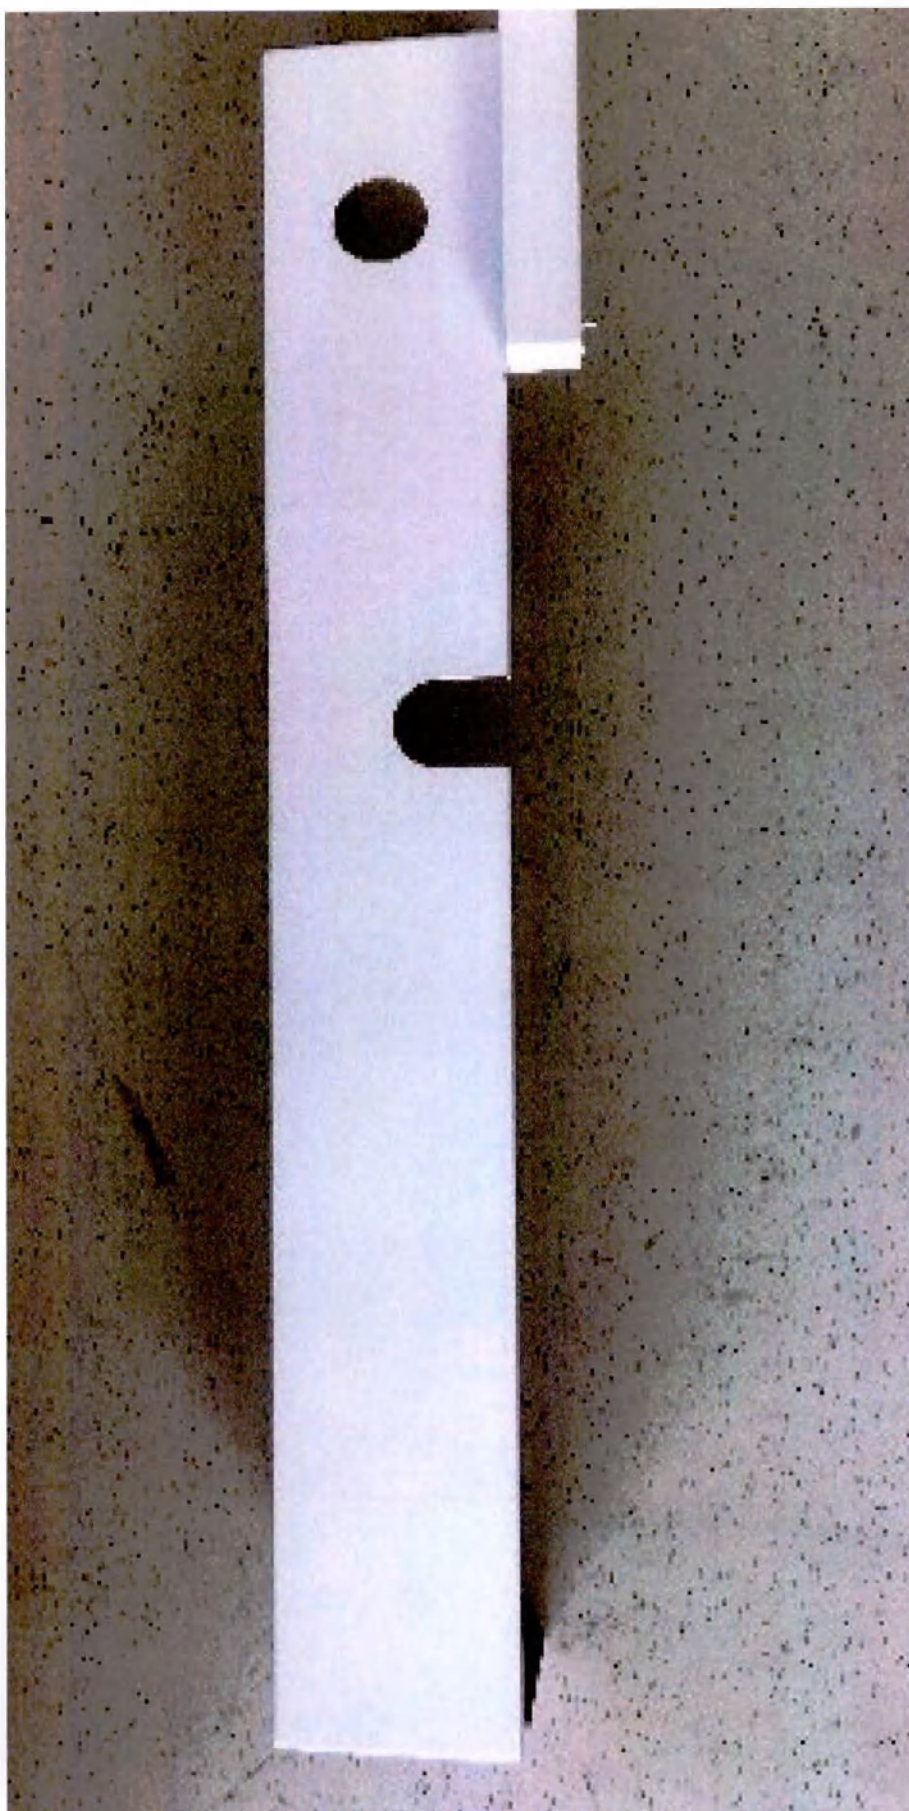


37. Крышка отсека окраски мазков прибора SC-120 – не более 2 шт. (при необходимости).

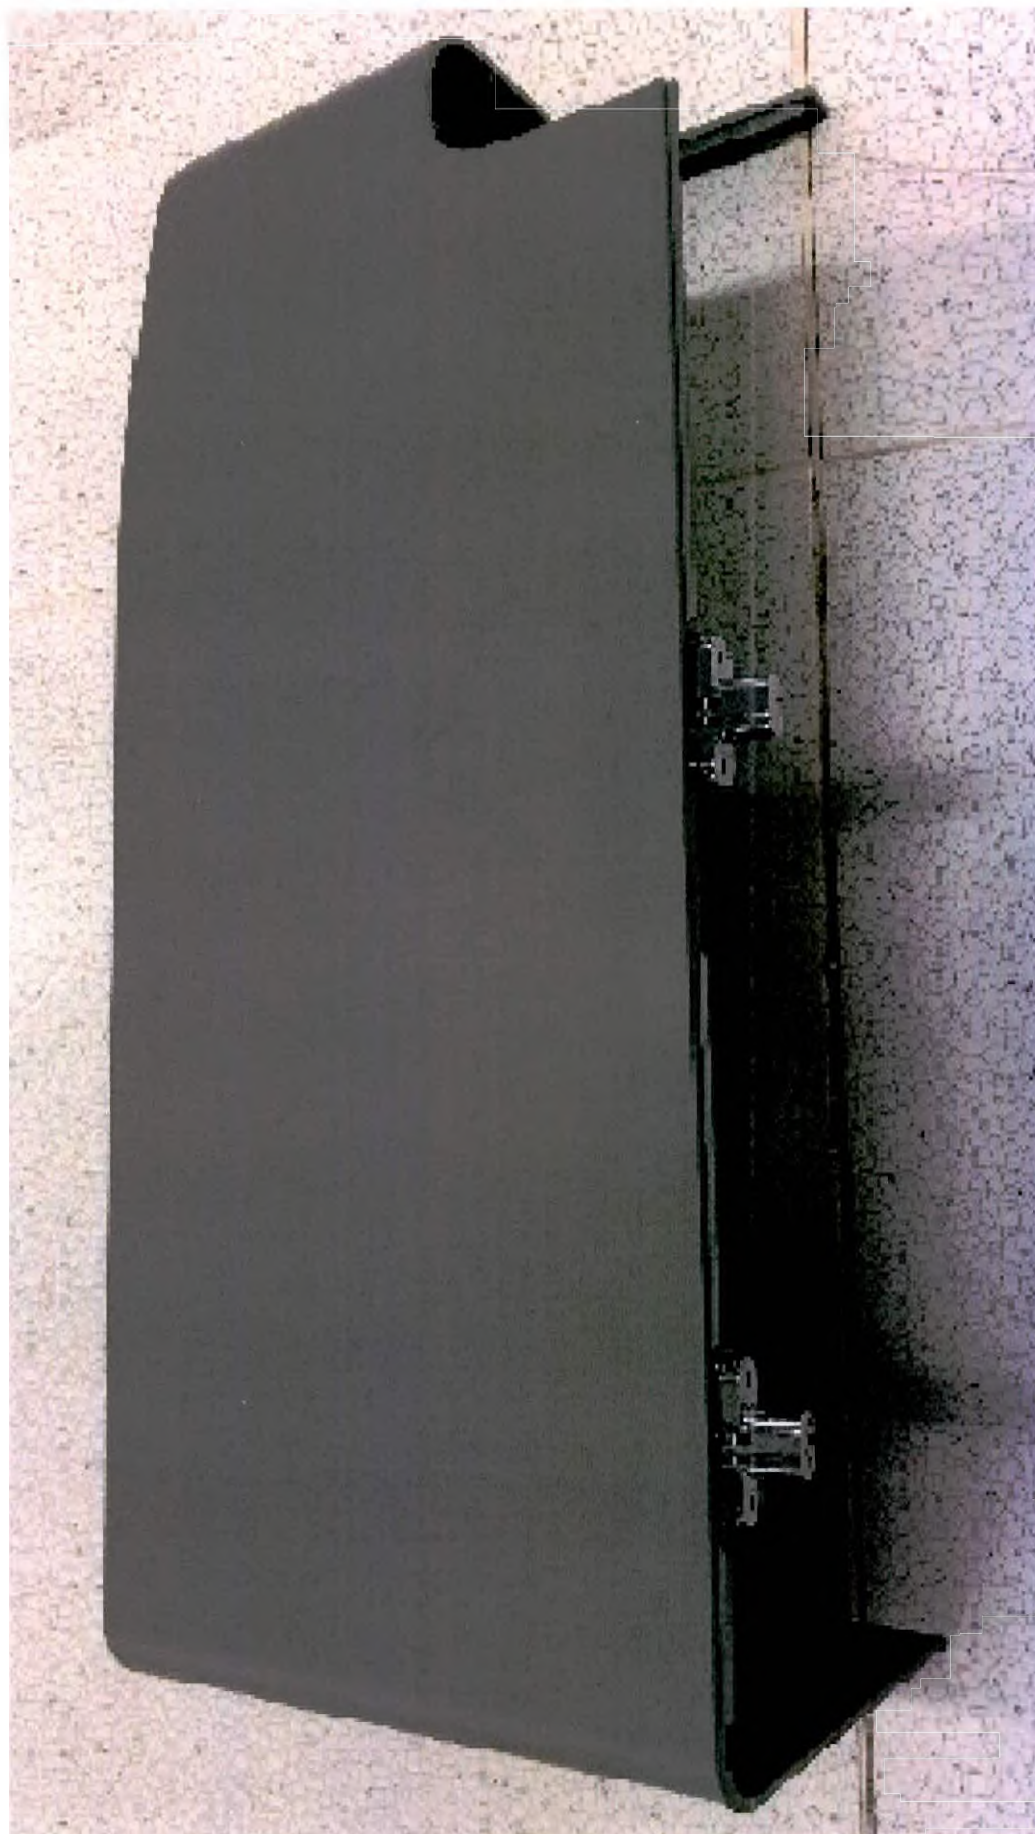


38. Защитная крышка блока электрических коммуникаций стола для установки прибора МС-80 – не более 2 шт. (при необходимости).

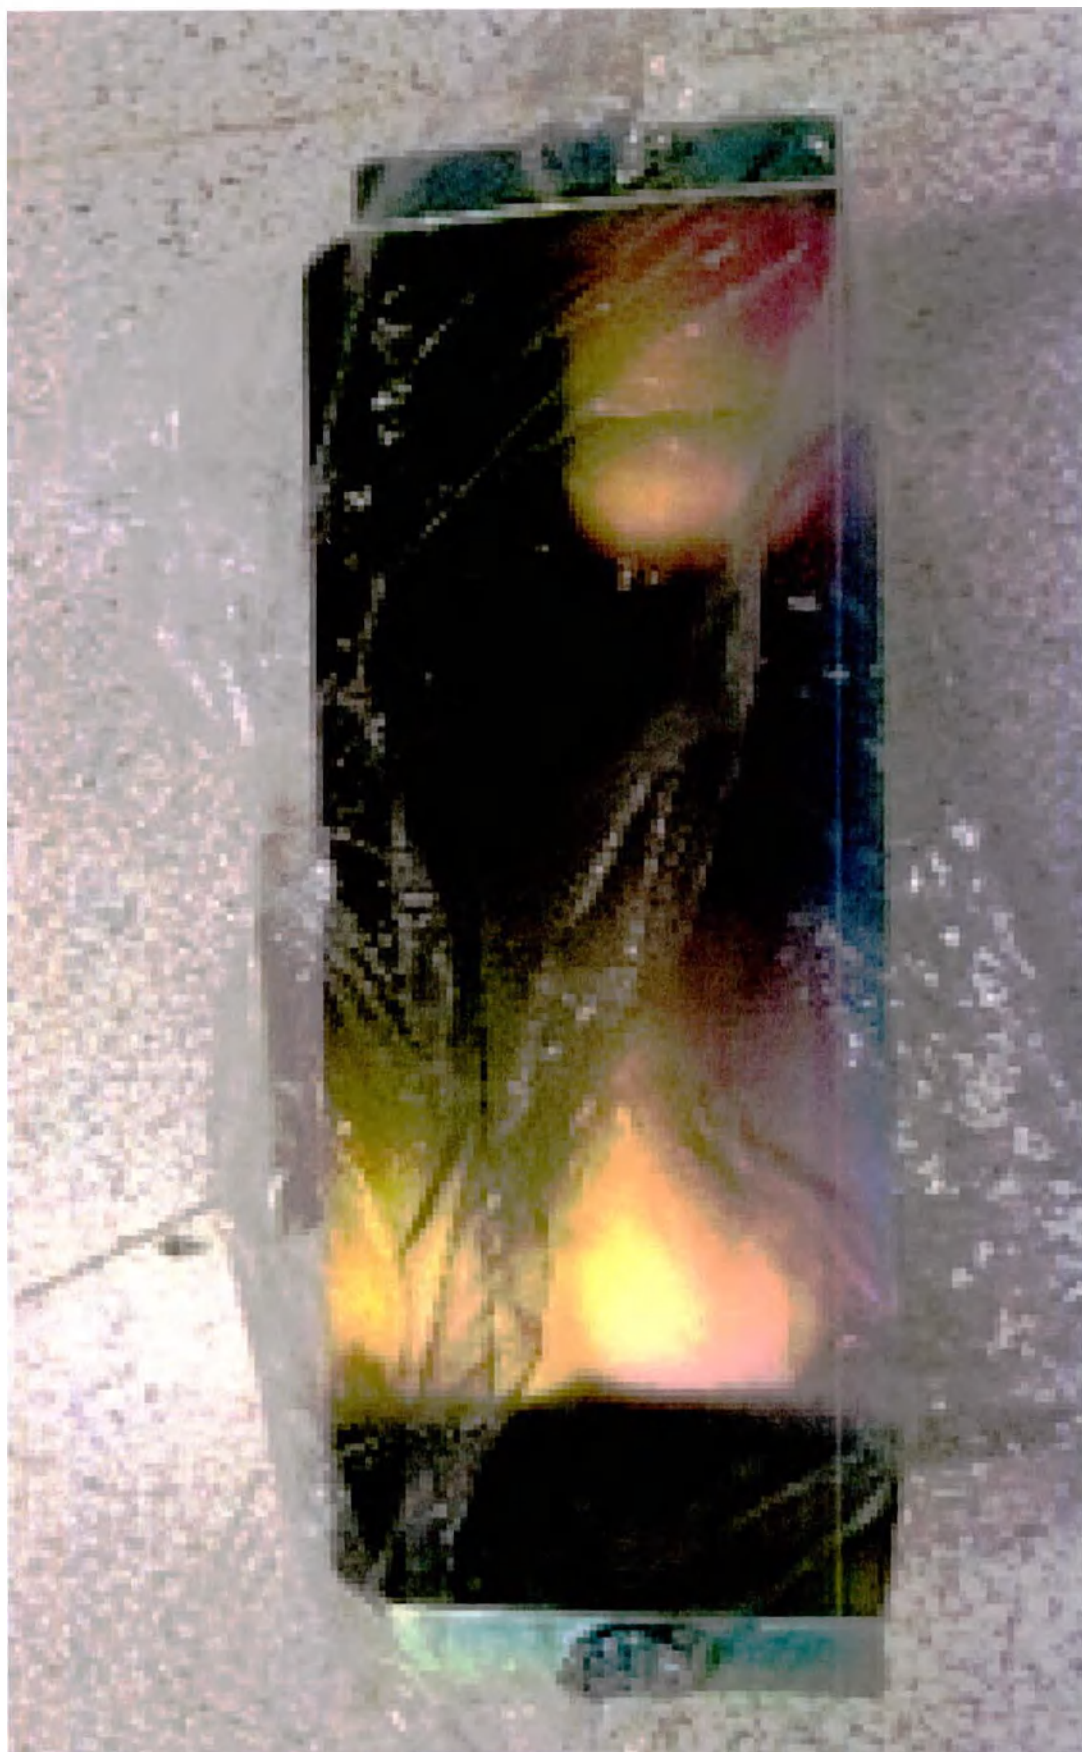


39. Фрагмент защитной панели прибора МС-80 – не более 2 шт. (при необходимости).

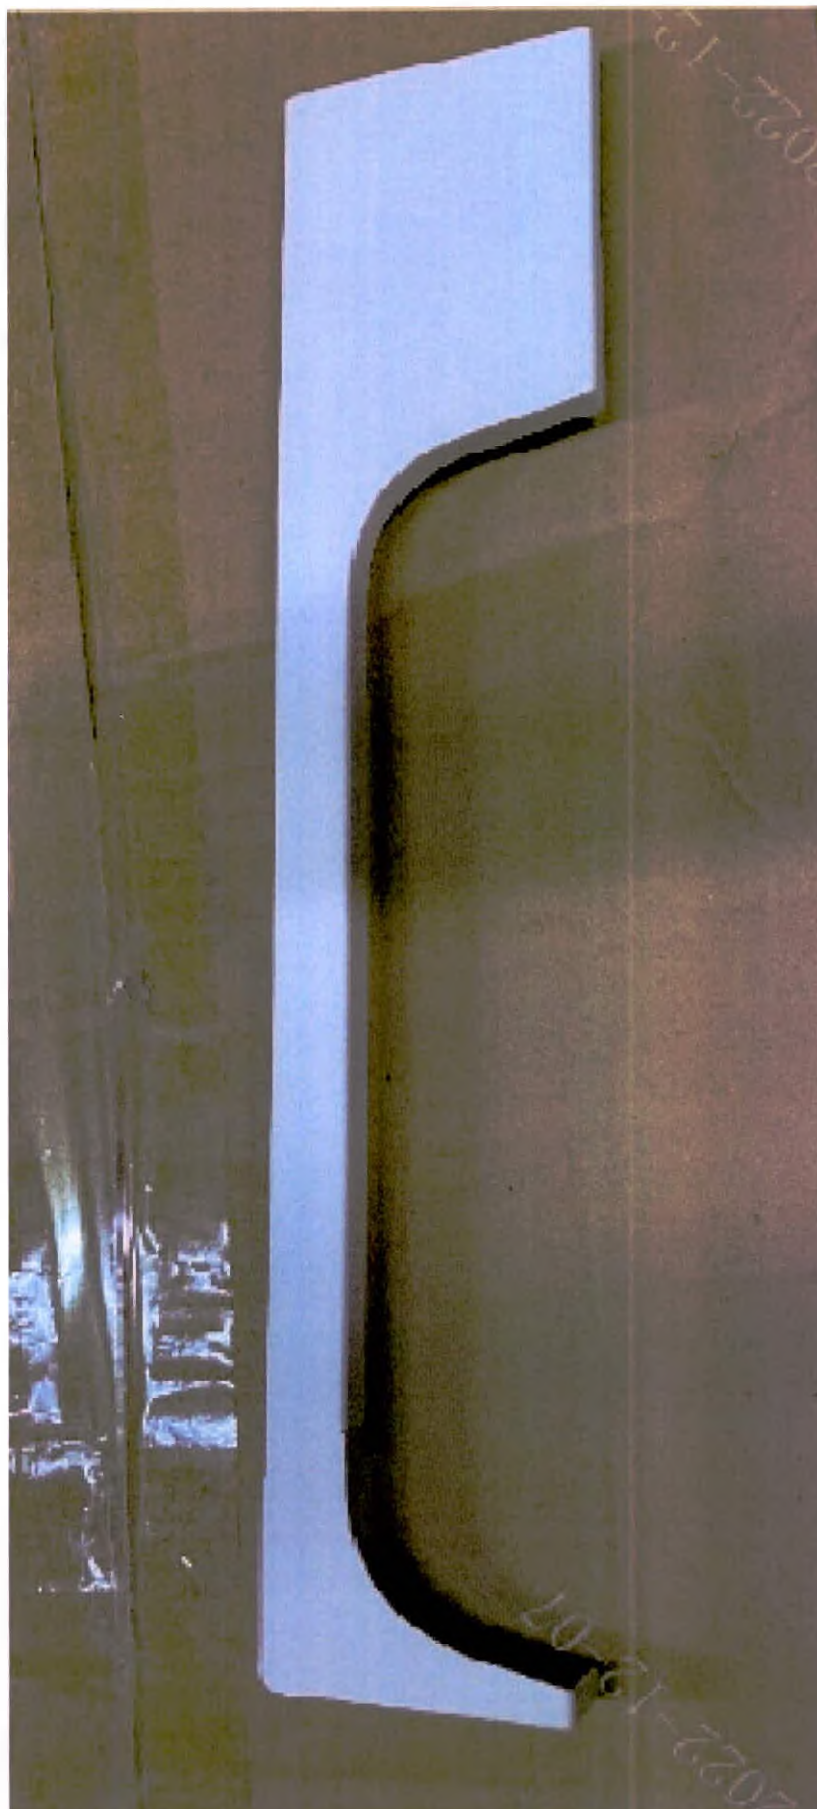

40. Ручка тележки для кабинета – не более 8 шт. (при необходимости).

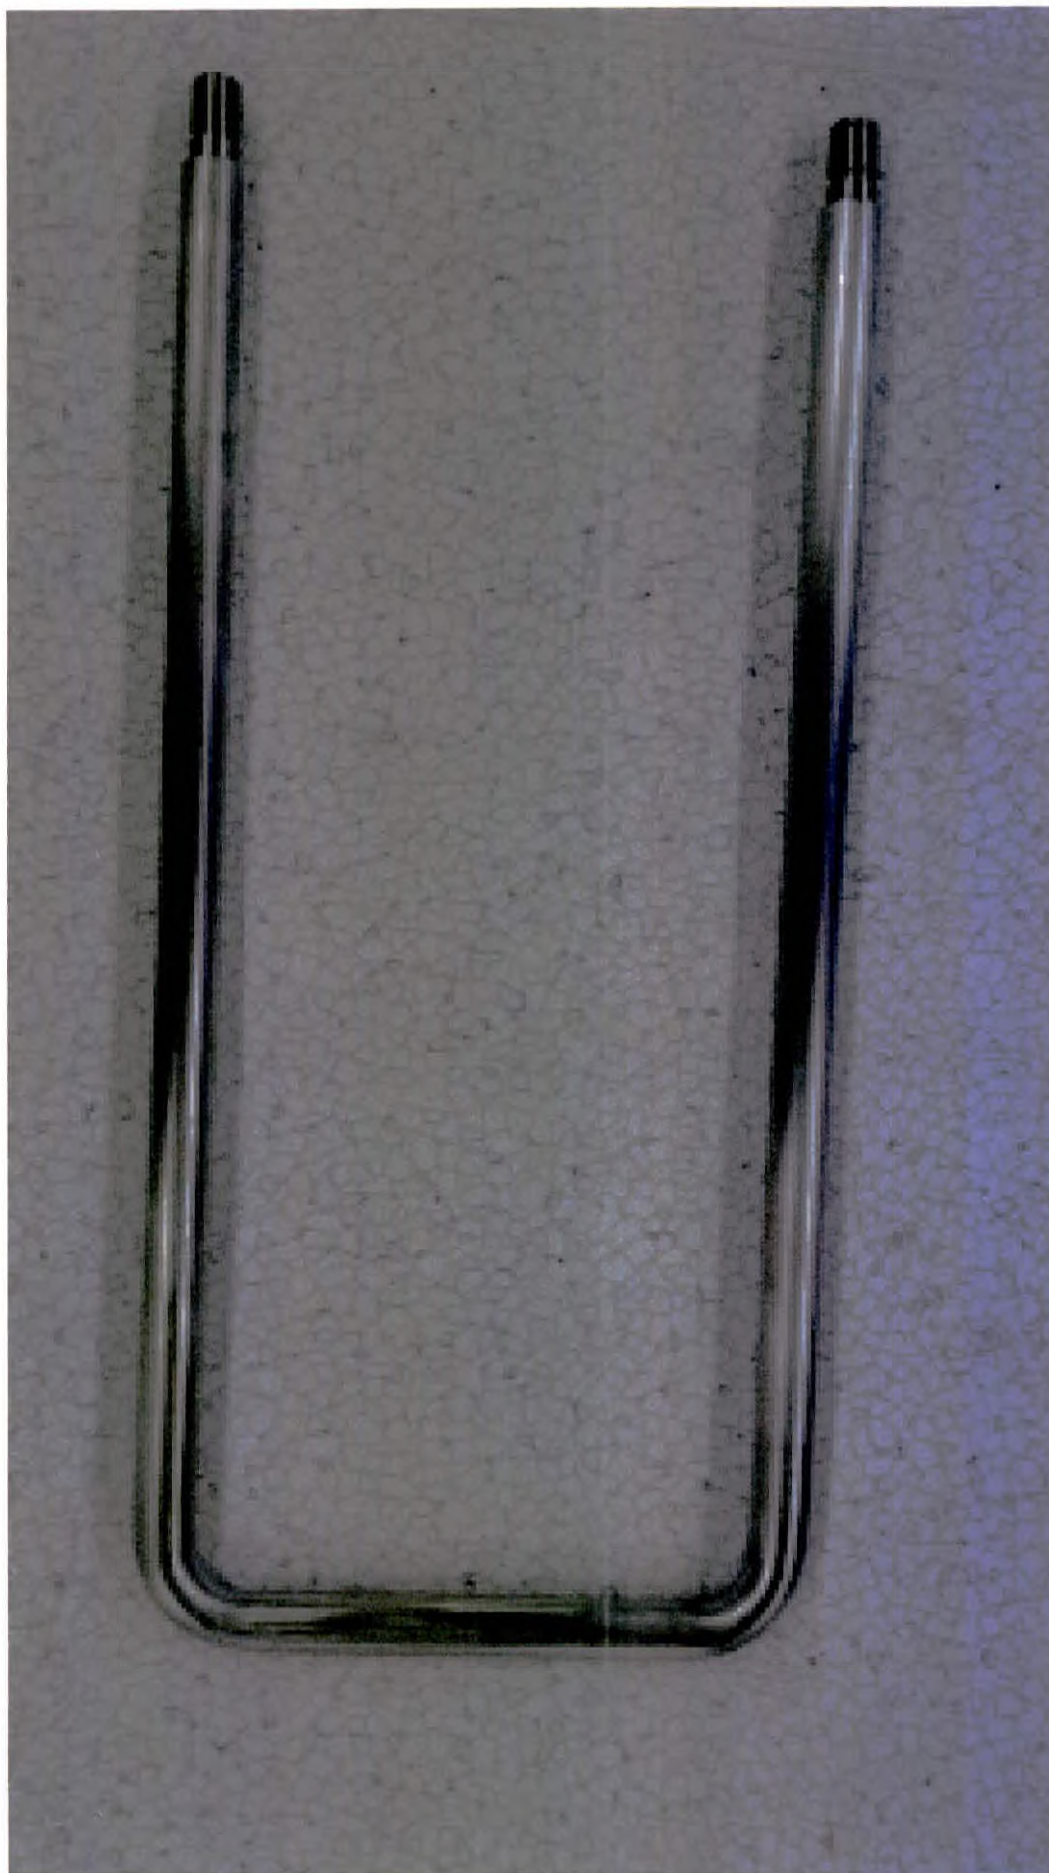


41. Направляющая рельса тележки для кабинета – не более 16 шт. (при необходимости).

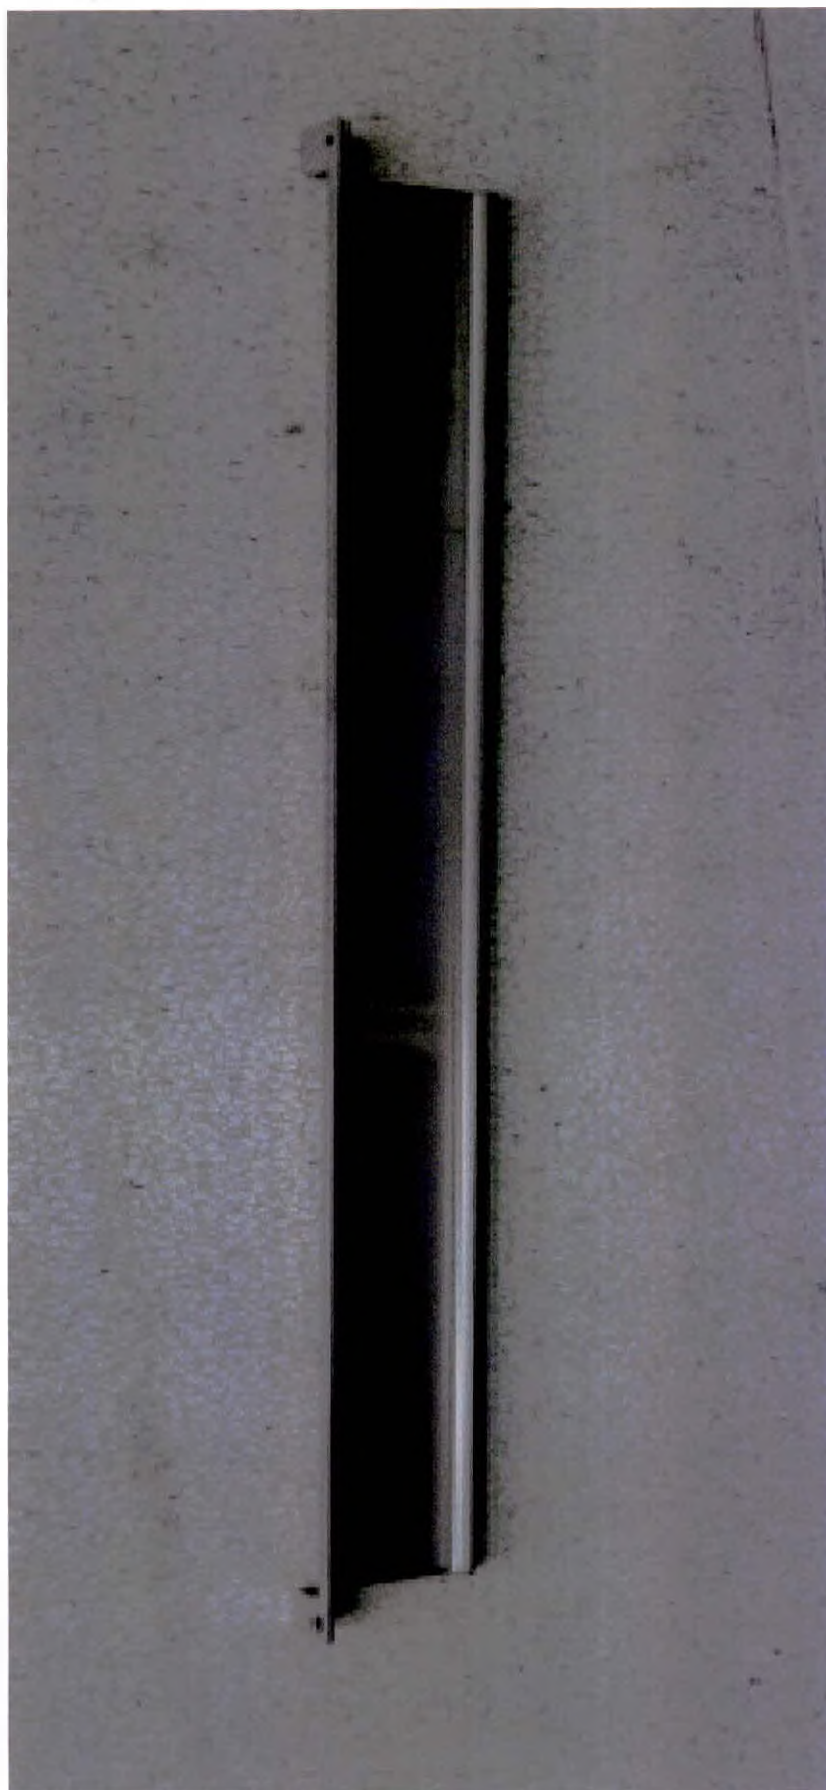

42. Каркас тележки для кабинета модуля прибора SC-120 – не более 2 шт. (при необходимости).



43. Каркас тележки для кабинета модуля прибора SC-120 с дополнительным отсеком – не более 2 шт. (при необходимости).

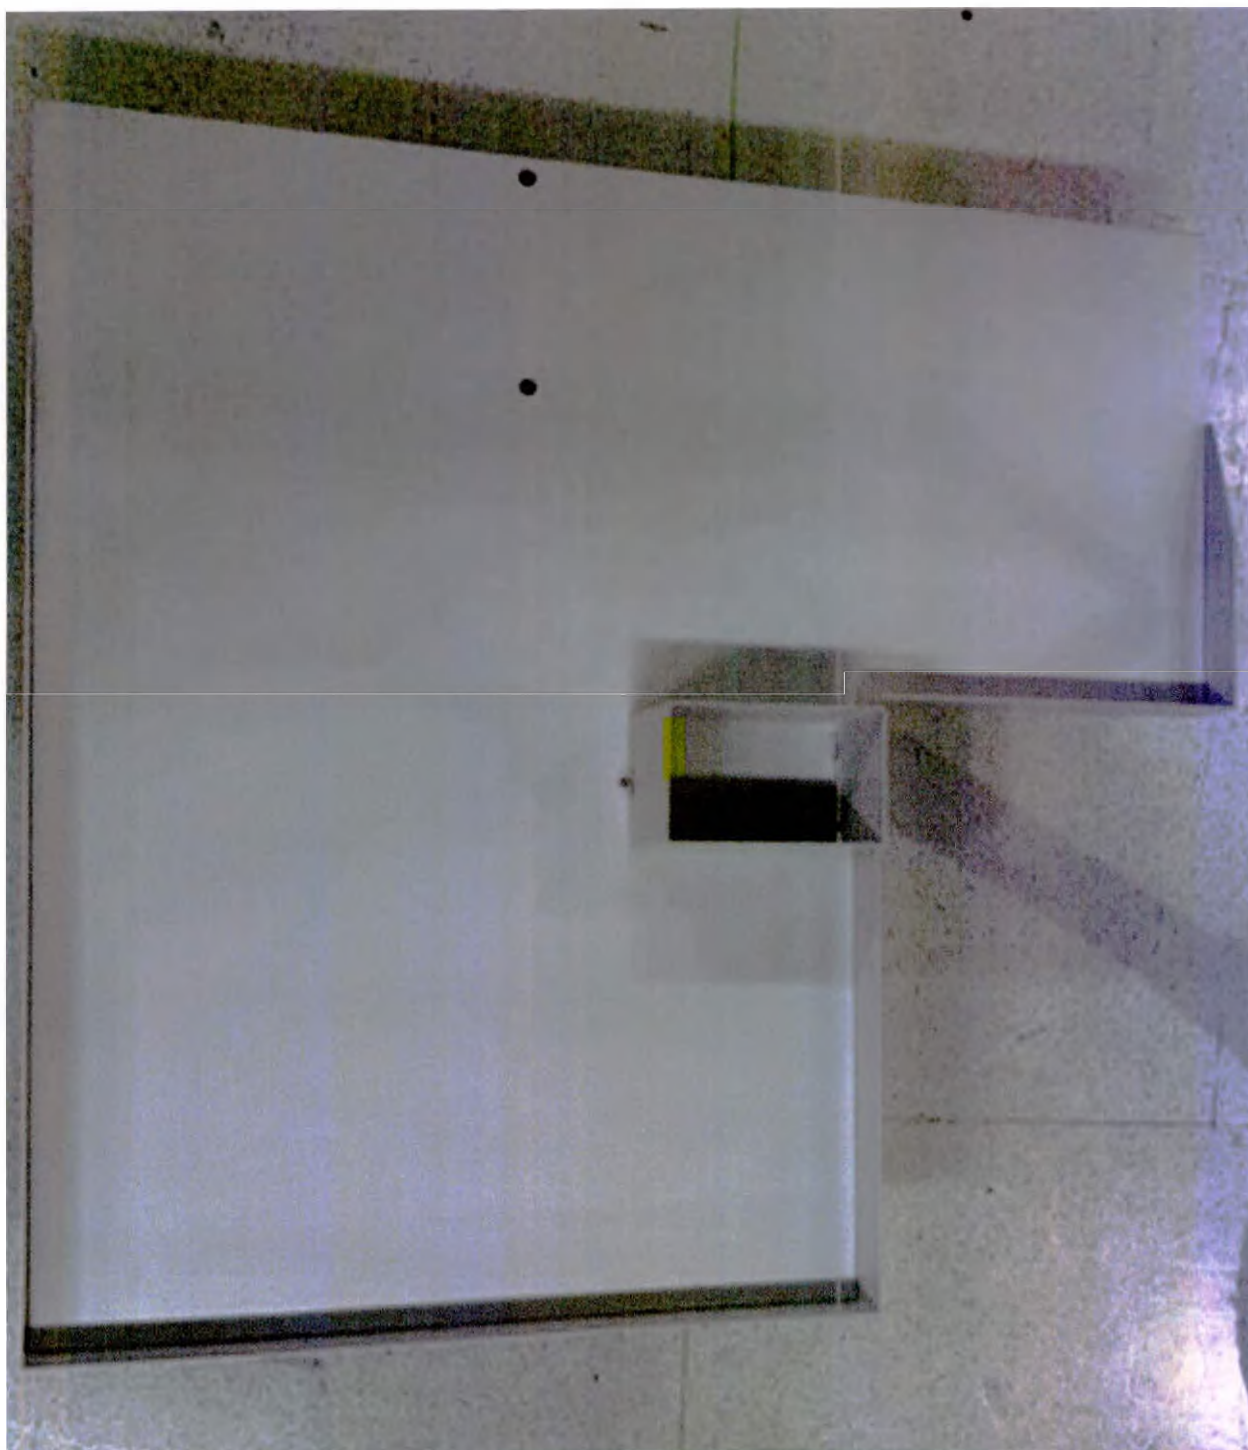

44. Каркас тележки для кабинета модуля анализатора гематологического – не более 4 шт. (при необходимости).



45. Каркас тележки для кабинета модуля анализатора гематологического с дополнительным сегментом – не более 4 шт. (при необходимости).



46. Гайка шестигранная М12 – не более 24 шт. (при необходимости).



47. Шайба пружинная М5 – не более 30 шт. (при необходимости).



48. Шайба пружинная М8 – не более 20 шт. (при необходимости).




49. Шайба плоская 7 мм – не более 20 шт. (при необходимости).



50. Шайба плоская 9 мм – не более 20 шт. (при необходимости).



51. Шайба плоская 16 мм – не менее 45 шт. (при необходимости).

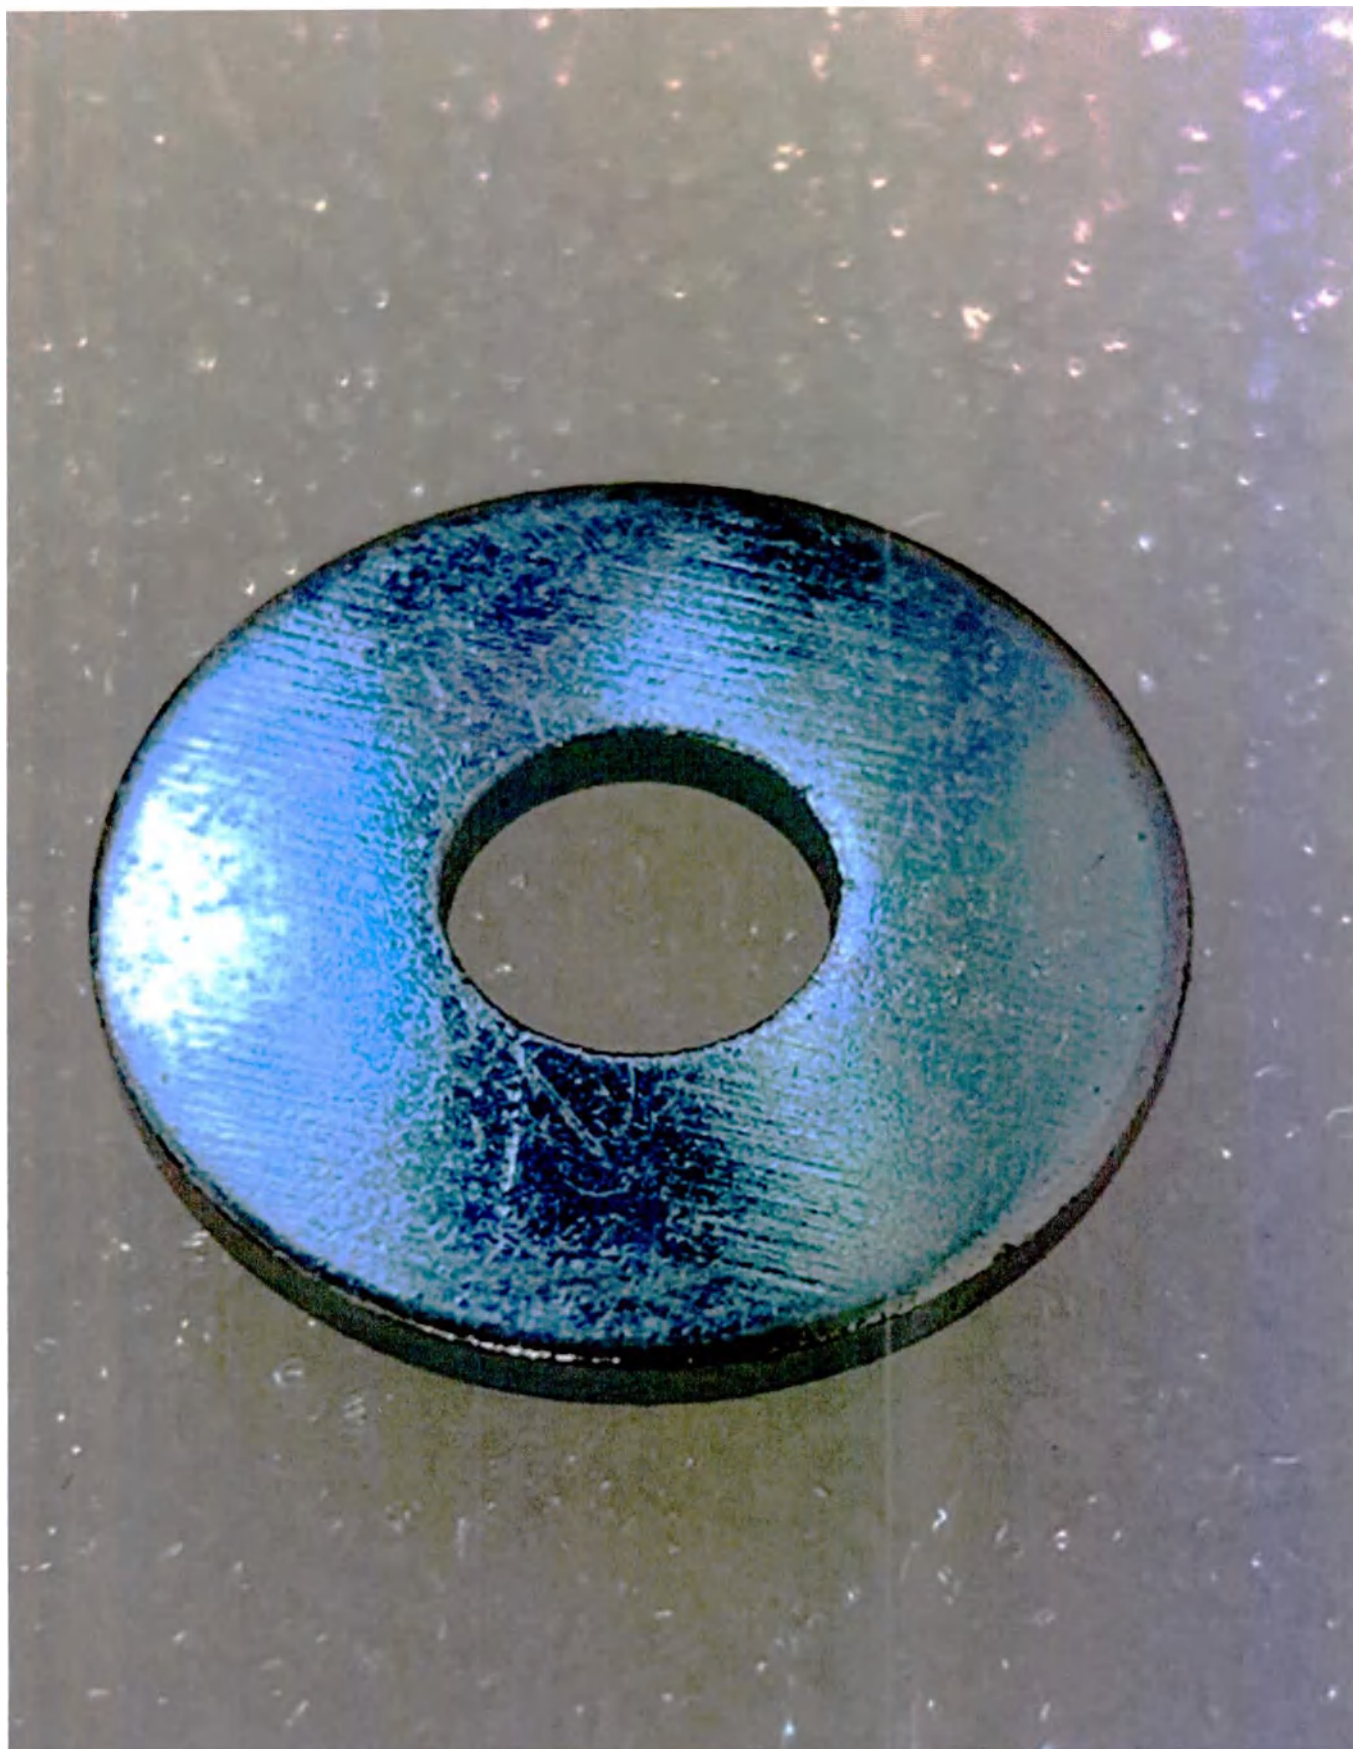

52. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М4Х12 – не более 60 шт. (при необходимости).



53. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем M5X20 – не более 60 шт. (при необходимости).



54. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем M8X25 – не более 60 шт. (при необходимости).



55. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М4Х10 – не более 6 шт. (при необходимости).



56. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М8Х20 – не более 30 шт. (при необходимости).



57. Винт комбинированный с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М3Х8 – не более 30 шт. (при необходимости).



58. Винт комбинированный с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М4Х12 – не более 40 шт. (при необходимости).



59. Винт комбинированный с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М4Х8 – не более 30 шт. (при необходимости).



60. Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем М4Х8 – не более 40 шт. (при необходимости).



61. 030-001213-00 Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем M3X12 – 40 шт. (при необходимости).



62. 030-001217-00 Винт комбинированный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем M4X12 – 40 шт. (при необходимости).




63. Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М4Х8 – 20 шт. (при необходимости).



64. Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем M4×12мм – 20 шт. (при необходимости).



65. Винт с плоской головкой и внутренним шестигранным шлицем М6Х16 – 20 шт. (при необходимости).

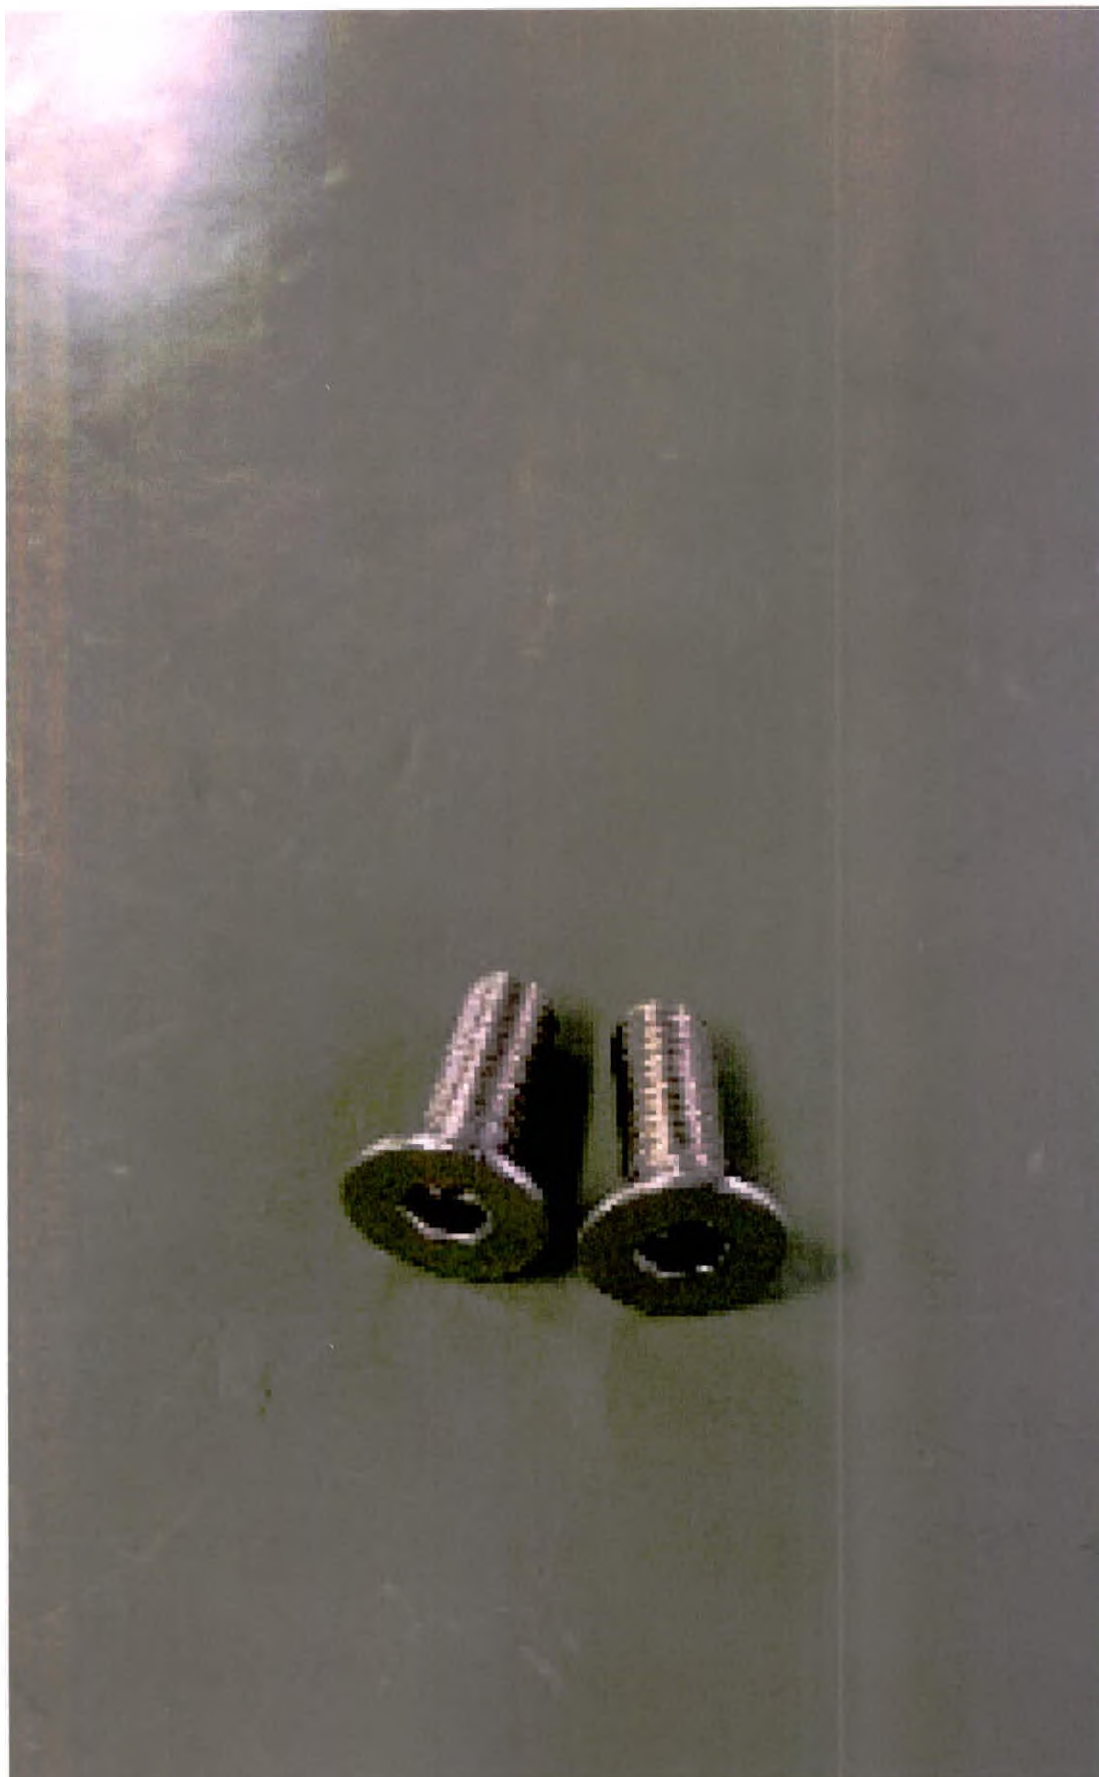

66. Резиновые крышки для технологических отверстий – не более 100 шт. (при необходимости).



Фотографическое изображение транспортной коробки пневматического модуля



Маркировка транспортной упаковки пневматического блока

PNEUMATIC UNIT

mindray

(3 OF 3)

Ordering No.:  5300313143.30

W#:  96506336

P/N:  3213B-PA00032

SN:  009-31000142

2023-01-09



HSF

Size: 590mmx450mmx590mm

N.W.: 20 kg

G.W.: 24.7 kg

Qty.: 1

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81800000 Fax: +86-755-26660680
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

10°C 40°C 90% 106.0kPa 50.0kPa

67. Пневматический блок - не более 9 шт. (при необходимости).



Маркировка пневматического блока



Автозагрузчик CAL8000 для объединения автоматических гематологических анализаторов BC-6800Plus или BC-6800, прибора автоматического для подготовки и окраски мазков SC-120 и анализатора морфологии клеток MC-80, в составе:
67. Пневматический блок

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.
 Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк
 высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь,
 Китайская Народная Республика

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129110, г. Москва, вн.
 тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский,
 д. 16, стр. 5, ан/пом 4/1, ком. 7, 11а

Тел. +7 (499) 553-60-36

**Регистрационное
удостоверение**

№ _____ от _____


68. Предохранитель – не более 18 шт. (при необходимости).



69. Трубка пневматическая 2.5 x 4.0 мм – не более 18 шт. (при необходимости).



70. Трубка пневматическая 2.0 x 3.5 мм – не более 18 шт. (при необходимости).

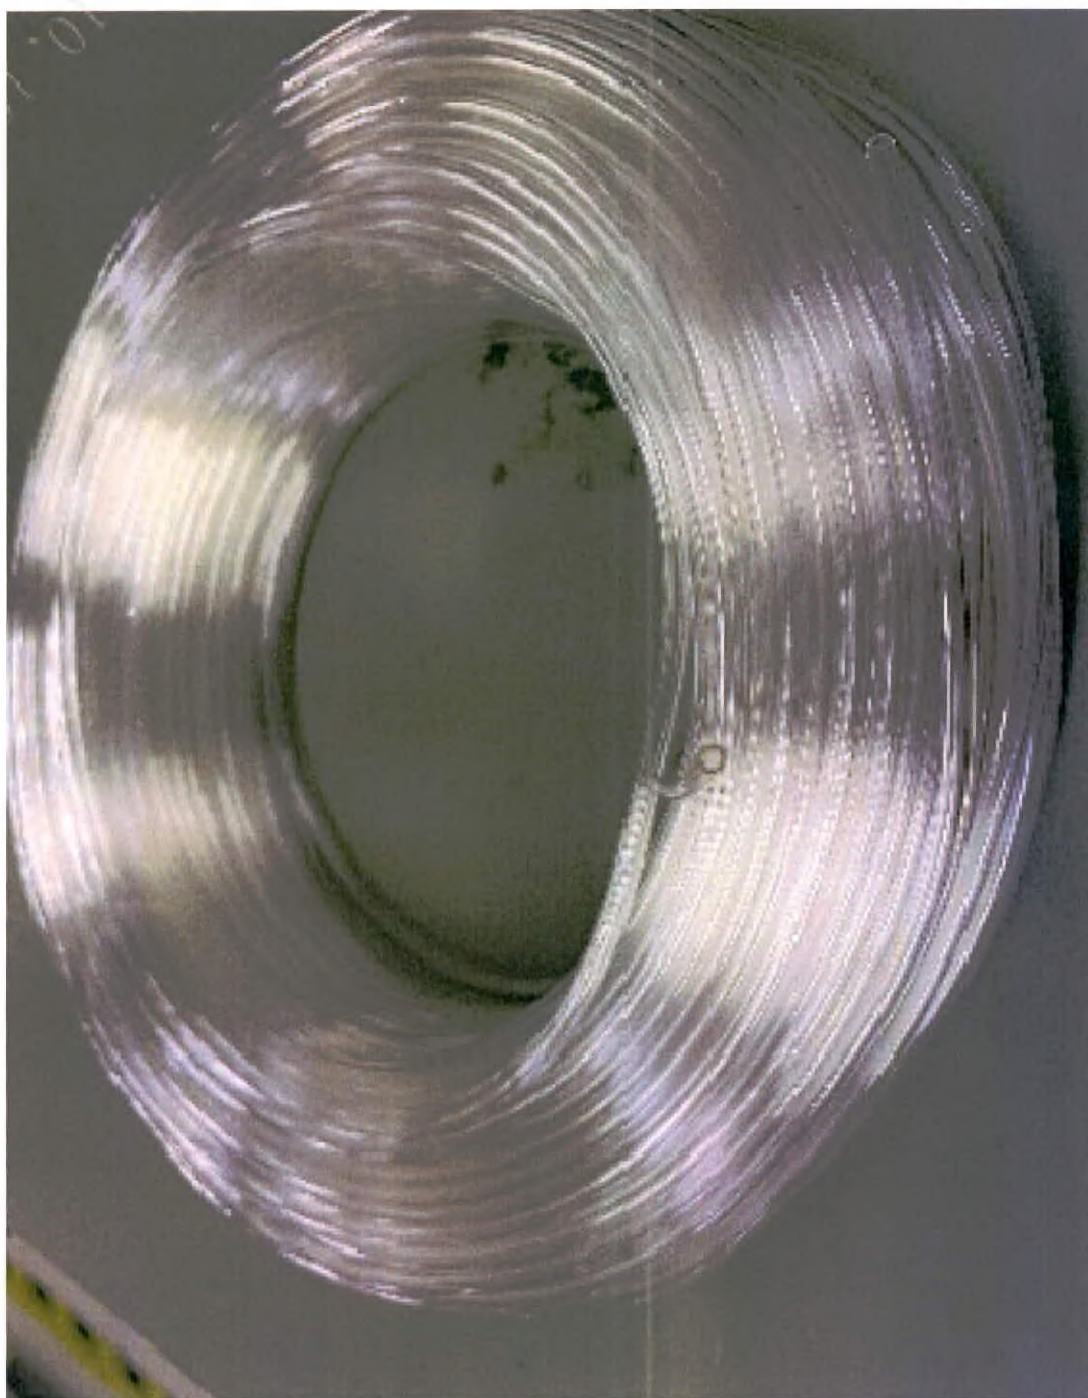

71. Трубка пневматическая 4.0 x 6.0 мм – не более 18 шт. (при необходимости).



72. Крышка для отходов – не более 4 шт. (при необходимости).



73. Крышка сливной емкости в сборе – 1 шт. (при необходимости).



74. Соединитель-тройник Y-типа – не более 50 шт. (при необходимости).



75. Коннектор Y-образный – не более 8 шт. (при необходимости).



76. Коннектор сливной магистрали Y-образный – не более 16 шт. (при необходимости).




77. Коннектор сливной магистрали Y-образный малый – не более 16 шт. (при необходимости).



78. Коннектор прямой не более –10 шт. (при необходимости).



79. Коннектор Т-образный не более – 10 шт. (при необходимости).

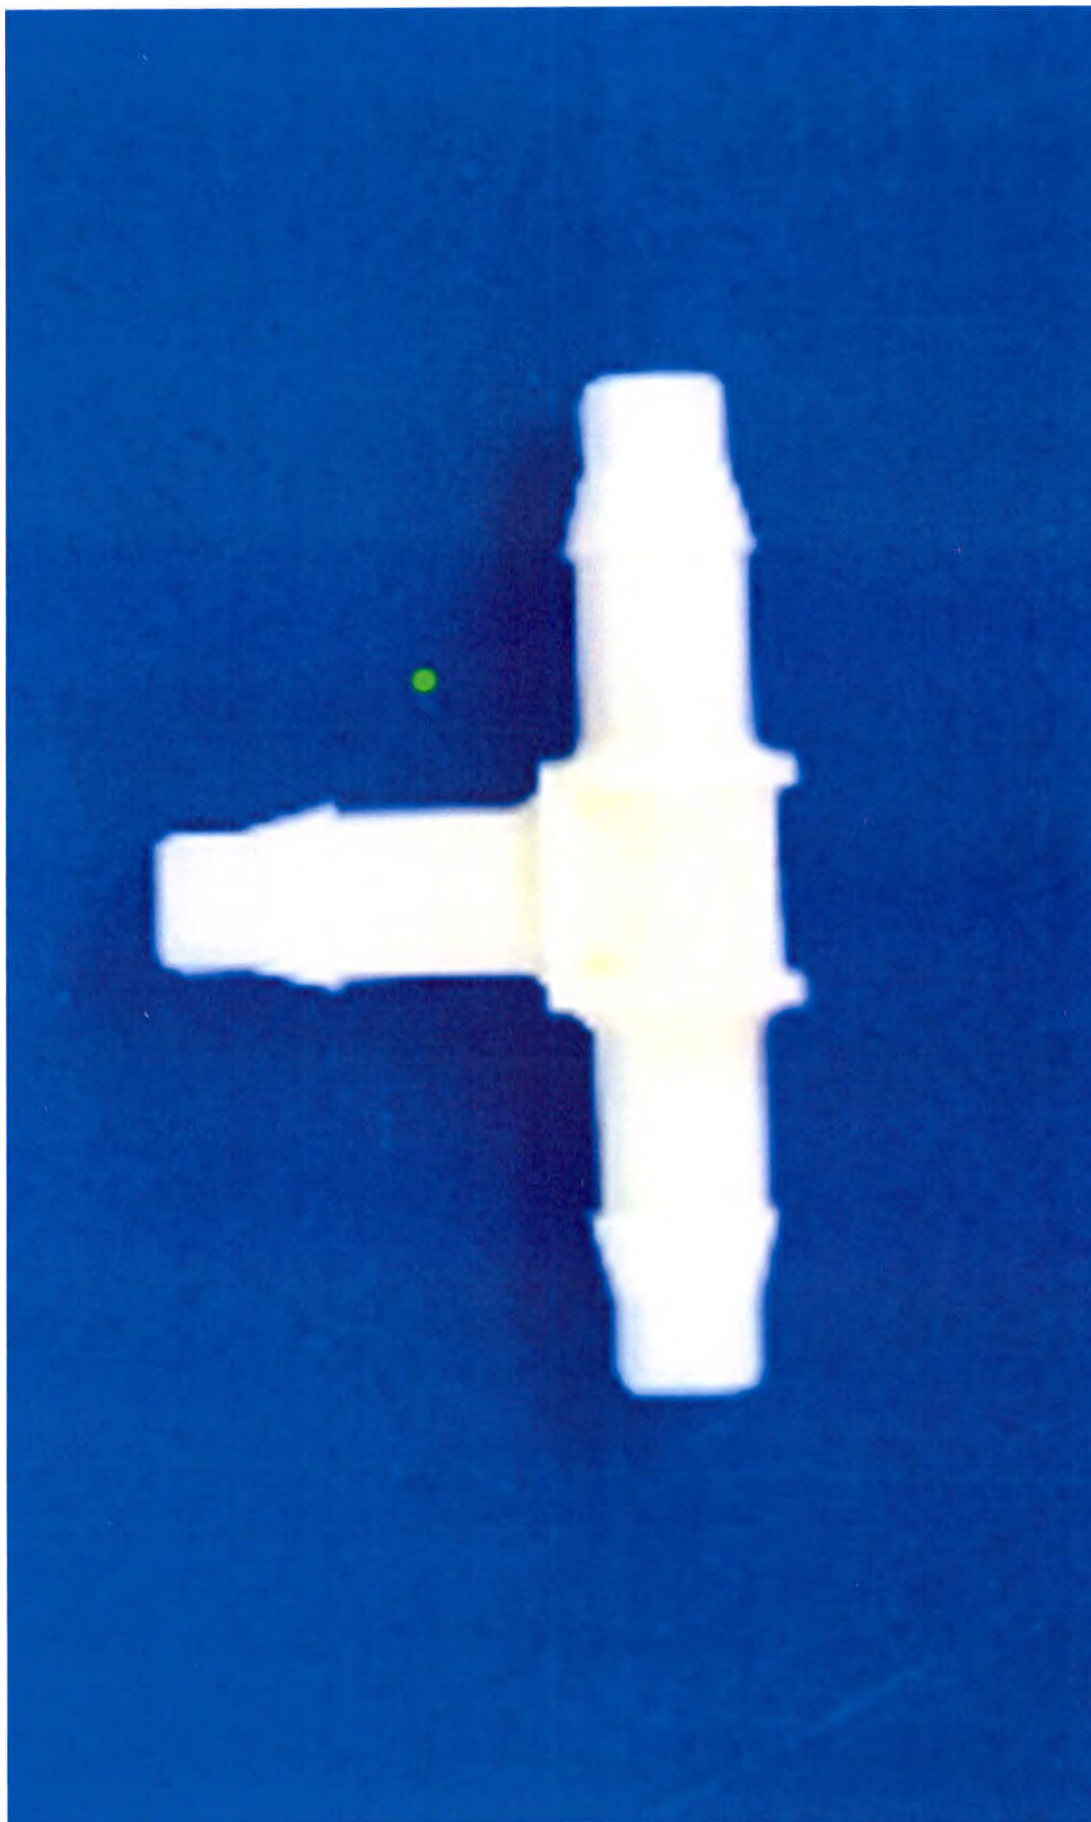

80. Коннектор быстросъемный для пневматической линии – 10 шт. (при необходимости).



81. Тройник быстросъемный для пневматической линии – 10 шт. (при необходимости).



82. Магнит для крепления панелей – не более 60 шт . (при необходимости).



83. Кронштейн крепежный для стола для установки анализатора МС-80 – не более 2 шт. (при необходимости).



84. Кронштейн крепежный для передней верхней декоративной панели для модуля транспортировки кассет – не более 2 шт. (при необходимости).



85. Кронштейн крепежный угловой для передней верхней декоративной панели для модуля транспортировки кассет – не более 4 шт. (при необходимости).



86. Кронштейн анализатора фиксирующий – не более 8 шт. (при необходимости).



87. Кронштейн прибора SC-120 фиксирующий – не более 8 шт. (при необходимости).



88. Кабель питания для внутренней коммуникации – не более 40 шт. (при необходимости).



89. CAN-кабель для соединения приборов – не более 40 шт. (при необходимости).




90. CAN-кабель для управления пневматическим блоком – не более 10 шт. (при необходимости).



91. Кабель питания для подключения к электрической сети – 1 шт. (при необходимости).



92. Кабель питания для подключения к электрической сети (дополнительный) – не более 16 шт. (при необходимости).

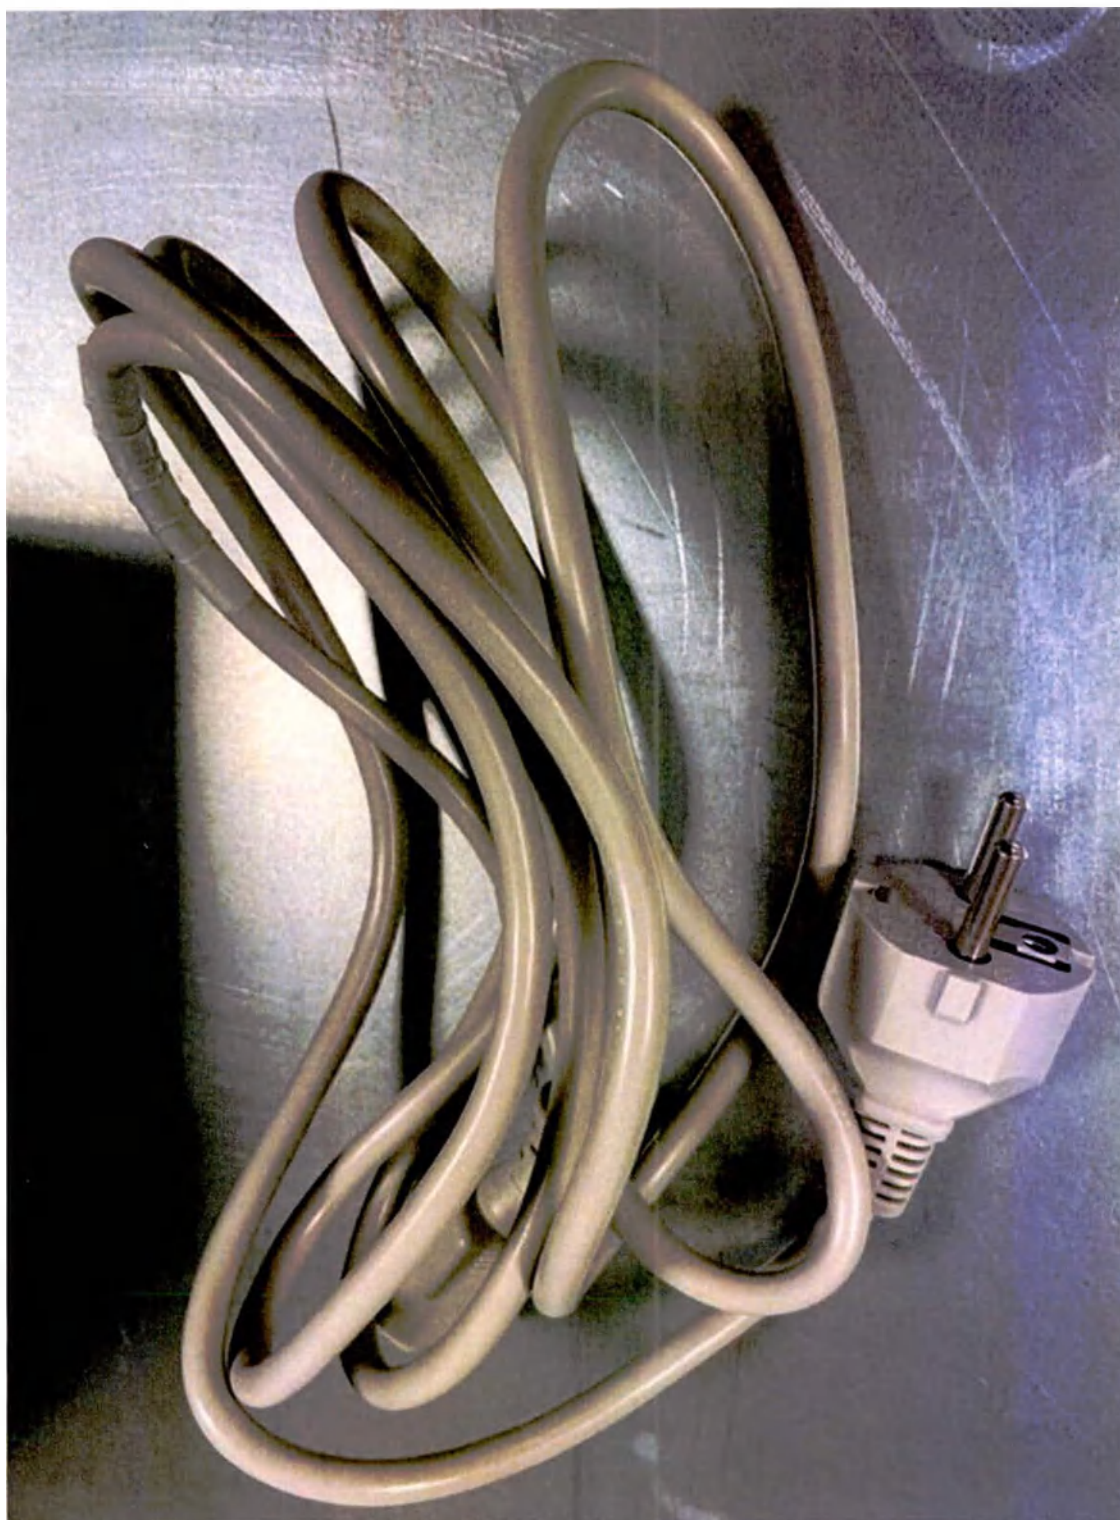

93. Канал для укладки кабелей – 1 шт. (при необходимости).




94. Сетевой кабель 2 – не более 12 шт. (при необходимости).



95. Сетевой кабель 3 – не более 12 шт. (при необходимости).



96. Сетевой кабель 4 – не более 12 шт. (при необходимости).

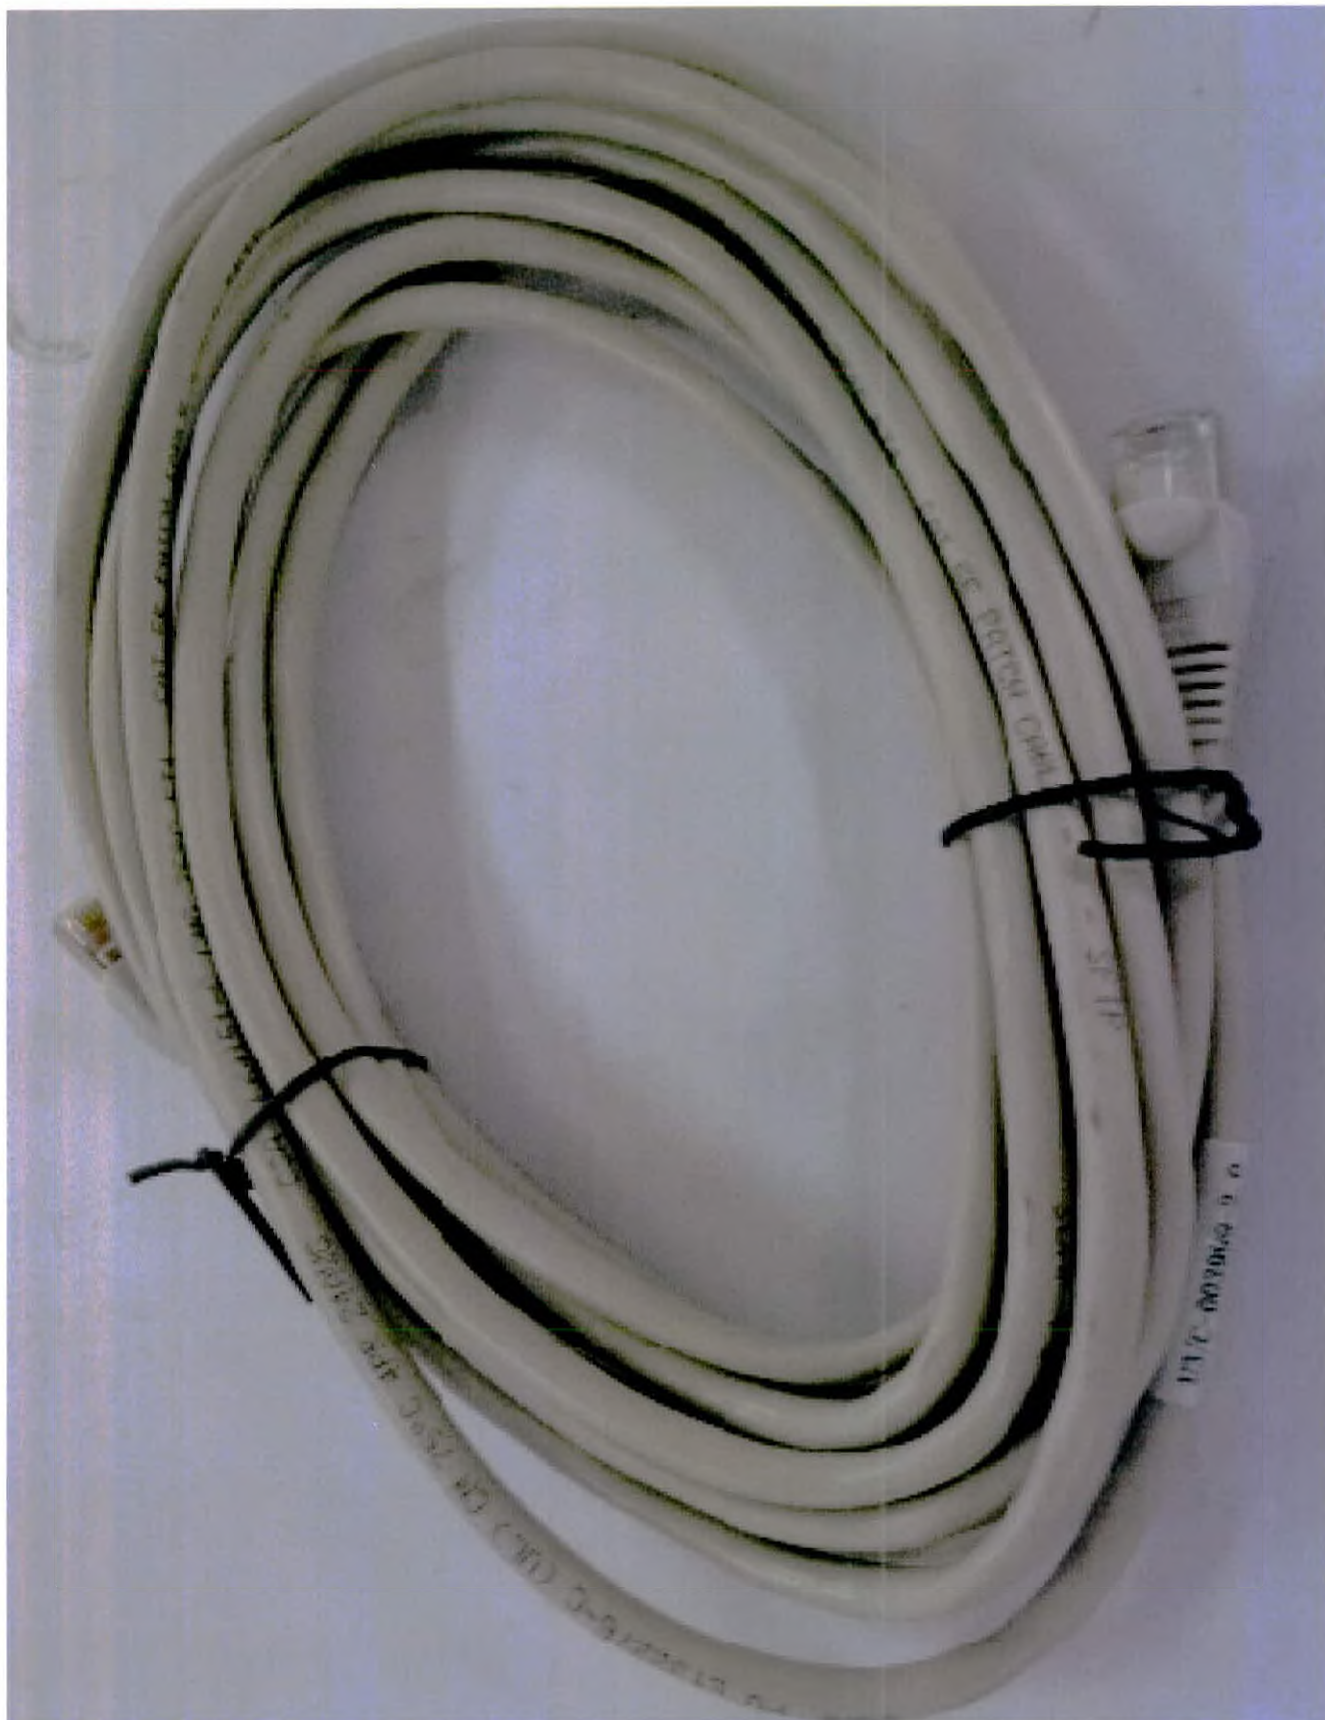


97. Сетевой кабель 5 – не более 12 шт. (при необходимости).



98. Сетевой кабель 6 – не более 12 шт. (при необходимости).



99. Сетевой кабель 7 – не более 12 шт. (при необходимости).

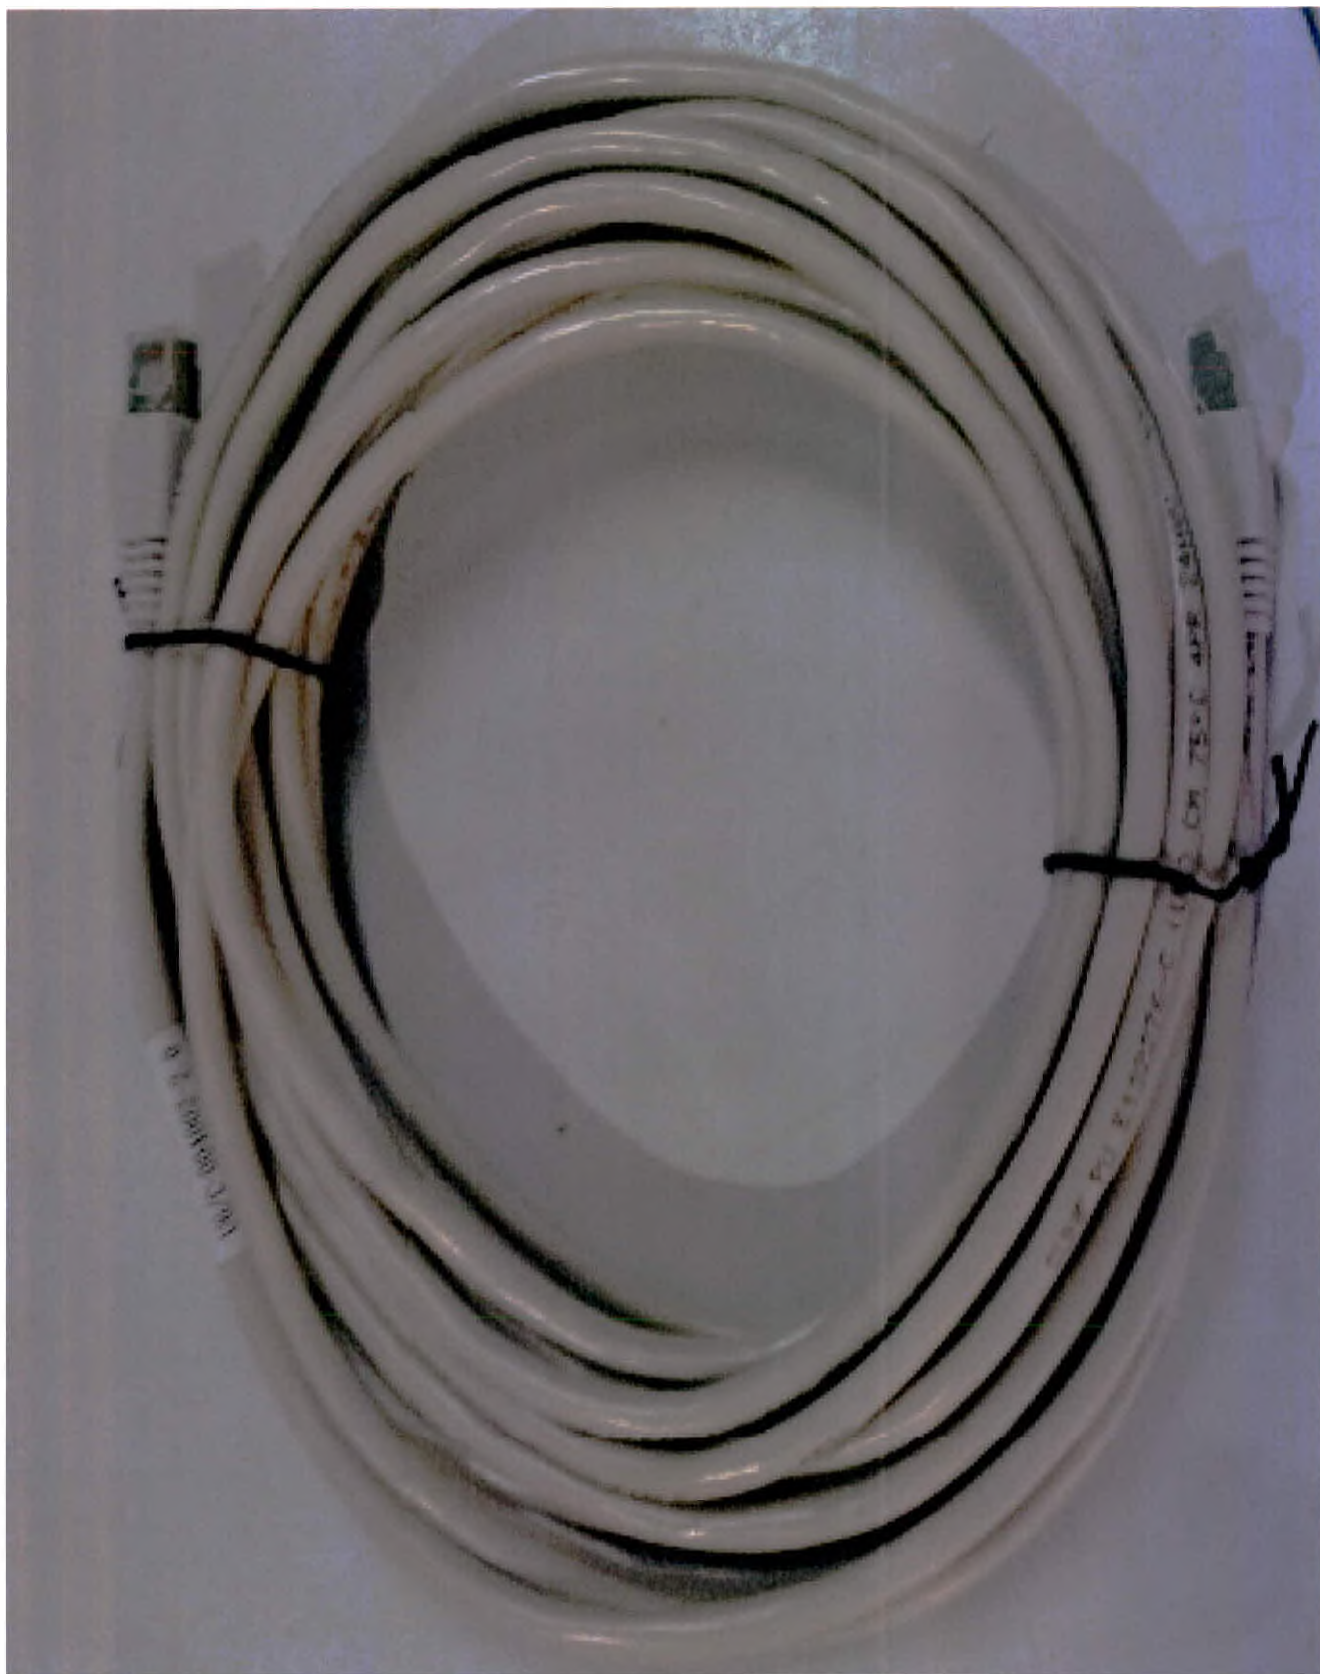

100. Сетевой кабель 8— не более 12 шт. (при необходимости).



101. Сетевой кабель (ЛИС) – не более 12 шт. (при необходимости).



102. Сетевой кабель 9 – не более 12 шт. (при необходимости).



103. Сетевой кабель 10 – не более 12 шт. (при необходимости).



104. Сетевой кабель 11– не более 12 шт. (при необходимости).



105. Сетевой кабель 12 – не более 12 шт. (при необходимости).



106. Сетевой кабель 13 – не более 12 шт. (при необходимости).



107. Сетевой кабель 14 – не более 12 шт. (при необходимости).




108. Сетевой кабель 15 – не более 12 шт. (при необходимости).



109. Кабель CAT5 Ethernet – не более 12 шт. (при необходимости).



110. Разъем кабеля CAN-шины – 1 шт. (при необходимости).

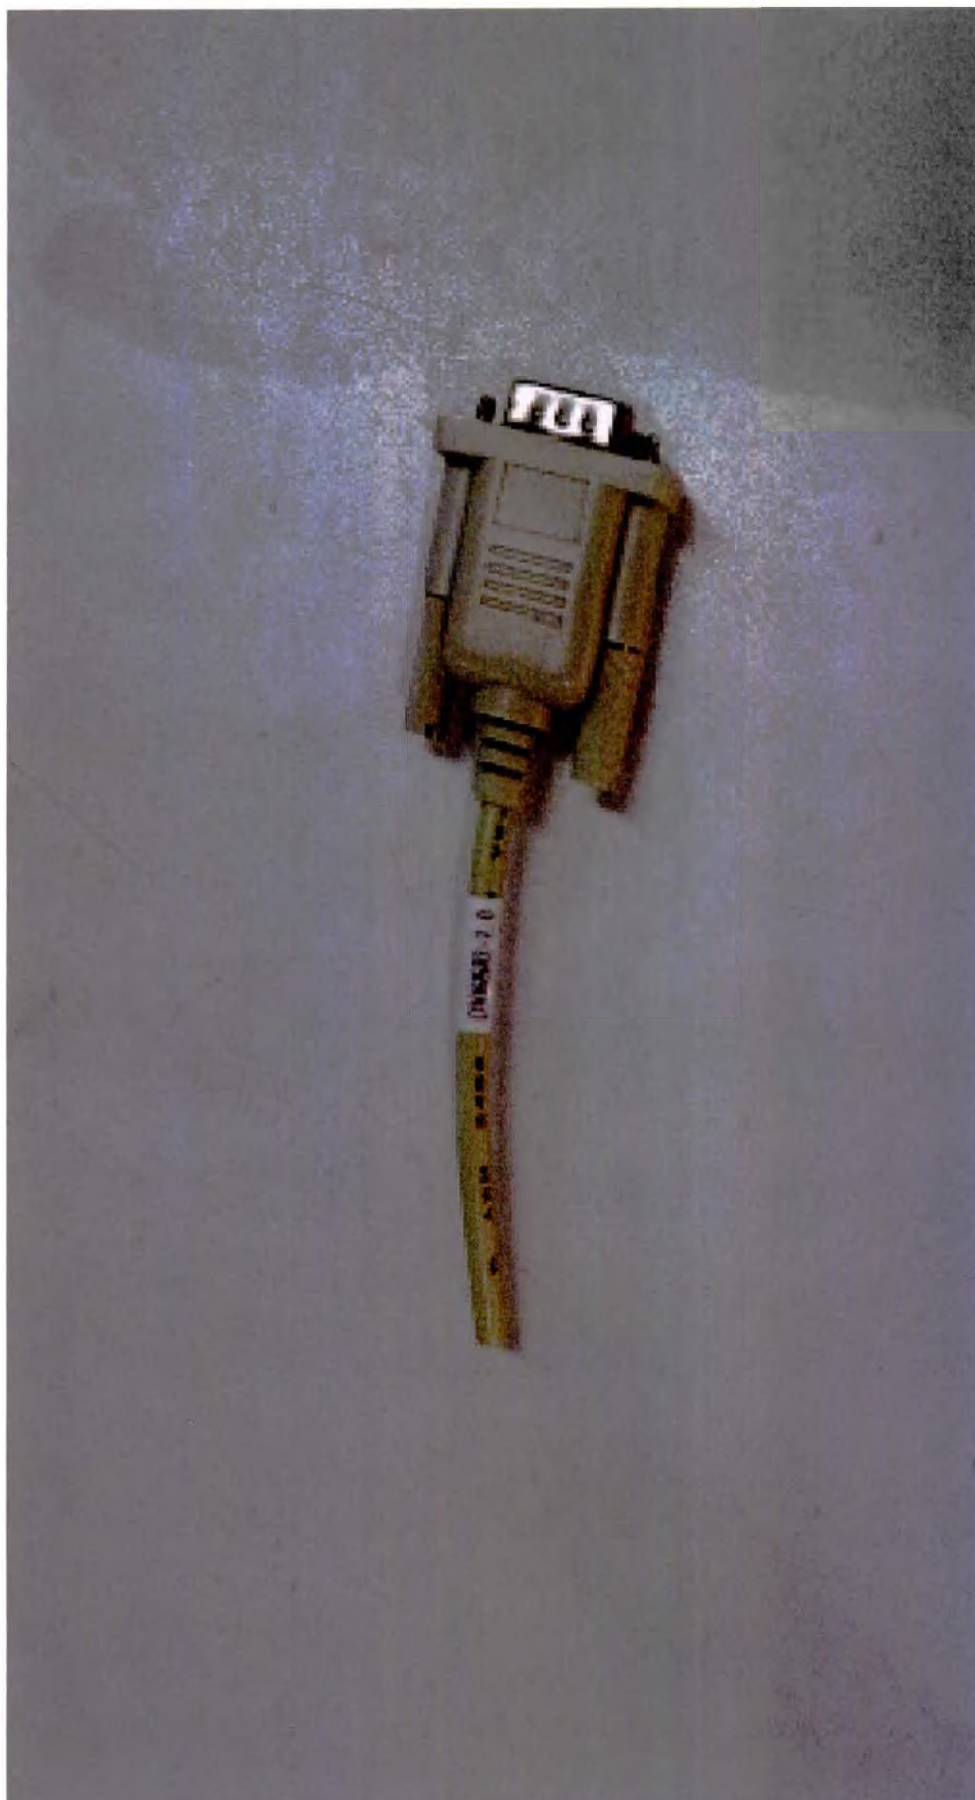


111. Линия передачи переменного тока – 1 шт. (при необходимости).




112. Набор CD-дисков программного обеспечения – 1 шт., в составе (при необходимости):

- Laboratory Data Management SoftWare (Client) – 1 шт;

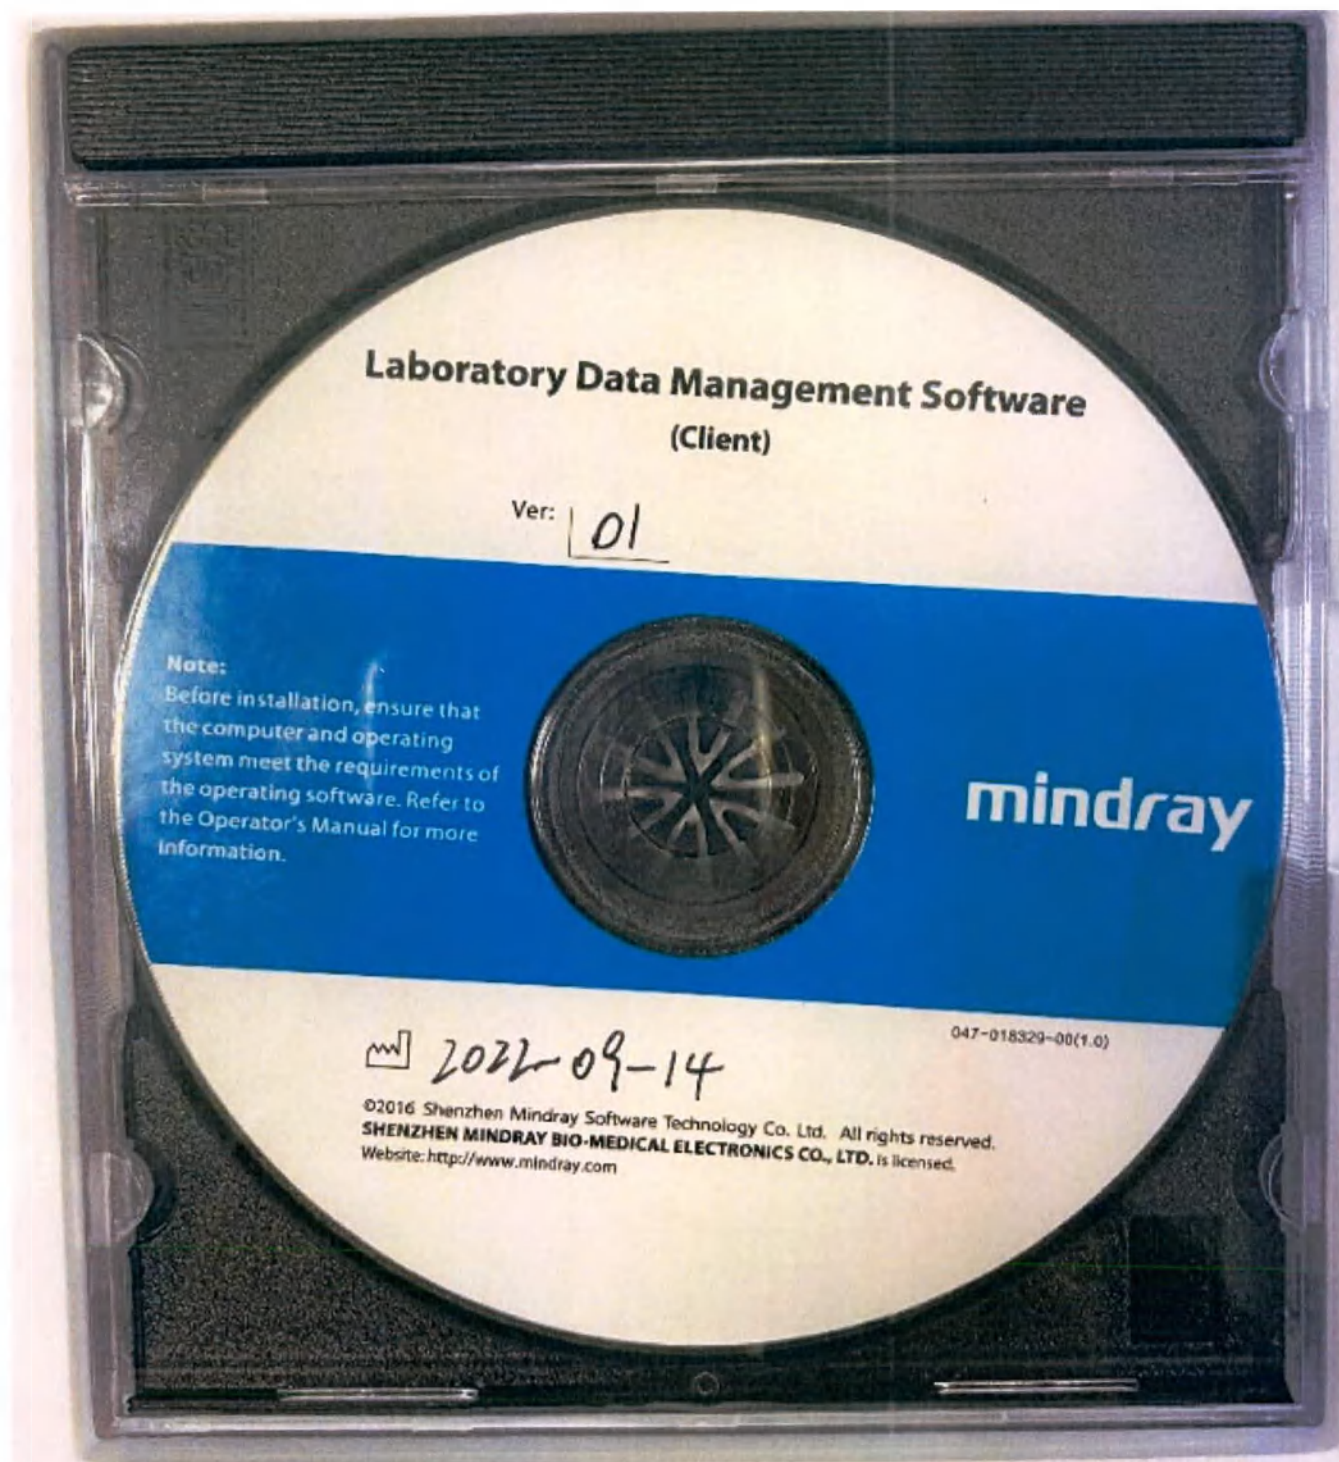


- Laboratory Data Management SoftWare (Server) – 1 шт.

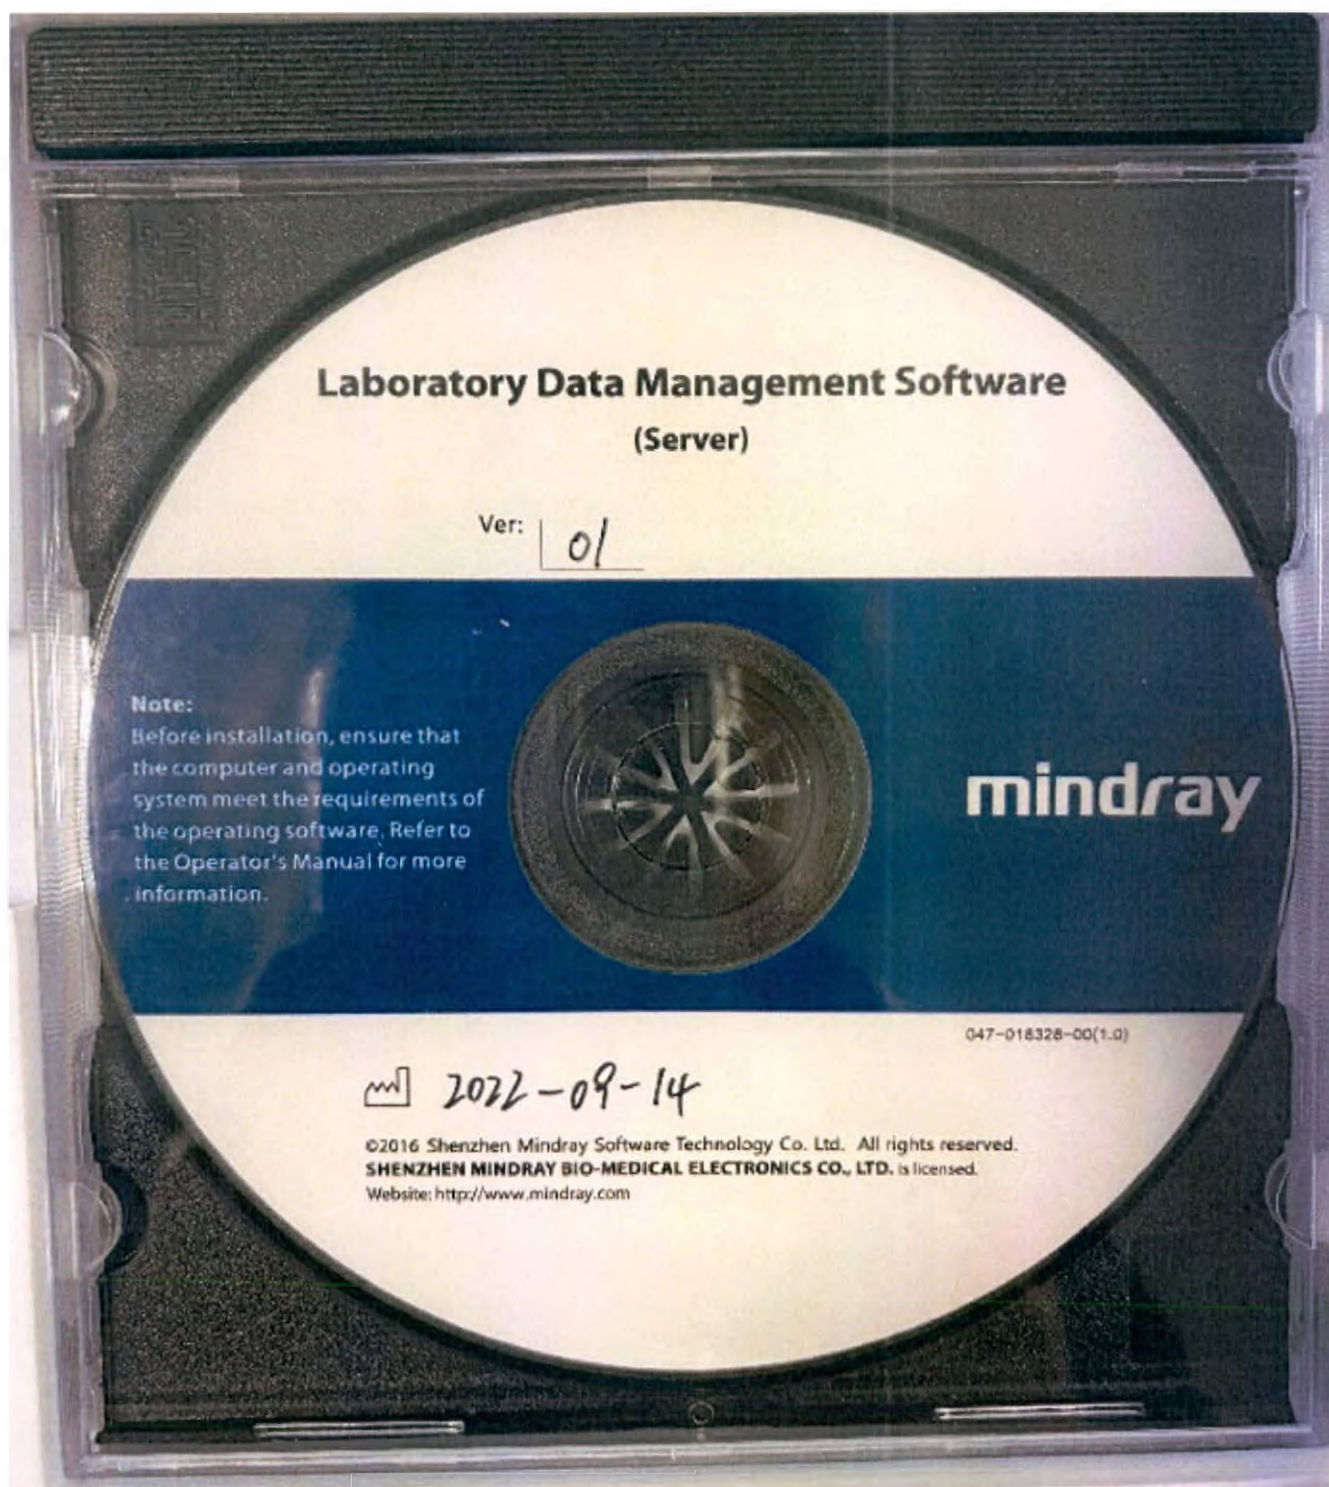


113. Диск с программным обеспечением – 1 шт. (при необходимости).




114. Ручка для транспортировки приборов – не более 36 шт. (при необходимости).

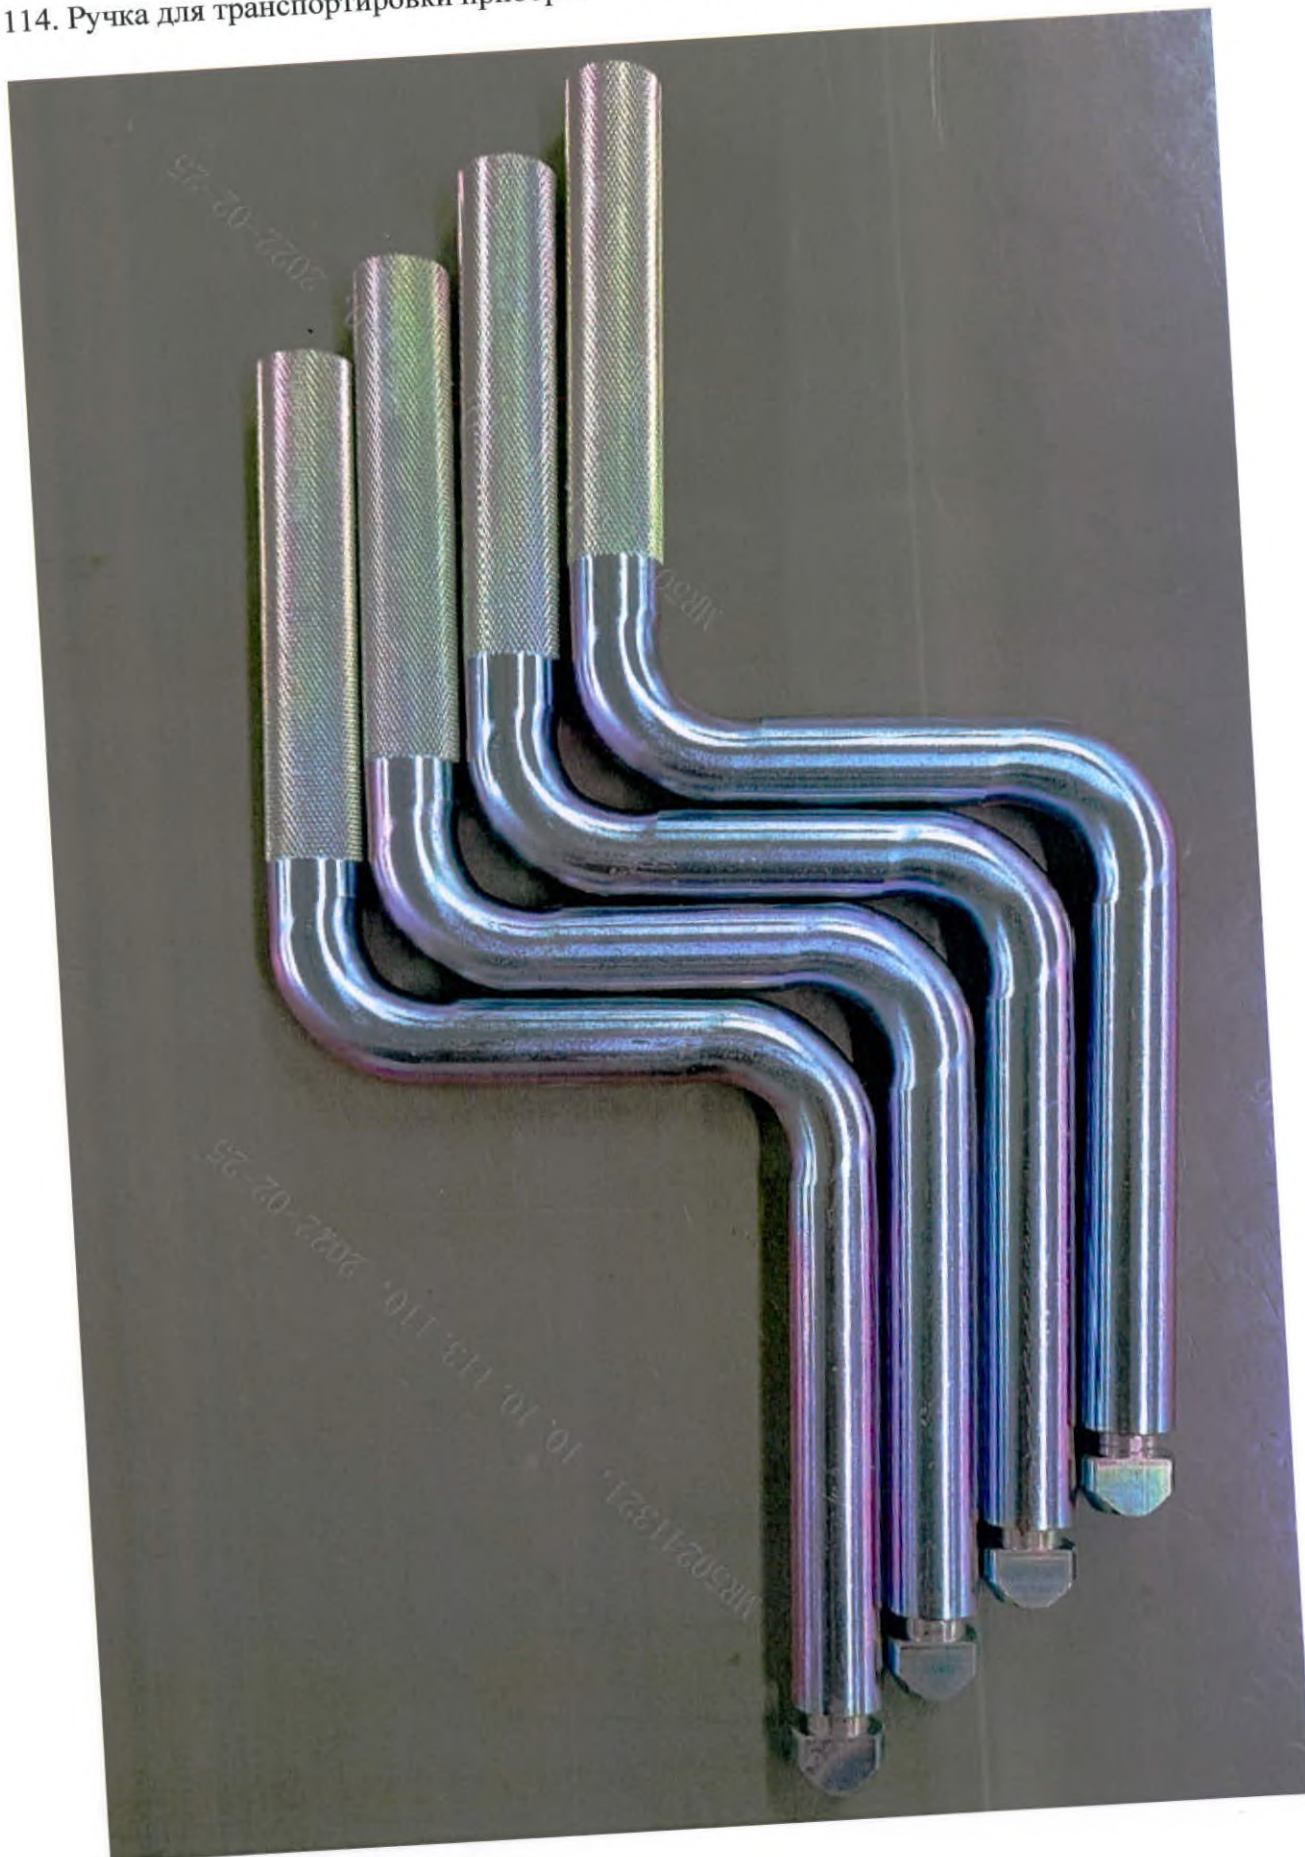

115. Сетевой роутер – 1 шт. (при необходимости).

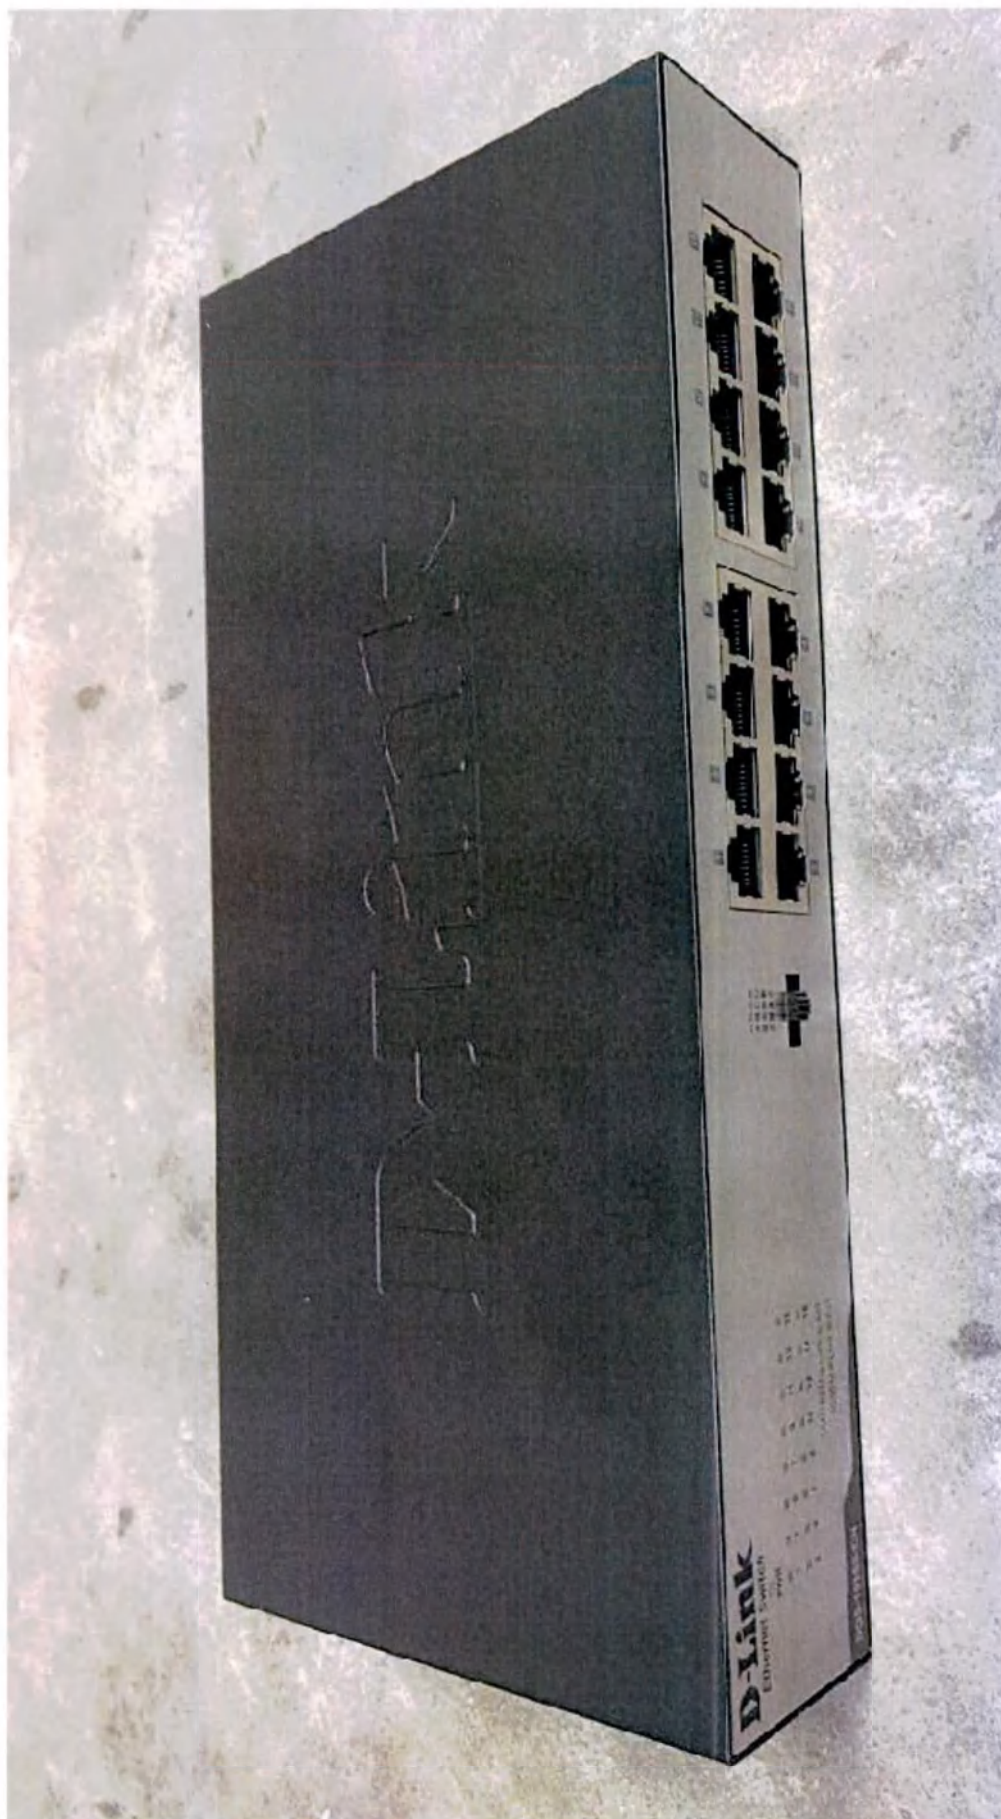

116. Рельса механизма транспортировки кассет прибора SC-120 – не более 2 шт. (при необходимости).

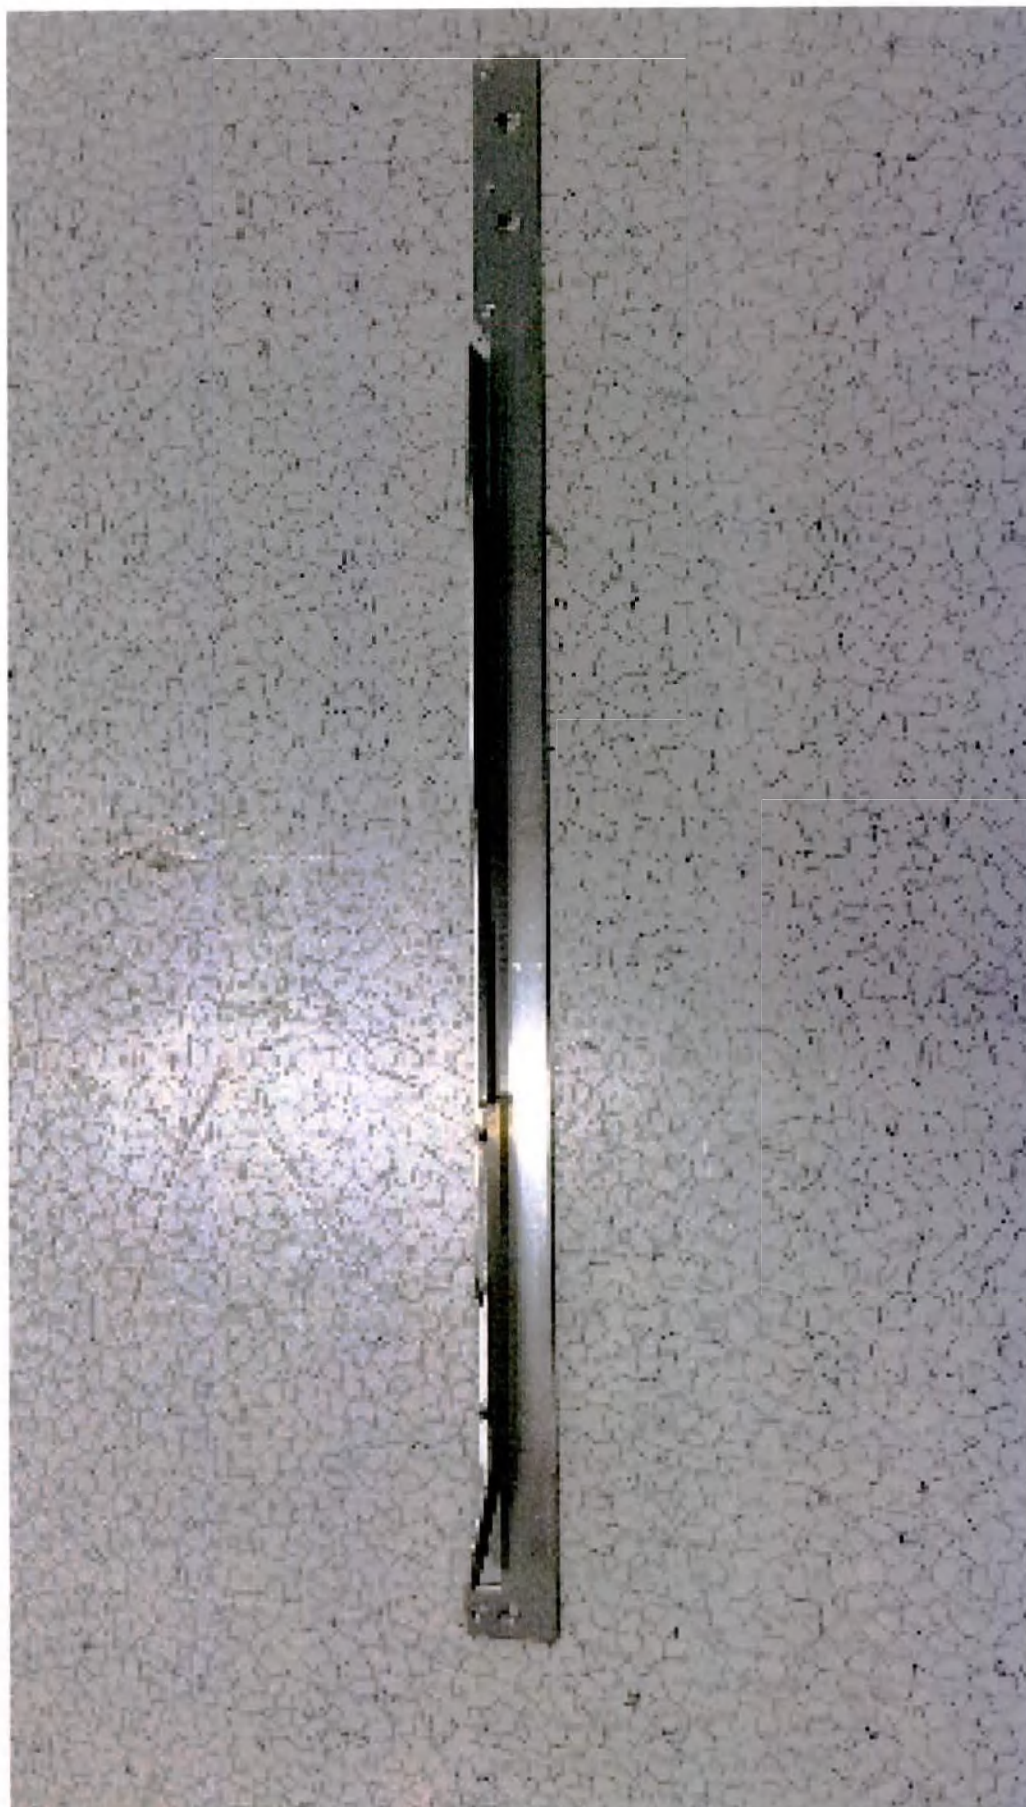


118. Осушитель воздушный – 1 шт. (при необходимости).



120. Емкость сливная – 1 шт. (при необходимости).




121. Адаптер для штативов зеленый – не более 40 шт. (при необходимости).

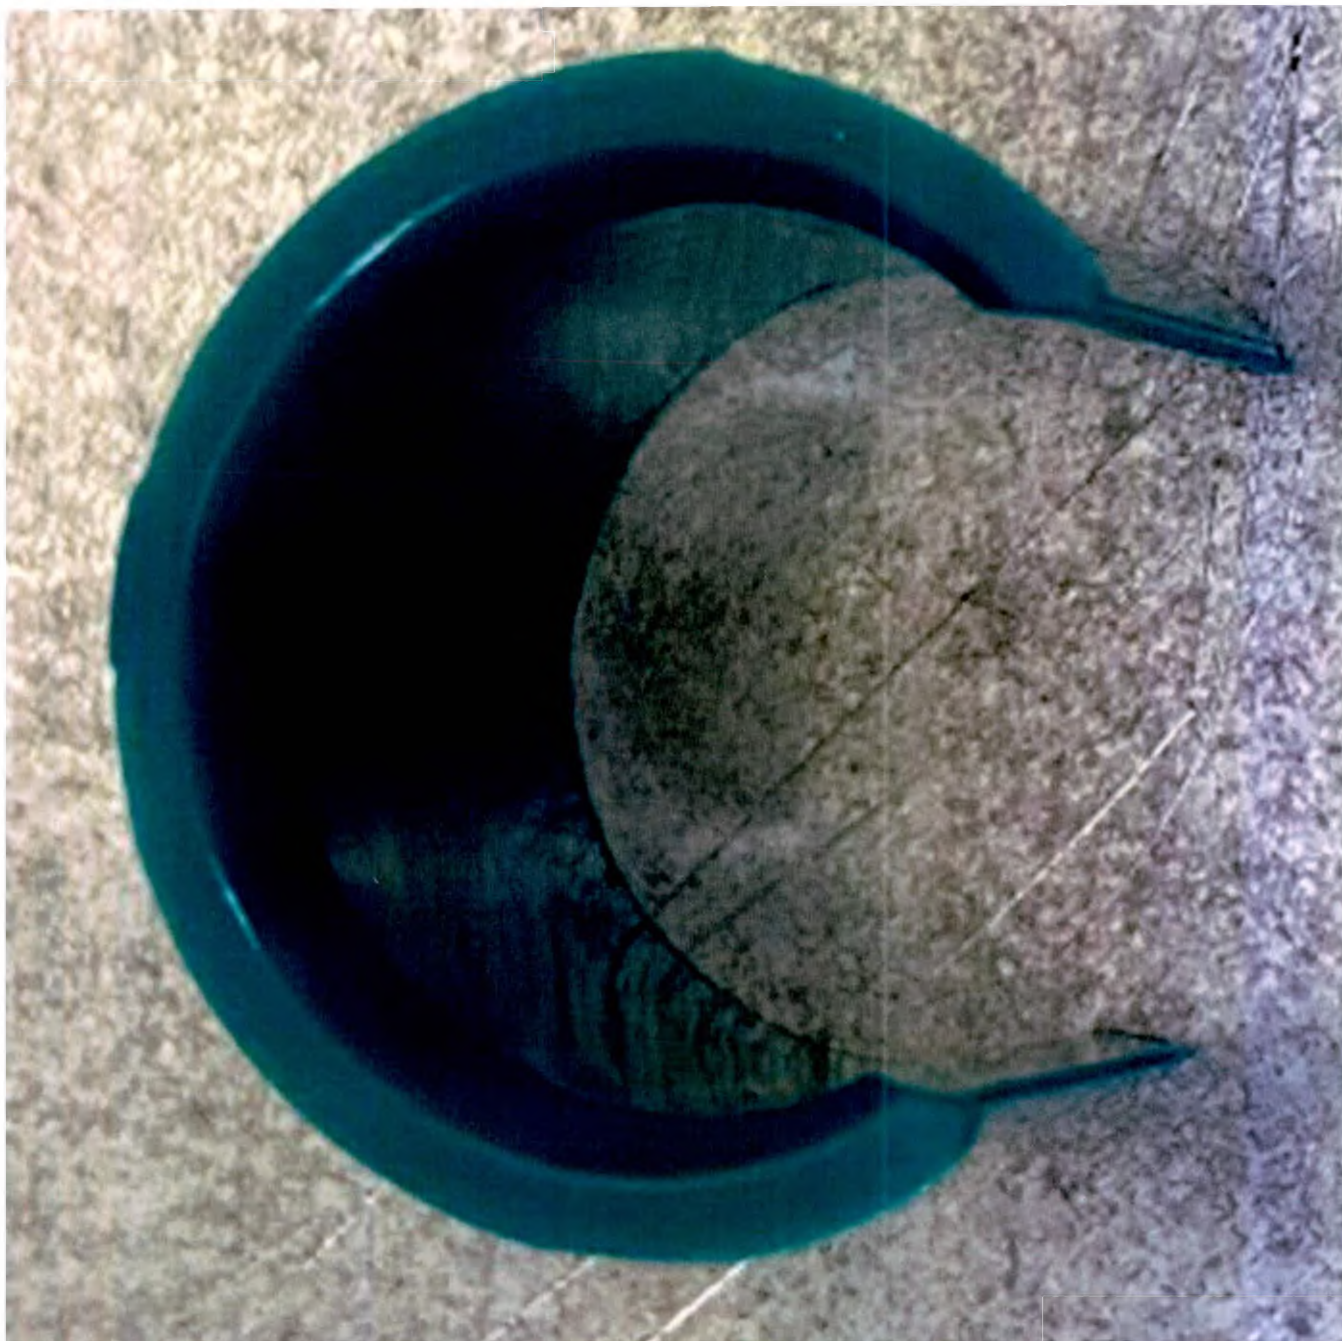

122. Адаптер для штативов красный – не более 40 шт. (при необходимости).




123. Адаптер для штативов синий – не более 40 шт. (при необходимости).

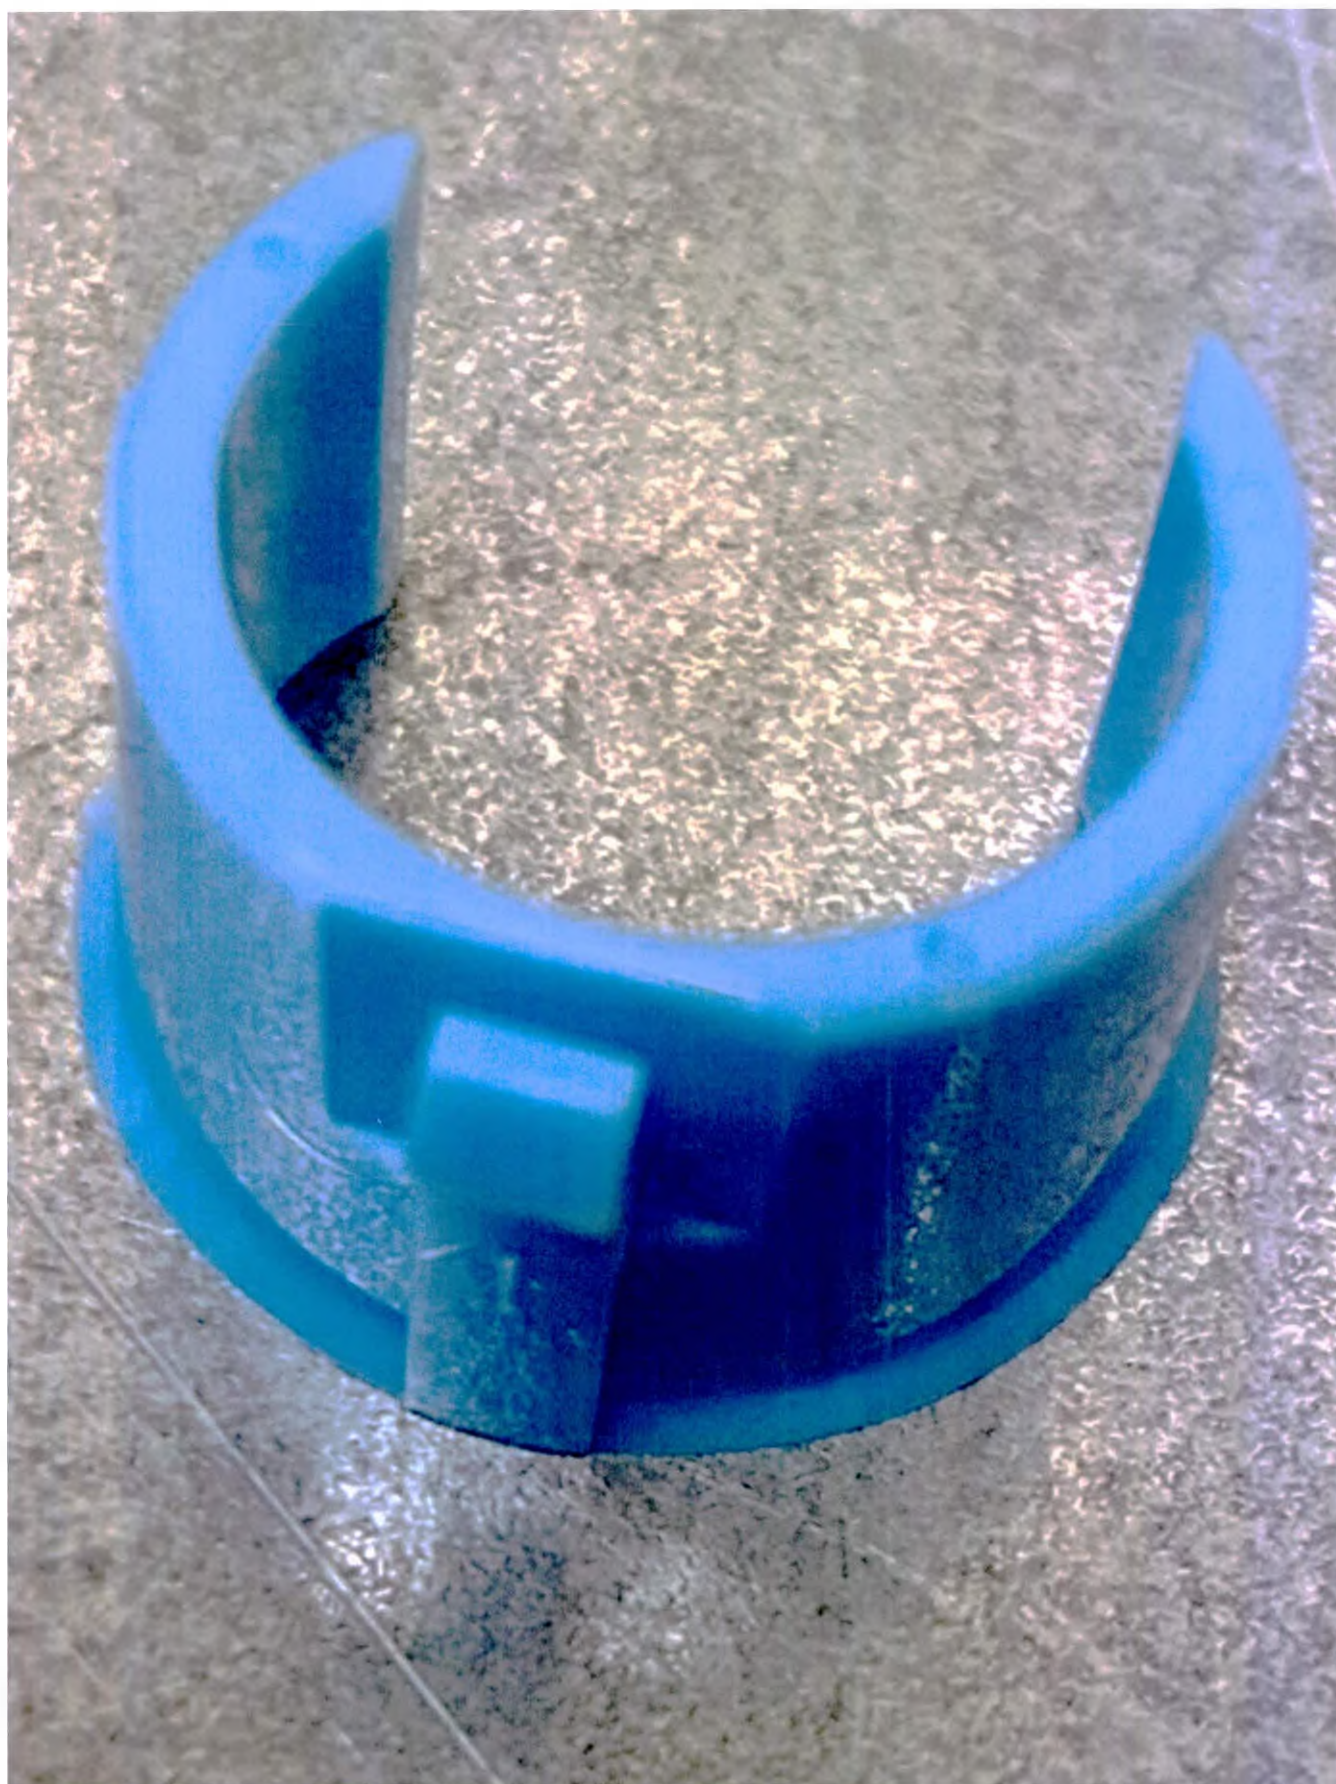

124. Адаптер для штативов желтый – не более 40 шт. (при необходимости).



125. Адаптер для штативов оранжевый – не более 40 шт. (при необходимости).

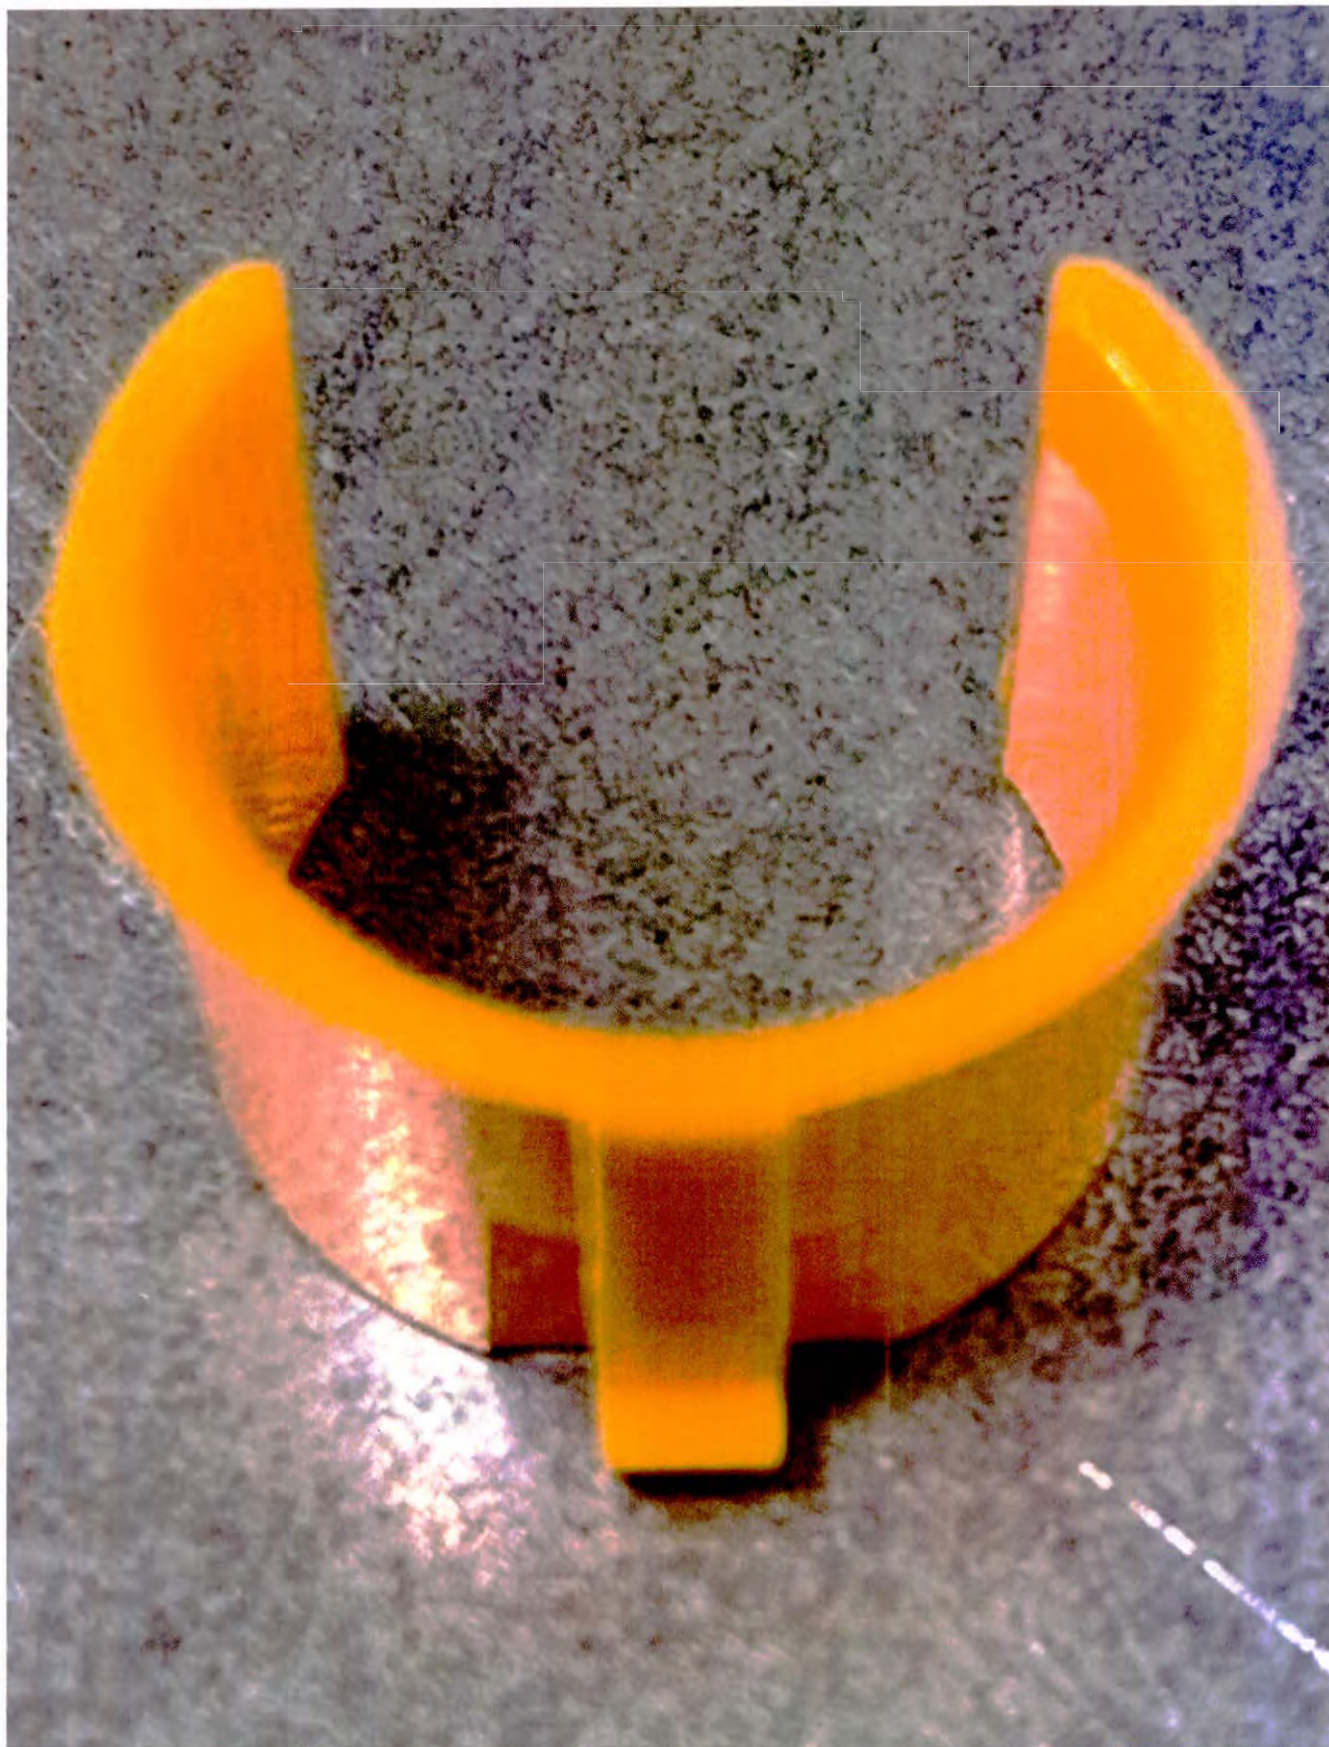



ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
211 ЛИСТОВ

Сысоев

ПО ДОЗЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСОЕВ Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

