

Общая маркировка изделия на штативе




Стойка с мониторами



Маркировка рентгеновской трубки




Общий вид аппарата, заводской номер: 21113-32

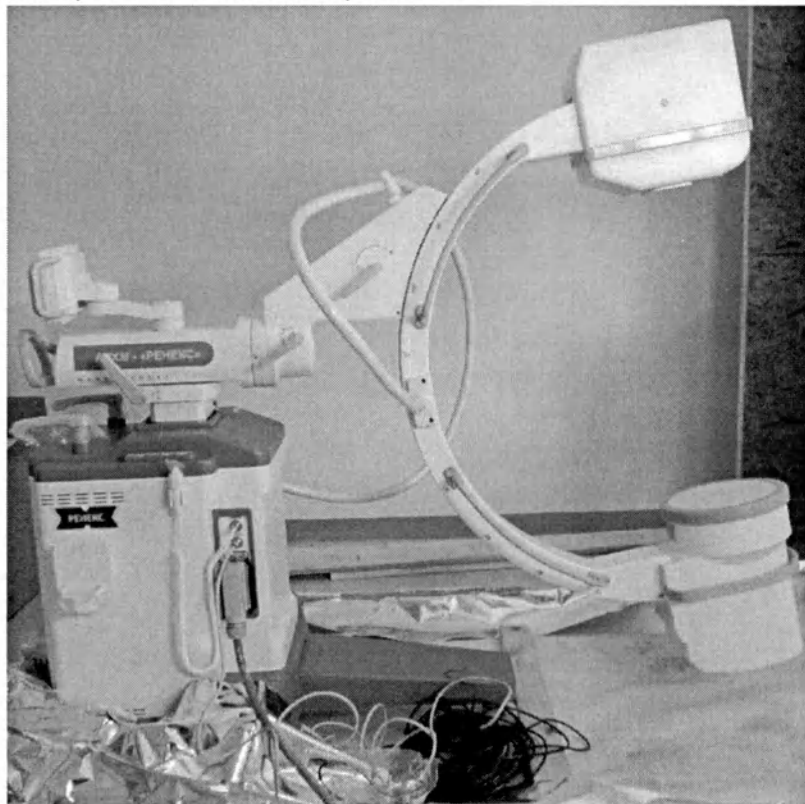


Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
 Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего протокола без разрешения
 ИЛ Б ТС «ВНИИФТРИ-ТЕСТ», ИЦМТ ВНИИФТРИ

Педаль ножного управления

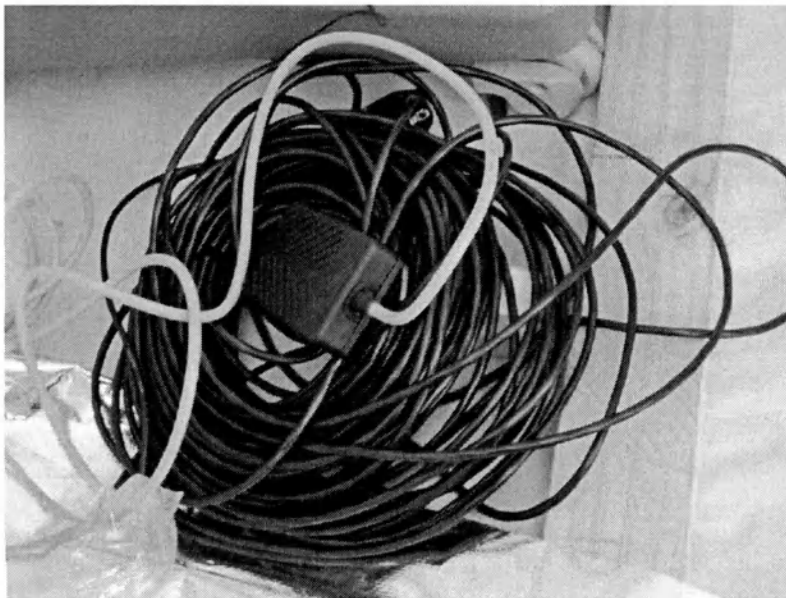

Рукоятки управления (перемещения), кнопка аварийной остановки рентгеновского излучения (красная)



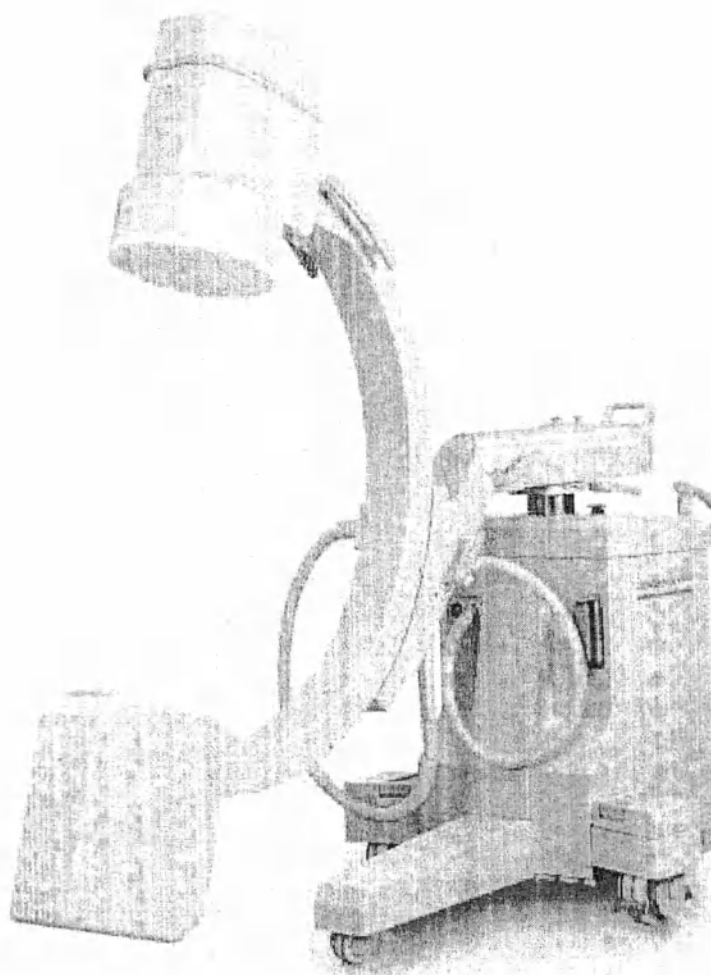

Внешний вид аппарата APXM-«РЕНЕКС»