


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ"  
серия 7

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусанов  
2022 г.



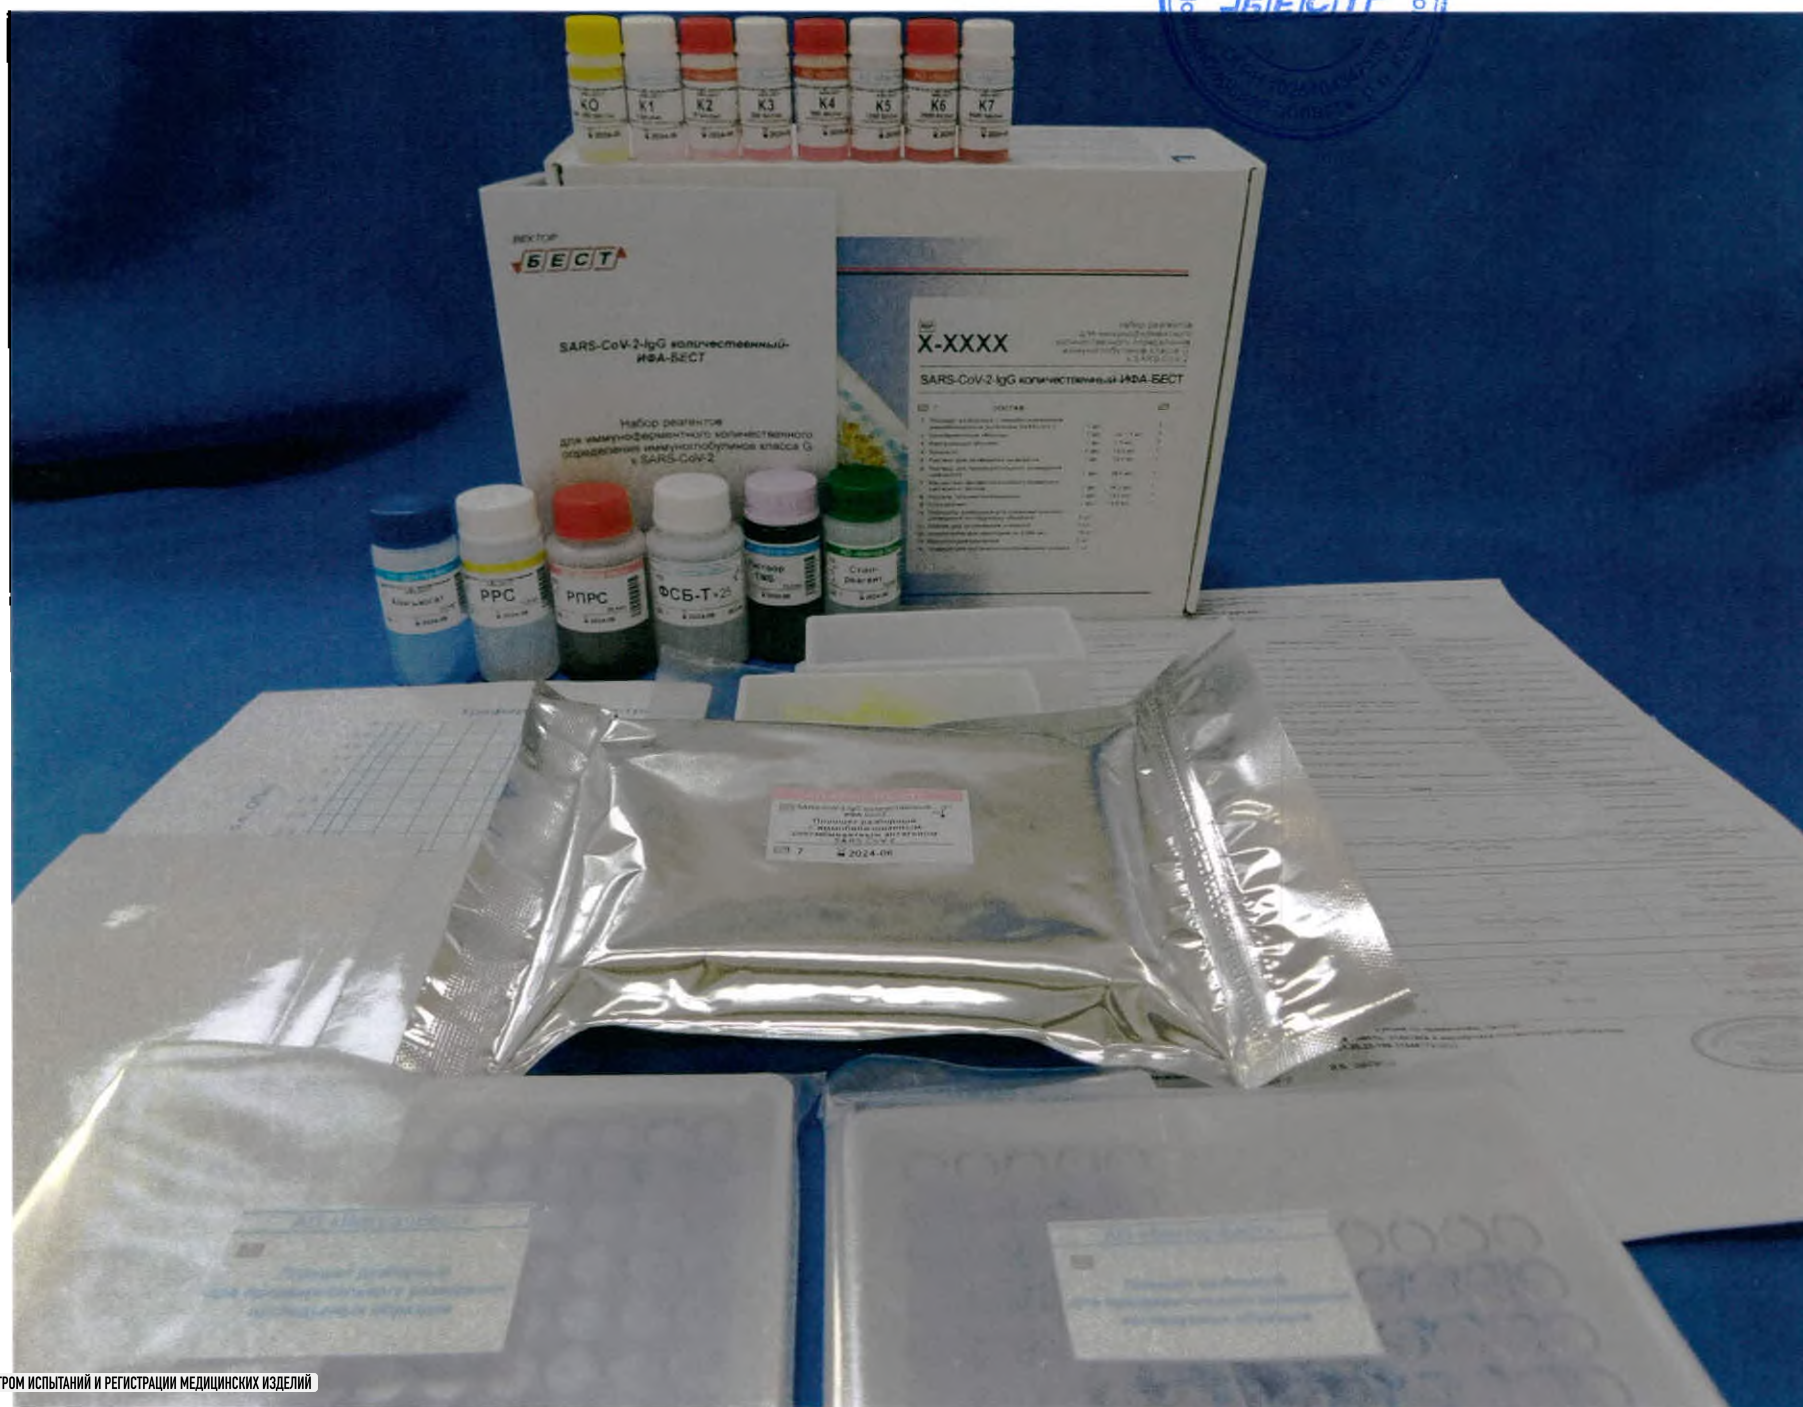

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 1  
серия 7

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
"05" 2022 г.  
М.П.  
Акционерное общество  
«Вектор-Бест»  
ВЕКТОР  
БЕСТ  
ОГРН 1025404347550  
Новосибирская область, г.п. Новосибирск





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 2  
серия 7



М.Д. Хусаинов  
"05" / "12" / 2022 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 3  
серия 7

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов  
2022 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 4  
серия 7

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
2022 г.

М.П. ВЕКТОР-БЕСТ





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 5  
серия 7

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
“05” \_\_\_\_\_ 2022 г.  
М.П.  
АО «Вектор-Бест»  
Иркутская область, Р.п. Котлowski





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 6  
серия 7

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
"05" 12/ 2022 г.

Вектор-Бест  
М.П.  
ОГРН 1025404347880  
Общество с ограниченной ответственностью





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 7  
серия 7

Генеральный директор  
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
“05” 12 2022 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 8  
серия 7

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов  
2022 г.





Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
**“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 1**  
 серия 7


Генеральный директор  
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
 “25” 12 2022 г.





Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 2  
серия 7


Генеральный директор  
АО “Вектор-Вест” М.Д. Хусаинов  
“05” 12 2022 г.

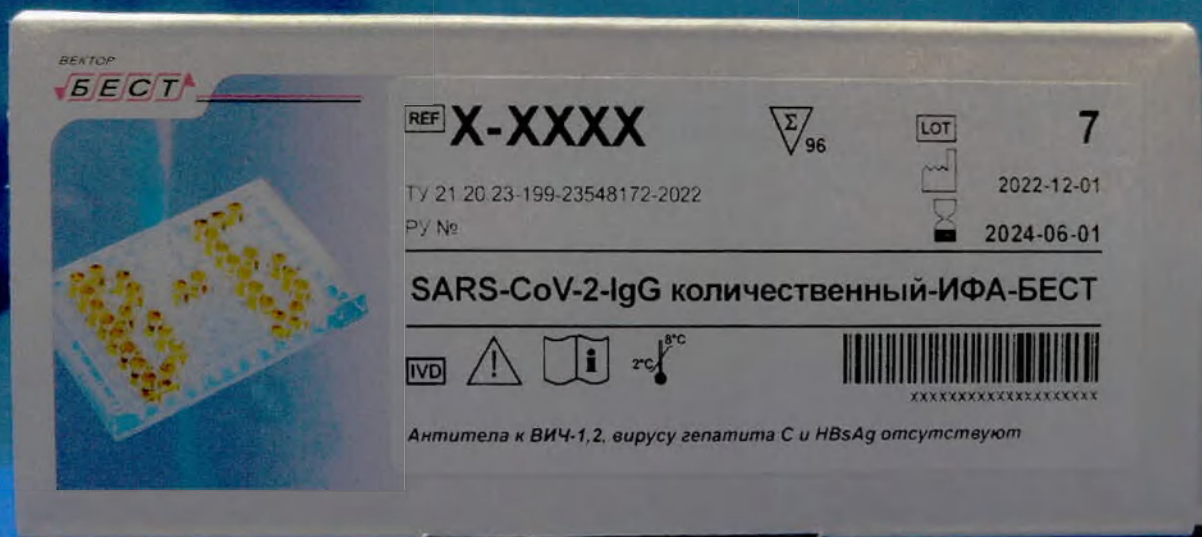



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 3  
серия 7


Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
"13" 12/ 2022 г.

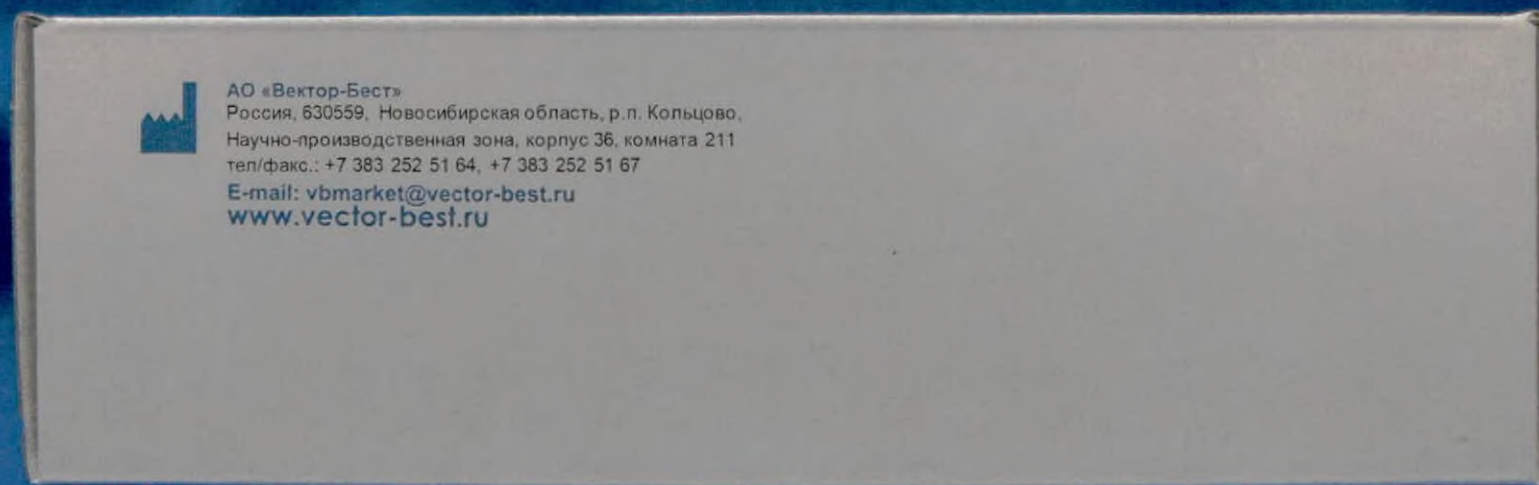



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ"  
серия 8

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
"15" 12 2022 г.

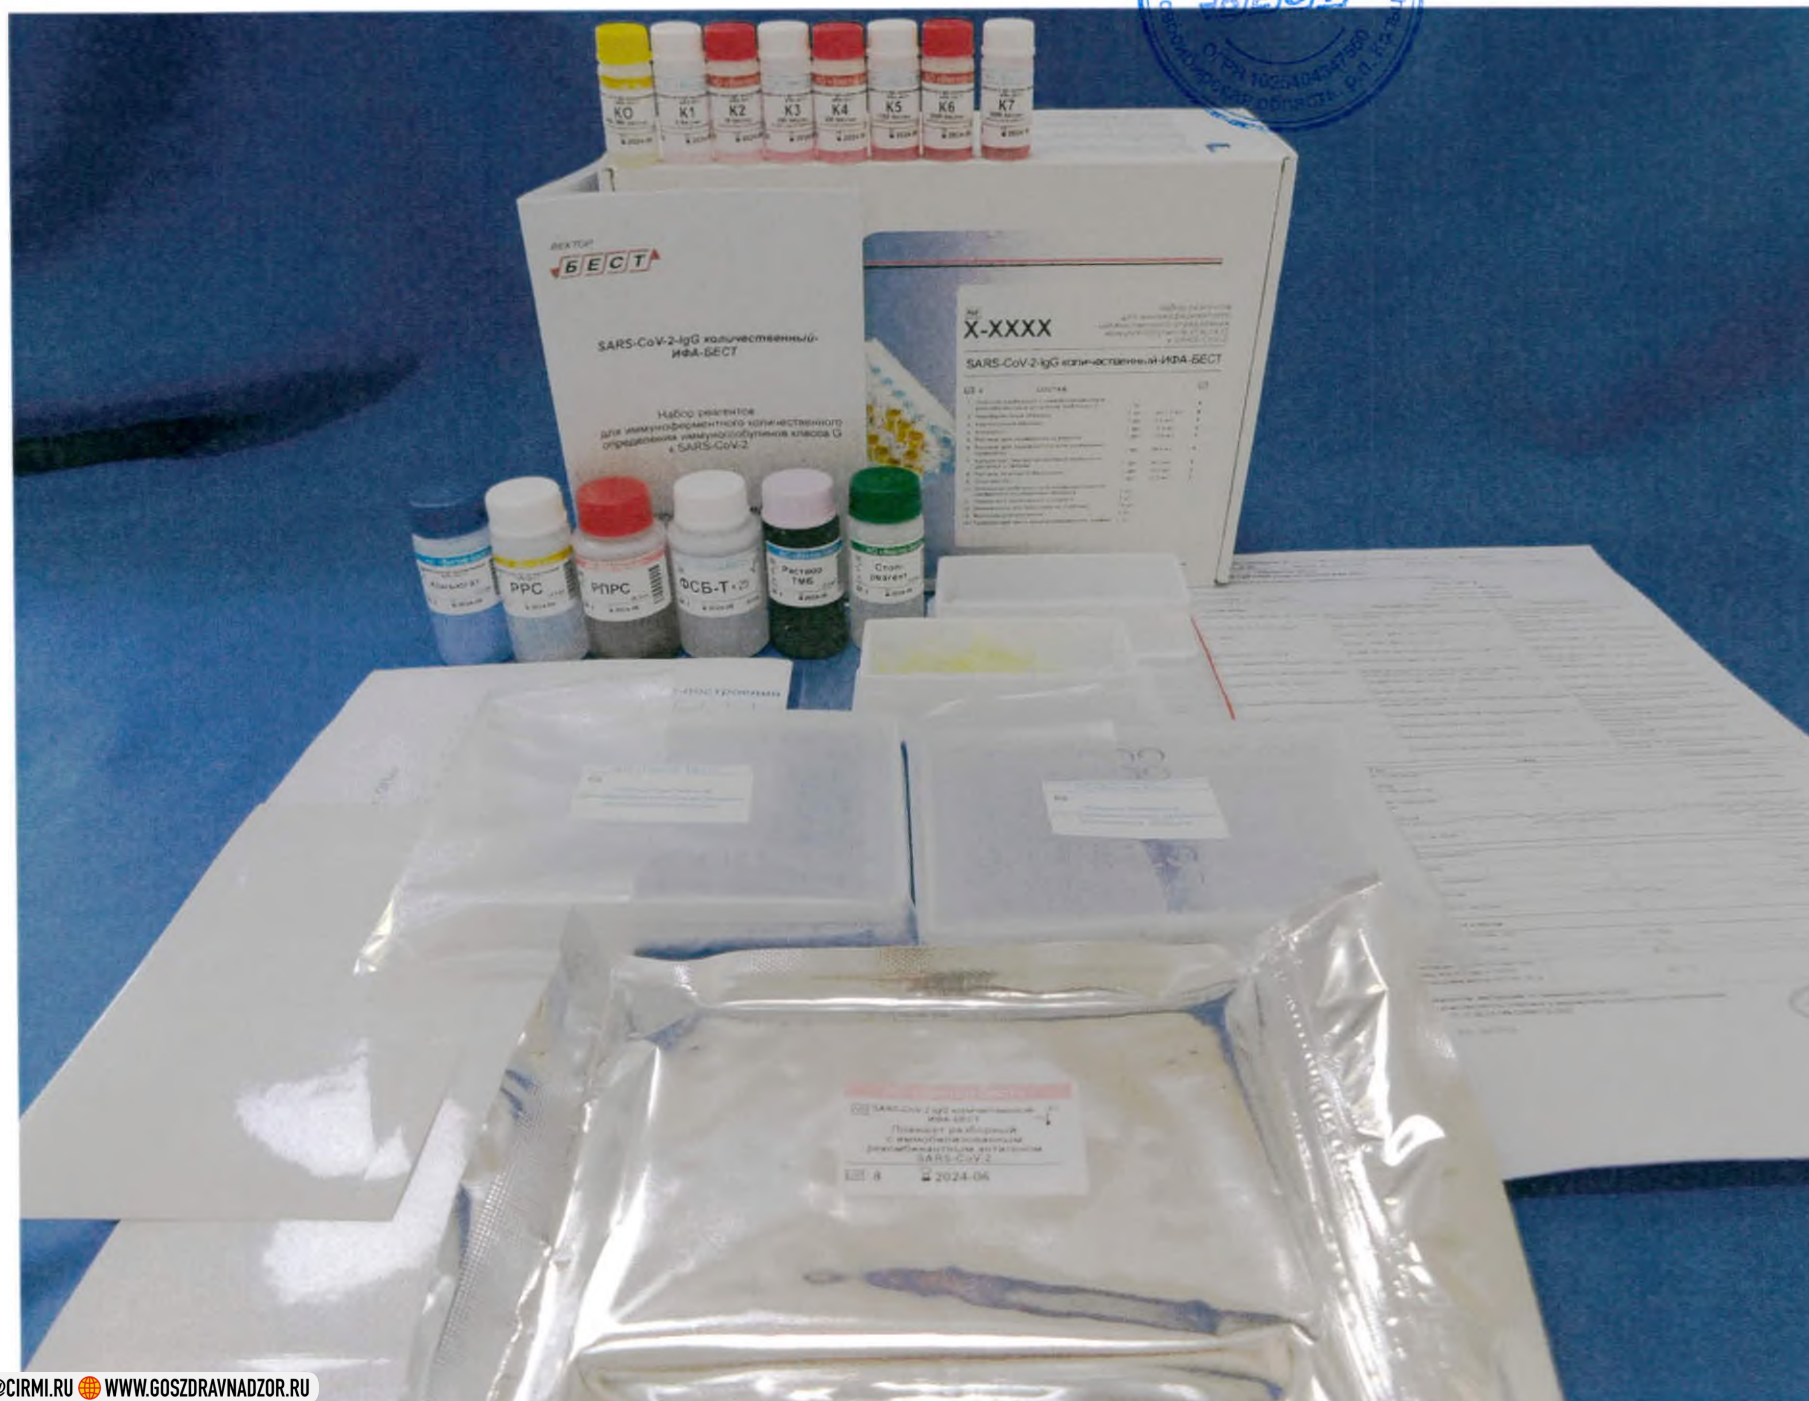




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 1  
серия 8

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
“05” 14 2022 г.

М.П.  
Вектор-БЕСТ  
ОГРН 1025404347650  
Новосибирская область, р.п. Бердск

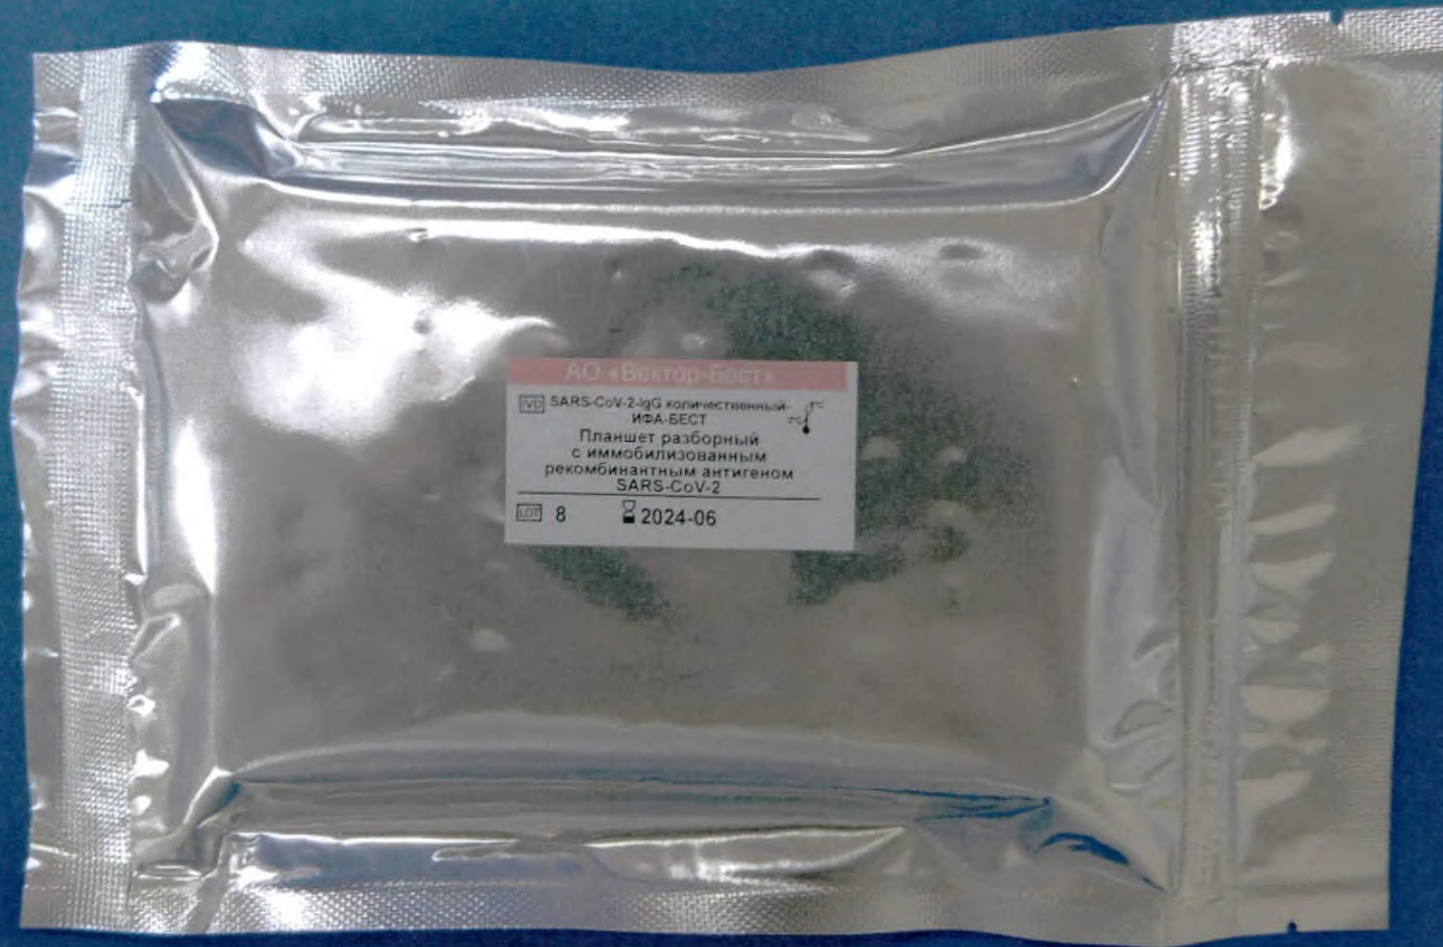



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 2  
серия 8

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
“25” 2022 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 3  
серия 8

Генеральный директор  
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов  
12/12/2022 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 4  
серия 8

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
“05” 12 2022 г.

Вектор-Бест  
М.П.  
ОГРН 1024401000000





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 5  
серия 8

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
“05” 12/2022 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 6  
серия 8

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов  
“05” 12 2022 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 7  
серия 8

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
“05” 12/ 2022 г.

Вектор-Бест  
М.П.  
ОГРН 1026404347850  
Новосибирская область, г.п. Кемерово





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
**“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 8**  
*серия 8*

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2022 г.





Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
 “SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 1  
 серия 8

Генеральный директор  
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов

“05” 12/ 2022 г.





Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 2  
серия 8


Генеральный директор  
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов  
“05” 12/ 2022 г.





Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия  
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 3  
серия 8

Генеральный директор  
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов  
"05" 12/2022 г.




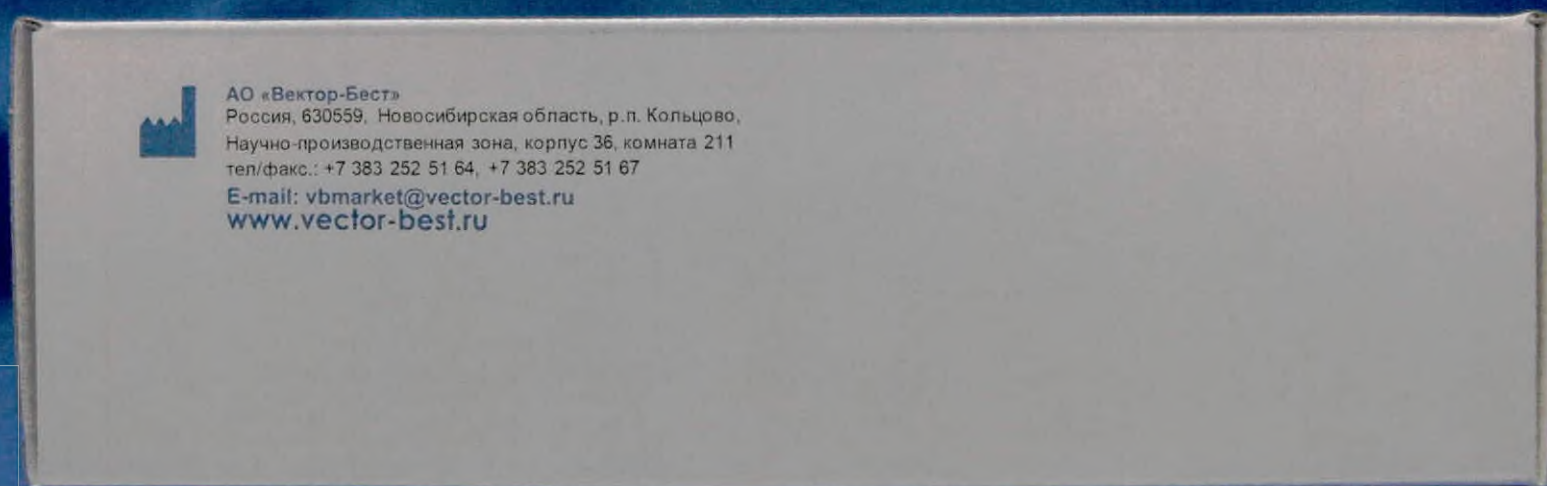




**Образцы маркировки на Набор реагентов**  
**для иммуноферментного количественного определения иммуноглобулинов класса G**  
**к SARS-CoV-2**

**“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ”**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ»
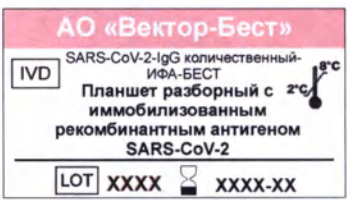
| Наименование компонента                                                  | Этикетка                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2 |    |
| Калибровочный образец                                                    |    |
| Калибровочный образец                                                    |   |
| Калибровочный образец                                                    |  |
| Калибровочный образец                                                    |  |
| Калибровочный образец                                                    |  |
| Калибровочный образец                                                    |  |
| Калибровочный образец                                                    |  |



| Наименование компонента                                                | Этикетка |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Контрольный образец                                                    |          |
| Конъюгат                                                               |          |
| Раствор для разведения сывороток (PPC)                                 |          |
| Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)               |          |
| Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)    |          |
| Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)                              |          |
| Стоп-реагент                                                           |          |
| Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов |          |



## 2. Образцы этикеток на коробке набора «SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ»

### 2.1. Верхняя этикетка.

|                                               |               |                                                                                |                                                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| REF                                           | <b>X-XXXX</b> |                                                                                | набор реагентов для<br>иммуноферментного количественного<br>определения иммуноглобулинов<br>класса G к SARS-CoV-2 |      |
| <b>SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ</b> |               |                                                                                |                                                                                                                   |      |
| LOT                                           | XXXX          | Состав:                                                                        | LOT                                                                                                               | XXXX |
|                                               |               | 1. Планшет разборный с иммобилизованным<br>рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2 | 1 шт.                                                                                                             | xxxx |
|                                               |               | 2. Калибровочные образцы                                                       | 7 фл. по 1,5 мл                                                                                                   | xxxx |
|                                               |               | 3. Контрольный образец                                                         | 1 фл., 1,5 мл                                                                                                     | xxxx |
|                                               |               | 4. Конъюгат                                                                    | 1 фл., 13,0 мл                                                                                                    | xxxx |
|                                               |               | 5. Раствор для разведения сывороток                                            | 1 фл., 12,0 мл                                                                                                    | xxxx |
|                                               |               | 6. Раствор для предварительного<br>разведения сывороток                        | 1 фл., 28,0 мл                                                                                                    | xxxx |
|                                               |               | 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного<br>раствора с твином                 | 1 фл., 28,0 мл                                                                                                    | xxxx |
|                                               |               | 8. Раствор тетраметилбензида                                                   | 1 фл., 13,0 мл                                                                                                    | xxxx |
|                                               |               | 9. Стоп-реагент                                                                | 1 фл., 12,0 мл                                                                                                    | xxxx |
|                                               |               | 10. Планшеты разборные для предварительного<br>разведения исследуемых образцов | 2 шт.                                                                                                             |      |
|                                               |               | 11. Пленки для заклеивания планшета                                            | 2 шт.                                                                                                             |      |
|                                               |               | 12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл                                     | 16 шт.                                                                                                            |      |
|                                               |               | 13. Ванночки для реагентов                                                     | 2 шт.                                                                                                             |      |
|                                               |               | 14. Трафарет для построения калибровочного<br>графика                          | 1 шт.                                                                                                             |      |

### 2.2. Боковая этикетка № 1.

|                                                           |               |                        |            |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|-------------|
| REF                                                       | <b>X-XXXX</b> | $\Sigma$ 96            | LOT        | <b>XXXX</b> |
| ТУ 21.20.23-199-23548172-2022<br>ПУ №                     |               |                        | XXXX-XX-XX | XXXX-XX-XX  |
| <b>SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ</b>             |               |                        |            |             |
| IVD                                                       |               | <br>XXXXXXXXXXXXXXXXXX |            |             |
| Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют |               |                        |            |             |

### 2.3. Боковая этикетка № 2.

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>АО «Вектор-Бест»</b>                                                                                                                                                                                                |
| Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,<br>Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211<br>тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67<br>E-mail: vbmarket@vector-best.ru<br>www.vector-best.ru |

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»  
Директор НИИСД  
АО «Вектор-Бест»

М.Ю. Рукавишников  
«01» 12

2022 г.



Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 3 листов.  
Директор по технологии и качеству  
АО «Вектор-Бест»



*Масяго*  
*12*

Масяго А.В.  
20 22 г.