

Фотографические изображения изделия:

**«Тест-полоски «Exactive» к системе мониторинга уровня
глюкозы в крови «Exactive Vital»»**

Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. («Микротек Медикал
(Ханчжоу) Ко., Лтд.»), Китай.

Генеральный директор


М.П.



Носова Т.А.


« 09 » августа

2019

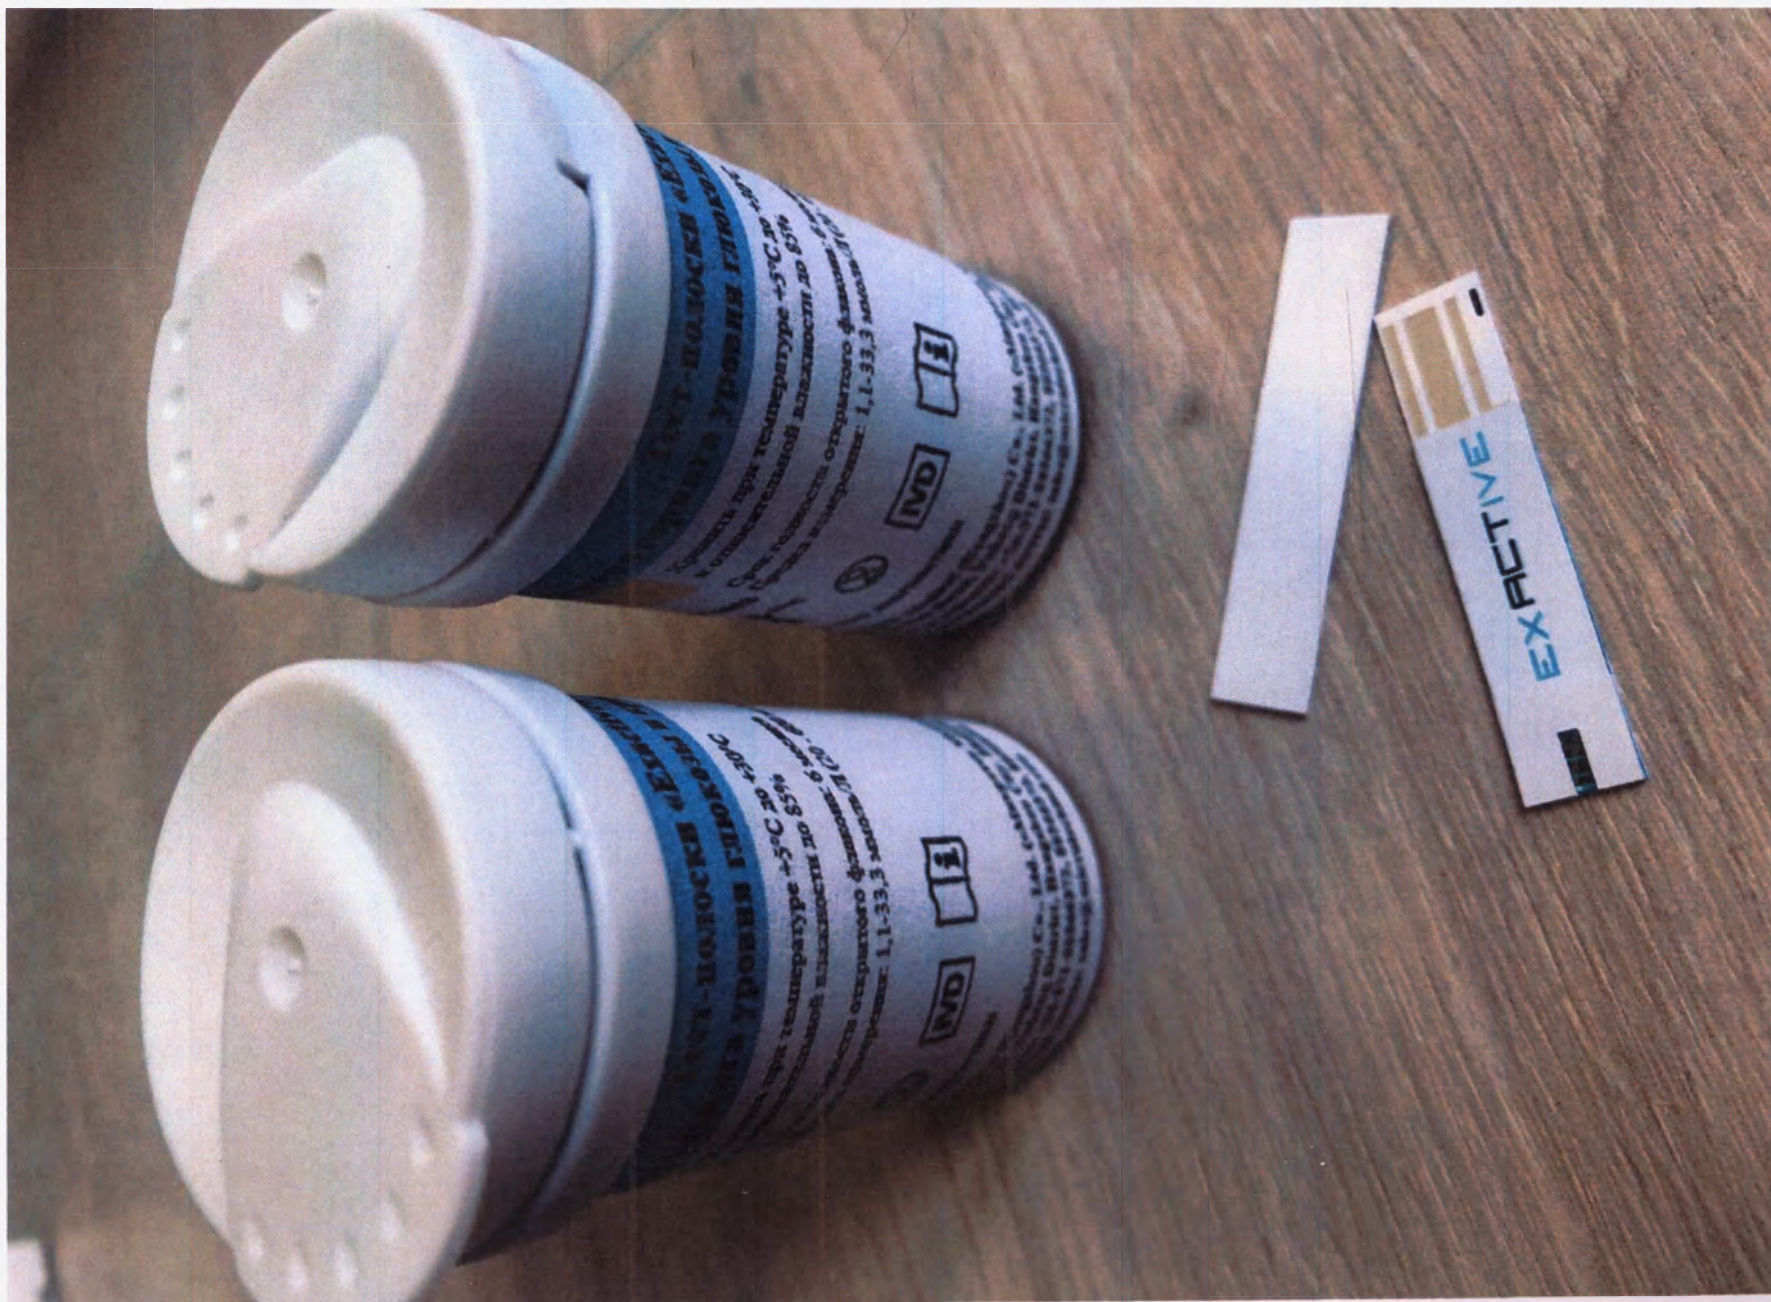

Общий вид Тест-полоски - 2 уп./по 25 шт.



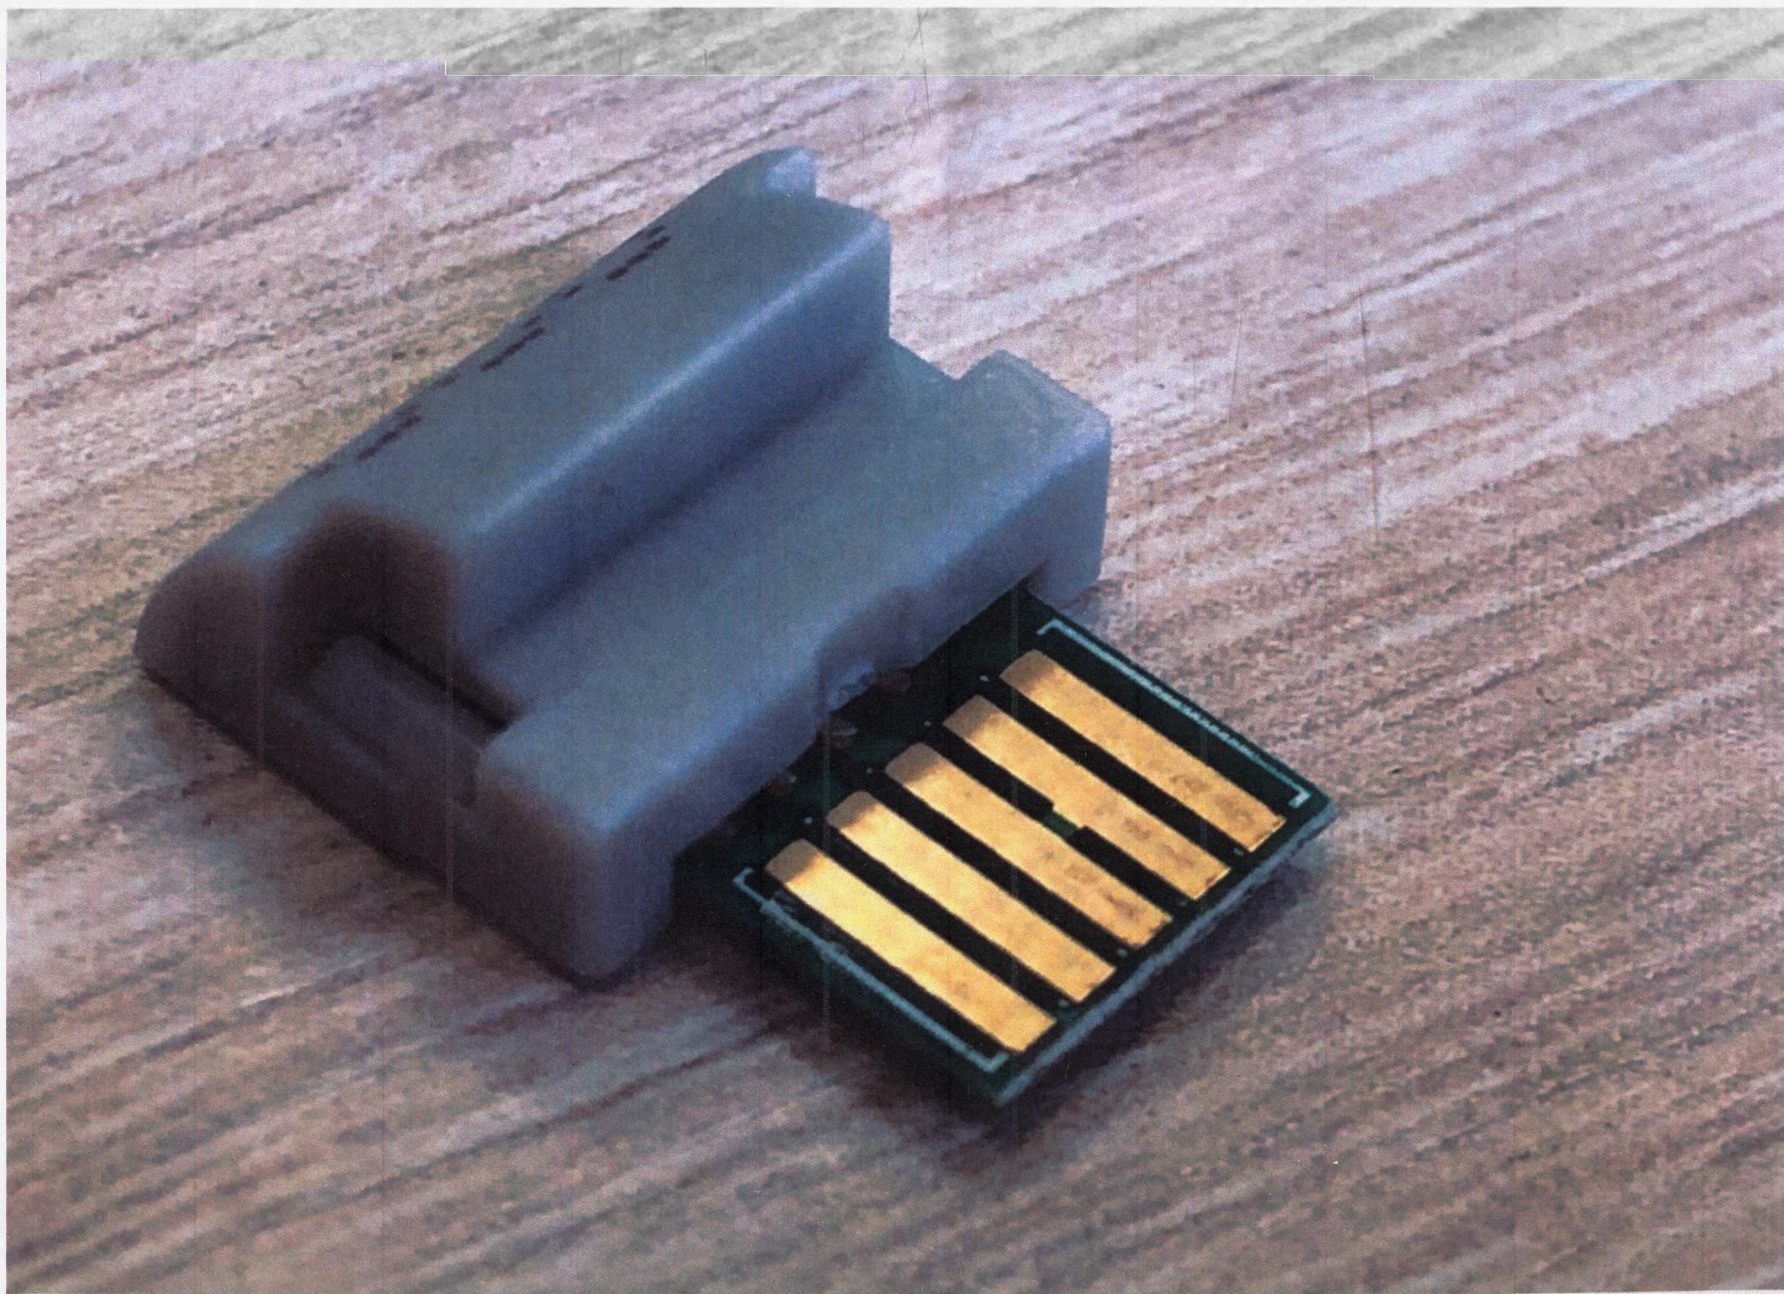

Общий вид Кодового чипа

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: _____ листа (-ов)

Генеральный Директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

