



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

03 2023 г.

Макеты этикеток на медицинское изделие:

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке
(плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Комплектация №1	стр. 2
Комплектация №2	стр. 3
Комплектация №3	стр. 4
Комплектация №4	стр. 5
Комплектация №5	стр. 6
Комплектация №6	стр. 7
Комплектация №7	стр. 8
Комплектация №8	стр. 9

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазаым/глутаматдегидрогеназыым методом
«МОЧЕВИНА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Макет
этикеток



Комплектация №1

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX «МОЧЕВИНА АБРИС+» (уреазно-ГДГ-методом)	НПФ АБРИС+ REF XXXXX Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазаым/глутаматдегидрогеназыым методом «МОЧЕВИНА АБРИС+» Состав набора Комплектация №1 Реагент 1 1 x 40 мл Реагент 2 1 x 10 мл Калибратор 1 x 1 мл 2°C 8°C по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022 РЗН XXXX/XXXXX от XXXX.XXXX г. Для профессионального применения

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 2 10 мл 2°C 8°C	LOT XXX
--	--------------------

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Калибратор, XXX ммоль/л 1 мл 2°C 8°C	LOT XXX
---	--------------------

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 1 40 мл 2°C 8°C	LOT XXX
---	--------------------

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом
«МОЧЕВИНА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Макет
этикеток



Комплектация №2

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXX Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом «МОЧЕВИНА АБРИС+» (уреазно-ГДГ кинетический UV-метод) «МОЧЕВИНА АБРИС+»						
	Состав набора Комплектация №2						
	<table> <tr> <td>Реагент 1</td> <td>1 x 80 мл</td> </tr> <tr> <td>Реагент 2</td> <td>1 x 20 мл</td> </tr> <tr> <td>Калибратор</td> <td>1 x 1 мл</td> </tr> </table>	Реагент 1	1 x 80 мл	Реагент 2	1 x 20 мл	Калибратор	1 x 1 мл
	Реагент 1	1 x 80 мл					
Реагент 2	1 x 20 мл						
Калибратор	1 x 1 мл						
8°C по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022 2°C РЗН XXXX/XXXXX от XXXX.XXXX г. Для профессионального применения							

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 1 80 мл LOT XXX 8°C XXXX-XX
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 2 20 мл LOT XXX 8°C XXXX-XX
--




НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Калибратор, XXX ммоль/л 1 мл LOT XXX 8°C XXXX-XX

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом
«МОЧЕВИНА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Макет
этикеток



Комплектация №3

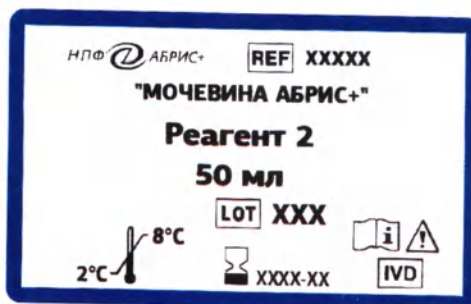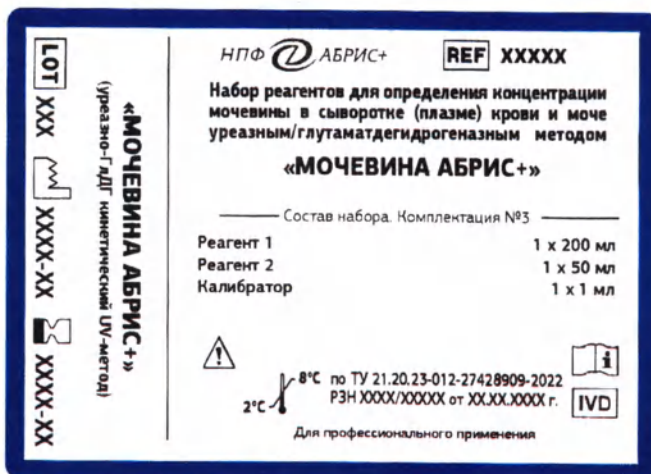

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом
«МОЧЕВИНА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Макет
этикеток



Комплектация №4

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXX Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом «МОЧЕВИНА АБРИС+» Состав набора: Комплектация №4 Реагент 1 2 x 200 мл Реагент 2 2 x 50 мл Калибратор 1 x 2 мл 8°C по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022 2°C РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г. Для профессионального применения	IVD
	«МОЧЕВИНА АБРИС+» (уреазно-г-адг-иниметический CV-метод)	

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 1 200 мл LOT XXX 8°C 2°C XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 1 200 мл LOT XXX 8°C 2°C XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 2 50 мл LOT XXX 8°C 2°C XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 2 50 мл LOT XXX 8°C 2°C XXXX-XX IVD




НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Калибратор, XXX ммоль/л 2 мл LOT XXX 8°C 2°C XXXX-XX IVD
--

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом
«МОЧЕВИНА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Макет
этикеток



Комплектация №5

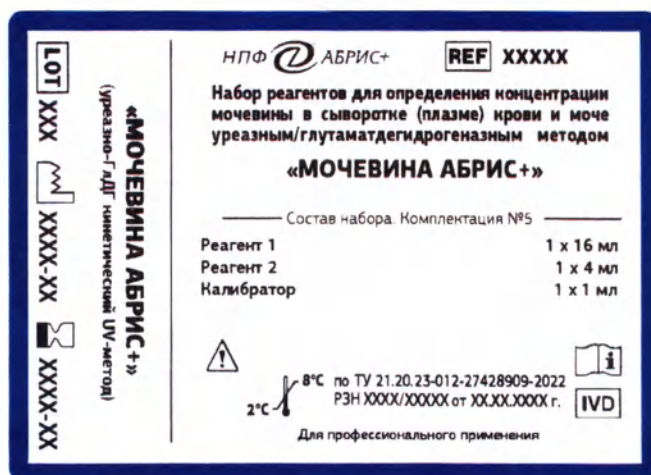

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом
«МОЧЕВИНА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Макет
этикеток



Комплектация №6

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»
(уреазно-г/дг-иниметрический UV-метод)

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Состав набора. Комплектация №6

Реагент 1	5 x 16 мл
Реагент 2	5 x 4 мл
Калибратор	1 x 1 мл

2°C 8°C по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022
РЗН XXXX/XXXX от XXX.XX.XXXX г.

Для профессионального применения

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1
16 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1
16 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1
16 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1
16 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1
16 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2
4 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2
4 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2
4 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2
4 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2
4 мл

2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXX

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Калибратор,
XXX ммоль/л

1 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом
«МОЧЕВИНА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Макет
этикеток



Комплектация №7

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом «МОЧЕВИНА АБРИС+» Состав набора Комплектация №7 Реагент 1 5 x 40 мл Реагент 2 5 x 10 мл Калибратор 1 x 1 мл 2°C 8°C по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022 РЗН XXXX/XXXX от XXXX.XXXX г. Для профессионального применения	 IVD
--	--	----------------

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 1 40 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 1 40 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 1 40 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 1 40 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 1 40 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 2 10 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 2 10 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 2 10 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 2 10 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Реагент 2 10 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD
--

НПФ АБРИС+ REF XXXXX «МОЧЕВИНА АБРИС+» Калибратор, XXX ммоль/л 1 мл 2°C 8°C LOT XXX XXXX-XX IVD

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом
«МОЧЕВИНА АБРИС+» по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Макет
этикеток



Комплектация №8

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

(уреазно-ГДГ-кинетический UV-метод)

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

— Состав набора. Комплектация №8 —

Реагент 1	5 x 80 мл
Реагент 2	5 x 20 мл
Калибратор	1 x 2 мл

8°C по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022
РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

IVD

Для профессионального применения

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1

80 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1

80 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1

80 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1

80 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 1

80 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Калибратор,

XXX ммоль/л

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2

20 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2

20 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2

20 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2

20 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXX**

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Реагент 2

20 мл

8°C

LOT XXX

XXXX-XX

IVD

Прошито и пронумеровано

9 (девять) листов

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский



Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке
(плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022


- Комплектация 1 – лист 2,3
- Комплектация 2 – лист 4,5
- Комплектация 3 – лист 6,7
- Комплектация 4 – лист 8,9
- Комплектация 5 – 10,11
- Комплектация 6 – 12,13
- Комплектация 7 – 14,15
- Комплектация 8 – 16,17

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
09.03.2023



Марковский В.М.



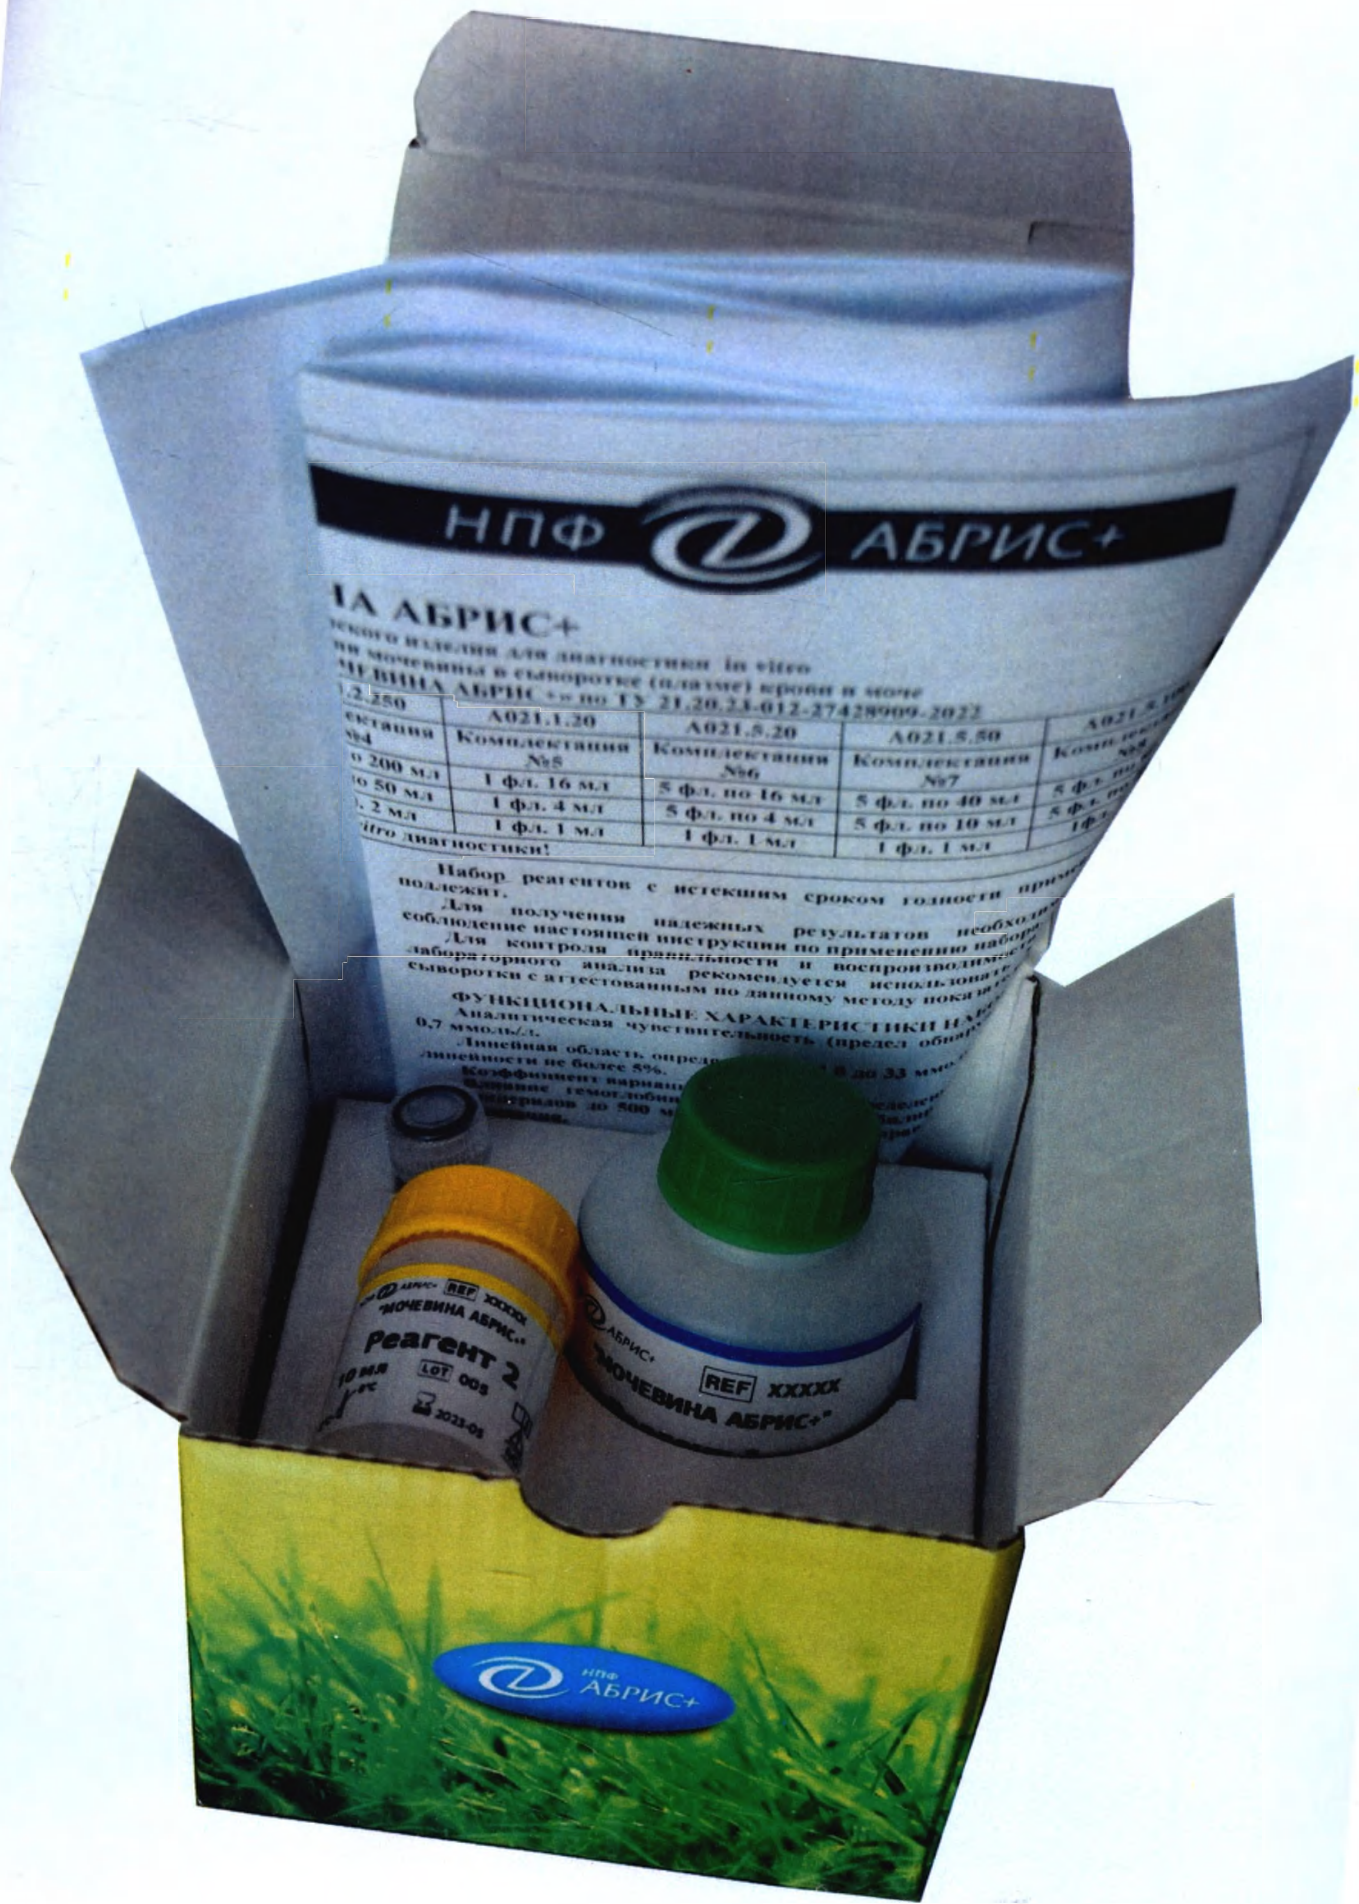

НПФ АБРИС+

1А АБРИС+

реактанта для диагностики in vitro
уровня мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче

АБРИС+ по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022

Объем	А021.1.20	А021.5.20	А021.5.50	А021.5.100
Комплектация №5	Комплектация №6	Комплектация №7	Комплектация №8	Комплектация №9
200 мл	1 фл. 16 мл	5 фл. по 16 мл	5 фл. по 40 мл	5 фл. по 100 мл
50 мл	1 фл. 4 мл	5 фл. по 4 мл	5 фл. по 10 мл	5 фл. по 25 мл
10 мл	1 фл. 1 мл	1 фл. 1 мл	1 фл. 1 мл	1 фл. 1 мл

Набор реагентов с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Для получения надежных результатов необходимо соблюдать настоящие инструкции по применению набора.

Для контроля правильности и воспроизводимости лабораторного анализа рекомендуется использовать сыворотки с аттестованным по данному методу показателем.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

Аналитическая чувствительность (предел обнаружения) 0,7 ммоль/л.

Линейная область определения 0,7 до 33 ммоль/л.

Коэффициент вариации не более 5%.

Время тестирования не более 10 минут.



4

ООО «НПФ «АБРИС+»
г. Москва, ул. Лесотехническая, д. 19, лит. М, 2-й этаж
196009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Создано в России

LOT 005 2023-05

«МОЧЕВИНА АБРИС+»
(Уреазный-глютаминный UV-метод)

НПФ «АБРИС+» REF XXXXX

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазиный/глютаминный/фотометрический метод

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Состав набора: Комплектация №2

Реагент 1 1 x 80 мл
Реагент 2 1 x 20 мл
Намбиратор 1 x 1 мл

20°C ± 0,5°C по ТУ 21.20.23-012-27428990-2023
РН 1000/10000 от 000000001

Для профессионального применения

ООО «НПФ «АБРИС+»
г. Москва, ул. Лесотехническая, д. 19, лит. М, 2-й этаж
196009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Создано в России

LOT 005 2023-05

«МОЧЕВИНА АБРИС+»
(Уреазный-глютаминный UV-метод)

НПФ «АБРИС+» REF XXXXX

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазиный/глютаминный/фотометрический метод

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Состав набора: Комплектация №2

Реагент 1 1 x 80 мл
Реагент 2 1 x 20 мл
Намбиратор 1 x 1 мл

20°C ± 0,5°C по ТУ 21.20.23-012-27428990-2023
РН 1000/10000 от 000000001

Для профессионального применения

ООО «НПФ «АБРИС+»
г. Москва, ул. Лесотехническая, д. 19, лит. М, 2-й этаж
196009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Создано в России

LOT 005 2023-05

«МОЧЕВИНА АБРИС+»
(Уреазный-глютаминный UV-метод)

НПФ «АБРИС+» REF XXXXX

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазиный/глютаминный/фотометрический метод

«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Состав набора: Комплектация №2

Реагент 1 1 x 80 мл
Реагент 2 1 x 20 мл
Намбиратор 1 x 1 мл

20°C ± 0,5°C по ТУ 21.20.23-012-27428990-2023
РН 1000/10000 от 000000001

Для профессионального применения

ПАСПОРТ

№ XXXX/XXXX

Комплектация №4

№4	№5	№6	№7	№8
200 мл	1 фл. 16 мл	5 фл. по 16 мл	5 фл. по 16 мл	5 фл. по 16 мл
50 мл	1 фл. 4 мл	5 фл. по 4 мл	5 фл. по 4 мл	5 фл. по 4 мл
2 мл	1 фл. 1 мл	1 фл. 1 мл	1 фл. 1 мл	1 фл. 1 мл

Набор реагентов с истечением срока годности

Для получения надежных результатов

Для контроля правильности и

лабораторного анализа результатов

сыворотки с аттестованной по динамике

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аналитическая чувствительность (предел обнаружения) 0,7 ммоль/л

Линейная область определения от 1,0 до 20 ммоль/л

Коэффициент вариации результатов определения не более 5%

Время измерения до 500 мсек не зависит от концентрации

РЕФЕРЕНТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Сыворотка (плазма) крови:

Новорожденные до 18-90 лет - 1,1 - 6,6 ммоль/л

Взрослые до 18-90 лет - 1,1 - 6,6 ммоль/л

Моча суточная: 20 - 710 ммоль/сут

Анализаторы с автоматическим отбором



НПФ АБРИС+

2,250	А021.1.20	Комплекция	№5
200 мл	1 фл. 16 мл	5 фл. по 16 мл	№6
50 мл	1 фл. 4 мл	5 фл. по 4 мл	№7
2 мл	1 фл. 1 мл	5 фл. по 1 мл	№8
А021.5.100	А021.5.50	А021.5.20	А021.5.10

Набор реагентов с истекшим сроком годности полностью не
получит.
Для получения надежных результатов необходимо строгое
соблюдение инструкций и применение набора.
Для контроля правильности и точности результатов
используйте контрольные
таблетки с известными по данному методу показателями.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА
Аналитическая чувствительность (предел обнаружения) не более
0,7 мкг/л.
Измеряемая область определения от 1,0 до 33 мкг/л, отклонение от
значения не более 5%.

НПФ АБРИС+
Общество
с ограниченной
ответственностью
с дополнительной
информацией
концентрации
методом «МД»
Комплекс № XXXXXXXX





НПФ **АБРИС+**

ЛА АБРИС+

Сертификат соответствия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51303-2012

АБРИС+ 1.30	АБРИС+ 1.30	АБРИС+ 1.30	АБРИС+ 1.30	АБРИС+ 1.30	АБРИС+ 1.30
Концентрация	Концентрация	Концентрация	Концентрация	Концентрация	Концентрация
1 ф. 16 мл	5 ф. 16 мл	5 ф. 16 мл	5 ф. 16 мл	5 ф. 16 мл	5 ф. 16 мл
1 ф. 4 мл	5 ф. 4 мл	5 ф. 4 мл	5 ф. 4 мл	5 ф. 4 мл	5 ф. 4 мл
1 ф. 1 мл	5 ф. 1 мл	5 ф. 1 мл	5 ф. 1 мл	5 ф. 1 мл	5 ф. 1 мл

Набор реактивов с метками для определения концентрации мочевины в моче. Реактивы предназначены для использования в лабораторных условиях. Срок годности: 24 месяца. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C.

НПФ **АБРИС+** Общество с ограниченной ответственностью
Федеральная Фабрика, г. Санкт-Петербург, 19002, 190-1755, 190-1756
ПАСПОРТ К
для определения концентрации мочевины методом «АБРИС+»
Комплектация № XXXXXXXX

НПФ **АБРИС+**
REF XXXXX
"МОЧЕВИНА АБРИС+"
Реагент 1
200 мл
LOT 005
2023-05
IVD

НПФ **АБРИС+**
REF XXXXX
"МОЧЕВИНА АБРИС+"
Реагент 1
200 мл
LOT 005
2023-05
IVD

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Научно-производственный центр «АБРИС»
г. Санкт-Петербург
1755, 740-1789



ПАСПОРТ
Комплектация
№ XXXX/XXXX


1.2.250	А021.1.20	Комплектация №5	1 фл. 16 мл	5 фл. по 4 мл
2.2.250	А021.1.20	Комплектация №5	1 фл. 16 мл	5 фл. по 4 мл
3.2.250	А021.1.20	Комплектация №5	1 фл. 16 мл	5 фл. по 4 мл
4.2.250	А021.1.20	Комплектация №5	1 фл. 16 мл	5 фл. по 4 мл

Набор реактивов с истекшим сроком годности
подлежит утилизации.
Для получения паспортов
соблюдение настоящей инструкции.
Для контроля правильности
лабораторного анализа рекомендуется
сыворотки с аттестованным результатом.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Аналитическая чувствительность
0,7 ммоль/л.
Линейная область
линейности не более 5%.
Коэффициент вариации
Влияние гемоглобина 30 г/л
триглицеридов до 500 мг/л не оказывает
влияния.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Сыворотка (плазма) крови
Новорожденные/дети
Взрослые до 18-90 лет - 2,1
Взрослые: 430 - 710 ммоль/сут.
Моча суточная: 430 - 710 ммоль/сут.
Рекомендуется в каждой лаборатории

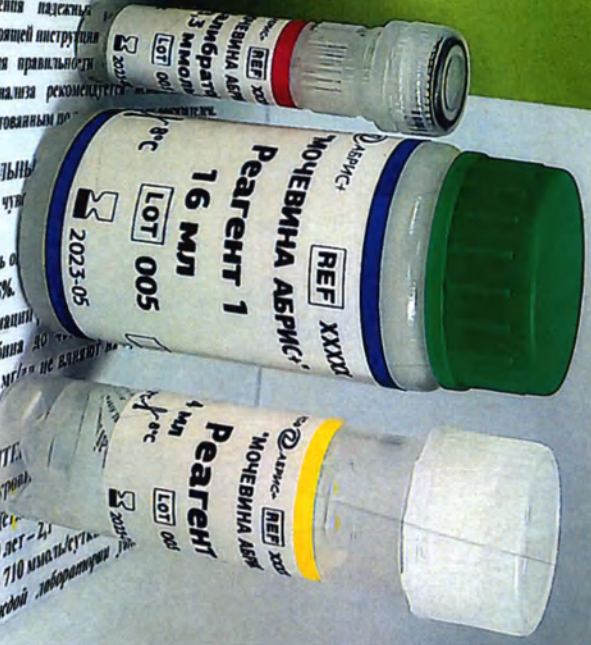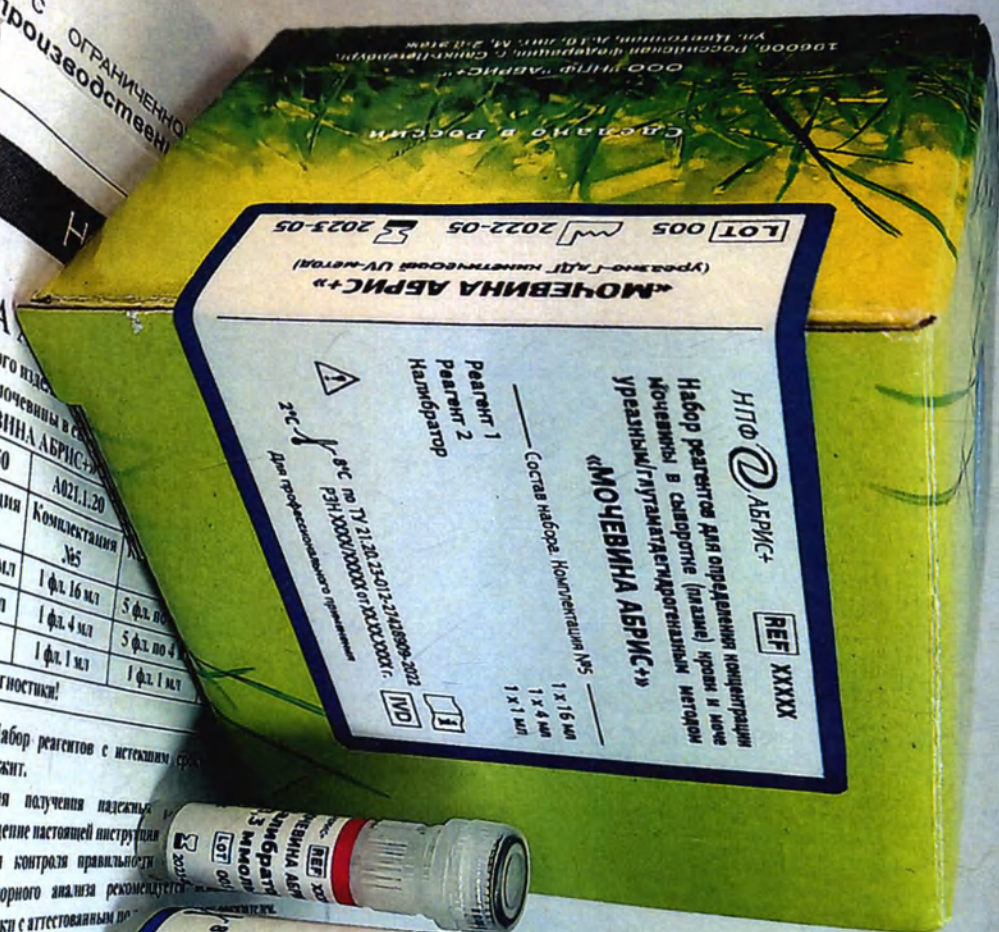

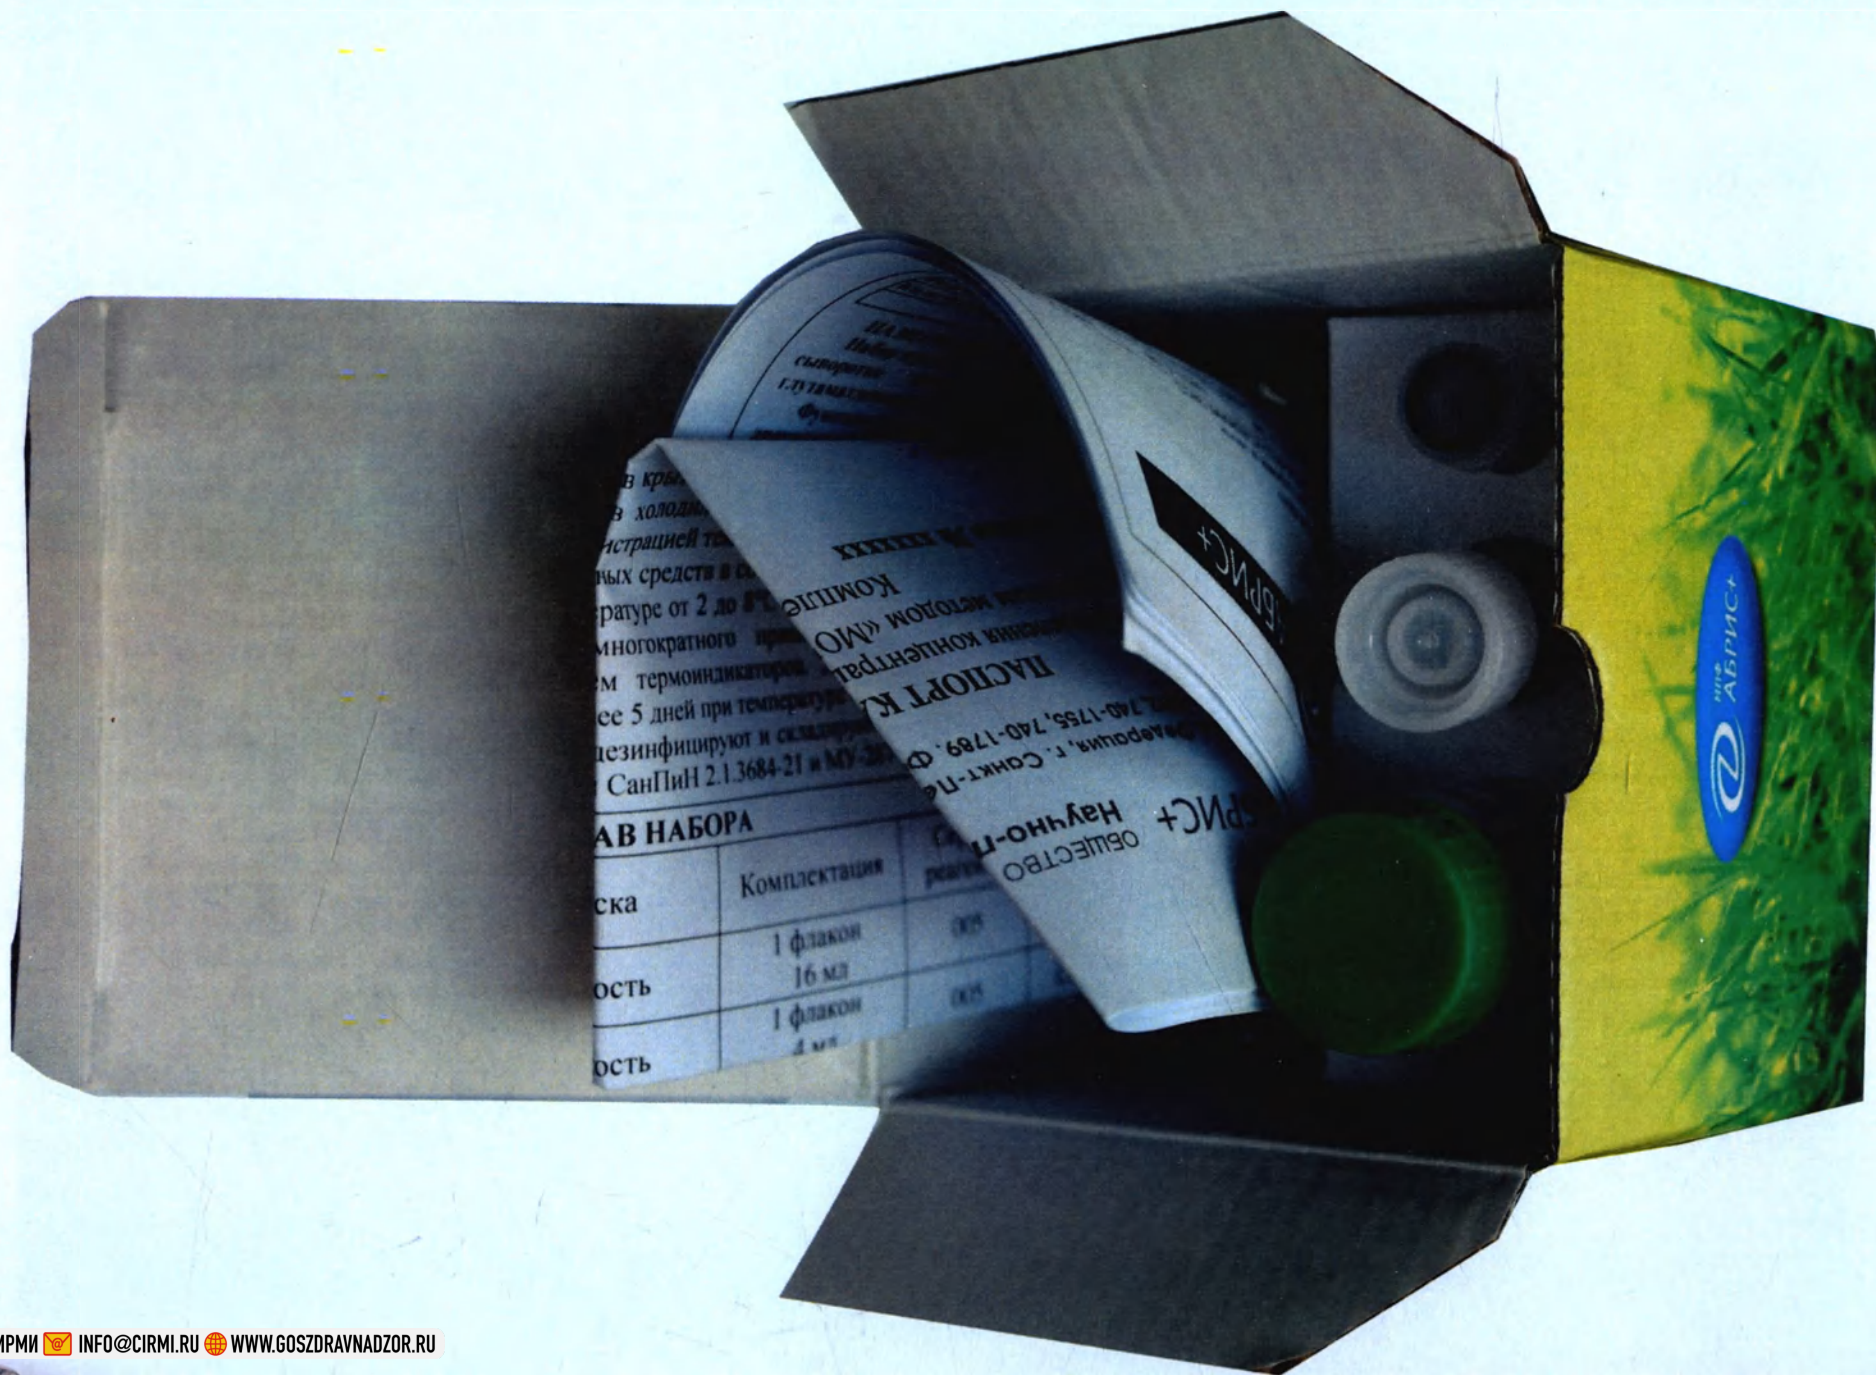



34

1360006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Цивильная, д. 16, лит. А, 3-й этаж

Сделано в России

«МОЧЕВИНА АБРИС+»
(реактивы для измерения концентрации мочевины)

LOT 005 2023-05 2023-05

НПФ АБРИС+

REF XXXXX

Набор реактивов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреаэним/глутаматдегидрогеназным методом
«МОЧЕВИНА АБРИС+»

Состав набора Комплектация №7
Реагент 1 5 x 40 мл
Реагент 2 5 x 10 мл
Калибратор 1 x 1 мл



8°C по ТУ 21.20.23-012-27428909-2022
РЭН XXXXX/XXXXX от XXXXX/XXXXX г.
2°C
Для профессионального применения





«МОЧЕВИНА АБРИС+»
Реагент 1
40 мл
8°C
LOT 005
2023-05

«МОЧЕВИНА АБРИС+»
Реагент 1
40 мл
8°C
LOT 005
2023-05

«МОЧЕВИНА АБРИС+»
Реагент 2
10 мл
8°C
LOT 005
2023-05

«МОЧЕВИНА АБРИС+»
Реагент 2
10 мл
8°C
LOT 005
2023-05

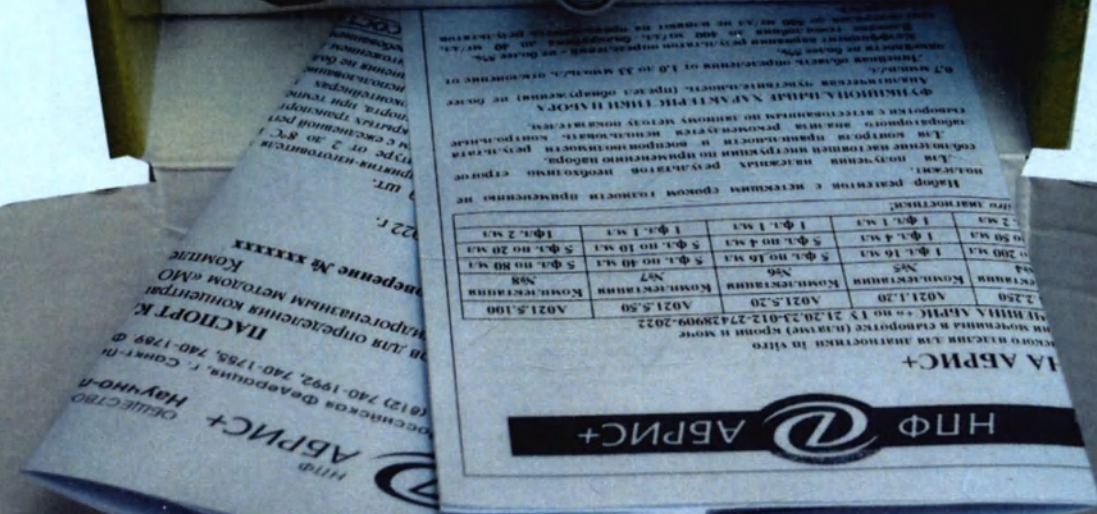

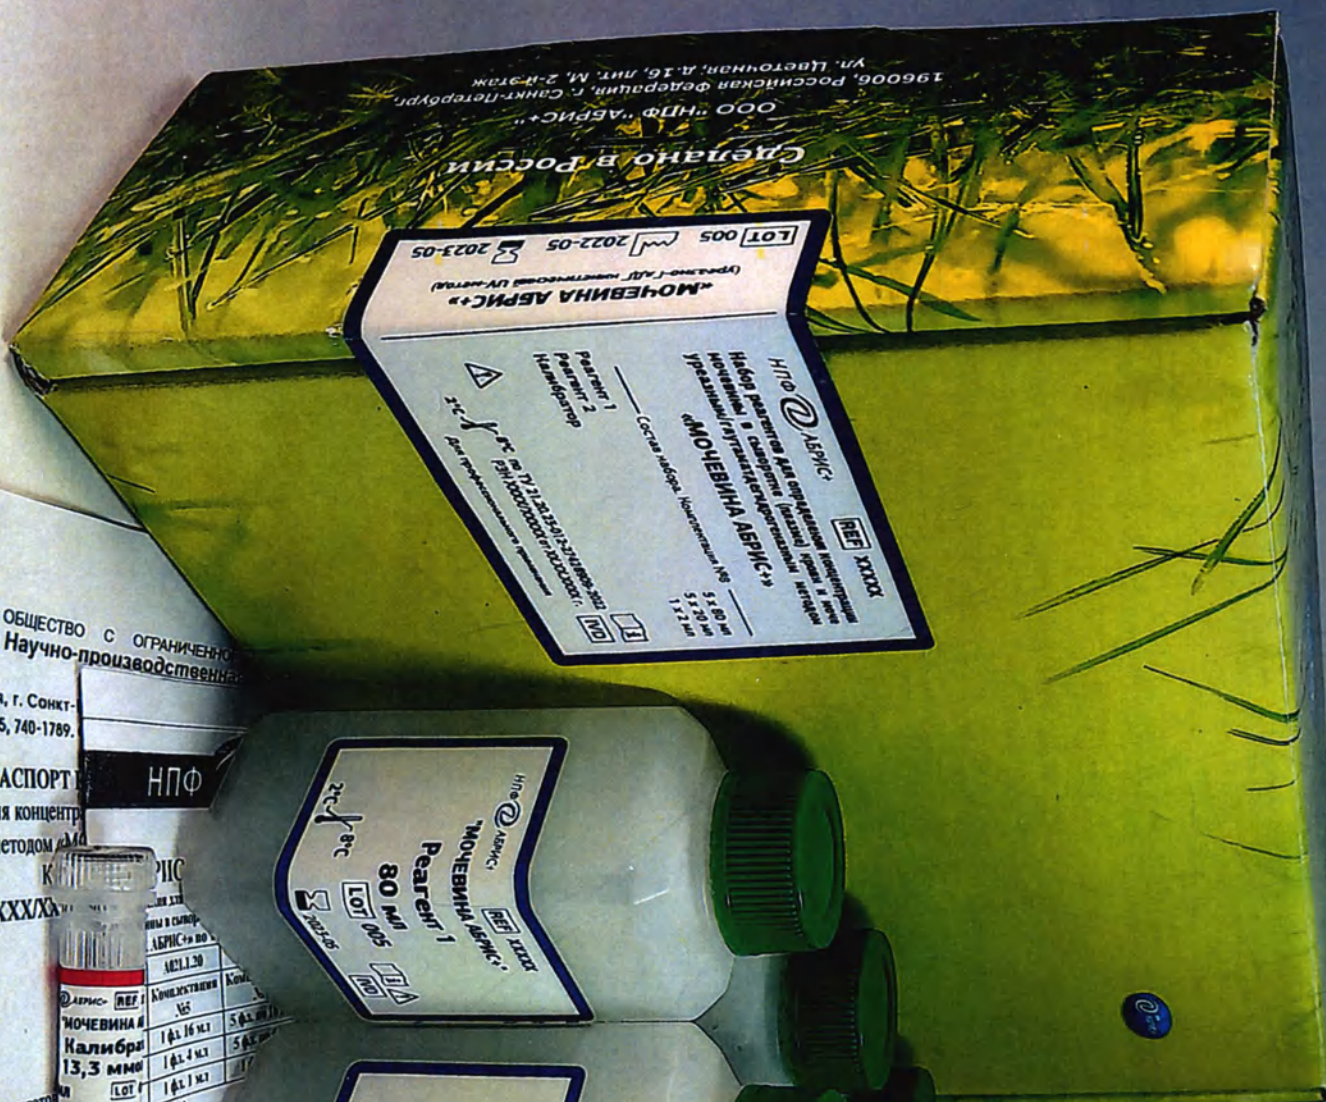

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Научно-производственная

Россия, г. Санкт-Петербург
Д-1755, 740-1789.

ПАСПОРТ
ления концентрат
ым методом

№ XXXXX

МОЧЕВИНА АБРИС+

Калибра
13,3 мм

ИТ.

иятия-изгот

гуре от 2

им с ежеднев

и крытых тр

анспорта, при тем

термоконтейнерах

ах с использо

ия и хранения не бо

ред уничтожения

ствости с требова

№	Концентрация	Кол-во
1	1 фл. 16 мл	5 фл. 16 мл
2	1 фл. 4 мл	5 фл. 4 мл
3	1 фл. 1 мл	5 фл. 1 мл

Набор реагентов
подлежит.
Для получе
соблюдение вост
Для соотв
лабораторного
гидролиз с этано

СОСТАВ

вид и форма вып

бесцветная жид

бесцветная жид



Прошито и пронумеровано

17 (семнадцать) листов

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

