Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2023 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными характеристиками и принципом работы медицинского изделия **«Набор мебели медицинской по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020»** (далее – набор, мебель, изделия мебели), предназначенный для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

1.2 Условия эксплуатации изделия: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий изделия в наборе относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

1.4 Набор включает в себя:

1.4.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета, в составе:

1.4.1.1 Ширма медицинская поликарбонатная Э-051-ШП, Э-052-ШП, Э-053-ШП – не более 2 шт. (при необходимости).

1.4.1.2 Подставка для забора крови Э-008-П - не более 2 шт.

1.4.1.3 Кушетка процедурная детская Э-001-ПКД - не более 2 шт. (при необходимости).

1.4.1.4 Кушетка процедурная Э-001-ПК, Э-101-ПФК - не более 2 шт.

1.4.1.5 Кушетка процедурная Э-105-ФК - не более 2 шт. (при необходимости).

1.4.1.6 Подставка для таза Э-031-П, Э-032-П, Э-131-П, Э-132-П - не более 2 шт.

1.4.1.7 Стол передвижной хирургический Э-060-СХ, Э-060-СХ/Н, Э-160-СХ, Э-260-СХ - не более 2 шт. (при необходимости).

1.4.1.8 Стол медицинский инструментальный Э-1180/590, Э-1180/590/П, Э-1180/750, Э-1180/750/П, Э-1180/590/1, Э-1180/590/1/П, -1180/750/1, -1180/750/1/П, Э-1180/590/ЯП, Э-1180/590/ПЯП, Э-1180/750/ЯП, Э-1180/750/ПЯП, Э-1180/590/1/ЯП, Э-1180/590/1/ПЯП, Э-1180/750/1/ЯП, Э-1180/750/1/ПЯП, Э-1180/590/ЯП2, Э-1180/590/ПЯП2, Э-1180/750/ЯП2, Э-1180/750/ПЯП2, Э-1180/590/1/ЯП2, Э-1180/590/1/ПЯП2, Э-1180/750/1/ЯП2, Э-1180/750/1/ПЯП2, Э-1180/590/ТП, Э-1180/590/ПТП, Э-1180/750/ТП, Э-1180/750/ПТП, Э-1180/590/1/ТП, Э-1180/590/1/ПТП, Э-1180/750/1/ТП, Э-1180/750/1/ПТП - не более 3 шт. (при необходимости).

1.4.1.9 Кушетка стационарная Э-002-ПК - не более 2 шт. (при необходимости).

1.4.1.10 Стол пеленальный Э-070-СП, СПП, Э-070-СПМ - не более 2 шт. (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.4.2 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки:

1.4.2.1 Стеллаж передвижной медицинский Э-048-СПЭ, Э-048/Н-СПЭ, Э-048-СП, Э-048-Н-СП, Э-148-СП, Э-248-СП - не более 3 шт. (при необходимости).

1.4.2.2 Тележка медицинская Э-040-СПЭ, Э-041-СПЭ, Э-042-СПЭ, Э-043-СПЭ, Э-044-СПЭ, Э-045-СПЭ, Э-046-СПЭ, Э-047-СПЭ, Э-047/2-СПЭ, Э-047/3-СПЭ, Э-041/Н-СПЭ, Э-042/Н-СПЭ, Э-044/Н-СПЭ, Э-045/Н-СПЭ, Э-046/Н-СПЭ, Э-047/Н-СПЭ, Э-047/2/Н-СПЭ, Э-047/3/Н-СПЭ, Э-040-СП, Э-041-СП, Э-042-СП, Э-043-СП, Э-044-СП, Э-045-СП, Э-046-СП, Э-047-СП, Э-047/2-СП, Э-047/3-СП, Э-041/Н-СП, Э-042/Н-СП, Э-044/Н-СП, Э-045/Н-СП, Э-046/Н-СП, Э-047/Н-СП, Э-047/2/Н-СП, Э-047/3/Н-СП, Э-140-СП, Э-141-СП, Э-142-СП, Э-143-СП, Э-144-СП, Э-145-СП, Э-146-СП, Э-147-СП, Э-147/2-СП, Э-147/3-СП, Э-240-СП, Э-241-СП, Э-242-СП, Э-243-СП, Э-244-СП, Э-245-СП, Э-246-СП, Э-247-СП, Э-247/2-СП, Э-247/3-СП - не более 3 шт.

1.4.2.3 Стойка инфузионная для капельниц Э-031-СР, Э-032-СР, Э-131-СР, Э-132-СР, Э-031-СИ, Э-032-СИ, Э-131-СИ, Э-132-СИ - не более 5 шт. (при необходимости).

1.4.2.4 Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-110-ШКЭ, Э-111-ШКЭ, -112-ШКЭ, Э-113-ШКЭ, Э-114-ШКЭ, Э-115-ШКЭ, Э-110-ШК, Э-111-ШК, -112-ШК, Э-113-ШК, Э-114-ШК, Э-115-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-111/Н-ШК, Э-112/Н-ШК, Э-113/Н-ШК, Э-114/Н-ШК, Э-115/Н-ШК, Э-110-ШКП, Э-111-ШКП, Э-112-ШКП, Э-113-ШКП, Э-114-ШКП, Э-115-ШКП - не более 3 шт. (при необходимости).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения – лечебно-профилактические учреждения любого профиля

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

Набор выпускается в двух вариантах исполнения:

1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета, предназначенный для оборудования процедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения медицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

В состав набора входят следующие изделия:

1.1 Ширмы медицинские поликарбонатные, предназначенные для разделения пространства во время проведения медицинских процедур и осмотров.

1.2 Подставка для забора крови, предназначенная для организации забора крови у пациента.

1.3 Кушетки процедурные, предназначенные для размещения пациентов во время осмотра или проведения медицинских процедур.

1.4 Подставки для таза, предназначенные для размещения медицинских тазов с использованными медицинскими инструментами и/или материалами.

1.5 Столы передвижные хирургические, предназначенные для размещения и перемещения медицинских инструментов.

1.6 Столы медицинские инструментальные, предназначенные для хранения медицинского оборудования и инструментов.

1.7 Кушетка стационарная, предназначенная для размещения пациента во время медицинского осмотра.

1.8 Столы пеленальные, предназначенные для проведения осмотра и процедур пациентам в возрасте до 1 года.

2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки, предназначенный для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

В состав набора входят:

2.1 Стеллажи передвижные медицинские, предназначенные для размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

2.2 Тележки медицинские, предназначенные для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

2.3 Стойки инфузионный для капельниц с держателями для бутылок/пакетов с растворами предназначены для размещения на определенной высоте флаконов или одноразовых систем с лекарственными растворами при проведении лечебных процедур.

2.4 Шкафы медицинские металлические предназначены для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Модельный и типоразмерный ряд для каждого вида исполнения представлен в таблице 1.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

Не рекомендуется:

- использование мебели для лечения, профилактики заболеваний, иных манипуляций, могущих нанести вред здоровью пациента.

- использование тележек для перемещения пациентов.

- использование кушеток для оснащения палат с целью длительного размещения пациентов в лежачем положении.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделий в наборе составляет 10 лет с даты изготовления.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1 Транспортирование мебели осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными изделиями от атмосферных осадков.

6.2 Доставка мебели в разобранном или собранном виде осуществляется специальной организацией, привлеченной изготовителем или автотранспортными средствами изготовителя. Доставка может осуществляться как за один раз, так и поэтапно по мере готовности комплектующих для выполнения заказа.

6.3 При транспортировании самолетом изделия должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается.

6.4 Условия перевозки в части действия климатических факторов – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50°С до 50°С, относительной влажности до 80%, механических – по группе Л ГОСТ Р 51908.

6.5 Мебель хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150, при температуре от 10°С

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

до 40°С, относительной влажности до 75%. Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

6.6 Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий производят в соответствии с ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020 и действующими правилами для данного вида транспортных средств.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**

ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.

Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**

Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**

Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ И МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1 Состав каждого исполнения с массогабаритными характеристиками представлен в таблице 1:

Таблица 1

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная	Э-051-ШП	Ш*В: 745*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
1.2 Подставка для забора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
1.3 Кушетка процедурная детская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
1.4 Кушетка процедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
1.5 Кушетка процедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
1.6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
1.7 Стол передвижной хирургический				Не более 2 шт. (при необходимости)	регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
1.8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
					увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
1.9 Кушетка стационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
1.10 Стол пеленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
					выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
					нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
					выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Количество, шт.	Конструктивные особенности
					усиленные полки

8.2 Комплектность поставки и перечень используемых материалов для каждого изделия, а также порядок сборки/монтажа приведены в паспорте.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9.1 Шкафы, тумбы, стеллажи состоят из двух основных частей:

- фасадной части;
- каркаса изделия.

Фасадная часть может полностью отсутствовать (открытые полки, любое изделие без фасадов).

9.2 Фасады изделий содержат:

- створчатые фасады на поворотном механизме;
- распашные двери, состоящие из металлического каркаса и различных вставок;
- фасады из пластика

9.3 Стекла, используемые в фасадах, а также стеклянные полки могут быть укреплены пленкой безопасности или декоративной пленкой либо закалены термическим путем. Дефекты плёнки: воздушные пузыри, инородные включения, отслоения, царапины не нормируются и не являются дефектом изделия.

9.4 Детали фасада изделия из стекла могут иметь по бокам скругление радиусом 1 мм.

9.5 Задняя стенка в корпусном изделии устанавливается в паз. Во встроенном изделии задняя стенка должна быть вкладной на пластиковых уголках, либо может отсутствовать.

9.6 Если в изделии используются ящики или фасады на петлях, то зазоры и наложения фасадов ящиков и фасадов дверей соответствуют следующим параметрам:

- для вкладных фасадов: зазор между фасадом и стенками его секции составляет от 2 до 4 мм по всему периметру;
- для накладных и смежных фасадов: наложение на полки, боковые или межсекционные стойки составляет от 5 до 16 мм по всему периметру. Расстояние между самими фасадами в одной секции составляет от 2 до 4 мм. Расстояние между фасадами смежных секций составляет от 5 до 13 мм.

9.7 Зазоры в проемах на сторону для дверей не превышают:

- 2,0 мм - для дверей;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- 1,5 мм - для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем.

9.8 Колесные опоры свободно и без заедания вращаются на горизонтальной оси при усилии не более 0,35 Н (0,035 кгс).

9.9 Усилие по перемещению передвижных изделий представлены в таблице 2:

Таблица 2. Усилие трогания с места

Масса изделия, кг	**Усилие трогания с места, Н, не более**	**Усилие трогания с места при заторможенных колесных опорах (Н), не менее**
Менее 50	60	115
50 -100 кг	125	235

Дополнение:
Усилие, прикладываемое к педали гидропривода, не превышает 250 Н (25 кгс)

9.10 Допустимые нагрузки на изделие представлены в таблице 3:

Таблица 3. Величины нагрузок

Деталь/изделие	**Нагрузка, кг, не более**
Дно ящика из ЛДСП	**5**
Дно ящика металлического	**10**
Полка из ЛДСП	**15**
Полка из стекла	**5**
Полка металлическая	**15**
Столешница из ЛДСП	**80**
Столешница столов инструментальных	**100**
Полка столов инструментальных	**50**
Столешница столов передвижных хирургических	**15**
Подставка для тазов	**5**
Полки тележек и стеллажей металлические	**7**
Полки тележек и стеллажей стеклянные	**5**
Стол пеленальный	**30**
Кушетки на деревянном каркасе	**120**
Кушетки на металлическом каркасе (ложе)	**150**
Кушетки на металлическом каркасе (подголовник)	**30**
Стойка инфузионная	**5**

Угол регулировки наклона подголовника кушеток на металлическом каркасе – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
Прогиб горизонтальных несущих элементов под действием нагрузки не превышает 6 мм на 1 м длины.

9.11 Усилие открывания дверей мебельных изделий не превышает 50 Н.

10. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

10.2 Детали изделия освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

10.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

10.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

10.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

11.1 Не допускайте воздействия на изделие агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);

11.2 Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

11.3 При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклянную деталь;

11.4 Во избежание опрокидывания мебели запрещается в пустом (незаполненном вещами)

изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно;

11.5 Не допускайте в помещении высоких или низких температур, а также резких перепадов температур, соблюдайте режим эксплуатации, указанный в разделе 1;

11.6 При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов, раскачивания не допускается.

12. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

12.1 Изделия должны применяться только в целях, обозначенных в разделах 2 и 3, при строгом соблюдении руководства по эксплуатации.

12.2 При эксплуатации изделия следует предохранять от механических повреждений.

12.3 Монтажные и ремонтные работы должны проводить лица, прошедшие инструктаж по безопасным методам труда.

12.4 При монтаже мебели должны использоваться крепежные детали и фурнитура, предназначенные для каждого конкретного вида (исполнения, типоразмера) мебели.

12.5 Недопустимо попадание на защитно-декоративные лаковые покрытия жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12.6 Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.

12.7 В процессе эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов, особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере надобности) подтягивать винты в петлях, в монтажных планках и других элементах крепежа.

13. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

13.8 Текущая дезинфекция

Способ обработки: мебель обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

13.9 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие абразивные материалы и органические растворители.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

14.1 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытия и резьбовых соединений крепежных элементов.

14.2 В процессе эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов, особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере надобности) подтягивать винты в петлях, в монтажных планках и других элементах крепежа.

14.3 Техническое обслуживание необходимо производить не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

15.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу отходов А).

15.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке или изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

16. МАРКИРОВКА

16.1 Маркировка изделия должна содержать:

1) наименование предприятия-изготовителя, его адрес, адрес производства и его товарный знак (при наличии);

2) наименование и обозначение изделия, включая номер технических условий;

3) дату изготовления;

4) схематичное изображение изделия (при наличии);

5) номер регистрационного удостоверения и дата его получения;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6) сведения о сертификации (декларировании)

7) указания по утилизации

8) гарантийный срок

9) срок службы, установленный изготовителем

10) - знак обращения Таможенного союза (только для кушеток);

11) обозначение ГОСТ 19917 (только для кушеток).

16.2 Артикул каждого изделия состоит из трех позиций:



где:

позиция 1 – обозначение производителя, ООО «Эргомедикс»;

позиция 2 – конструктивные особенности (размеры и другое) изделий согласно таблице 4:

Таблица 4

Изделие	Код	Расшифровка		
Ширма медицинская поликарбонатная	051	05 – код изделия по системе изготовителя	1 – одна секция	
	052		2 – две секции	
	053		3 – три секции	
Подставка для забора крови	008	008 – код по системе изготовителя		
Кушетка процедурная детская, кушетка процедурная, кушетка стационарная	001	0 – металлический каркас	01 – код изделия по системе изготовителя	
	101	1 – деревянный каркас		
	105		05 – код изделия по системе изготовителя	
	002	0 – металлический каркас	02 – код изделия по системе изготовителя	
Подставка для таза	031	0 – металлический каркас	3 – код изделия по системе изготовителя	1 – один таз
	032			2 – два таза
	131	1 – каркас из нержавеющей стали		1 – один таз
	132			2 – два таза
Стол передвижной хирургический	060	0 – изделие из металла с ручной регулировкой высоты	60 – код изделия по системе изготовителя	
	160	1 – изделие из нержавеющей стали с ручной регулировкой высоты		
	260	2 – изделие из нержавеющей стали с		

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		гидравлической регулировкой высоты	
Стол медицинский инструментальный	1180/590	Габариты (ширина и глубина) и стандартная высота	
	1180/750		
	1180/590 /1	Габариты (ширина и глубина) и увеличенная высота	
	1180/750 /1		
	/П	Наличие Полки	
	/ЯП	Наличие Ящика Подвесного	
	/ПЯП	Наличие Полки и Ящика Подвесного	
	/ЯП2	Наличие 2 Ящиков Подвесных	
	/ПЯП2	Наличие Полки и 2 Ящиков Подвесных	
	/ТП	Наличие Тумбы Подвесной	
	/ПТП	Наличие Полки и Тумбы Подвесной	
Стол пеленальный	070	0 – металлический каркас 70 – код изделия по системе изготовителя	

Таблица 4 (продолжение)

Изделие	**Код**	**Расшифровка**		
Стеллаж передвижной медицинский	048	0 – металл	48 – код изделия по системе изготовителя	
	048/Н			Н – наличие полок из нержавеющей стали
	148	1 – нержавеющая сталь круглого сечения		
	248	2 – нержавеющая сталь прямоугольного сечения		
Тележка медицинская	040	0 - металл	4 – код изделия по системе изготовителя	0 – 2 рамки и 2 полки из стекла
	041			1 – две рамки, одна полка из стекла и поддон из металла
	042			2 – две рамки и два поддона из металла
	043			3 – три рамки и 3 полки из стекла
	044			4 – три рамки, две полки из стекла и один поддон из металла
	045			5 – три рамки, одна полка из стекла и два поддона из металла
	046			6 – три рамки и три поддона из металла
	047			7 – две рамки, два поддона из металла и

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

				один выдвижной ящик
	140	1 – нержавеющая сталь круглого сечения		0 – 2 рамки и 2 полки из стекла
	141			1 – две рамки, одна полка из стекла и поддон из металла
	142			2 – две рамки и два поддона из металла
	143			3 – три рамки и 3 полки из стекла
	144			4 – три рамки, две полки из стекла и один поддон из металла
	145			5 – три рамки, одна полка из стекла и два поддона из металла
	146			6 – три рамки и три поддона из металла
	147			7 – две рамки, два поддона из металла и один выдвижной ящик
	240	2 – нержавеющая сталь прямоугольного сечения		0 – 2 рамки и 2 полки из стекла
	241			1 – две рамки, одна полка из стекла и поддон из металла
	242			2 – две рамки и два поддона из металла
	243			3 – три рамки и 3 полки из стекла
	244			4 – три рамки, две полки из стекла и один поддон из металла
	245			5 – три рамки, одна полка из стекла и два поддона из металла
	246			6 – три рамки и три поддона из металла
	247			7 – две рамки, два поддона из металла и один выдвижной ящик
	/2	Наличие 2 выдвижных ящиков		
	/3	Наличие 3 выдвижных ящиков		
	/Н	Наличие поддона из Нержавеющей стали		

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Стойка инфузионная для капельниц	031	0 – металл	3 – код изделия по системе изготовителя	1 – две подставки для бутылок и два крючка для пакетов
	032			2 – четыре крючка для пакетов
	131	1 – нержавеющая сталь		1 – две подставки для бутылок и два крючка для пакетов
	132			2 – четыре крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	110	11 – код изделия по системе изготовителя		0 – две стеклянные двери
	111			1 – одна стеклянная дверь и одна металлическая
	112			2 – две металлические двери
	113			3 – четыре стеклянные двери
	114			4 – две металлические и две стеклянные двери
	115			5 – четыре металлические двери
	/Н	Изделие из нержавеющей стали		

позиция 3 – буквенный код изделия, согласно таблице 5:

Таблица 5

Буквенный код	**Расшифровка**
ШП	Ширма Поликарбонатная
П	Подставка
ПКД	Процедурная Кушетка Детская
ПК	Процедурная Кушетка
ПФК	Процедурная Физиотерапевтическая Кушетка
ФК	Физиотерапевтическая Кушетка
СХ	Стол Хирургический
СХ/Н	Стол Хирургический с поддоном из Нержавеющей стали
СП	Стол Пеленальный
СПП	Стол Пеленальный с Полкой
СПМ	Стол Пеленальный Мягкий
СП	Стеллаж Передвижной
СПЭ	Стеллаж Передвижной Эконом
СИ	Стойка Инфузионная
СР	Стойка Инфузионная Регулируемая
ШК	ШКаф
ШКЭ	ШКаф Эконом
ШКП	ШКаф Про (усиленные полки)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

17. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

17.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ТУ, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

17.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

17.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

17.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо изделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

17.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели владелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической помощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических специалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец берет на себя).

18. СИМВОЛЫ НА МАРКИРОВКЕ

	Изготовитель Указывает изготовителя медицинского изделия, как это определено в Директивах Европейского сообщества 90/385/EEC, 93/42/EEC и 98/79/EC Рядом с символом должны быть указаны наименование и адрес изготовителя (т.е. лица, выпускающего медицинское изделие в обращение на рынке).
	Дата изготовления Указывает дату, когда было изготовлено медицинское изделие Рядом с символом должна быть расположена дата изготовления. Эта дата должна быть указана в соответствии с ИСО 8601 как четыре цифры для года и, при необходимости две цифры для месяца и две цифры для дня.
	Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	Беречь от влаги Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия влаги.
	Единый знак обращения на рынке ЕАЭС

19. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 2.601-2019	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы
ГОСТ 9.031-74	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия анодно-окисные полуфабрикатов из алюминия и его сплавов. Общие требования и методы контроля
ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301-86	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302-88	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля
ГОСТ 9.303-84	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 9.402-2004	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
ГОСТ 12.0.004-2015	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.016-79	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
ГОСТ 12.1.018-93	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ Р 12.1.019-2017	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.032-78	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.3.002-2014	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.003-86	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности
ГОСТ 12.3.005-75	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы окрасочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.009-76	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.020-80	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.025-80	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обработка металлов резанием. Требования безопасности
ГОСТ 12.4.009-83	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.011-89	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.021-75	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.026-2015	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
ГОСТ 12.4.280-2014	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования
ГОСТ 14.201-83	Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ГОСТ 15.309-98	Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 17.1.3.13-86	Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ Р 27.403-2009	Надежность в технике (ССНТ). Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы
ГОСТ Р 27.605-2013	Надежность в технике (ССНТ). Ремонтопригодность оборудования. Диагностическая проверка
ГОСТ 111-2014	Стекло листовое бесцветное. Технические условия
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 4381-87	Микрометры рычажные. Общие технические условия
ГОСТ 5378-88	Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 6507-90	Микрометры. Технические условия
ГОСТ 6799-2021	Стеклоизделия для мебели. Технические условия
ГОСТ 7016-2013	Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ Р ИСО 8568-2010	Стенды ударные. Заявление и подтверждение характеристик
ГОСТ 8639-82	Трубы стальные квадратные. Сортамент
ГОСТ 6449.1-82	Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки
ГОСТ 6449.2-82	Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски углов
ГОСТ 6449.3-82	Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы и расположения поверхностей
ГОСТ 6449.4-82	Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-9-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деструкции
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия
ГОСТ ISO 10993-12-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ ИСО 14644-1-2017	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
ГОСТ ISO 14971-2021	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ 15140-78	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008	Изделия медицинские. Руководство по выбору стандартов, поддерживающих важнейшие принципы обеспечения безопасности и эксплуатационных характеристик медицинских изделий
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 16504-81	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 16588-91	Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ГОСТ 19195-89	Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения
ГОСТ 19917-2014	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
ГОСТ 19882-91	Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость
ГОСТ 23660-79	Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий
ГОСТ 23945.0-80	Унификация изделий. Основные положения
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 24404-80	Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения
ГОСТ 24444-87	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности
ГОСТ 25051.4-83	Установки испытательные вибрационные электродинамические. Общие технические условия
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 26656-85	Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования
ГОСТ Р ИСО 26800-2013	Эргономика. Общие принципы и понятия
ГОСТ 28237-89	Камеры неинжекционного типа для получения постоянной относительной влажности
ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ 31093-2003	Материалы лакокрасочные мебельные. Общие технические условия
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р 50460-92	Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования
ГОСТ Р 51908-2002	Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования
ГОСТ Р 51909-2002	Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на транспортирование и хранение
ГОСТ Р 52108-2003	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения
ГОСТ Р 52539-2006	Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ Р 53618-2009	Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию температуры
ГОСТ Р МЭК 62366-1-2021	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
МУ 2.1.7.730-99	Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест
МУ 287-113	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 №4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
РД 50-690-89	Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным
Решение от 28.05.2010 г. №299	О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СанПиН 2.1.3685 – 21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СП 2.1.7.1386-03	Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления
СП 2.2.3670-20	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
ТР ТС 005/2011	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 16 августа 2011 г. №769)
ТР ТС 025/2012	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 №32)
Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г.	О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

34 (тридцать четыре) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / **Дрокин Э.А.**/

«01» _____ 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Ширма медицинская поликарбонатная Э-051-ШП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Ширма медицинская поликарбонатная Э-051-ШП** (далее – ширма). Ширма входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации ширмы: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий ширма относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования процедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения медицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Ширма предназначена для разделения пространства во время проведения медицинских процедур и осмотров.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы ширмы составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
Ширма дицинская ликарбонатная	**Э-051-ШП**	**Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;**	**4,2±0,3**	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка процедурная тская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка процедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка процедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка для а	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
		(регулируемая высота)			
Стол редвижной ургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол ицинский струментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки ширмы:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
СТ-1	Створка ширмы	1
К-1	Опора одноколесная	1
К-2	Опора двухколесная	1
	Крепежные изделия	
С-1	Саморез 4,2*16	6

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Профиль из алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617 с окраской порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Непрозрачный сотовый поликарбонат по ГОСТ 56712 (экран); Пластик АБС по ГОСТ 11645 (колеса, коннекторы); Нержавеющая сталь по ГОСТ 9940 (опоры)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	4,2±0,3
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали ширмы освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении вил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки ширмы показана на рисунке 1.
10.2 Опору **К-1** и **К-2** закрепить к створке ширме **СТ-1** саморезом согласно схеме сборки.
10.3 Ширма готова к использованию

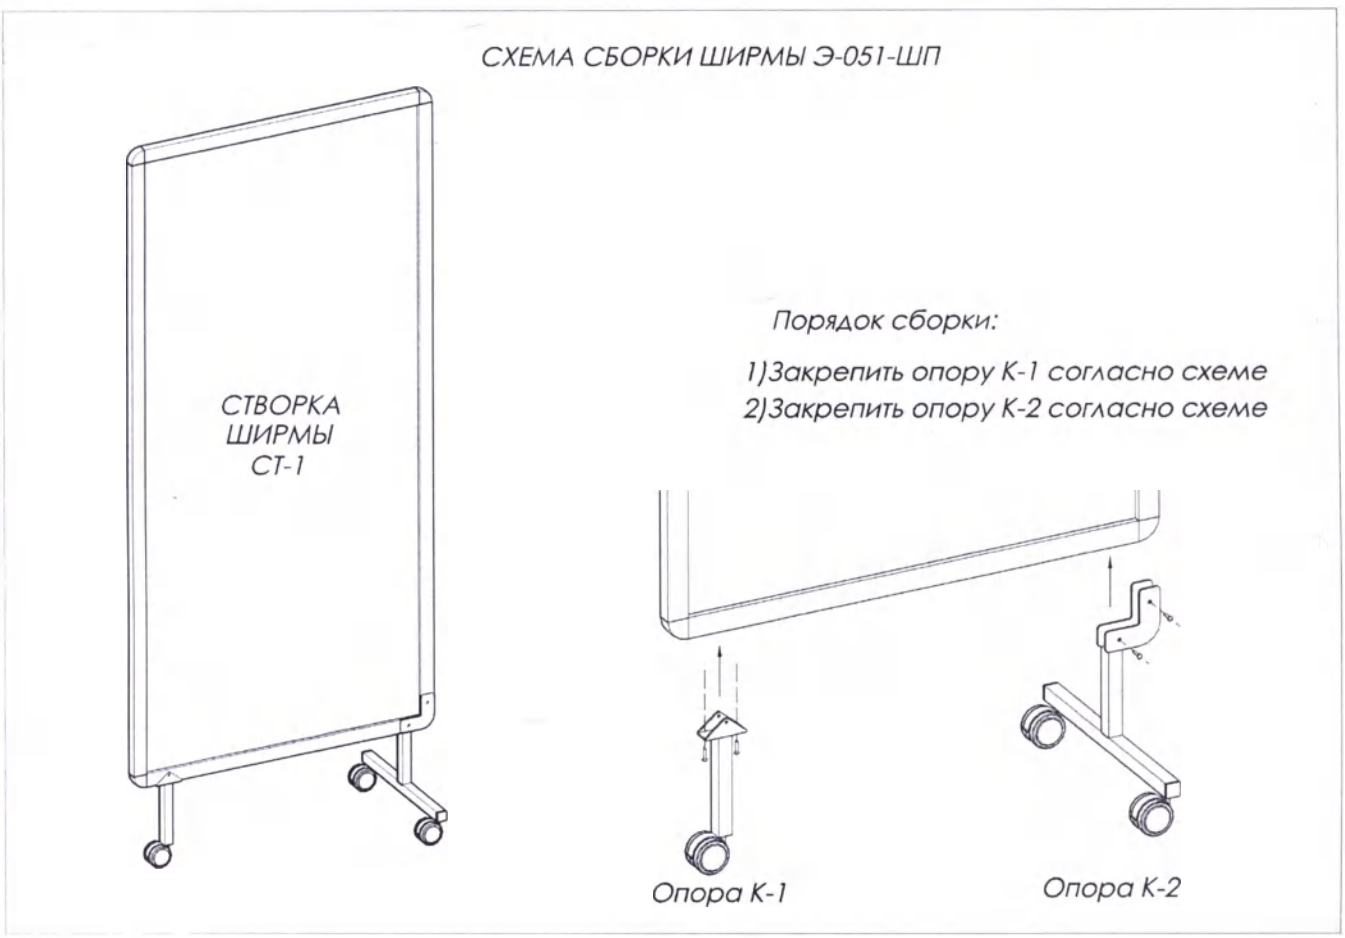

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: ширма обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма медицинская поликарбонатная Э-051-ШП в количестве __________шт. принята в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Ширма поликарбонатная Э-051-ШП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20____ г.

Дата_______________ Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А./
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

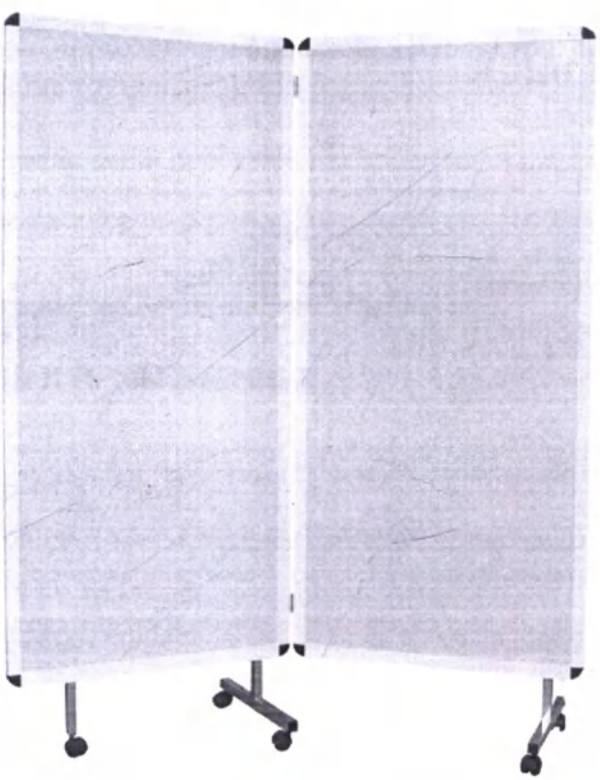

Ширма медицинская поликарбонатная Э-052-ШП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Ширма медицинская поликарбонатная Э-052-ШП** (далее – ирма). Ширма входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации ширмы: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий ширма носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Ширма предназначена для разделения пространства во время проведения медицинских процедур осмотров.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы ширмы составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1 **Ширма**	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3	Не более 2 шт.	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
ицинская икарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		(при необходимости)	
	Э-052-ШП	**Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;**	**7,0±0,3**		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка для ра крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка оцедурная ская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол ередвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки ширмы:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ-1	Створка ширмы	2
К-1	Опора одноколесная	1
К-2	Опора двухколесная	2
Крепежные изделия		
С-1	Саморез 4,2*16	10

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Профиль из алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617 с окраской порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Непрозрачный сотовый поликарбонат по ГОСТ 56712 (экран); Пластик АБС по ГОСТ 11645 (колеса, коннекторы); Нержавеющая сталь по ГОСТ 9940 (опоры)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	7,0±0,3
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали ширмы освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять ого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки ширмы показана на рисунке 1.
10.2 Опору **К-1** и **К-2** закрепить к створке ширмы **СТ-1** саморезом согласно схеме сборки.
10.3 Ширма готова к использованию

СХЕМА СБОРКИ ШИРМЫ Э-052-ШП

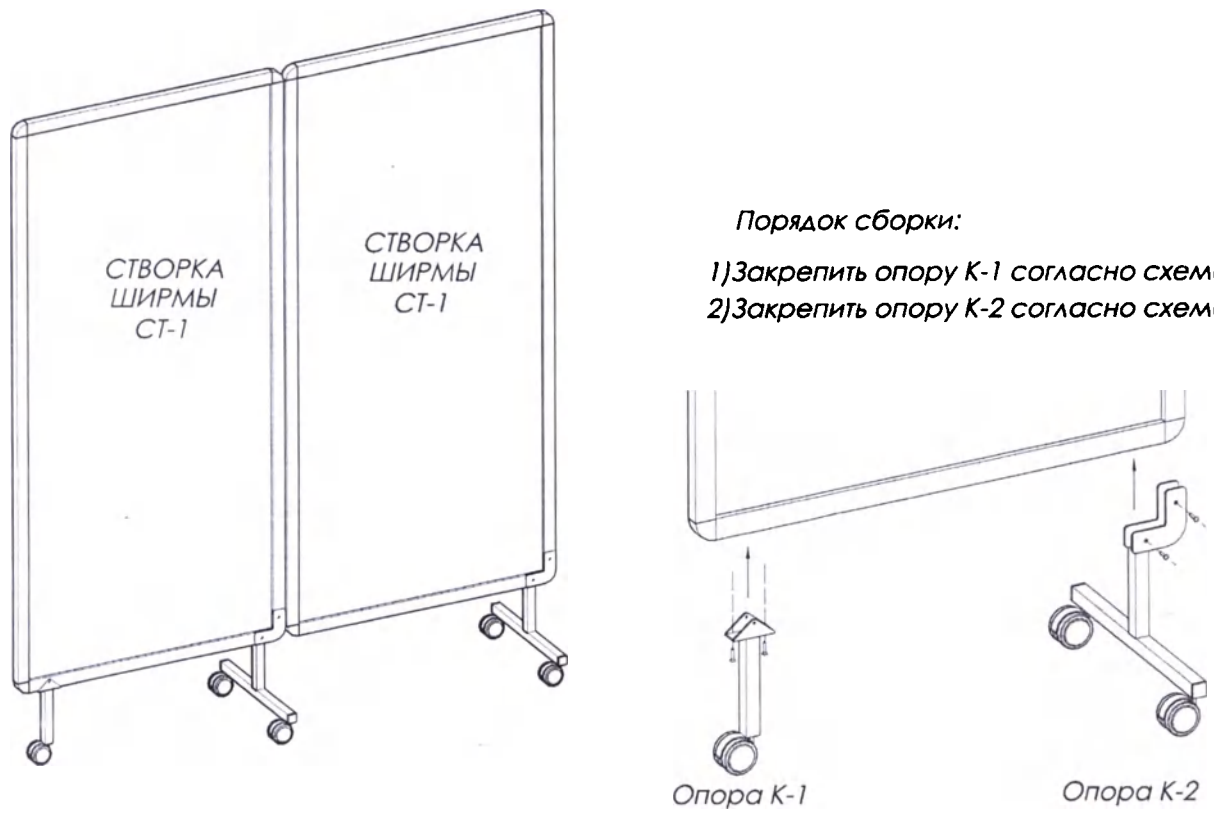

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: ширма обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие зазивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма медицинская поликарбонатная Э-052-ШП в количестве __________шт. принята в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Ширма поликарбонатная Э-052-ШП

Дата выпуска ___________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

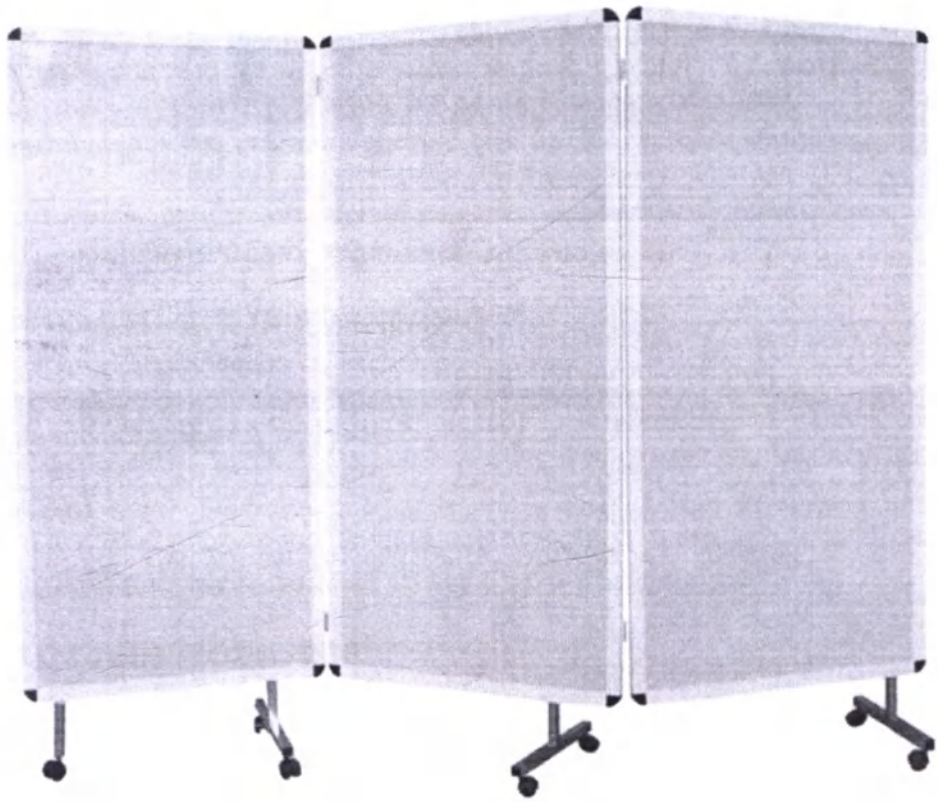

Ширма медицинская поликарбонатная Э-053-ШП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Ширма медицинская поликарбонатная Э-053-ШП** (далее – ирма). Ширма входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации ширмы: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий ширма носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Ширма предназначена для разделения пространства во время проведения медицинских процедур осмотров.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы ширмы составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1 **Ширма**	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры:	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
дицинская ликарбонатная		400; Диаметр колеса: 40;		необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	**Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;**	**11±0,3**		Трехсекционная
Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка оцедурная тская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
Стол ередвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
		1170)			ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол дицинский струментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
0 Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки ширмы:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ-1	Створка ширмы	3
К-1	Опора одноколесная	1
К-2	Опора двухколесная	3
Крепежные изделия		
С-1	Саморез 4,2*16	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Профиль из алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617 с окраской порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Непрозрачный сотовый поликарбонат по ГОСТ 56712 (экран); Пластик АБС по ГОСТ 11645 (колеса, коннекторы); Нержавеющая сталь по ГОСТ 9940 (опоры)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	11,0±0,3
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали ширмы освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки ширмы показана на рисунке 1.
10.2 Опору **К-1** и **К-2** закрепить к створке ширме **СТ-1** саморезом согласно схеме сборки.
10.3 Ширма готова к использованию

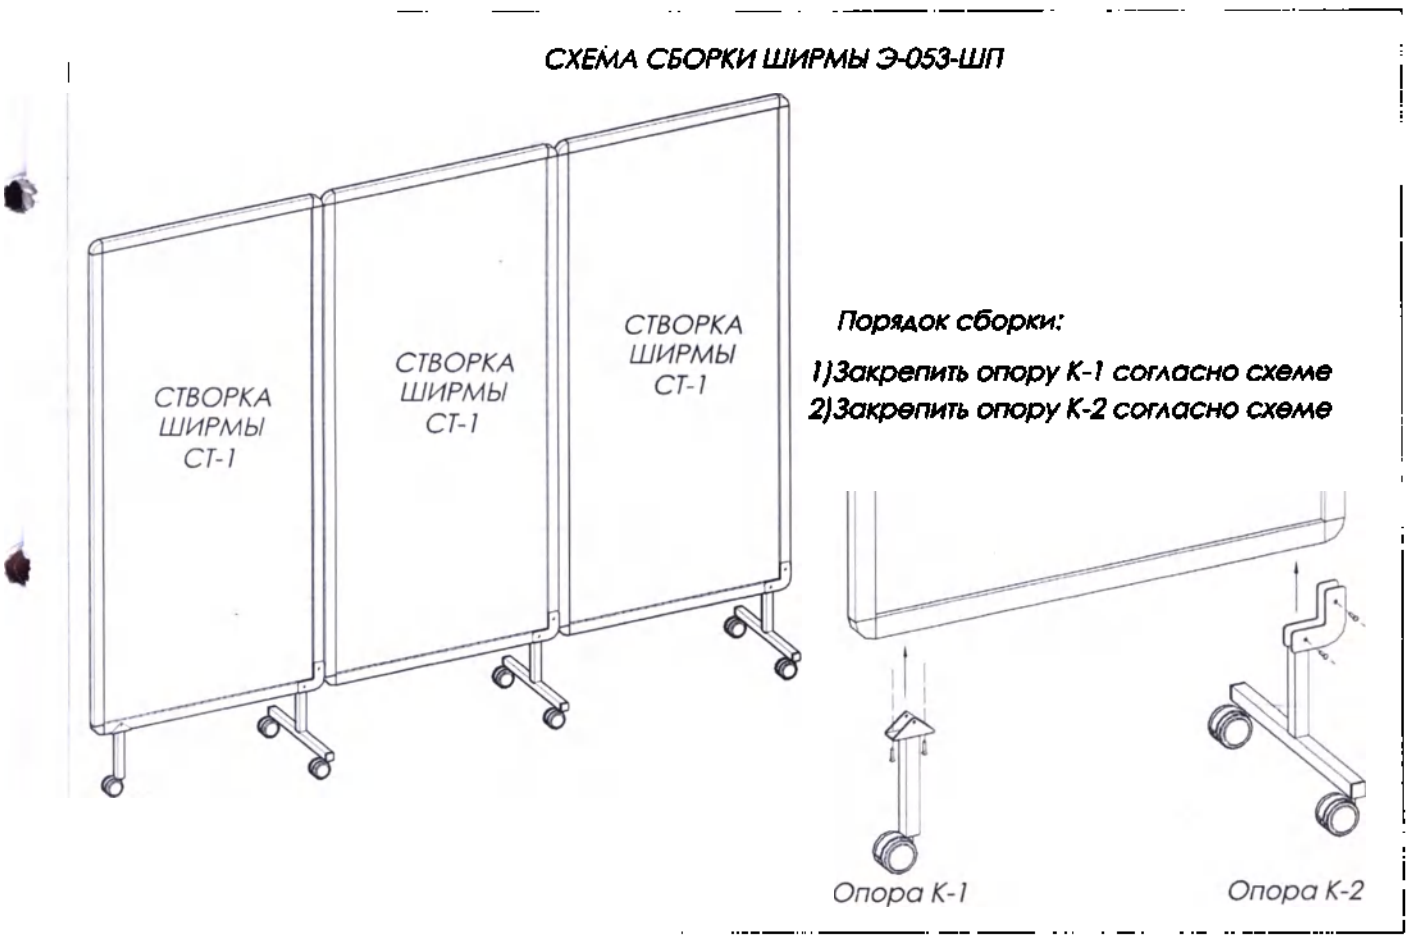

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: ширма обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу :ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ш изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации ;звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ıаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических іециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма медицинская поликарбонатная Э-053-ШП в количестве __________шт. принята в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической экументации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Ширма поликарбонатная Э-053-ШП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20____ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Подставка для забора крови Э-008-П

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Подставка для забора крови Э-008-П** (далее – подставка). Подставка ходит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий подставка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования оцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.
Подставка предназначена для организации забора крови у пациента.
Потенциальные потребители: медицинский персонал стационаров, реабилитационных, офилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного ководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы подставки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
Ширма едицинская аликарбонатная	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка забора крови	**Э-008-П**	**700*400*770**	**6,0±0,5**	**Не более 2 шт.**	**Мягкий элемент из винилискожи.**
Кушетка щедурная ская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка щедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка щедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка для а	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
Стол едвижной ургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
Стол ицинский трументальный	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при	Металлический каркас, Угол регулировки наклона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
				необходимости)	подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
Стол нальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки подставки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
А-2	Поперечина	2
П-3	Опора	2
М-2	Мягкий элемент	1
Крепежные изделия		
К1	Винт-стяжка М6х70	4
К2	Гайка –бочонок М6	4
К3	Саморез 4.2х41мм	7

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (каркас) Винискожа ПВХ-С, пенополиуретан эластичный по ГОСТ 10174, синтепон по ГОСТ 3811 (мягкий элемент)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	6,0±0,3
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять ого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки подставки показана на рисунке 1.
10.2 Установить между опорами **П-3** две поперечины **А-2** закрепить с помощью винта-стяжки К1 и гайки-бочонка К2.
10.3 Положить мягкий элемент **М-2** лицевой стороной вниз и установить собранный ранее каркас согласно схеме сборки. Прикрутить каркас к мягкому элементу с помощью саморезов К3.
10.4 Подставка готова к использованию.

СХЕМА СБОРКИ Подставка для забора крови Э-008-П

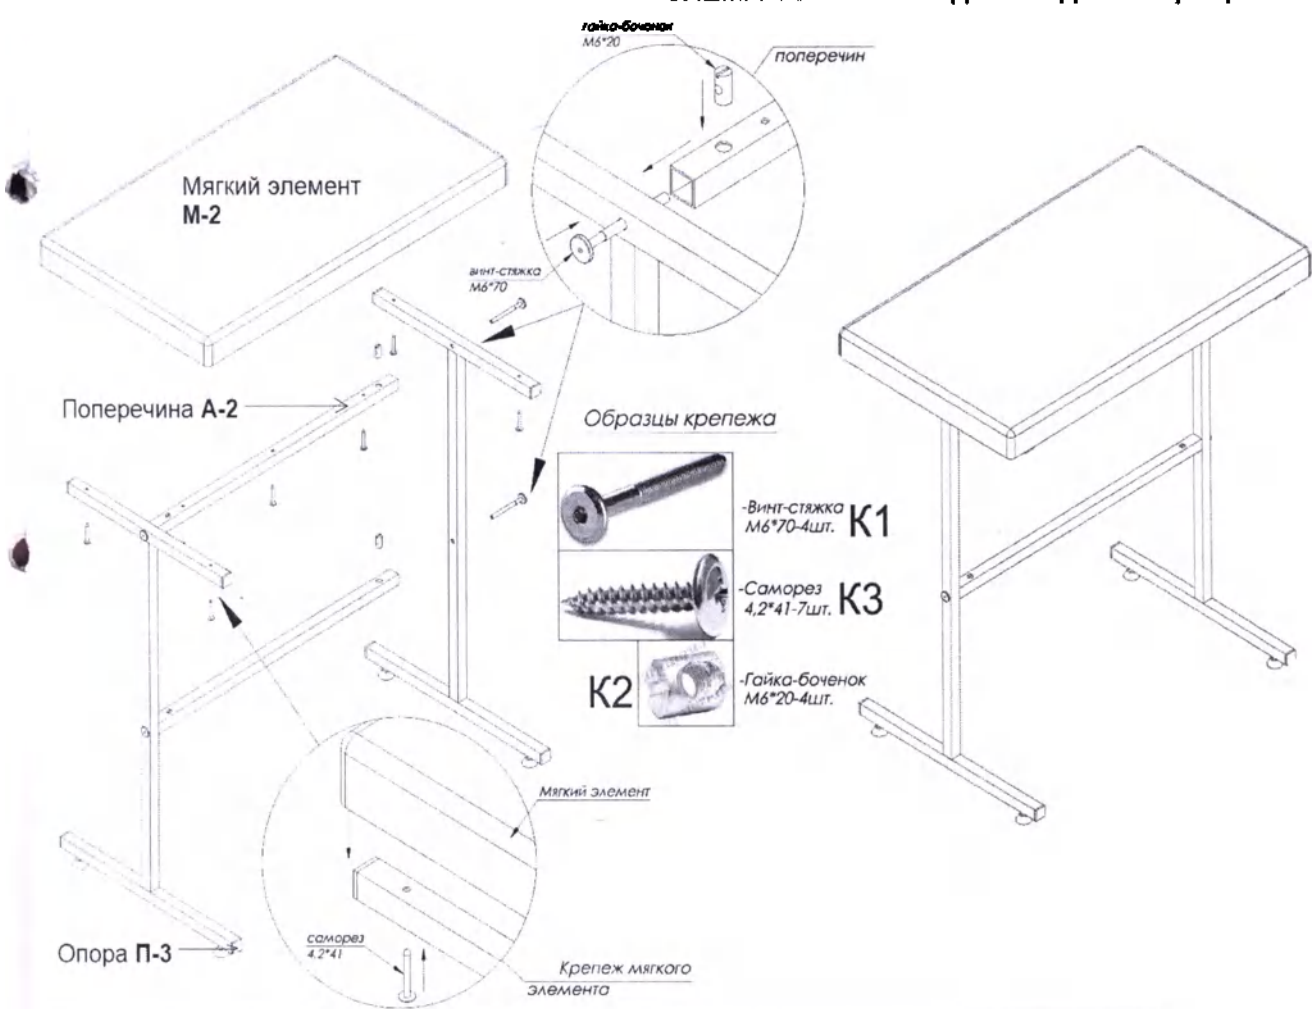

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: подставка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором рекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ецималистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка для забора крови Э-008-П в количестве _____шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признан одным для эксплуатации.

Дата выпуска_____

Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Подставка для забора крови Э-008-П
Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____20_____ г.

Дата_____ Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность **Генеральный директор**
Подпись _____ / **Дрокин Э. А.**
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Кушетка процедурная детская Э-001-ПКД

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Кушетка процедурная детская Э-001-ПКД** (далее – кушетка). шетка входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 50.30-001-42494039-2020.**
1.2 Условия эксплуатации кушетки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.
1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий кушетка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского орудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.
Кушетка предназначена для размещения пациентов во время осмотра или проведения едицинских процедур.
Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы кушетки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма медицинская	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
икарбонатн		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка забора ови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка оцедурная ская	**Э-001-ПКД**	**1500*500*600**	**17,7±0,5**	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка я таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
3 Стол едицинский стрименталь ый	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
0 Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки кушетки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали	Кол-во, шт.
Деталь		
Р-1	Рама с мягкими элементами	**1**
П-1	Опоры кушетки	**2**
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	**12**
К2	Гайка М6	**12**
К3	Саморез 4,2х19 мм	**2**

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (каркас) Винискожа ПВХ-С, пенополиуретан эластичный по ГОСТ 10174, синтепон по ГОСТ 3811 (мягкий элемент)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	17,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10
Максимальный угол подъема подголовника, градусы	36
Угол регулировки наклона подголовника кушеток на металлическом каркасе	13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали кушетки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной и крестовой битами или отвертки стовую и шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять ого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки кушетки показана на рисунке 1.
10.2 Установите опоры кушетки **П-1** вертикально.
10.3 Закрепите раму с мягкими элементами **Р-1** к опорам кушетки с помощью винтов, как показано на рисунке 1.
10.4 Собранную конструкцию установить вертикально в рабочее положение и закрепить мультифлекс к раме при помощи саморезов К3
10.5 Кушетка готова к эксплуатации.

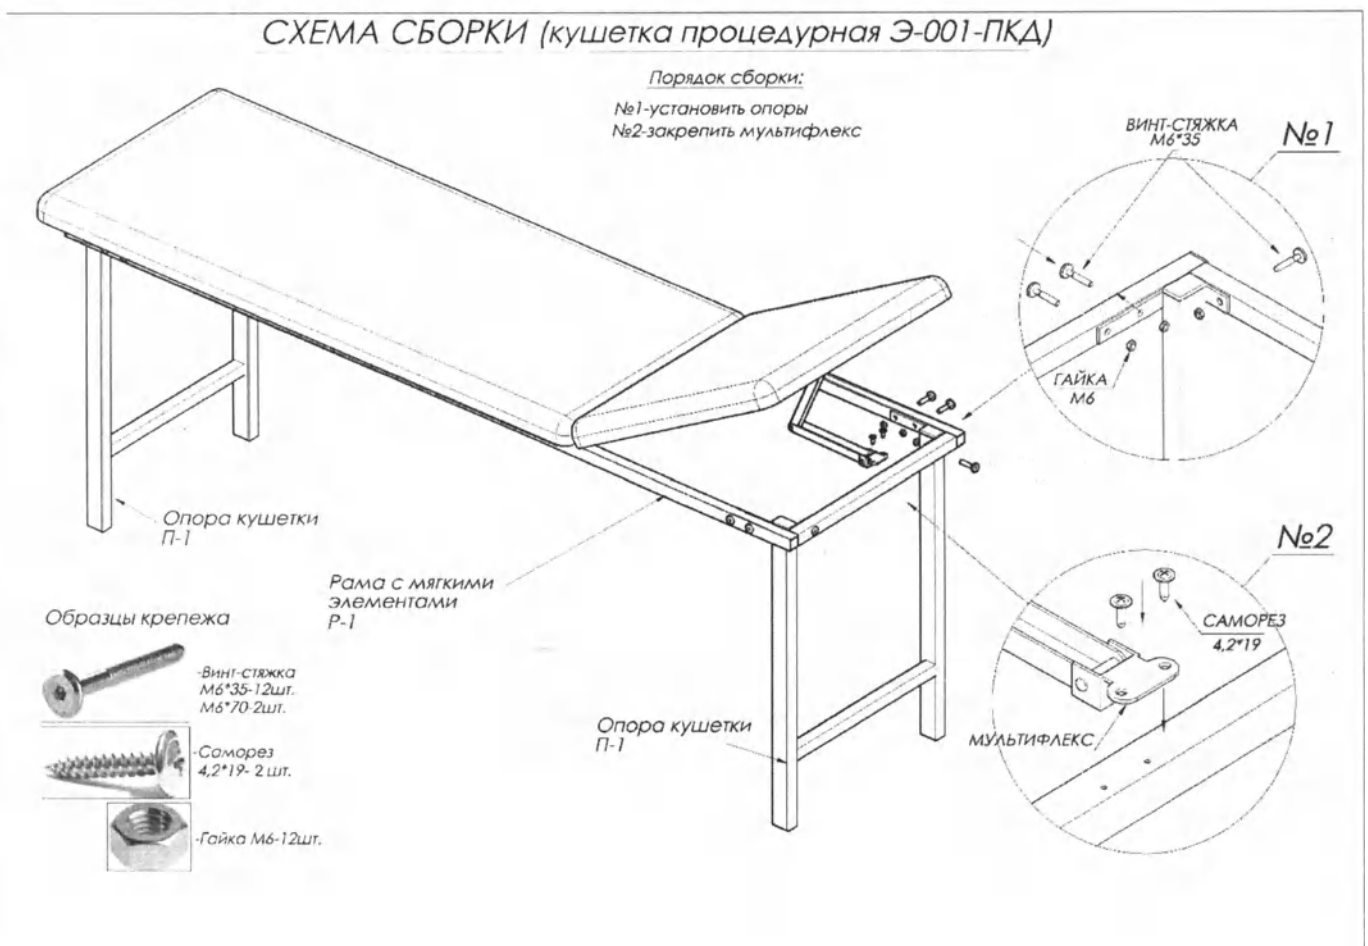

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: кушетка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ю рода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка процедурная детская Э-001-ПКД в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Кушетка процедурная детская Э-001-ПКД
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.
Дата________________Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Кушетка процедурная Э-001-ПК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Кушетка процедурная Э-001-ПК** (далее – кушетка). Кушетка входит остав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-42494039-20.**

1.2 Условия эксплуатации кушетки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий кушетка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Кушетка предназначена для размещения пациентов во время осмотра или проведения едицинских процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы кушетки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	**Э-001-ПК**	**2020*580*610**	**26,9±0,5**	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
) Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки кушетки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали	Кол-во, шт.
Деталь		
Р-2	Рама с мягкими элементами	**1**
П-2	Опоры кушетки	**2**
А-1	Поперечина	**1**
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	**12**
К2	Винт М6х70	**2**
К3	Саморез 4,2х19 мм	**2**
К4	Гайка М6	**12**
К5	Гайка-бочонок М6х20	**2**

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (каркас) Винискожа ПВХ-С, пенополиуретан эластичный по ГОСТ 10174, синтепон по ГОСТ 3811 (мягкий элемент)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Допустимая нагрузка на конструкцию (не более), кг	100
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	26,9±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Максимальный угол подъема подголовника, градусы	36
Угол регулировки наклона подголовника кушеток на металлическом каркасе	13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали кушетки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной и крестовой битами или отвертки естовую и шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия упателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки кушетки показана на рисунке 1.
10.2 Установите опоры кушетки **П-2** вертикально.
10.3 Закрепите раму с мягкими элементами **Р-2** к опорам кушетки с помощью винтов, как показано на рисунке 1.
10.4 Закрепить с помощью винта и гайки бочонок , внизу рамы кушетки поперечину **А-1**, расположив её между опорами кушетки **П-2**
10.5 Собранную конструкцию установить вертикально в рабочее положение и закрепить мультифлекс к раме при помощи саморезов К3.
10.6 Кушетка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

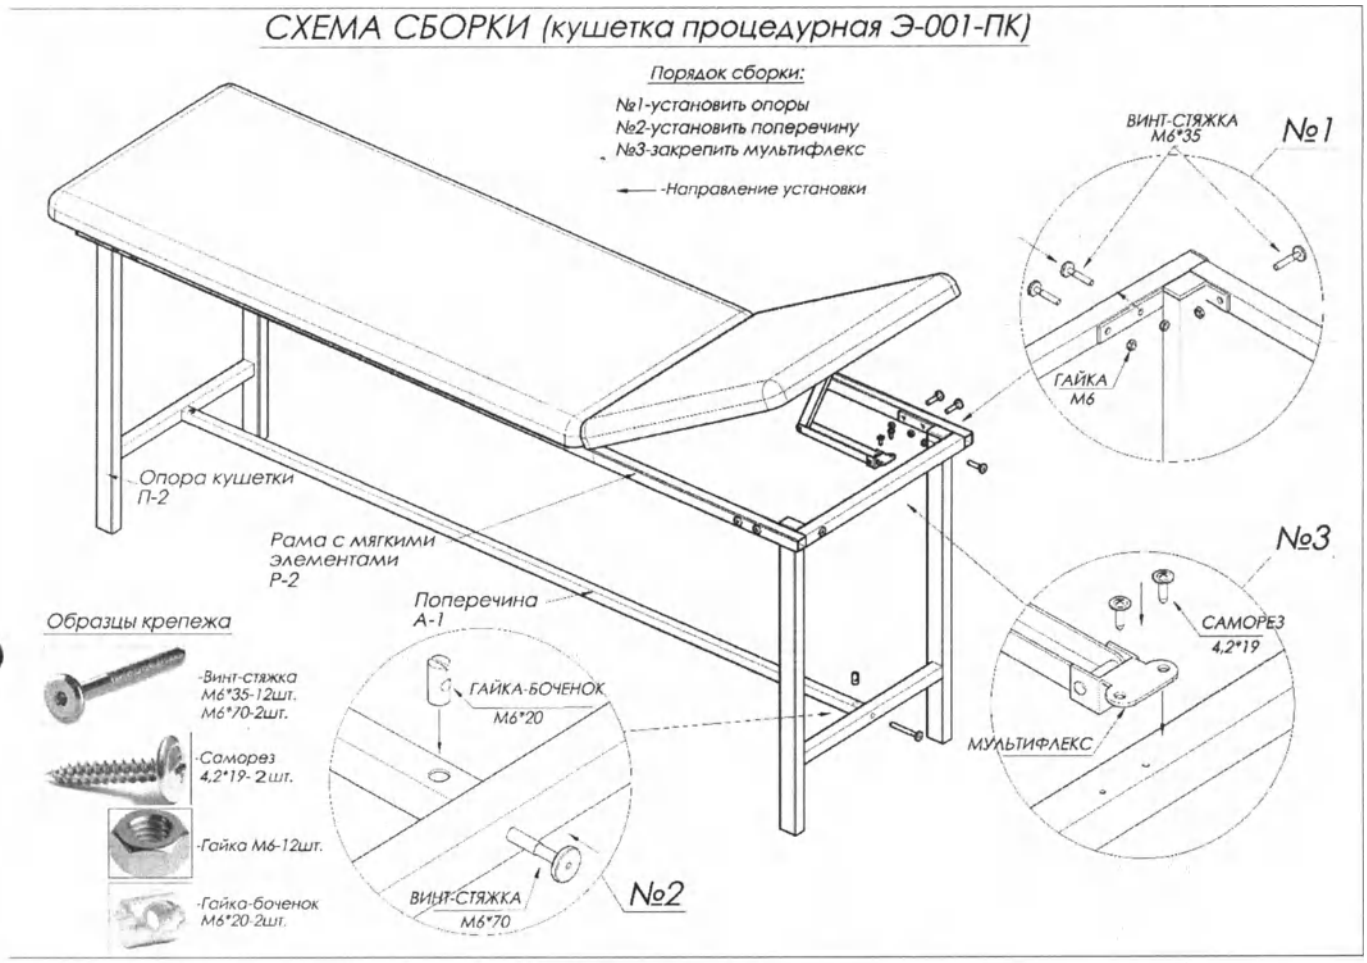

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: кушетка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка процедурная Э-001-ПК в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Кушетка процедурная Э-001-ПК

Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________________Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
8 (восемь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____/ Дрокин Э. А./
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Кушетка процедурная Э-101-ПФК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Кушетка процедурная Э-101-ПФК** (далее – кушетка). Кушетка ходит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации кушетки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий кушетка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Кушетка предназначена для размещения пациентов во время осмотра или проведения едицинских процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, билитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного ководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы кушетки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3	Не более 2 шт.	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
ицинская икарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		(при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка для ра крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка цедурная ская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка цедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	**2020*610*610**	**30,0±0,5**		Деревянный каркас
Кушетка цедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка для а	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол редвижной ургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол ицинский струментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
0 Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки кушетки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали	Кол-во, шт.
Деталь		
№2	Мягкий элемент с обвязкой	**1**
№1	Опора	**4**
Крепежные изделия		
К1	Винт М10х60	**8**
К2	Гайка М10	**8**
К3	Шайба М10	**8**
К4	Саморез 4х30	**2**

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Брус обрезной по ГОСТ 6564 (каркас) с лаковым покрытием по ГОСТ 4976; Винискожа ПВХ-С, пенополиуретан эластичный по ГОСТ 10174, синтепон по ГОСТ 3811 (мягкий элемент)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	30,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10
Максимальный угол подъема подголовника, градусы	36

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали кушетки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной и крестовой битами или отвертки естовую и шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки кушетки показана на рисунке 1.
10.2 Закрепить опоры **№1** к элементу обвязки **№ 2** при помощи винтов М10*50
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально в рабочее положение и закрепить мультифлекс к раме при помощи саморезов К4
10.4 Кушетка готова к эксплуатации.

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: кушетка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка процедурная Э-101-ПФК в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Кушетка процедурная Э-101-ПФК
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_________________________Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

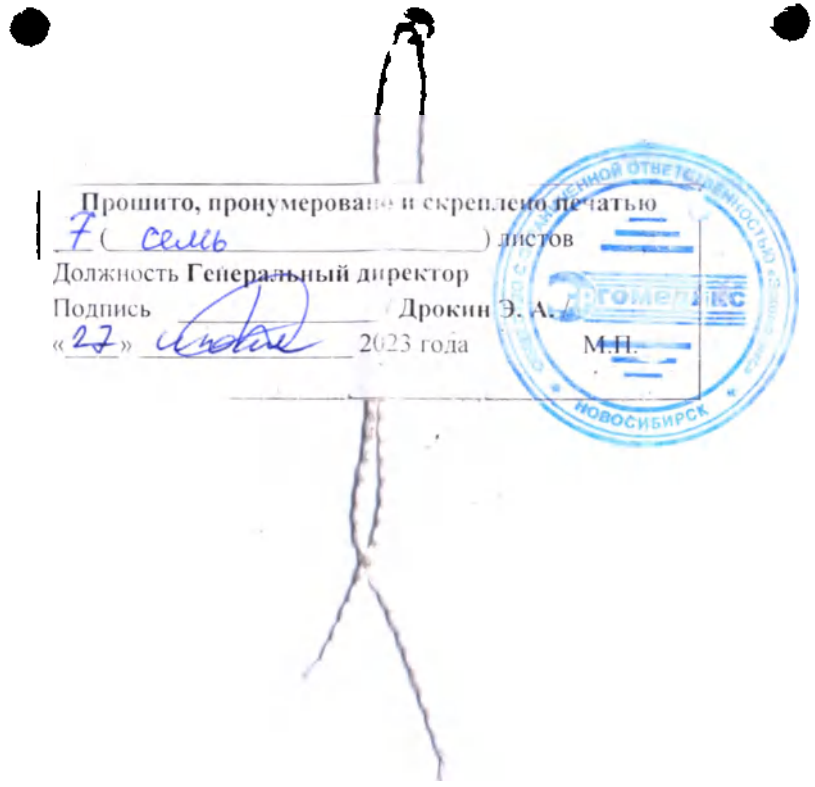
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» _____ 2023 года М.П.
ГЕОМЕРА ГКС
НОВОСИБИРСК

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Кушетка процедурная Э-105-ФК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Кушетка процедурная Э-105-ПФК** (далее – кушетка). Кушетка входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации кушетки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий кушетка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования процедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения медицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Кушетка предназначена для размещения пациентов во время осмотра или проведения медицинских процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы кушетки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3	Не более 2 шт.	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
дицинская ликарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		(при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для ра крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка оцедурная тская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	**Э-105-ФК**	**2070*610*750**	**34,5±0,5**	**Не более 2 шт. (при необходимости)**	**Деревянный каркас, увеличенная высота**
	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
6 Подставка для аза	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
.8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки кушетки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали	Кол-во, шт.
Деталь		
№2	Мягкий элемент с обвязкой	**1**
№1	Опора	**4**
Крепежные изделия		
К1	Винт М10х60	**8**
К2	Гайка М10	**8**
К3	Шайба М10	**8**
К4	Саморез 4х30	**2**

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Брус обрезной по ГОСТ 6564 (каркас) с лаковым покрытием по ГОСТ 4976; Винискожа ПВХ-С, пенополиуретан эластичный по ГОСТ 10174, синтепон по ГОСТ 3811 (мягкий элемент)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	34,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10
Максимальный угол подъема подголовника, градусы	36

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали кушетки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной и крестовой битами или отвертки крестовую и шестигранную.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки кушетки показана на рисунке 1.

10.2 Закрепить опоры №1 к элементу обвязки № 2 при помощи винтов М10*50

10.3 Собранную конструкцию установить вертикально в рабочее положение и закрепить мультифлекс к раме при помощи саморезов К4

10.4 Кушетка готова к эксплуатации

Схема сборки Кушетка процедурная Э-105-ФК

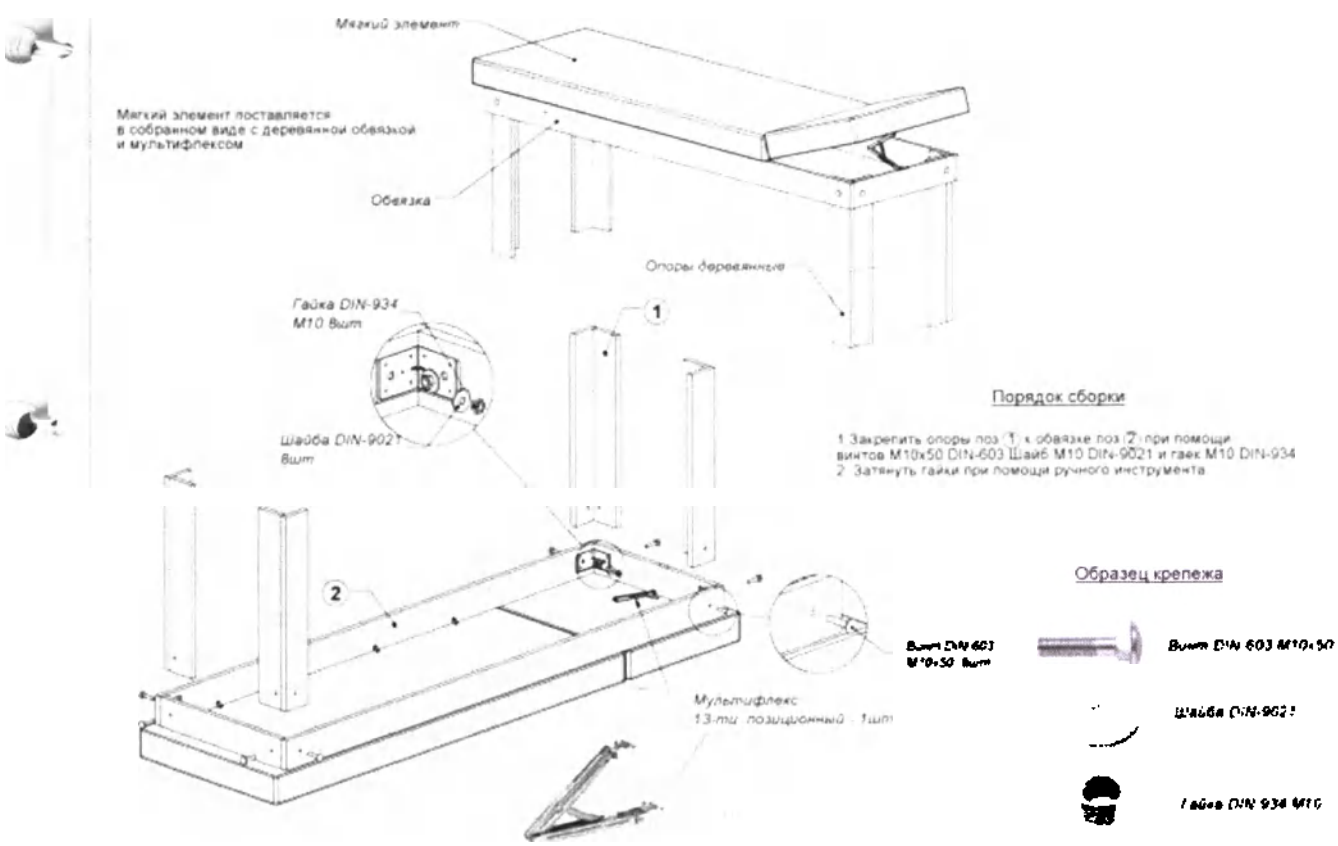

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: кушетка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ТУ, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец берет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка процедурная Э-105-ФК в количестве __________шт. принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Кушетка процедурная Э-105-ФК

Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата___________________________Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» _____ 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Подставка для таза Э-031-П

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Подставка для таза Э-031-П** (далее – подставка). Подставка входит в остав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-42494039-020.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий подставка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Подставка предназначена для размещения медицинских тазов с использованными медицинскими нструментами и/или материалами.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы подставки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
Ширма	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3	Не более 2 шт.	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
дицинская ликарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		(при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для ра крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная тская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка я таза	**Э-031-П**	**Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)**	**3,0±0,5**	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол дицинский струментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
) Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки подставки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Д-1	Держатель таза	1
С-1	Стойка	1
Т-1	Таз	1
П-1	Опоры с колесами	3
С-2	Основание в сборе	1
Крепежные изделия		
К1	Винт-стяжка М6х35	3
К2	Гайка – М6	3
К3	Винт-стяжка М8х20	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания (опоры) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (основание) Стальной тонкостенный профиль с гальваническим покрытием (стойка) Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	3,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия упателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки подставки показана на рисунке 1.
10.2 В основание **С-2** установить три опоры с колесами **П-1** и закрепить их винтами М6*35.
10.3 В собранное основание **С-2** установить стойку **С-1** и закрепить его снизу винтом М8*10.
10.4 В В стойку С-1 вставить держатель таза **Д-1** и отрегулировать по высоте.
10.5 В держатель таза **Д-1** вложить – таз **Т-1**.
10.6 Подставка готова к использованию

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

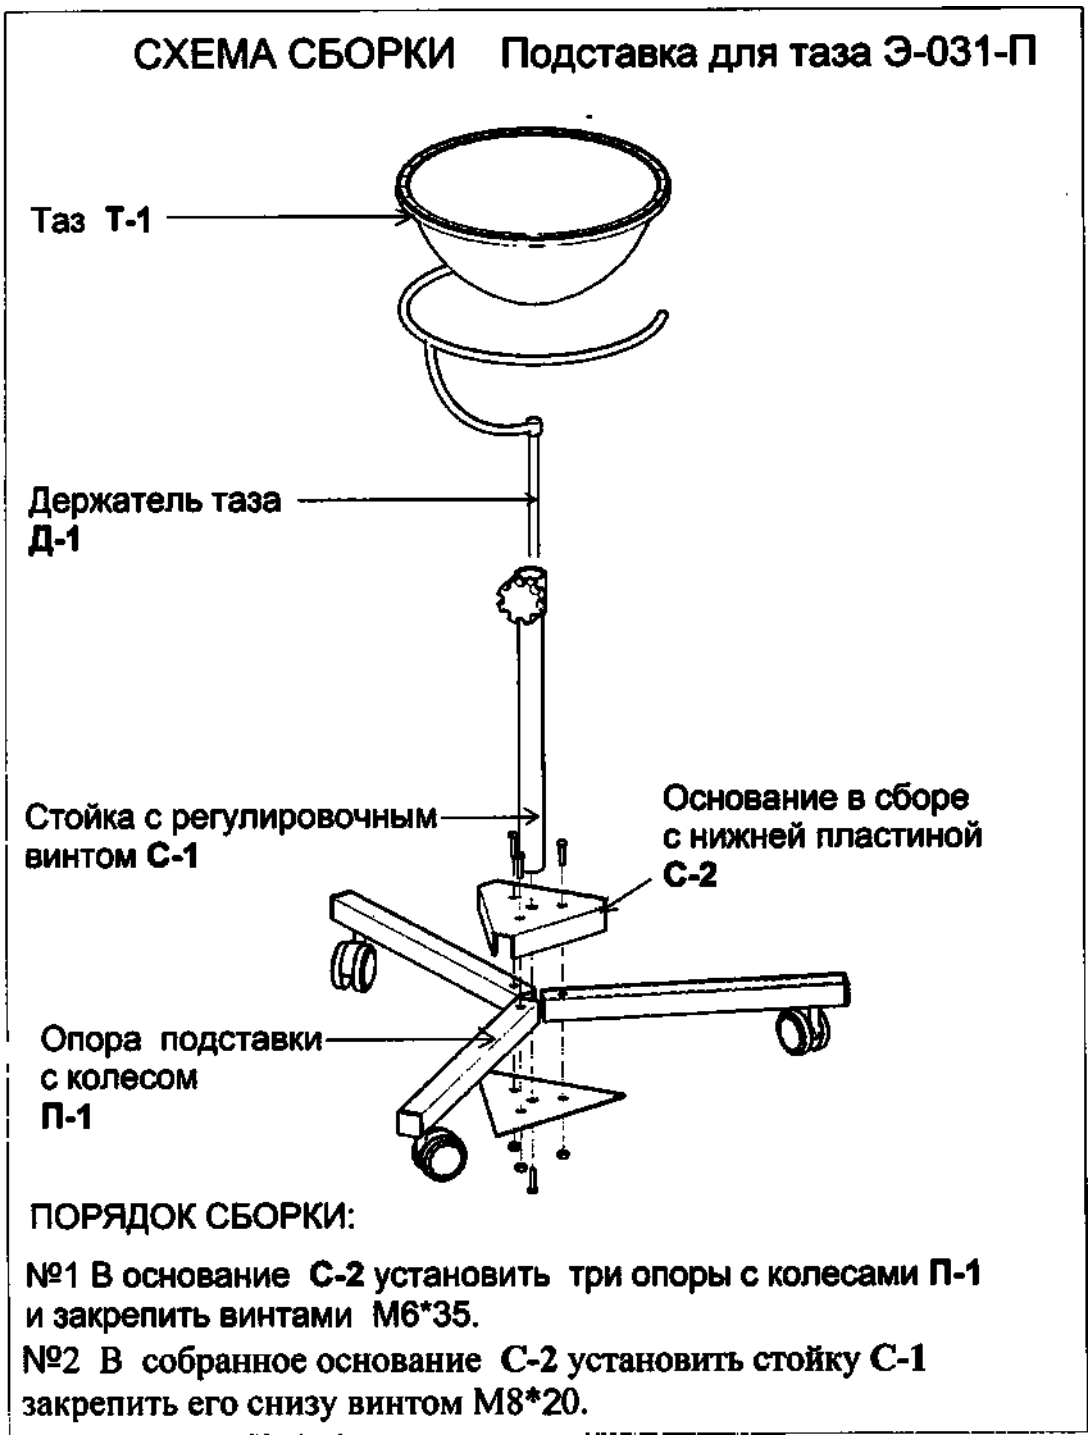

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: подставка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором ерекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели делец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка для таза Э-031-П в количестве __________шт. принята в соответствии с обязательными ебованиями государственных стандартов и технической документации и признан годным для сплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Подставка для таза Э-031-П
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» _____ 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Подставка для таза Э-032-П

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Подставка для таза Э-032-П** (далее – подставка). Подставка входит в остав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-42494039-020.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий подставка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Подставка предназначена для размещения медицинских тазов с использованными медицинскими нструментами и/или материалами.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы подставки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1 Ширма едицинская	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
икарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка едурная тская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	**Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)**	**5,0±0,5**		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
17 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
0 Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки подставки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Д-2	Держатель таза	1
С-1	Стойка	1
Т-1	Таз	2
П-1	Опоры с колесами	3
С-2	Основание в сборе	1
Крепежные изделия		
К1	Винт-стяжка М6х35	3
К2	Гайка – М6	3
К3	Винт-стяжка М8х20	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания (опоры) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (основание) Стальной тонкостенный профиль с гальваническим покрытием (стойка) Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	5,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении равил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки подставки показана на рисунке 1.
10.2 В основание **С-2** установить три опоры с колесами **П-1** и закрепить их винтами М6*35.
10.3 В собранное основание **С-2** установить стойку **С-1** и закрепить его снизу винтом М8*10.
10.4 В В стойку С-1 вставить держатель таза **Д-1** и отрегулировать по высоте.
10.5 В держатель таза **Д-2** вложить – тазы **Т-1**.
10.6 Подставка готова к использованию

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ Подставка для таза Э-032-П

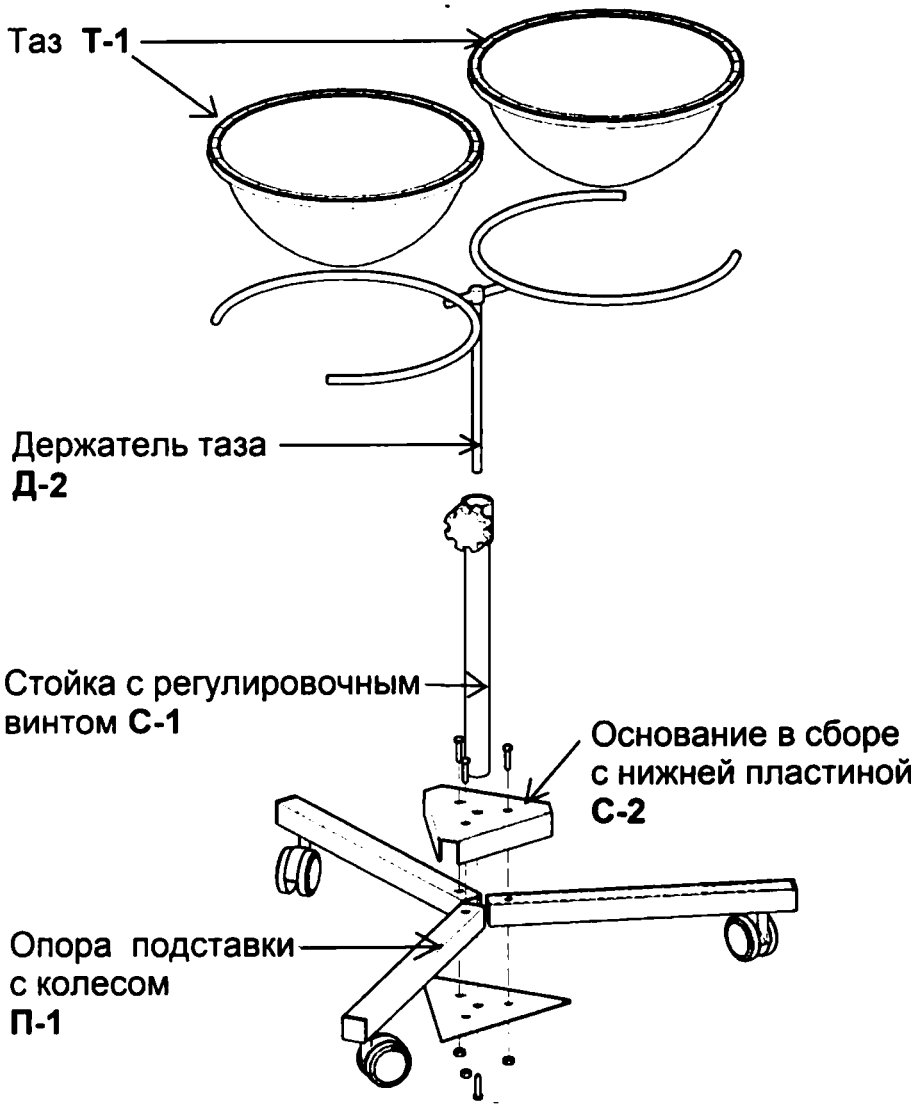

ПОРЯДОК СБОРКИ:

№1 В основание С-2 установить три опоры с колесами П-1 и закрепить винтами М6*35.

№2 В собранное основание С-2 установить стойку С-1 и закрепить его снизу винтом М8*20.

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: подставка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором ерекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели делец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка для таза Э-032-П в количестве __________шт. принята в соответствии с обязательными ребованиями государственных стандартов и технической документации и признан годным для сплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Подставка для таза Э-032-П
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Подставка для таза Э-131-П

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Подставка для таза Э-131-П** (далее – подставка). Подставка входит в став **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-42494039-20.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий подставка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Подставка предназначена для размещения медицинских тазов с использованными медицинскими нструментами и/или материалами.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного ководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы подставки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1 Ширма едицинская	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
икарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка для ора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка едурная ская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка едурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка едурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	**Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)**	**3,0±0,5**		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки подставки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Д-3	Держатель таза	1
С-2	Стойка	1
Т-1	Таз	1
П-2	Опоры с колесами	3
С-5	Основание в сборе	1
Крепежные изделия		
К1	Винт-стяжка М6х35	3
К2	Гайка – М6	3
К3	Винт-стяжка М8х20	1
Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (опоры, стойка) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (основание, держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	3,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки подставки показана на рисунке 1.
10.2 В основание **С-5** установить три опоры с колесами **П-2** и закрепить их винтами М6*35.
10.3 В собранное основание **С-5** установить стойку **С-2** и закрепить его снизу винтом М8*10.
10.4 В В стойку С-2 вставить держатель таза **Д-3** и отрегулировать по высоте.
10.5 В держатель таза **Д-3** вложить – таз **Т-1**.
10.6 Подставка готова к использованию

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

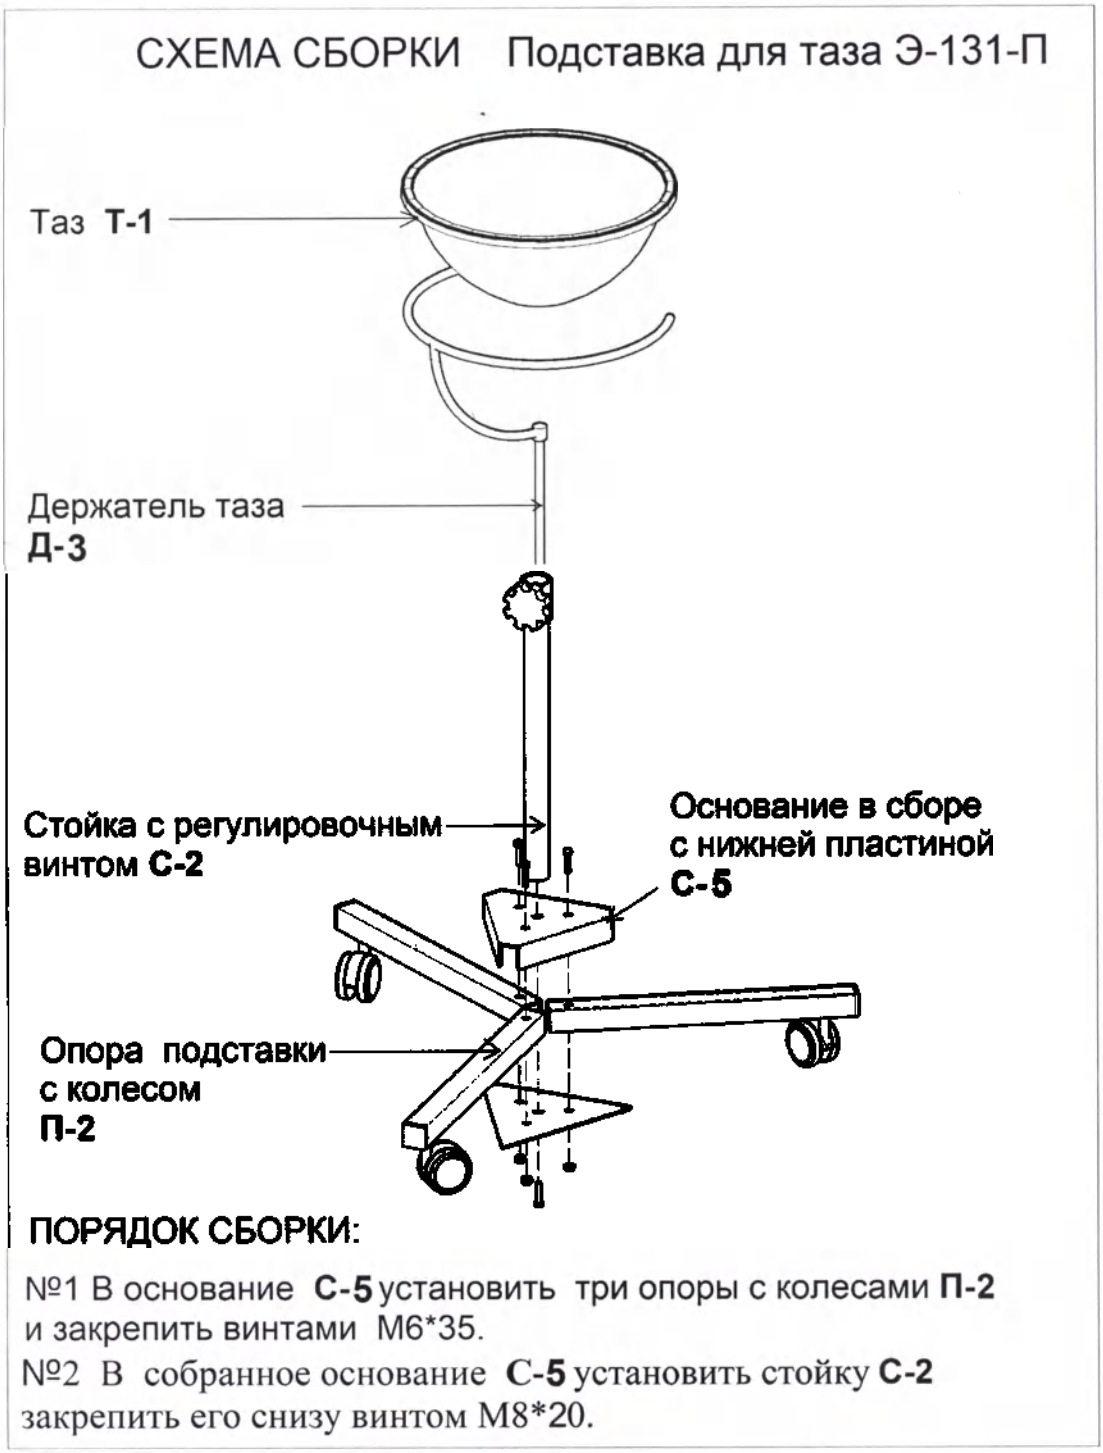

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: подставка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором ерекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка для таза Э-131-П в количестве __________шт. принята в соответствии с обязательными ебованиями государственных стандартов и технической документации и признан годным для сплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Подставка для таза Э-131-П
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э.А./

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Подставка для таза Э-132-П

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Подставка для таза Э-132-П** (далее – подставка). Подставка входит в став **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-42494039-20.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий подставка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Подставка предназначена для размещения медицинских тазов с использованными медицинскими нструментами и/или материалами.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы подставки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

менование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
ицинская карбонатн		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка абора ви	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка цедурная ская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка цедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка цедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка я таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	**Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)**	**5,0±0,5**		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол ицинский струменталь й	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки подставки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Д-3	Держатель таза	1
С-2	Стойка	1
Т-1	Таз	2
П-2	Опоры с колесами	3
С-5	Основание в сборе	1
Крепежные изделия		
К1	Винт-стяжка М6х35	3
К2	Гайка – М6	3
К3	Винт-стяжка М8х20	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (опоры, стойка) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (основание, держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	5,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки подставки показана на рисунке 1.
10.2 В основание **С-5** установить три опоры с колесами **П-2** и закрепить их винтами М6*35.
10.3 В собранное основание **С-5** установить стойку **С-2** и закрепить его снизу винтом М8*10.
10.4 В В стойку **С-2** вставить держатель таза **Д-3** и отрегулировать по высоте.
10.5 В держатель таза **Д-4** вложить – тазы **Т-1**.
10.6 Подставка готова к использованию

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ Подставка для таза Э-132-П

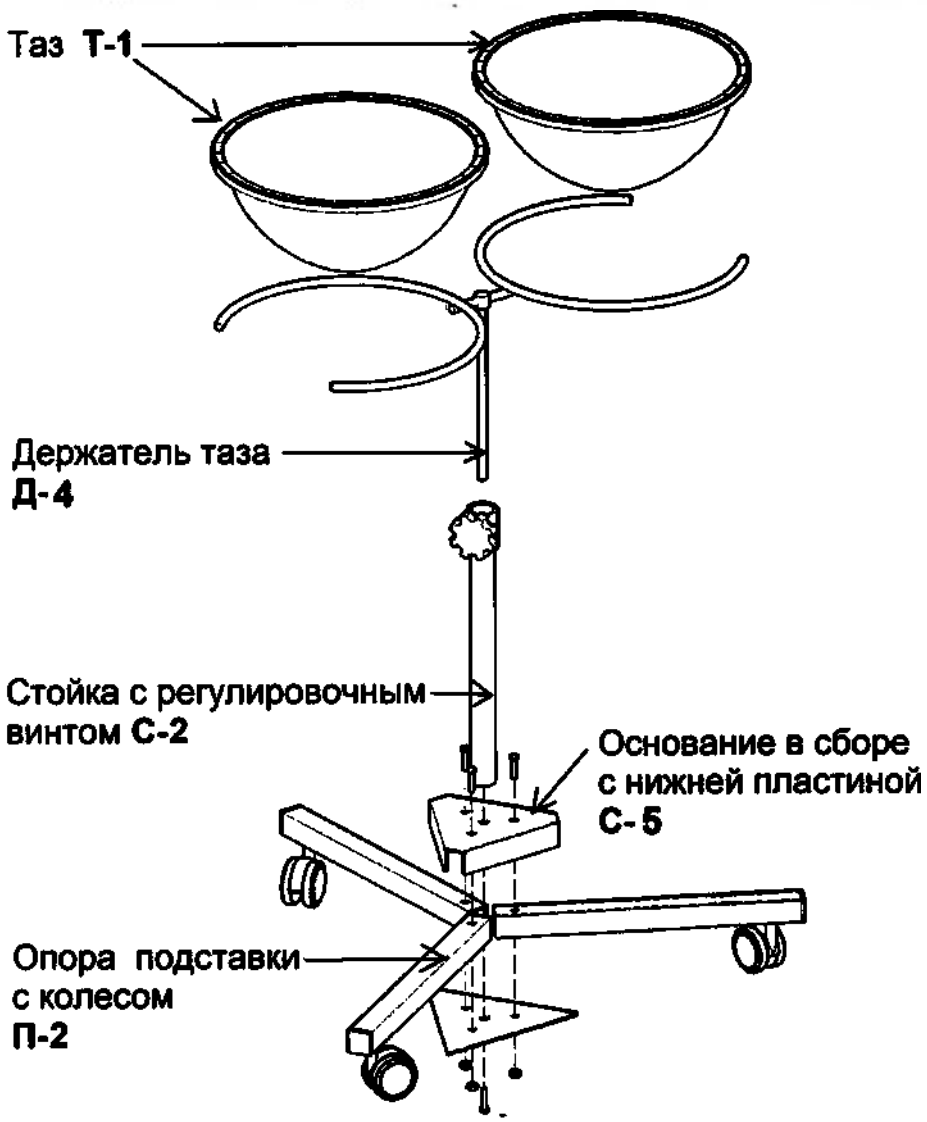

ПОРЯДОК СБОРКИ:

№1 В основание **С-5** установить три опоры с колесами **П-1** и закрепить винтами М6*35.

№2 В собранное основание **С-5** установить стойку **С-2** и закрепить его снизу винтом М8*20.

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: подставка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором ерекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических циалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка для таза Э-132-П в количестве __________шт. принята в соответствии с обязательными ебованиями государственных стандартов и технической документации и признан годным для сплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Подставка для таза Э-132-П
Дата выпуска ____________, партия ____________
товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол передвижной хирургический Э-060-СХ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол передвижной хирургический Э-060-СХ** (далее – стол). Стол ходит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для размещения и перемещения медицинских инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатн	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка я забора рови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка ля таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	**620*510*(720-1170)**	**7,6±0,5**		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
7 Стол передвижной хирургически	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструменталь ный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р-1	Рама	1
СТ-1	Стоевая опорная с регулировочным винтом	1
СТ-2	Стоевая внутренняя	1
К-1	Крестовина опорная	1
П-1	Поддон (сталь с полимерным покрытием)	1
Крепежные изделия		
	Винт М8х16	2
	Винт М6х16	3

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской. (поддон)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	7,6±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия окупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении равил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки стола показана на рисунке 1.
10.2 Прикрутить крестовину **К-1** к стоевой опорной **СТ-1** с помощью двух винтов М*8х16;
10.3 Прикрутить раму **Р-1** к стоевой внутренней **СТ-2** с помощью трёх винтов М6х16;
10.4 Вставить вертикально -стоевую внутреннюю в стоевую опорную и закрепить регулировочным винтом.
10.5 Вложить .в раму **Р-1** поддон **П-1**
10.6 Стол готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ Стол передвижной хирургический Э-060-СХ

Порядок сборки

№1 Прикрутить крестовину **К-1** к стоевой опорной **СТ-1** с помощью двух винтов М8*16
№2 Прикрутить Раму **Р-1** к стоевой внутренней **СТ-2** с помошью трех винтов М6*16
№3 Вставить вертикально стоевую внутреннюю в стоевую опорную и закрепить регулировочным винтом
№ 4 Вложить поддон **П-1**

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол передвижной хирургический Э-060-СХ в количестве __________шт. принят в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признан дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол передвижной хирургический Э-060-СХ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол передвижной хирургический Э-060-СХ/Н

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол передвижной хирургический Э-060-СХ/Н** (далее – стол). Стол дит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-94039-2020.**
1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.
1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского орудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования оцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения дицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для размещения и перемещения медицинских инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
Ширма дицинская ликарбонатная	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
1.6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
Стол редвижной ургический	**Э-060-СХ/Н**	**620*510*(720-1170)**	**7,8±0,5**	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
.8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
) Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
0 Стол денальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р-1	Рама	1
СТ-1	Стоевая опорная с регулировочным винтом	1
СТ-2	Стоевая внутренняя	1
К-1	Крестовина опорная	1
П-2	Поддон (нержавеющая сталь)	1
Крепежные изделия		
	Винт М8х16	2
	Винт М6х16	3
Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (поддон)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
емпература окружающей среды при эксплуатации,	5 - 30
асса нетто, кг	7,8±0,5
азначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой бходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении вил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки стола показана на рисунке 1.
10.2 Прикрутить крестовину **К-1** к стоевой опорной **СТ-1** с помощью двух винтов М*8х16;
10.3 Прикрутить раму **Р-1** к стоевой внутренней **СТ-2** с помощью трёх винтов М6х16;
10.4 Вставить вертикально -стоевую внутреннюю в стоевую опорную и закрепить регулировочным винтом.
10.5 Вложить .в раму **Р-1** поддон **П-2**
10.6 Стол готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ Стол передвижной хирургический Э-060-СХ/Н

Порядок сборки

№1 Прикрутить крестовину **К-1** к стоевой опорной **СТ-1** с помощью двух винтов М8*16
№2 Прикрутить Раму **Р-1** к стоевой внутренней **СТ-2** с помошью трех винтов М6*16
№3 Вставить вертикально стоевую внутреннюю в стоевую опорную и закрепить регулировочным винтом
№ 4 Вложить поддон **П-2**

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол передвижной хирургический Э-060-СХ/Н в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол передвижной хирургический Э-060-СХ/Н
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» _____ 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол передвижной хирургический Э-160-СХ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол передвижной хирургический Э-160-СХ** (далее – стол). Стол дит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-94039-2020.**
1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.
1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского орудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования оцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения дицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для размещения и перемещения медицинских инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного ководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
Ширма ицинская икарбонатная	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка для ора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка оцедурная гская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
.6 Подставка для аза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
Стол едвижной ургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	**620*510*(720-1170)**	**8,8±0,5**		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
0 Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р-2	Рама	1
СТ-3	Стоевая опорная с регулировочным винтом	1
СТ-4	Стоевая внутренняя	1
К-2	Крестовина опорная	1
П-2	Поддон (нержавеющая сталь)	1
Крепежные изделия		
	Винт М8х16	2
	Винт М6х16	3
Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (поддон)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	8,8±0,5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки стола показана на рисунке 1.
10.2 Прикрутить крестовину **К-2** к стоевой опорной **СТ-3** с помощью двух винтов М*8х16;
10.3 Прикрутить раму **Р-2** к стоевой внутренней **СТ-4** с помощью трёх винтов М6х16;
10.4 Вставить вертикально -стоевую внутреннюю в стоевую опорную и закрепить регулировочным винтом.
10.5 Вложить .в раму **Р-2** поддон **П-2**
10.6 Стол готов к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ Стол передвижной хирургический Э-160-СХ

Порядок сборки

№1 Прикрутить крестовину К-2 к стоевой опорной СТ-3 с помощью двух винтов М8*16

№2 Прикрутить Раму Р-2 к стоевой внутренней СТ-4 с помошью трех винтов М6*16

№3 Вставить вертикально стоевую внутреннюю в стоевую опорную и закрепить регулировочным винтом

№ 4 Вложить поддон П-2

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол передвижной хирургический Э-160-СХ в количестве __________шт. принят в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признан дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________ Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол передвижной хирургический Э-160-СХ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (Восемь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол передвижной хирургический Э-260-СХ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол передвижной хирургический Э-260-СХ** (далее – стол). Стол ходит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для размещения и перемещения медицинских инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного ководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
		Ширина опоры: - 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
1.2 Подставка для забора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
1.3 Кушетка процедурная детская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
1.4 Кушетка процедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
1.5 Кушетка процедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
1.6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
.7 Стол ередвижной ирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	**620*510*(860-1000)**	**15,5±0,5**		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р-3	Рама	1
Г-1	Гидроподъемник в сборе	1
К-3	Крестовина опорная	1
П2	Поддон (нержавеющая сталь)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х16	3
	Болт М10х16	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (поддон) Механический гидравлический подъёмник.
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Масса нетто, кг	15,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10
Усилие, прикладываемое к педали гидропривода	не превышает 250 Н (25 кгс)

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки стола показана на рисунке 1.
10.2 Прикрутить крестовину **К-3** к нижней части гидроподъёмника Г-**1** с при помощи болта М*10х16 с шайбой.
10.3 Прикрутить раму **Р-3** к верхней части гидроподъёмника Г-**1 4** с помощью трёх винтов М6х16
10.5 Вложить .в раму **Р-3** поддон **П-2**
10.6 Стол готов к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ Стол предвижной хирургический Э-260-СХ

Порядок сборки

№1 Вставить нижнюю часть гидропьемника в центр крестовины и закрепить с низу болтом М10*16 с шайбой.
№2 Прикрутить раму **Р-3** к верхней части гидропьемника **Г-1** с помощью трех винтов М6*16

№3 Вложить подоон **П-2**

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси юрода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу одов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации ѕзвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо ѕделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ıаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ɔмощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ıециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ɛрет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол передвижной хирургический Э-260-СХ в количестве _____шт. принят в соответствии с ɔязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признан ɑдным для эксплуатации.

Дата выпуска_____

Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол передвижной хирургический Э-260-СХ
Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____20__ г.

Дата_____ Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» ноября 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590** (далее – стол). тол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-01-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 745*1720;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2245*1720; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	**Э-1180/590**	**1180*590*760**	**25,0±0,5**	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол денальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	10
К2	Саморез 4х16мм	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
Масса нетто, кг	25,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

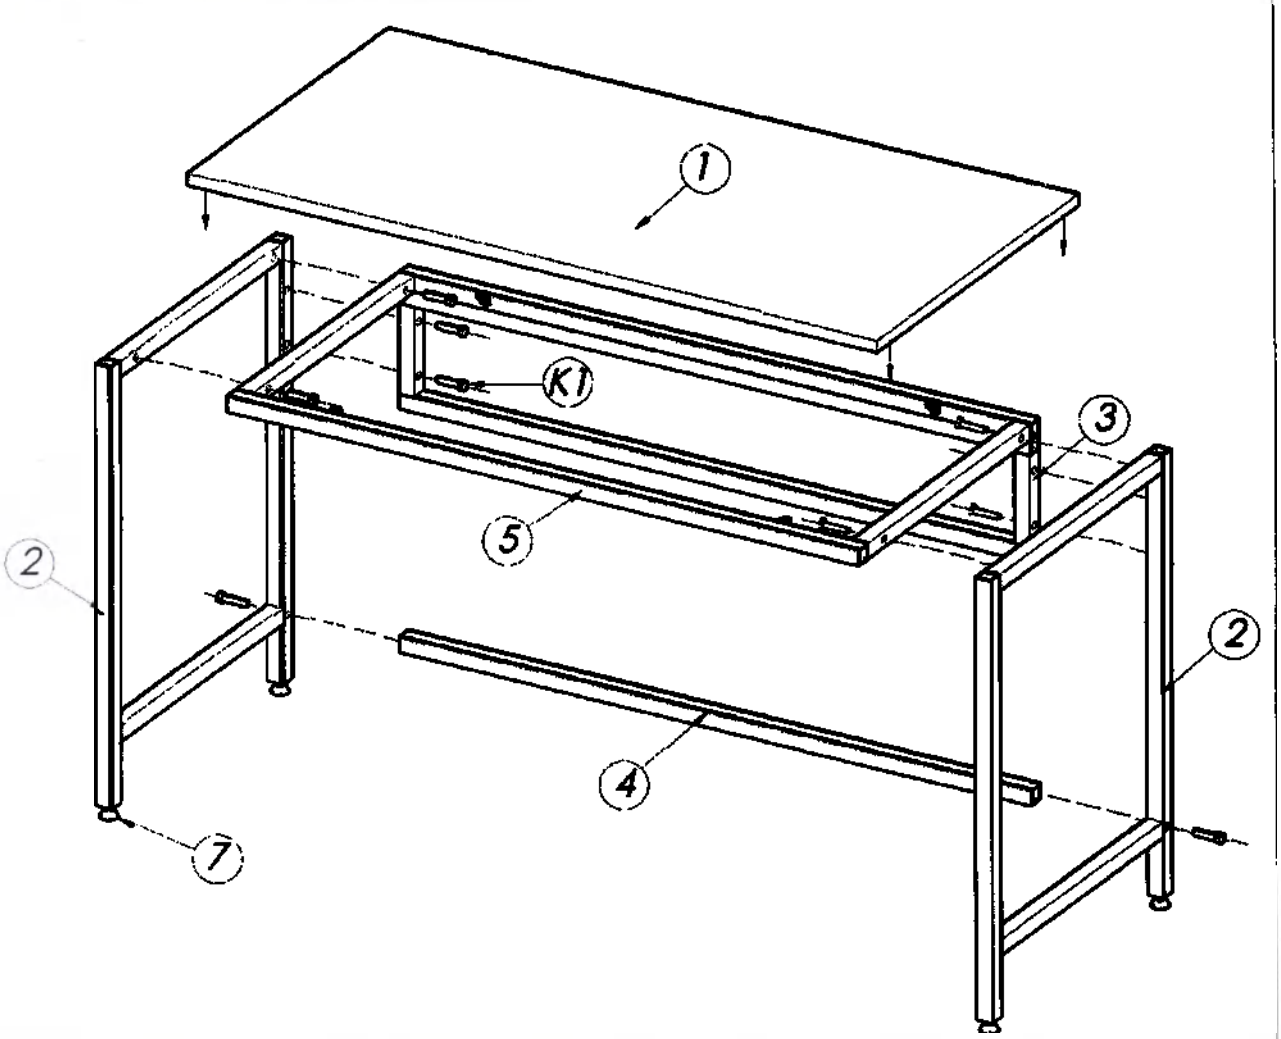

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм (K1)

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси)дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590 в количестве __________шт. принята в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________

Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дроки Э. А.** /

«21» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/П

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/П** (далее – стол). тол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-01-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для аза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	**1180*590*760**	**32,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	12
К2	Саморез 4х16мм	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
Масса нетто, кг	32,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

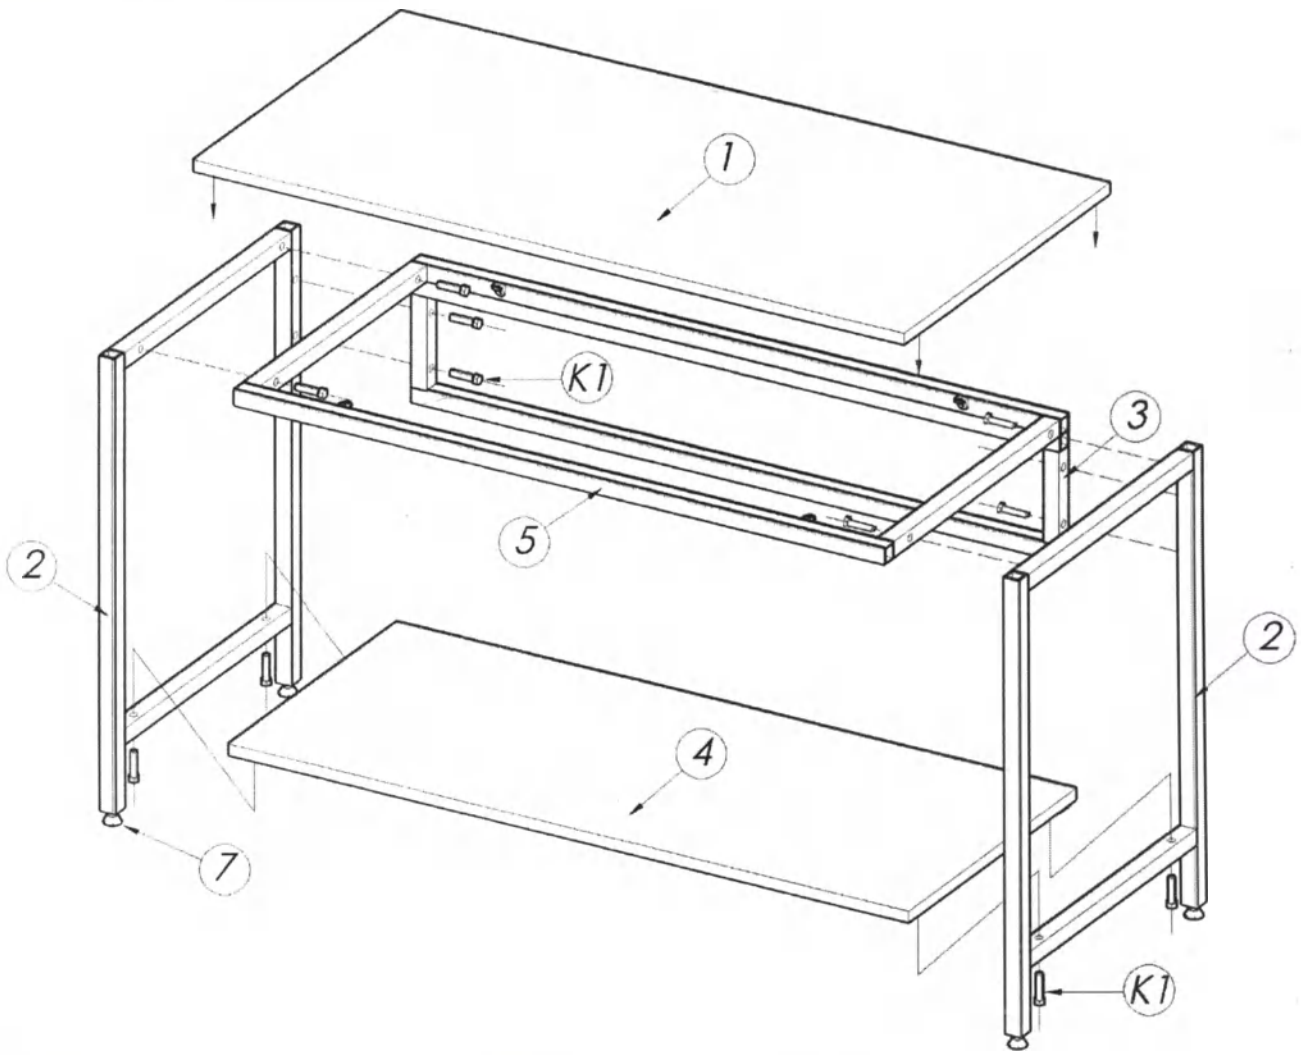

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм (K1)

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ш изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели иаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ›мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических iециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/П в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/П
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность **Генеральный директор**
Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750** (далее – стол). ол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-1-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	**1180*750*760**	**29,0±0,5**		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	10
К2	Саморез 4х16мм	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	29,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

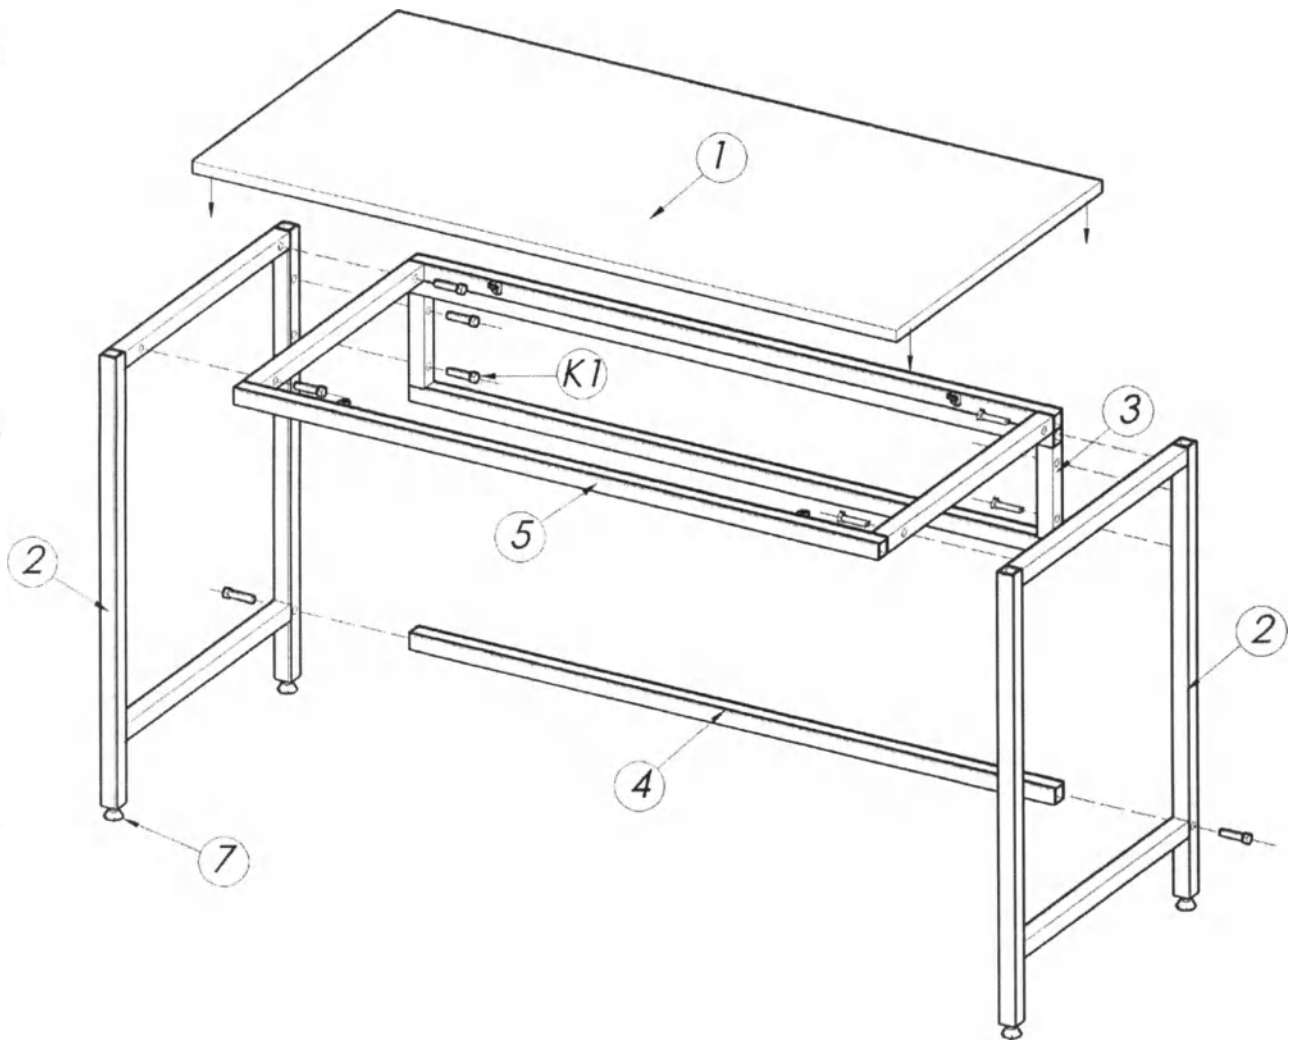

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3)
Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм (K1)
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели иделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750 в количестве __________шт. принята в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750
Дата выпуска _____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А.
«27» апреля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/П

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/П** (далее – стол). ол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-1-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для аза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	**1180*750*760**	**38,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	12
К2	Саморез 4х16мм	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
Масса нетто, кг	38,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять ого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

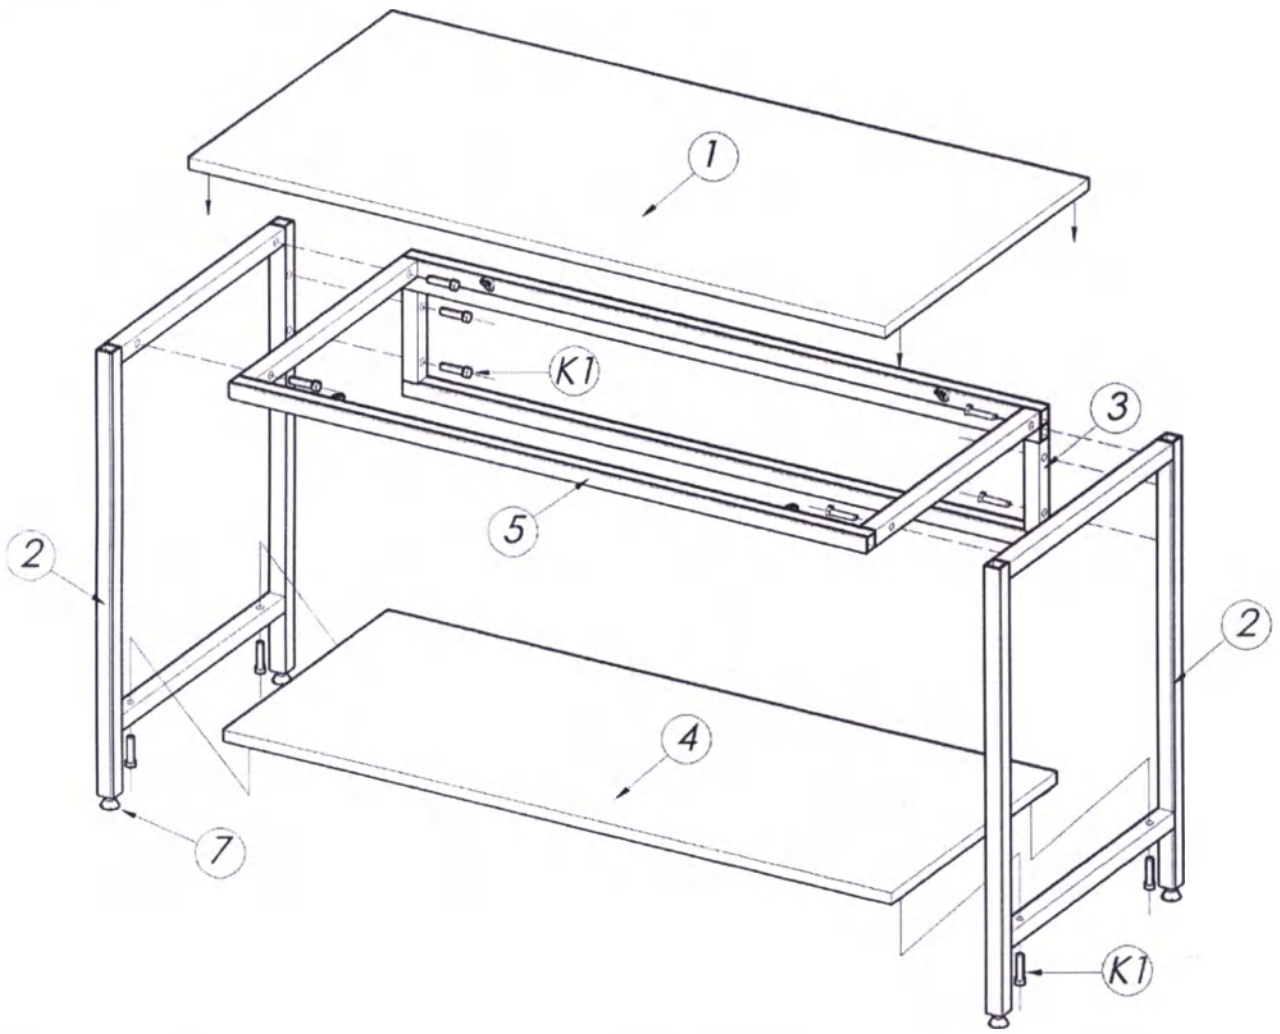

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм (K1)

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ;орода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ;одов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/П в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/П
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1** (далее – стол). тол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-01-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатн я		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка я забора рови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка ля таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	**1180*590*900**	**26,0±0,5**		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
0 Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	10
К2	Саморез 4х16мм	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	26,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

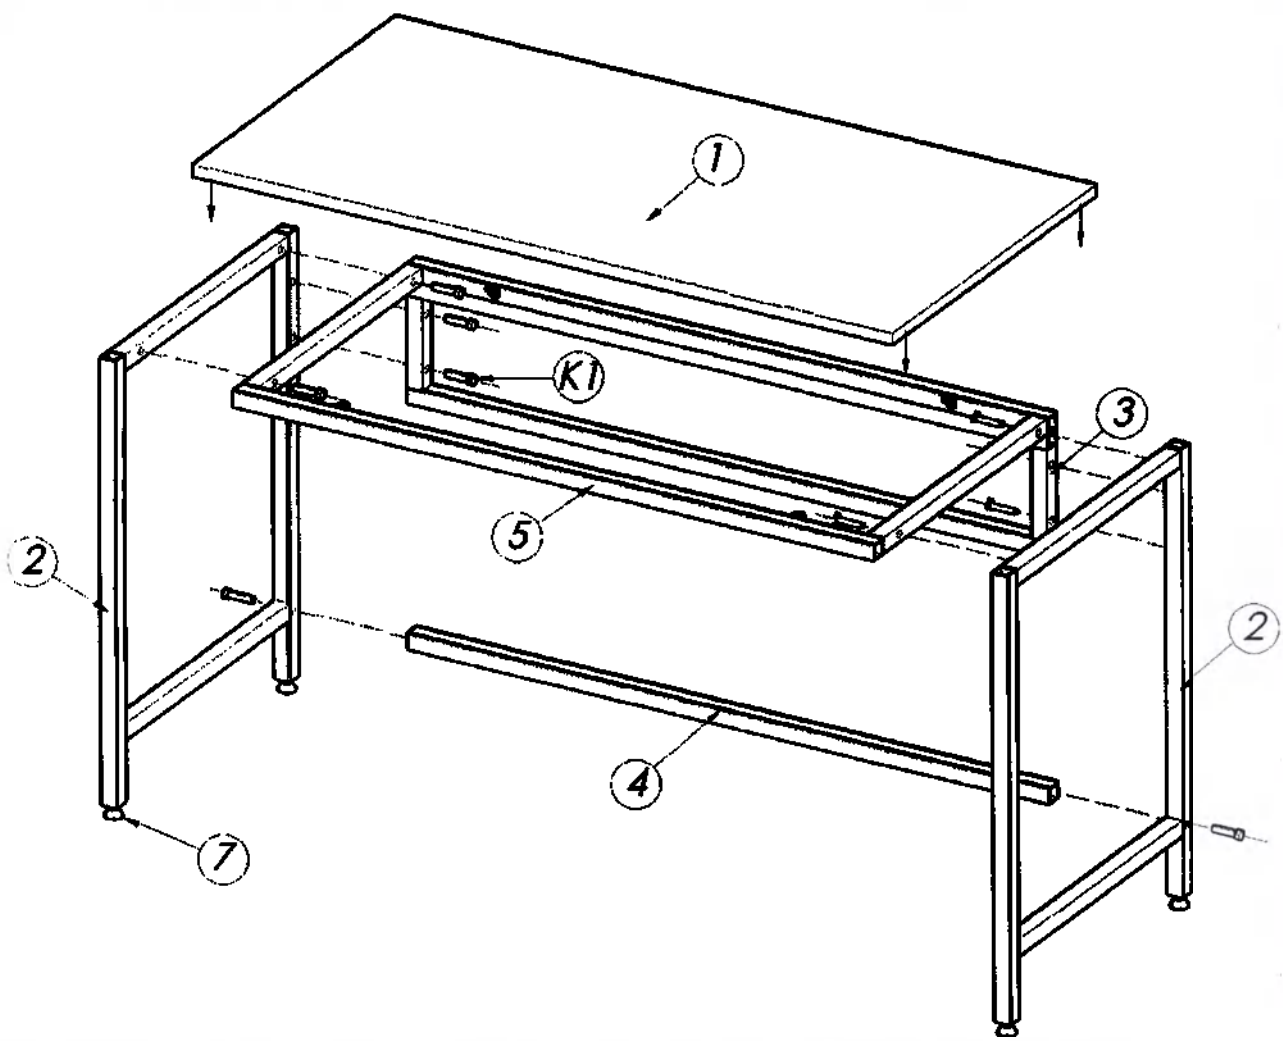

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм (K1)
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1 в количестве ___________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

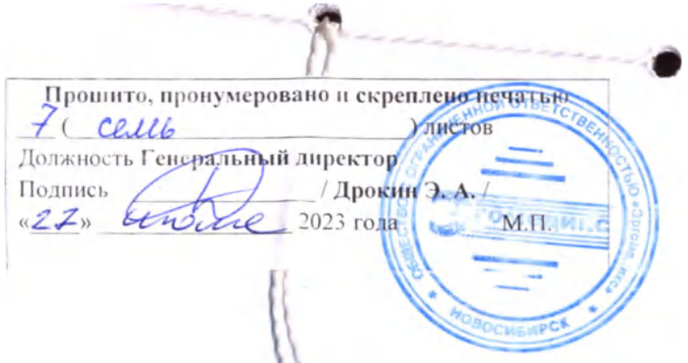
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» октября 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/П

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/П** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
17 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
18 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	**1180*590*900**	**33,0±0,5**		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	12
К2	Саморез 4х16мм	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	33,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении равил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

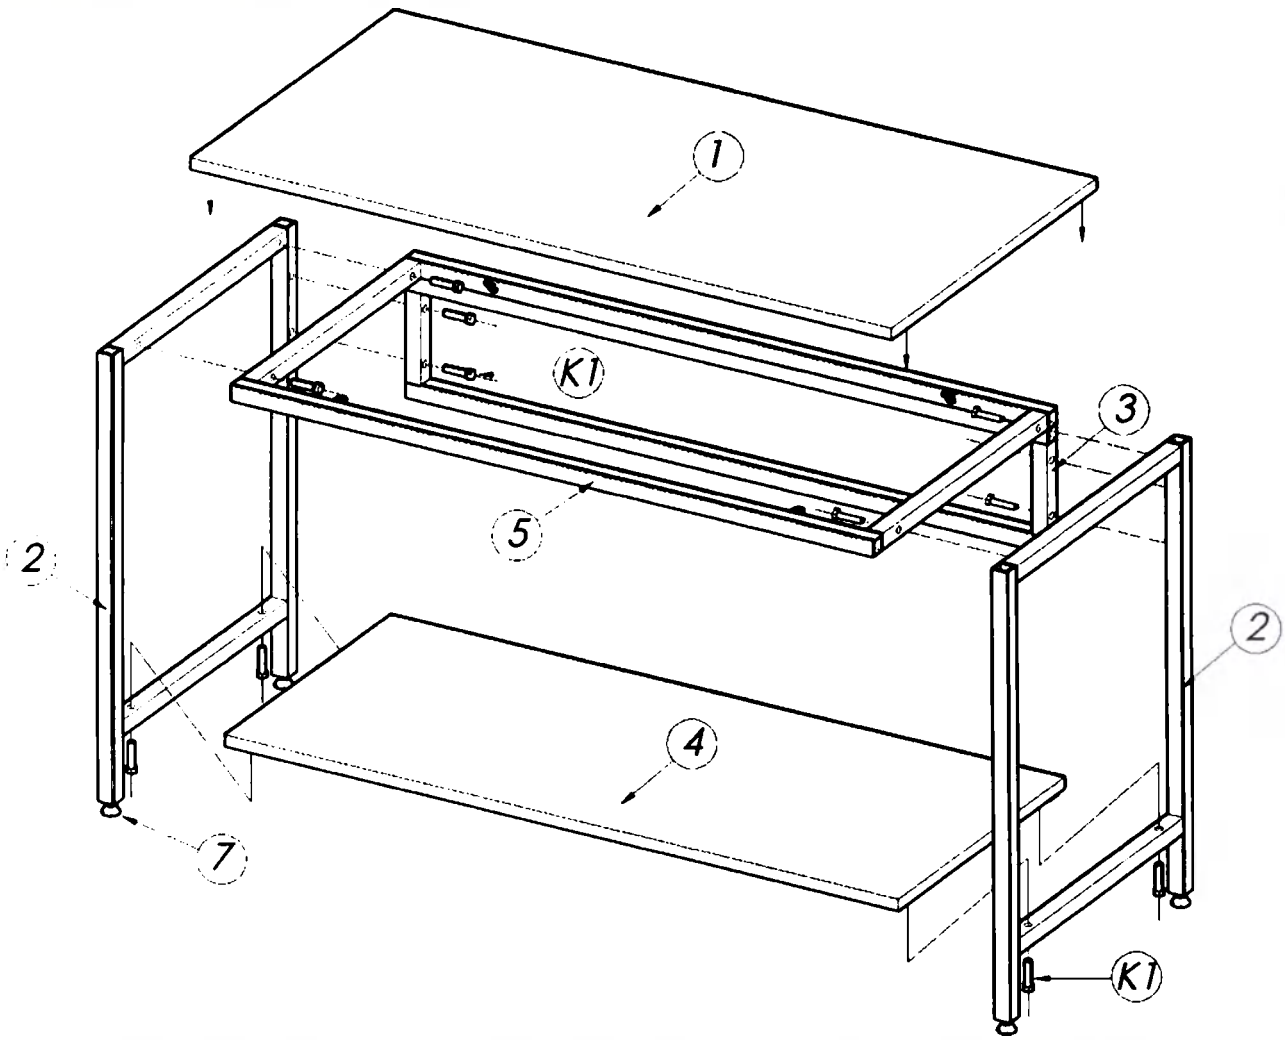

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм (K1)
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/П в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/П
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А./

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1** (далее – стол). тол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-)1-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка оцедурная тская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	**1180*750*900**	**30,0±0,5**		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	10
К2	Саморез 4х16мм	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Допустимая нагрузка на конструкцию (не более), кг	60
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	30,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

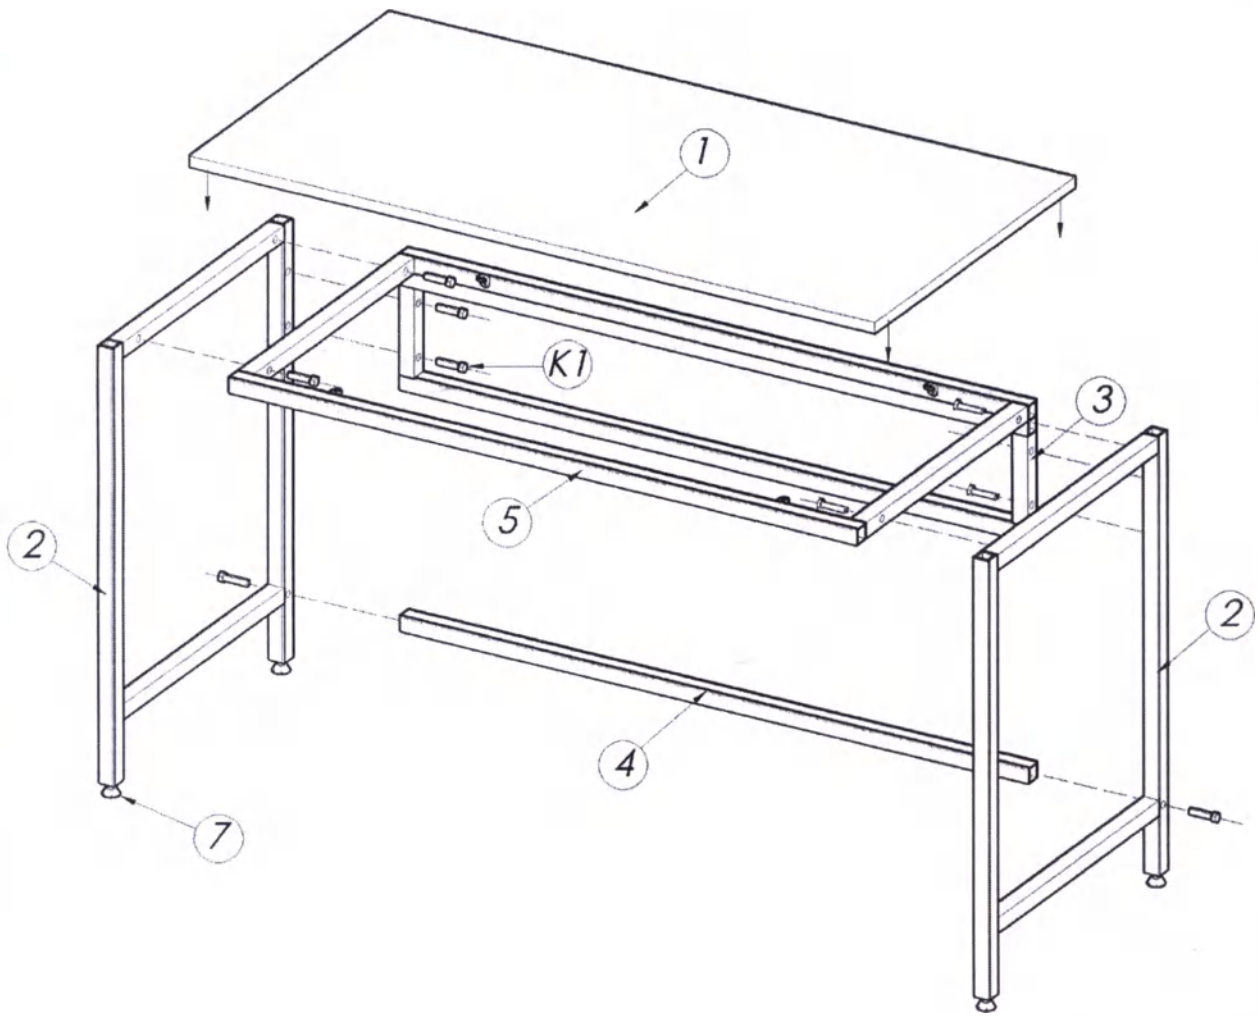

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм (K1)

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1 в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.**/

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/П

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/П** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	**1180*750*900**	**39,0±0,5**		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	12
К2	Саморез 4х16мм	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	39,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

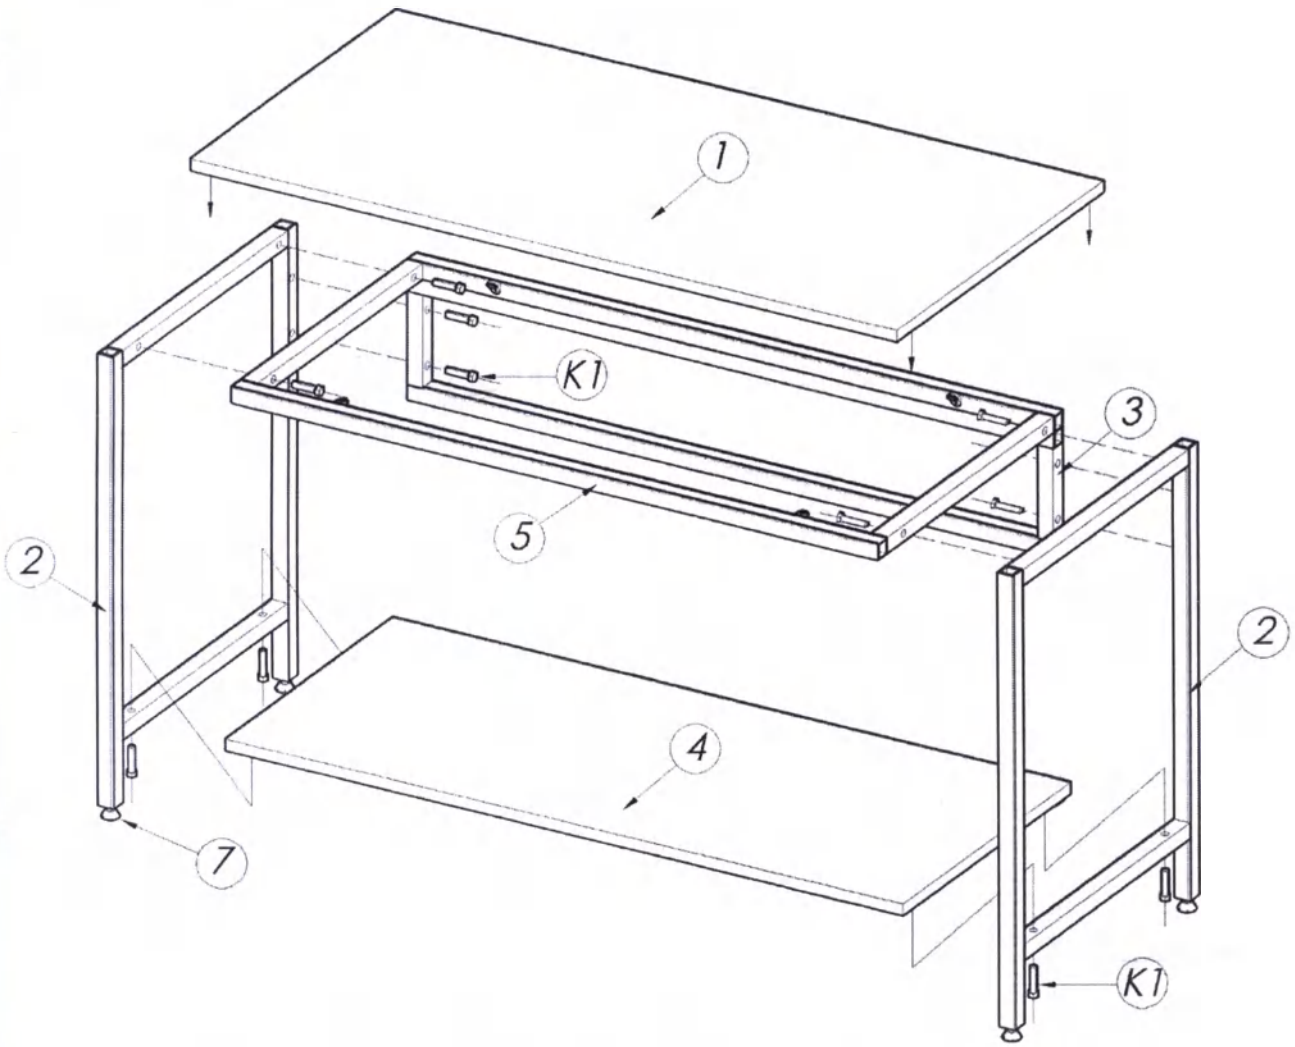

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм (K1)
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/П в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/П
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ЯП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ЯП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма медицинская	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
оликарбонатн		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка ля забора рови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка я таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	**1180*590*760**	**34,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с ящиком	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	34,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

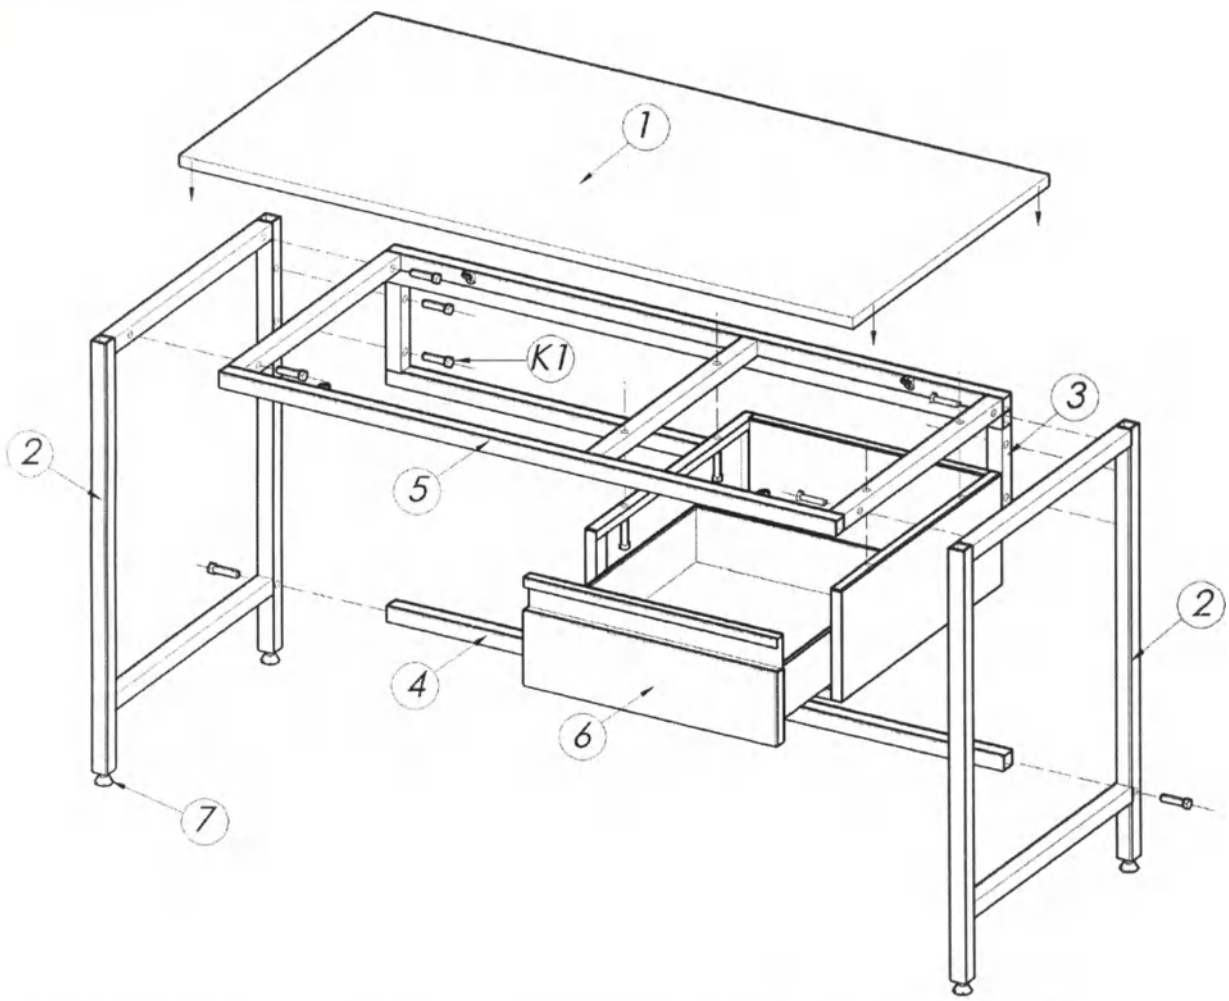

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3)
Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Вытащить ящик из тумбы.

6) Тумбу с ящиком (6) подвесить к раме (5) на винты.

7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ЯП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ЯП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________2021 г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПЯП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПЯП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	**1180*590*760**	**45,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с ящиком	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	45,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

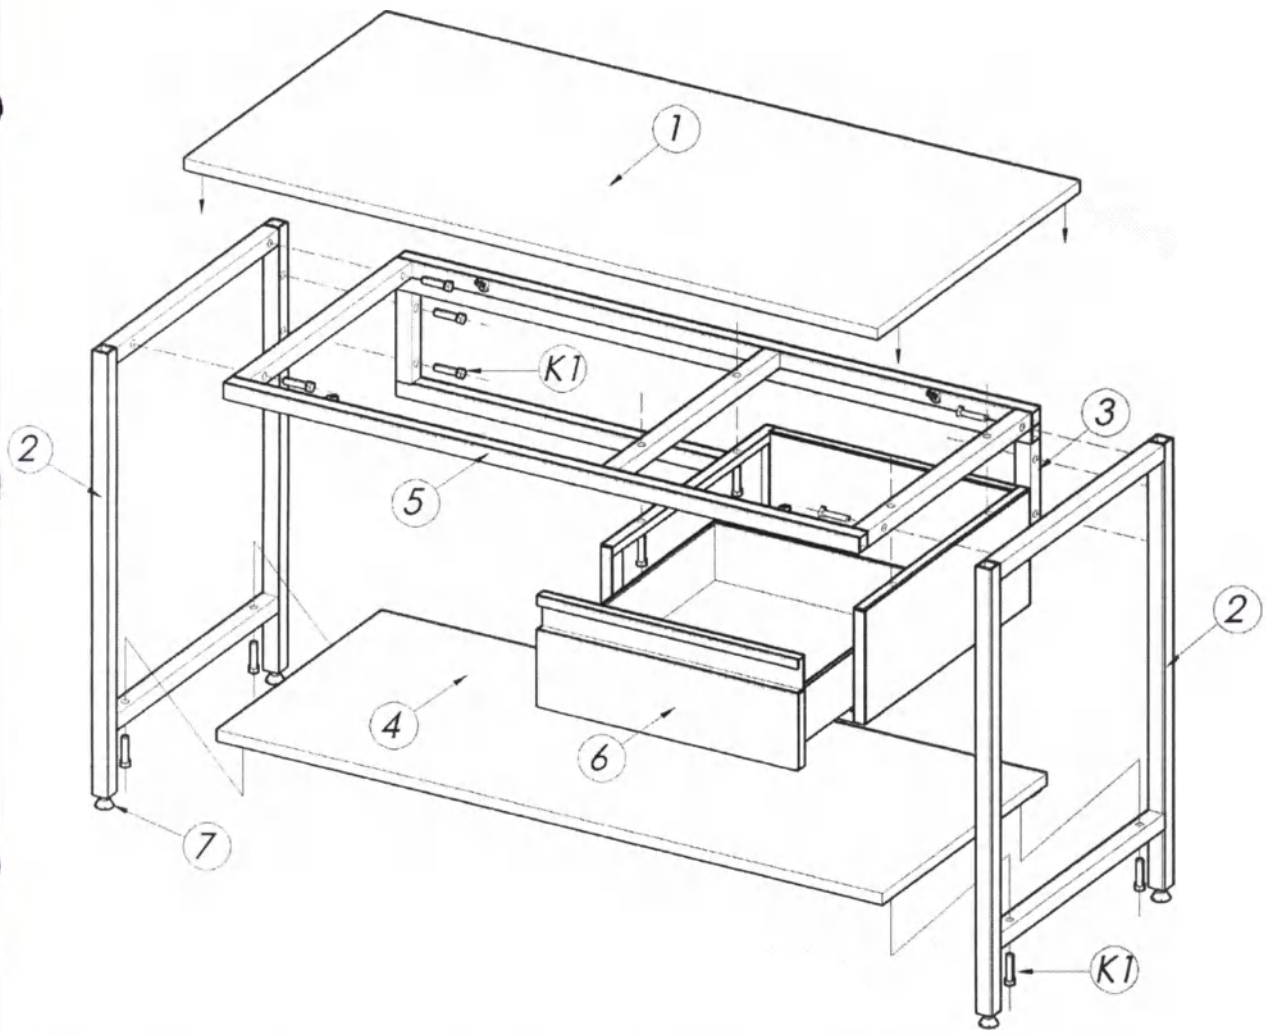

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) Вытащить ящик из тумбы.
6) Тумбу с ящиком (6) подвесить к раме (5) на винты.
7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПЯП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПЯП

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А./

«27» _____ 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ЯП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ЯП** (далее – ол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	**1180*750*760**	**41,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с ящиком	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Допустимая нагрузка на конструкцию (не более), кг	60
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	41,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

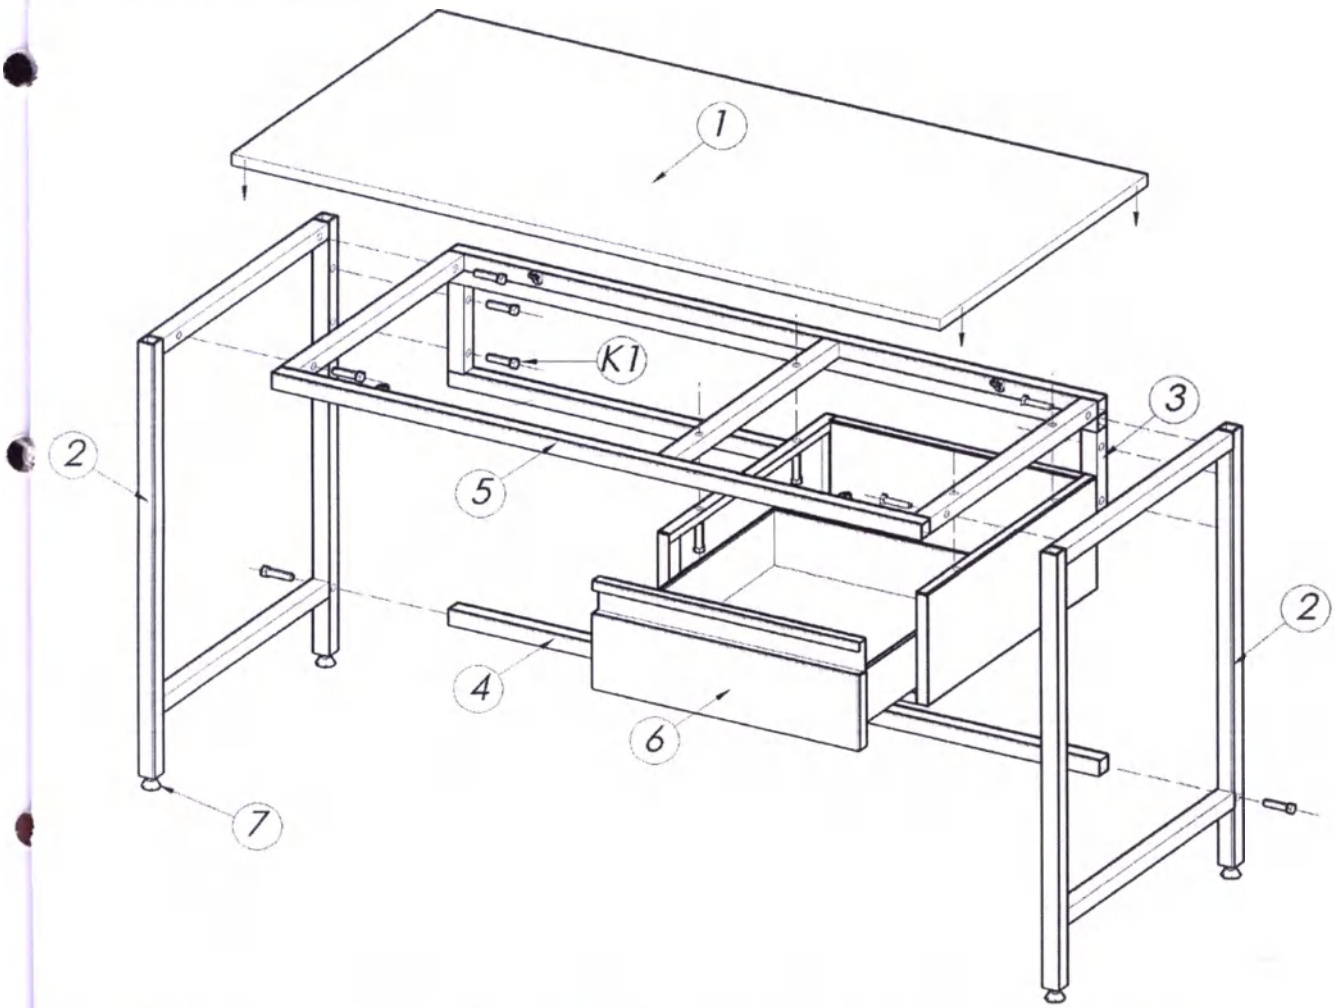

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) Вытащить ящик из тумбы.
6) Тумбу с ящиком (6) подвесить к раме (5) на винты.
7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ЯП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ЯП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПЯП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПЯП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка цедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720--1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	**1180*750*760**	**49,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с ящиком	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	49,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

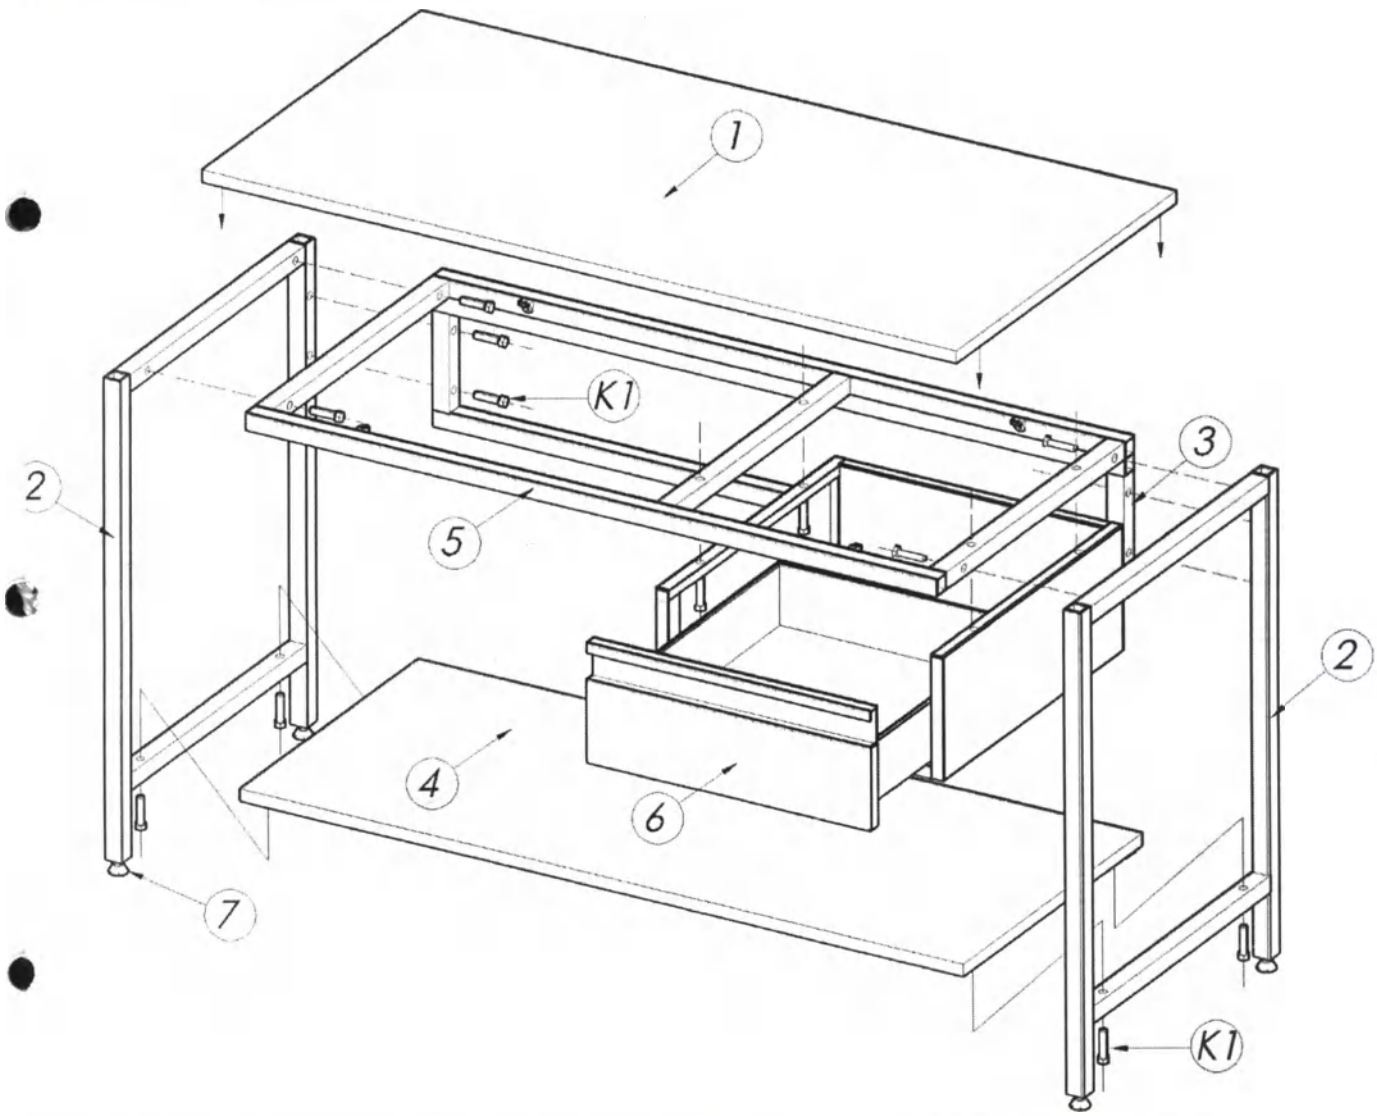

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) Вытащить ящик из тумбы.
6) Тумбу с ящиком (6) подвесить к раме (5) на винты.
7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПЯП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПЯП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность **Генеральный директор**
Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ЯП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ЯП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная		Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
1.2 Подставка для забора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
1.3 Кушетка процедурная детская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
1.4 Кушетка процедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
1.5 Кушетка процедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
1.6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	**1180*590*900**	**35,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с ящиком	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	35,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

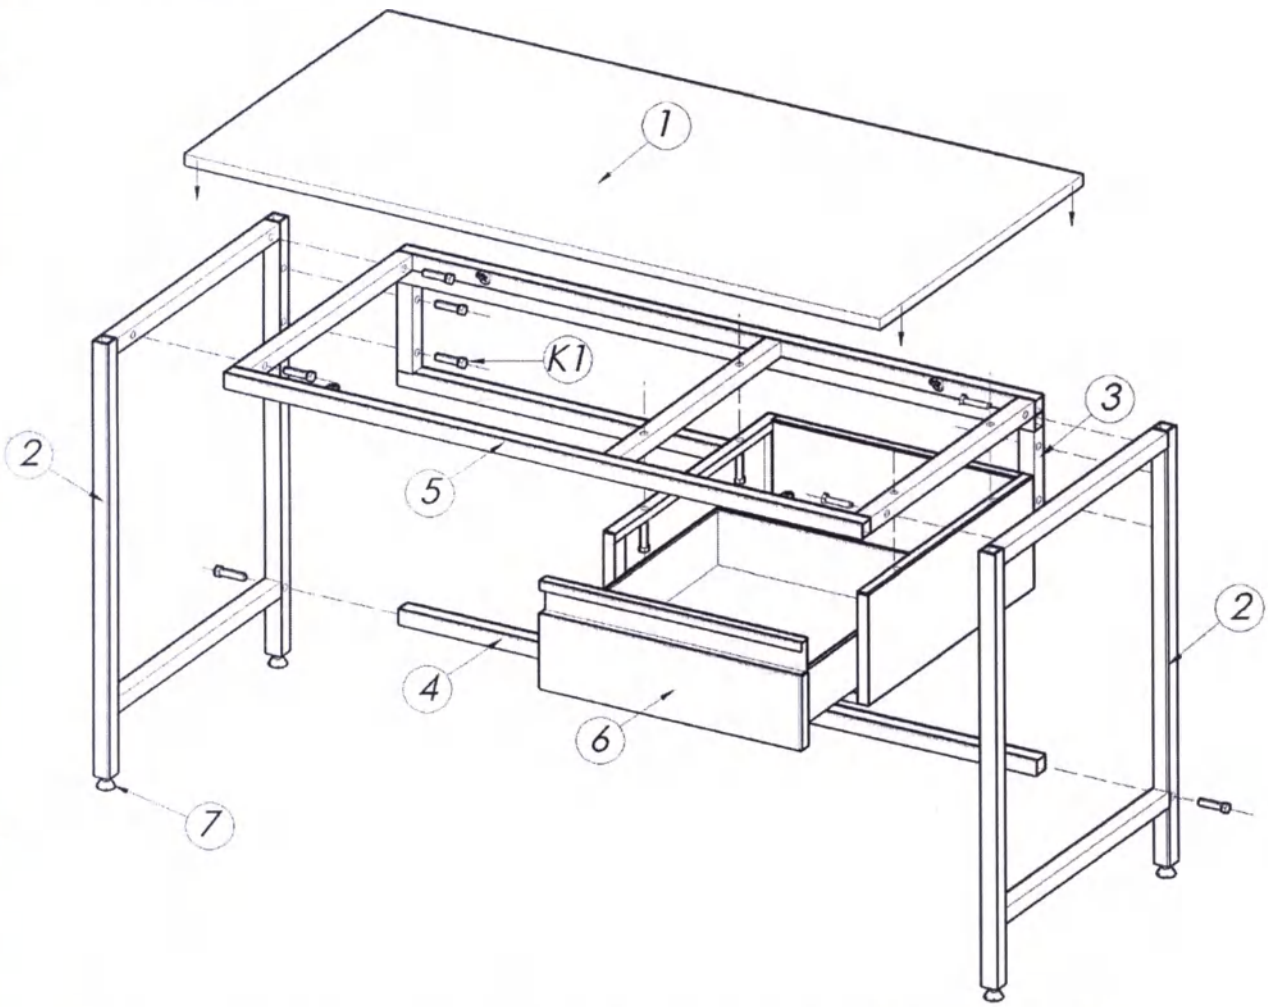

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Вытащить ящик из тумбы.

6) Тумбу с ящиком (6) подвесить к раме (5) на винты.

7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ЯП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ЯП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202_ г.

Дата________________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А.
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПЯП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПЯП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
1.2 Подставка для сбора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
1.3 Кушетка процедурная детская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
1.4 Кушетка процедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
1.5 Кушетка процедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
1.6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
.8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	**1180*590*900**	**42,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с ящиком	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	42,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

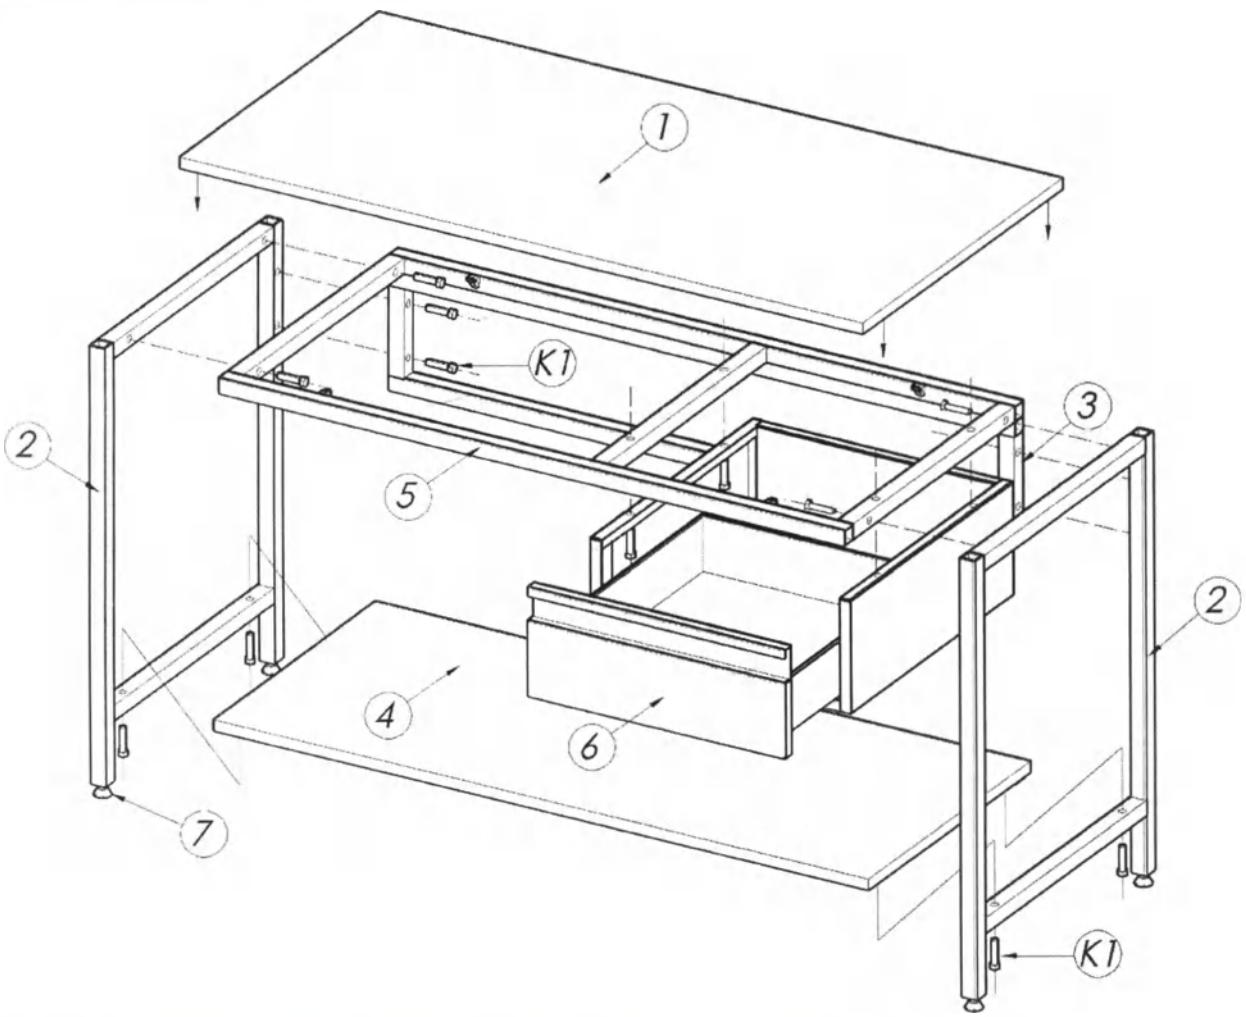

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Вытащить ящик из тумбы.

6) Тумбу с ящиком (6) подвесить к раме (5) на винты.

7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ɔдорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при ɜзинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие ɓразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу гходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации ɜзвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели иаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ɔмощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ɛциалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ɛрет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПЯП в количестве __________шт. принят в ɔответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической ɔкументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПЯП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ЯП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ЯП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка оцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для аза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол ередвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	**1180*750*900**	**42,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
) Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с ящиком	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
Масса нетто, кг	42,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

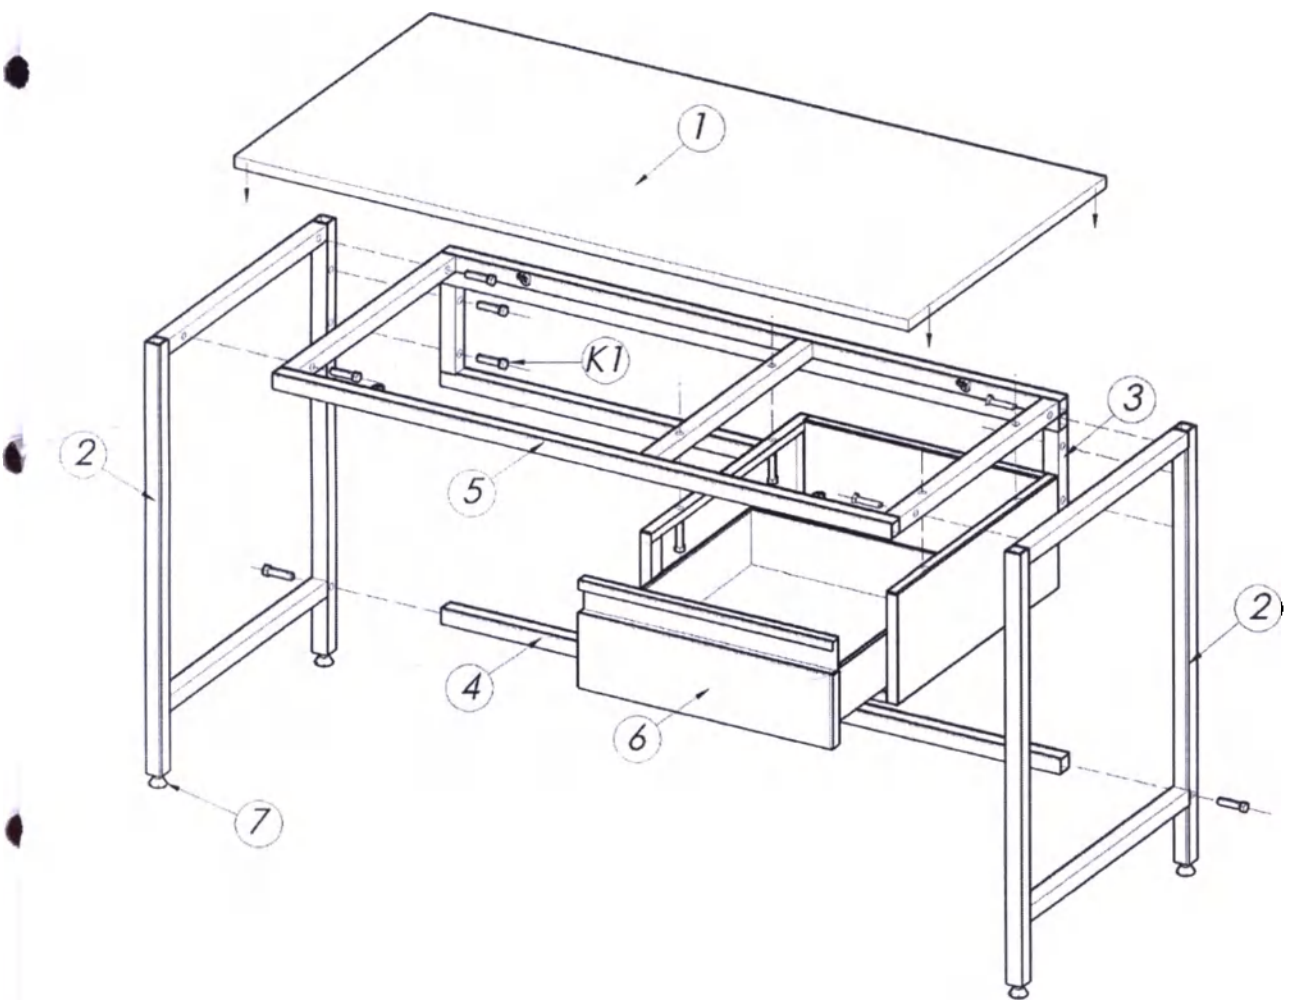

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Вытащить ящик из тумбы.

6) Тумбу с ящиком (6) подвесить к раме (5) на винты.

7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ЯП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ________________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ЯП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20-- г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.**

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПЯП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПЯП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720–1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
8 Стол едицинский нструментальный	**Э-1180/750/1/ПЯП**	**1180*750*900**	**50,0±0,5**	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с ящиком	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	50,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

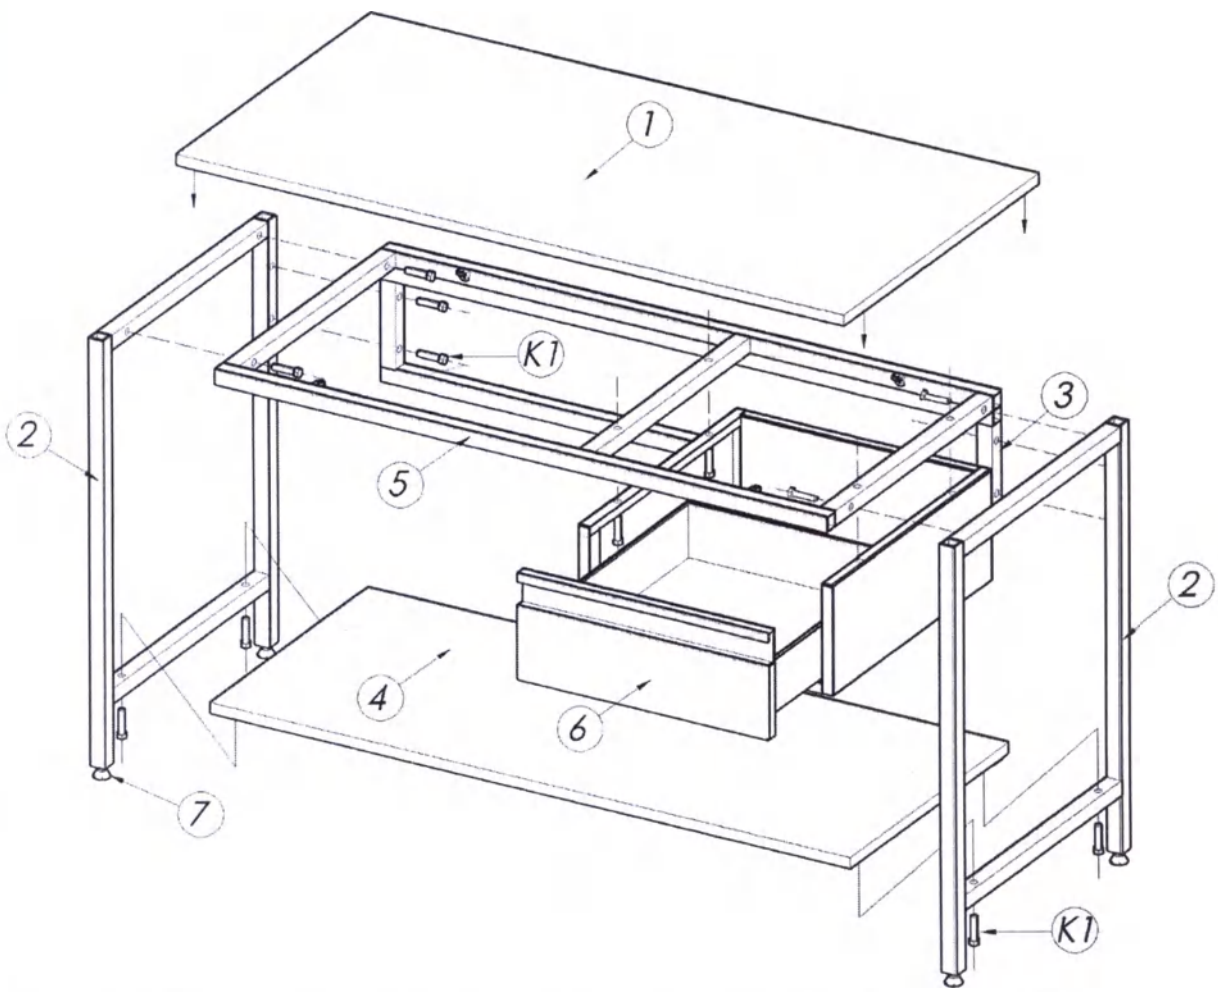

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3)
Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) Вытащить ящик из тумбы.
6) Тумбу с ящиком (6) подвесить к раме (5) на винты.
7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПЯП в количестве ___________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПЯП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ЯП2

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ЯП2** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
1.2 Подставка для забора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
1.3 Кушетка процедурная детская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
1.4 Кушетка процедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
1.5 Кушетка процедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
1.6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	**1180*590*760**	**39,0±0,5**		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с 2мя ящиками	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Допустимая нагрузка на конструкцию (не более), кг	60
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
Масса нетто, кг	39,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

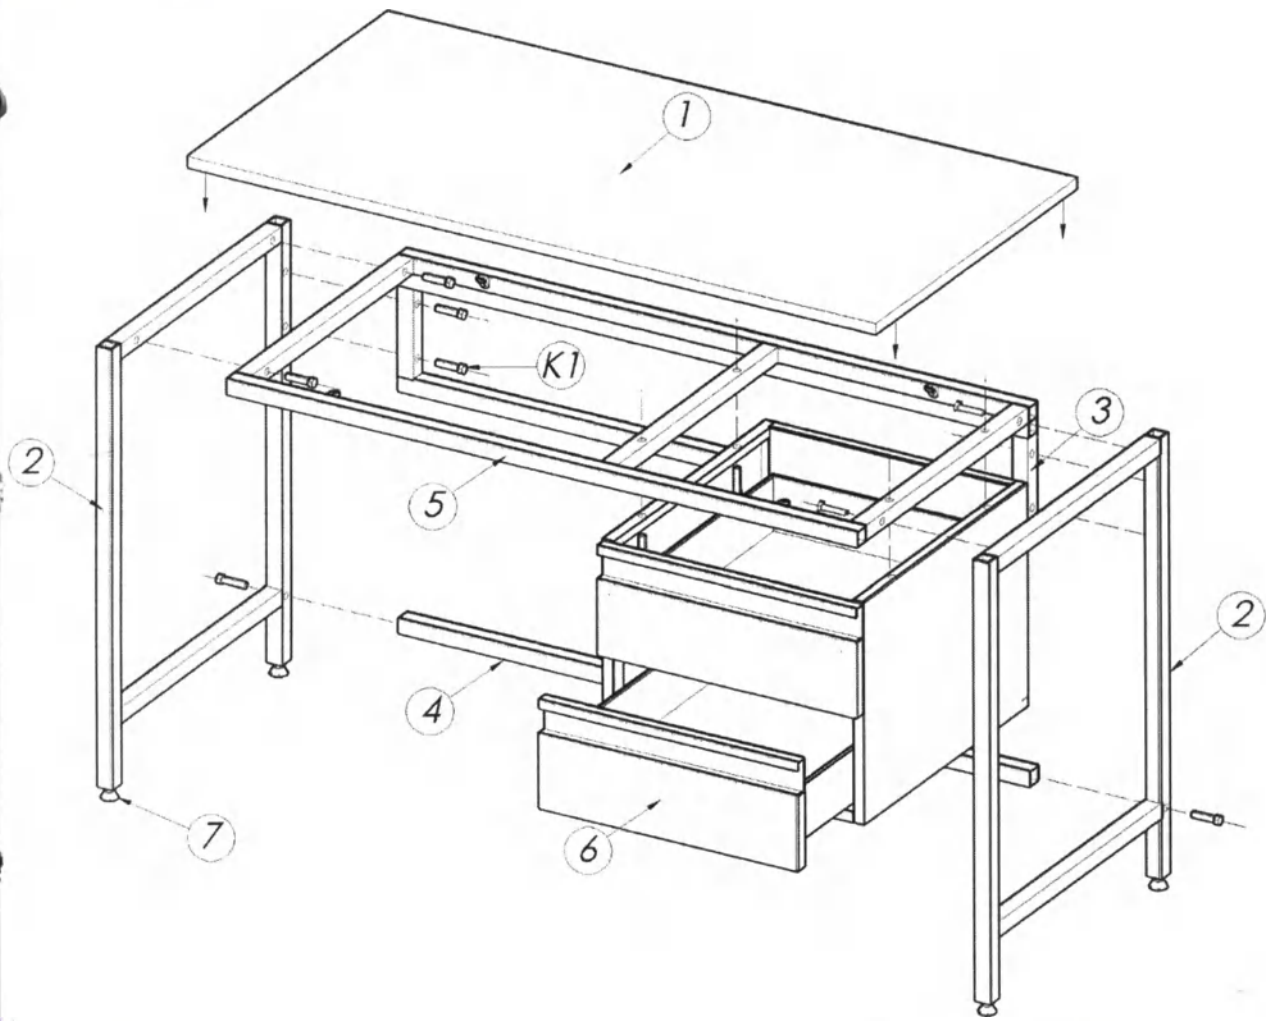

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на опорах винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Вытащить ящики из тумбы.

6) Тумбу с ящиками (6) подвесить к раме (5) на винты.

7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ЯП2 в количестве _____шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

5. ГАРАНТИЙНЫЙ АЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ЯП2
Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____202__ г.

Дата_____
Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Эгомедика»
Эгомедика
НОВОСИБИРСК

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПЯП2

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПЯП2** (далее – ол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
.8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	**1180*590*760**	**45,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с 2мя ящиками	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	45,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия окупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении равил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

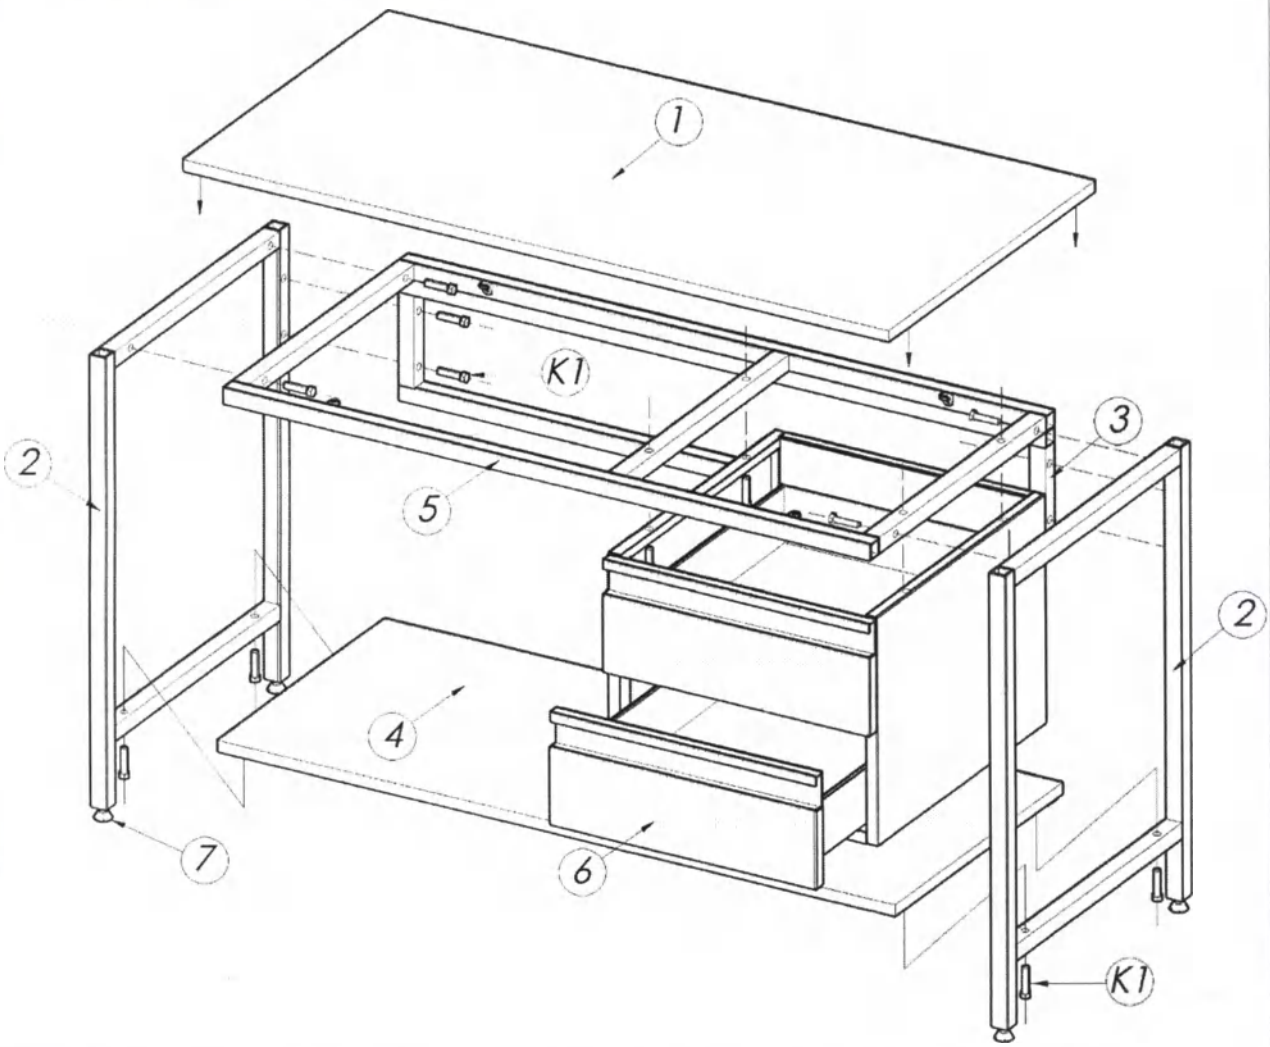

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Вытащить ящики из тумбы.

6) Тумбу с ящиками (6) подвесить к раме (5) на винты.

7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПЯП2 в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПЯП2

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата_______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ЯП2

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ЯП2** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного ководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для аза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-260-СХ	620*510*(860- - 1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
Стол дицинский струментальный	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	**1180*750*760**	**48,0±0,5**		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с 2мя ящиками	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
спользуемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
оминальное отклонение габаритных размеров, не олее, мм	4
лиматический класс	УХЛ 4.2
емпература окружающей среды при эксплуатации,	5 - 30
асса нетто, кг	48,0±0,5
азначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой бходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

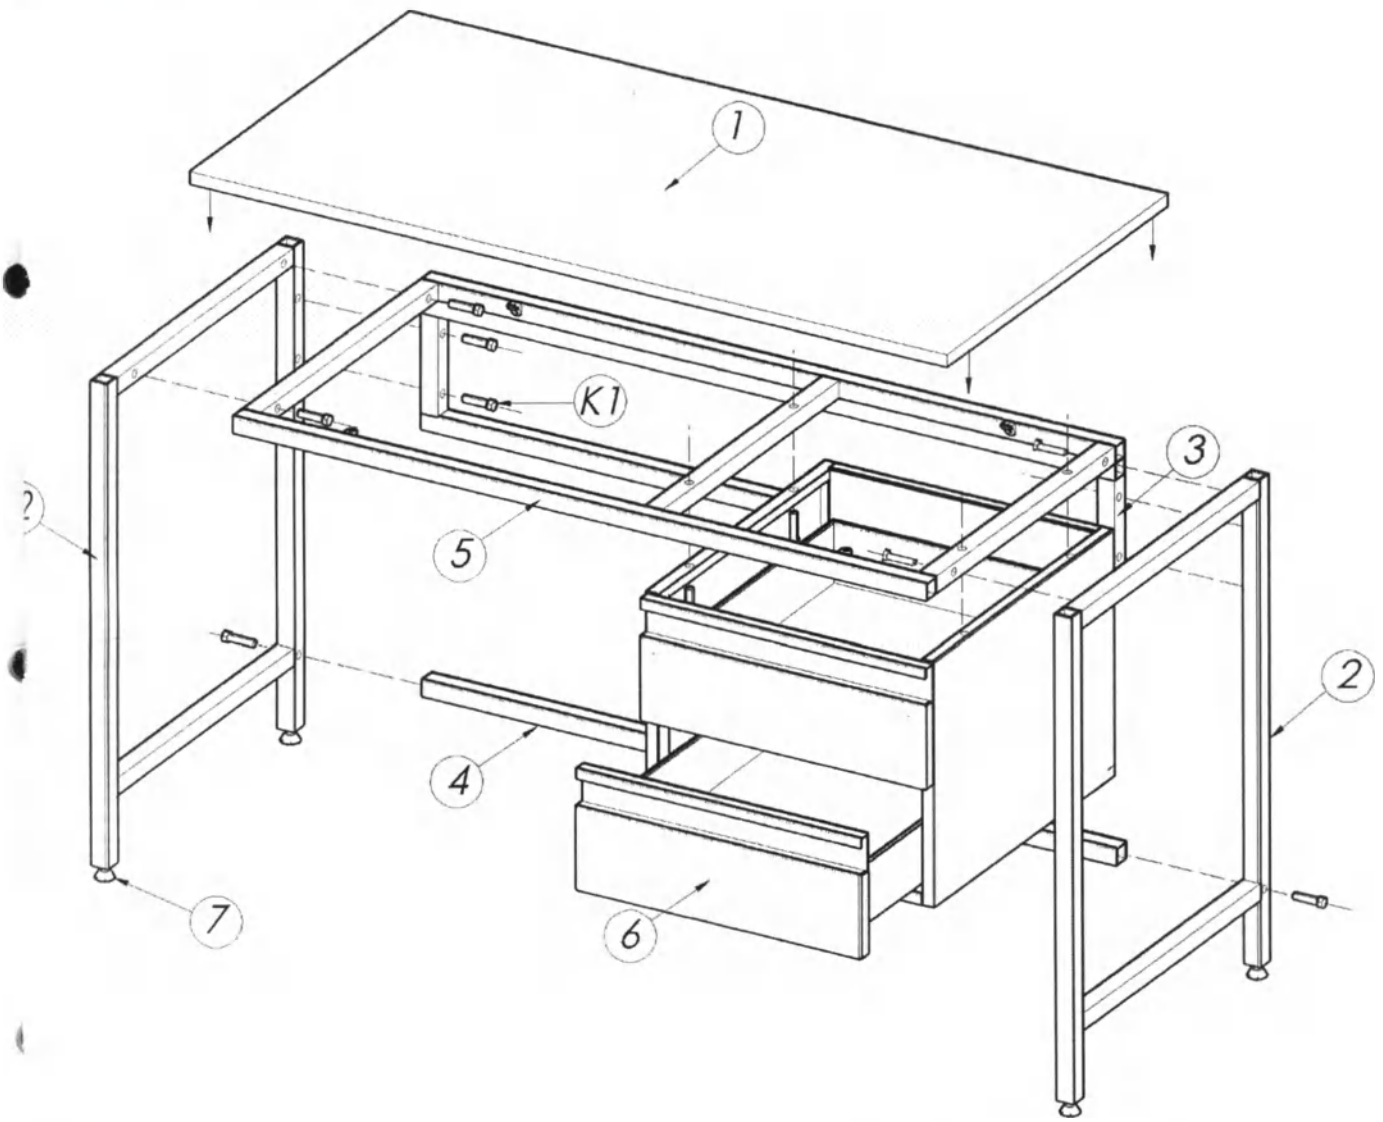

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Вытащить ящики из тумбы.

6) Тумбу с ящиками (6) подвесить к раме (5) на винты.

7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси)дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при :зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу :ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ш изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих 7, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических циалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ЯП2 в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ЯП2

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПЯП2

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПЯП2** (далее – ол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного ководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка оцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол ередвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	**1180*750*760**	**56,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с 2мя ящиками	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
спользуемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
оминальное отклонение габаритных размеров, не олее, мм	4
лиматический класс	УХЛ 4.2
емпература окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
асса нетто, кг	56,0±0,5
азначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

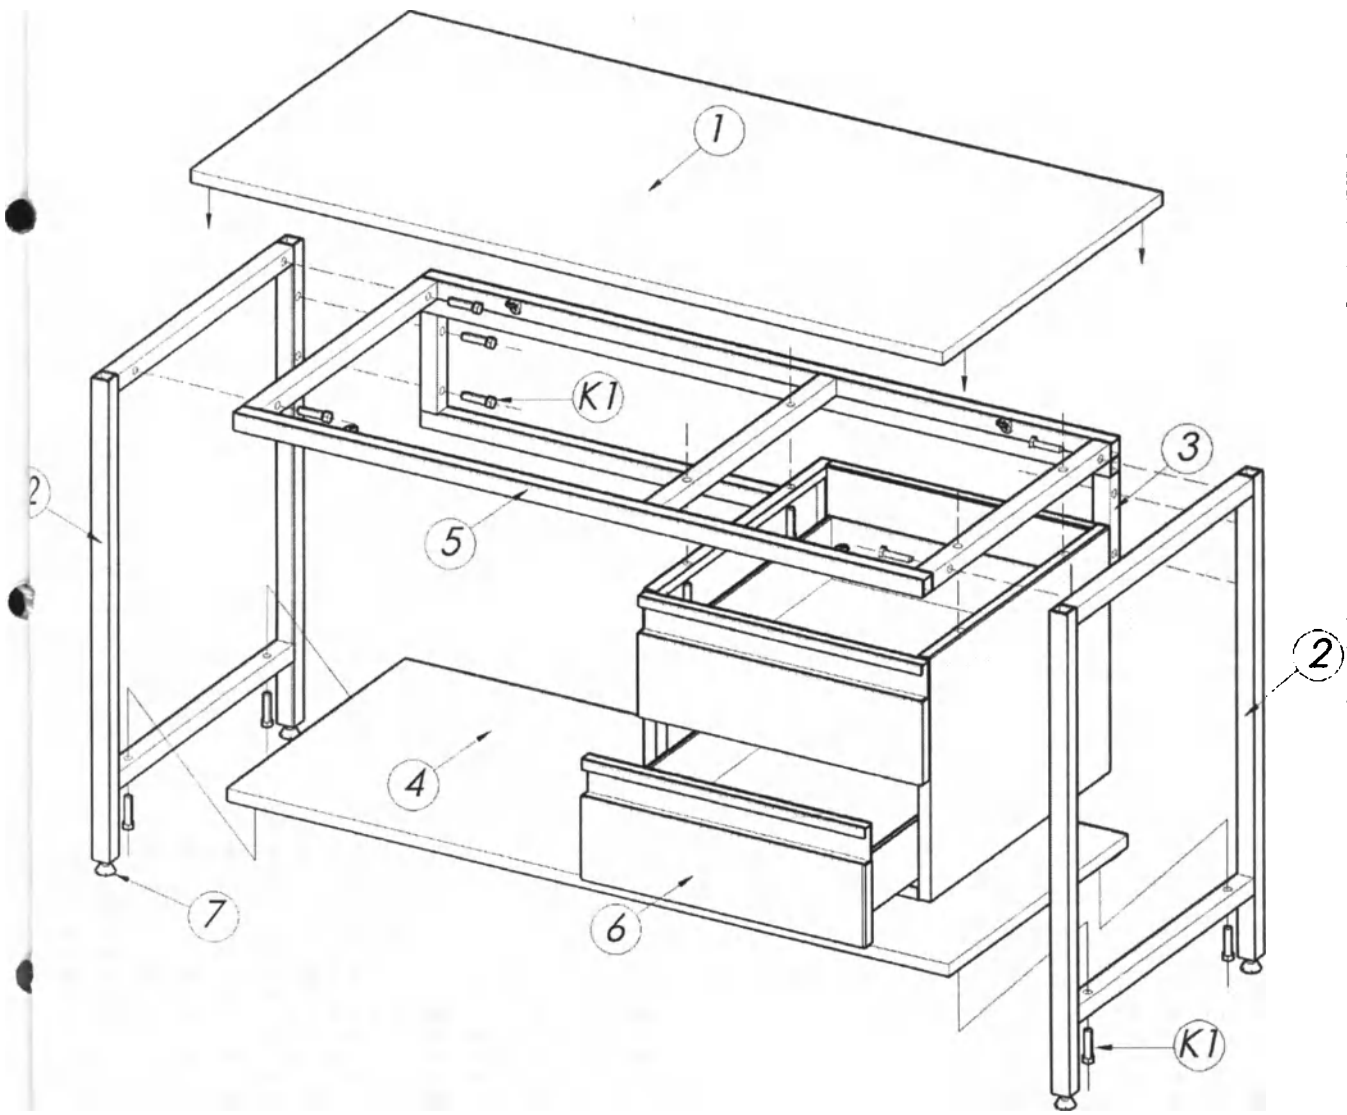

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) Вытащить ящики из тумбы.
6) Тумбу с ящиками (6) подвесить к раме (5) на винты.
7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу кодов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПЯП2 в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПЯП2
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата_______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ЯП2

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ЯП2** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
1.2 Подставка для забора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
1.3 Кушетка процедурная детская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
1.4 Кушетка процедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
1.5 Кушетка процедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
1.6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	**1180*590*900**	**46,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с 2мя ящиками	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	46,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

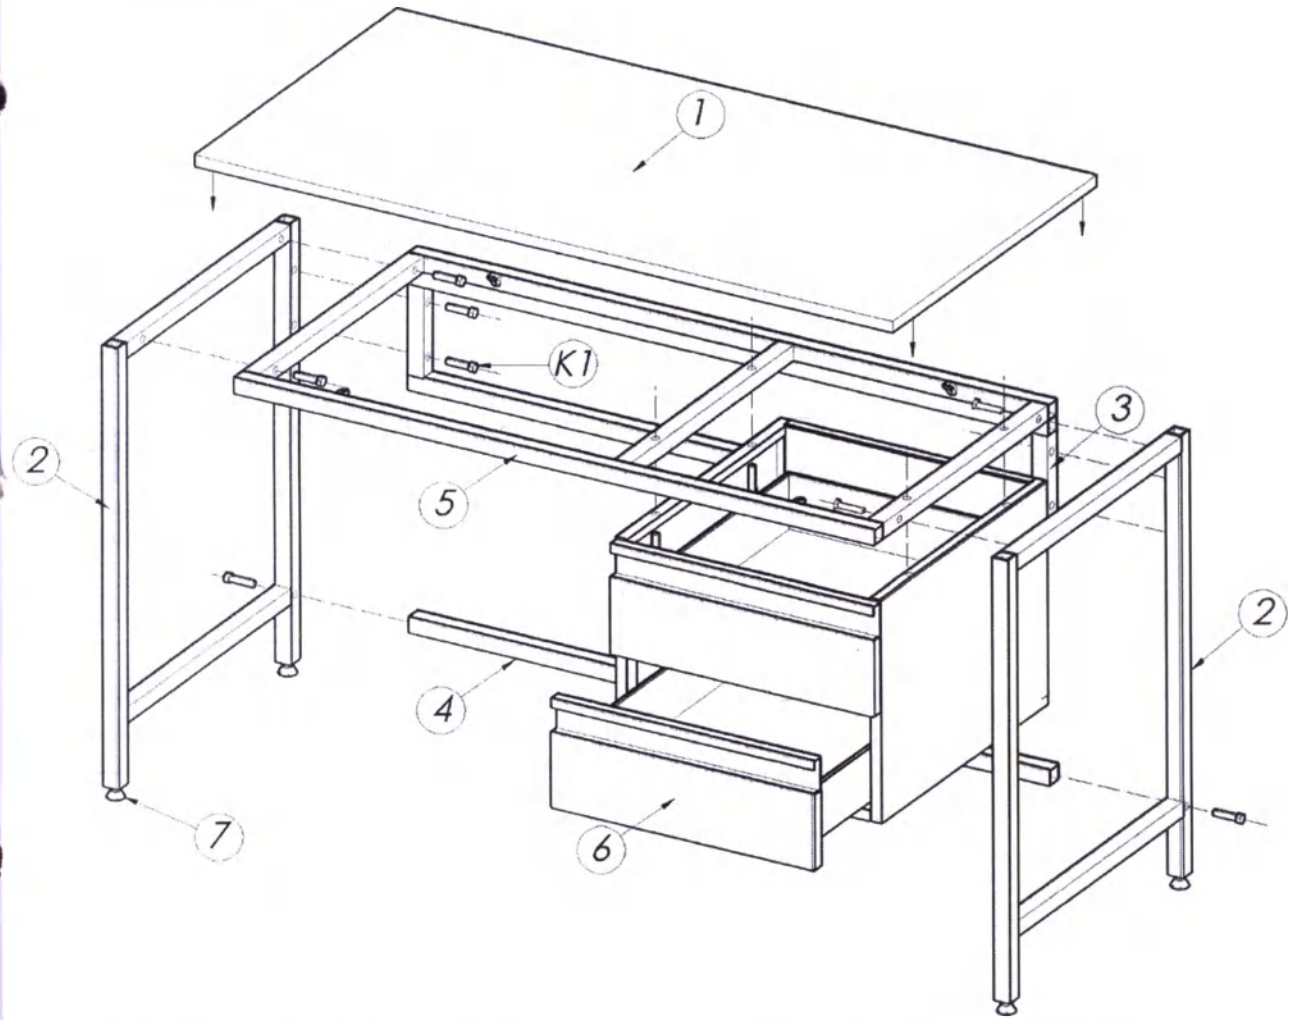

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3)
Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) Вытащить ящики из тумбы.
6) Тумбу с ящиками (6) подвесить к раме (5) на винты.
7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ЯП2 в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ЯП2
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата______________ Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПЯП2

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПЯП2** (далее тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 50.30-001-42494039-2020.**
1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.
1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского орудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования оцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
Ширма дицинская ликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка оцедурная тская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для аза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720--1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	**1180*590*900**	**46,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ГП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
) Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с 2мя ящиками	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	46,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять ого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

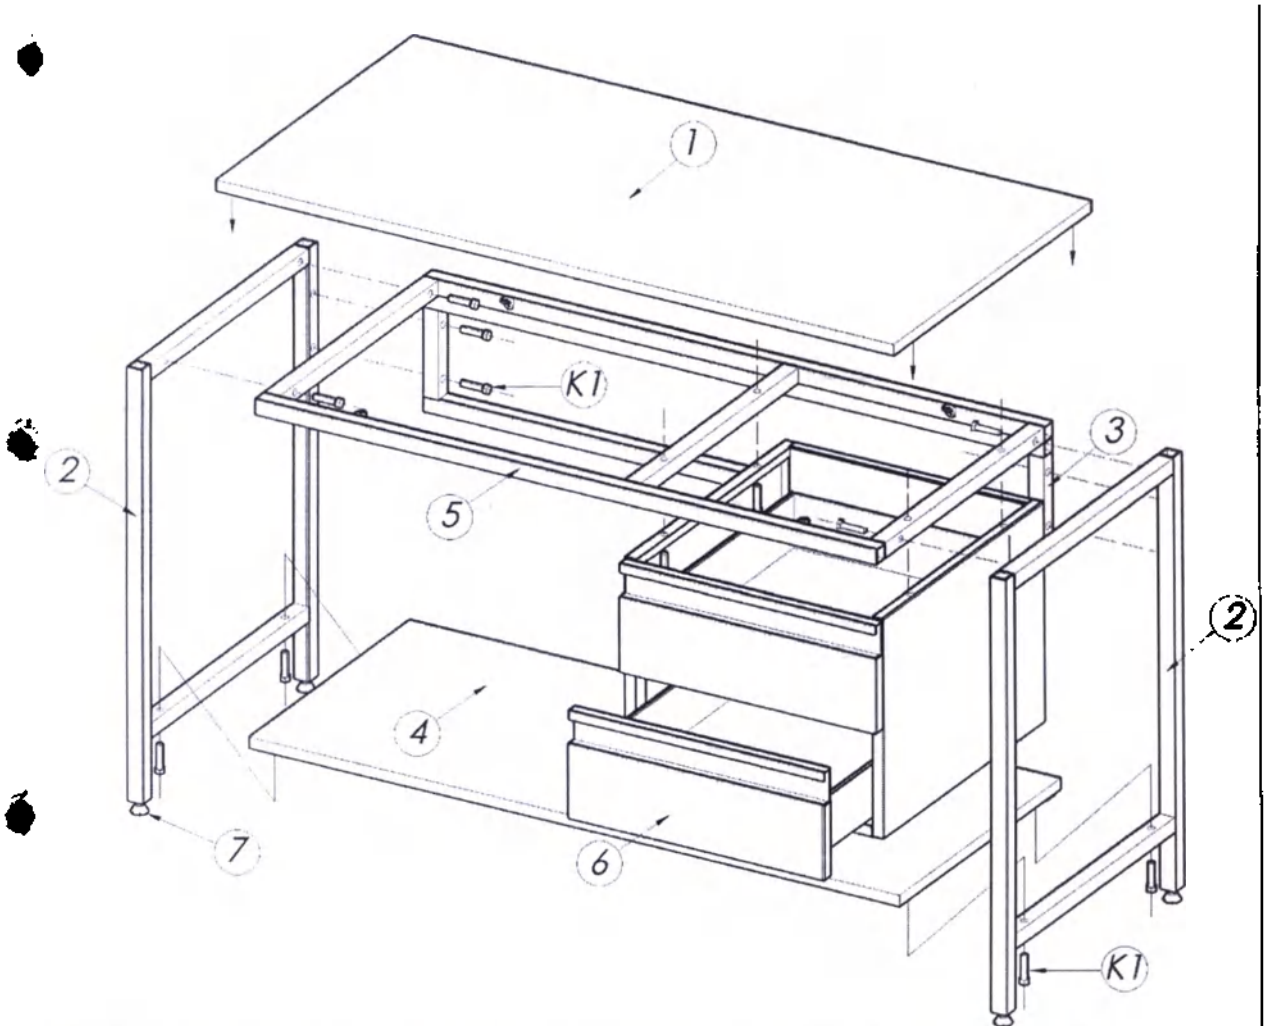

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.

2) Раму: (5) и полку: (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Вытащить ящики из тумбы.

6) Тумбу с ящиками (6) подвесить к раме (5) на винты.

7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ıорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при ıинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие ɔазивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации ɜвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПЯП2 в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПЯП2

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата_______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ Дрокин Э. А. /

«27» _____ 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ЯП2

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ЯП2** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка оцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для аза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720–1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	**1180*750*900**	**49,0±0,5**		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с 2мя ящиками	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Допустимая нагрузка на конструкцию (не более), кг	60
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	49,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

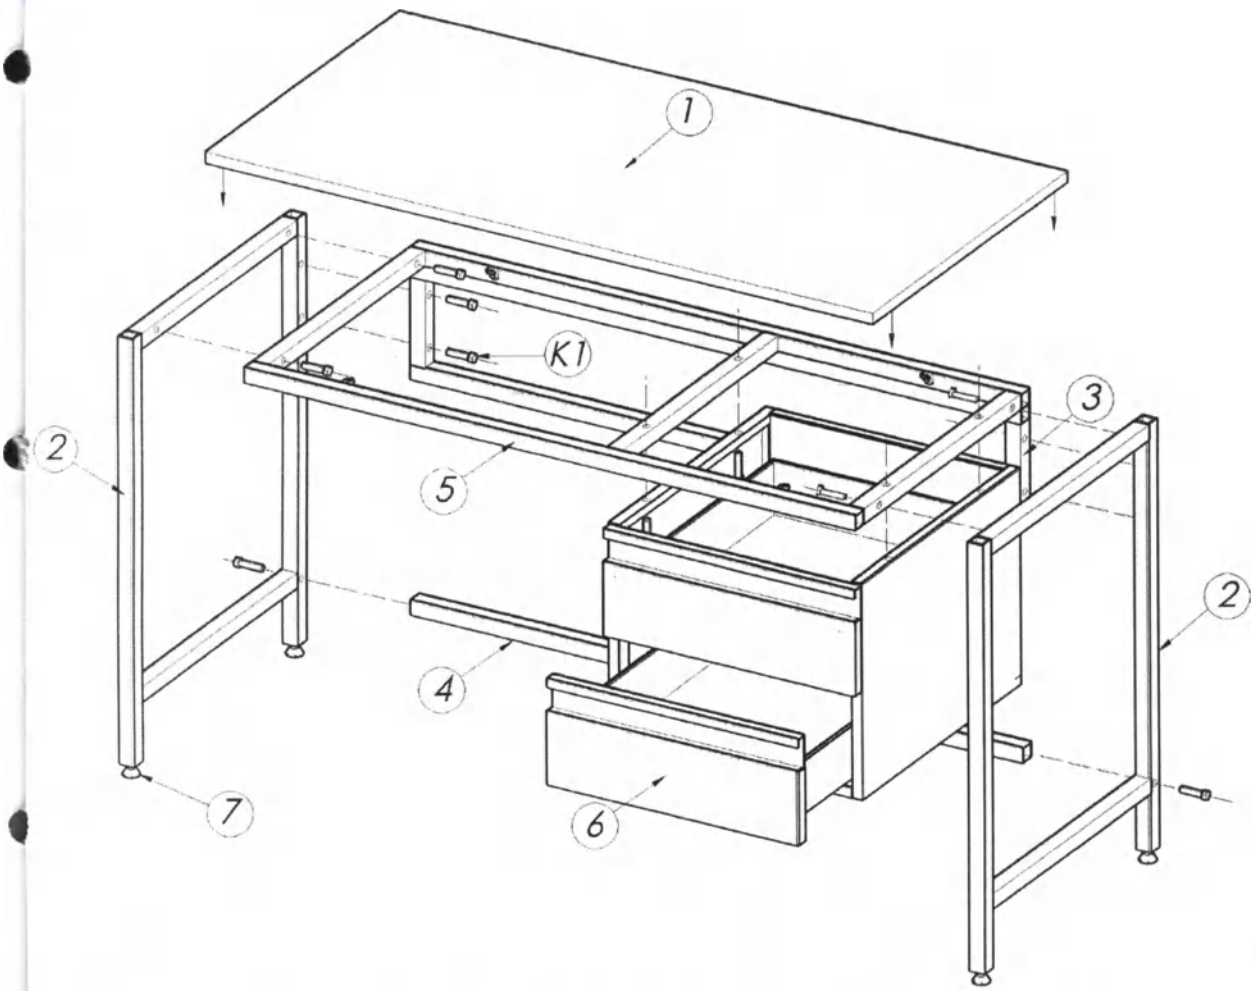

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Вытащить ящики из тумбы.

6) Тумбу с ящиками (6) подвесить к раме (5) на винты.

7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ıорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при ıинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ıодов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ЯП2 в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ЯП2
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э.А.** /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПЯП2

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПЯП2** (далее стол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма медицинская	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
оликарбонатн		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка ля забора рови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка я таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
17 Стол ередвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментал ный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	**1180*750*900**	**57,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
10 Стол ленальный	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с 2мя ящиками	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	57,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных оверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия окупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

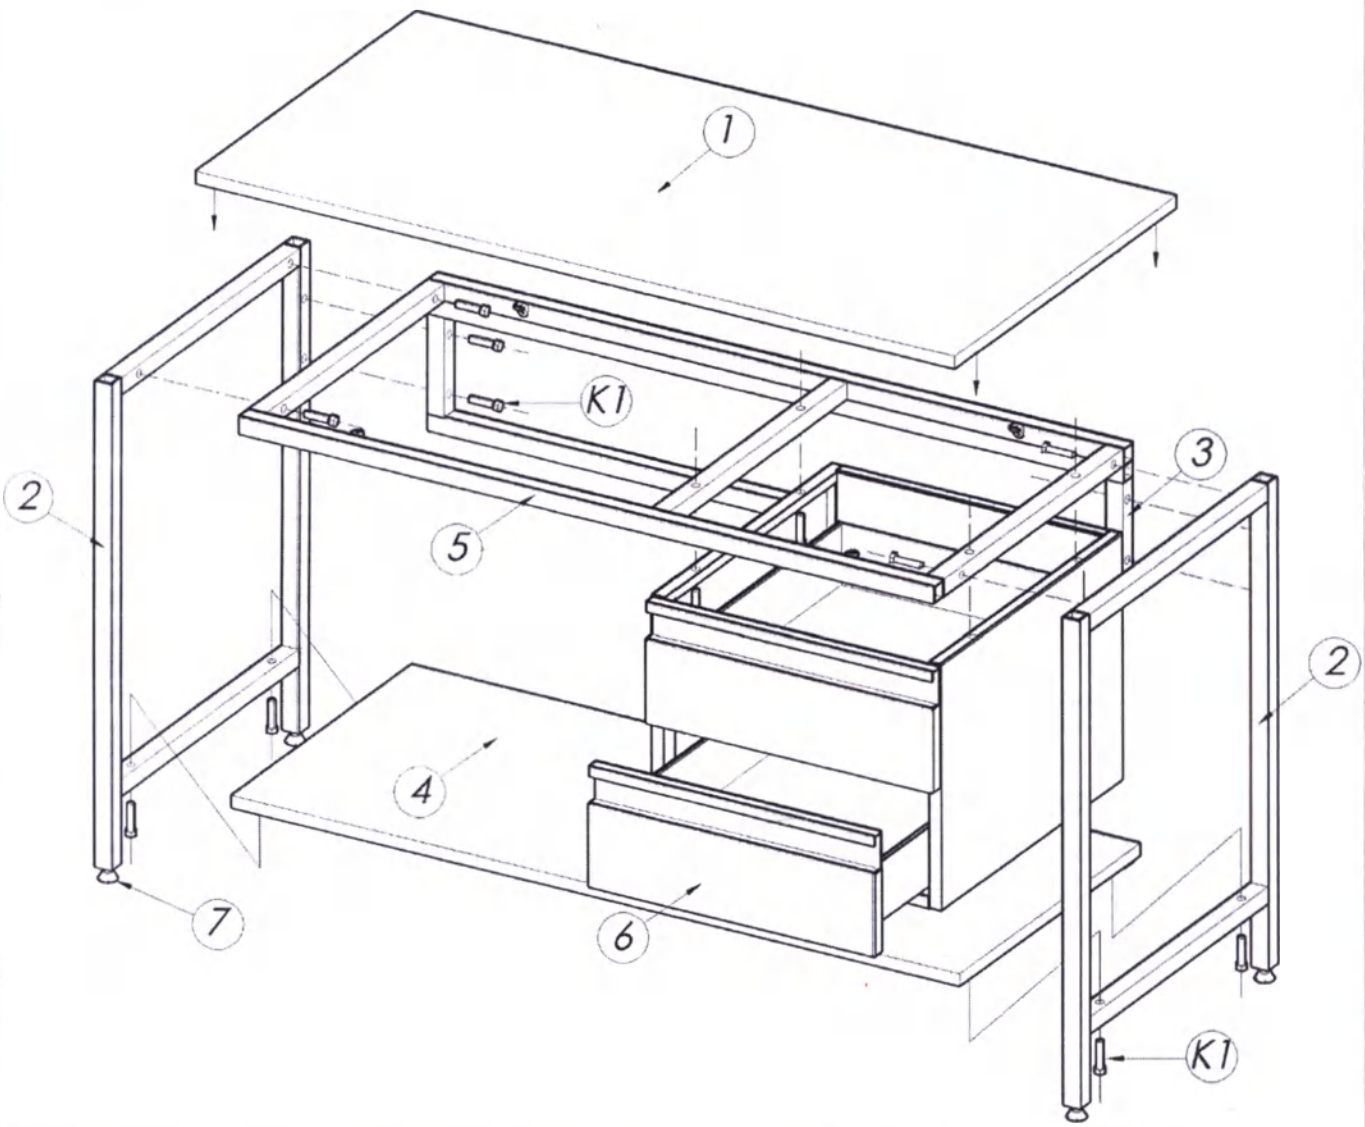

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.
2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм
3) Окончательно затянуть все винты.
4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)
5) Вытащить ящики из тумбы.
6) Тумбу с ящиками (6) подвесить к раме (5) на винты.
7) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПЯП2 в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПЯП2
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э.А./
«27» ноября 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ТП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ТП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
1.2 Подставка для забора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
1.3 Кушетка процедурная детская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
1.4 Кушетка процедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
1.5 Кушетка процедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
1.6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	**1180*590*760**	**37,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
.9 Кушетка тационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
.10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с дверцей	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	37,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

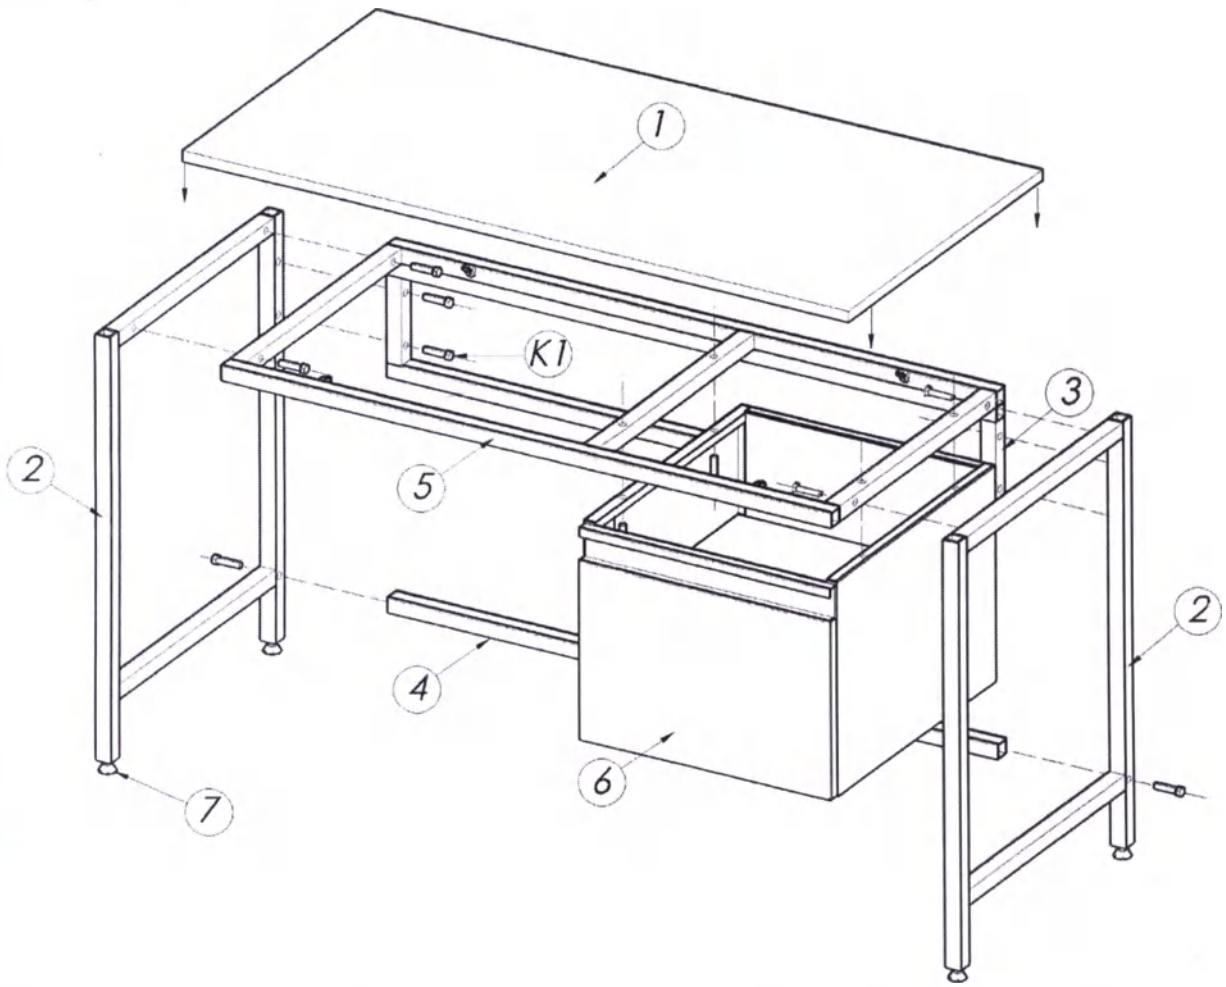

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Тумбу с дверцей (6) подвесить к раме (5) на винты.

6) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси
дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при
зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие
разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу
ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке
и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих
, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации
звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо
зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели
ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической
омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических
ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец
рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ТП в количестве __________шт. принят в
ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической
окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ТП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э.А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПТП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПТП** (далее – ол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка оцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для аза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	**1180*590*760**	**43,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с дверцей	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	43,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

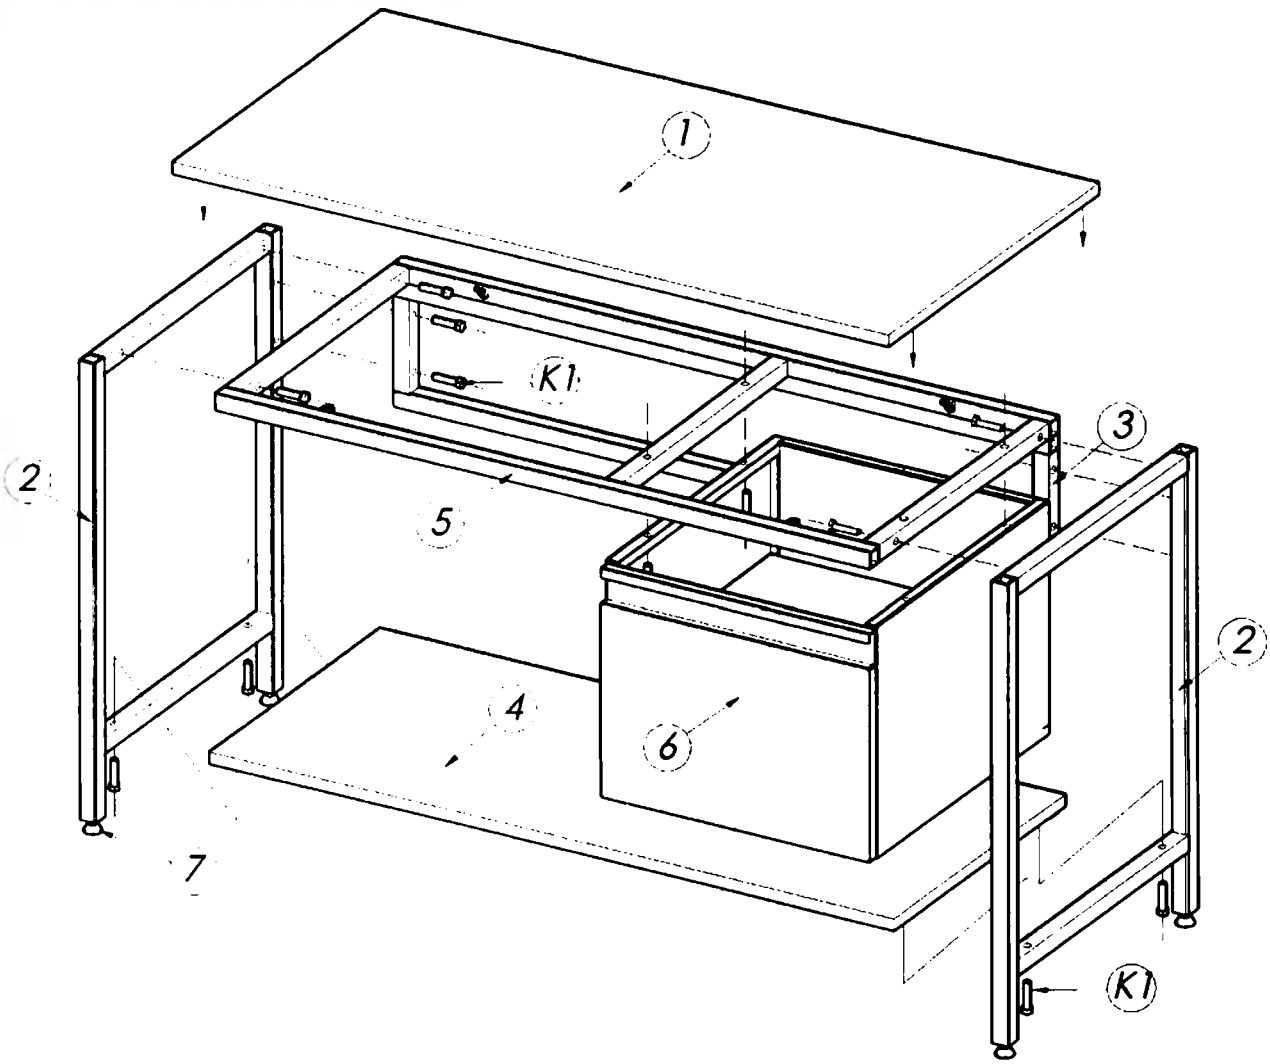

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Тумбу с дверцей (6) подвесить к раме (5) на винты.

6) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПТП в количестве _____шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/ПТП

Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____202__ г.

Дата_____ Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А.
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ТП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ТП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного ководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка цедурная тская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	**1180*750*760**	**44,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с дверцей	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
спользуемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
оминальное отклонение габаритных размеров, не олее, мм	4
лиматический класс	УХЛ 4.2
емпература окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
асса нетто, кг	44,0±0,5
азначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

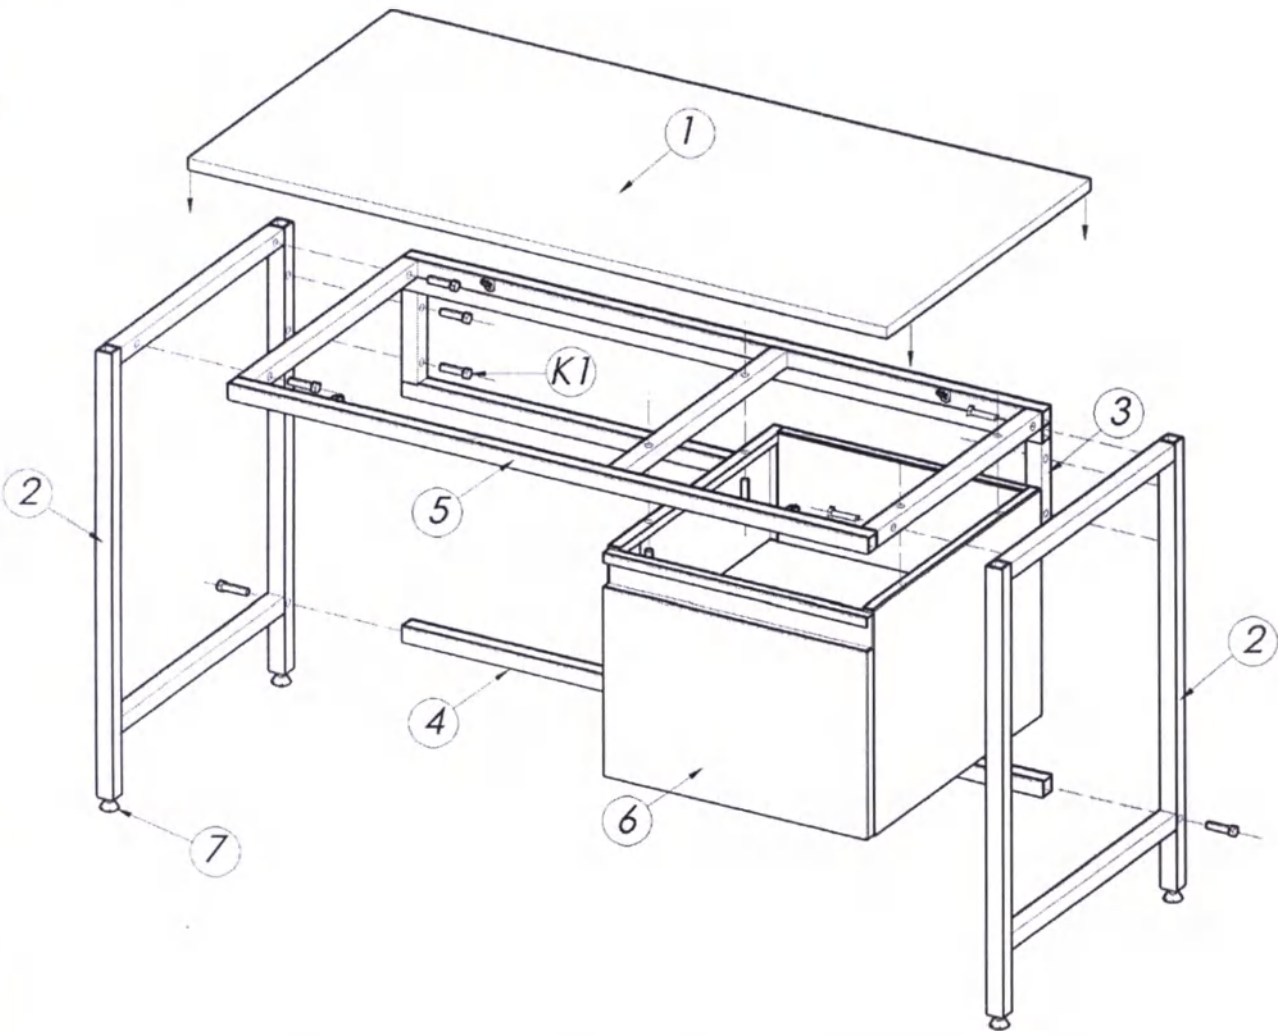

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Тумбу с дверцей (6) подвесить к раме (5) на винты.

6) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ТП в количестве _____шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ТП

Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____202__ г.

Дата_____
Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дроздин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПТП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПТП** (далее – ол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма дицинская ликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка цедурная тская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-.1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
.8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	**1180*750*760**	**52,0±0,5**		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с дверцей	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	52,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

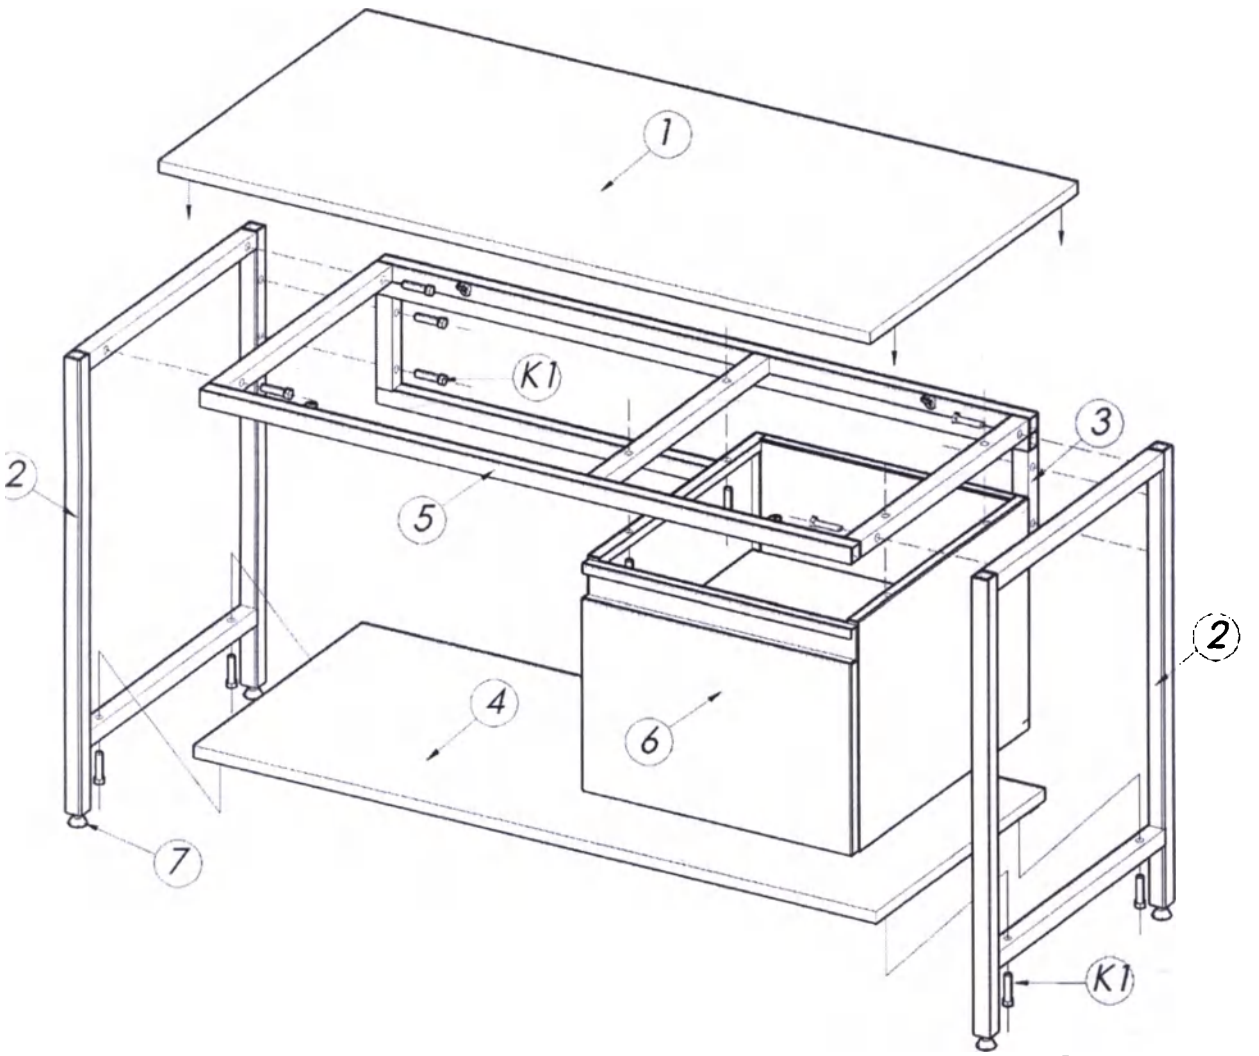

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Тумбу с дверцей (6) подвесить к раме (5) на винты.

6) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПТП в количестве _____шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/ПТП

Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____202___ г.

Дата_____
Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность **Генеральный директор**
Подпись _____ / **Дрокин Э.А.** /
«27» августа 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ТП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ТП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол ередвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720--1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	**1180*590*900**	**38,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с дверцей	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	38,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

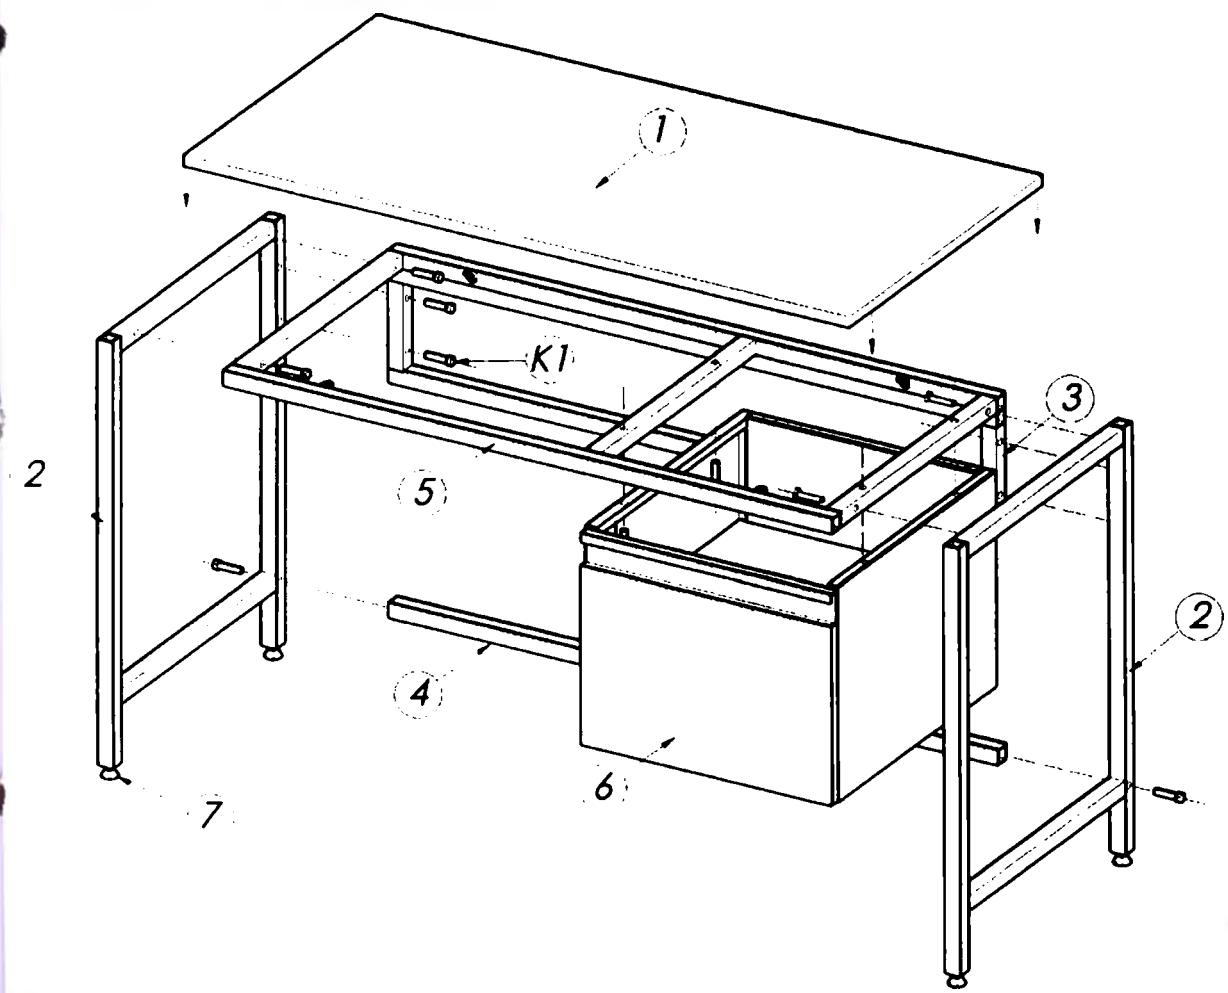

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Тумбу с дверцей (6) подвесить к раме (5) на винты.

6) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ТП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ТП

Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э.А.** /

«27» ноября 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПТП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПТП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	**1180*590*900**	**44,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
) Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с дверцей	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	44,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

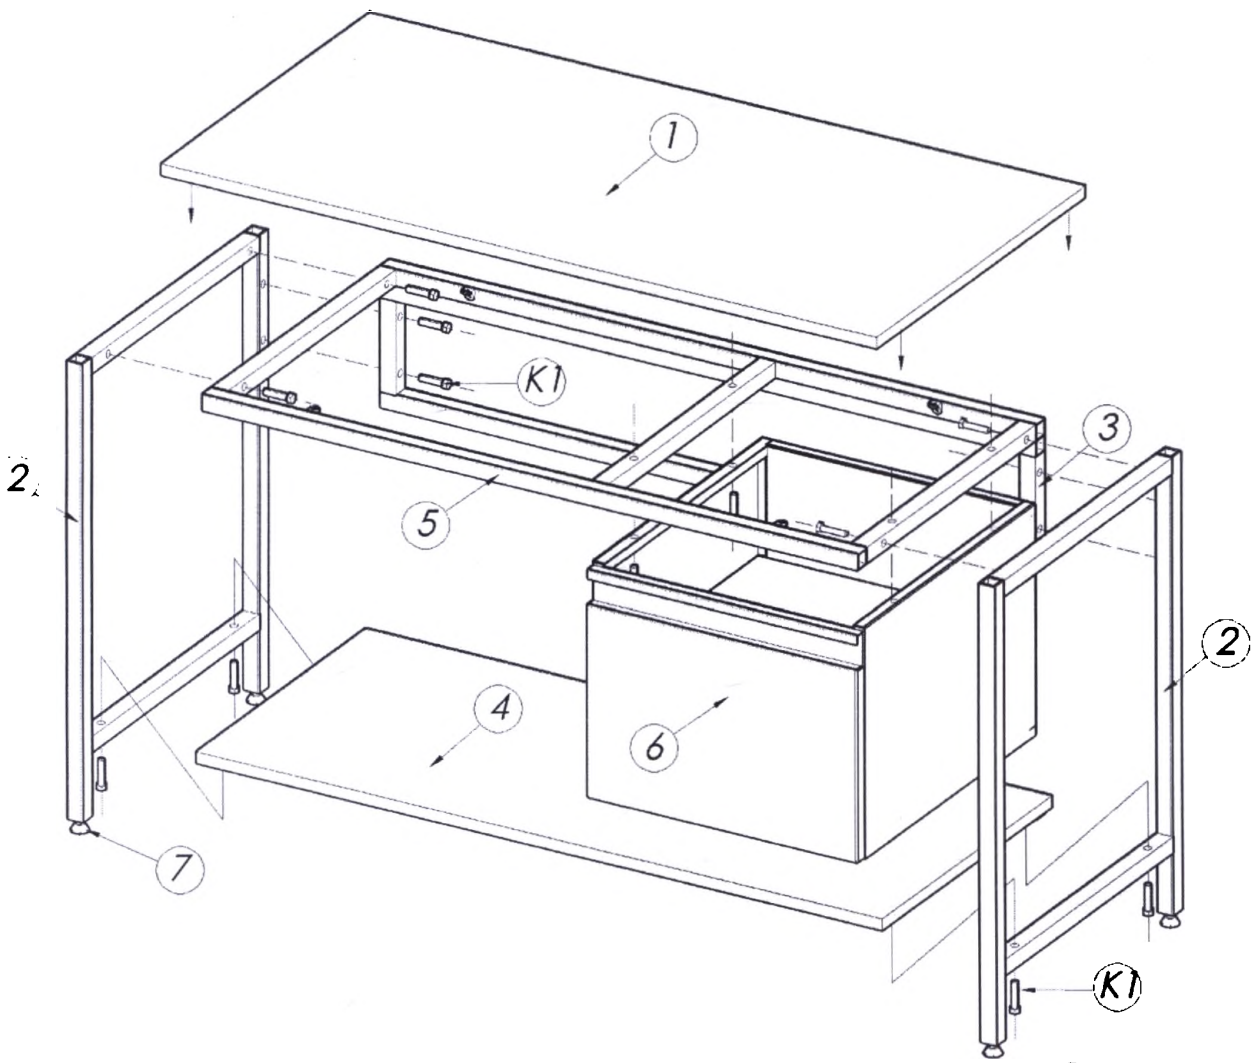

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Тумбу с дверцей (6) подвесить к раме (5) на винты.

6) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПТП в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/590/1/ПТП

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202_ г.

Дата_______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» _____ 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ТП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ТП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская ликарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка оцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка оцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка оцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол ередвижной ирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	**1180*750*900**	**45,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол ленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Дополнительная полка из ЛДСП, металлический каркас
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Царга	1
5	Рама	1
6	Тумба с дверцей	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	14
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	45,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

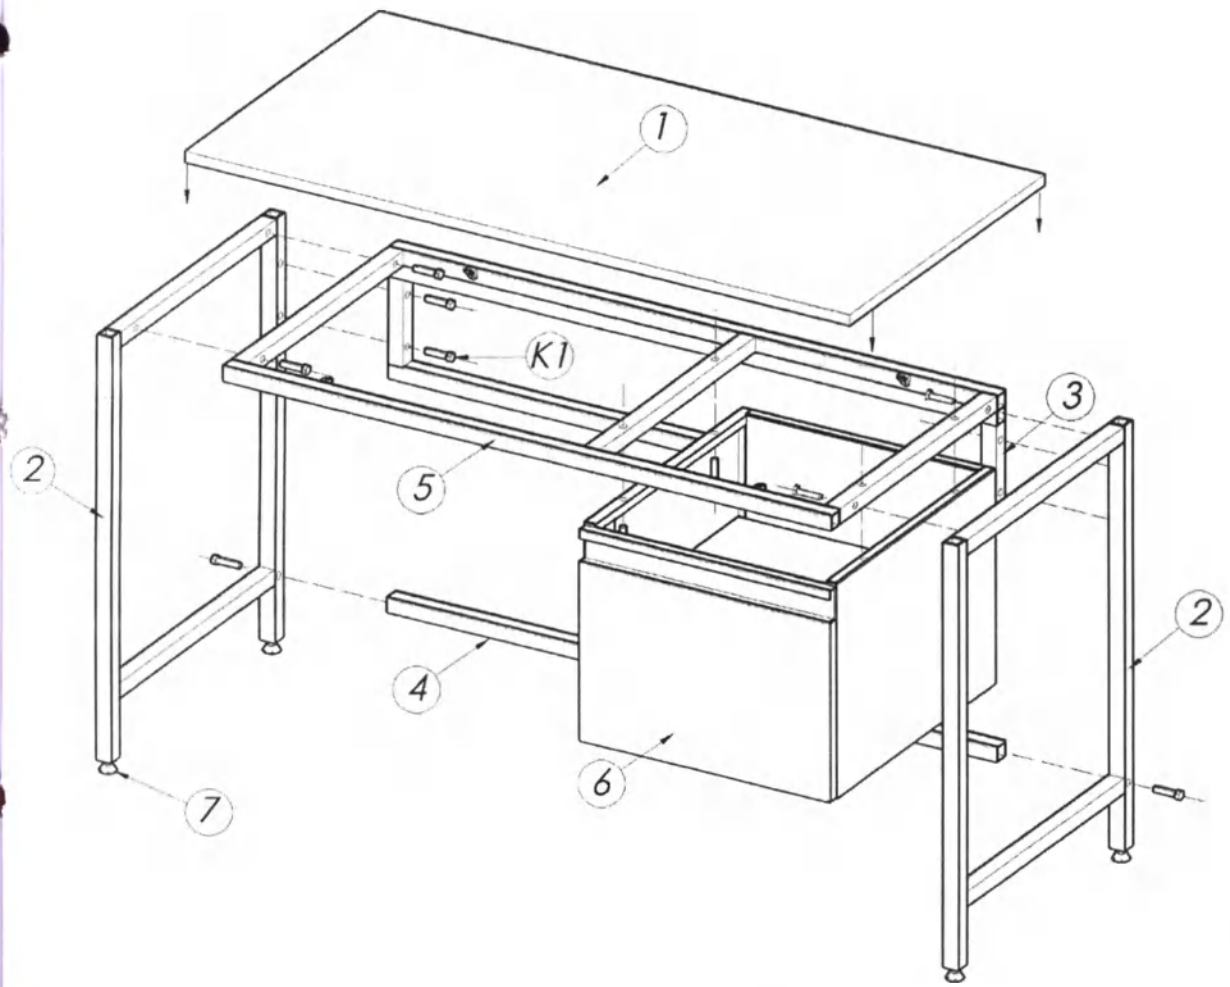

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (K1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и царгу (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Тумбу с дверцей (6) подвесить к раме (5) на винты.

6) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических циалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ТП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ТП

Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________202__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дроки Э. А.**

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПТП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПТП** (далее – тол). Стол входит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Стол предназначен для хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690;	4,2±0,3		Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Ширма едицинская оликарбонатная		Ширина опорьк 400; Диаметр колеса: 40;		Не более 2 шт. (при необходимости)	
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная етская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка для за	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
8 Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПТП	**1180*750*900**	**53,0±0,5**		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ационарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол денальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Столешница	1
2	Стойка	2
3	Царга	1
4	Полка	1
5	Рама	1
6	Тумба с дверцей	1
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	16
К2	Саморез 4х16	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
Масса нетто, кг	53,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении равил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

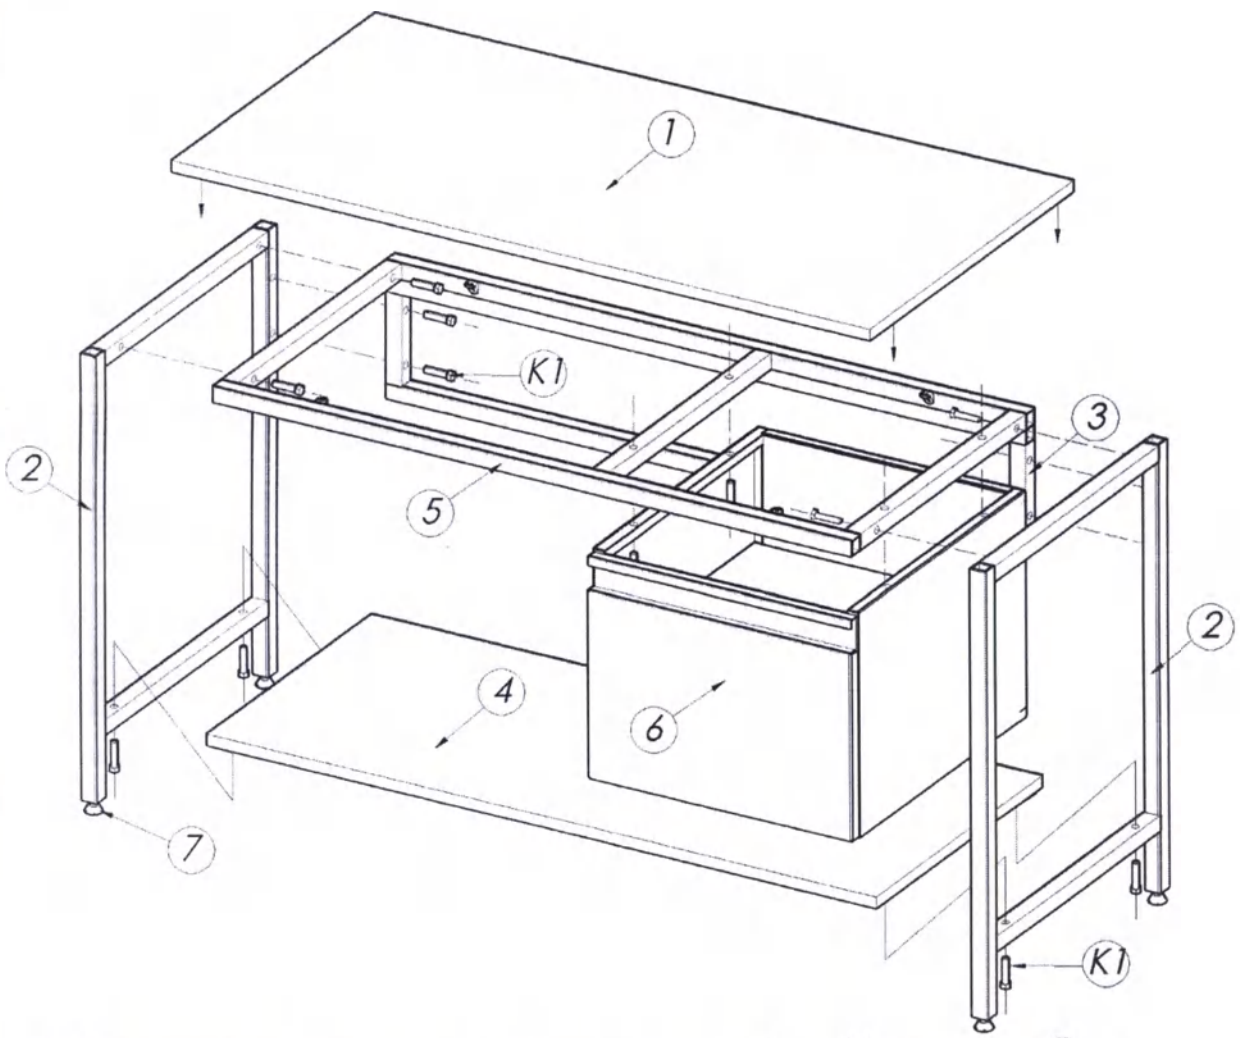

1) Совместить монтажные отверстия стойки (2) и царги (3) Винты М6х35мм (К1) ввернуть не до конца.

2) Раму (5) и полку (4) закрепить на стойках винтами М6х35мм

3) Окончательно затянуть все винты.

4) С помощью саморезов 4х16 закрепить на раме столешницу (1)

5) Тумбу с дверцей (6) подвесить к раме (5) на винты.

6) При необходимости отрегулировать опоры (7)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПТП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол медицинский инструментальный Э-1180/750/1/ПТП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_________202__ г.

Дата______________
Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (семь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А.

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Кушетка стационарная Э-002-ПК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Кушетка стационарная Э-002-ПК** (далее – кушетка). Кушетка ходит в состав **Набора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации кушетки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий кушетка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.

Кушетка стационарная предназначена для размещения пациента во время медицинского осмотра.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набора мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
1.2 Подставка для забора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
1.3 Кушетка процедурная детская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
1.4 Кушетка процедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
1.5 Кушетка процедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
1.6 Подставка для таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
1.7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
.8 Стол едицинский нструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
9 Кушетка ционарная	**Э-002-ПК**	**2020*580*600**	**22,7±0,5**	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
10 Стол еленальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали	Кол-во, шт.
Деталь		
М-1	Мягкий элемент	**1**
Р-3	Опора	**2**
Р-5	Рамка жесткости	**2**
Крепежные изделия		
К1	Винт М6х35	**8**
К2	Саморез 4,2х19 мм	**8**

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (каркас) Винискожа ПВХ-С, пенополиуретан эластичный по ГОСТ 10174, синтепон по ГОСТ 3811 (мягкий элемент)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	22,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10
Максимальный угол подъема подголовника, градусы	36

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали кушетки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной и крестовой битами или отвертки крестовую и шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки кушетки показана на рисунке 1.
10.2 Закрепить две рамки жесткости **Р-5** к двум опорам **Р-3** при помощи винтов.
10.3 На плоскую чистую поверхность (сборочный стол, пол) уложить мягкий элемент **М-1** лицевой стороной вниз, на него уложить собранную конструкцию. Выровнять элементы и скрепить их между собой при помощи саморезов К2.
10.Собранную конструкцию установить вертикально в рабочее положение и закрепить мультифлекс к раме при помощи саморезов К2.
10.5 Кушетка готова к эксплуатации.

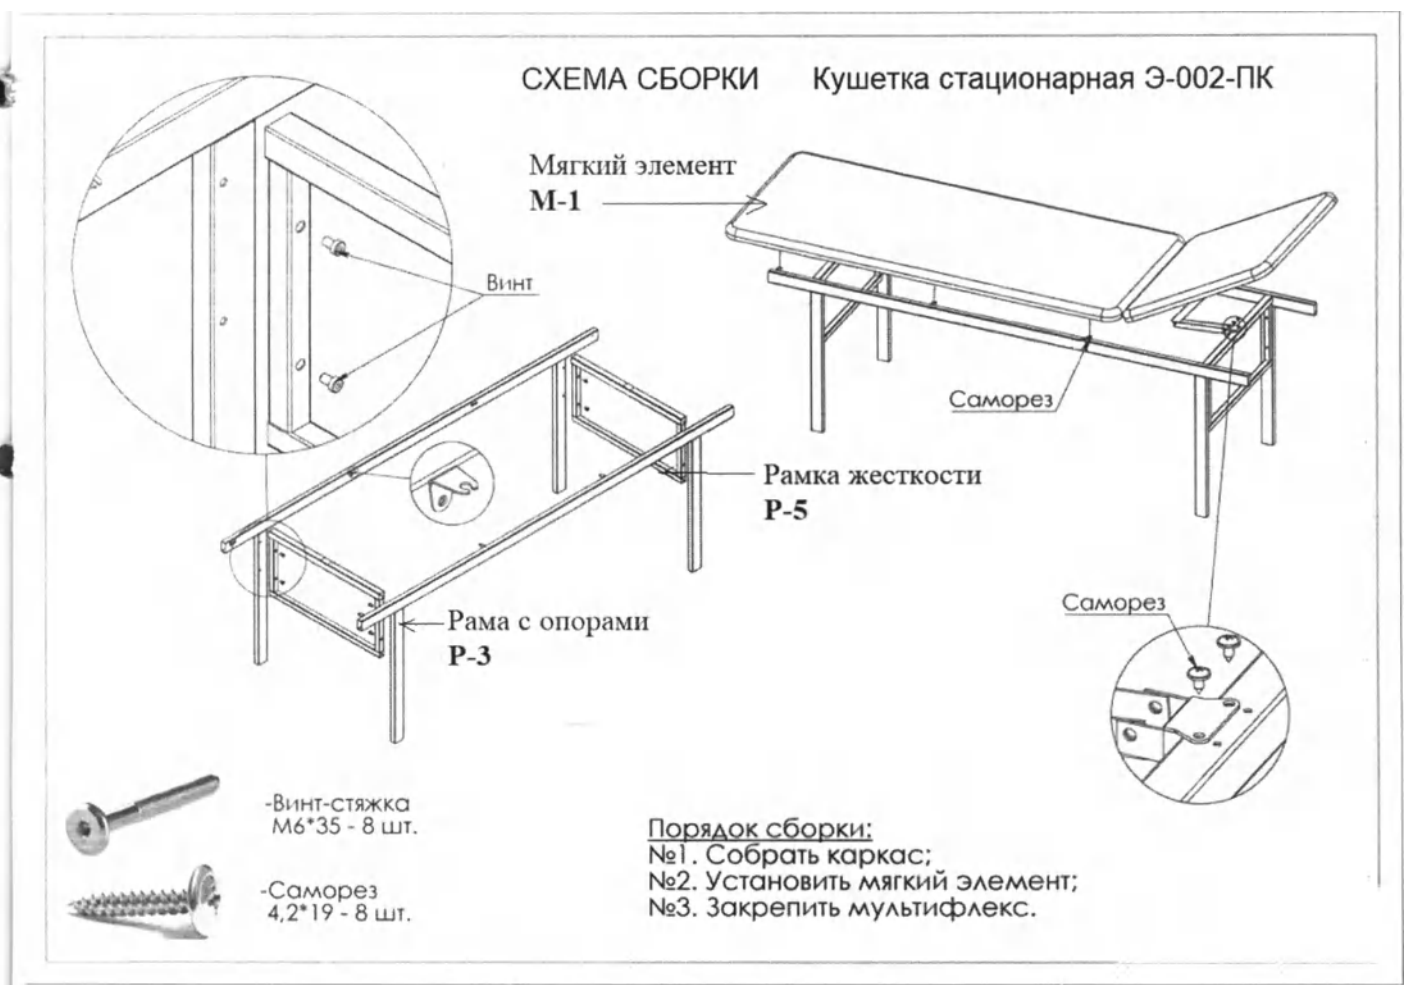

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: кушетка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ти изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кушетка стационарная Э-002-ПК в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Кушетка стационарная Э-002-ПК
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.
Дата________________________________Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дроздов Э. А.
« 27 » июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол пеленальный Э-070-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол пеленальный Э-070-СП** (далее – стол). Стол входит в состав **абора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**
1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.
1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.
Стол пеленальный, предназначен для проведения осмотра и процедур пациентам в возрасте до 1 ода.
Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 0, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набора мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма медицинская	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
икарбонатная		Диаметр колеса: - 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка для ора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка едурная ская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка едурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка едурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка для	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
17 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол дицинский струментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
0 Стол енальный	**Э-070-СП**	**850*700*1050**	**22,5±0,5**	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Стойка	2
2	Полка	1
3	Задняя стенка	1
4	Столешница	1
5	Ребро боковое	2
6	Ребро заднее	1
7	Царга	3
Крепежные изделия		
8	Евровинт	12
9	Винт М6х30	2
10	Винт М6х70	6
11	Гайка-бочонок	6
12	Саморез 4,2х35	17

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (каркас) ЛДСП по ГОСТ 10632
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	22,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной и крестовой битой или отвертки.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки стола показана на рисунке 1.
10.2 Собрать каркас. Прикрутить стойки 1 к царгам 7 с помощью винтов 10 и гайка-боченок 11.
10.3 Собрать столешницу 4. Прикрутить ребро боковое 5 к ребру заднему 6 с помощью евровинтов 8, затем эту конструкцию прикрутить к столешнице с помощью евровинтов 8 таким образом что бы радиусы на деталях были с одной стороны.
10.4 Собрать полку 2. Прикрутить царгу 3 к полке 2 с помощью евровинтов 8.
10.5 Закрепить столешницу 4 (4,5,6) к каркасу сверху с помощью саморезов 12 через сквозные отверстия в стойках 1 и верхних царг 7.
10.6 Закрепить полку 2 (2,3) в средней части стола пеленального установив полку 2 на среднюю царгу 7 и перемычки стоек 1 с помощью винтов 9 совместив отверстия царги 3 и стоек 1. Окончательно закрепить полку 2 через сквозные отверстия царги 7 и отверстия в перемычках стойки 1 с помощью саморезов 12.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

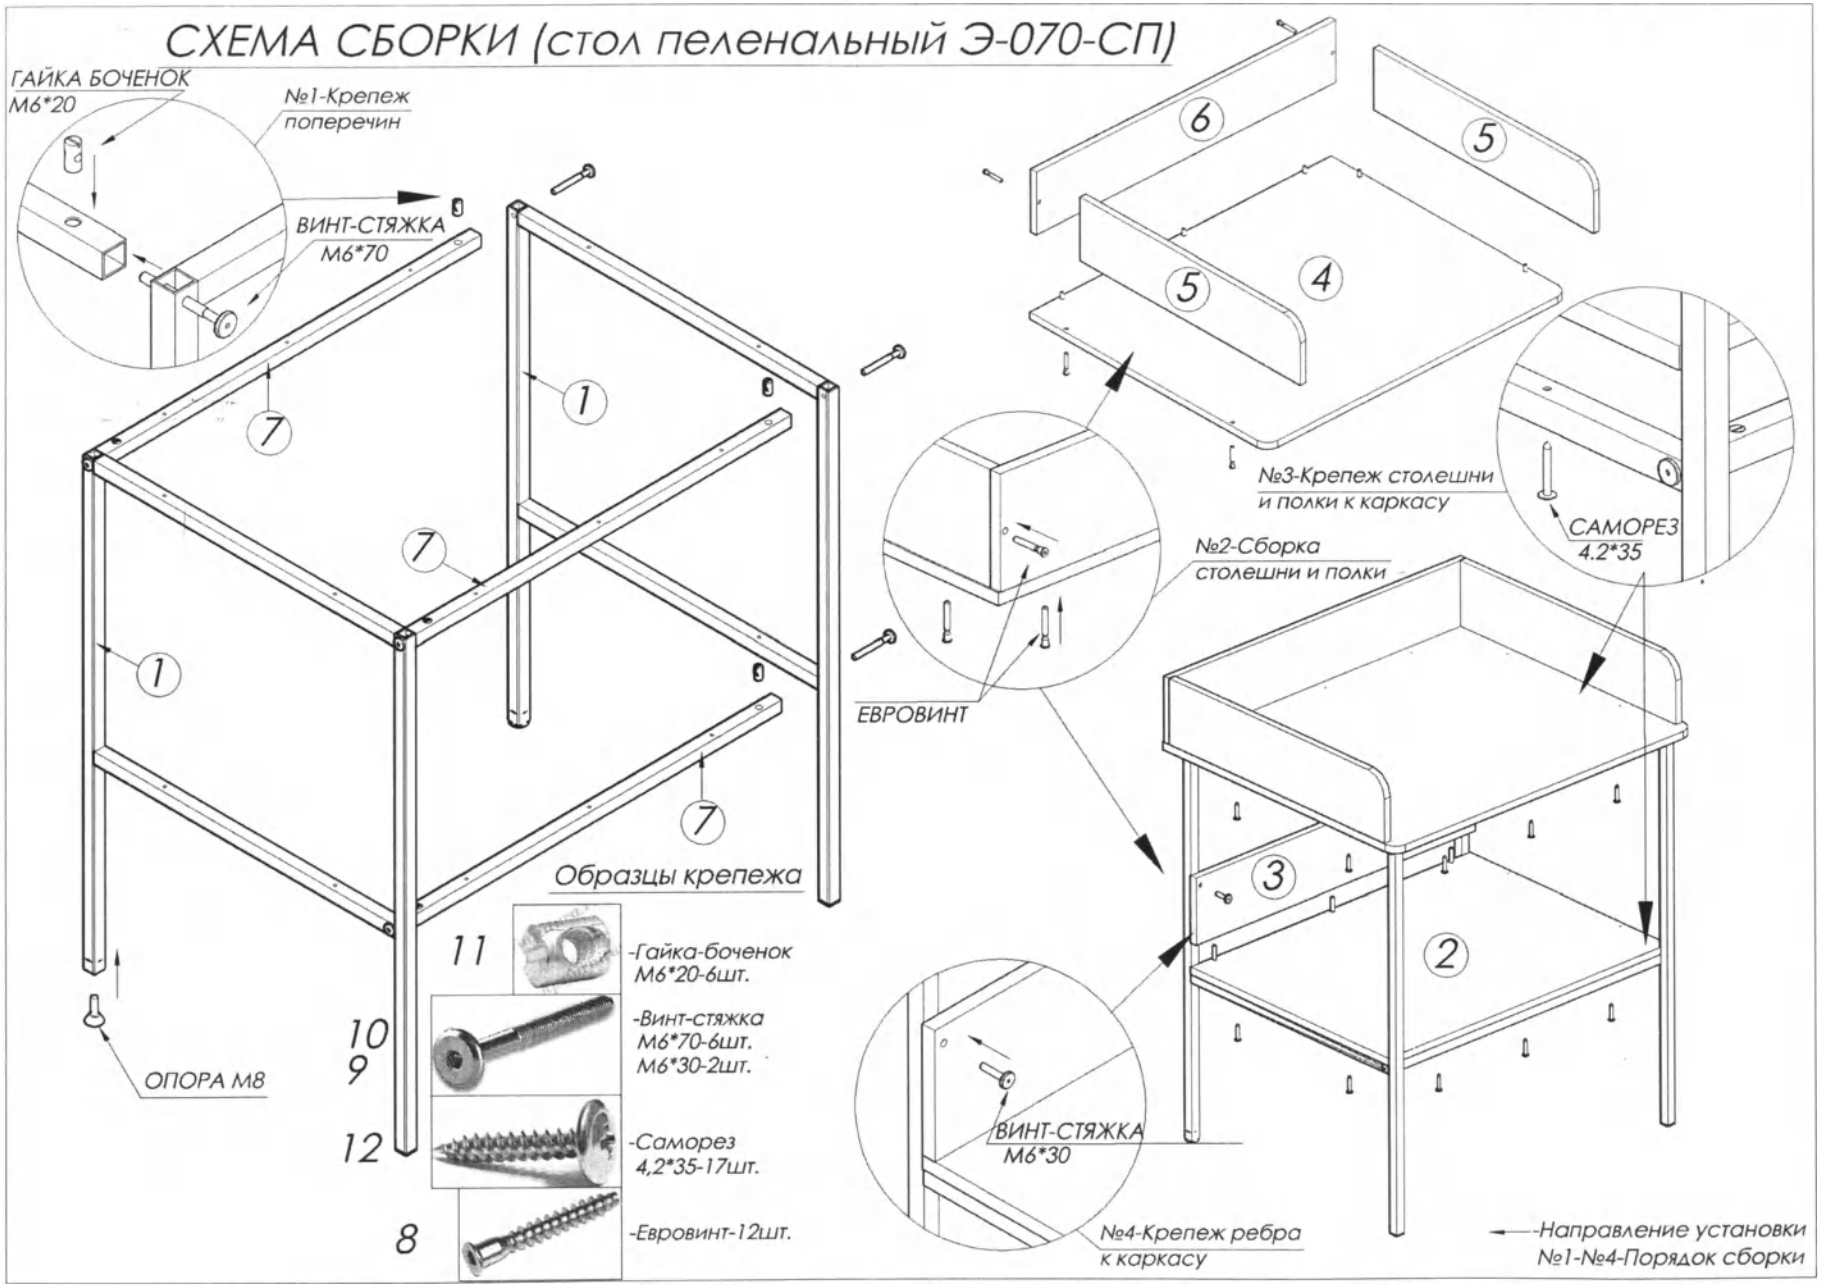

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол пеленальный Э-070-СП в количестве __________шт. принят в соответствии с обязательными ебованиями государственных стандартов и технической документации и признан годным для сплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол пеленальный Э-070-СП

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
8 (восемь) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол пеленальный СПП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол пеленальный СПП** (далее – стол). Стол входит в состав **абора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**
1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.
1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.
Стол пеленальный, предназначен для проведения осмотра и процедур пациентам в возрасте до 1 ода.
Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 0, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набора мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
1.1 Ширма медицинская поликарбонатная	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
2 Подставка ля забора рови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
3 Кушетка роцедурная кая	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
4 Кушетка роцедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
5 Кушетка роцедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
6 Подставка ля таза	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
7 Стол передвижной хирургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0.5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0.5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0.5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42.0±0.5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39.0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0.5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0.5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0.5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0.5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ционарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
0 Стол пенальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	**650*650*1016**	**22,0±0,5**		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	830*706*1050	26,0±0,5		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2 Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
1	Стойка с регулируемыми опорами	2
2	Полка	1
3	Задняя стенка	1
4	Столешница	1
5	Ребро боковое	2
6	Ребро заднее	1
Крепежные изделия		
7	Евровинт	17
8	Эксцентриковая стяжка	6
Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
спользуемые материалы	ЛДСП по ГОСТ 10632
оминальное отклонение габаритных размеров, не олее, мм	4
лиматический класс	УХЛ 4.2
емпература окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
асса нетто, кг	22,0±0,5
азначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки стола показана на рисунке 1.

10.2 Собрать каркас стола. Прикрутить стойки 1 к задней стенке 3 с помощью евровинтов 7. Затем установить полку 2 между стойками задней стенкой 3 и закрепить с помощью евровинтов 7.

10.3 Собрать столешницу 4. Прикрутить ребро боковое 5 к ребру заднему 6 с помощью евровинтов 7, затем эту конструкцию прикрутить к столешнице 4 с помощью евровинтов 7 таким образом что бы радиусы на деталях были с одной стороны. Перевернуть столешницу (4,5,6) ив отверстия Д-5мм вкрутить штифт эксцентриковой стяжки 8.

10.4 Закрепить столешницу 4 (4,5,6) на каркас (1,2,3). Совместить штифты с отверстиями в стойках 1 и задней стенке 3, легким нажатием на столешницу 4 (4,5,6) достичь плотного соединения всех деталей столешницы и каркаса. С помощью эксцентрика установленного в стойки 1 и заднюю стенку 3 зафиксировать детали.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки СПП

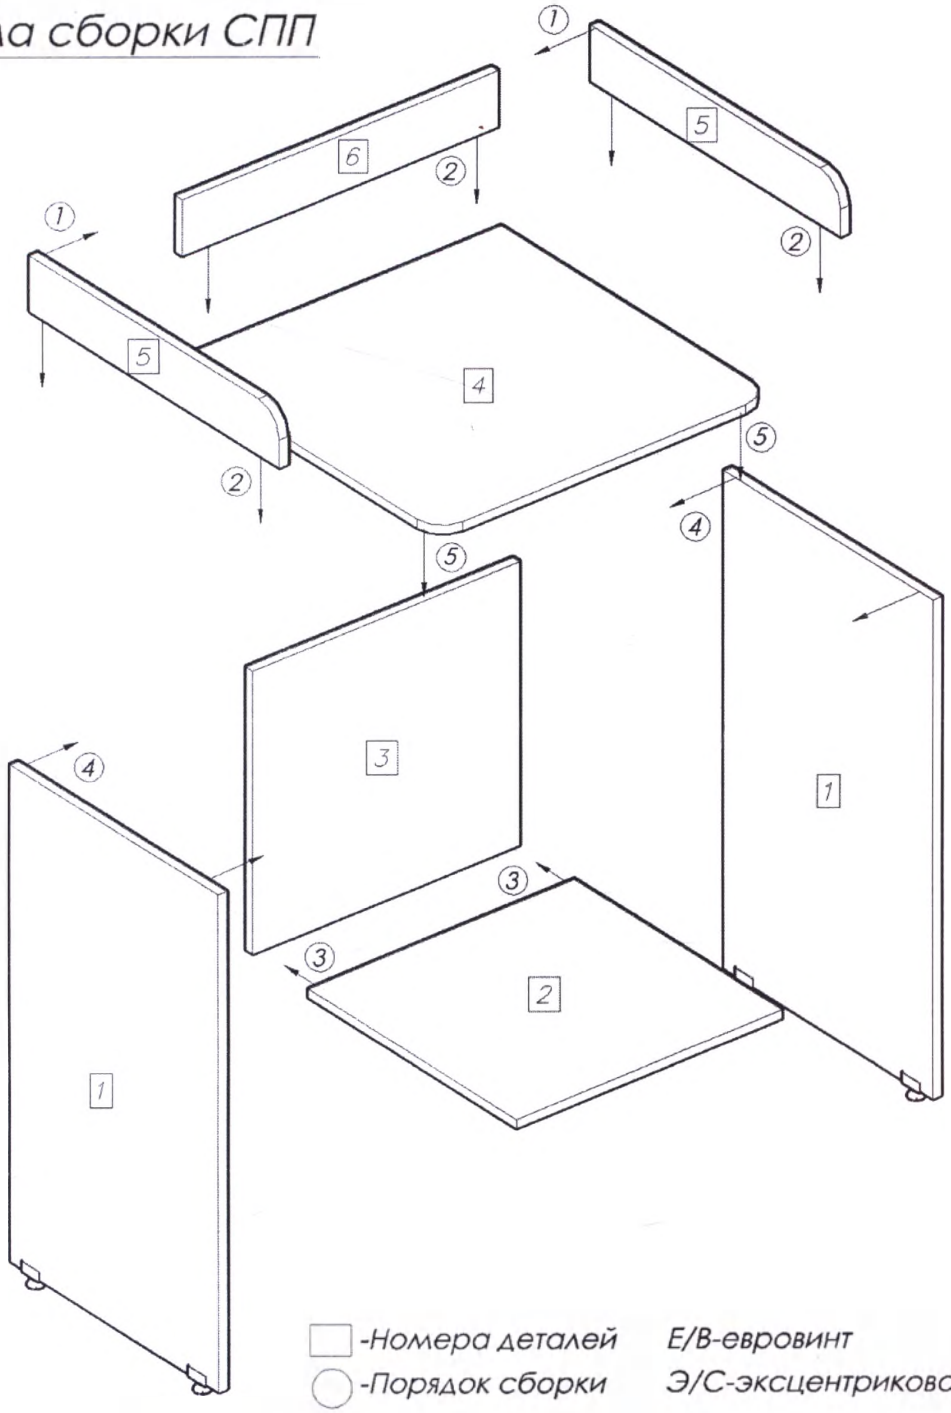

-Номера деталей Е/В-евровинт

-Порядок сборки Э/С-эксцентриковая стяжка

ДЕТАЛИРОВКА

№	Наименование	Кол. шт.	Вдоль мм.	Поперек мм.	Крепеж	
					Е/В	Э/С
1	СТОЙКА	2	880	500		
2	ПОЛКА	1	518	500	4	
3	ЗАДНЯЯ СТЕНКА	1	500	518	5	
4	СТОЛЕШНИЦА	1	650	650		6
5	РЕБРО БОКОВОЕ	2	100	584	6	
6	РЕБРО ЗАДНЕЕ	1	100	644	2	
					17	6

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол пеленальный СПП в количестве __________шт. принят в соответствии с обязательными ебованиями государственных стандартов и технической документации и признан годным для сплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________ Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол пеленальный СПП

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стол пеленальный Э-070-СПМ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стол пеленальный Э-070-СПМ** (далее – стол). Стол входит в состав **абора мебели медицинской для процедурного кабинета по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**
1.2 Условия эксплуатации стола: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.
1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стол тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для процедурного кабинета предназначен для оборудования роцедурных кабинетов с целью проведения медицинских процедур и осмотров, а также размещения едицинского оборудования и инструментов, в том числе использованных.
Стол пеленальный, предназначен для проведения осмотра и процедур пациентам в возрасте до 1 ода.
Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стола составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская , пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набора мебели медицинской для процедурного кабинета включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1. Набор мебели медицинской для процедурного кабинета					
Ширма едицинская	Э-051-ШП	Ш*В: 720*1690; Ширина опоры: 400;	4,2±0,3	Не более 2 шт. (при необходимости)	Односекционная

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
пикарбонатная		Диаметр колеса: 40;			
	Э-052-ШП	Ш*В: 1450*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	7,0±0,3		Двухсекционная
	Э-053-ШП	Ш*В: 2180*1690; Ширина опоры: 400; Диаметр колеса: 40;	11±0,3		Трехсекционная
Подставка для бора крови	Э-008-П	700*400*770	6,0±0,5	Не более 2 шт.	Мягкий элемент из винилискожи.
Кушетка едурная ская	Э-001-ПКД	1500*500*600	17,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, уменьшенная длина
Кушетка цедурная	Э-001-ПК	2020*580*610	26,9±0,5	Не более 2 шт.	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
	Э-101-ПФК	2020*610*610	30,0±0,5		Деревянный каркас
Кушетка цедурная	Э-105-ФК	2070*610*750	34,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Деревянный каркас, увеличенная высота
Подставка для	Э-031-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5	Не более 2 шт.	**Регулируемая высота, металлический каркас, для 1 таза**
	Э-032-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, металлический каркас, для 2 тазов
	Э-131-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	3,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 1 таза
	Э-132-П	Диаметр трехлучья: 700; Диаметр каждой подставки: 295; 950 – 1620 (регулируемая высота)	5,0±0,5		Регулируемая высота, каркас из нержавеющей стали, для 2 тазов
Стол редвижной ургический	Э-060-СХ	620*510*(720-1170)	7,6±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Каркас из металла, ручная регулировка высоты
	Э-060-СХ/Н	620*510*(720-1170)	7,8±0,5		Каркас из металла, ручная регулировка высоты, поддон из нержавеющей стали
	Э-160-СХ	620*510*(720-1170)	8,84±0,5		Каркас из нержавеющей стали, ручная регулировка высоты

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-260-СХ	620*510*(860-1000)	15,5±0,5		Каркас из нержавеющей стали, гидравлическая ножная регулировка высоты
Стол медицинский инструментальный	Э-1180/590	1180*590*760	25,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Нержавеющая сталь
	Э-1180/590/П	1180*590*760	32,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/750	1180*750*760	29,0±0,5		Нержавеющая сталь
	Э-1180/750/П	1180*750*760	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка
	Э-1180/590/1	1180*590*900	26,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/П	1180*590*900	33,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/750/1	1180*750*900	30,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/П	1180*750*900	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, увеличенная высота, полка
	Э-1180/590/ЯП	1180*590*760	34,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э-1180/590/ПЯП	1180*590*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/750/ЯП	1180*750*760	41,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик
	Э – 1180/750/ПЯП	1180*750*760	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесной ящик
	Э-1180/590/1/ЯП	1180*590*900	35,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП	1180*590*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП	1180*750*900	42,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП	1180*750*900	50,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесной ящик, полка, увеличенная высота
	Э-1180/590/ЯП2	1180*590*760	39,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/590/ПЯП2	1180*590*760	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ЯП2	1180*750*760	48,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика
	Э-1180/750/ПЯП2	1180*750*760	56,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика
	Э-1180/590/1/ЯП2	1180*590*900	40,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПЯП2	1180*590*900	46,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ЯП2	1180*750*900	49,0±0,5		Нержавеющая сталь, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ПЯП2	1180*750*900	57,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, два подвесных ящика, увеличенная высота
	Э-1180/590/ТП	1180*590*760	37,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/590/ПТП	1180*590*760	43,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/750/ТП	1180*750*760	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба
	Э-1180/750/ПТП	1180*750*760	52,0±0,5		Нержавеющая сталь, полка, подвесная тумба
	Э-1180/590/1/ТП	1180*590*900	38,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота
	Э-1180/590/1/ПТП	1180*590*900	44,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
	Э-1180/750/1/ТП	1180*750*900	45,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, увеличенная высота

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-1180/750/1/ПТП	1180*750*900	53,0±0,5		Нержавеющая сталь, подвесная тумба, полка, увеличенная высота
Кушетка ионарная	Э-002-ПК	2020*580*600	22,7±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, Угол регулировки наклона подголовника – 13-ти ступенчатый механизм от 0° до 36°.
Стол енальный	Э-070-СП	850*700*1050	22,5±0,5	Не более 2 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	СПП	650*650*1016	22,0±0,5		Каркас из ЛДСП, дополнительная полка.
	Э-070-СПМ	**830*706*1050**	**26,0±0,5**		Мягкая обивка, столешница с бортами из винилискожи, металлический каркас

7.2. Комплектация поставки стола:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
1	Стойка	2
2	Полка	1
3	Задняя стенка	1
4	Столешница с бортами	1
7	Царга	3
Крепежные изделия		
8	Евровинт	3
9	Винт М6х30	2
10	Винт М6х70	6
11	Гайка-боченок	6
12	Саморез 4,2х35	17

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (каркас) Винискожа ПВХ-С, пенополиуретан эластичный по ГОСТ 10174, синтепон по ГОСТ 3811 (мягкий элемент) ЛДСП по ГОСТ 10632
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	26,0±0,5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой ходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стола освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной и крестовой битой или отвертки.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении авил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять ого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки стола показана на рисунке 1.
10.2 Собрать каркас. Прикрутить стойки 1 к царгам 7 с помощью винтов 10 и гайка-боченок 11.
10.3 Собрать полку 2. Прикрутить царгу 3 к полке 2 с помощью евровинтов 8.
10.4 Закрепить столешню 4 к каркасу сверху с помощью саморезов 12 через сквозные отверстия в стойках 1 и верхних царг 7.
10.5 Закрепить полку 2 (2,3) в средней части стола пеленального установив полку 2 на среднюю царгу 7 и перемычки стоек 1 с помощью винтов 9 совместив отверстия царги 3 и стоек 1. Окончательно закрепить полку 2 через сквозные отверстия царги 7 и отверстия в перемычках стойки 1 с помощью саморезов 12.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ (стол пеленальный Э-070-СПМ)

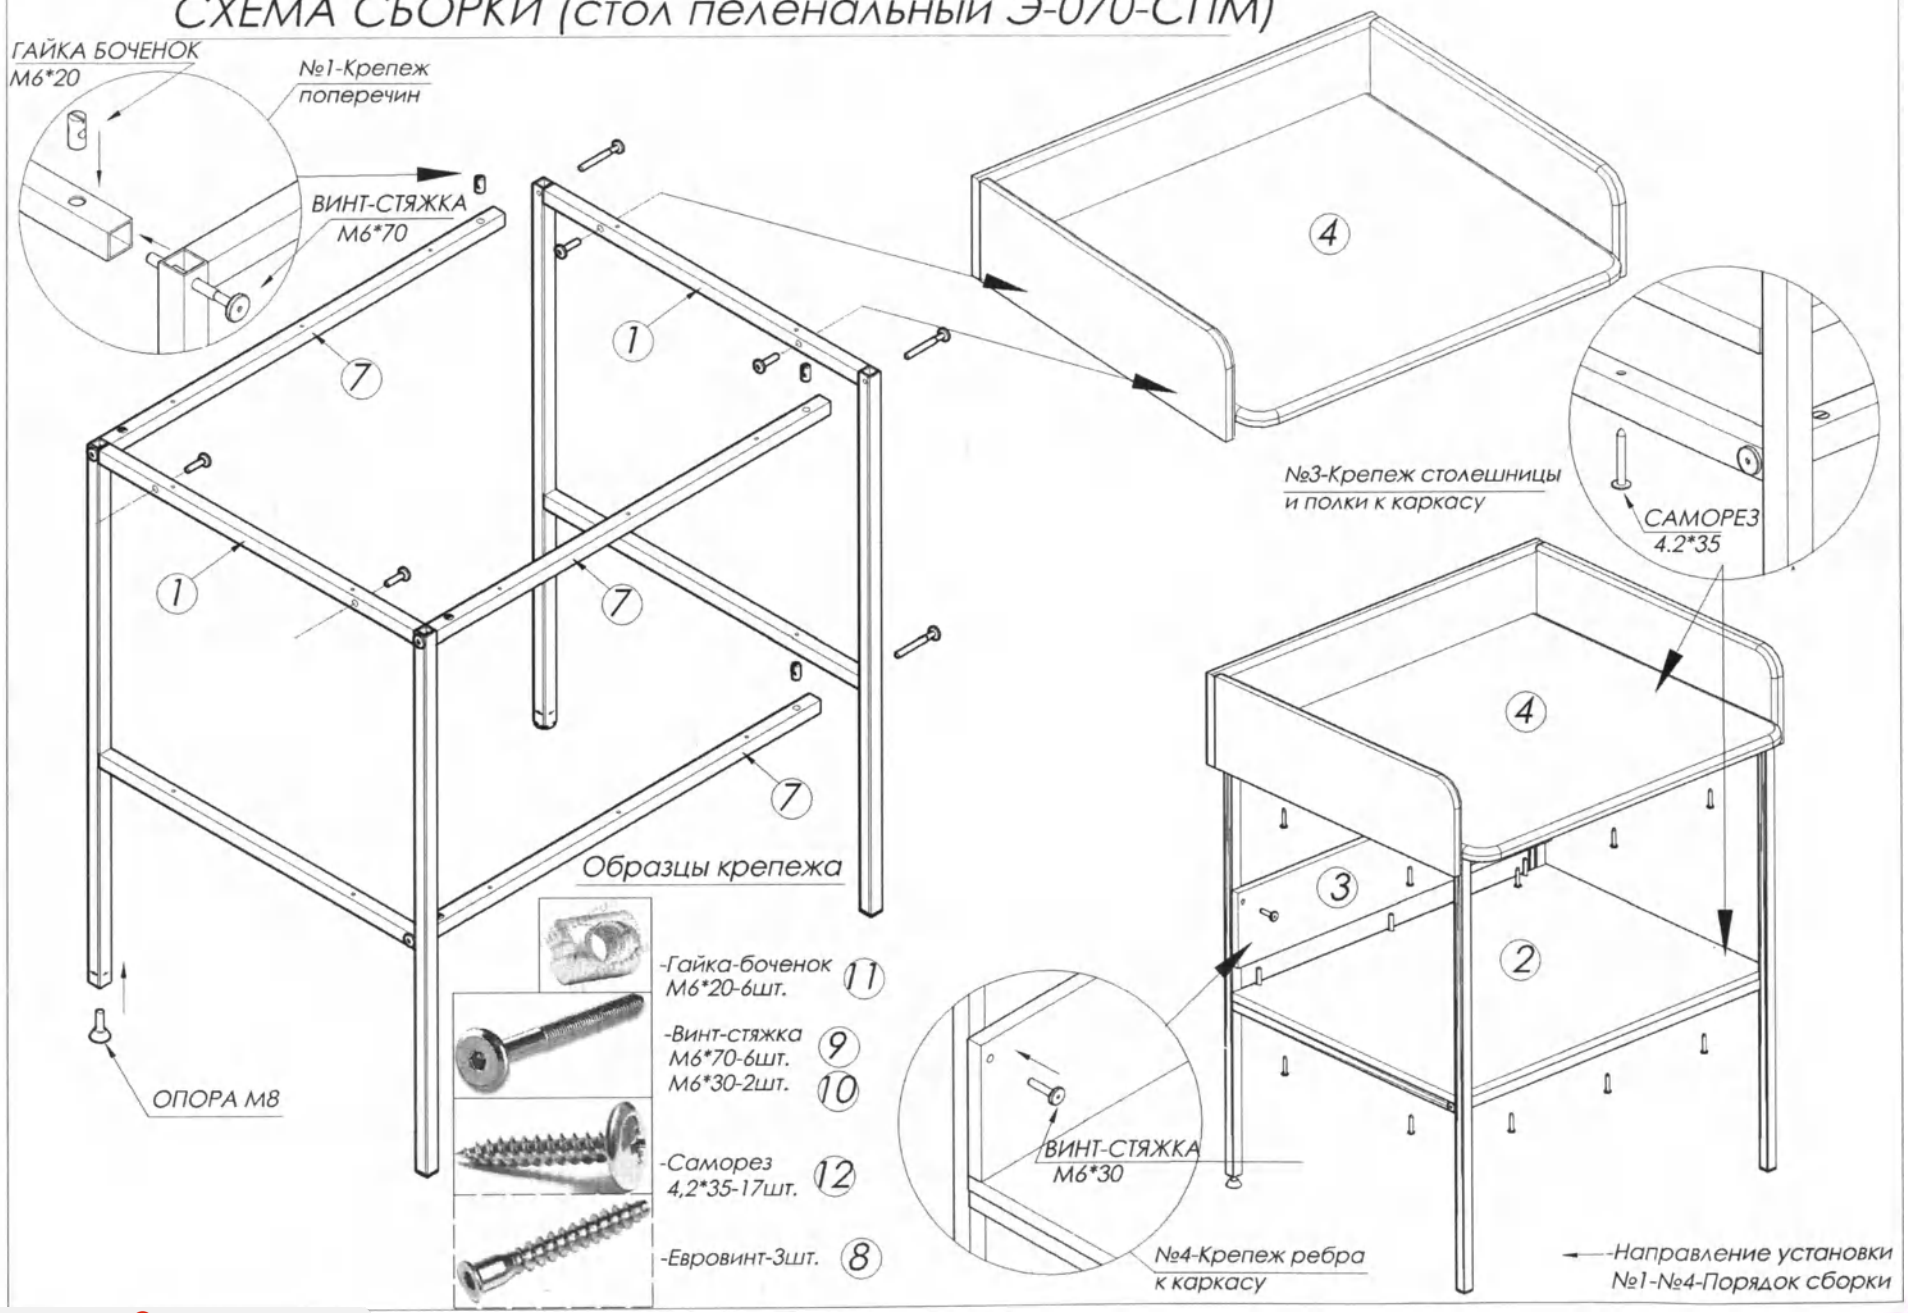

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стол обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ;орода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ;одов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке і изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ;, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации ;возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо ;елие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ;делец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное возиаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол пеленальный Э-070-СПМ в количестве __________шт. приият в соответствии с ;язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признан дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стол пеленальный Э-070-СПМ

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата______________ Начальник

производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стеллаж передвижной медицинский Э-048-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стеллаж передвижной медицинский Э-048-СПЭ** (далее – стеллаж). теллаж входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стеллаж носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стеллаж предназначен для размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стеллажа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
.1 Стеллаж передвижной медицинский	**Э-048-СПЭ**	**700*500*1490**	**17,0±0,5**	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
Тележка дицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка нфузионная я капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф едицинский еталлический хсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стеллажа:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р1	Рамка полки	4
К5	Стойка с колесами и отбойниками	2
П4	Полка (поддон металлический)	4
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	16

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (полки)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	22,0±0,5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки стеллажа показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К5** закрепить к четырем рамкам **Р1** восемью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку **Р1** - полки **П4**.
10.4 Стеллаж готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ СТЕЛЛАЖЕЙ Э-048-СПЭ.

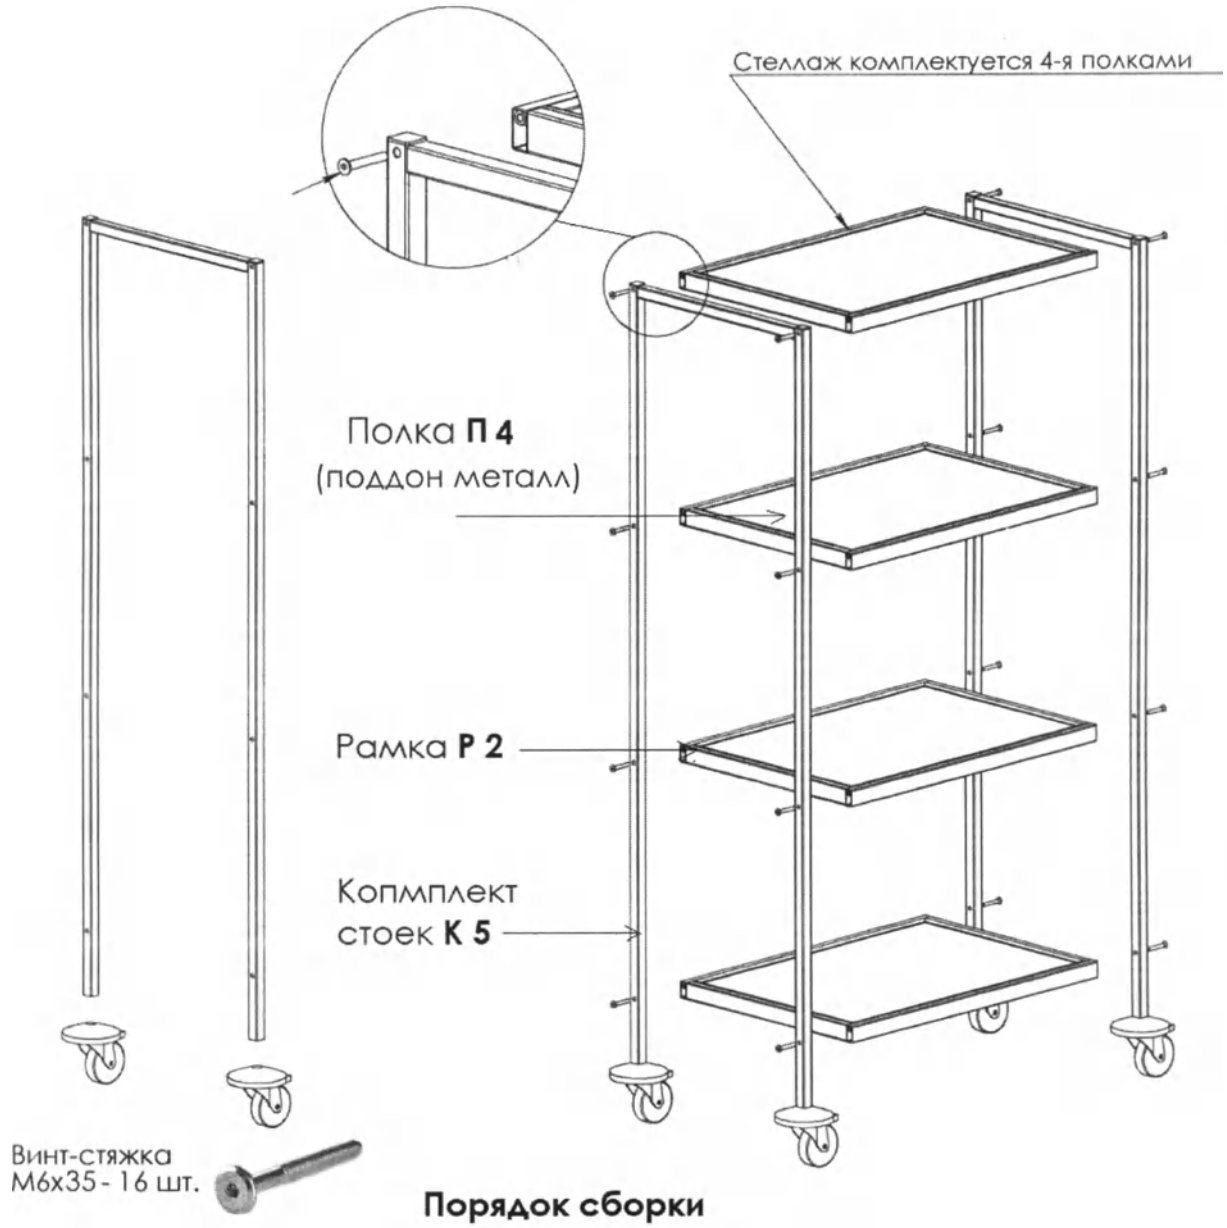

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стеллаж обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие азивные материалы и органические растворители.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу кодов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж передвижной медицинский Э-048-СПЭ в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стеллаж передвижной медицинский Э-048-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. Ю.
«27» ноября 2023 года М.П.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРГОМЕДИКА» г. НОВОСИБИРСК
ЭРГОМЕДИКА

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стеллаж передвижной медицинский Э-048/Н-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стеллаж передвижной медицинский Э-048/Н-СПЭ** (далее – теллаж). Стеллаж входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стеллаж тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стеллаж предназначен для размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стеллажа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
1 Стеллаж передвижной	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	**630*420*1490**	**22,0±0,5**		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
дицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
Тележка дицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка нфузионная я капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф едицинский таллический хсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стеллажа:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р1	Рамка полки	4
К5	Стойка с колесами и отбойниками	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	4
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	16

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (полки)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Масса нетто, кг	22,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки стеллажа показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К5** закрепить к четырем рамкам **Р1** восемью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку **Р1** - полки **П3**.
10.4 Стеллаж готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ СТЕЛЛАЖЕЙ Э-048/Н-СПЭ

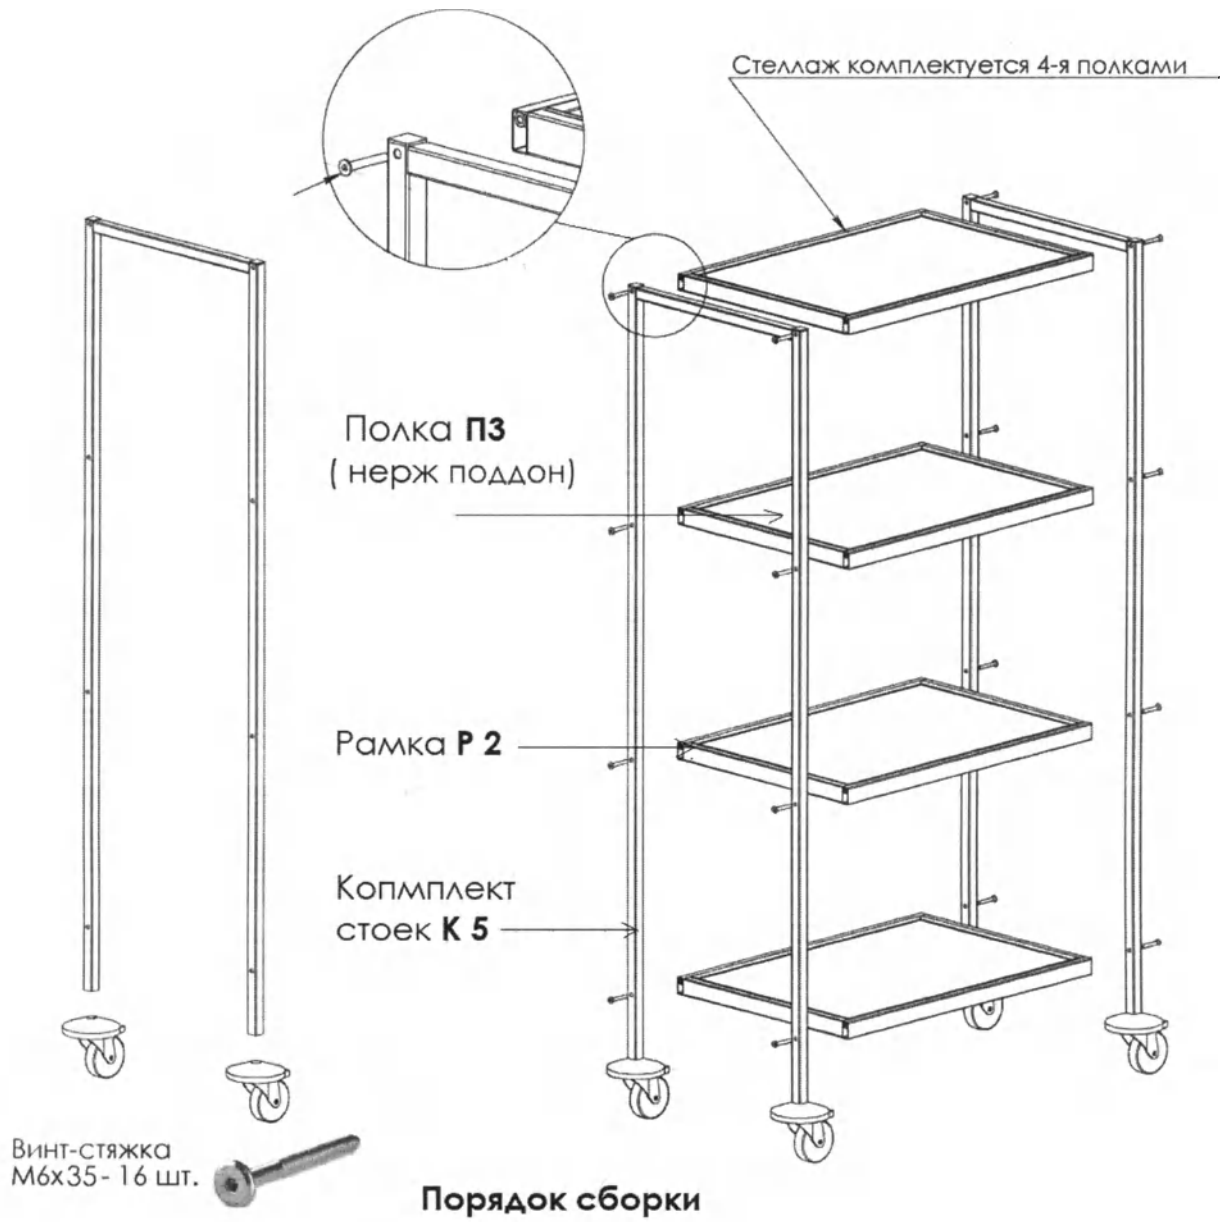

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стеллаж обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу :ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ти изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное возиаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж передвижной медицинский Э-048/Н-СПЭ в количестве __________шт. принят в тветствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стеллаж передвижной медицинский Э-048/Н-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата______________
Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А./
«27» июня 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стеллаж передвижной медицинский Э-048-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стеллаж передвижной медицинский Э-048-СП** (далее – стеллаж). Стеллаж входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стеллаж относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стеллаж предназначен для размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стеллажа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	**700*500*1490**	**22,0±0,5**		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка едицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический секционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стеллажа:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р 1	Рамка полки	4
С 5	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 4	Полка (поддон металлический)	4
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	16

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Листовая сталь по ГОСТ 9940 по ГОСТ 111 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (полки)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	22,0±0,5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С5** закрепить к четырем рамкам **Р1** – четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П4**, внутрь рамки.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-048-СП; Э-048/Н-СП

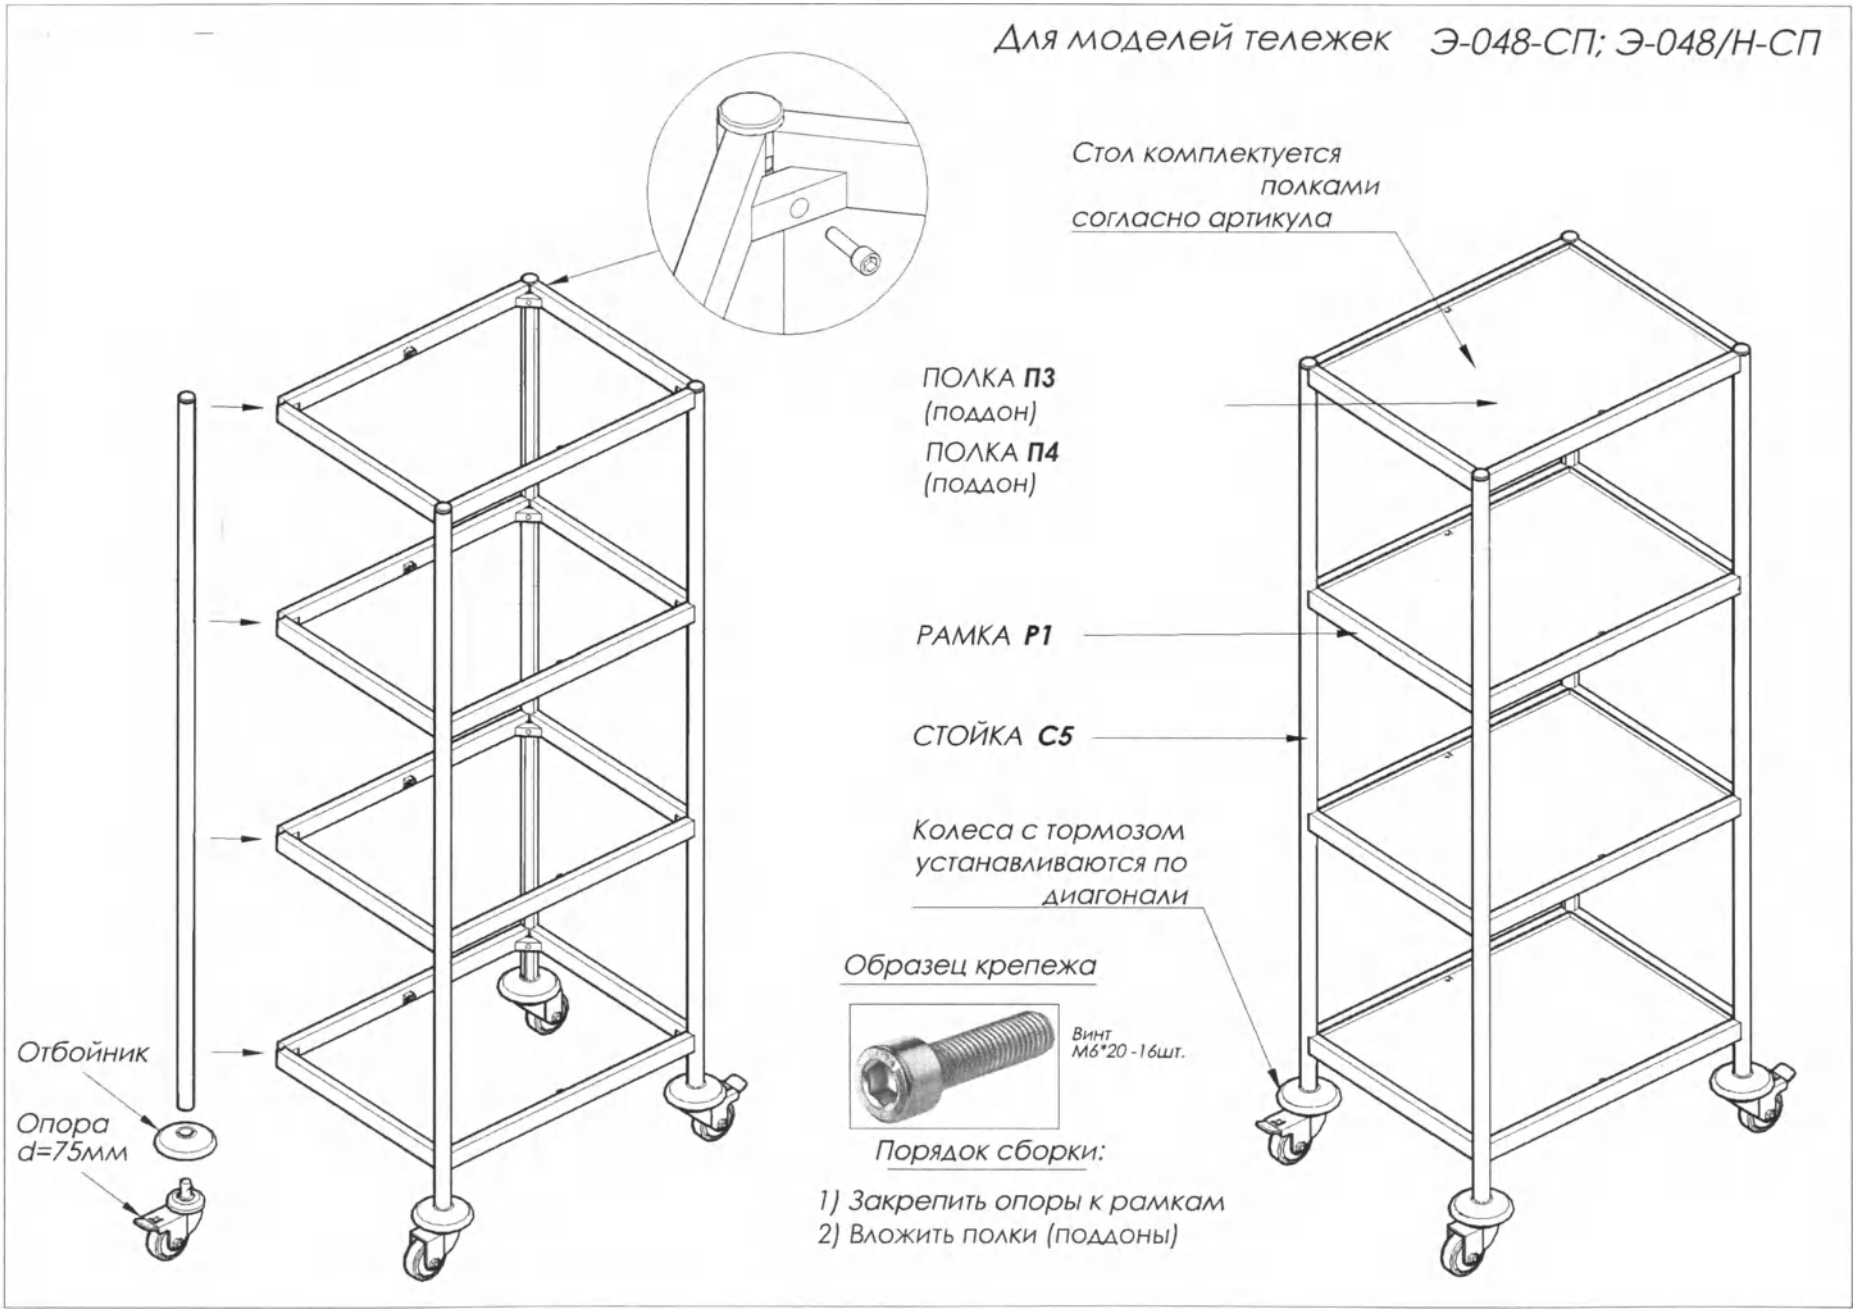

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стеллаж обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж передвижной медицинский Э-048-СП в количестве __________шт. принят в соответствии бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признан дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стеллаж передвижной медицинский Э-048-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность: Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э.А. /

«27» сентября 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

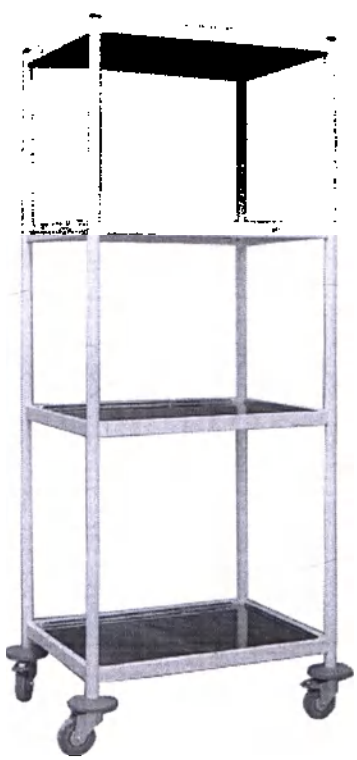

Стеллаж передвижной медицинский Э-048/Н-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стеллаж передвижной медицинский Э-048/Н-СП** (далее – стеллаж). Стеллаж входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тумба относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стеллаж предназначен для размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стеллажа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
дицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СП	**630*420*1490**	**22,0±0,5**		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка дицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка нфузионная я капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф едицинский еталлический ухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стеллажа:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р 1	Рамка полки	4
С 5	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	4
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	16

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	22,0±0,5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С5** закрепить к двум (четырем) рамкам **Р1** – четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П3**, внутрь рамок **Р1.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-048-СП; Э-048/Н-СП

Стол комплектуется полками согласно артикула

ПОЛКА **П3** (поддон)

ПОЛКА **П4** (поддон)

РАМКА **Р1**

СТОЙКА **С5**

Колеса с тормозом устанавливаются по диагонали

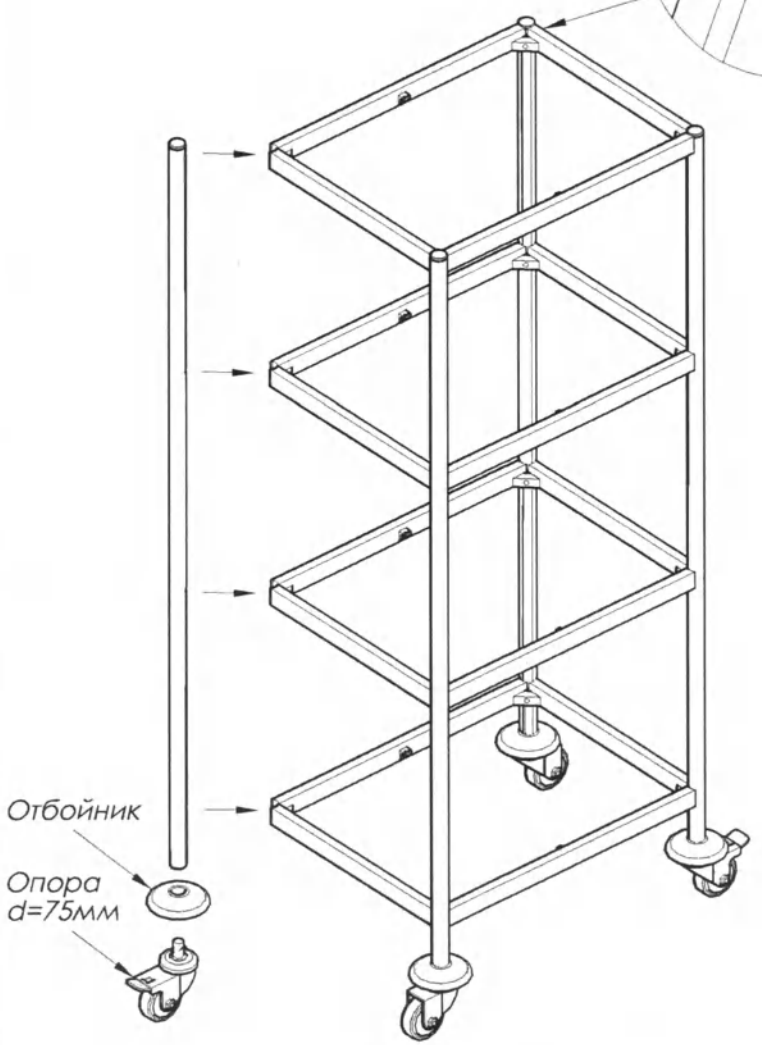

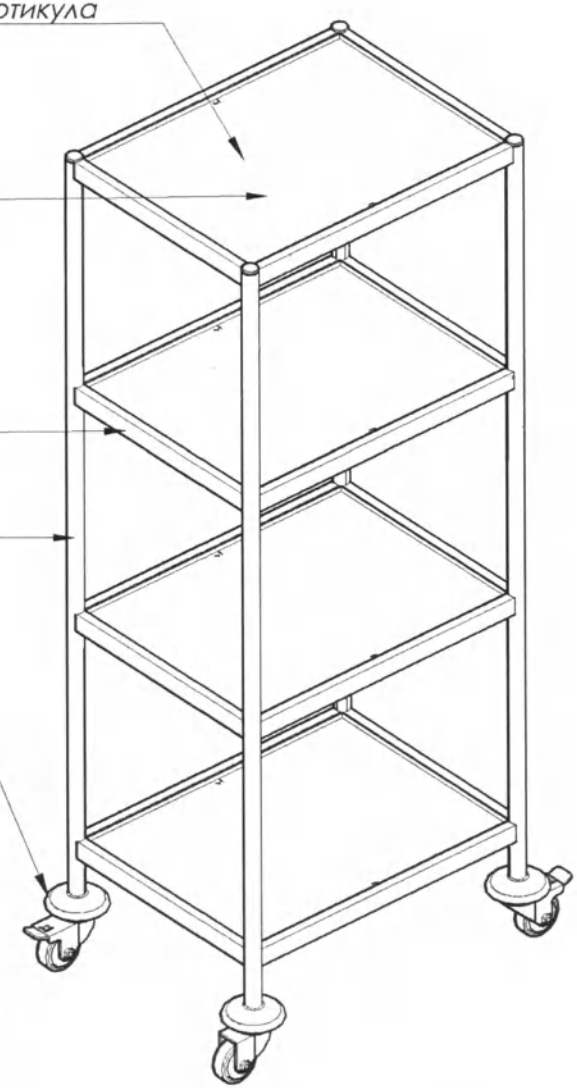

Образец крепежа

Винт М6*20 -16шт.

Порядок сборки:

1) Закрепить опоры к рамкам
2) Вложить полки (поддоны)

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стеллаж обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж передвижной медицинский Э-048/Н-СП в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стеллаж передвижной медицинский Э-048/Н-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность: Генеральный директор

Подпись _____ / Дроздов Э.А. /

« 27 » июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стеллаж передвижной медицинский Э-148-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стеллаж передвижной медицинский Э-148-СП** (далее – стеллаж). Стеллаж входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стеллаж относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стеллаж предназначен для размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стеллажа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	**550*340*1490**	**19,0±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
2 Тележка дицинская	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стеллажа:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	4
С 5	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	4
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	16

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас), Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (поддоны);
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	19,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия купателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении равил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять рого по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С5** закрепить к четырем рамкам **Р1** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить четыре полки **П3,** внутрь рамки полки **Р 1.**
10.4 Стеллаж готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

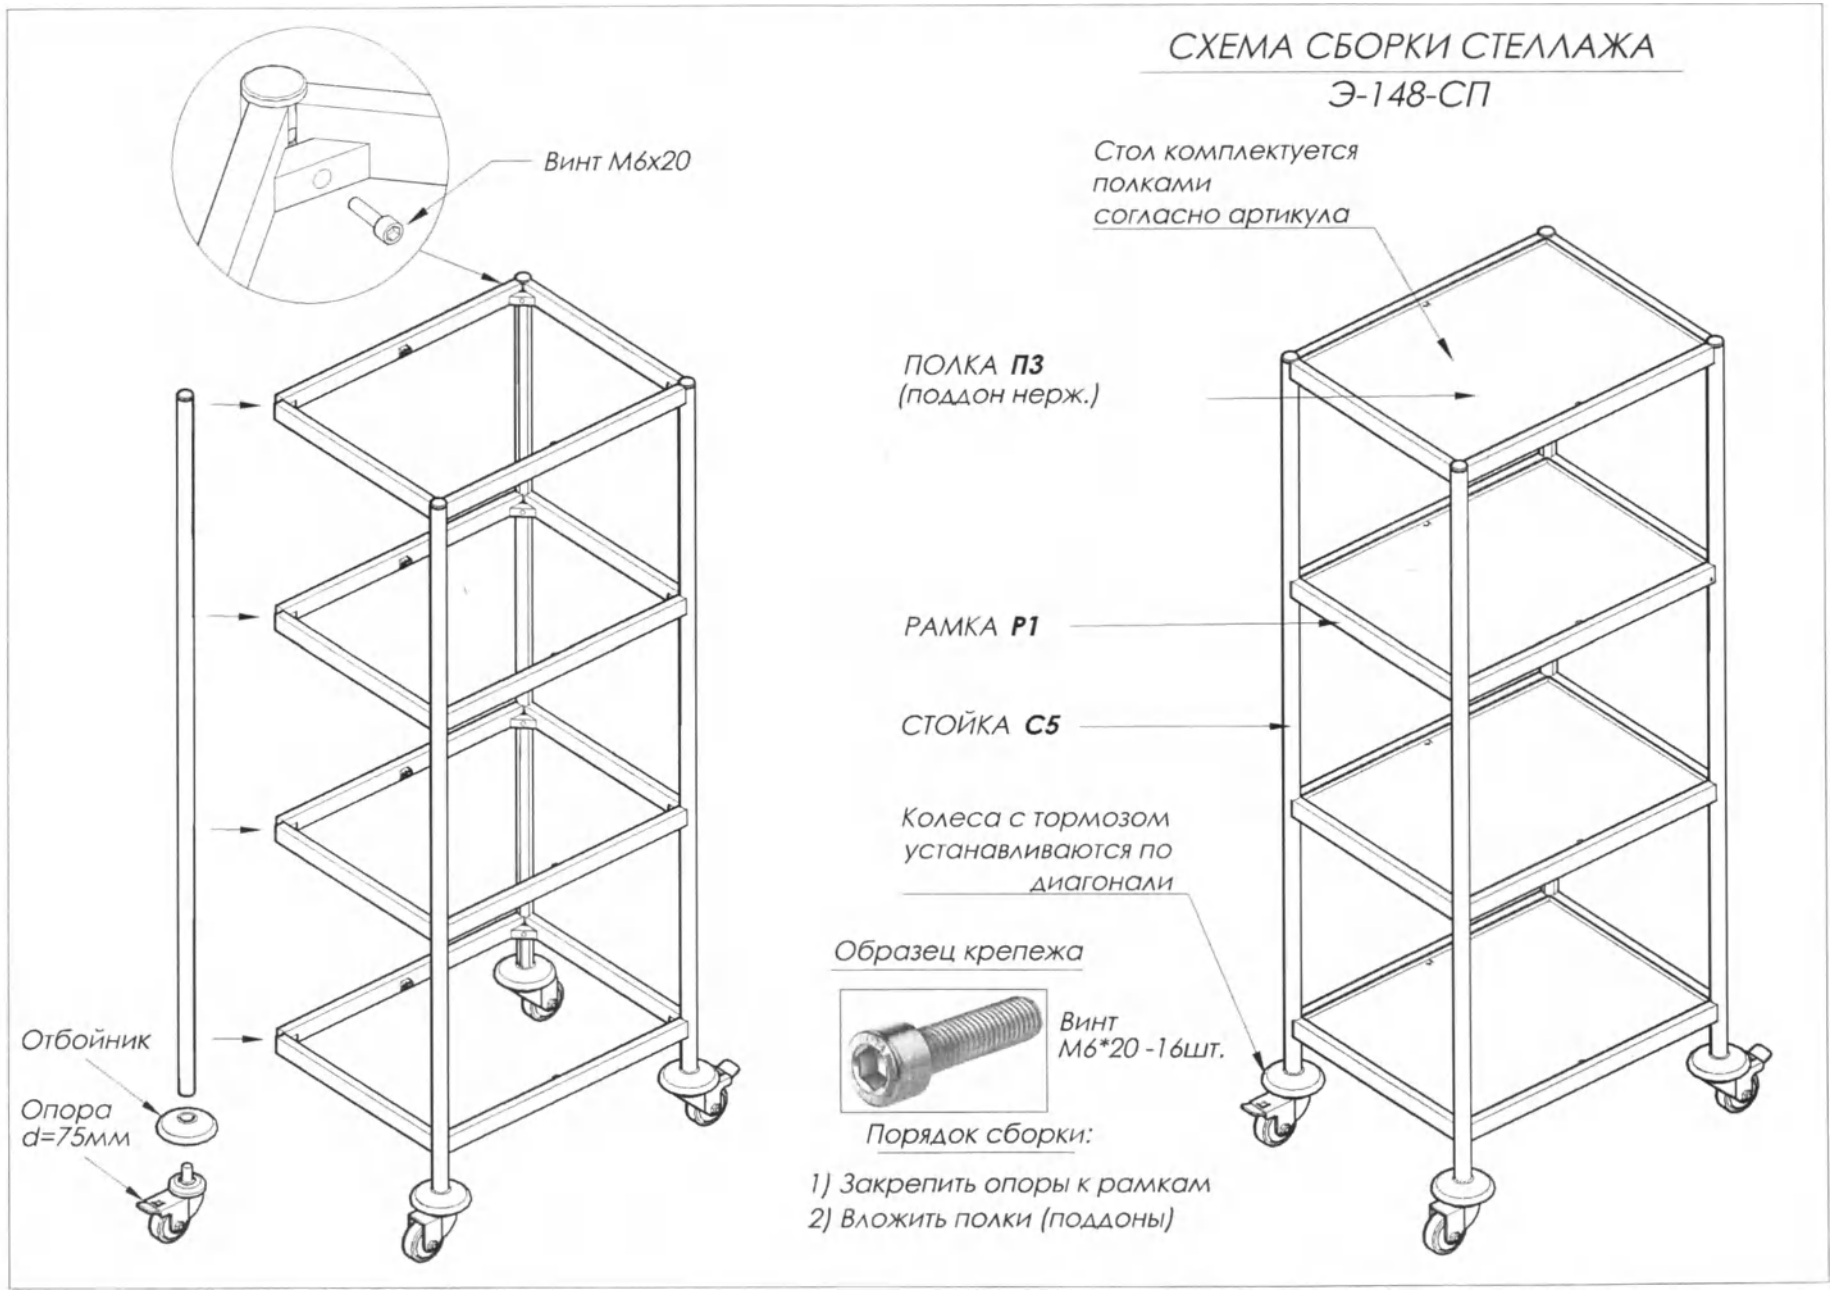

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стеллаж обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ›дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж передвижной медицинский Э-148-СП в количестве __________шт. принят в соответствии обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признан одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стеллаж передвижной медицинский Э-148-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин А.
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стеллаж передвижной медицинский Э-248-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стеллаж передвижной медицинский Э-248-СП** (далее – стеллаж). теллаж входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации подставки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стеллаж тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стеллаж предназначен для размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стеллажа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
редвижной дицинский				необходимости)	нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	**630*420*1490**	**22,0±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
Тележка дицинская	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
					ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка нфузионная я капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф едицинский еталлический хсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стеллажа:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р1	Рамка полки	4
К5	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	4
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	16

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (полки)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Допустимая нагрузка на конструкцию (не более), кг	60
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	22,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки стеллажа показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К5** закрепить к четырем рамкам **Р1** восемью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку **Р1** - полки **П3**.
10.4 Стеллаж готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ СТЕЛЛАЖЕЙ Э-248-СП

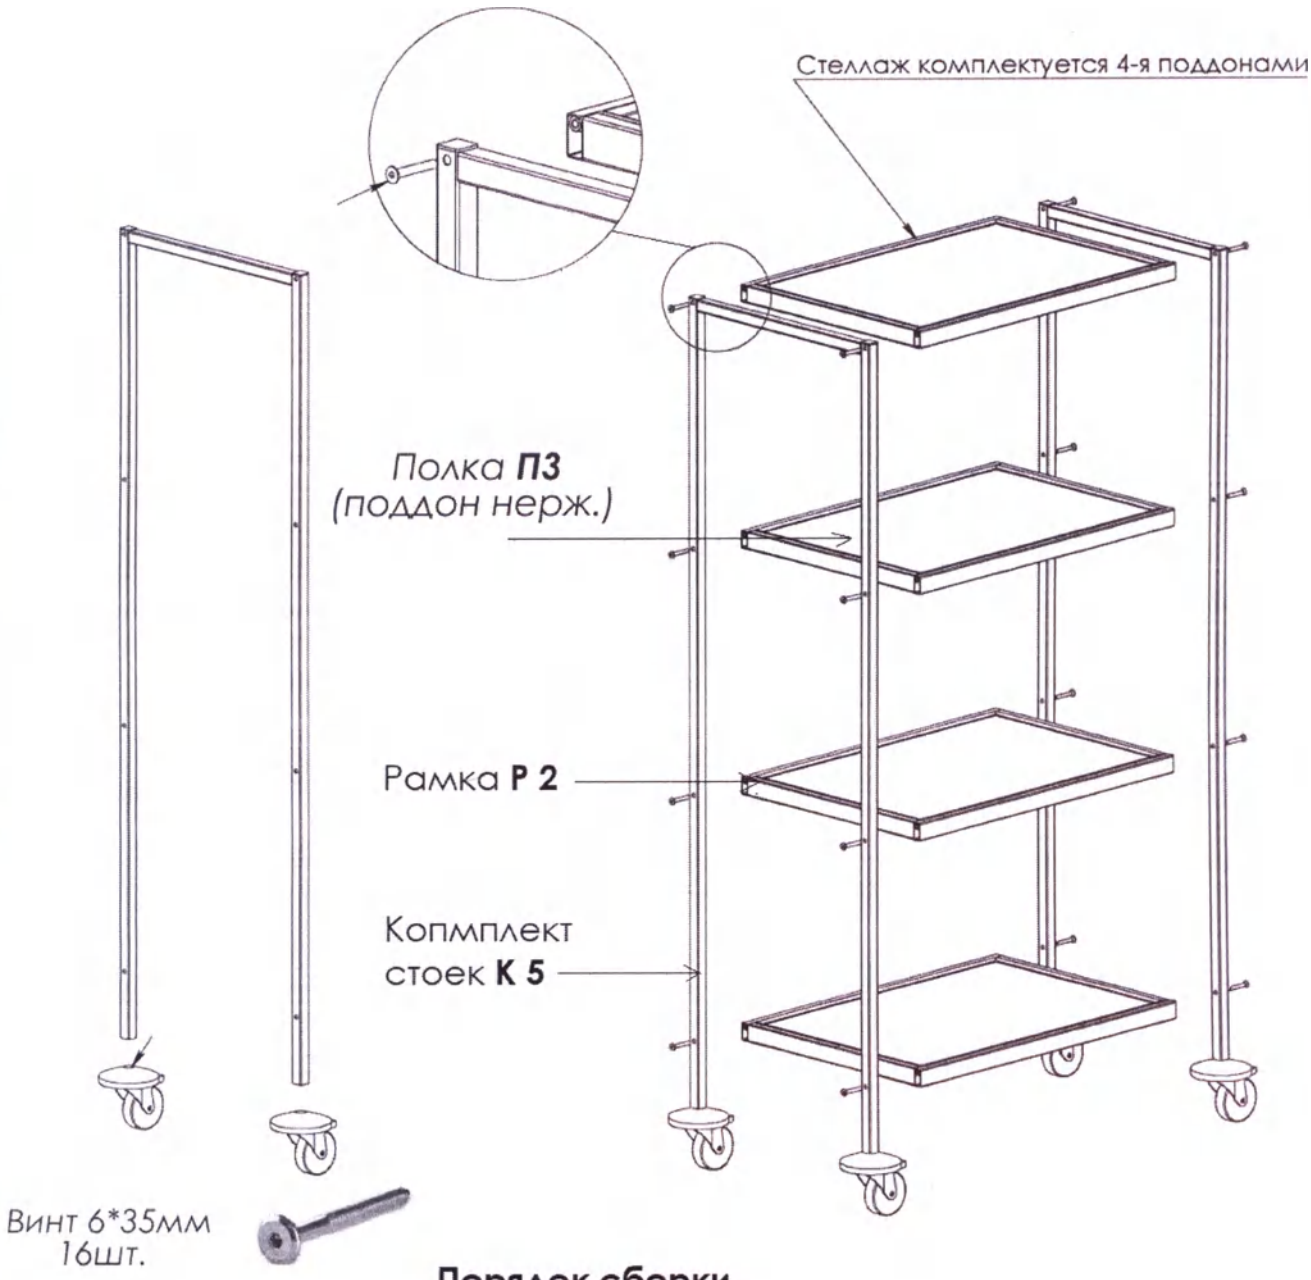

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стеллаж обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели іаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж передвижной медицинский Э-248-СП в количестве __________шт. принят в соответствии)бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признан дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стеллаж передвижной медицинский Э-248-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дроздин Э. А.**

«27» апреля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-040-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-040-СПЭ** (далее – тележка). Тележка одит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до)% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	**Э-040-СПЭ**	**630*430*830**	**9,2±0,5**	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р2	Рамка полки	2
К1	Стойка с колесными опорами	2
П2	Полка стеклянная	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	9,2±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к двум рамкам **Р2** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П2**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-040-СПЗ; Э-041-СПЗ; Э-041/Н-СПЗ; Э-042-СПЗ; Э-042/Н-СПЗ

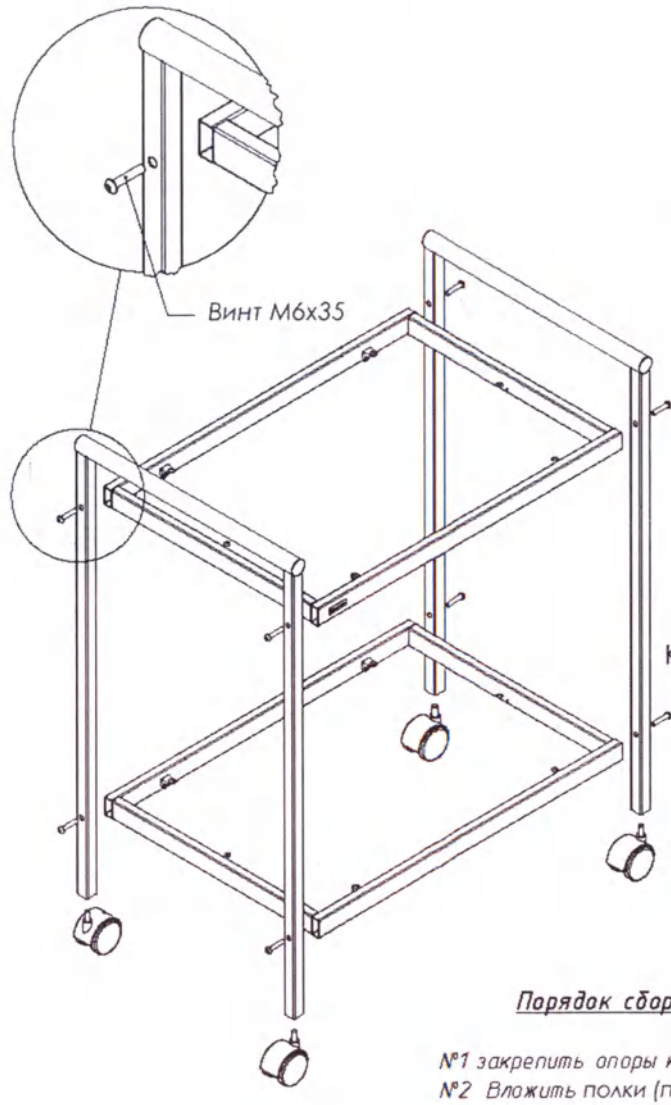

Полка П2(стекло)

Полка П3
(нерж поддон)

Полка П4
(поддон металл)

Рамка Р2

Комплект стоек К1

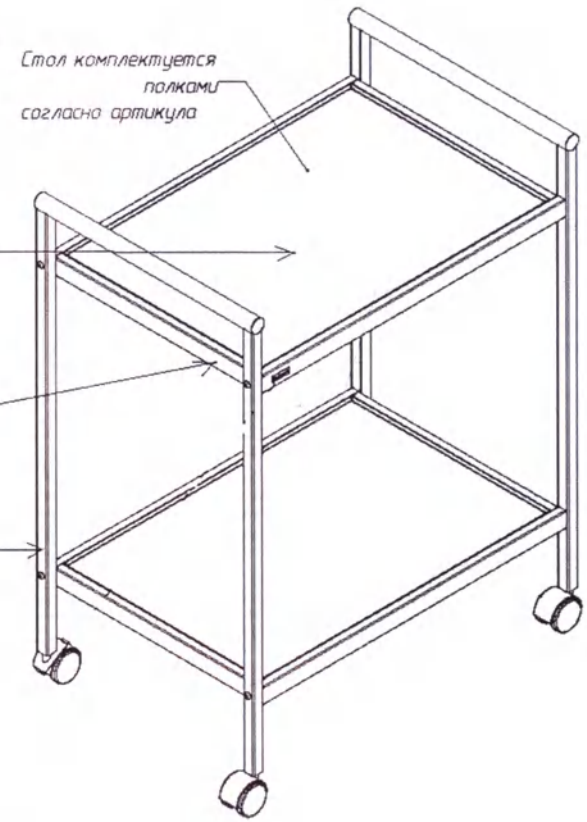

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-040-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-040-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20___ г.

Дата______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А.

« 27 » июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-041-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-041-СПЭ** (далее – тележка). Тележка одит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	**630*430*830**	**7,1±0,5**		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12.85±0.5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р2	Рамка полки	2
К1	Стойка с колесными опорами	2
П2	Полка стеклянная	1
П4	Полка (поддон металличесий)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
Масса нетто, кг	7,1±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к двум рамкам **Р2** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку – полки **П2 и П4**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-040-СПЗ; Э-041-СПЗ; Э-041/Н-СПЗ; Э-042-СПЗ; Э-042/Н-СПЗ

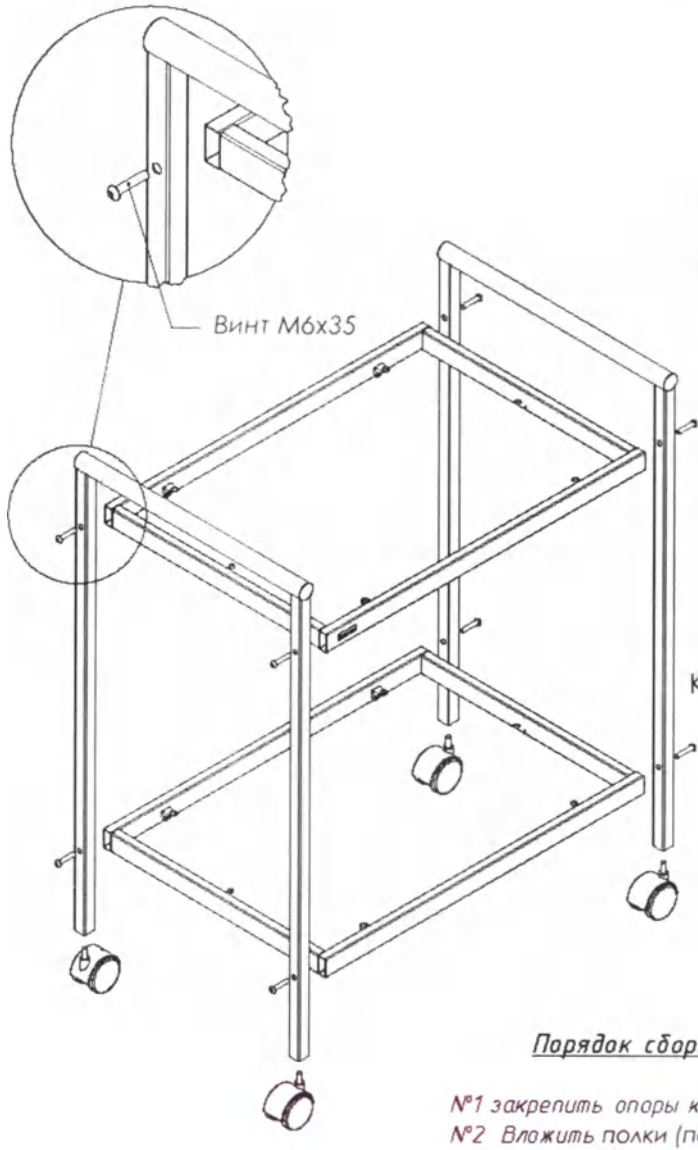

Полка П2(стекло)

Полка П3
(нерж поддон)

Полка П4
(поддон металл)

Рамка Р2

Комплект стоек К1

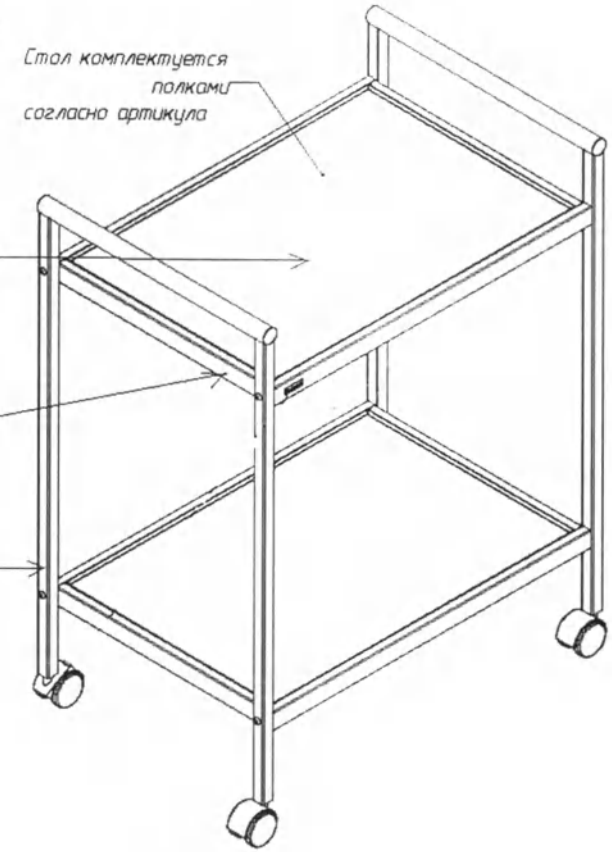

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-041-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-041-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А.
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-042-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-042-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	**630*430*830**	**9,6±0,5**		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
2.2 Тележка медицинская	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р2	Рамка полки	2
К1	Стойка с колесными опорами	2
П4	Полка (поддон металлический)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	9,6±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к двум рамкам **Р2** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П4**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-040-СПЗ; Э-041-СПЗ; Э-041/Н-СПЗ; Э-042-СПЗ; Э-042/Н-СПЗ

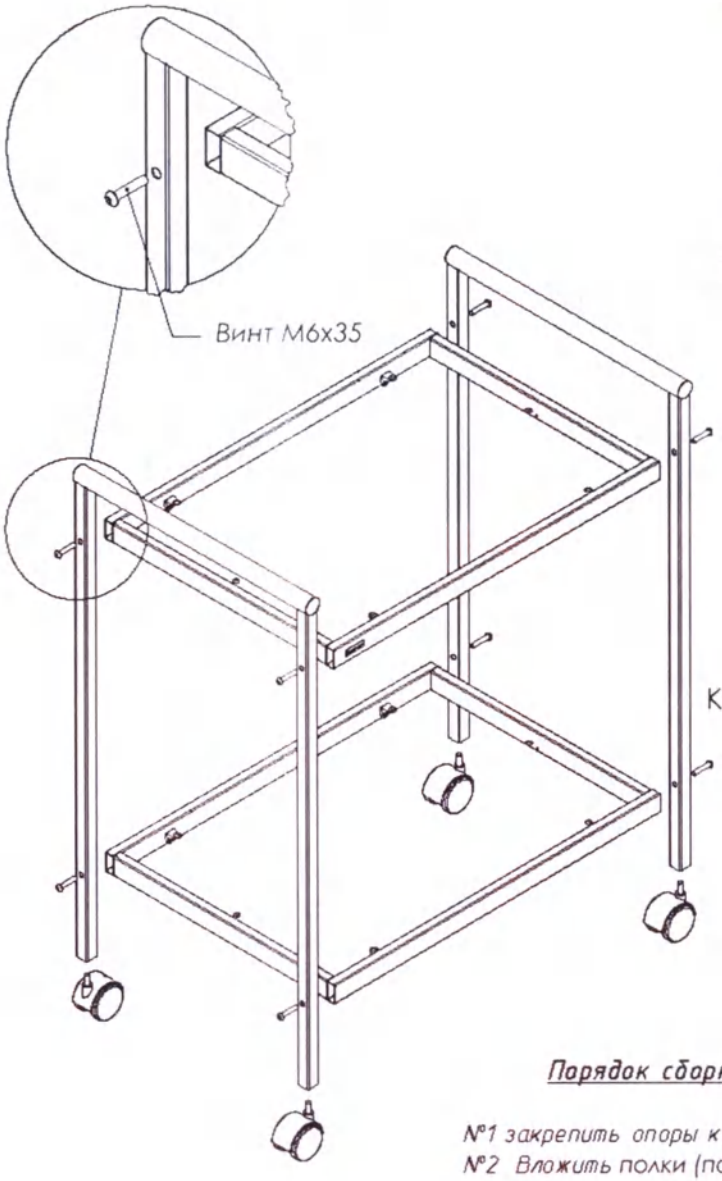

Полка П2(стекло)

Полка П3
(нерж поддон)

Полка П4
(поддон металл)

Рамка Р2

Комплект стоек К1

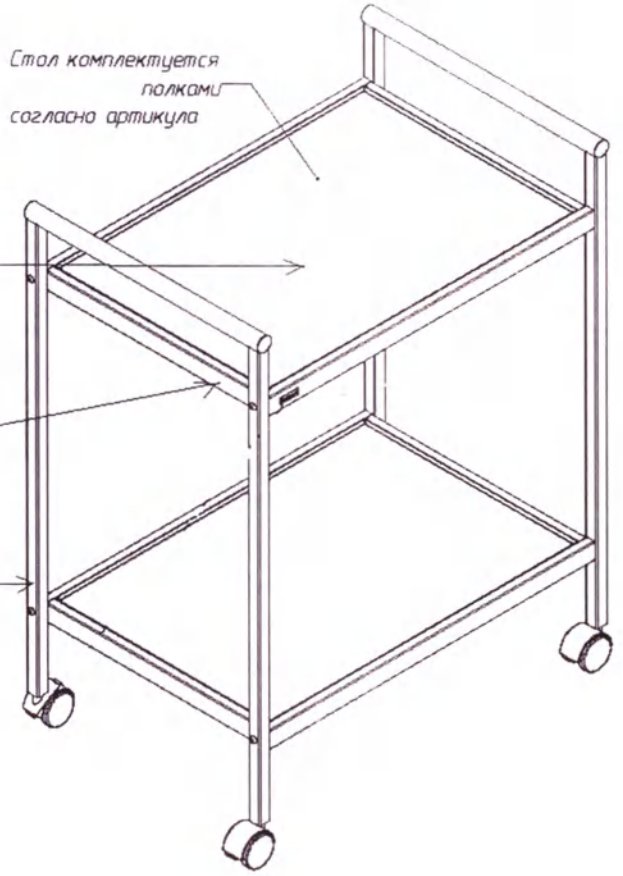

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-042-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-042-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

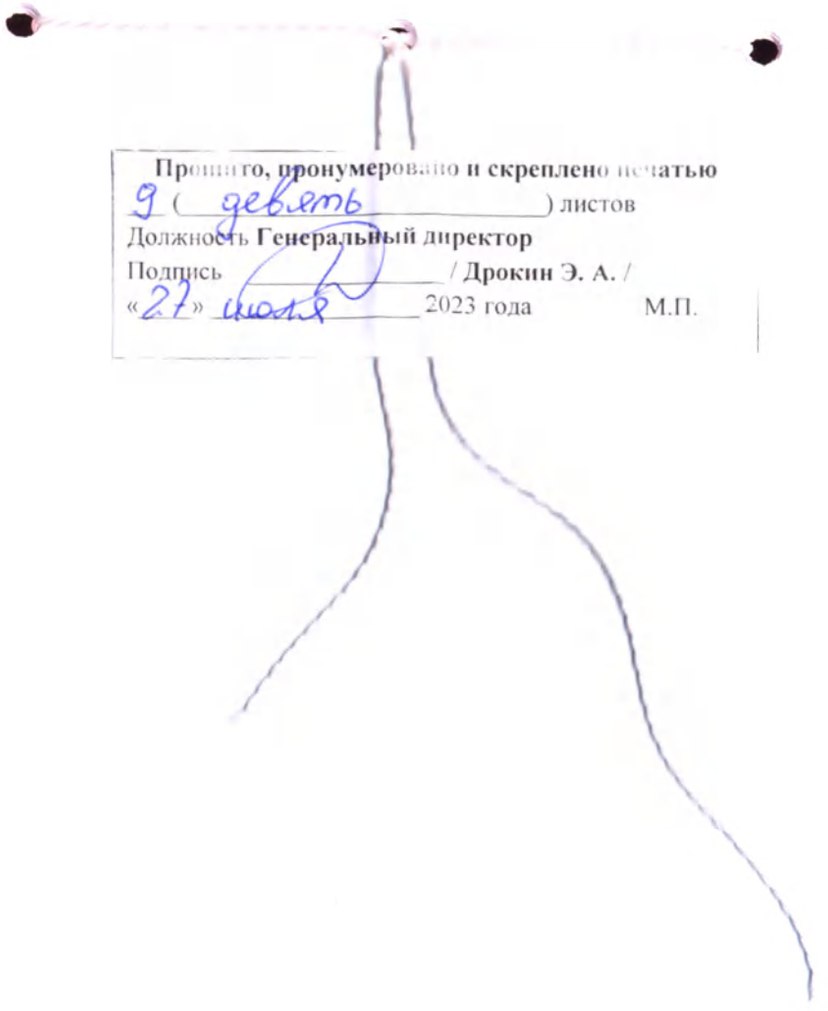
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-043-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-043-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
12 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	**630*430*830**	**12,4±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р2	Рамка полки	3
К1	Стойка с колесными опорами	2
П2	Полка стеклянная	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
Масса нетто, кг	12,4±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к трем рамкам **Р2** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П2**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-043-СПЭ, Э-044-СПЭ, Э-044/Н-СПЭ, Э-045-СПЭ, Э-045/Н-СПЭ, Э-046-СПЭ, Э-046/Н-СПЭ

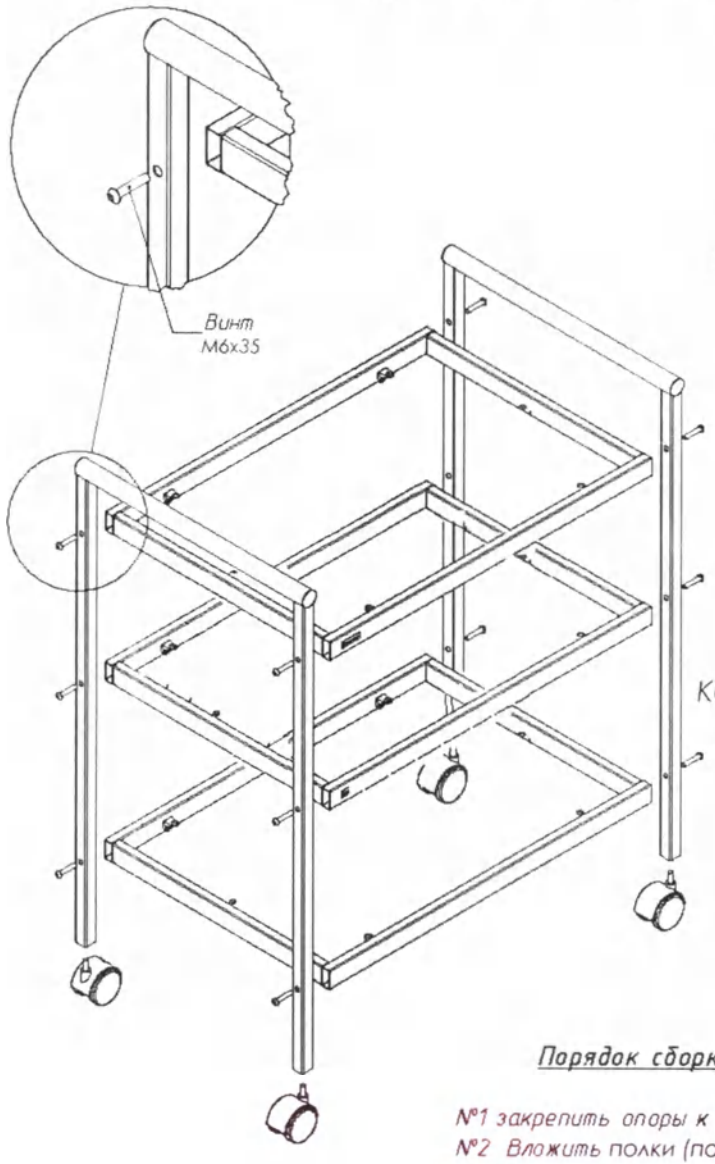

Полка П2(стекло)

Полка П3
(нерж поддон)

Полка П4
(поддон металл)

Рамка Р2

Комплект стоек К1

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-043-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-043-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-044-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-044-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
22 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	**630*430*830**	**11,7±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р2	Рамка полки	3
К1	Стойка с колесными опорами	2
П2	Полка стеклянная	2
П4	Полка (поддон металлический)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	11,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к трем рамкам **Р2** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П2 и П4**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-043-СПЭ, Э-044-СПЭ, Э-044/Н-СПЭ, Э-045-СПЭ, Э-045/Н-СПЭ, Э-046-СПЭ, Э-046/Н-СПЭ

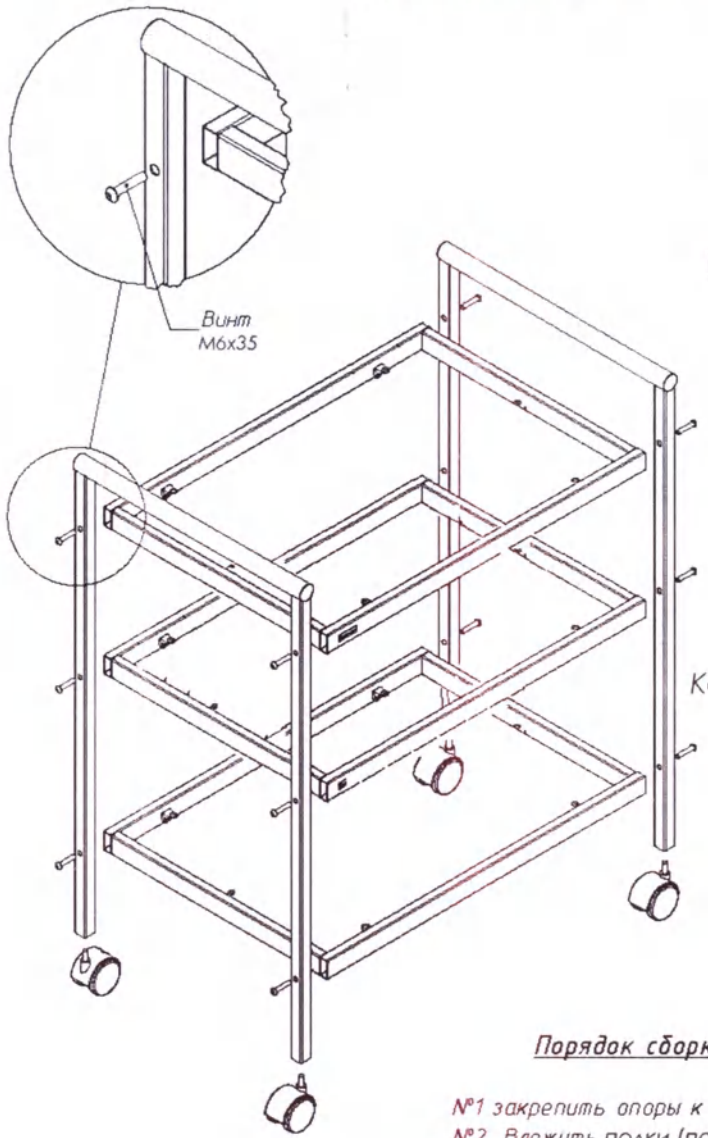

Полка П2(стекло)

Полка П3
(нерж поддон)

Полка П4
(поддон металл)

Рамка Р2

Комплект стоек К1

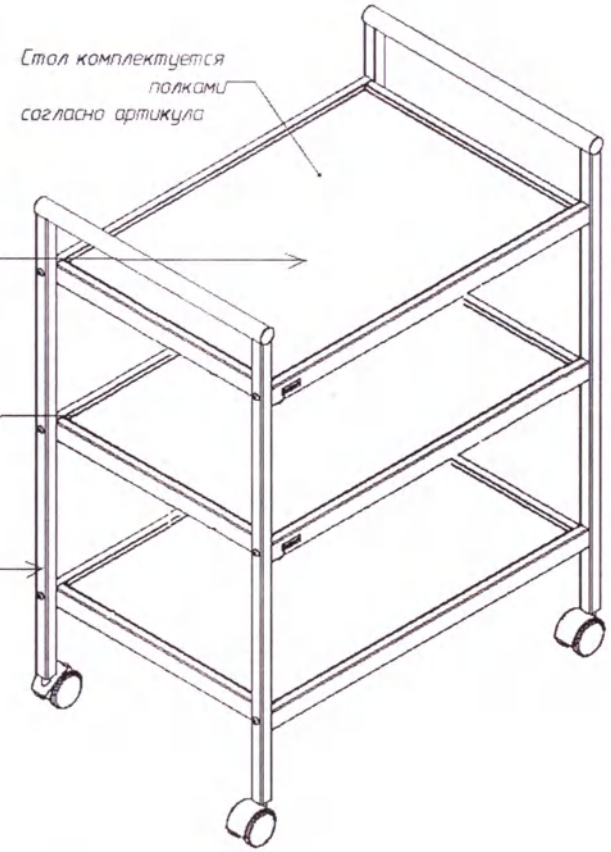

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-044-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-044-СПЭ
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

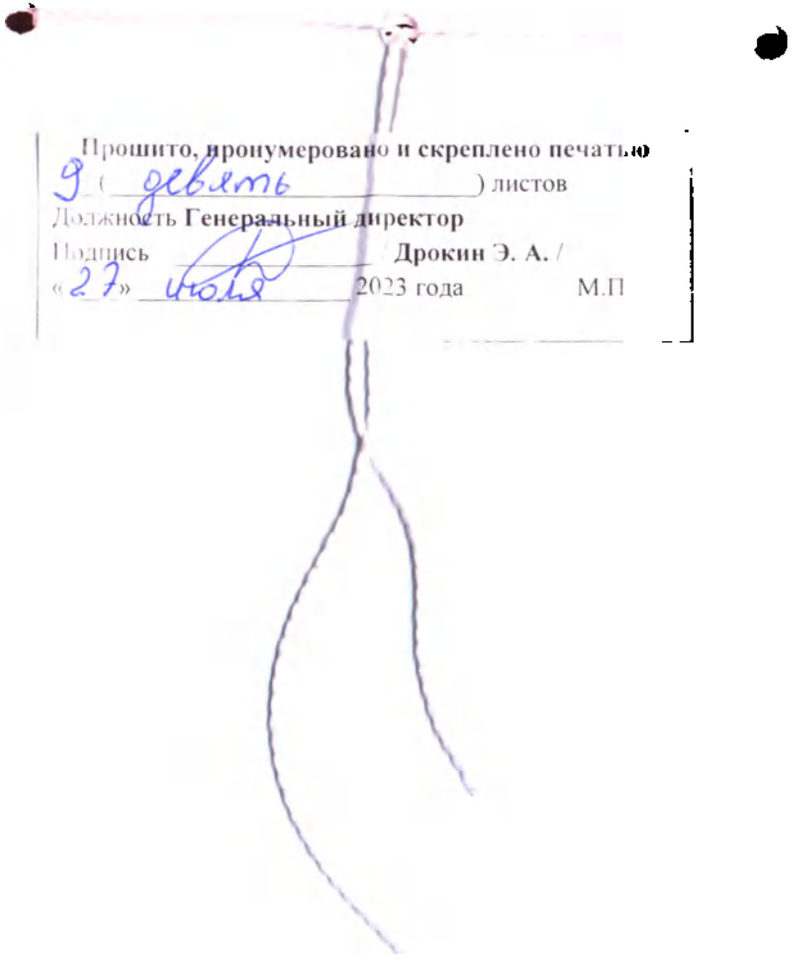
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-045-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-045-СПЭ** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
12 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	**630*430*830**	**12±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р2	Рамка полки	3
К1	Стойка с колесными опорами	2
П2	Полка стеклянная	1
П4	Полка (поддон металический)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка, поддоны)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	12,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к трем рамкам **Р2** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П2 и П4**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-043-СПЭ, Э-044-СПЭ, Э-044/Н-СПЭ, Э-045-СПЭ, Э-045/Н-СПЭ, Э-046-СПЭ, Э-046/Н-СПЭ

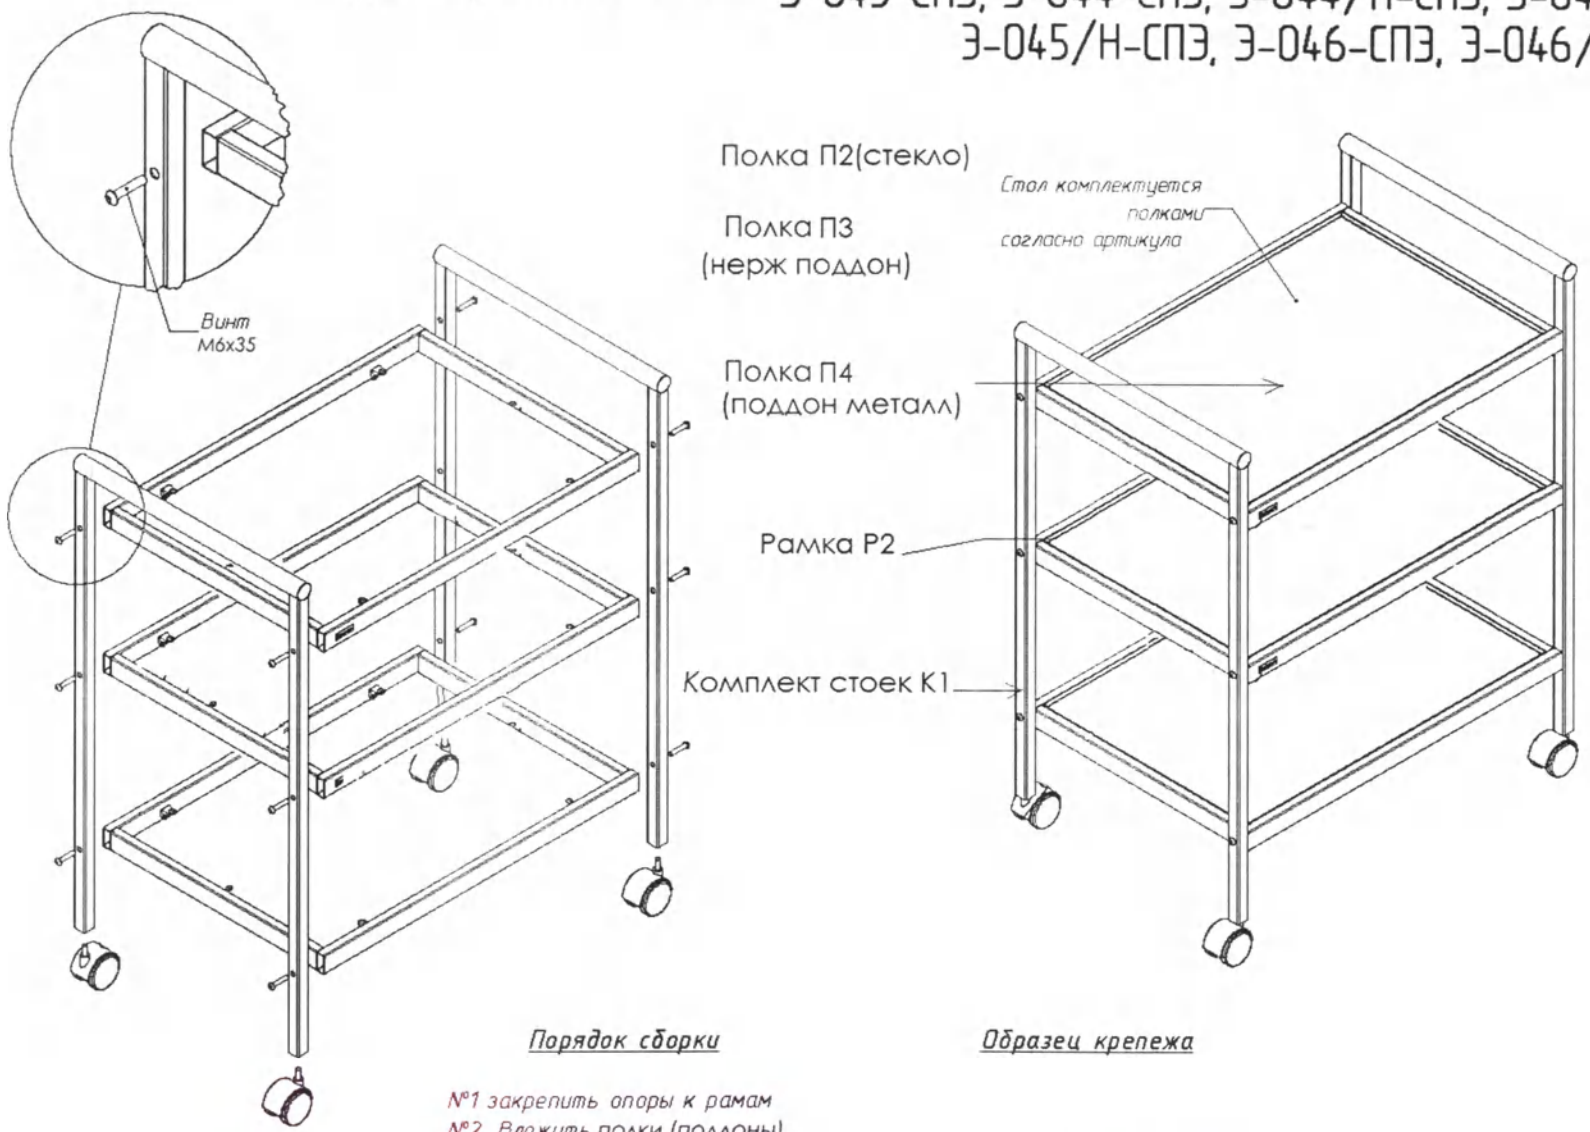

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ш изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели иделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-045-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-045-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-046-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-046-СПЭ** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	**630*430*830**	**10,6±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
22 Тележка медицинская	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р2	Рамка полки	3
К1	Стойка с колесными опорами	2
П4	Полка (поддон металлический)	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	10,6±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к трем рамкам **Р2** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П4**
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

Для моделей тележек Э-043-СПЭ, Э-044-СПЭ, Э-044/Н-СПЭ, Э-045-СПЭ, Э-045/Н-СПЭ, Э-046-СПЭ, Э-046/Н-СПЭ

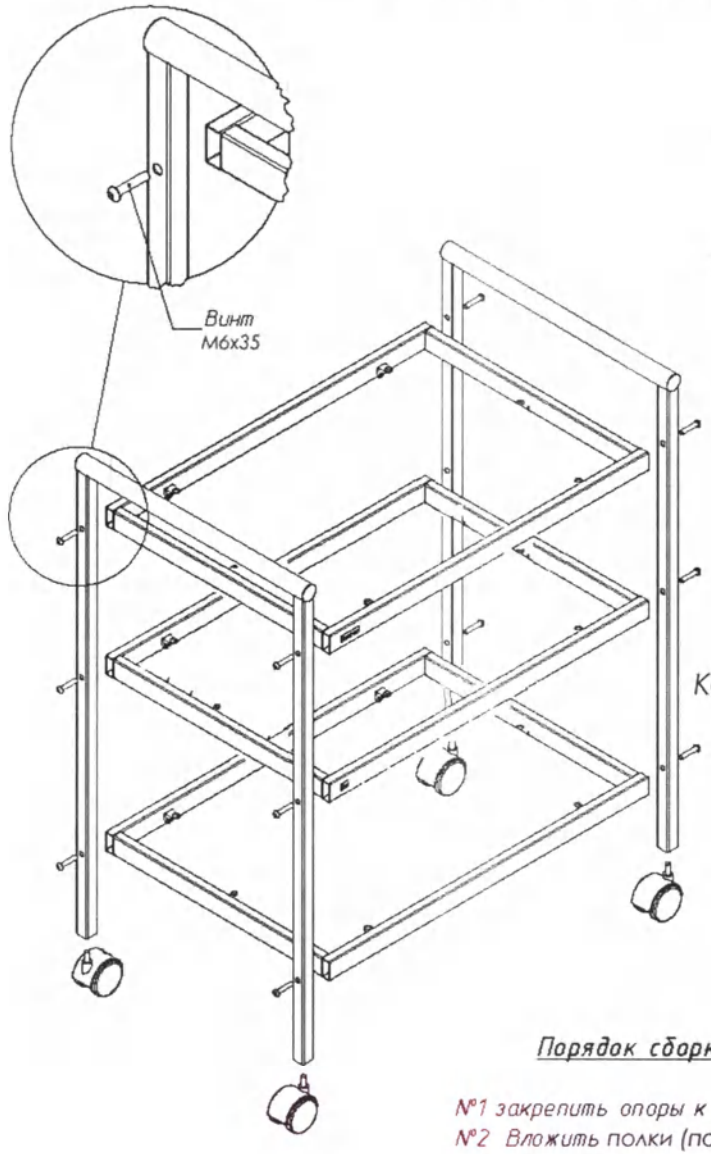

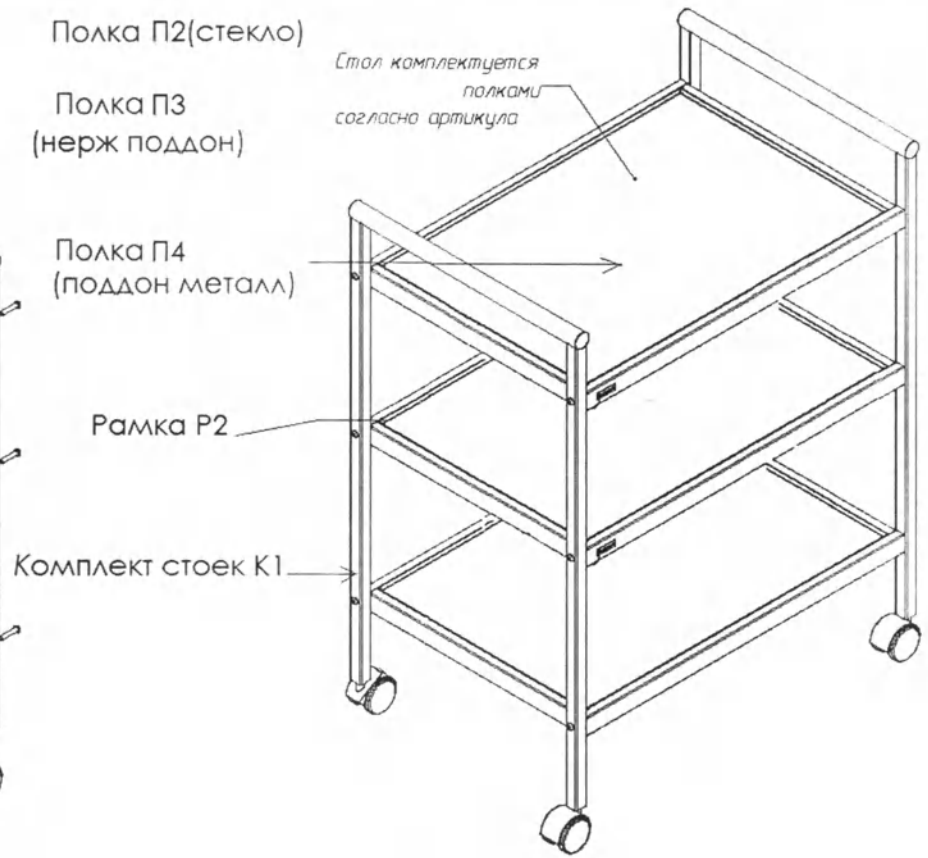

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ідорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ш изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели іаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических іециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-046-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-046-СПЭ
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

« 27 » июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047-СПЭ** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	**630*430*830**	**17,7±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р2	Рамка полки	1
С1	Стойка с колесными опорами	2
П4	Полка (поддон металлический)	1
Р3	Рамка с блоком ящика	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки, ящик	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной,
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	17,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек К**1** закрепить к рамкам **Р3**, и **Р2** - четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П 4,** внутрь рамки **Р3 и Р2**,
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

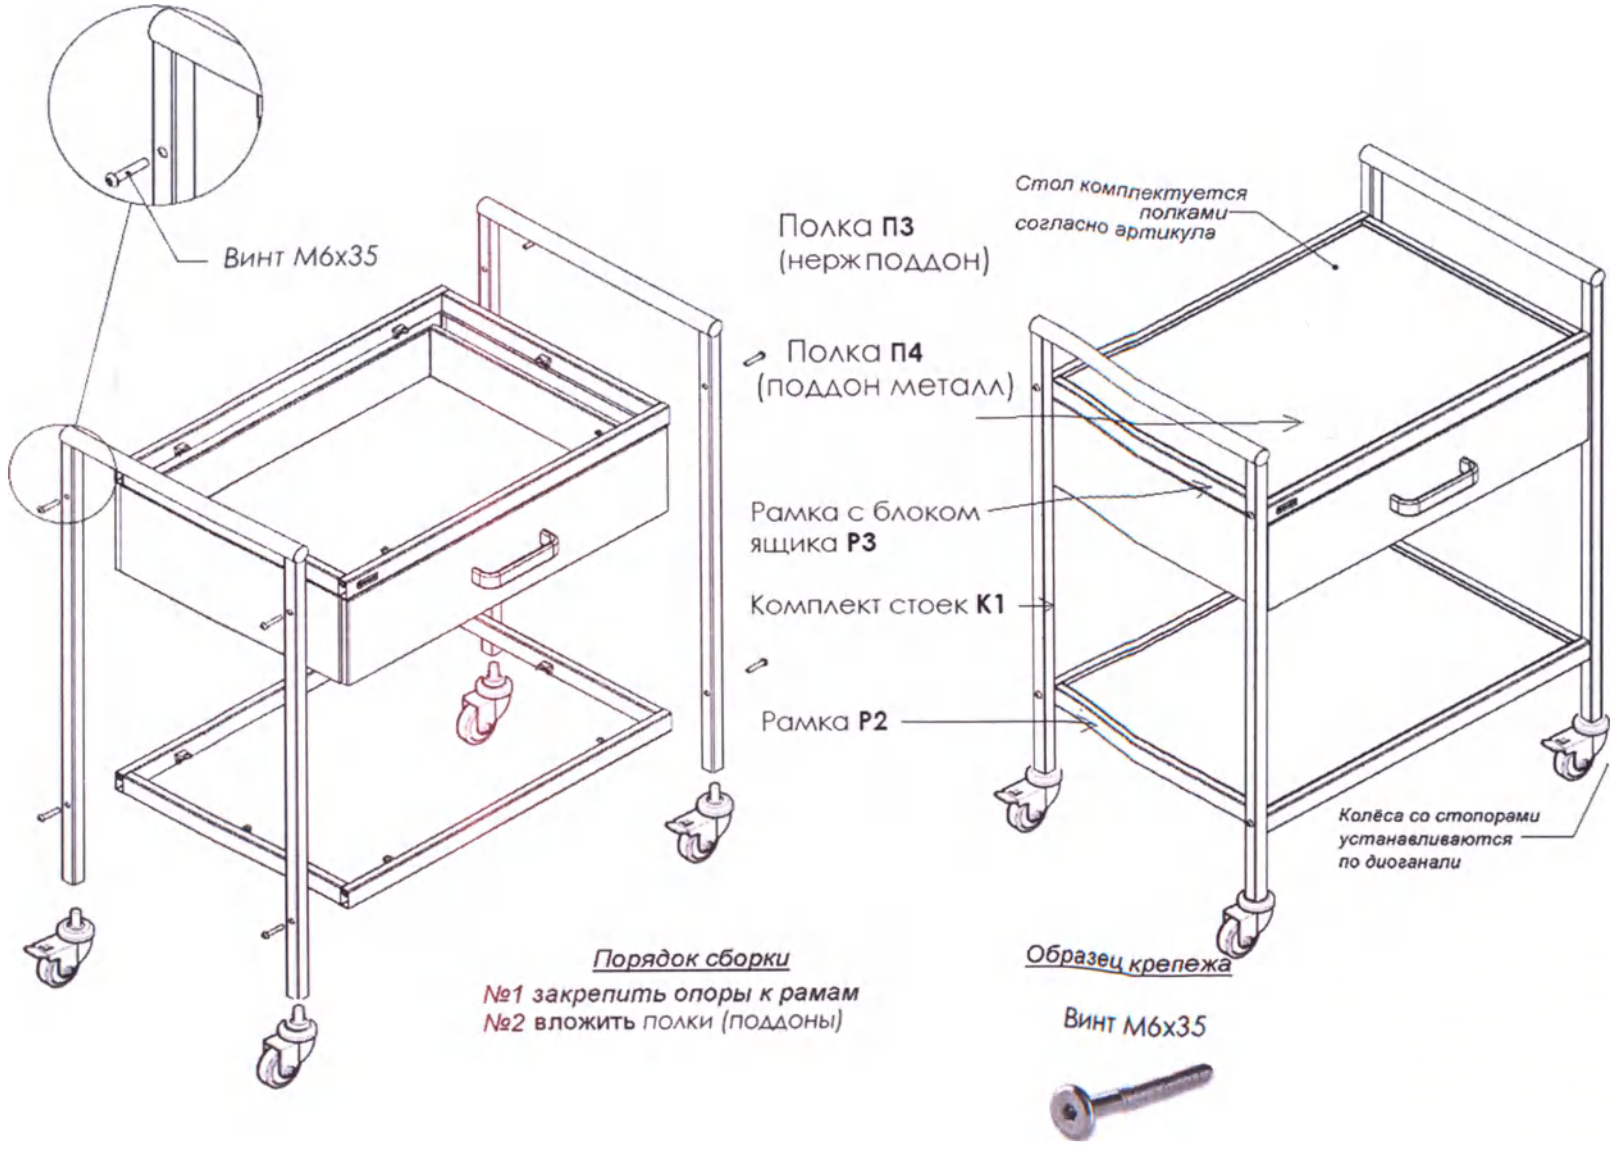

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу отходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке или изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ТУ, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо изделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели владелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической помощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических специалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец берет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047-СПЭ

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

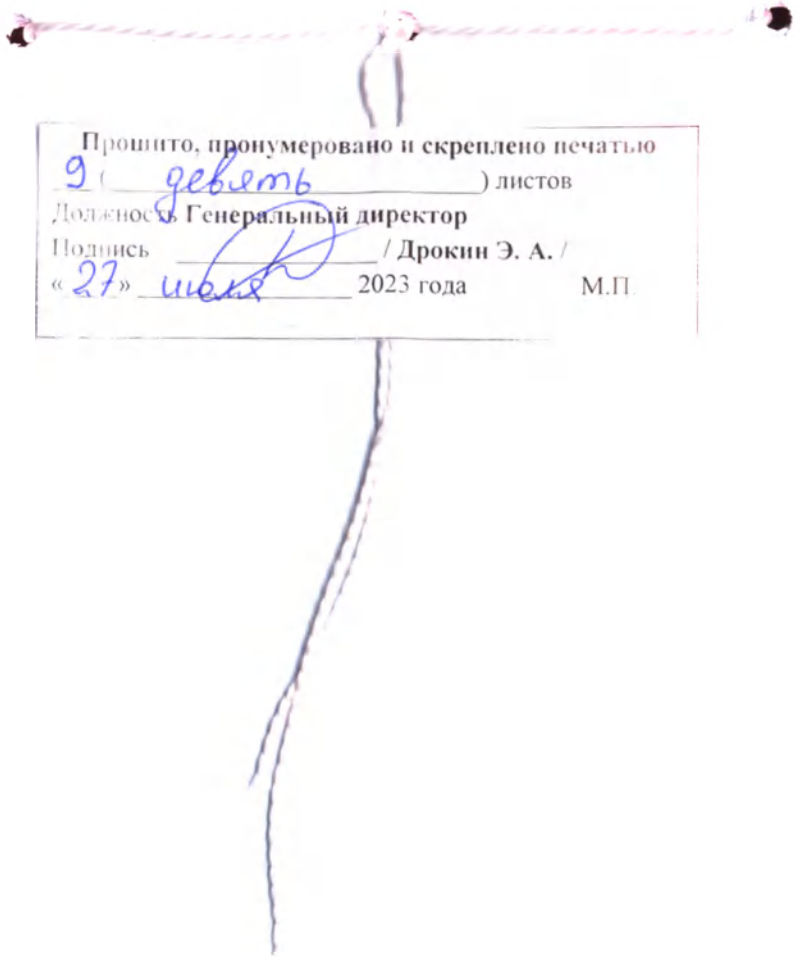
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/2-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/2-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	**630*430*830**	**26,1±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р2	Рамка полки	1
К3	Стойка с колесными опорами	2
П4	Полка (поддон металлический)	2
Р3	Рамка с блоком ящика	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки, ящики	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	26,1±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К3** закрепить к рамкам **Р3**, и **Р2** – шестью винтами .
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П 4,** внутрь рамки **Р3 и Р2**,
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

Э-047/2-СПЭ; Э-047/2/Н-СПЭ

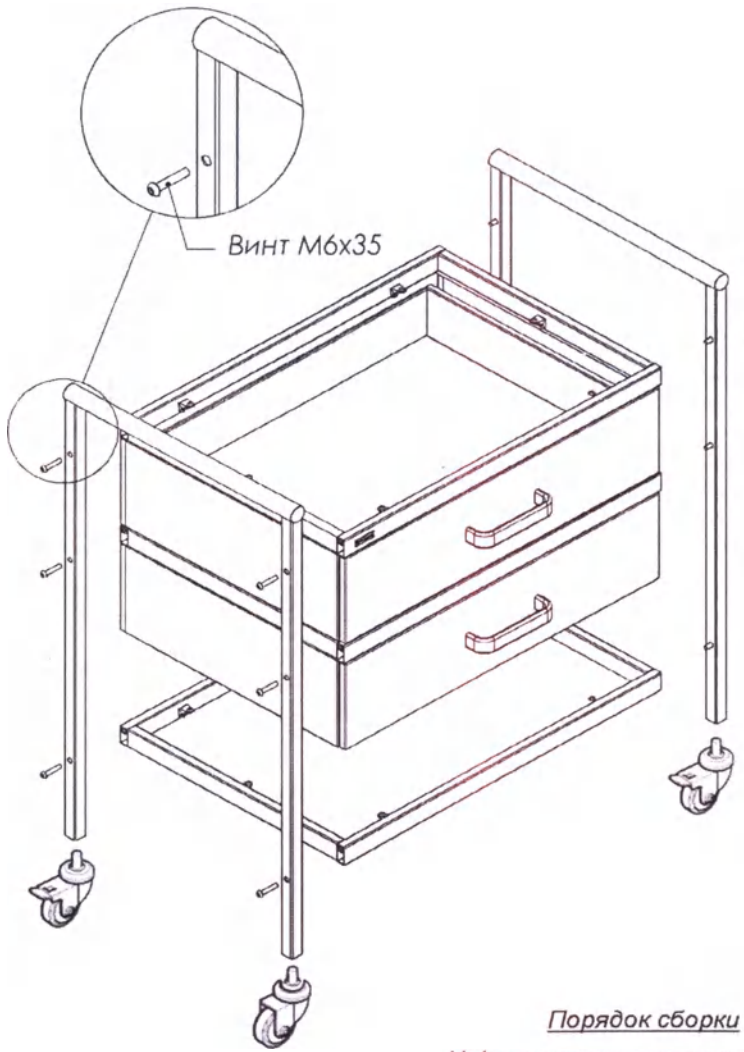

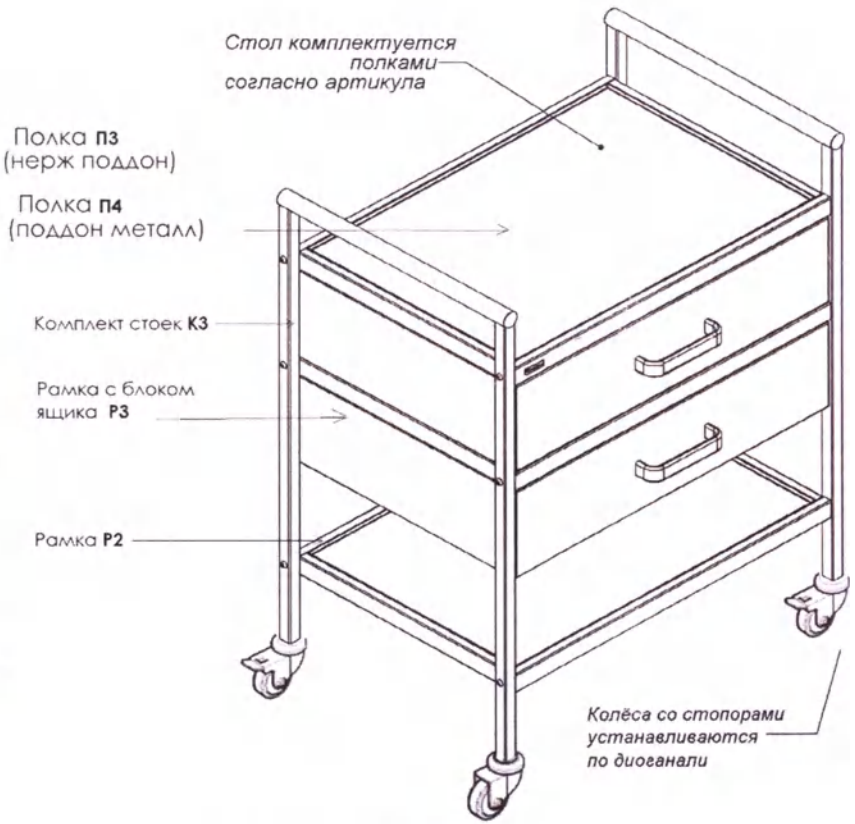

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 **вложить** *полки (поддоны)*

Образец крепежа

Винт М6х35

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/2-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047/2-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

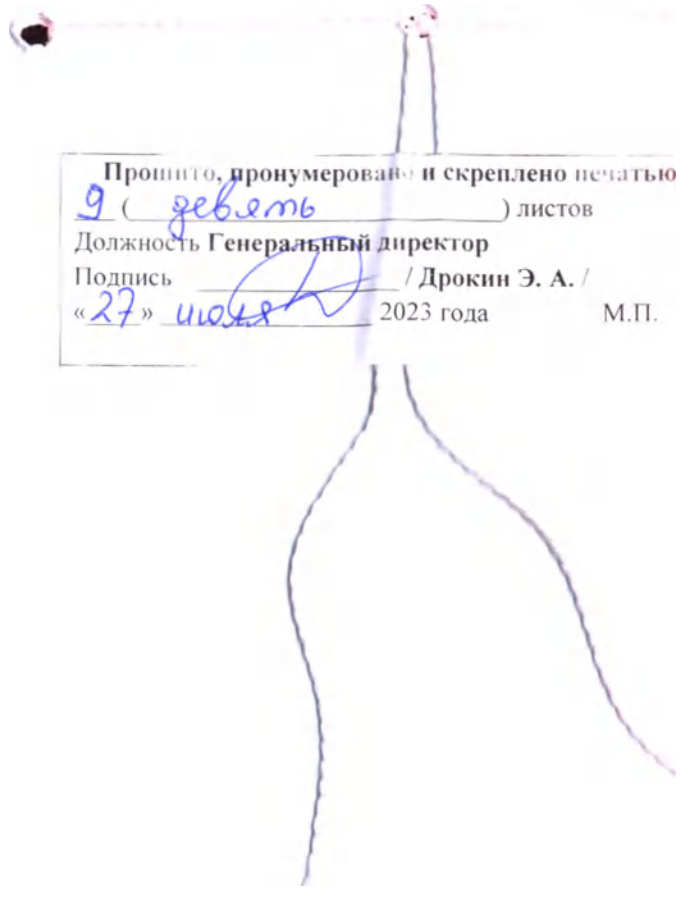
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/3-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/3-СПЭ** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-12494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	**630*430*830**	**34,5±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
К4	Стойка с колесными опорами	2
П4	Полка (поддон металлический)	1
Р3	Рамка с блоком ящика	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полка	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	34,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек К**4** закрепить к рамкам **Р3** – шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полку **П 4** внутрь рамки **Р3.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Э-047/3-СПЭ; Э-047/3/Н-СПЭ

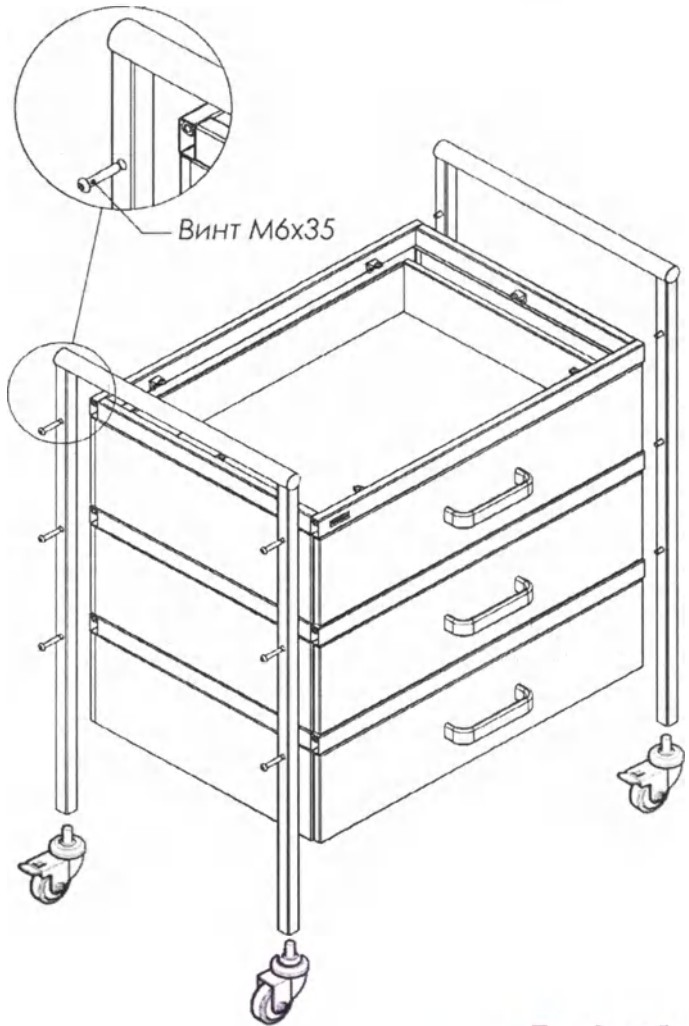

Полка **П3**
(нерж поддон)

Полка **П4**
(поддон металл)

Комплект стоек **К4**

Рамка с блоком
ящика **Р3**

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ии изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели заделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических иециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/3-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047/3-СПЭ
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-041/Н-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-041/Н-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	**630*430*830**	**7,2±0,5**		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р2	Рамка полки	2
К1	Стойка с колесными опорами	2
П2	Полка стеклянная	1
П3	Полка (поддон нержавеющий)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	7,2±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к двум рамкам **Р2** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку – полки **П2** и **П3.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-040-СПЗ; Э-041-СПЗ; Э-041/Н-СПЗ; Э-042-СПЗ; Э-042/Н-СПЗ

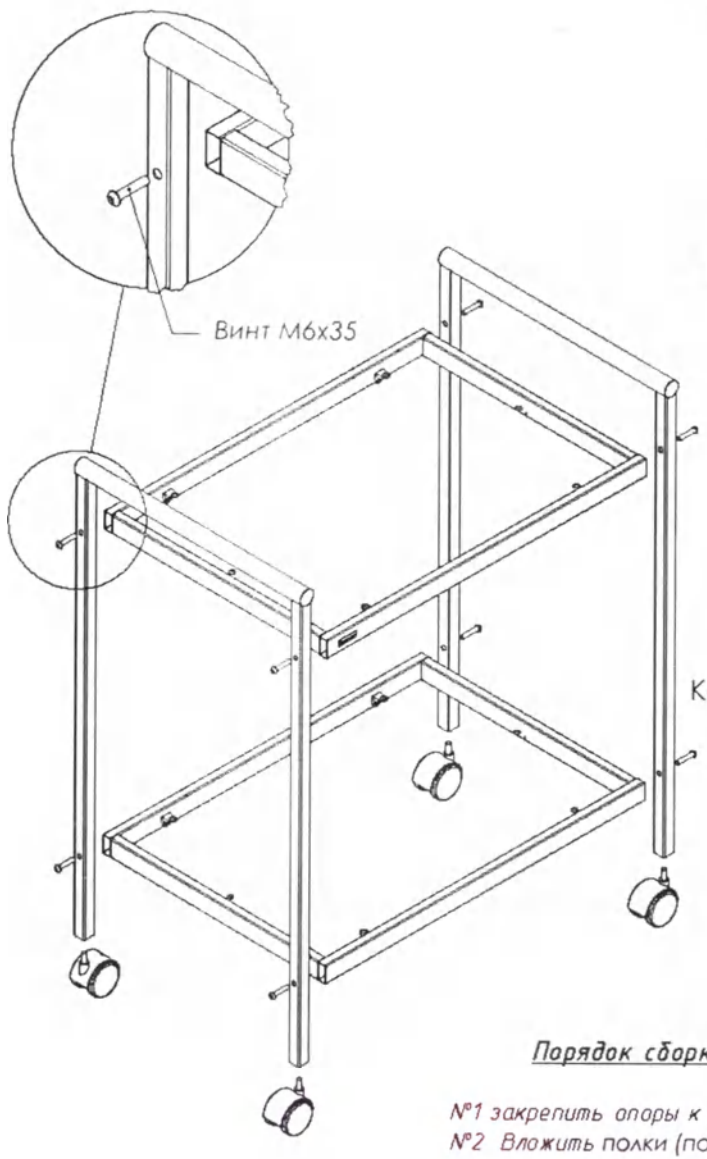

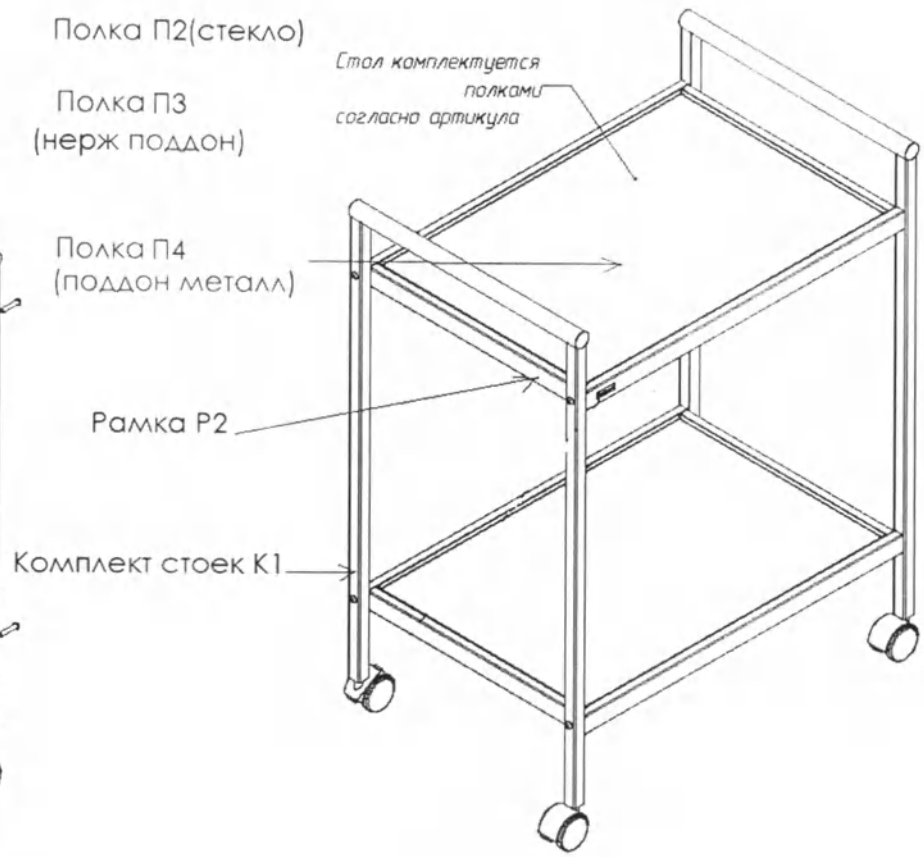

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-041/Н-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-041/Н-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А.
« 27 » июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-042/Н-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-042/Н-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	**630*430*830**	**9,7±0,5**		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
2 Тележка едицинская	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р2	Рамка полки	2
К1	Стойка с колесными опорами	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойки)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	9,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к двум рамкам **Р2** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - поддон **П3**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-040-СПЗ; Э-041-СПЗ; Э-041/Н-СПЗ; Э-042-СПЗ; Э-042/Н-СПЗ

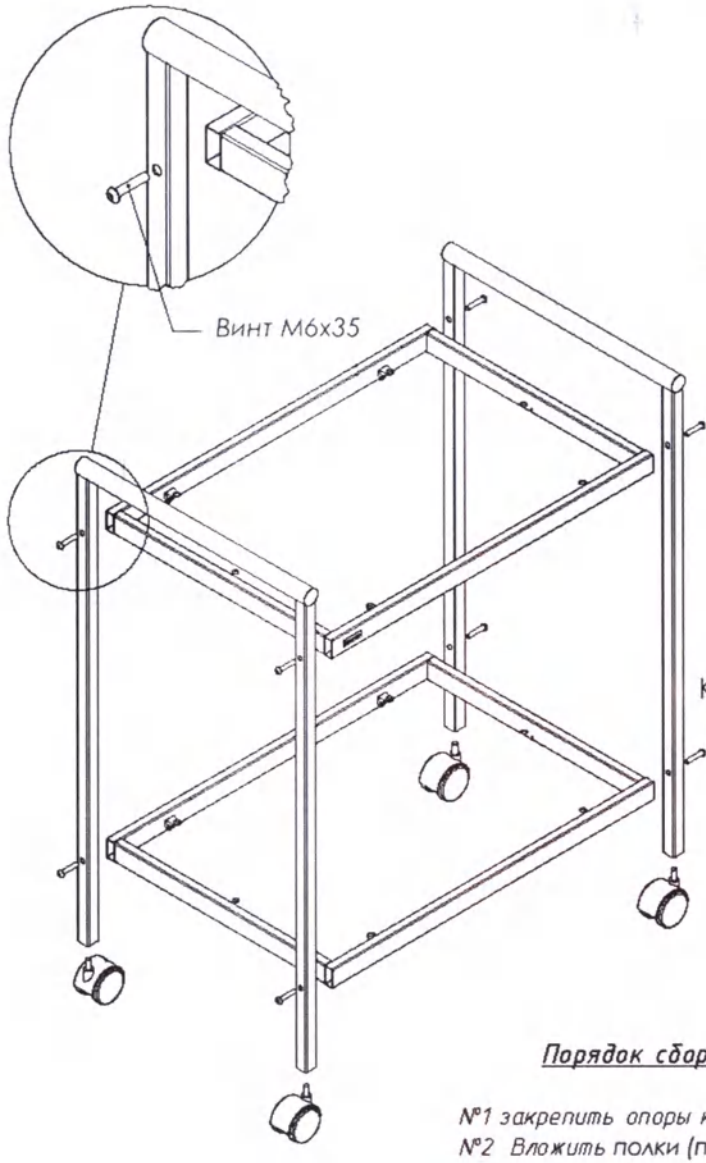

Полка П2(стекло)

Полка П3
(нерж поддон)

Полка П4
(поддон металл)

Рамка Р2

Комплект стоек К1

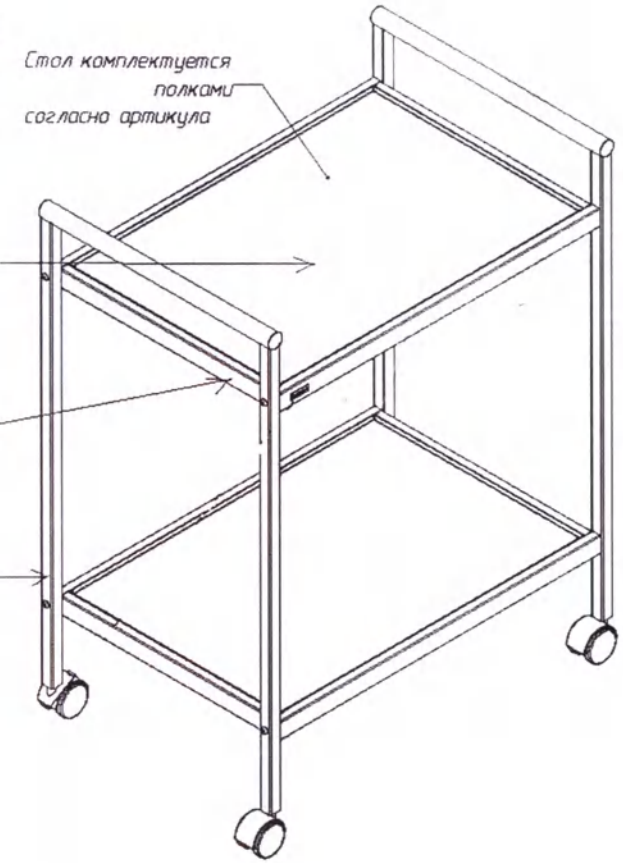

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ідорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при ззинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие біразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации ззвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели іаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических іециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец зрет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-042/Н-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-042/Н-СПЭ

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

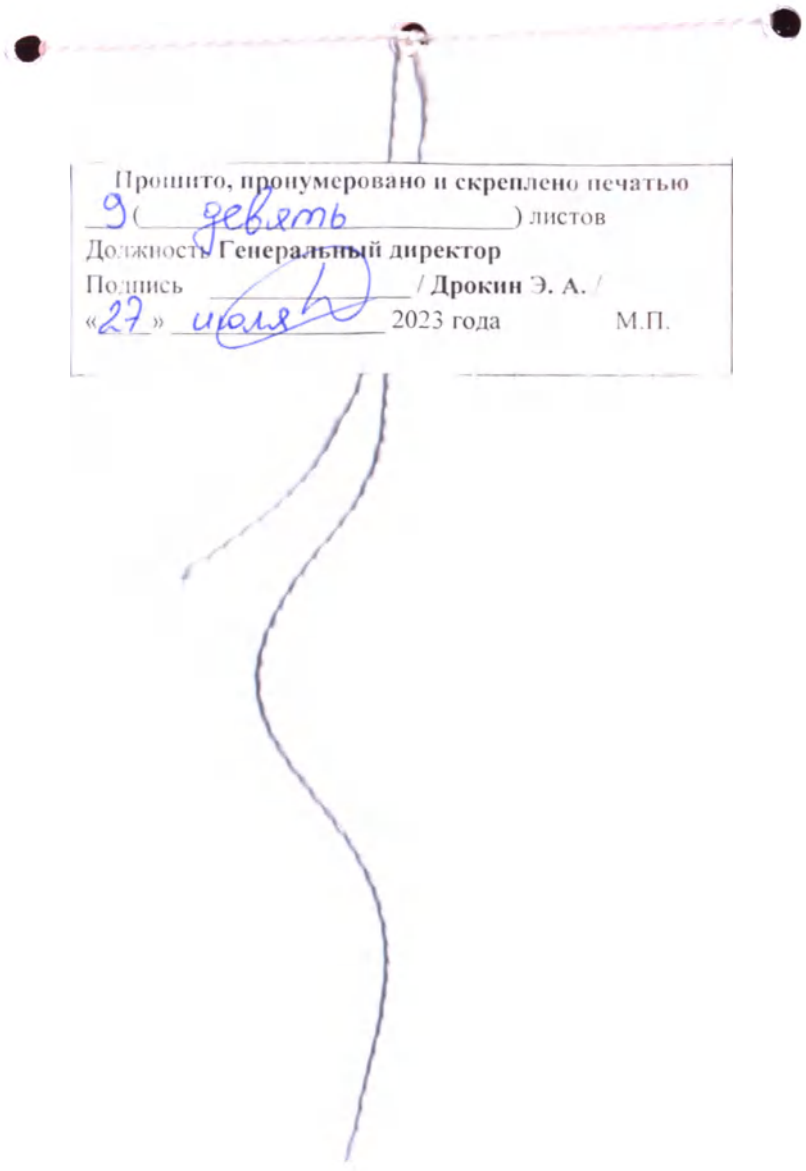
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-044/Н-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-044/Н-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
2 Тележка едицинская	**Э-044/Н-СПЭ**	**630*430*830**	**11,8±0,5**	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р2	Рамка полки	3
К1	Стойка с колесными опорами	2
П2	Полка стеклянная	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	11,8±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к трем рамкам **Р2** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П2**. и **П3**
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-043-СПЭ, Э-044-СПЭ, Э-044/Н-СПЭ, Э-045-СПЭ, Э-045/Н-СПЭ, Э-046-СПЭ, Э-046/Н-СПЭ

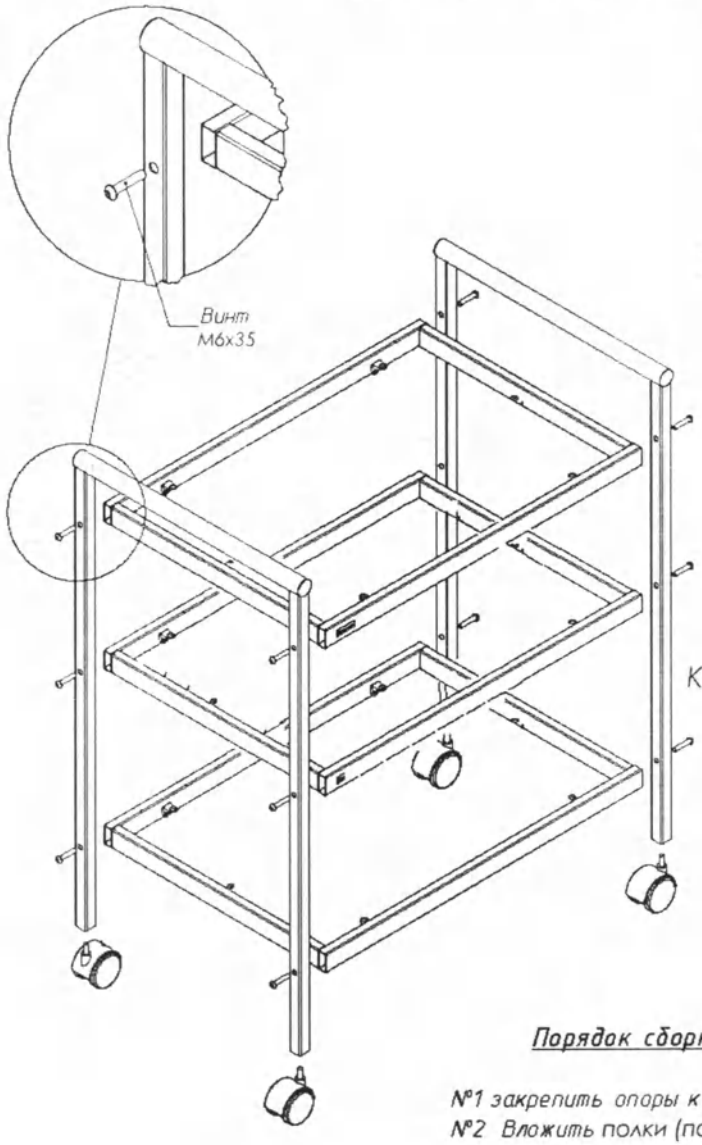

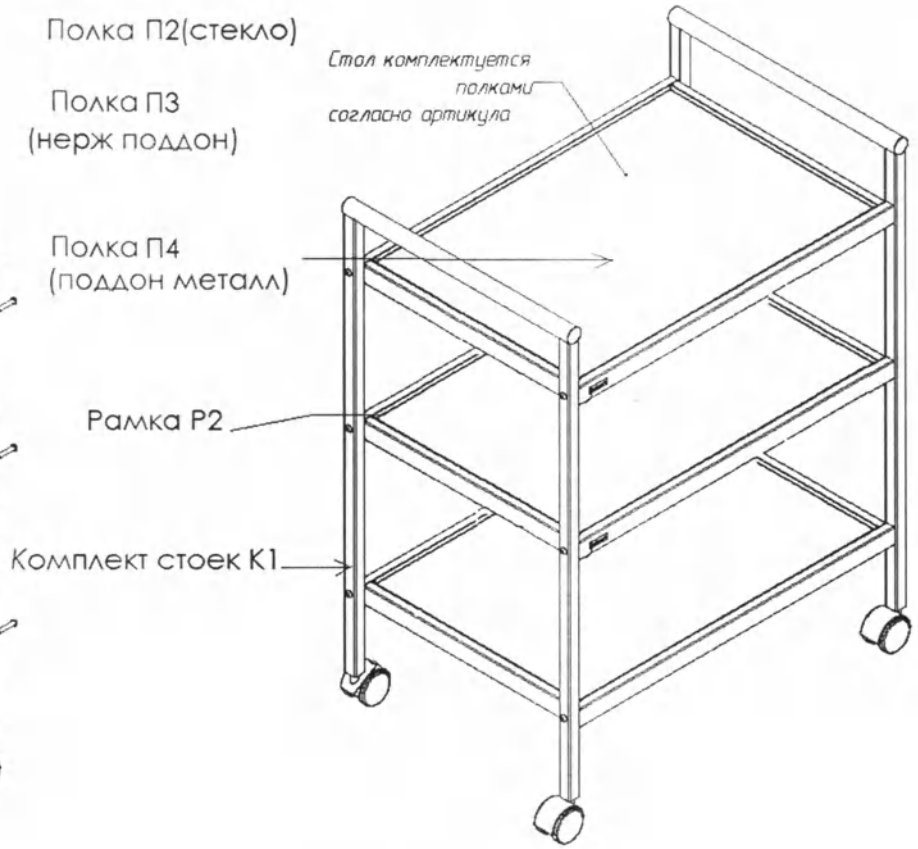

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ıи изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ıаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ›мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических іециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ›рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-044/Н-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана ›дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП _______________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-044/Н-СПЭ
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

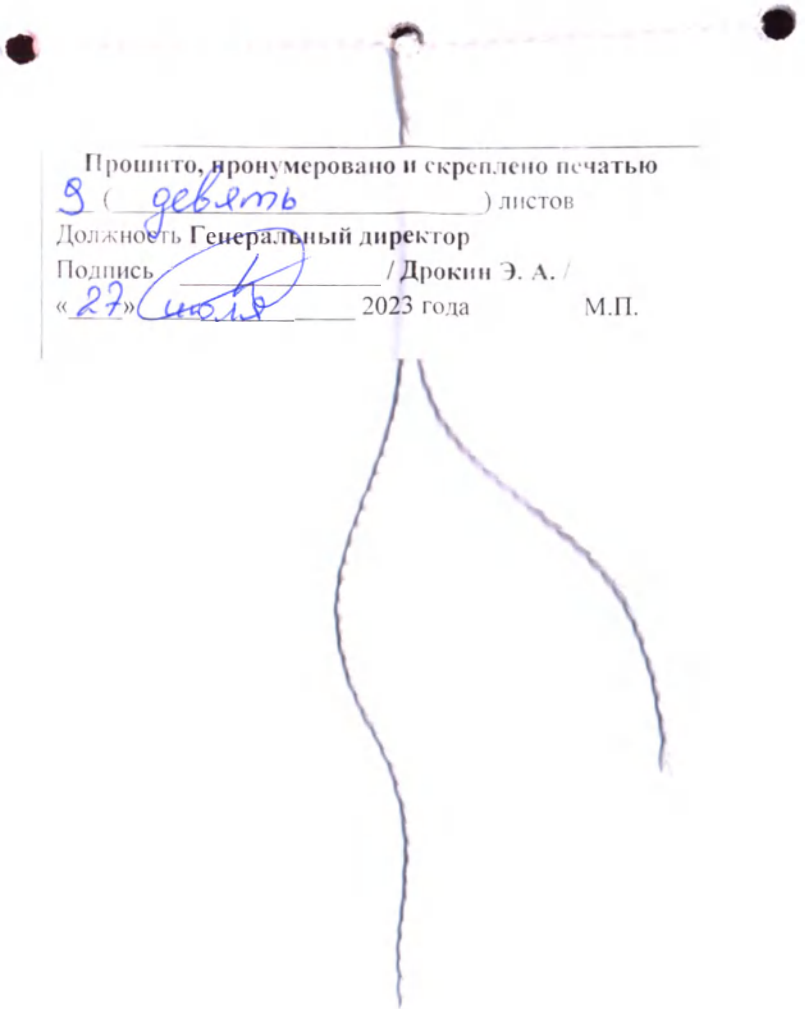
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-045/Н-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-045/Н-СПЭ** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-12494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
2.2 Тележка медицинская	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	**630*430*830**	**12,1±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р2	Рамка полки	3
К1	Стойка с колесными опорами	2
П2	Полка стеклянная	1
П3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	12,1±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к трем рамкам **Р2** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П2 и П3**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

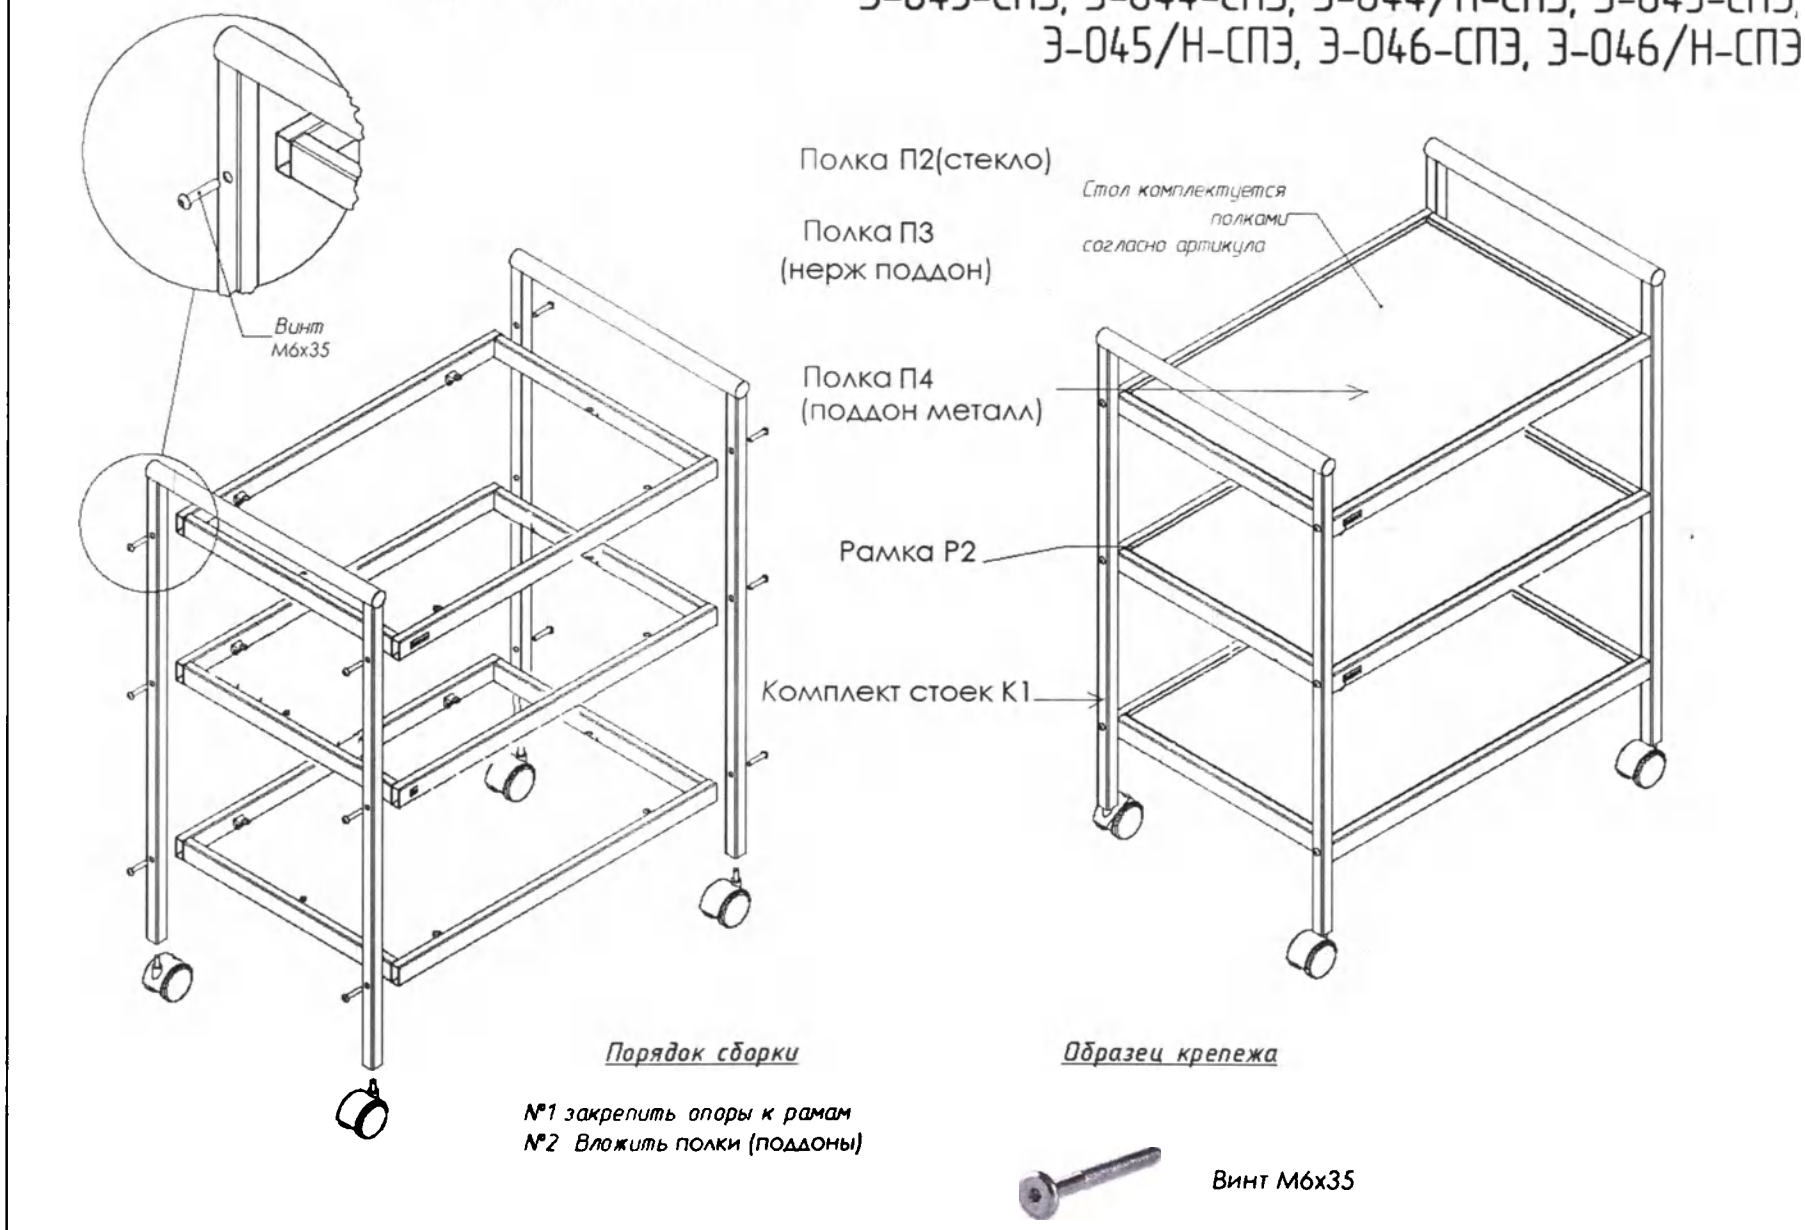

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ıаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических іециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец зрет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-045/Н-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана эдным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-045/Н-СПЭ
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-046/Н-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-046/Н-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	**630*430*830**	**10,7±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0.5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0.5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0.5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52.7±0.5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46.6±0.5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0.5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0.5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0.5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0.5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0.5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0.5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0.5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0.5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0.5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0.5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р2	Рамка полки	3
К1	Стойка с колесными опорами	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	10,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек **К1** закрепить к трем рамкам **Р2** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П3**
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-043-СПЭ, Э-044-СПЭ, Э-044/Н-СПЭ, Э-045-СПЭ, Э-045/Н-СПЭ, Э-046-СПЭ, Э-046/Н-СПЭ

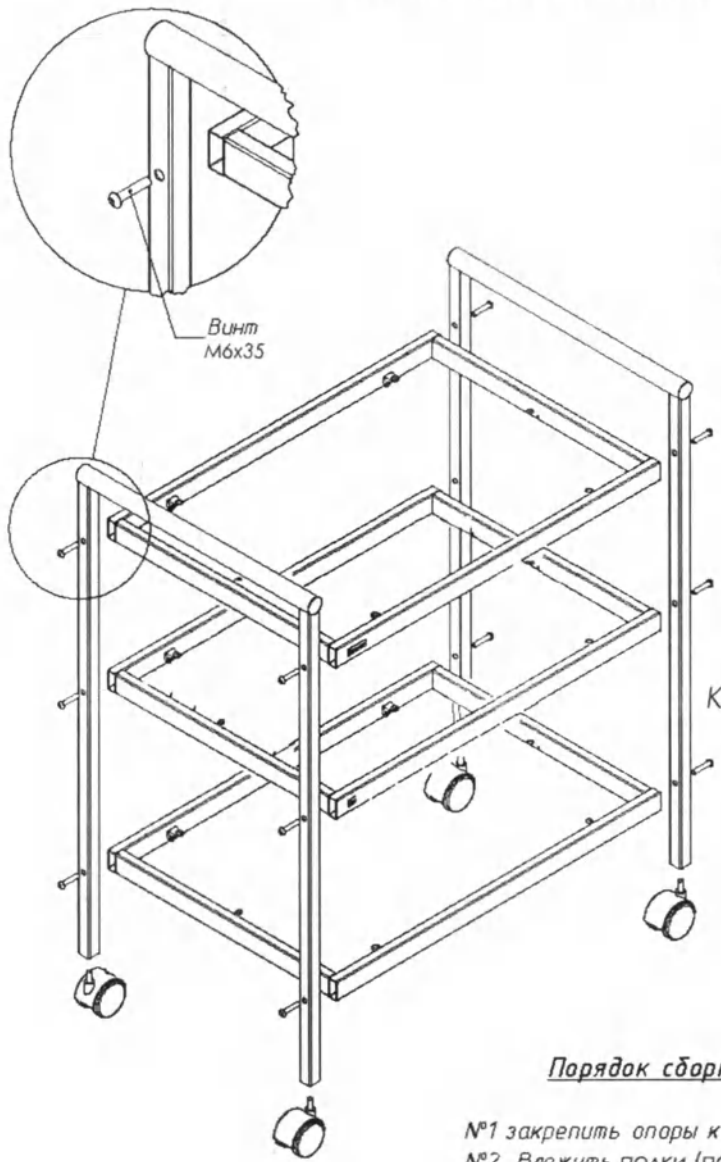

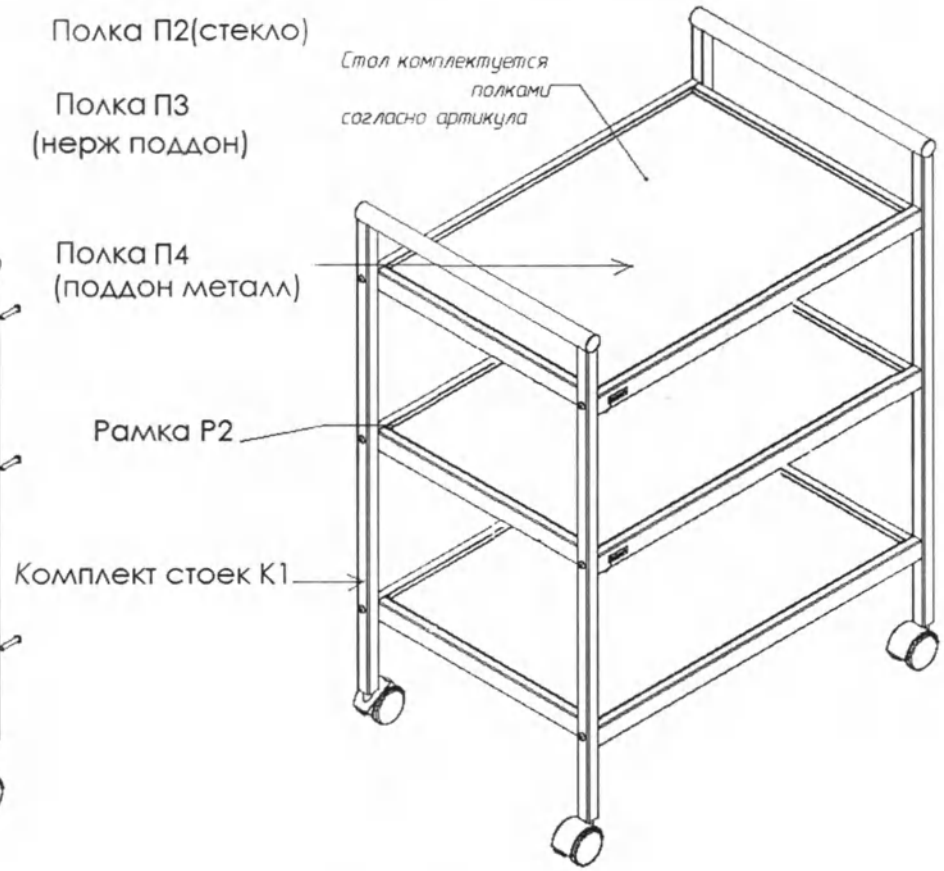

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 Вложить полки (поддоны)

Образец крепежа

Винт М6х35

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-046/Н-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-046/Н-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/Н-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/Н-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	**630*430*830**	**17,8±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р2	Рамка полки	1
С1	Стойка с колесными опорами	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	1
Р3	Рамка с блоком ящика	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Ящик	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	17,8±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек К**1** закрепить к рамкам **Р3**, и **Р2** – четырьмя винтами .
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П 3,** внутрь рамки **Р3 и Р2**,
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

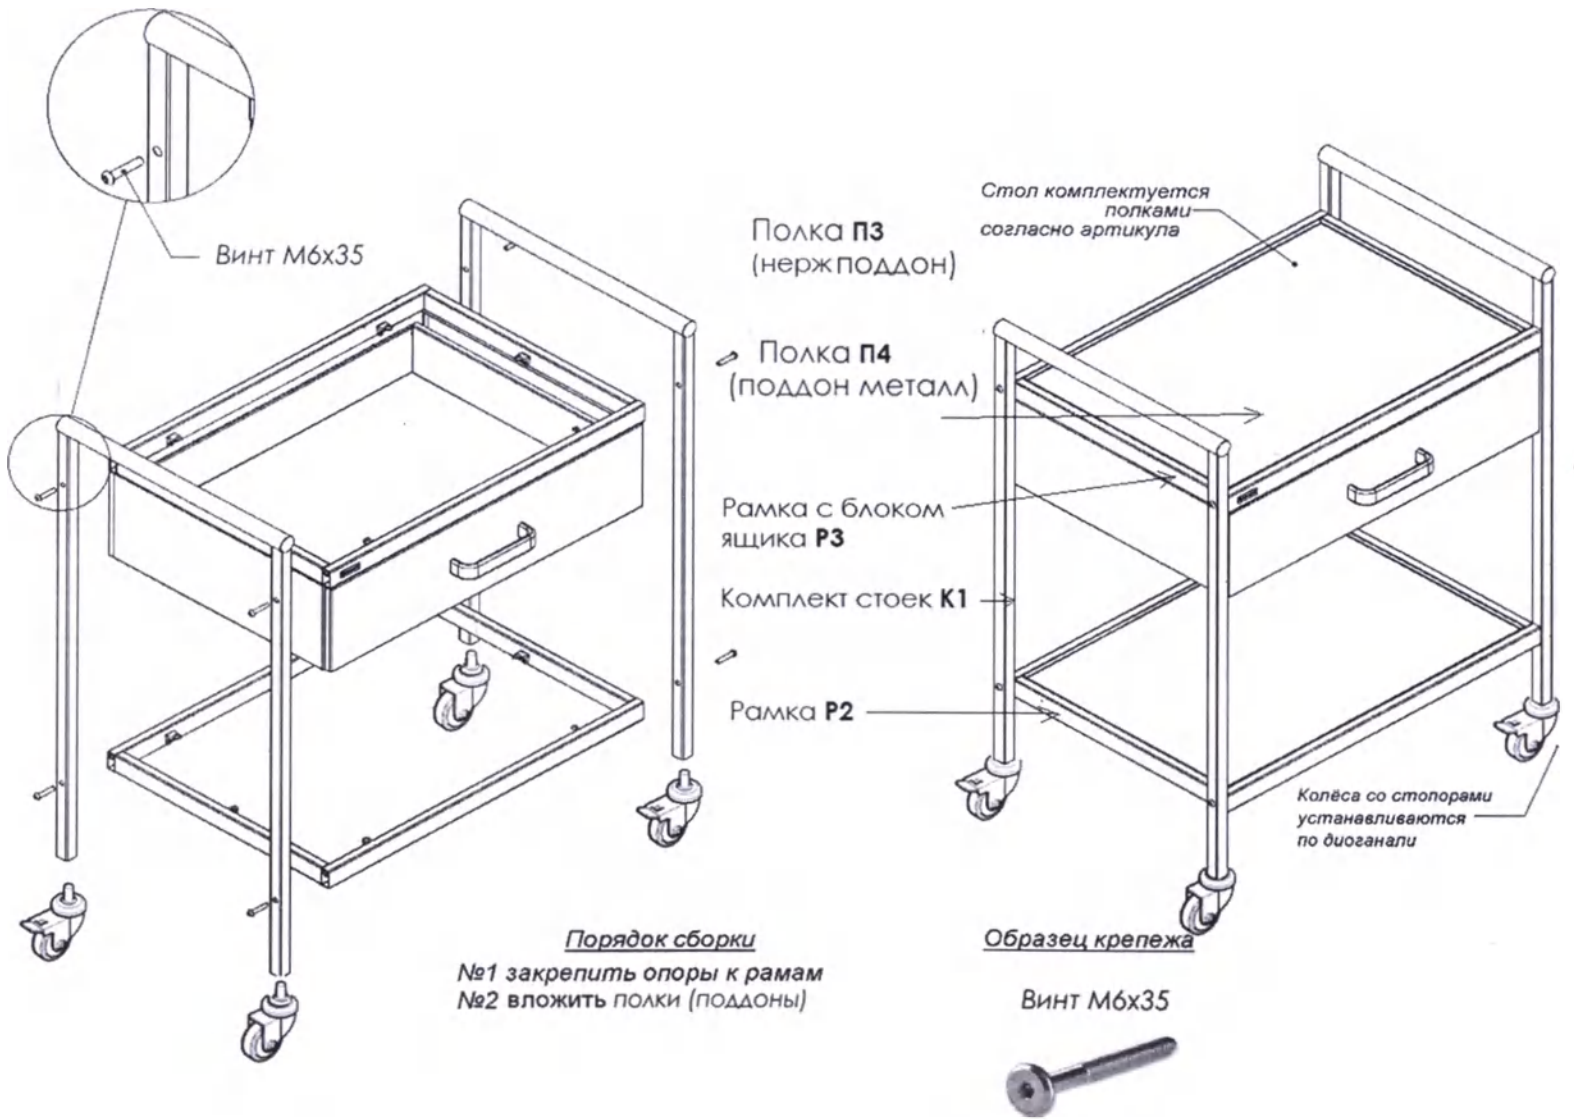

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/Н-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047/Н-СПЭ
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/2/Н-СПЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/2/Н-СПЭ** (далее – тележка). Тележка одит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	**630*430*830**	**26,2±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р2	Рамка полки	1
К3	Стойка с колесными опорами	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Р3	Рамка с блоком ящика	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Ящики	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	26,2±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек К**3** закрепить к рамкам **Р3**, и **Р2** – шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П 3,** внутрь рамки **Р3 и Р2**,
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

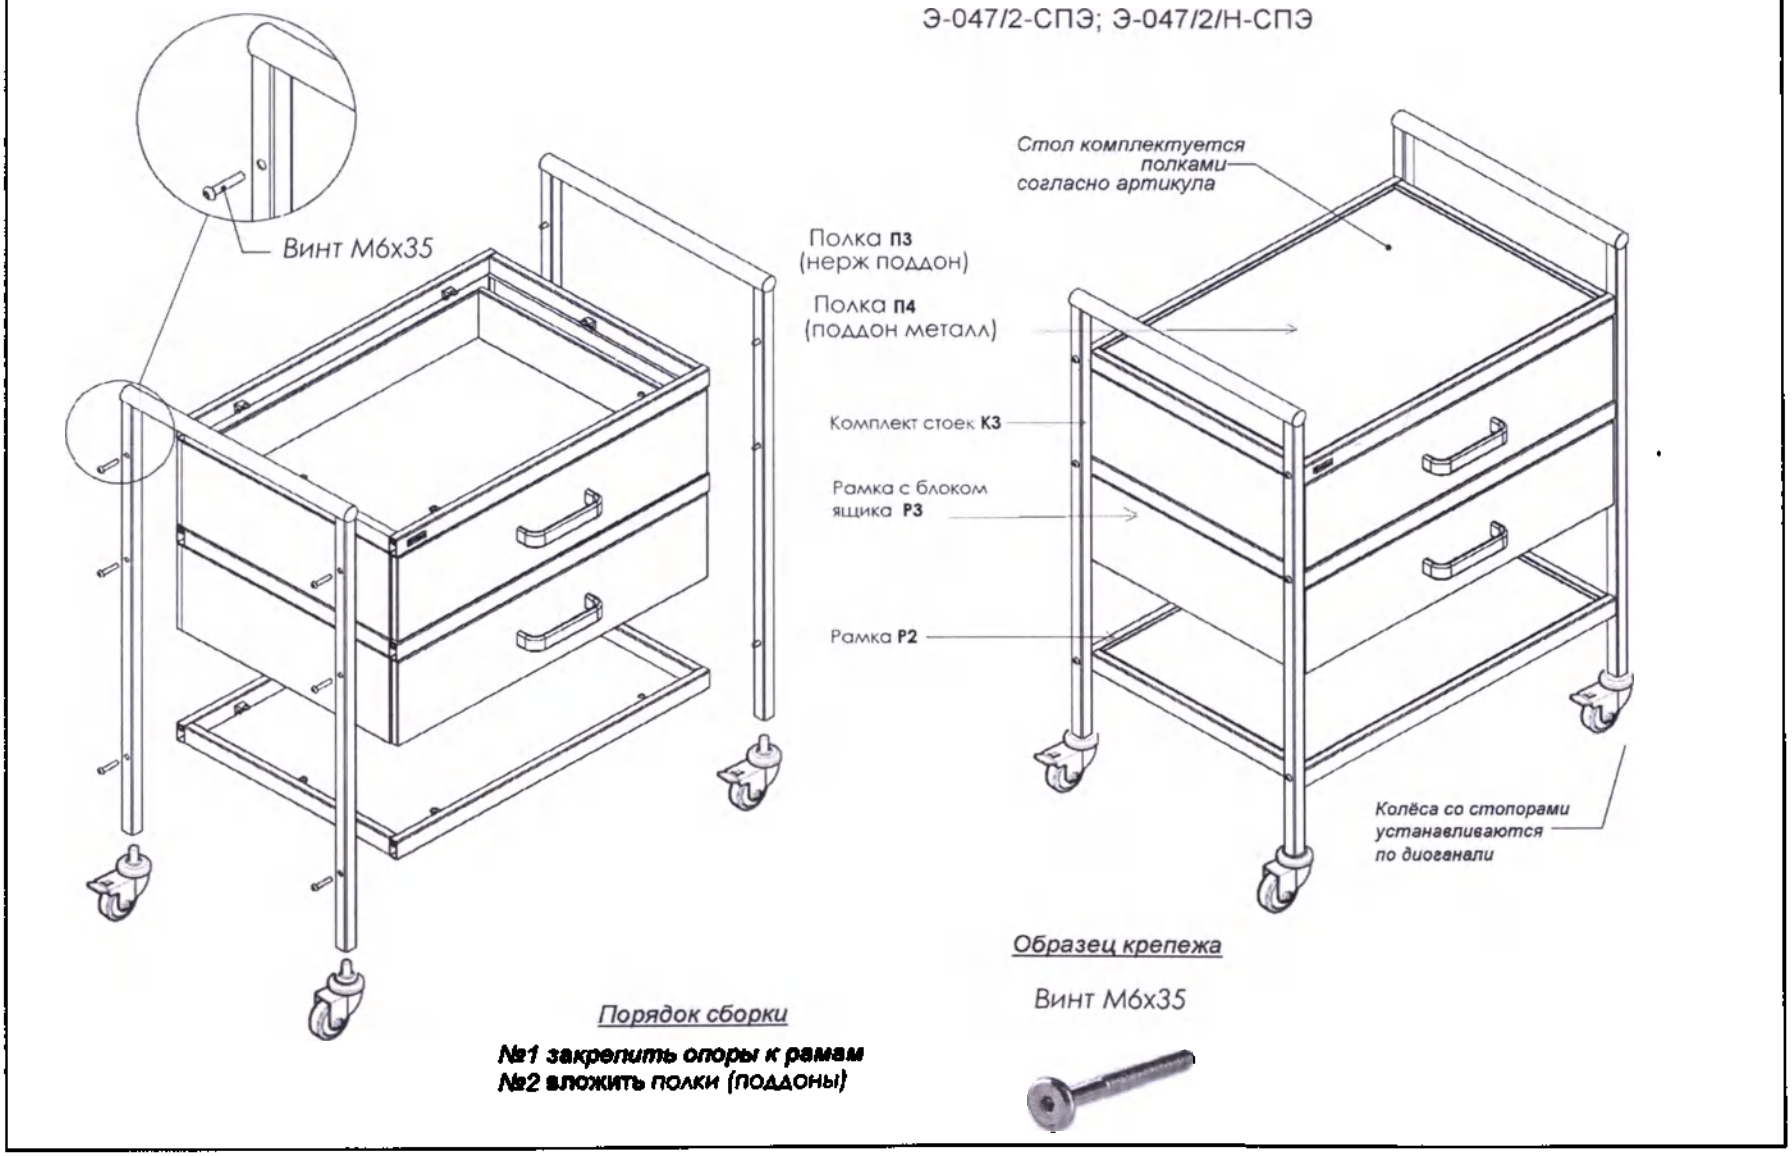

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ии изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации езвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/2/Н-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047/2/Н-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/3/Н-СПЭ

ПАСПОРТ

2023г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/3/Н-СПЭ** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
22 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	**630*430*830**	**34,6±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
К4	Стойка с колесными опорами	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	1
Р3	Рамка с блоком ящика	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полка	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Ящики	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной
Каркас (рамка полки, стойка,)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	34,6±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждый комплект стоек К**4** закрепить к рамкам **Р3** – шестью винтами .
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полку **П 3** внутрь рамки **Р3.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.
.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Э-047/3-СПЭ; Э-047/3/Н-СПЭ

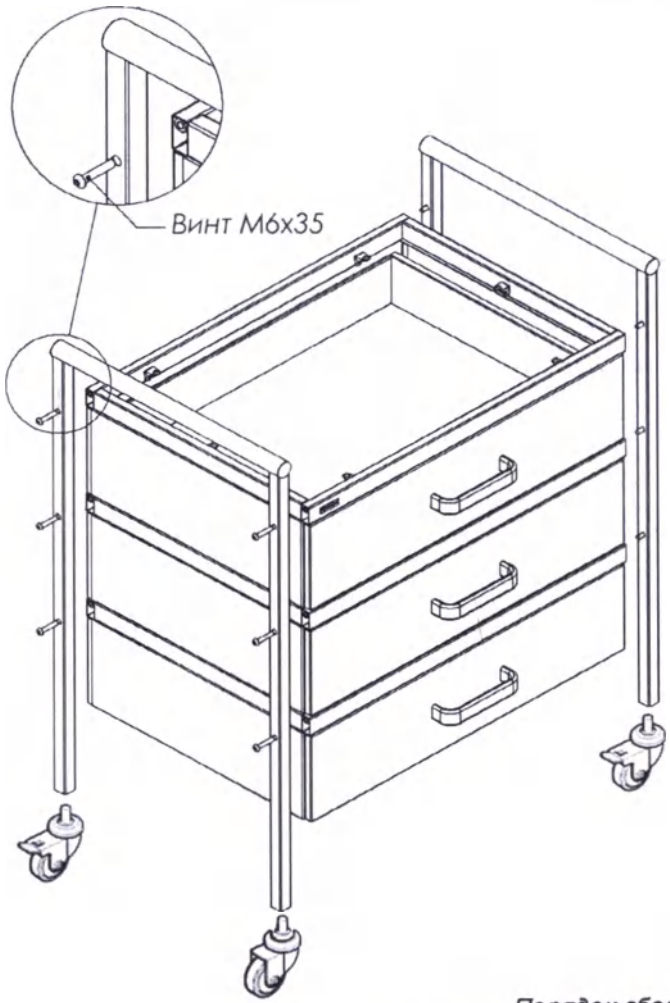

Полка **П3**
(нерж поддон)

Полка **П4**
(поддон металл)

Комплект стоек **К4**

Рамка с блоком
ящика **Р3**

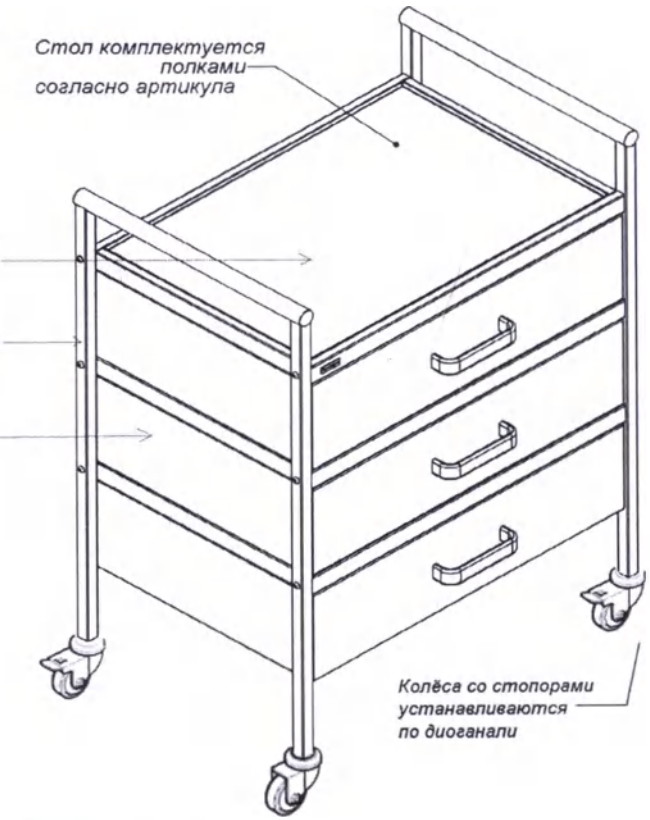

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 вложить *полки (поддоны)*

Образец крепежа

Винт М6х35

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ıдорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие þразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу гходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации эзвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ıаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ›мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ıециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец эрет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/3/Н-СПЭ в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана эдным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047/3/Н-СПЭ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-040-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-040-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования постринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка едицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	**575*450*800**	**9,9±0,5**		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	2
С 1	Стойка с колесной опорой	4
П 1	Полка стеклянная	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
олки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
аркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
оминальное отклонение габаритных размеров, не олее, мм	4
лиматический класс	УХЛ 4.2
емпература окружающей среды при эксплуатации,	5 - 30
lасса нетто, кг	9,9±0,5
азначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку С1 закрепить к двум рамкам Р1 двумя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить две полки П1, внутрь рамки полки Р 1.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-040-СП; Э-041-СП; Э-042-СП;
Э-041/Н-СП; Э-042/Н-СП

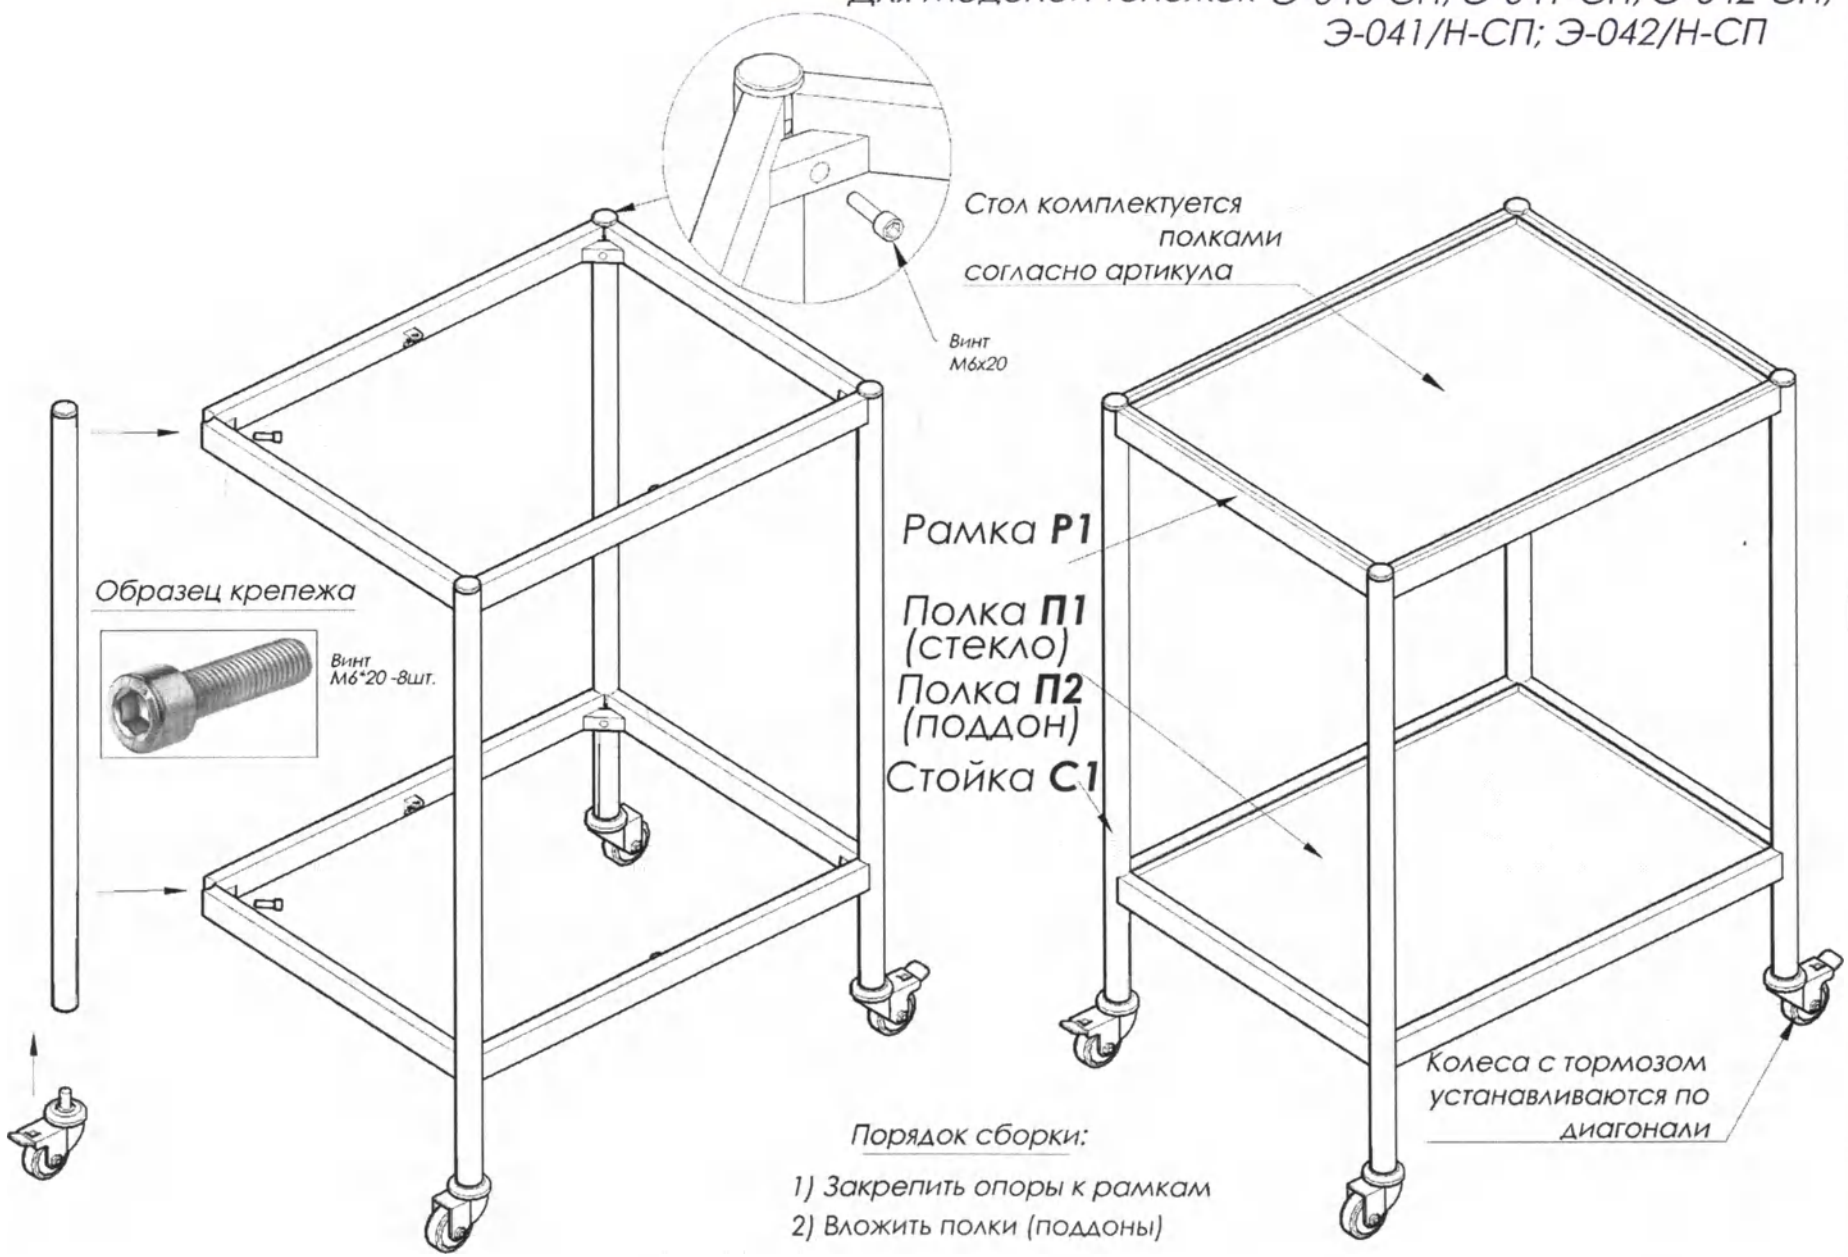

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-040-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-040-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дроздин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-041-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-041-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	**575*450*800**	**9,3±0,5**		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	2
С 1	Стойка с колесной опорой	4
П 1	Полка стеклянная	1
П 2	Полка (поддон металлический)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, С	5 - 30
Масса нетто, кг	9,3±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С1** закрепить к двум рамкам **Р1** винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки П1 и П2, внутрь рамки полки Р 1.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-040-СП; Э-041-СП; Э-042-СП;
Э-041/Н-СП; Э-042/Н-СП

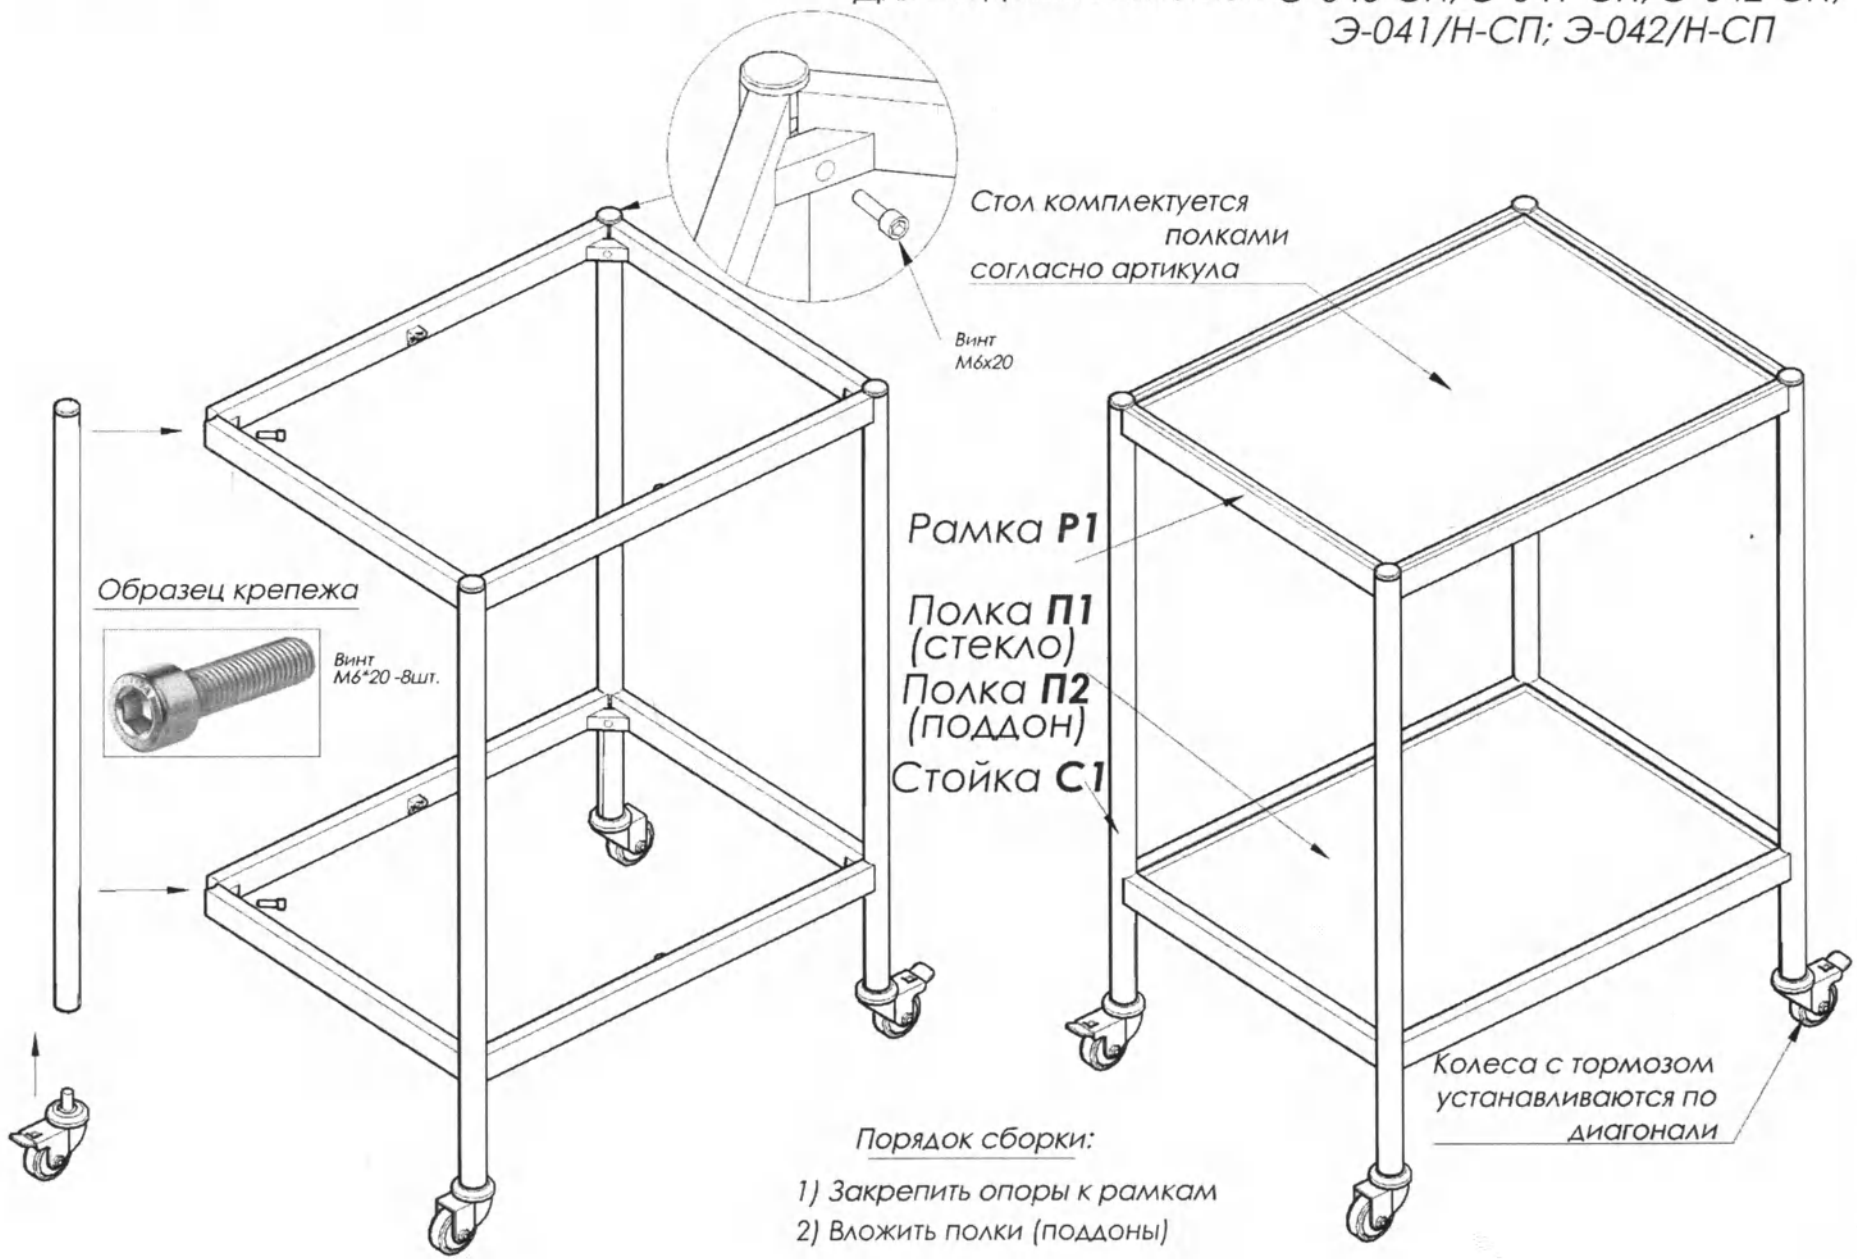

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ии изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-041-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-041-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-042-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-042-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка едицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	**575*450*800**	**8,6±0,5**		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	2
С 1	Стойка с колесной опорой	4
П 2	Полка (поддон металлический)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	8,6±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку С1 закрепить к двум рамкам Р1 двумя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить поддоны П2, внутрь рамки полки Р1.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

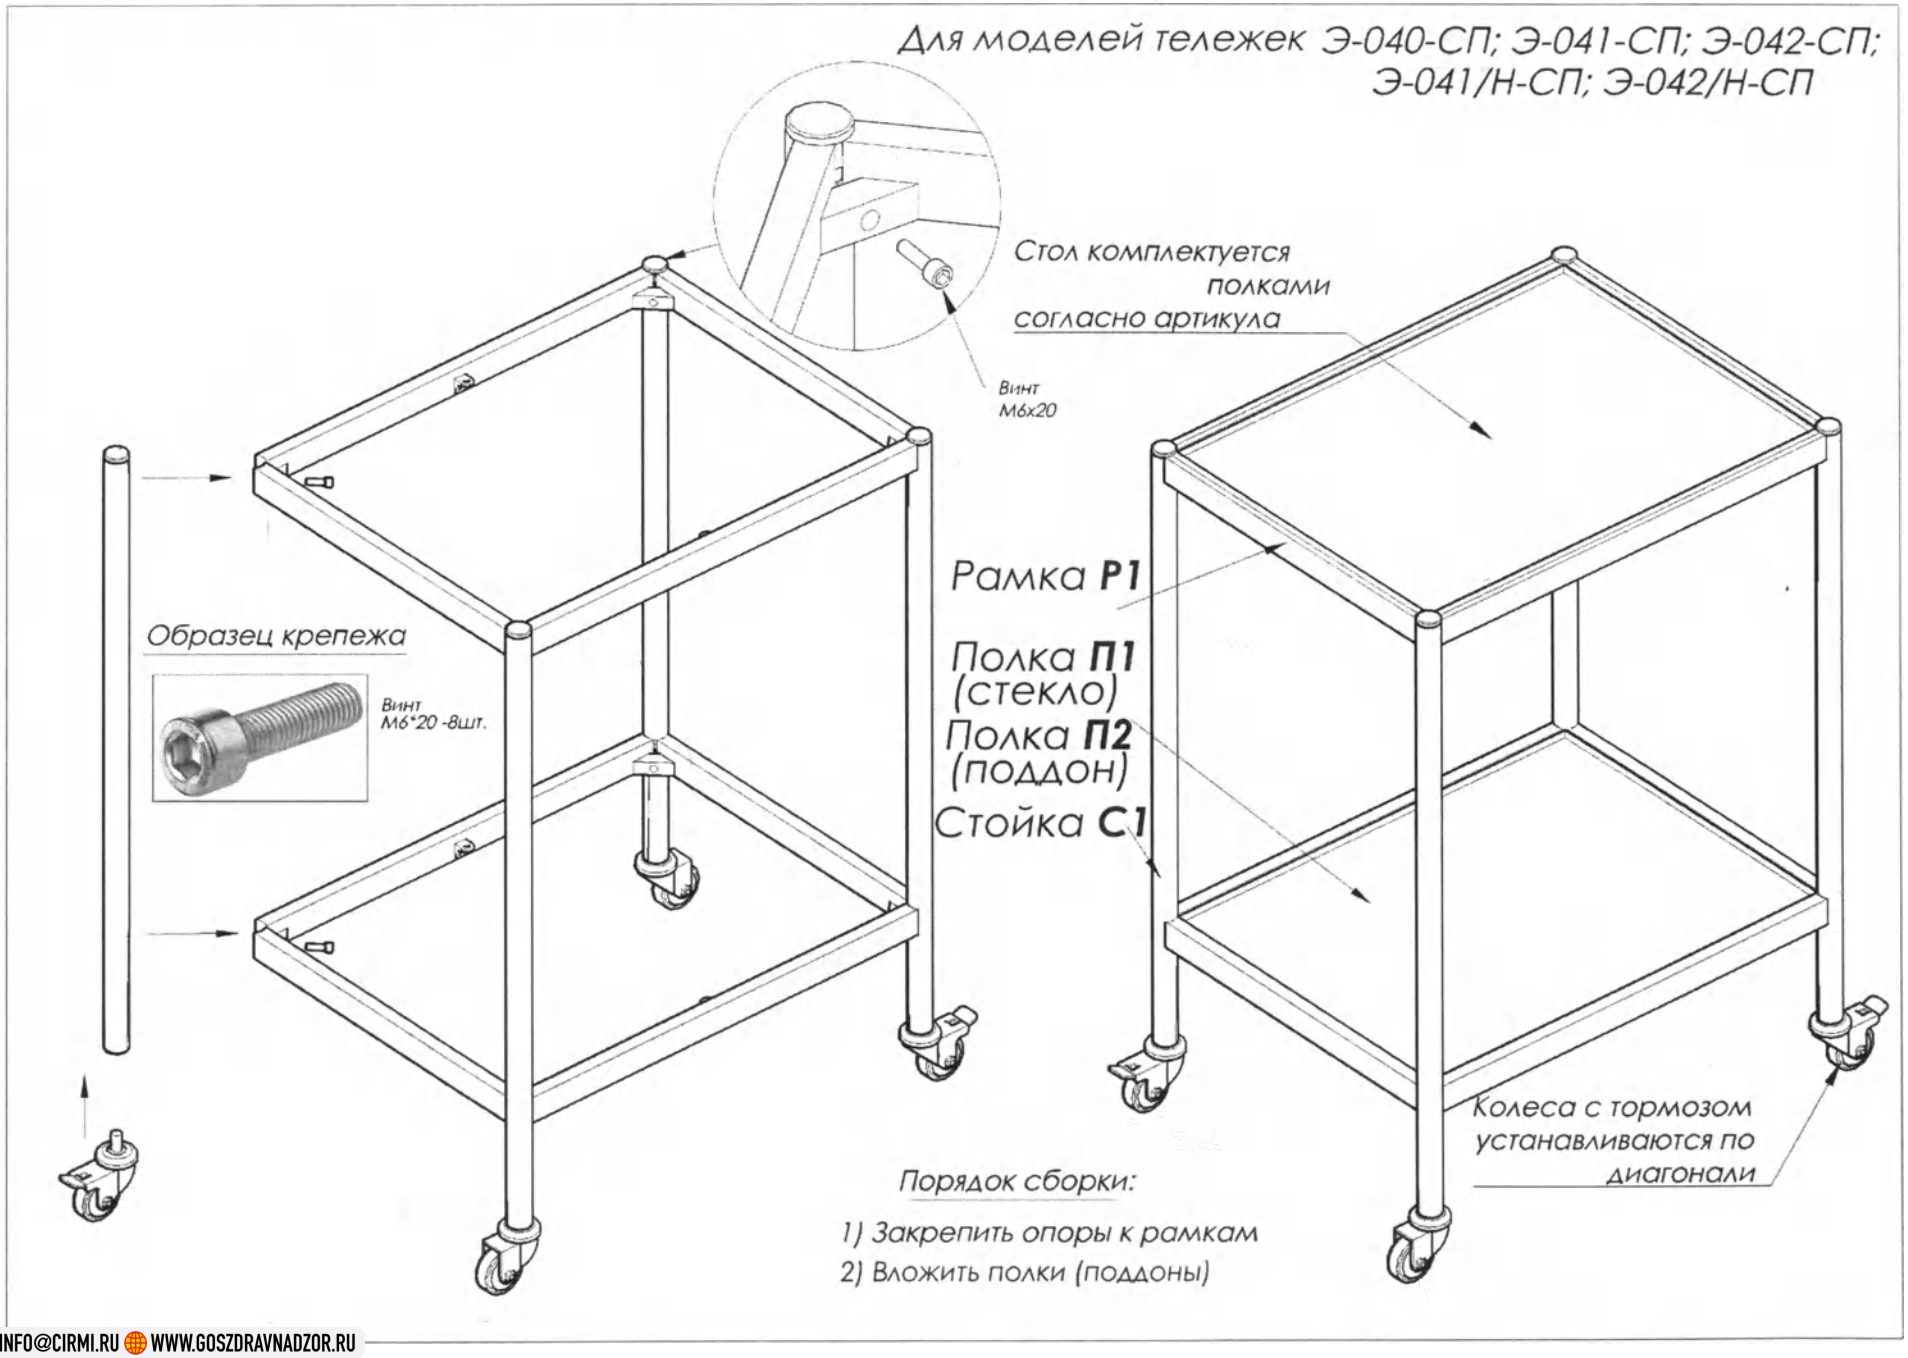

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ющью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-042-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-042-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись / Дроган Э. А.
«27» июля 2023 года М.П.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Гомеопатические технологии» НОВОСИБИРСК
Гомеопикс

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-043-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-043-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	**575*450*800**	**13,5±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р1	Рамка полки	3
С2	Стойка с колесной опорой	4
П1	Полка стеклянная	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	13,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку полку **П1**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

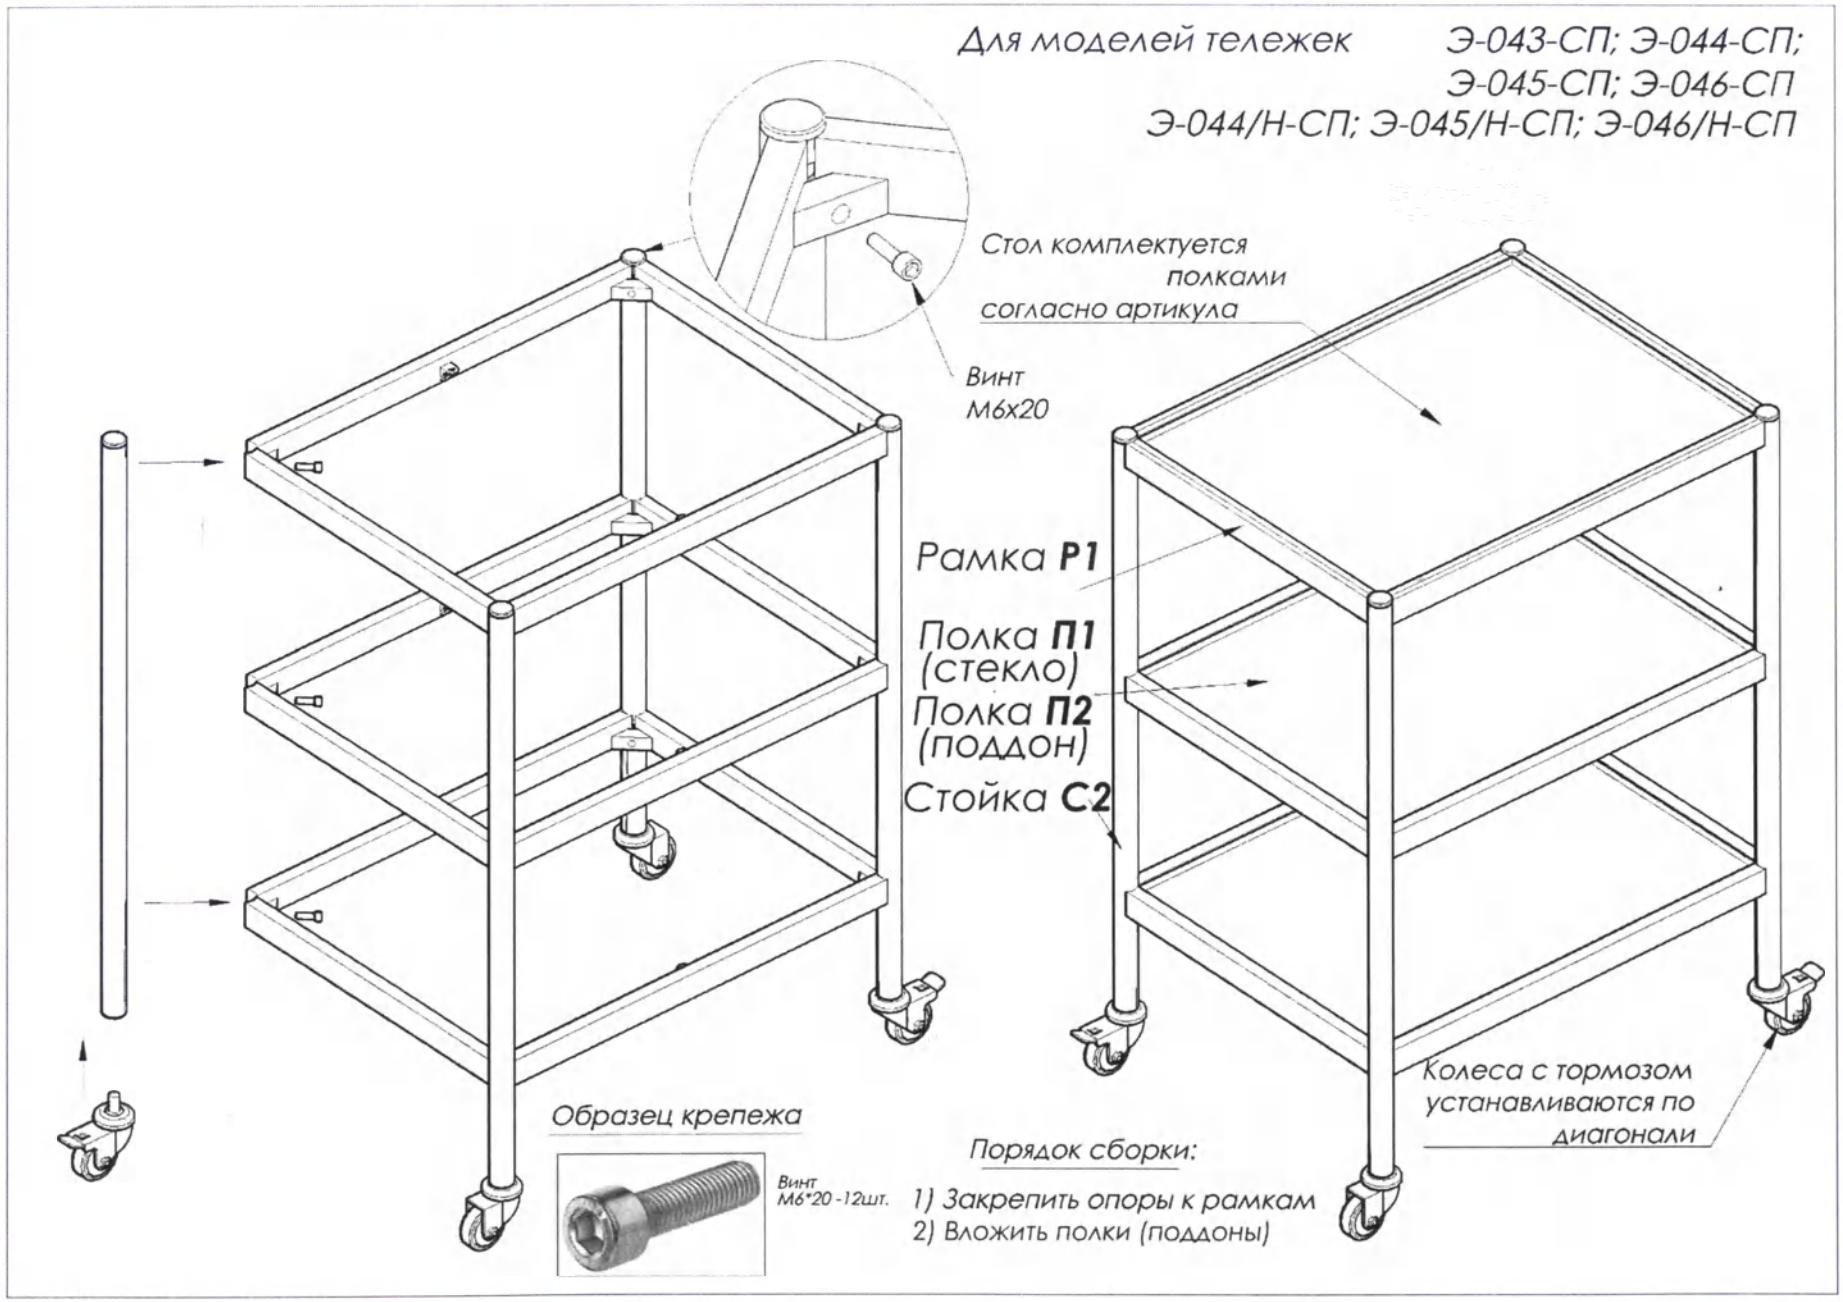

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси юрода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу кодов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-043-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ____________________ ________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тележка медицинская Э-043-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э.С. /
«27» марта 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-044-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-044-СП** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка едицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	**575*450*800**	**12,7±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 2	Стойка с колесной опорой	4
П 1	Полка стеклянная	2
П 2	Полка (поддон металлический)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
олки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	12,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полку **П1** и П2
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек **Э-043-СП; Э-044-СП;**
Э-045-СП; Э-046-СП
Э-044/Н-СП; Э-045/Н-СП; Э-046/Н-СП

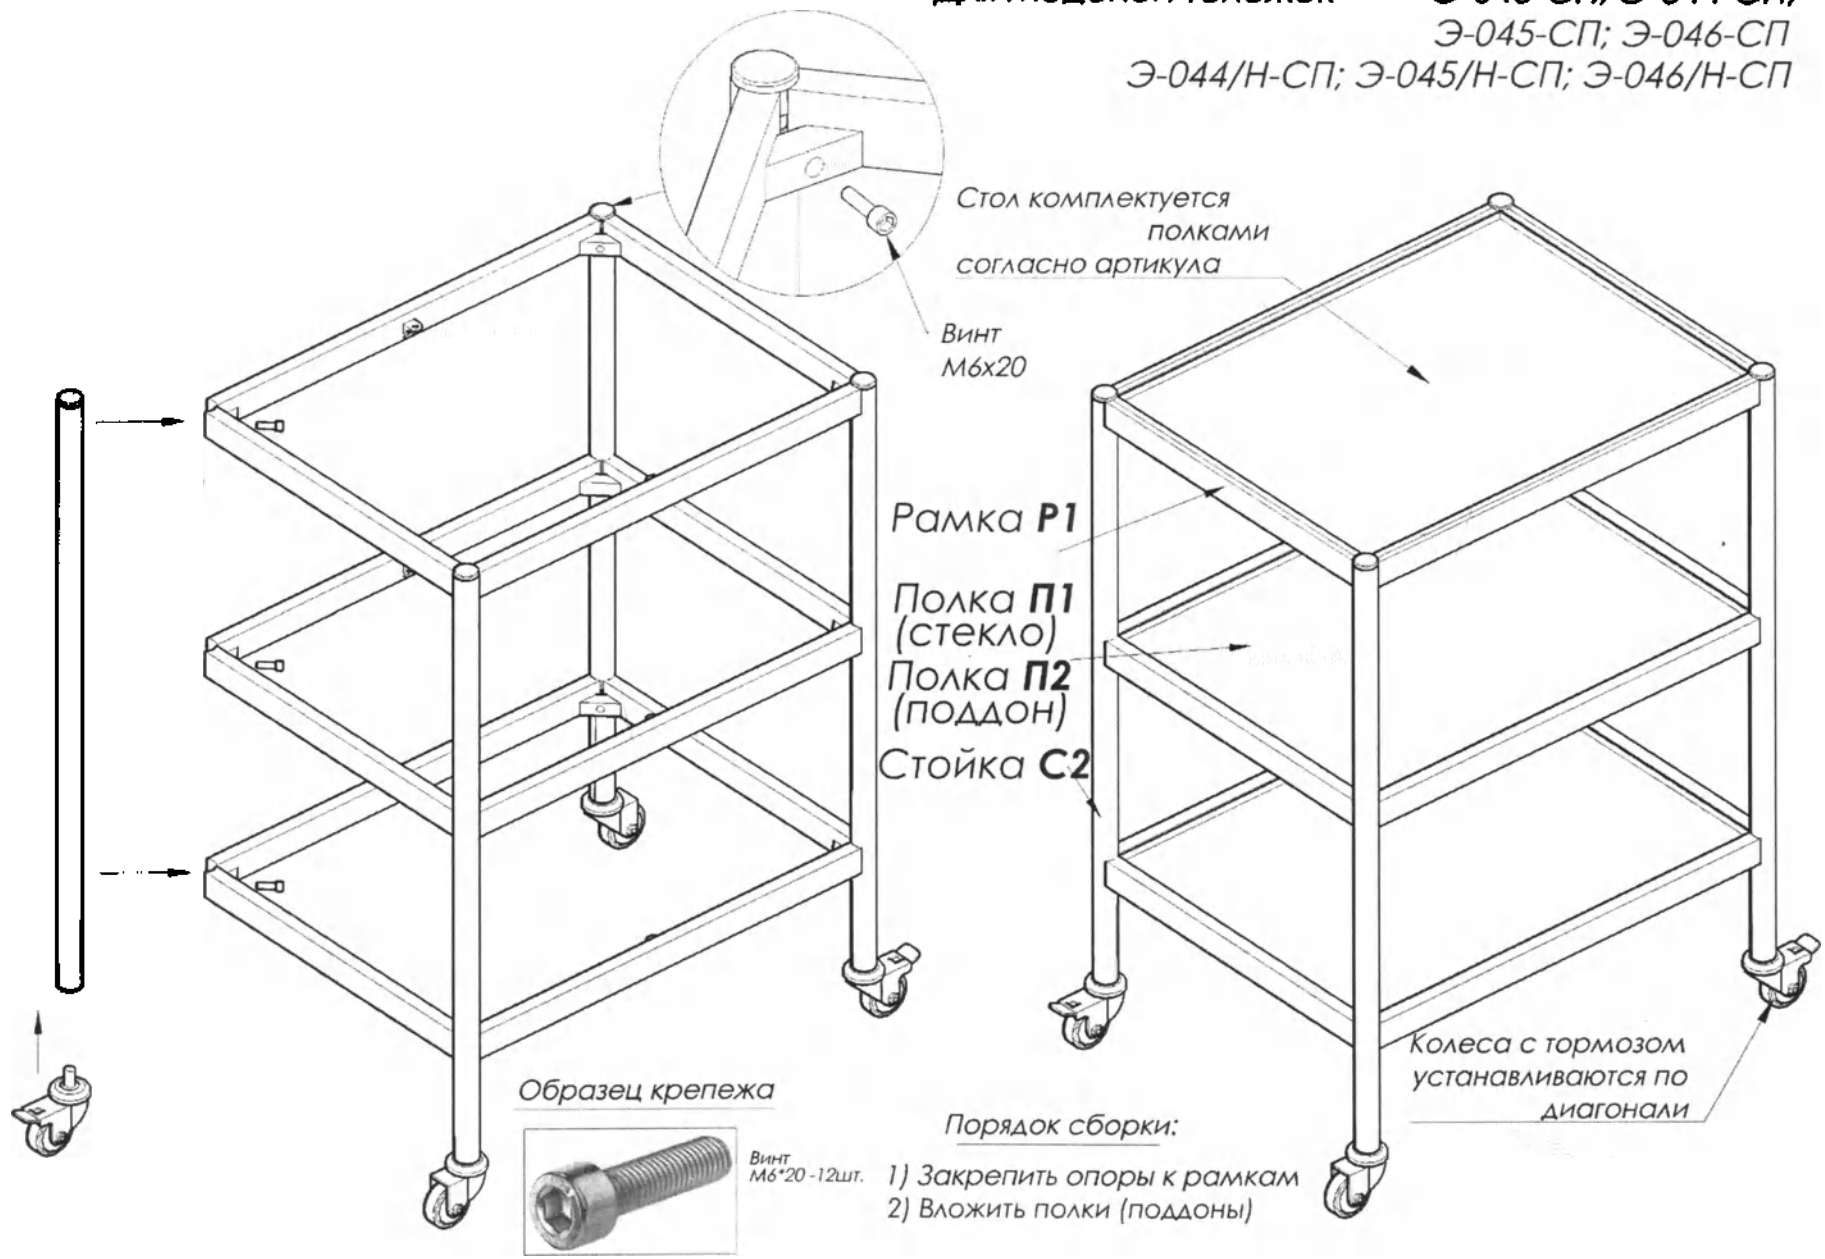

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ıорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при ›инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ‹одов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-044-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с ıязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-044-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
« 27 » июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-045-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-045-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	**575*450*800**	**12,2±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 2	Стойка с колесной опорой	4
П 1	Полка стеклянная	1
П 2	Полка (поддон металлический)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	12,2±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку полки **П1 и П2**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек **Э-043-СП; Э-044-СП;**
Э-045-СП; Э-046-СП
Э-044/Н-СП; Э-045/Н-СП; Э-046/Н-СП

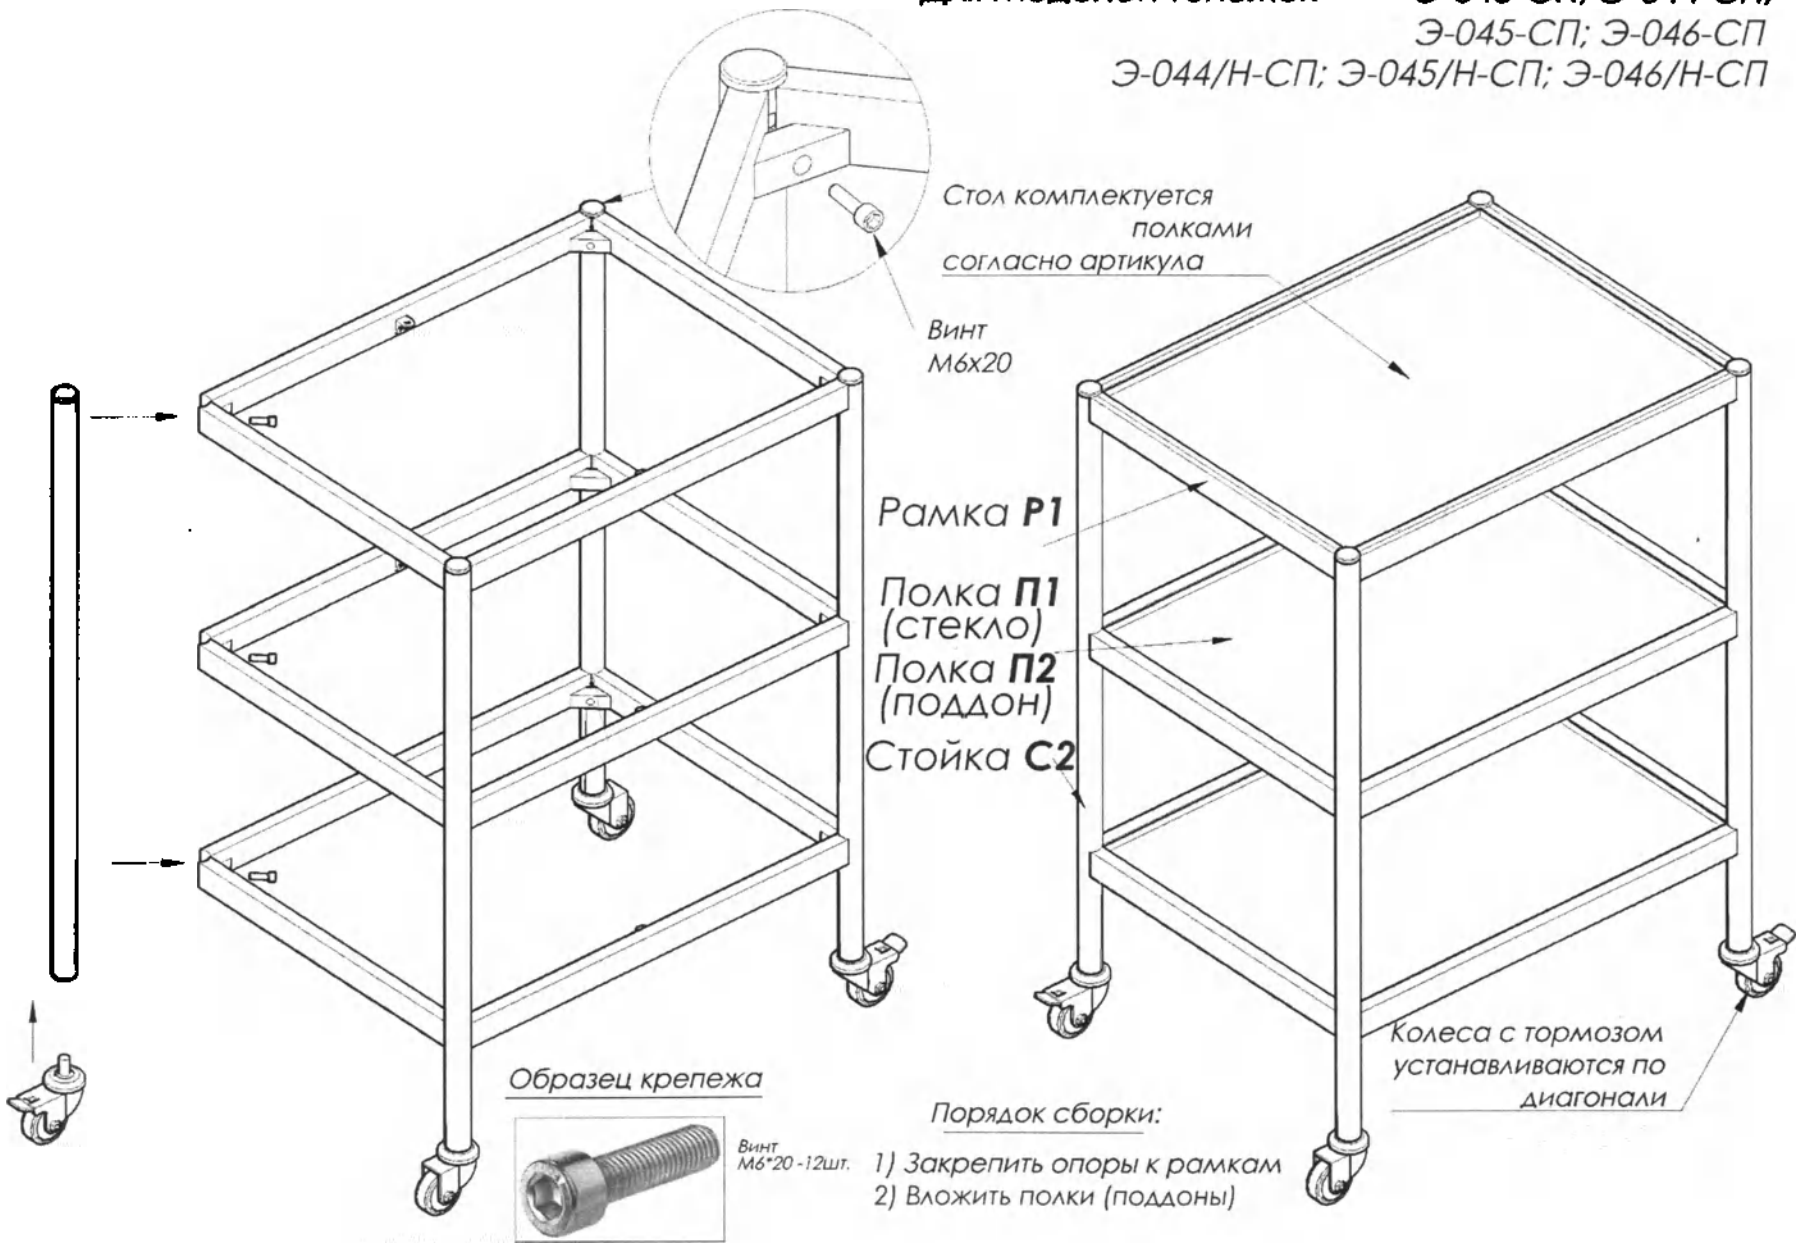

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-045-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-045-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) лист(ов)

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин** А. /

«27» мая 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-046-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-046-СП** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	**575*450*800**	**11,4±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 2	Стойка с колесной опорой	4
П 2	Полка (поддон металлический)	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка, поддоны)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	11,4±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полку поддон металлический **П1**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-043-СП; Э-044-СП;
Э-045-СП; Э-046-СП
Э-044/Н-СП; Э-045/Н-СП; Э-046/Н-СП

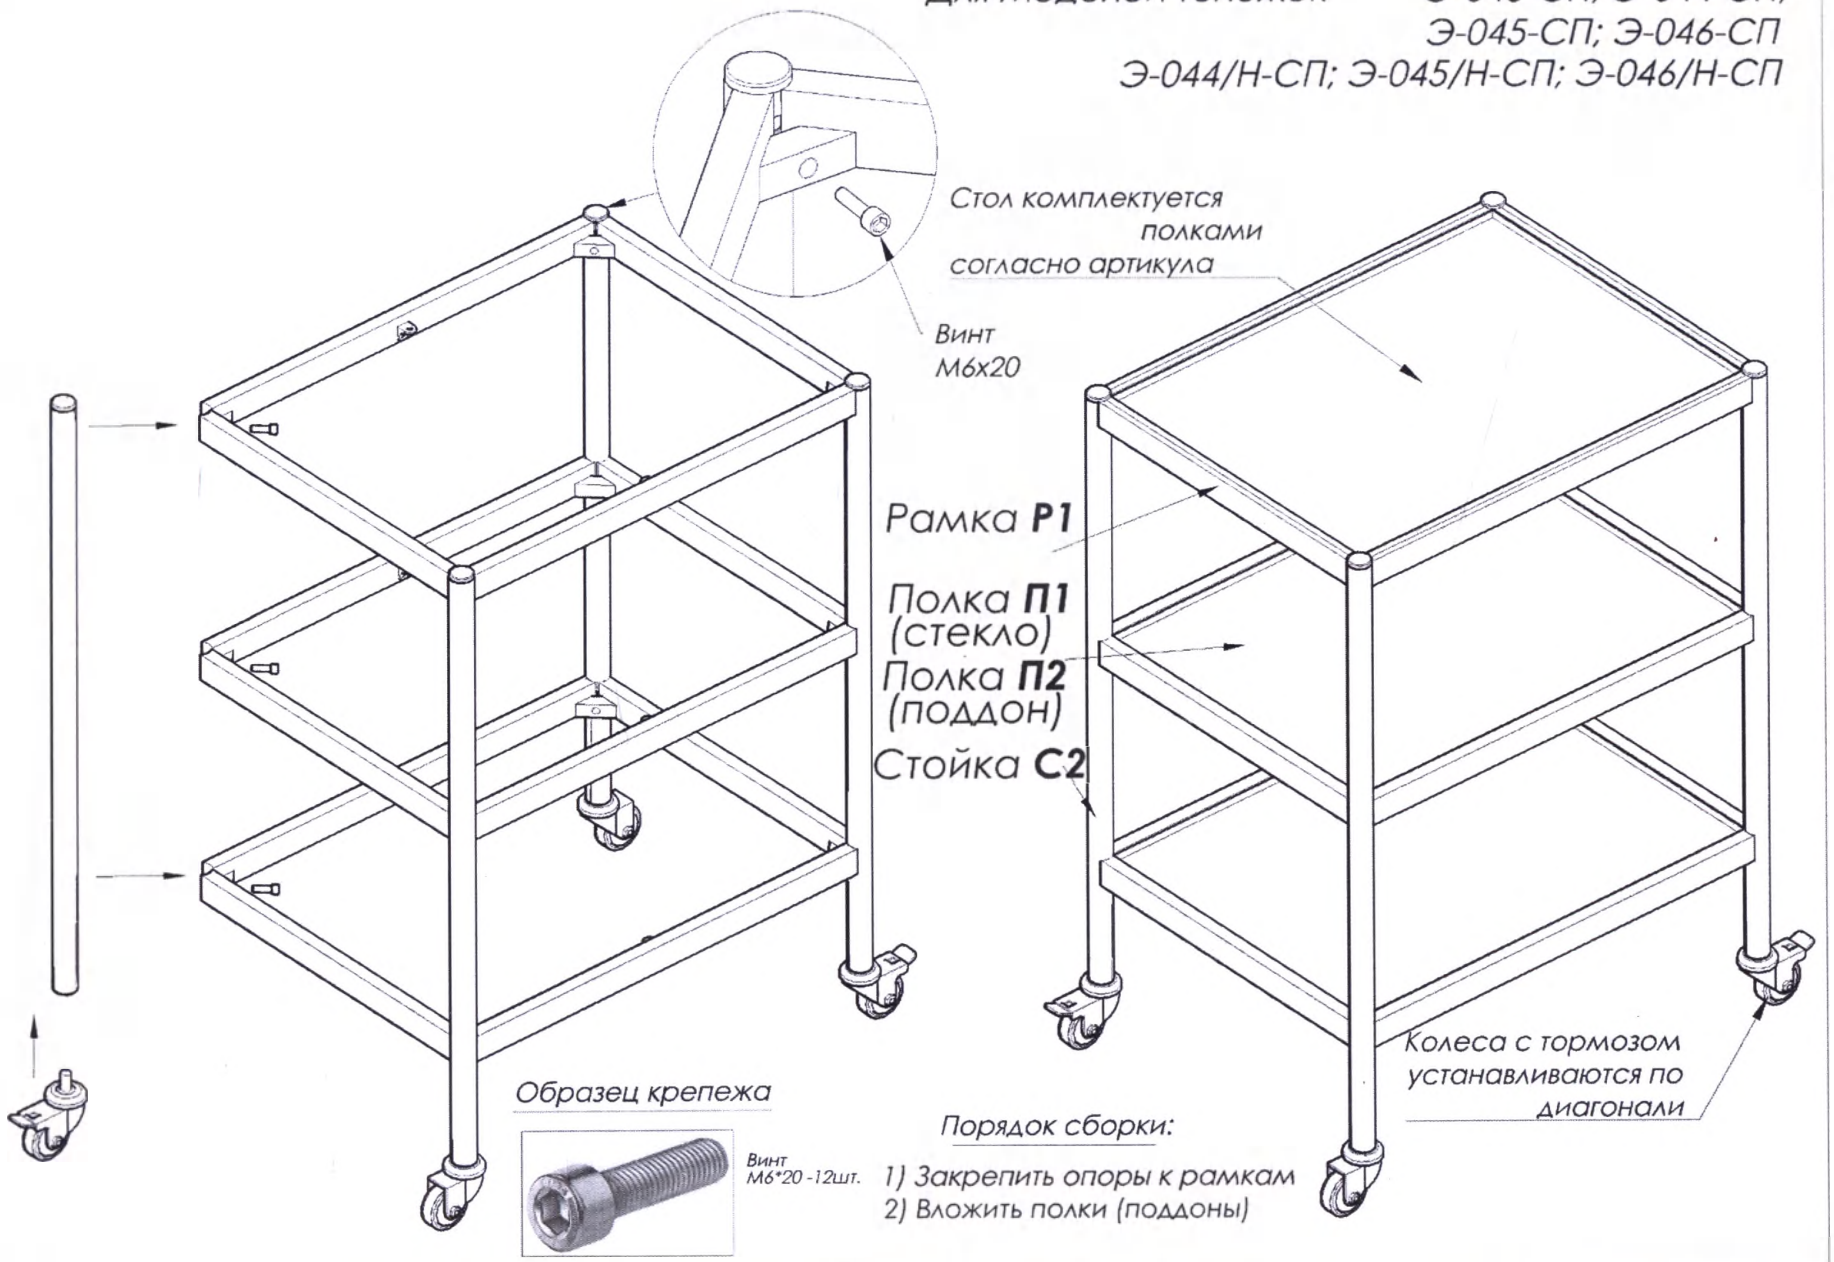

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ;орода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-046-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-046-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э.С./

«22» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
2 Тележка едицинская	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	**575*450*800**	**15±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р1	Рамка полки	1
С1	Стойка с колесной опорой	4
П2	Полка (поддон металлический)	2
Р2	Рамка с блоком ящика	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки, ящик	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	15,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С1** закрепить к рамкам (с блок ящиком) **Р2**, и рамки **Р1** – двумя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить поддоны **П2,** внутрь рамки **Р2 и Р1**,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

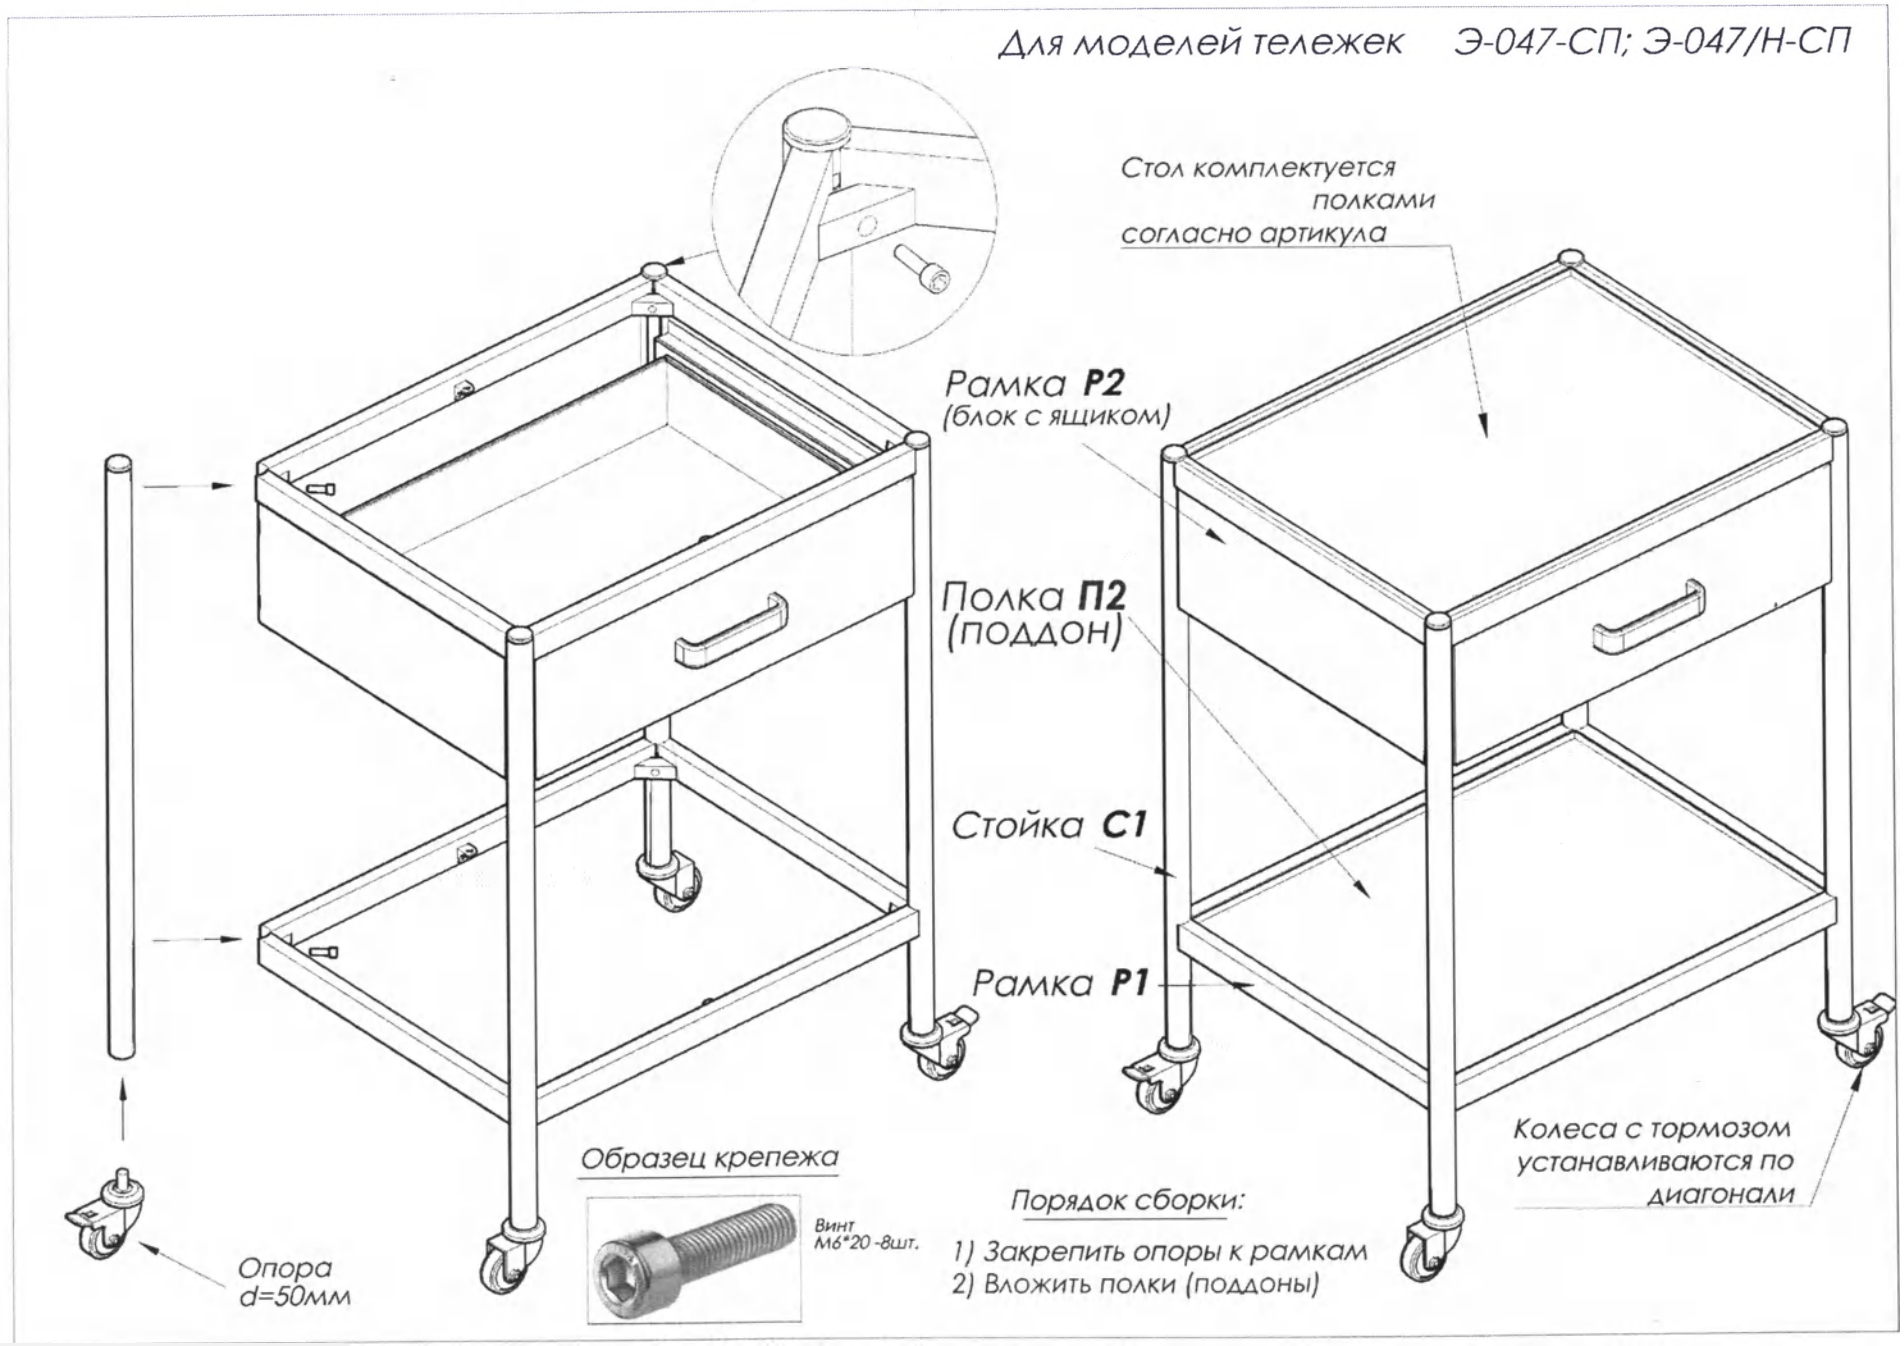

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А.
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/2-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/2-СП** (далее – тележка). Тележка одит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка едицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	**575*450*800**	**23,2±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р1	Рамка полки	1
С3	Стойка с колесной опорой	4
П2	Полка (поддон металлический)	2
Р2	Рамка с блоком ящика	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки, ящики	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамки полки, стойки)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	23,2±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой бходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали тележки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных ерхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С3** закрепить к рамкам (с блок ящиками) **Р2**, и рамки **Р1** – тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить поддоны **П2,** внутрь рамки **Р2 и Р1**,
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-047/2-СП; Э-047/2/Н-СП

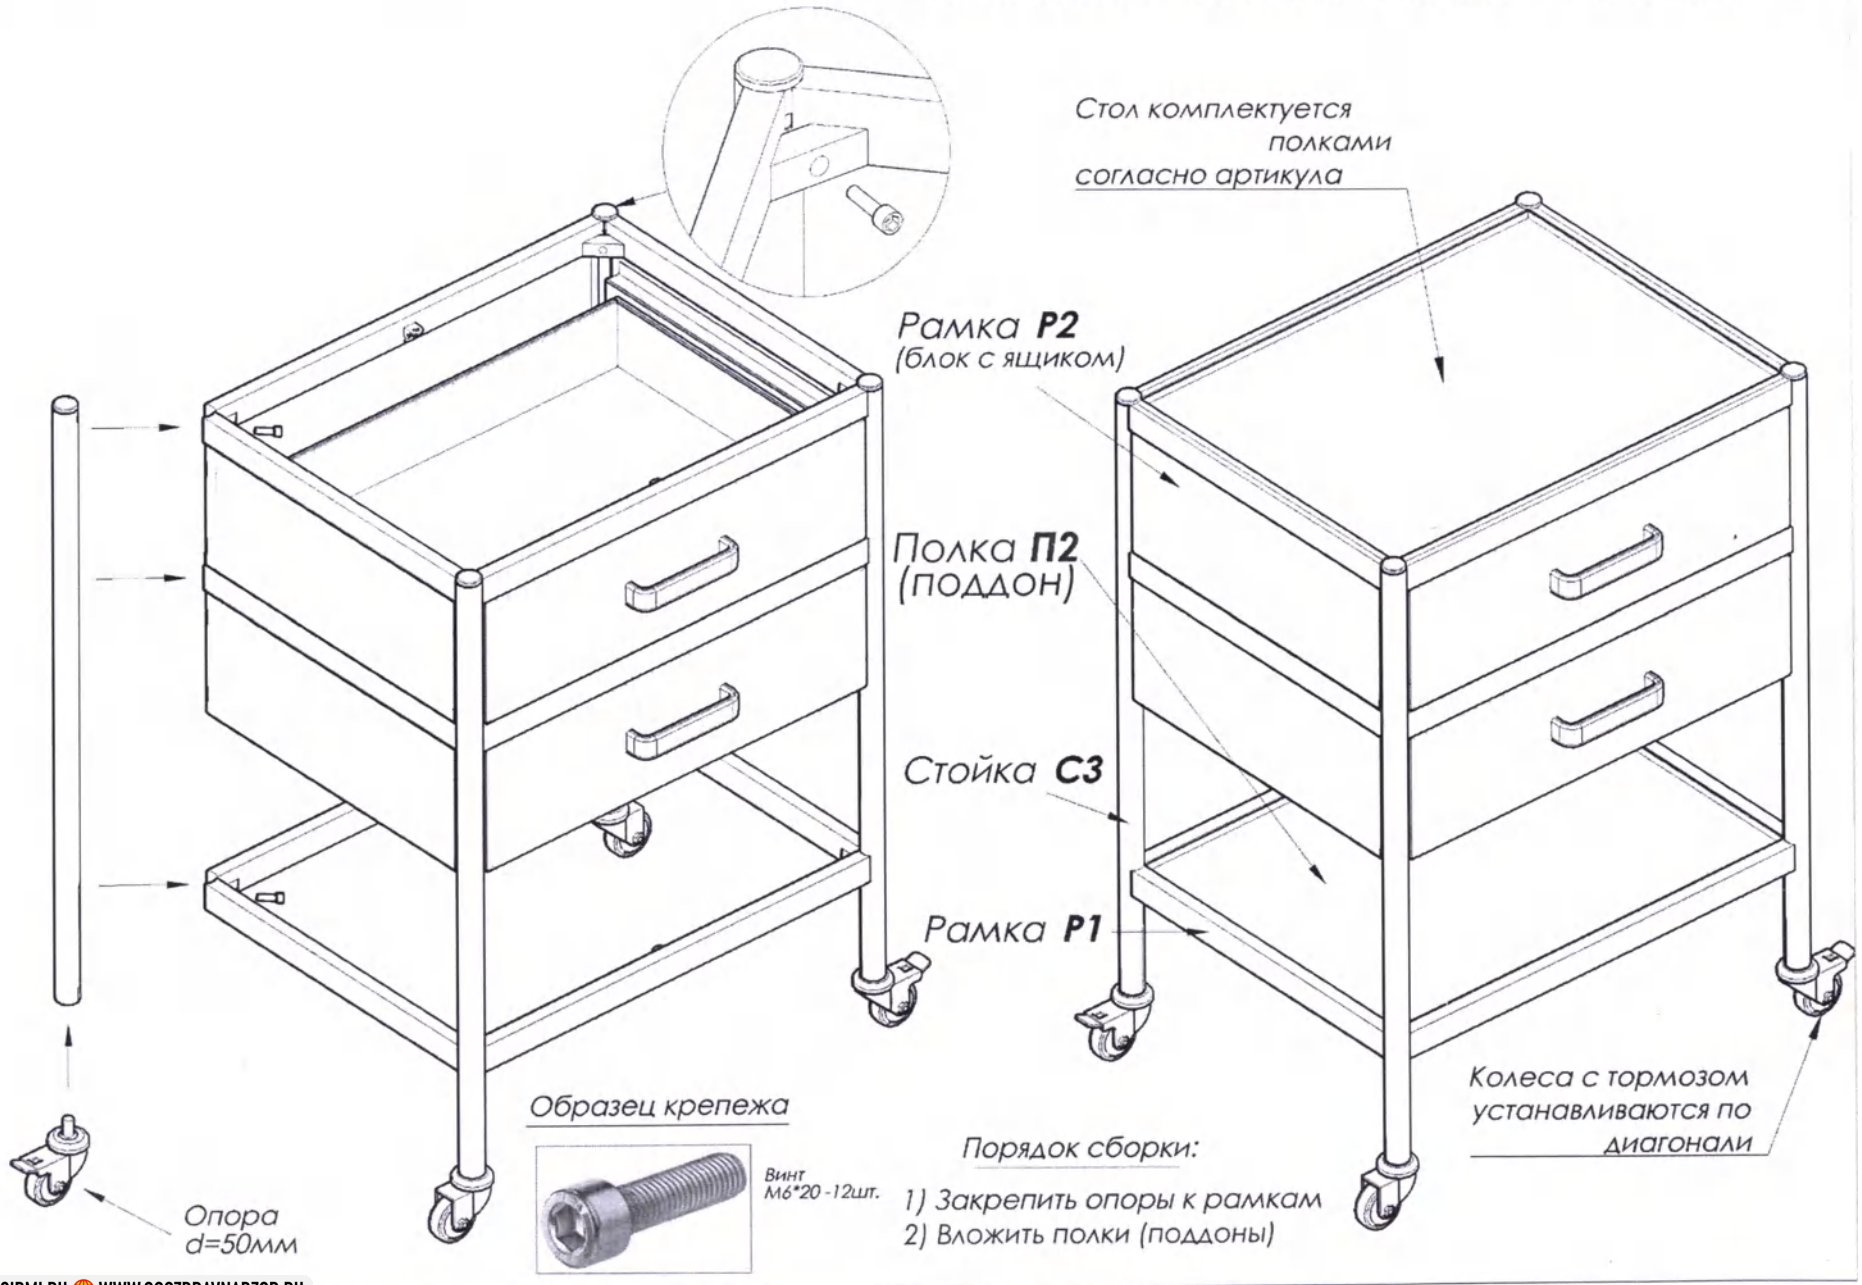

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ıорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при ıинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие ›азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ‹одов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ющью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/2-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047/2-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Д. А.** /

«27» июля 2023 года

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Эргомедикс» НОВОСИБИРСК

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/3-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/3-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	**575*450*800**	**31,4±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р2	Рамка с блоком ящика	3
С4	Стойка с колесной опорой	4
П2	Полка (поддон металлический)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полка, ящики	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамки полки, стойки)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	31,4±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С4** закрепить к рамкам (с блок ящиками) **Р2** – тремя винтами .
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить поддон **П2,** внутрь рамки **Р2**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-047/3-СП; Э-047/3/Н-СП

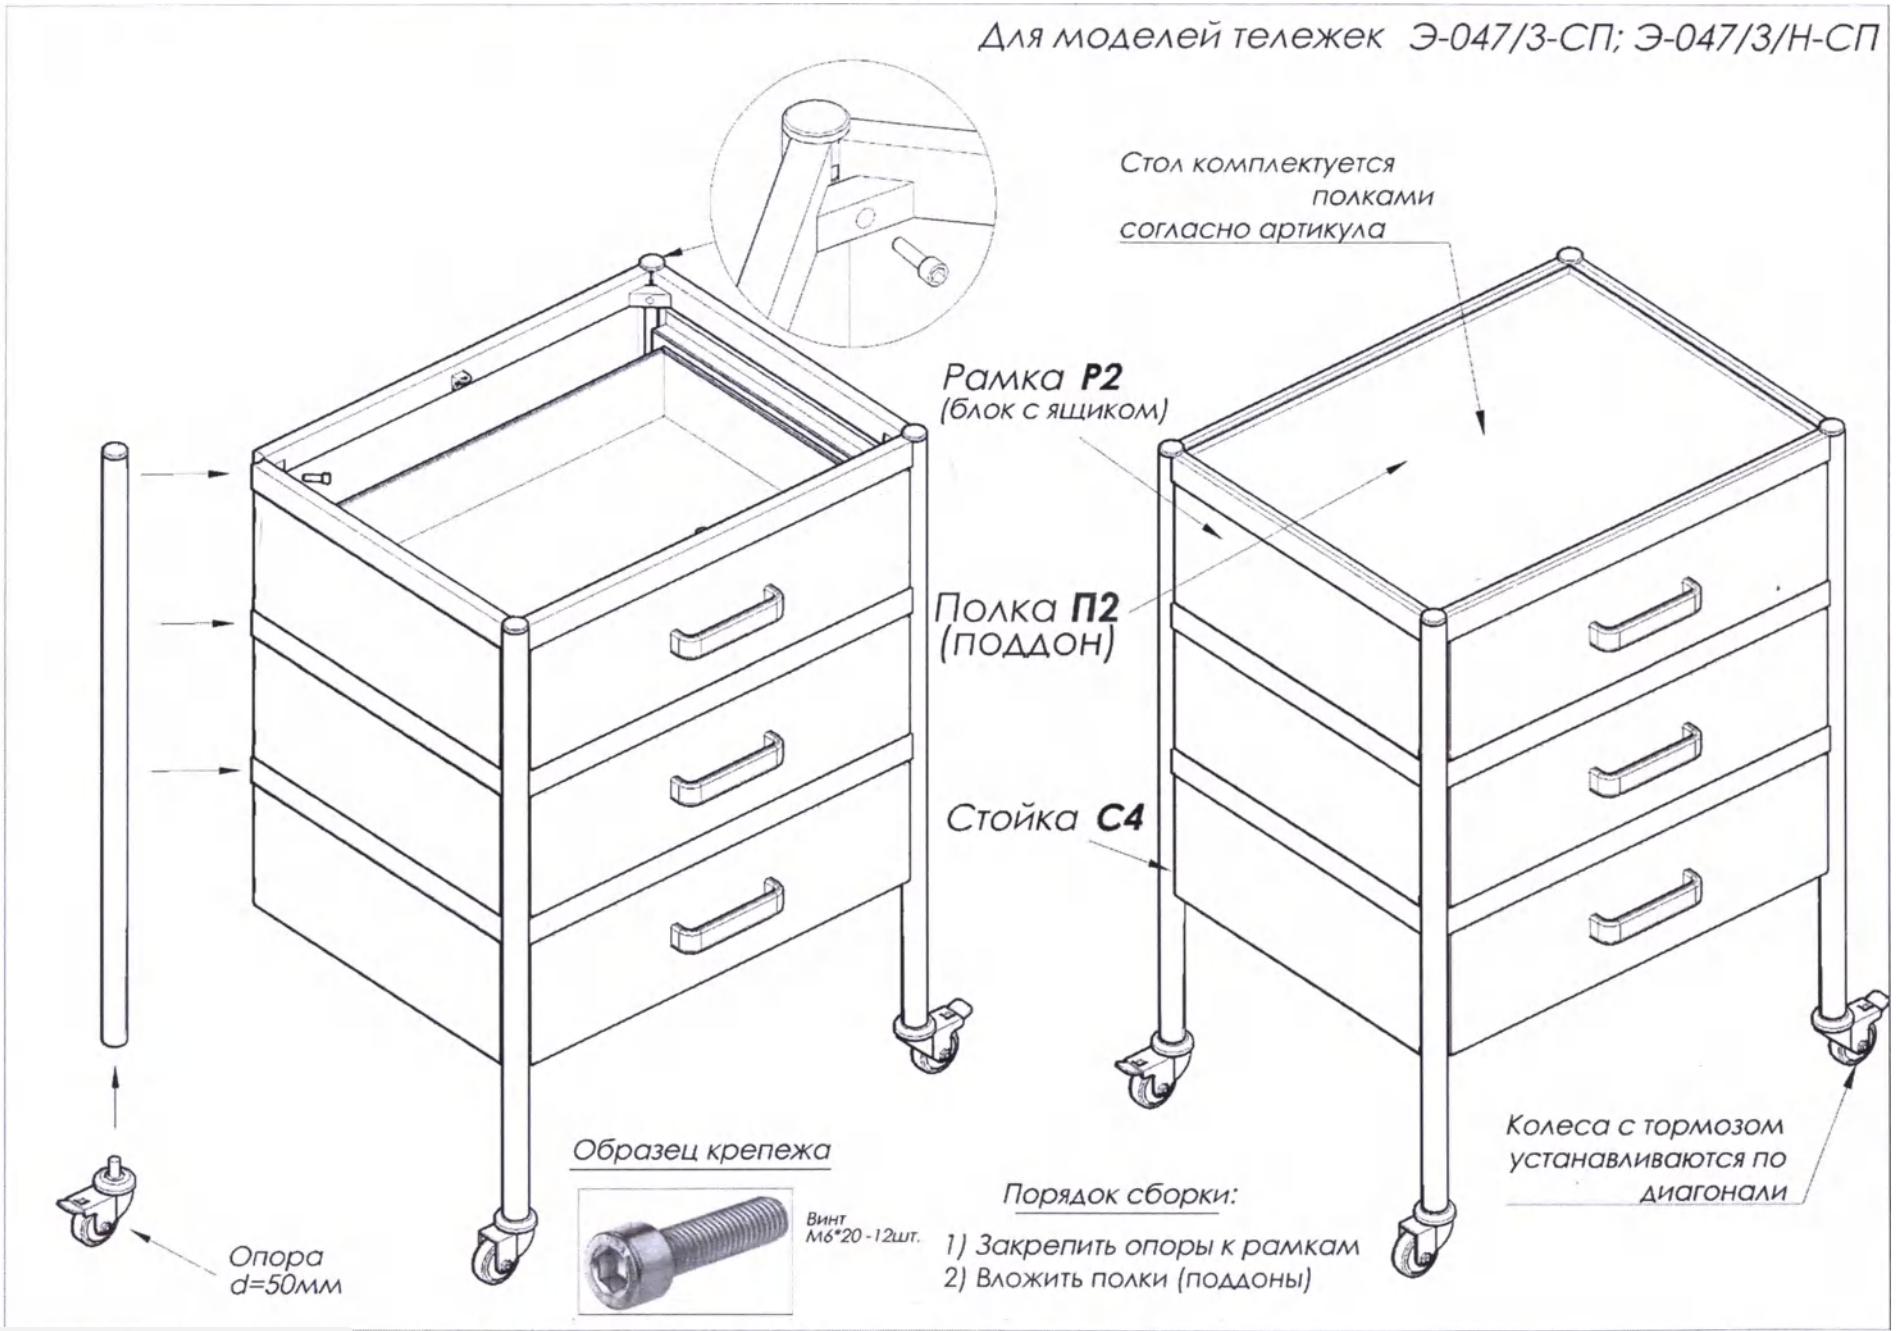

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/3-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047/3-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э.А./
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-041/Н-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-041/Н-СП** (далее – тележка). Тележка одит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования стринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка дицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	**575*450*800**	**9,4±0,5**		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	2
С 1	Стойка с колесной опорой	4
П 1	Полка стеклянная	1
П 2	Полка (поддон нержавеющий)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111, Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
аркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль по ГОСТ 13663, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
оминальное отклонение габаритных размеров, не олее, мм	4
лиматический класс	УХЛ 4.2
емпература окружающей среды при эксплуатации,	5 - 30
асса нетто, кг	9,4±0,5
азначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой бходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку С1 закрепить к рамкам Р1 двумя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки П1 и П2, внутрь рамки полки Р1
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

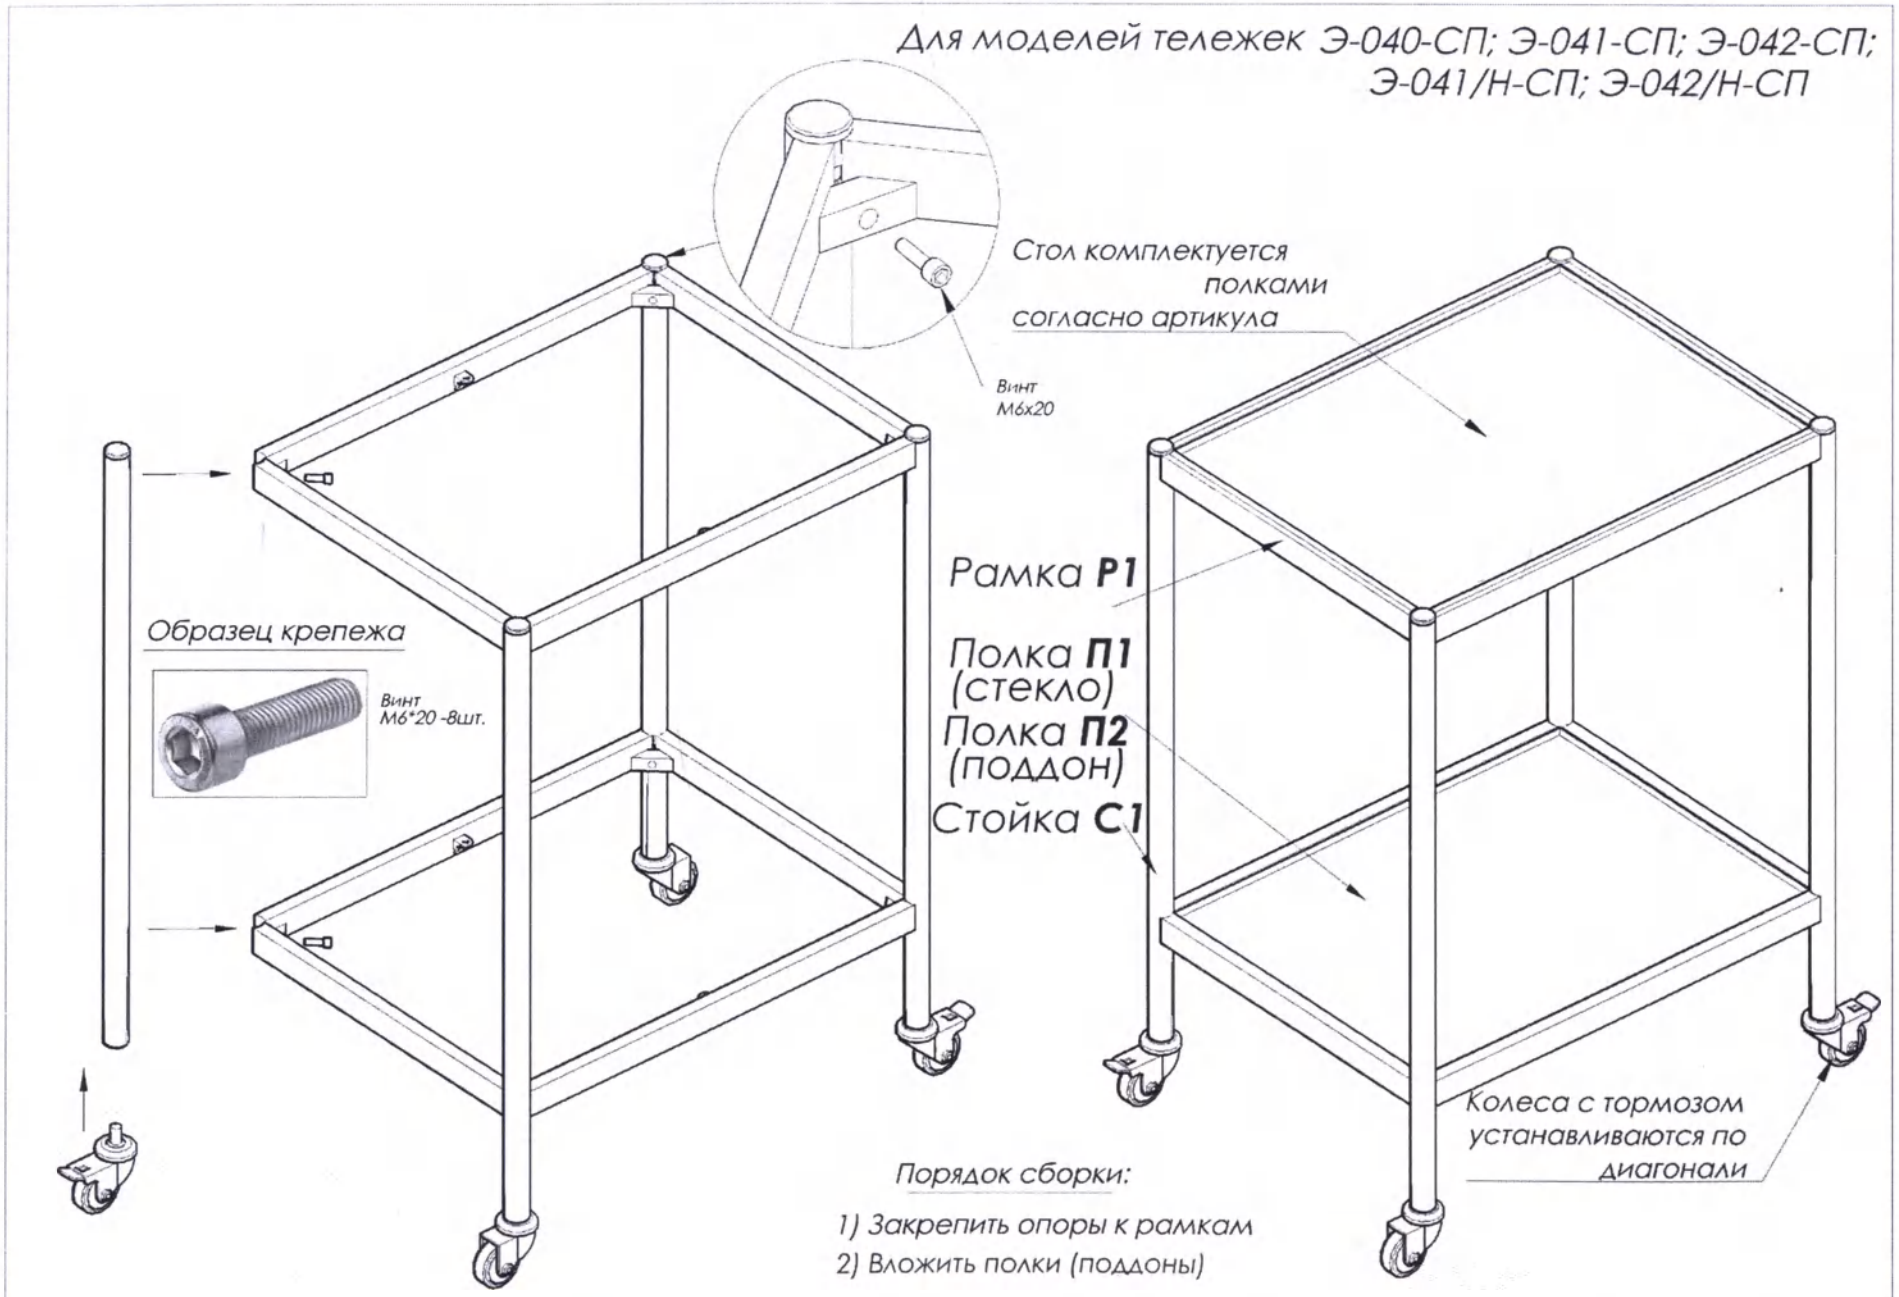

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

1.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси орода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
1.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу одов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке і изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-041/Н-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тележка медицинская Э-041/Н-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-042/Н-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-042/Н-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка едицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	**575*450*800**	**8,7±0,5**		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 1	Стойка с колесной опорой	4
П 2	Полка (поддон нержавейка)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
олки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	5 - 30
Масса нетто, кг	8,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку С1 закрепить к двум рамкам Р1 двумя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить два поддона П2, внутрь рамки полки Р 1.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

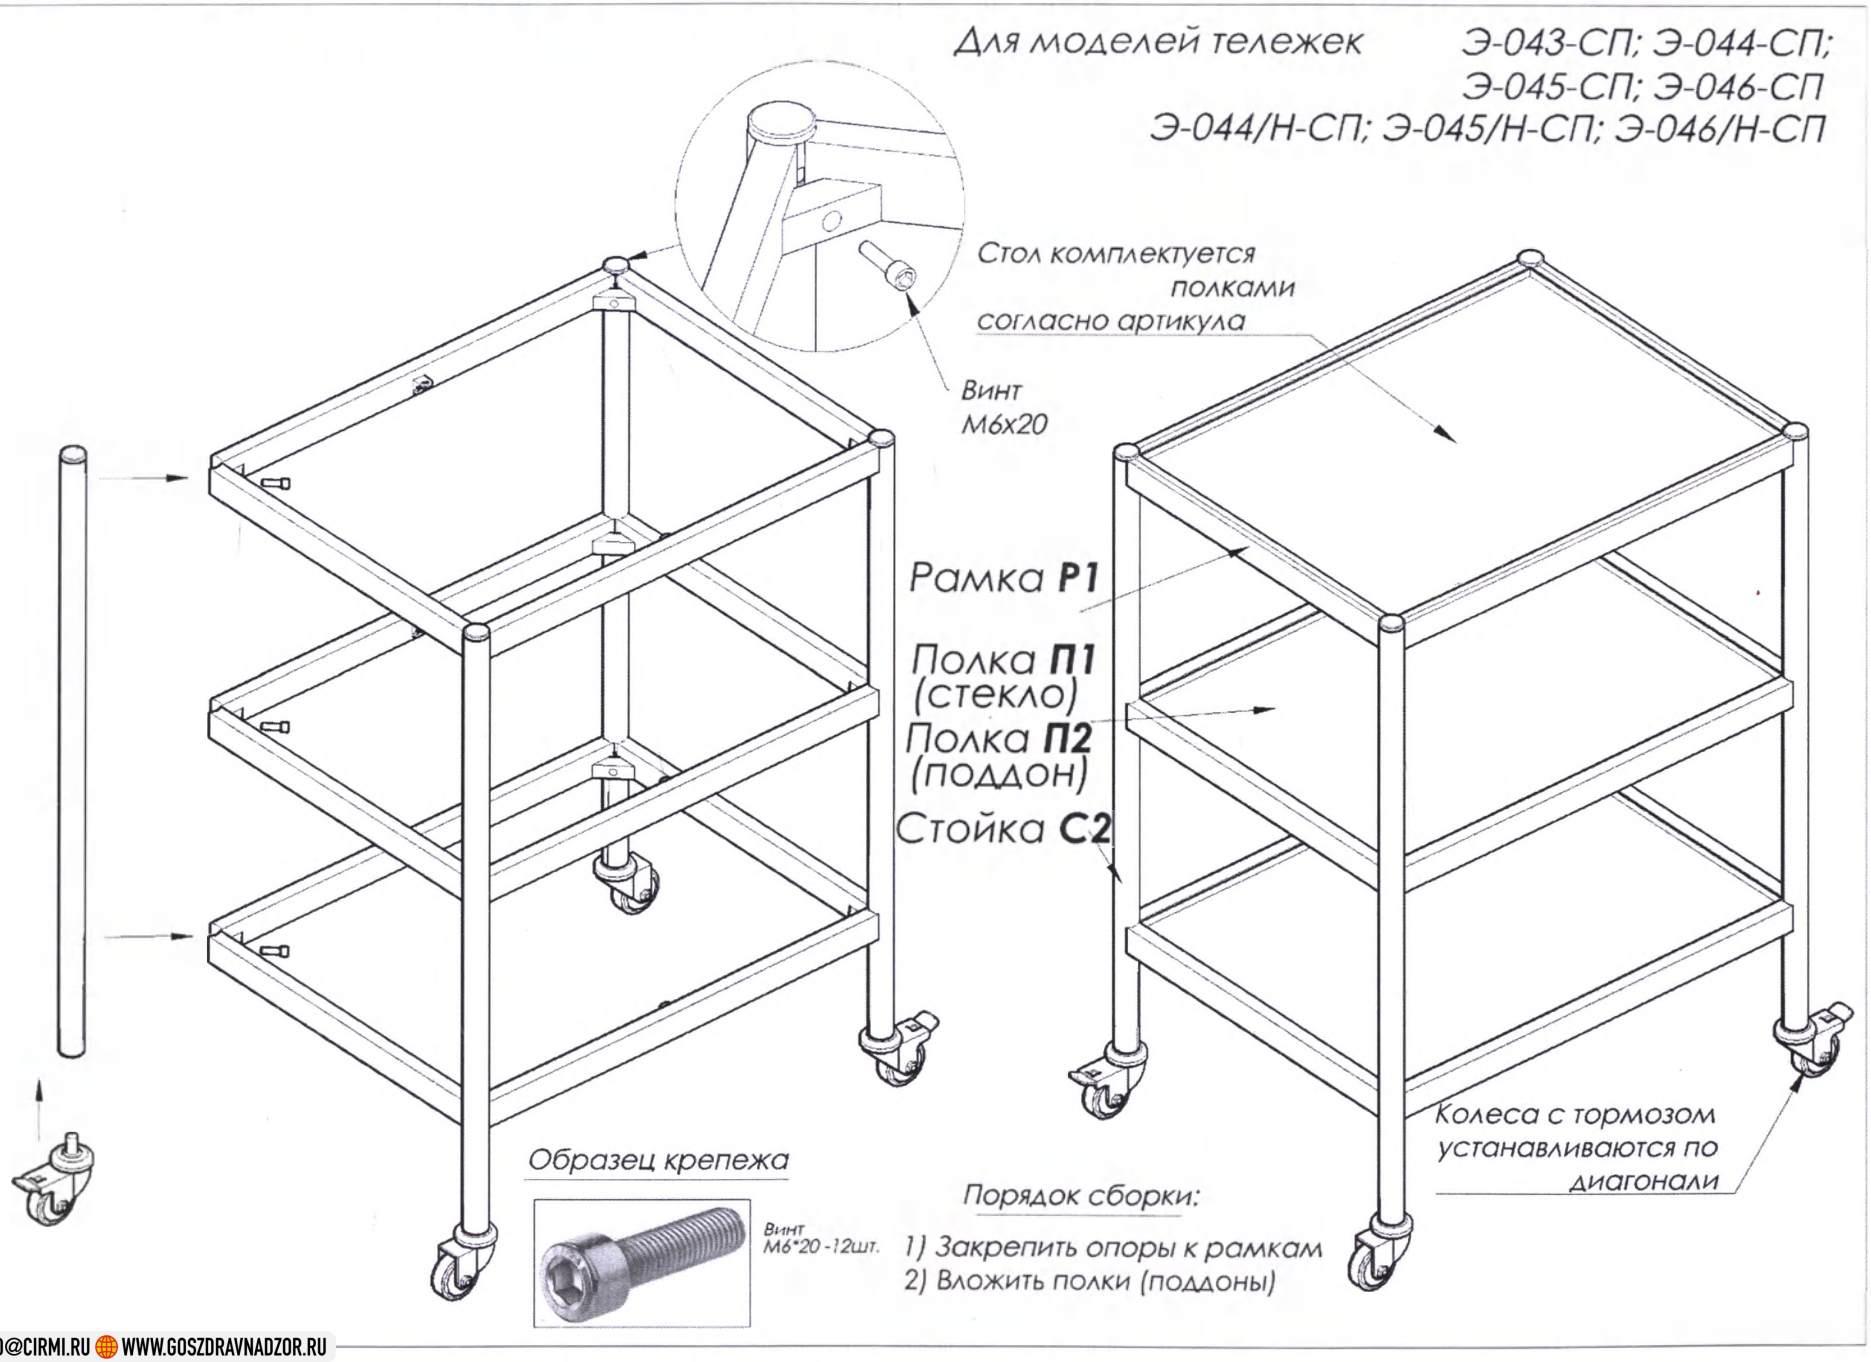

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси орода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу одов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-042/Н-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-042/Н-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-044/Н-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-044/Н-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского орудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, билитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного ководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	**575*450*800**	**12,8±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 2	Стойка с колесной опорой	4
П 1	Полка стеклянная	2
П 2	Полка (поддон нержавеющий)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
олки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111, Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
аркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
оминальное отклонение габаритных размеров, не олее, мм	4
лиматический класс	УХЛ 4.2
емпература окружающей среды при эксплуатации,	5 - 30
асса нетто, кг	12,8±0,5
азначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой бходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных ерхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П1 и П2**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

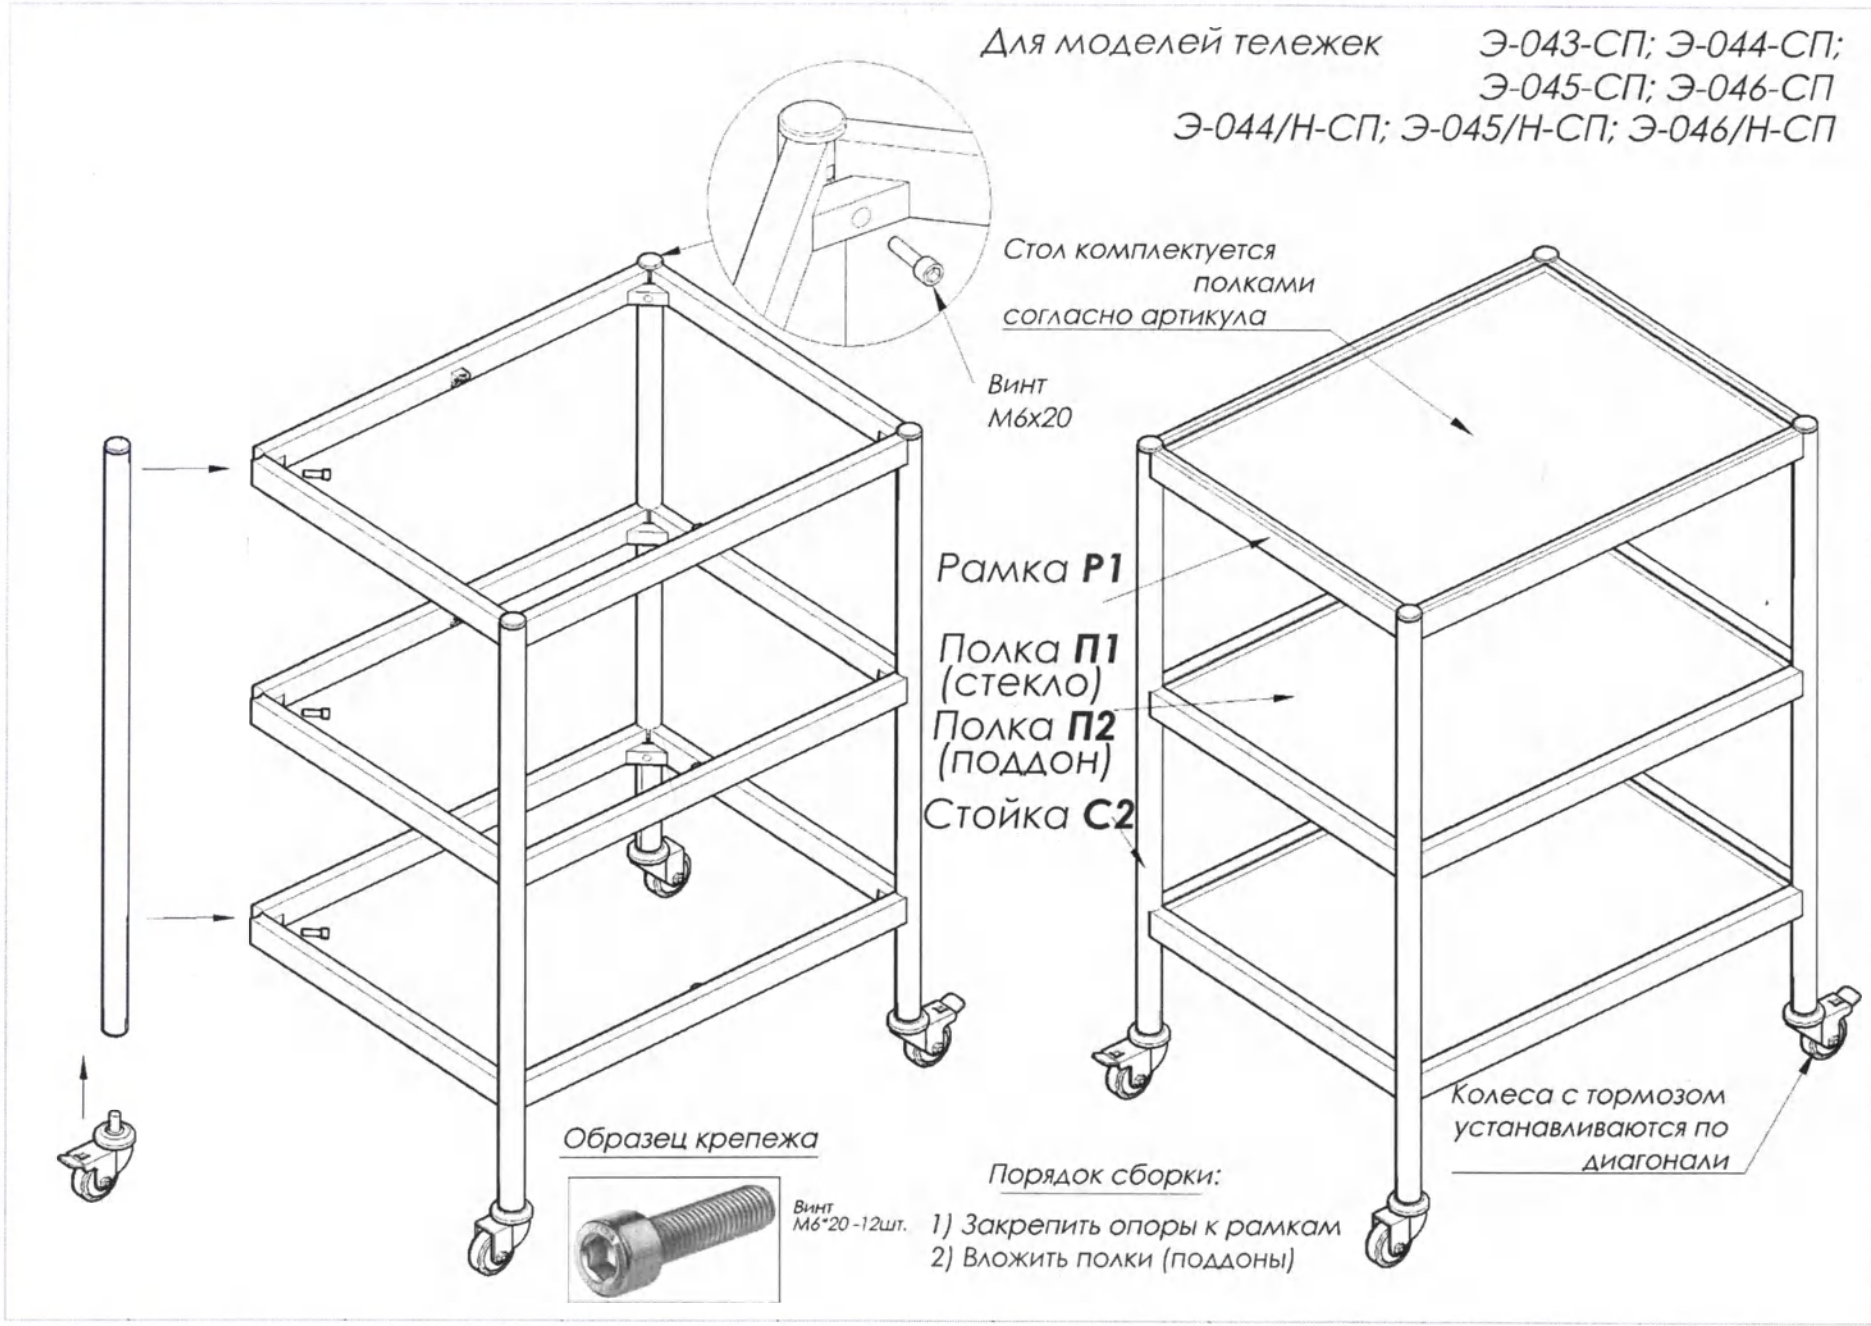

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической лощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-044/Н-СП в количестве ________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-044/Н-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____ Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-045/Н-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-045/Н-СП** (далее – тележка). Тележка одит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	**575*450*800**	**12,3±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 2	Стойка с колесной опорой	4
П 1	Полка стеклянная	1
П 2	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
ıркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
ominальное отклонение габаритных размеров, не олее, мм	4
лиматический класс	УХЛ 4.2
емпература окружающей среды при эксплуатации,	5 - 30
lасса нетто, кг	12,3±0,5
азначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П1 и П2**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

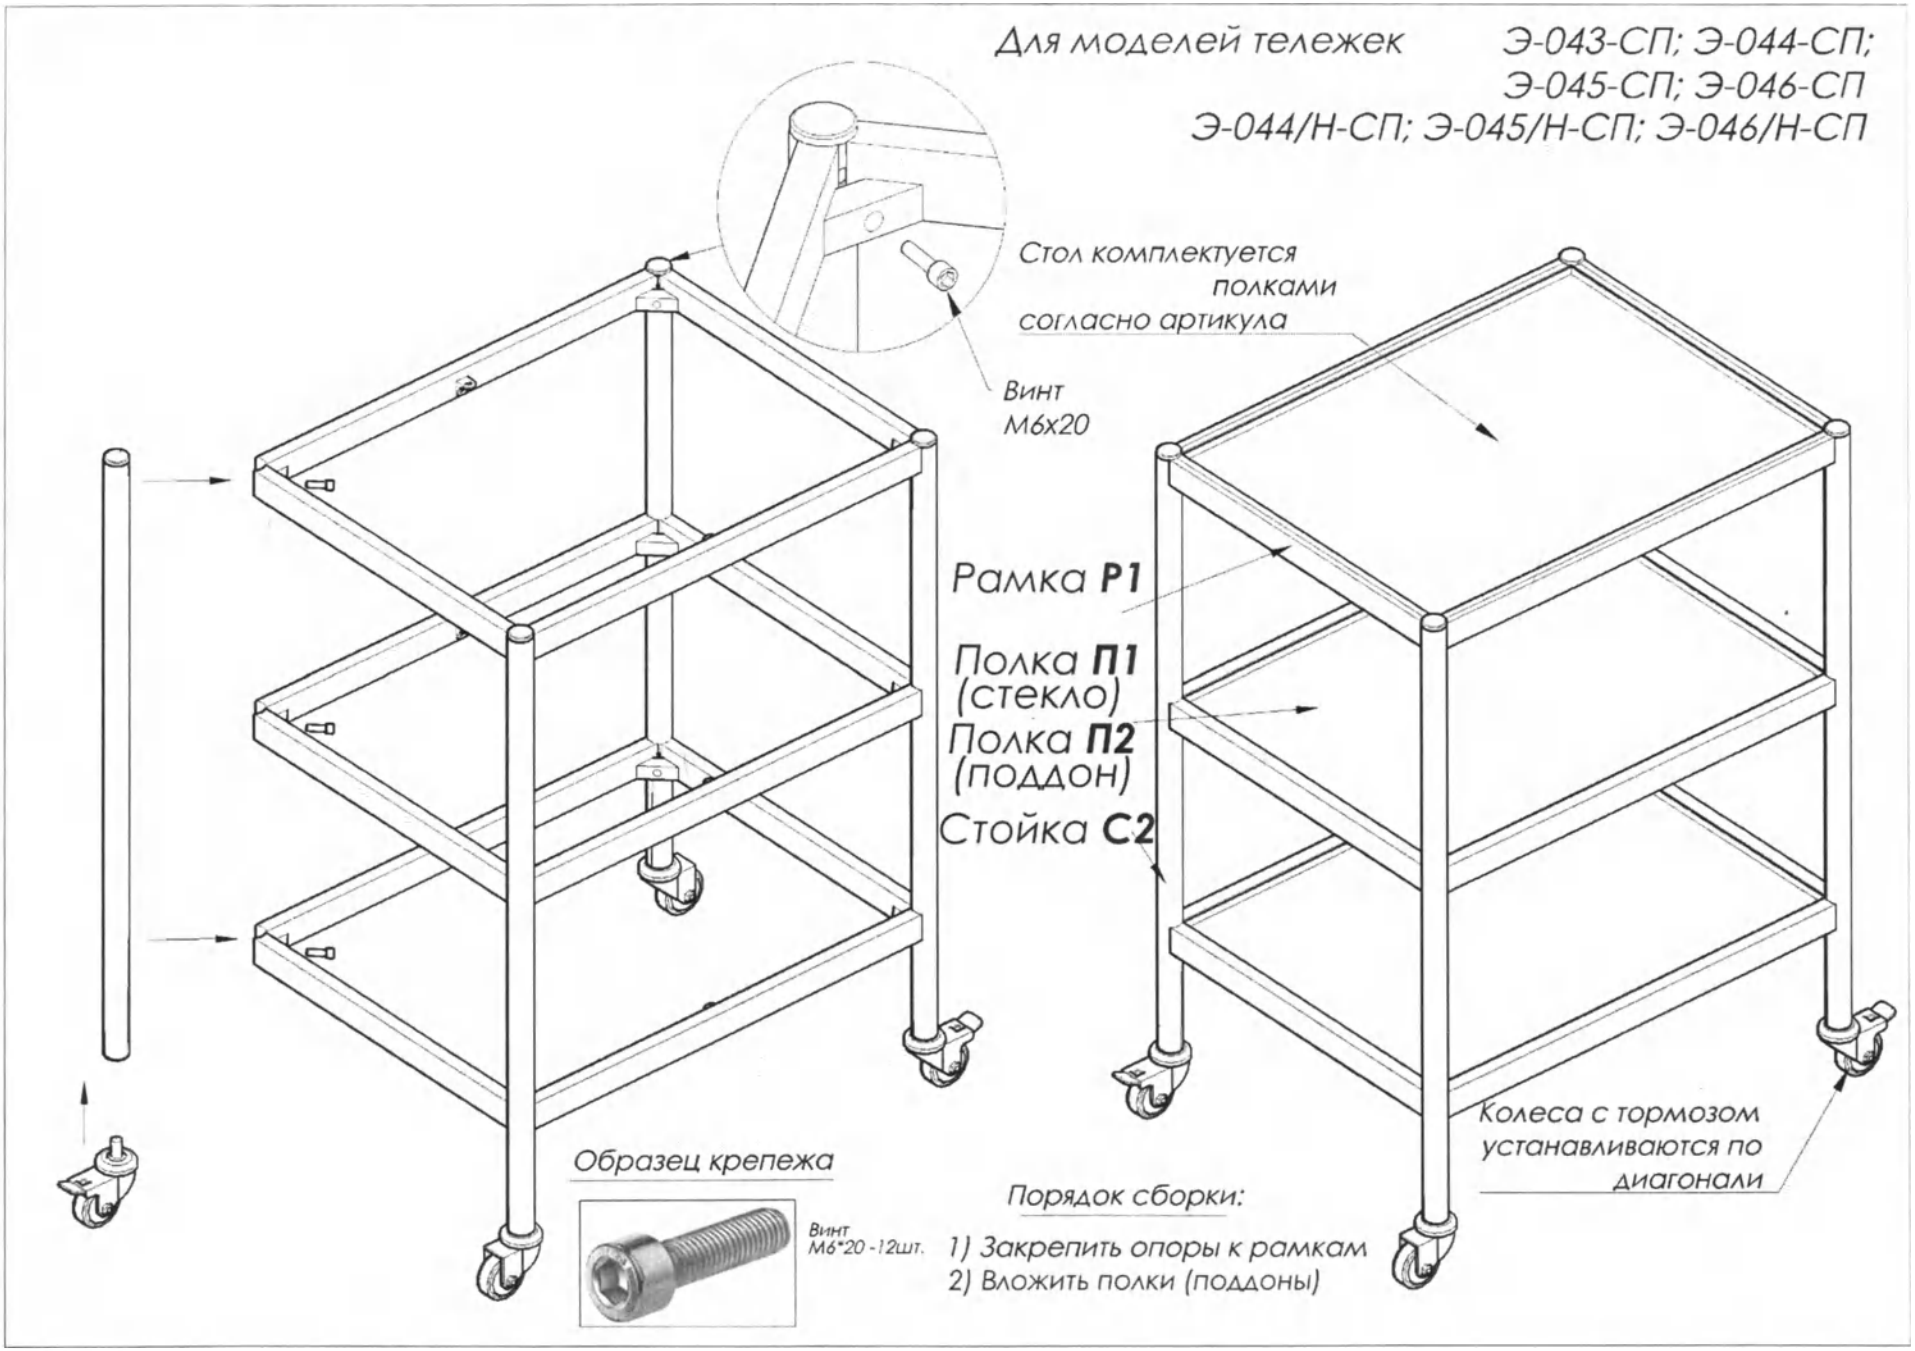

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-045/Н-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП _______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-045/Н-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-046/Н-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-046/Н-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	**575*450*800**	**11,5±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 2	Стойка с колесной опорой	4
П 2	Полка (поддон нержавеющий)	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	11,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных ерхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - полки **П2**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

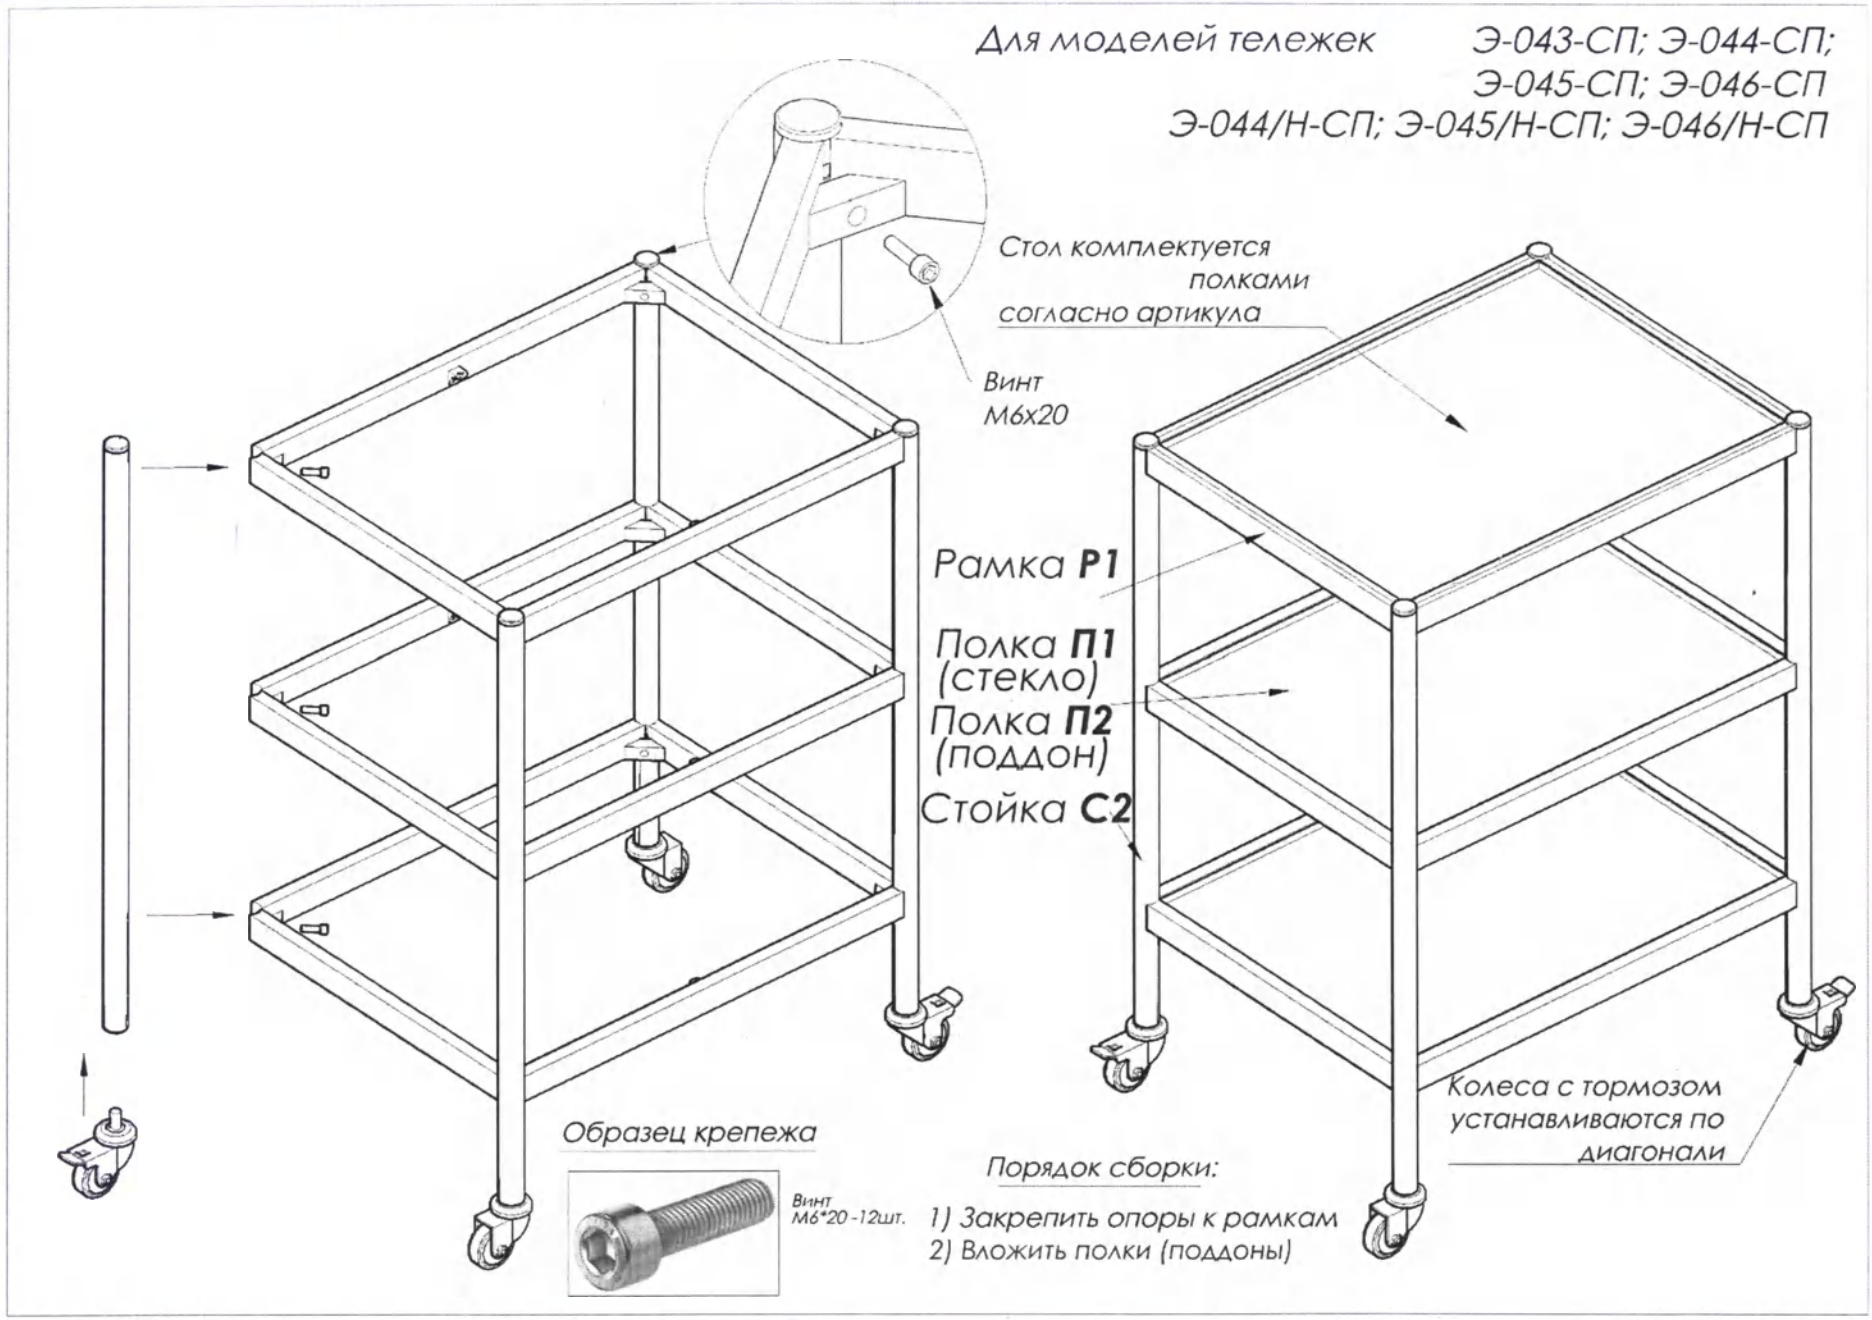

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

1.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси орода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
1.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу одов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке і изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-046/Н-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-046/Н-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/Н-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/Н-СП** (далее – тележка). Тележка одит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	**575*450*800**	**15,1±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
Р1	Рамка полки	1
С1	Стойка с колесной опорой	4
П2	Полка (поддон нержавеющий)	2
Р2	Рамка с блоком ящика	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х20	8

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Ящик	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	15,1±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С1** закрепить к рамке (с блок ящиком) **Р2**, и рамке **Р1** – двумя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П 2,** внутрь рамки **Р2 и Р1**,
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-047-СП; Э-047/Н-СП

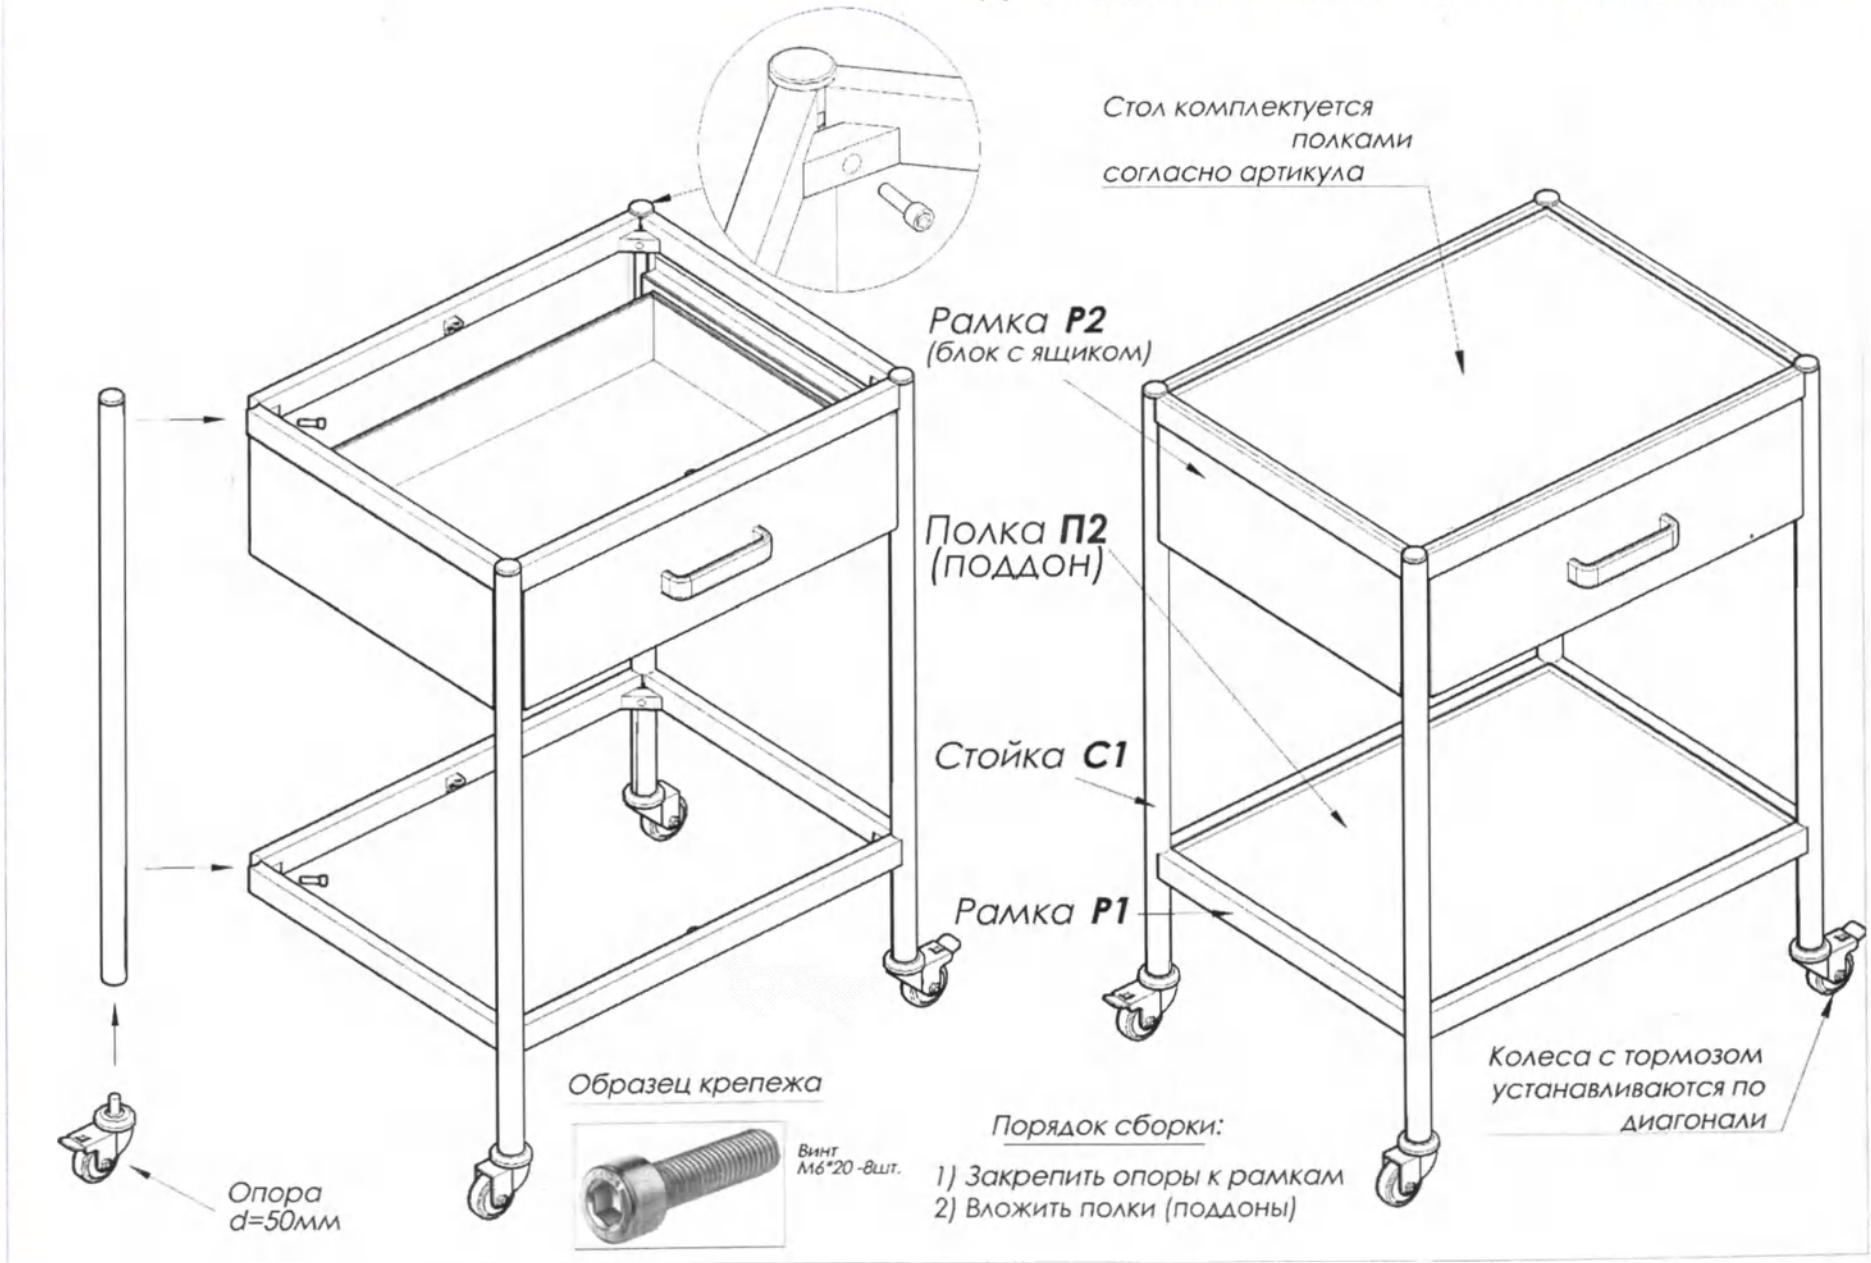

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели делец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических циалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/Н-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с зательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана ным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047/Н-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

оварная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/2/Н-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/2/Н-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка едицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	**575*450*800**	**23,3±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р1	Рамка полки	1
С3	Стойка с колесной опорой	4
П2	Полка (поддон нержавеющий)	2
Р2	Рамка полки с ящиком	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Ящики	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	23,3±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С3** закрепить к рамкам (с блок ящиками) **Р2**, и рамке **Р1** – тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить поддоны **П2,** внутрь рамки **Р2 и Р1**,
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

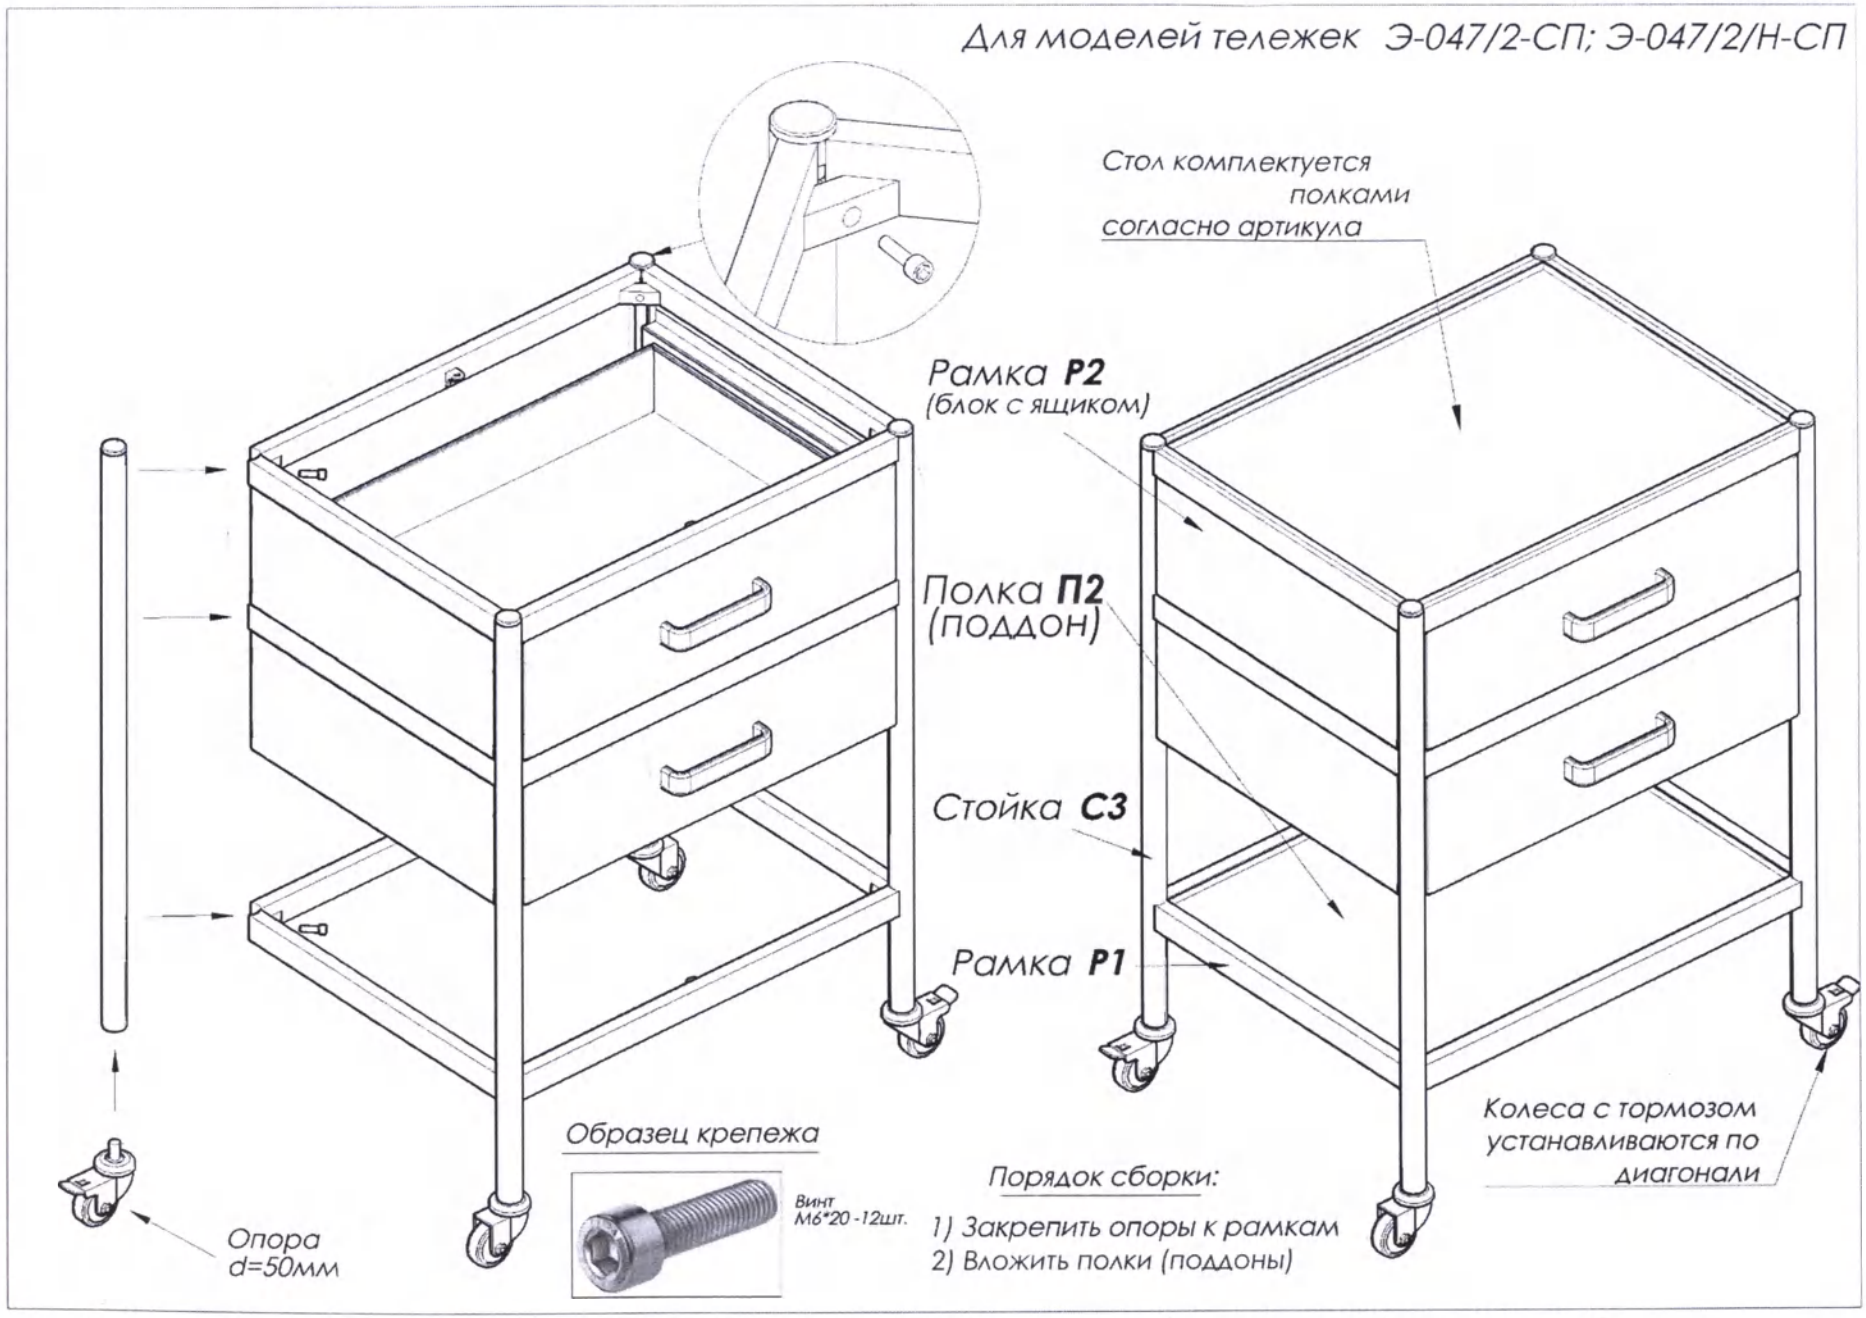

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ющью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/2/Н-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ________________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-047/2/Н-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э.А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-047/3/Н-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-047/3/Н-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
1.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	**575*450*800**	**31,5±0,5**		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
Р2	Рамка с блоком ящика	3
С4	Стойка с колесной опорой	4
П2	Полка (поддон нержавеющий)	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х20	12

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Ящики	Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка, поддоны)	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	31,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С4** закрепить к рамкам (с блок ящиками) **Р2** – тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить поддон **П2,** внутрь рамки **Р2**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

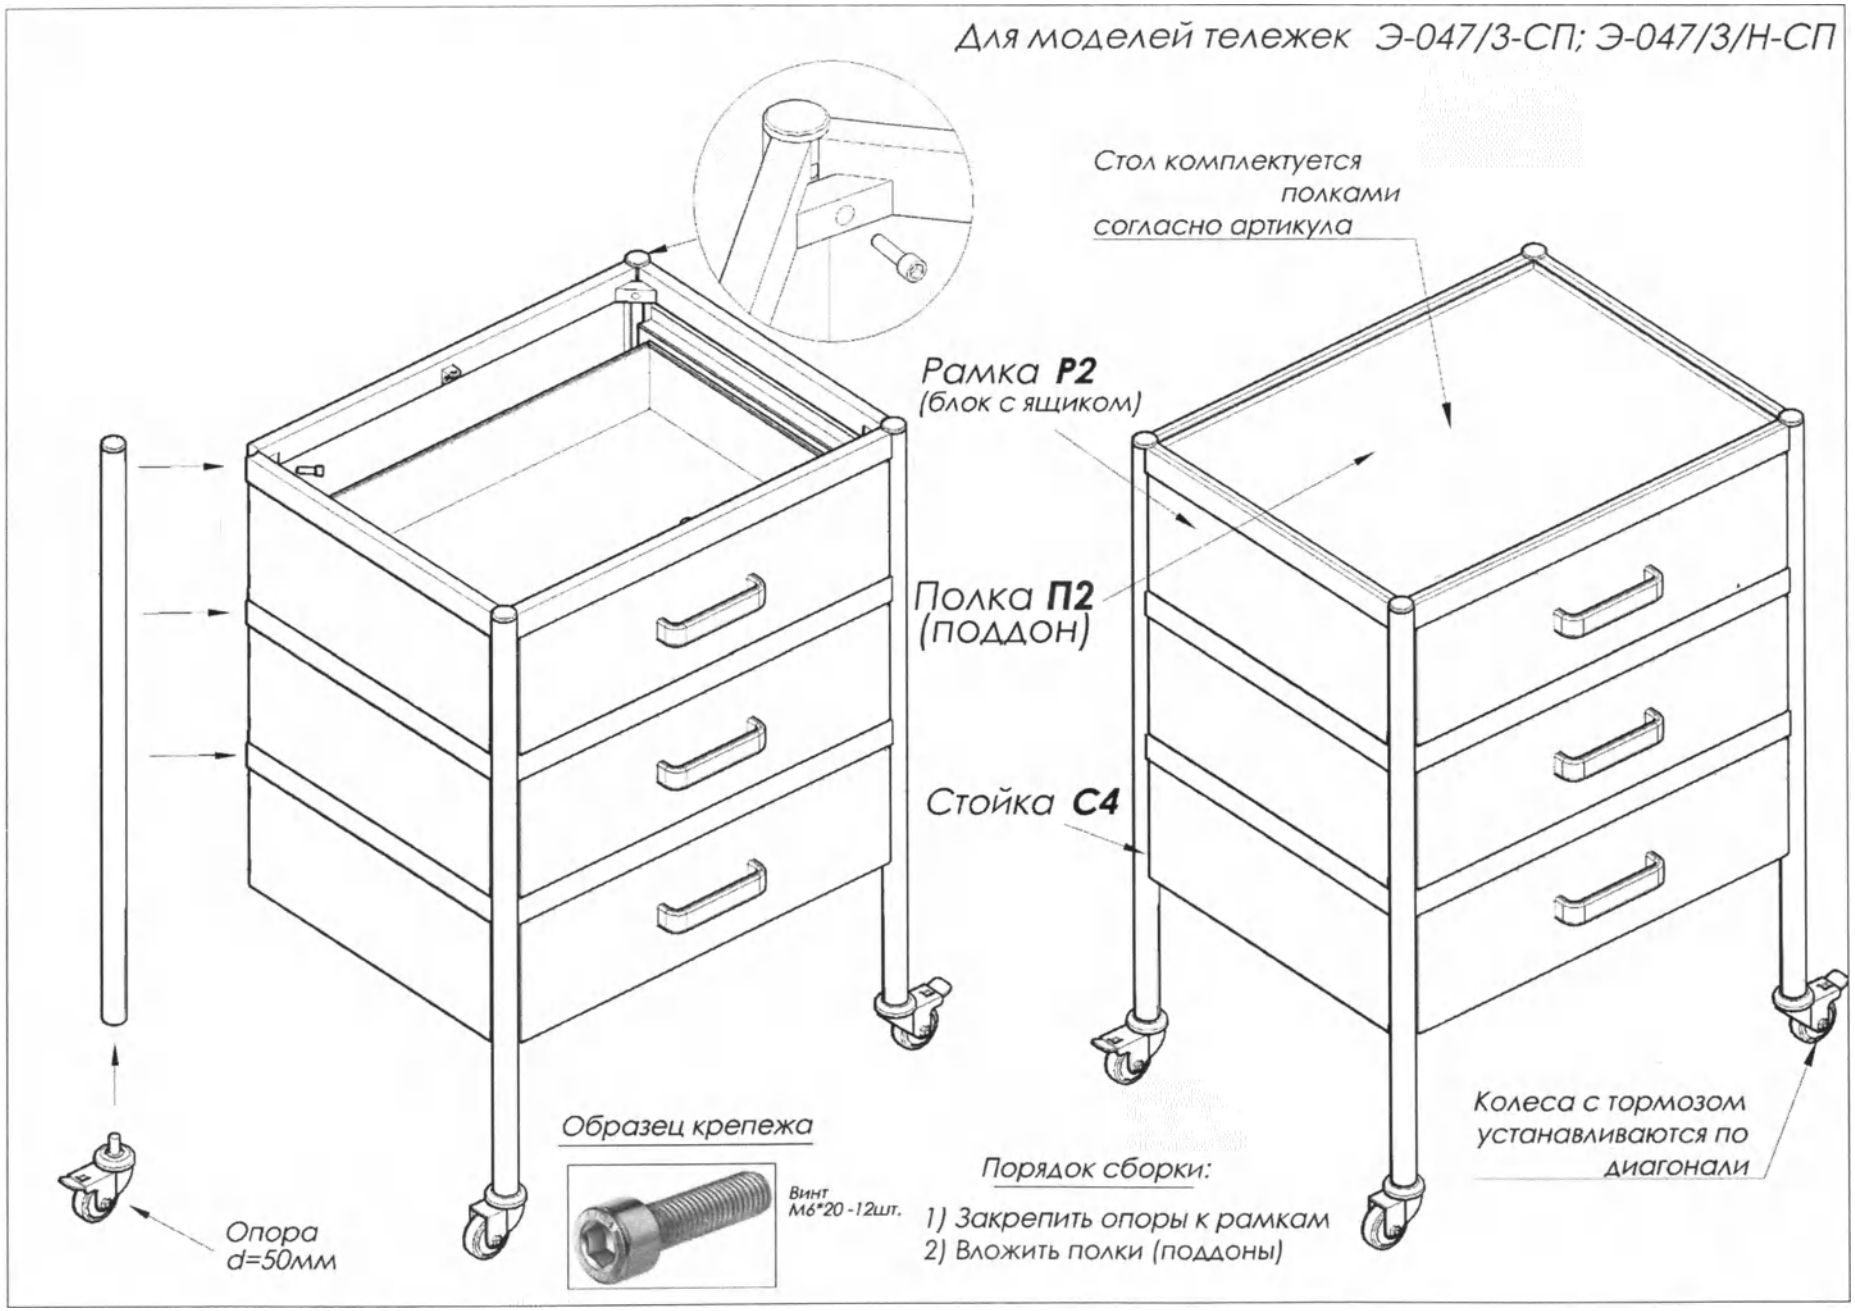

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

.1.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси орода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие азивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу одов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-047/3/Н-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тележка медицинская Э-047/3/Н-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-140-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-140-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	**550*345*770**	**12,85±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
Р 1	Рамка полки	2
С 1	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 2	Полка стеклянная	2
	Крепежные изделия	
	Винт М6х20	8

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	12,85±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С1** закрепить к двум рамкам Р1 двумя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить две полки **П2,** внутрь рамки полки **Р 1.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-140-СП; Э-141-СП; Э-142-СП;

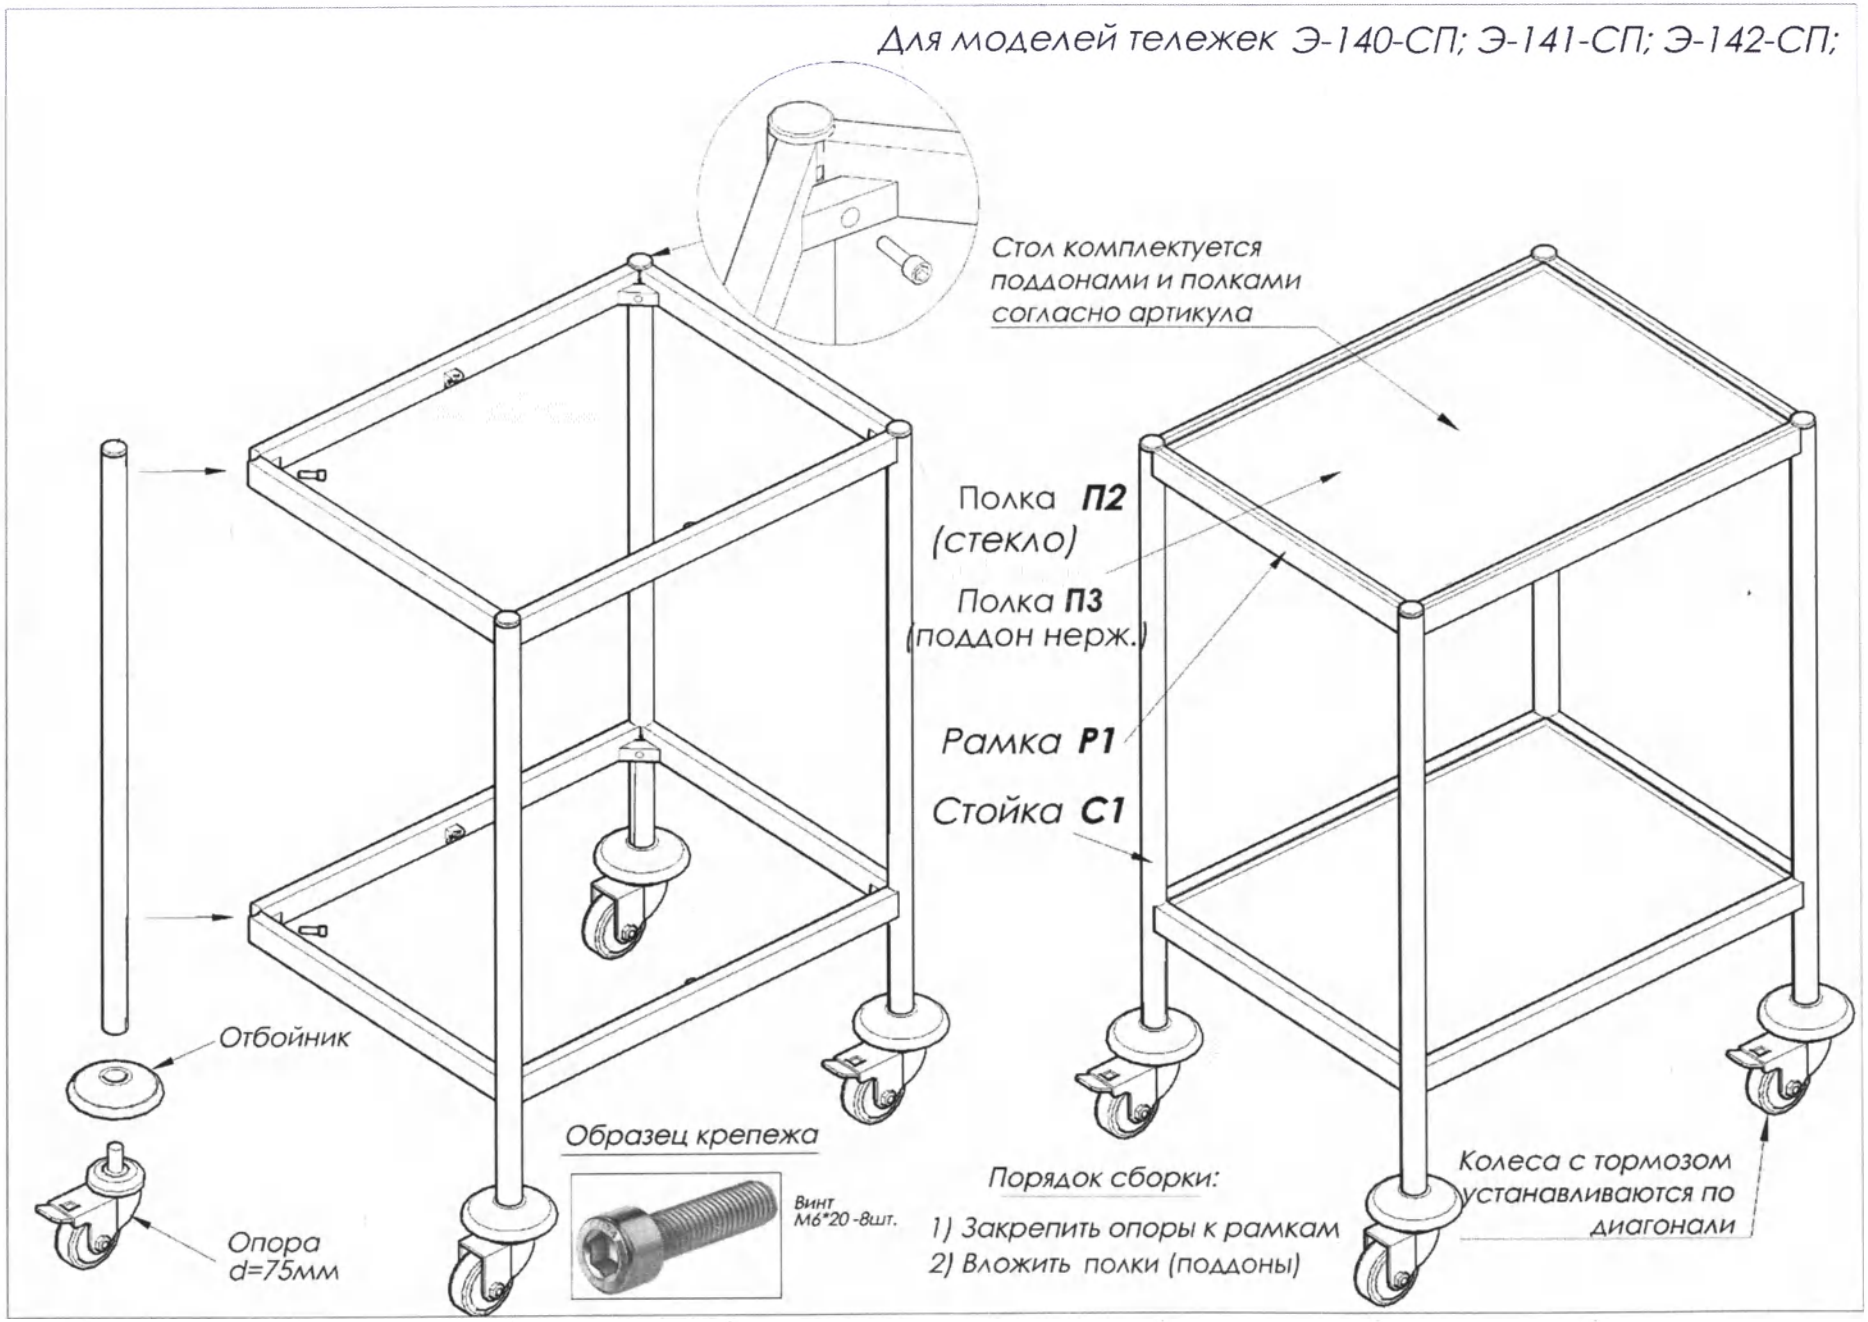

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси юрода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-140-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ _________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тележка медицинская Э-140-СП

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дроздов Э. А.** /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-141-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-141-СП** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
12 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	**550*345*770**	**11,95±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
Р 1	Рамка полки	2
С 1	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 2	Полка стеклянная	1
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х20	8

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	11,95±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С1** закрепить к двум рамкам **Р1** двумя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П2 и П3,** внутрь рамки полки **Р 1.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

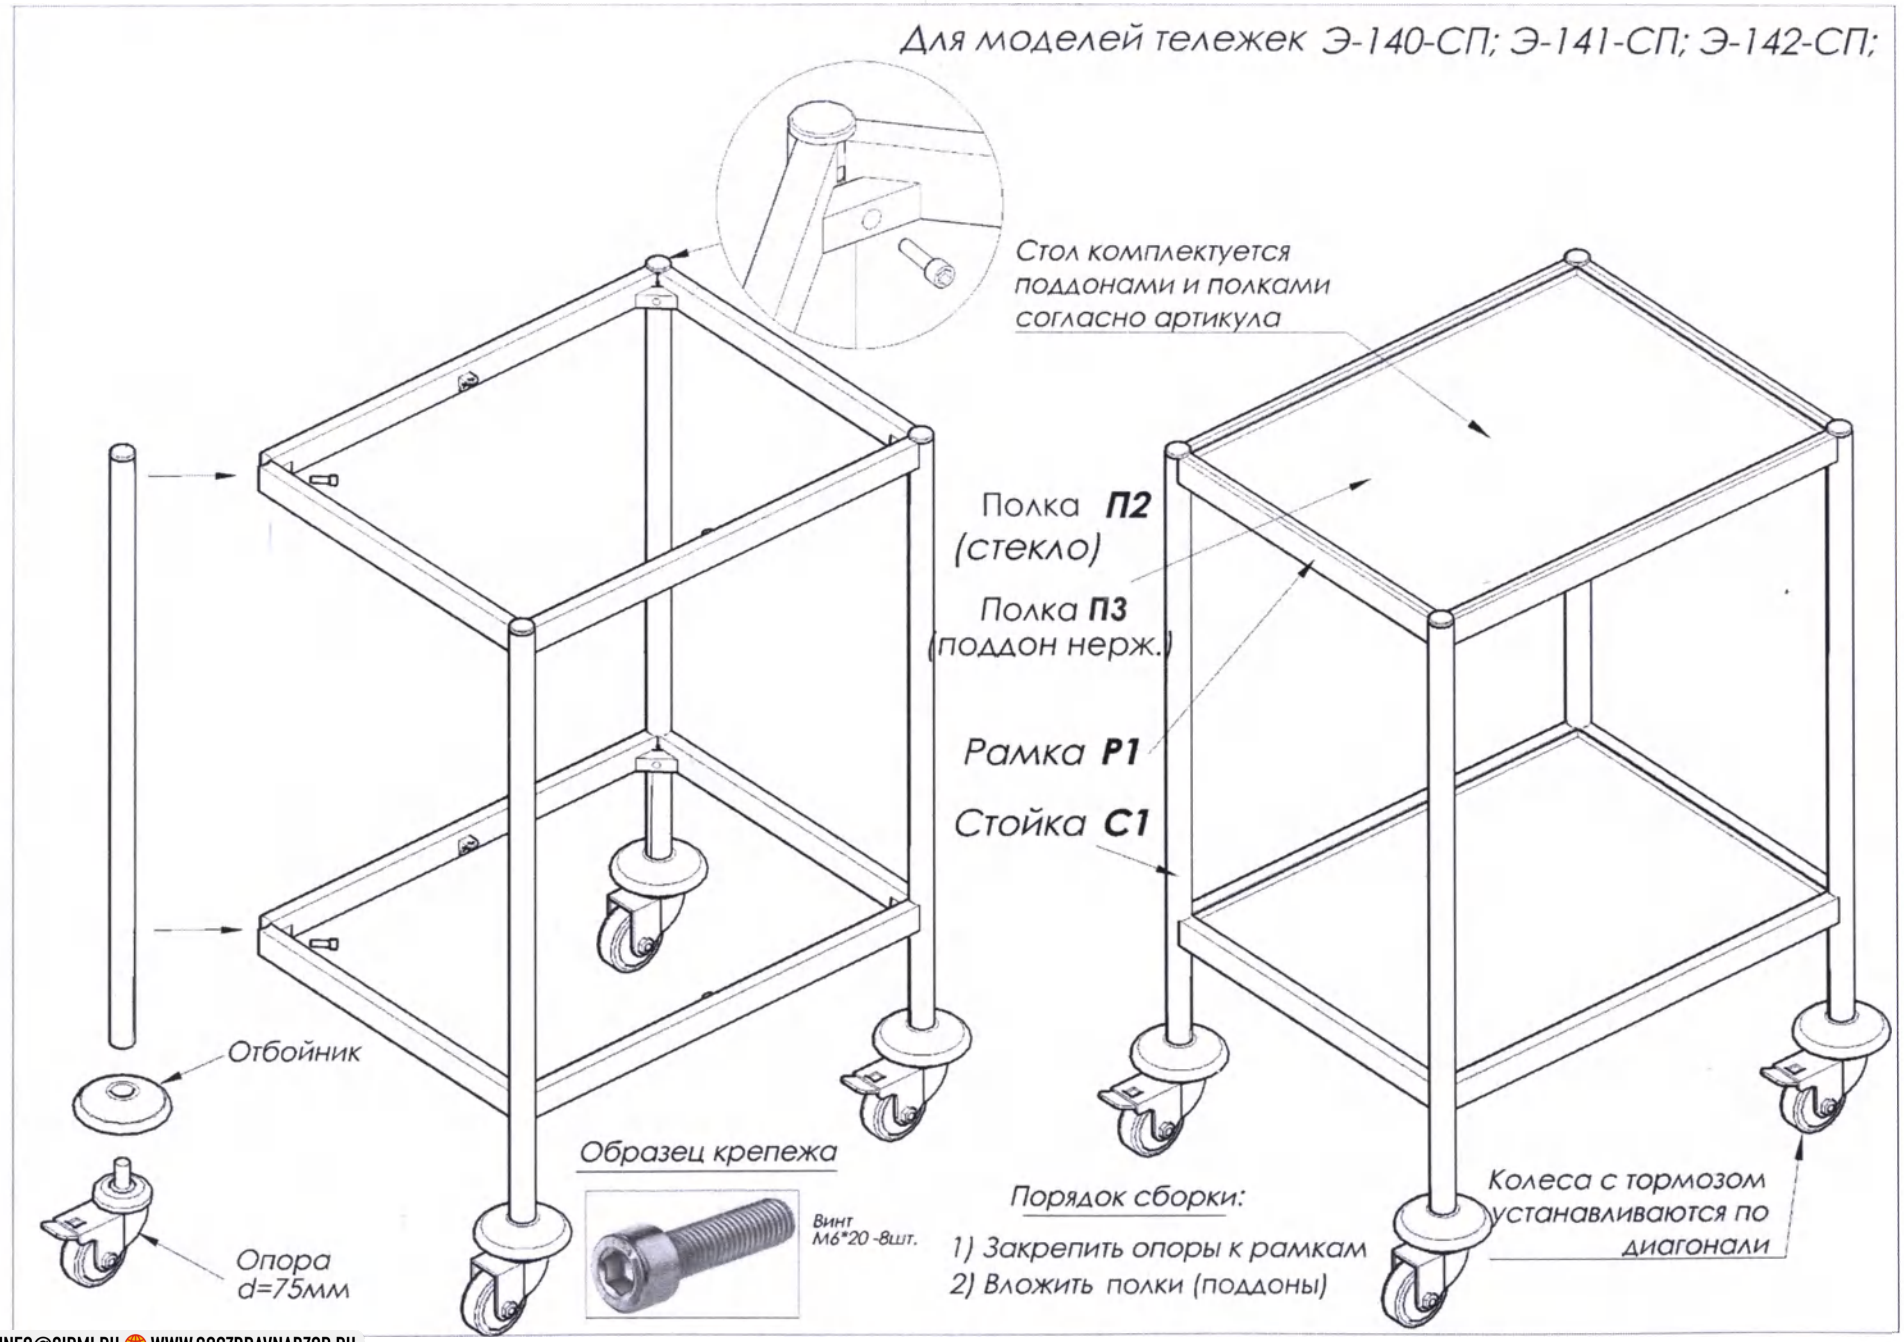

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-141-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-141-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-142-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-142-СП** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-12494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	**550*345*770**	**11,14±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

аименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р 1	Рамка полки	2
С 1	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	11,14±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С1** закрепить к двум рамкам **Р1** двумя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить два поддона **П3,** внутрь рамки полки **Р 1.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-140-СП; Э-141-СП; Э-142-СП;

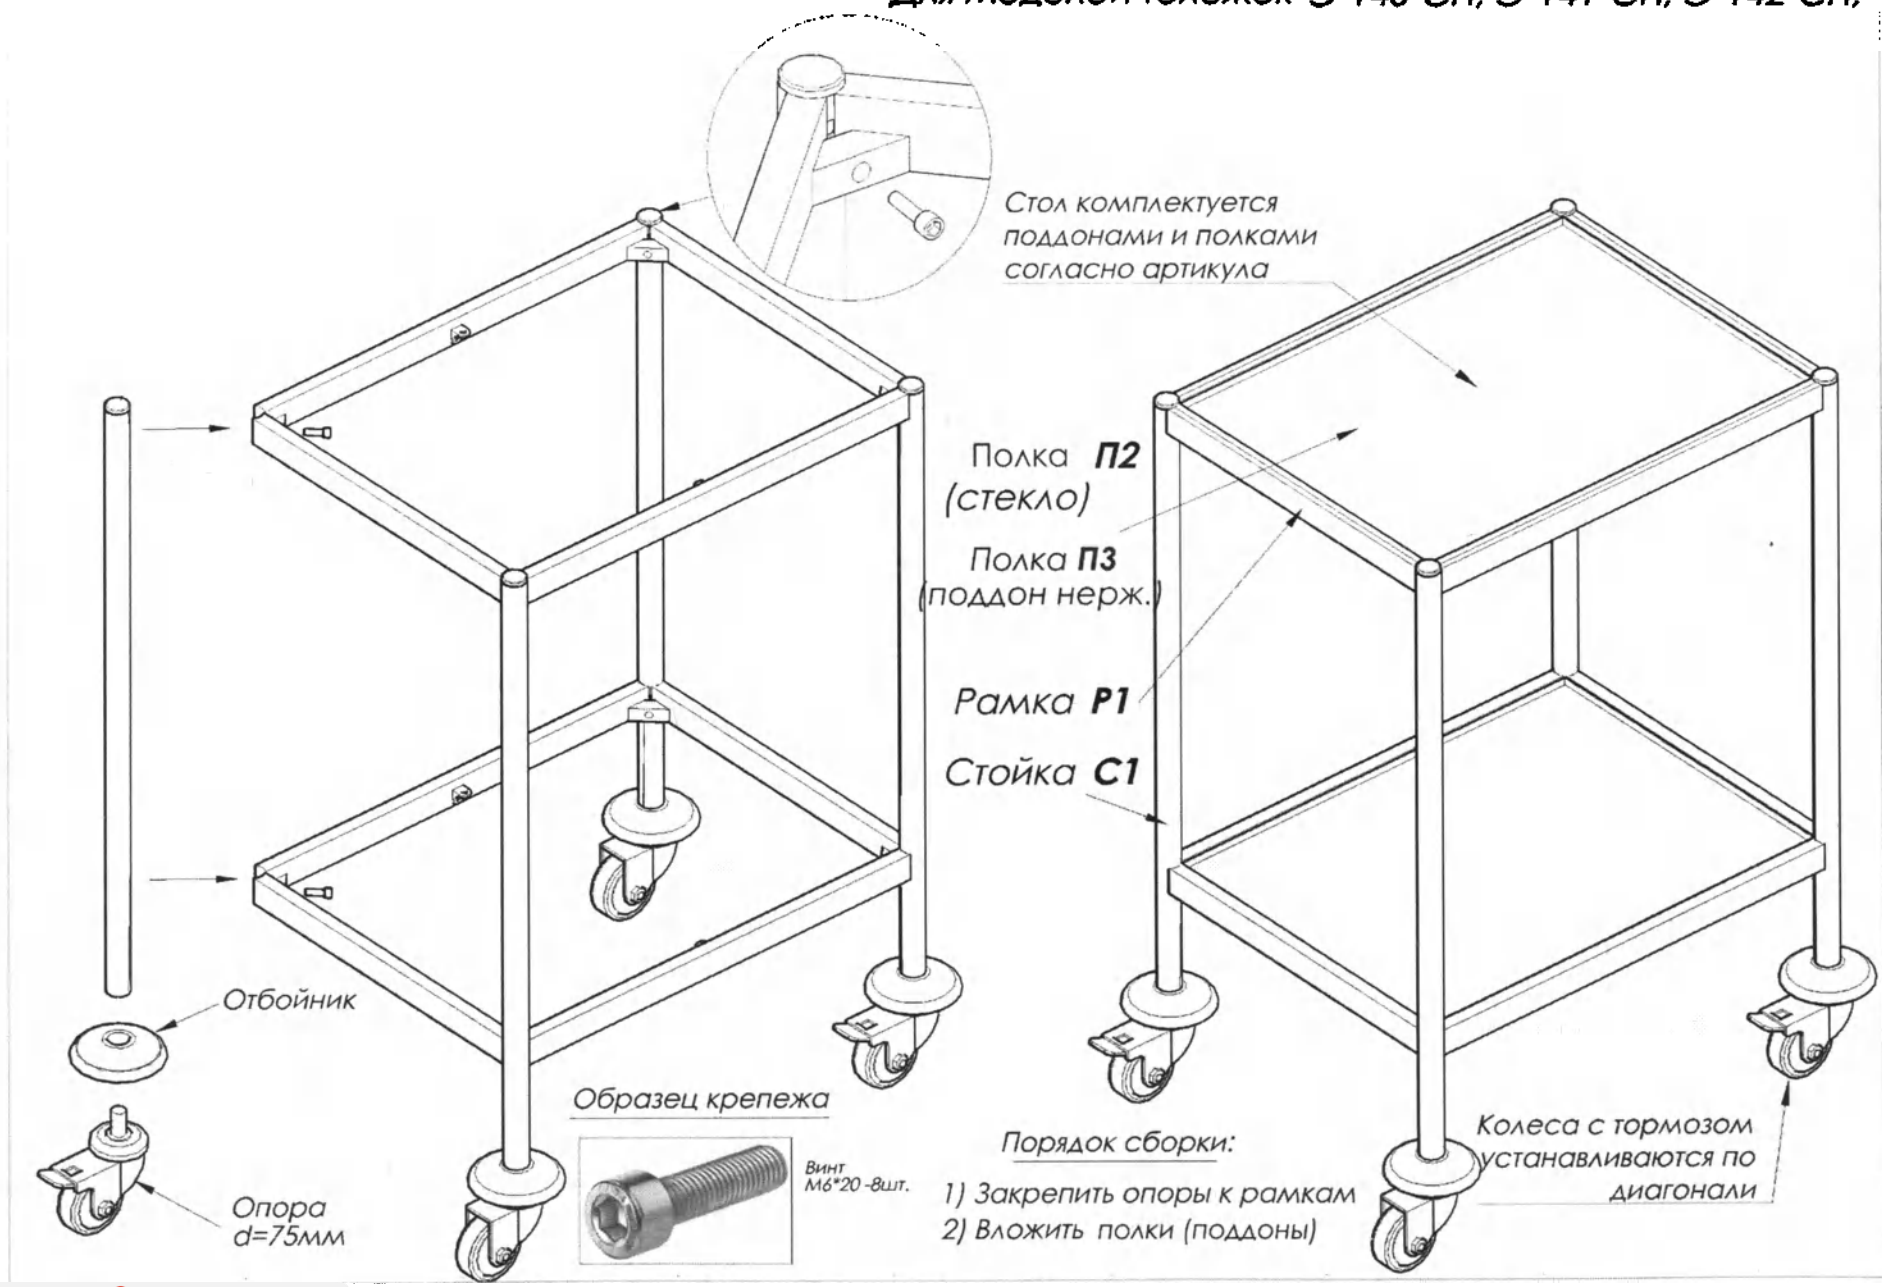

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели іаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических іециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-142-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ _________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тележка медицинская Э-142-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дроздов Э. А. /

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-143-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-143-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	**550*345*770**	**16,9±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 2	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 2	Полка стеклянная	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	16,9±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П2 ,** внутрь рамки полки **Р 1.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-143-СП; Э-144-СП; Э-145-СП; Э-146-СП

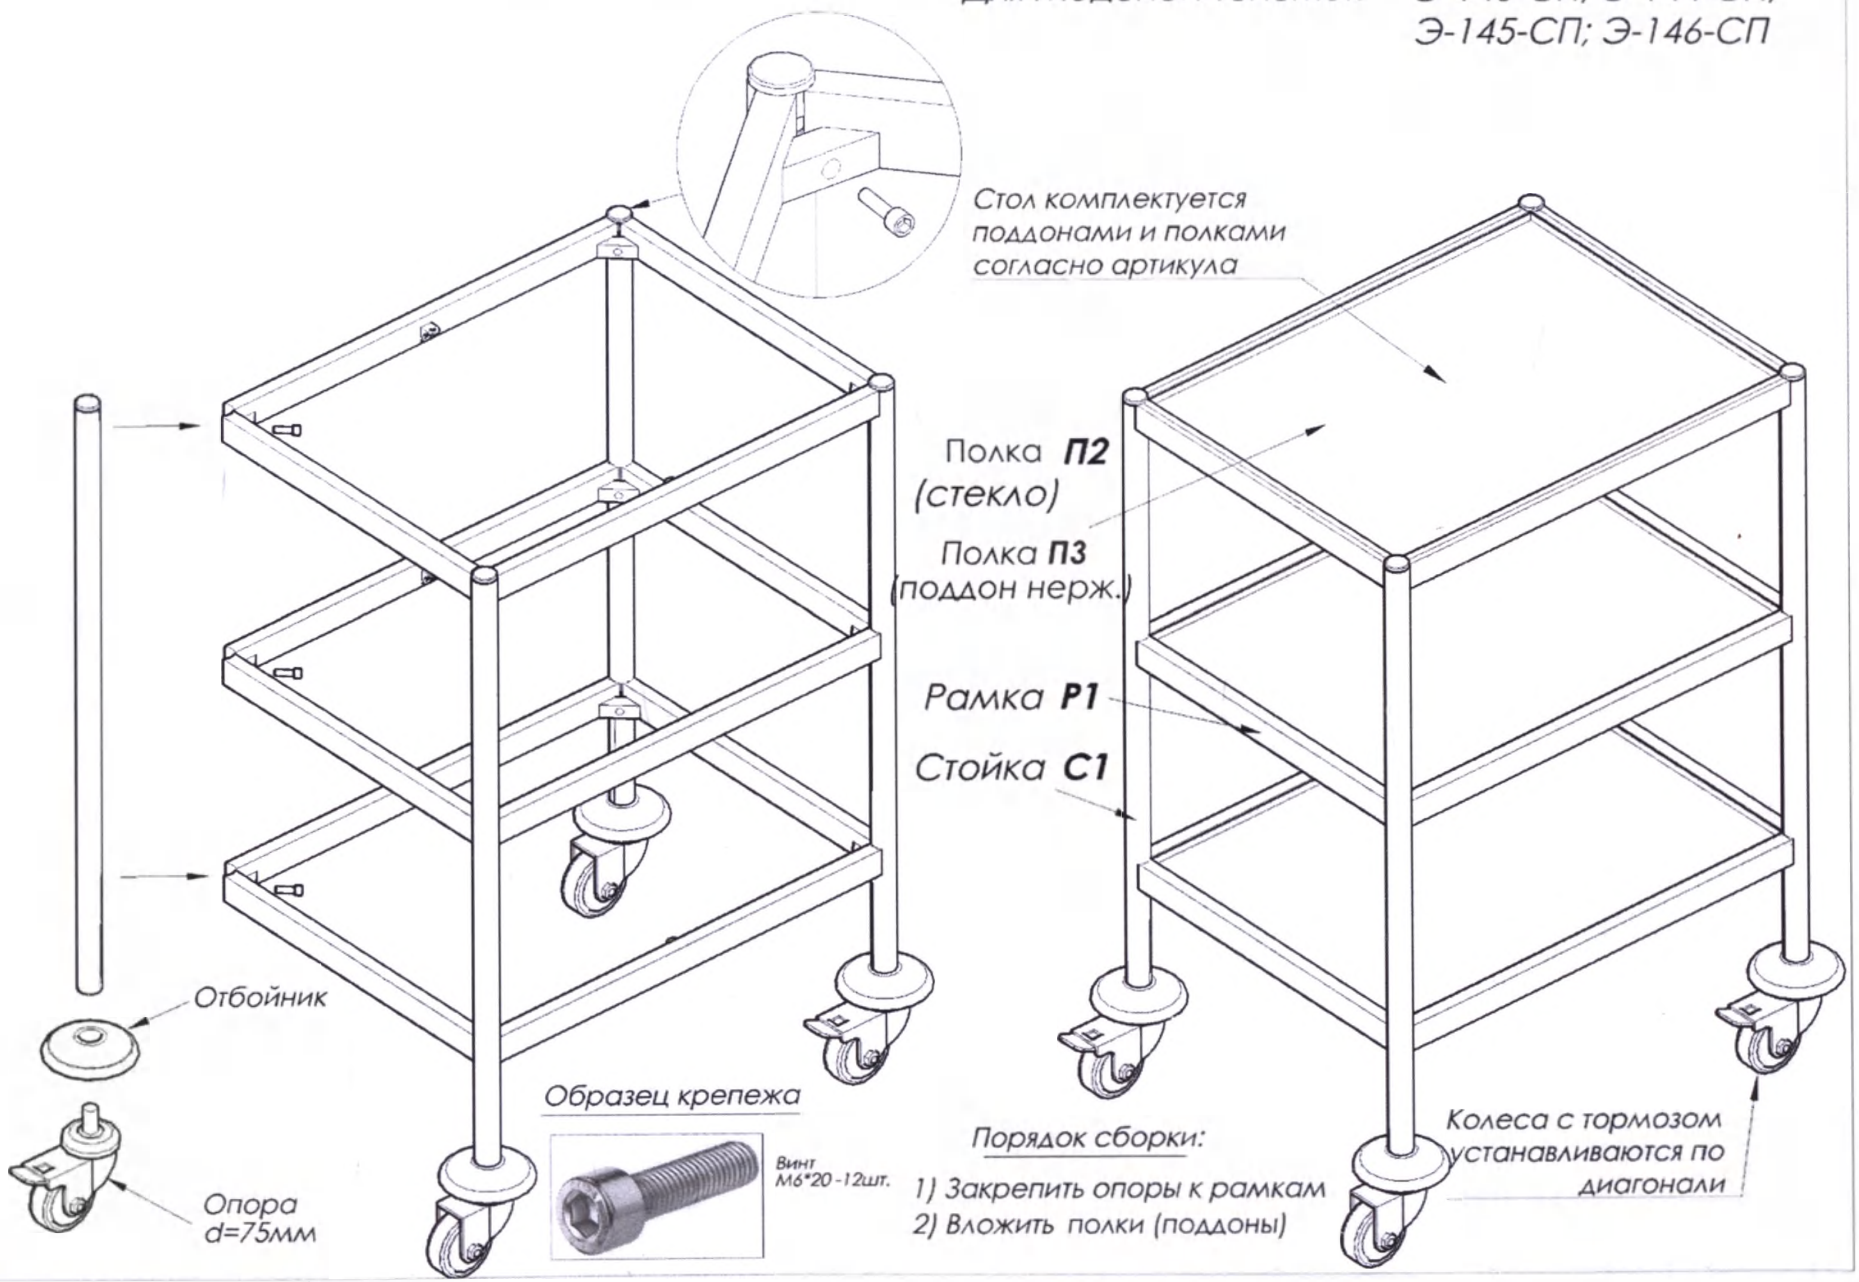

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-143-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-143-СП

Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________

Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дроздов Э. А. /

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-144-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-144-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	**550*345*770**	**16±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
С 2	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
Р 1	Рамка полки	3
П 2	Полка стеклянная	2
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х20	12

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	16,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П2** и **П3,** внутрь рамки полки **Р 1.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-143-СП; Э-144-СП; Э-145-СП; Э-146-СП

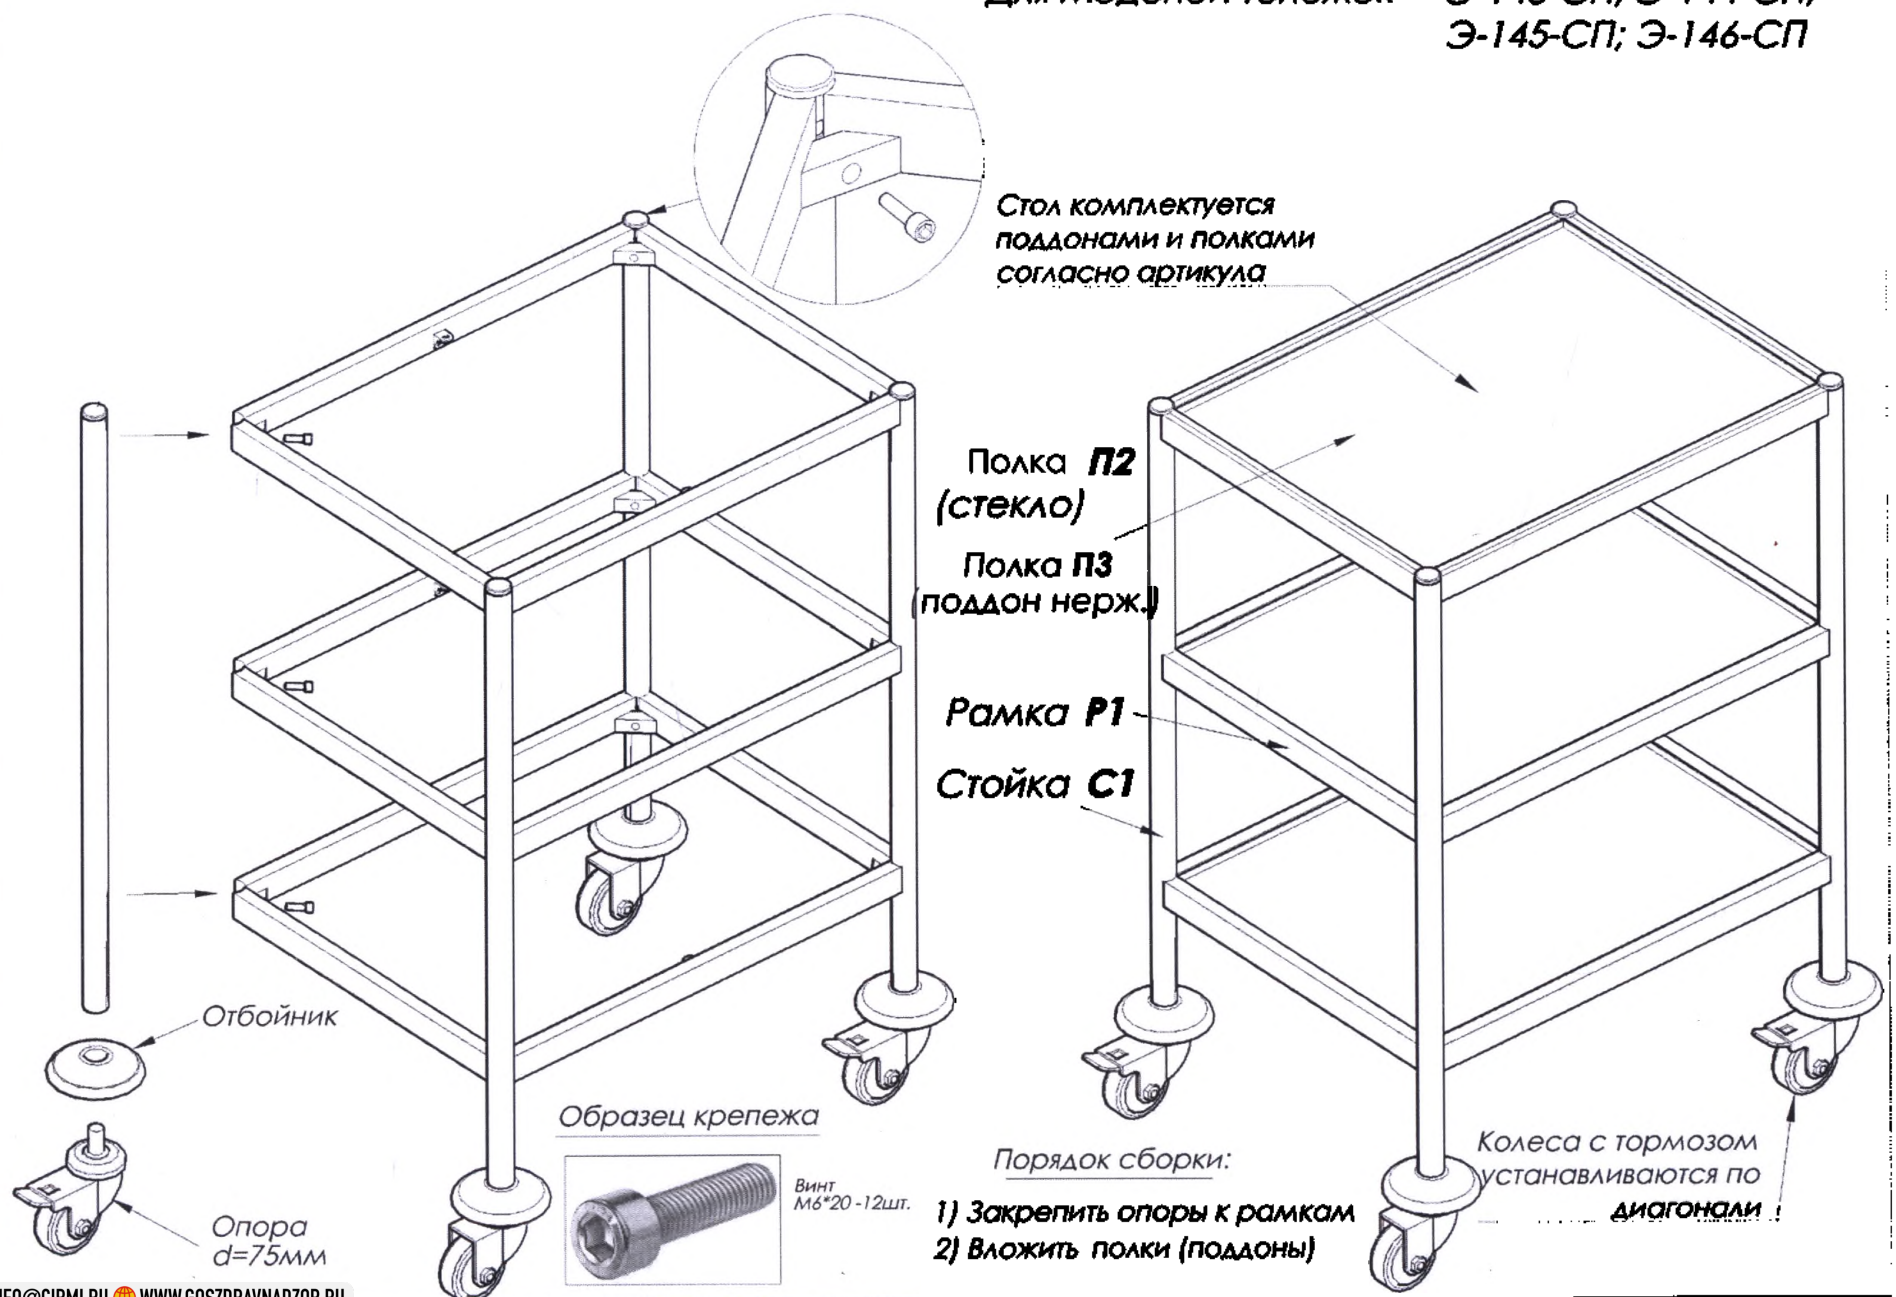

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ıорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при ıинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие ɔазивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ıаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ɪмощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ıециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ɪрет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-144-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с ɓязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана ɔдным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ _________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-144-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин А. А.

«27» марта 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-145-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-145-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
22 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	**550*345*770**	**15,2±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 2	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 2	Полка стеклянная	1
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	15,2±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П3** и **П2,** внутрь рамки полки **Р 1.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

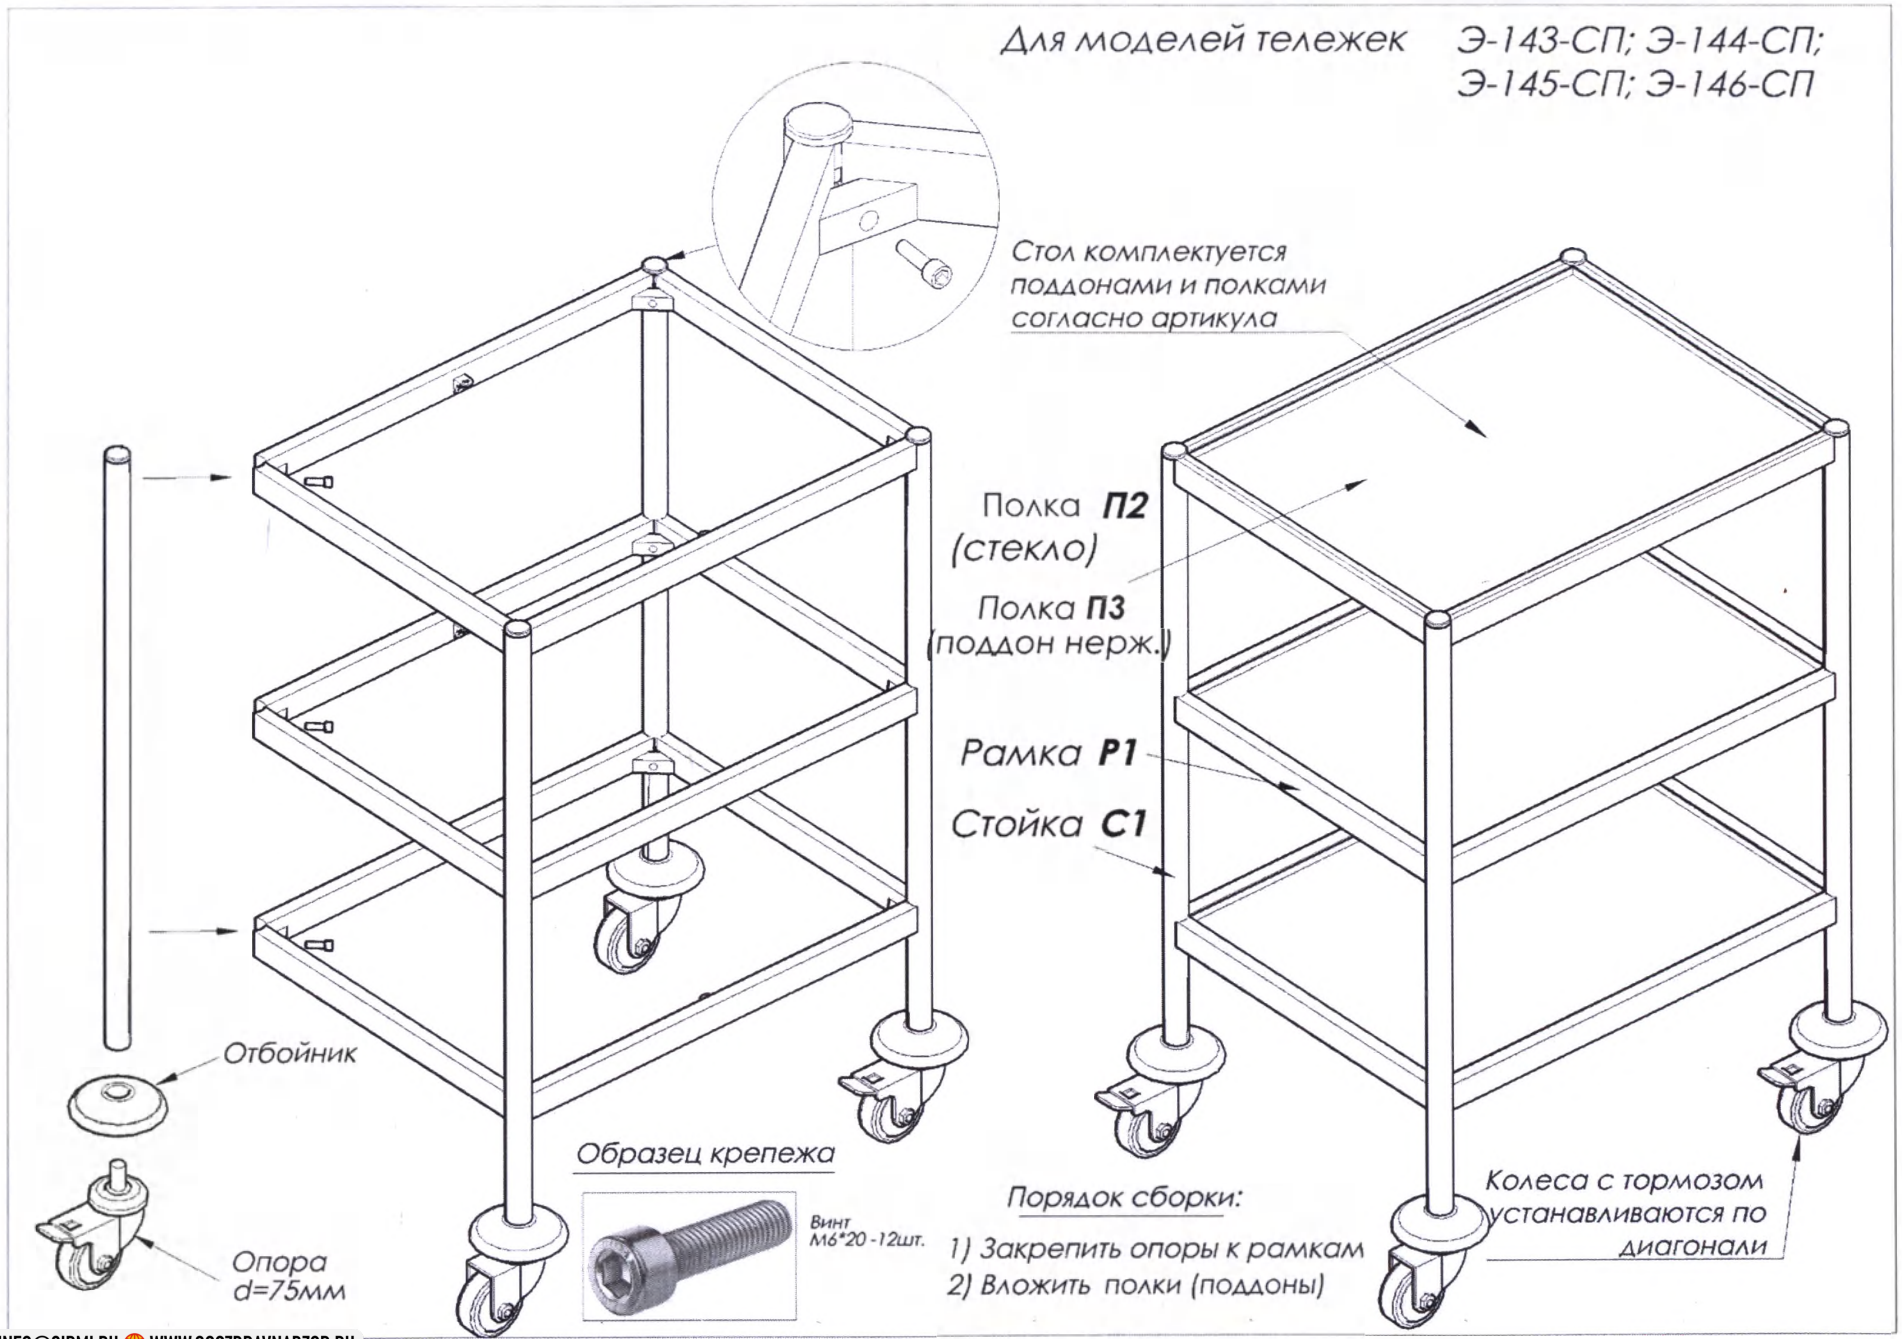

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу кодов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-145-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тележка медицинская Э-145-СП

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.**

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-146-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-146-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	**550*345*770**	**14,35±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	3
С 2	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	14,35±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С2** закрепить к трем рамкам **Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки **П3,** внутрь рамки полки **Р 1.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

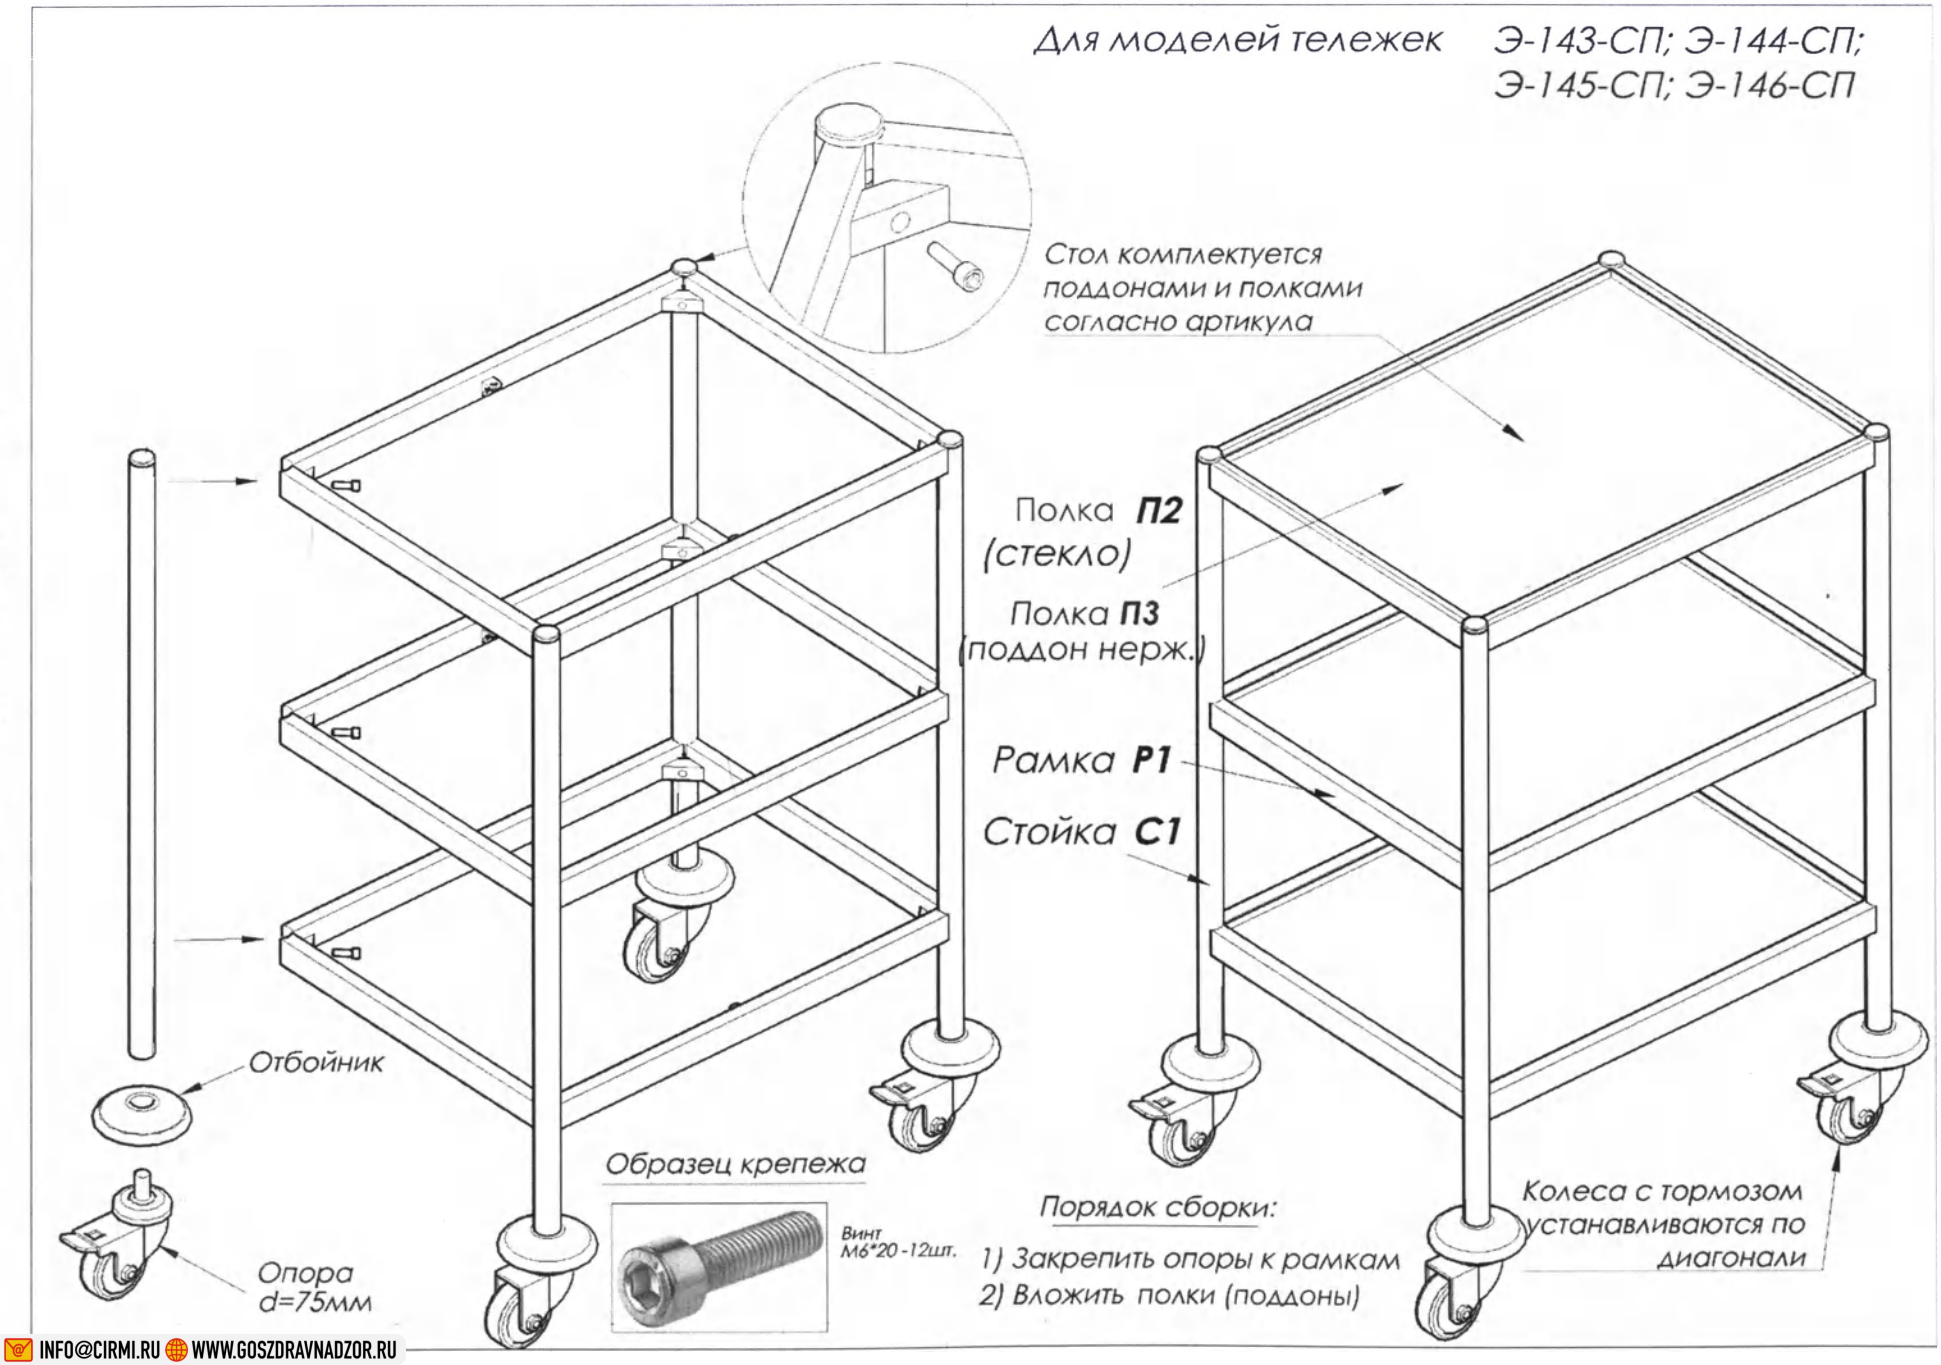

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-146-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-146-СП

Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________

Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э.А.** /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-147-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-147-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	**550*345*770**	**17,3±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
Р 1	Рамка полки	1
Р 2	Рамка с блоком ящика	1
С 1	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	2
	Крепежные изделия	
	Винт М6х20	8

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойки)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	17,3±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С1** закрепить к двум рамкам **Р2, и Р1** тремя винтами.
3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полки (поддоны) **П3** внутрь рамки **1 и Р 2.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СХЕМА СБОРКИ ТЕЛЕЖКИ

Э-147-СП

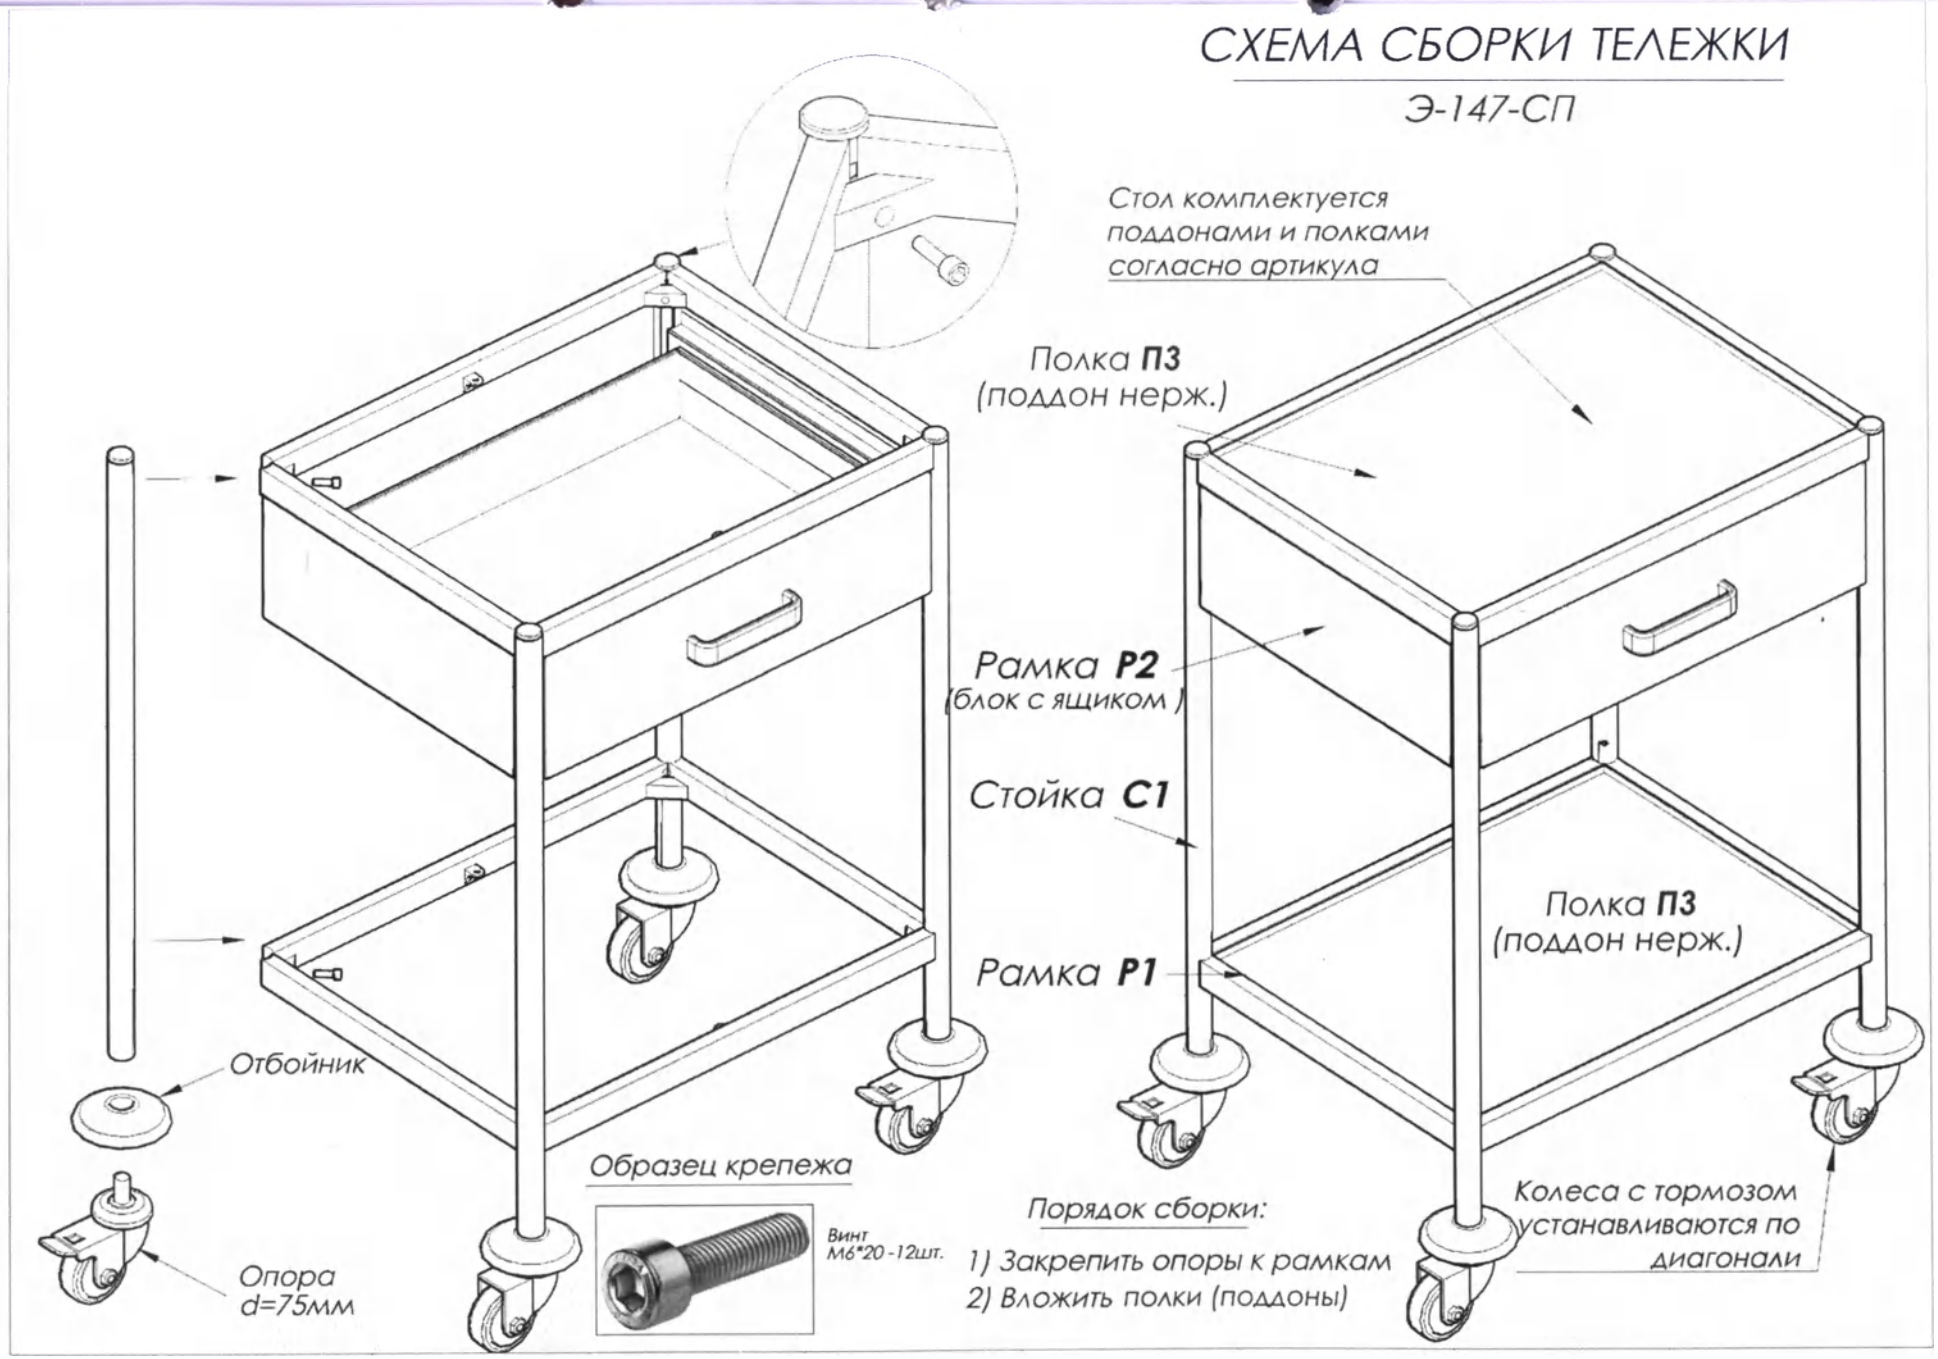

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-147-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-147-СП

Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________

Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А.

«27» мая 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-147/2-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-147/2-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	**550*345*770**	**25,3±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р 1	Рамка полки	1
Р 2	Рамка с блоком ящика	2
С 3	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х20	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	25,3±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С3** закрепить к трем рамкам **Р2, и Р1** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить два поддона **П3** внутрь рамки **Р 1 и Р2.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

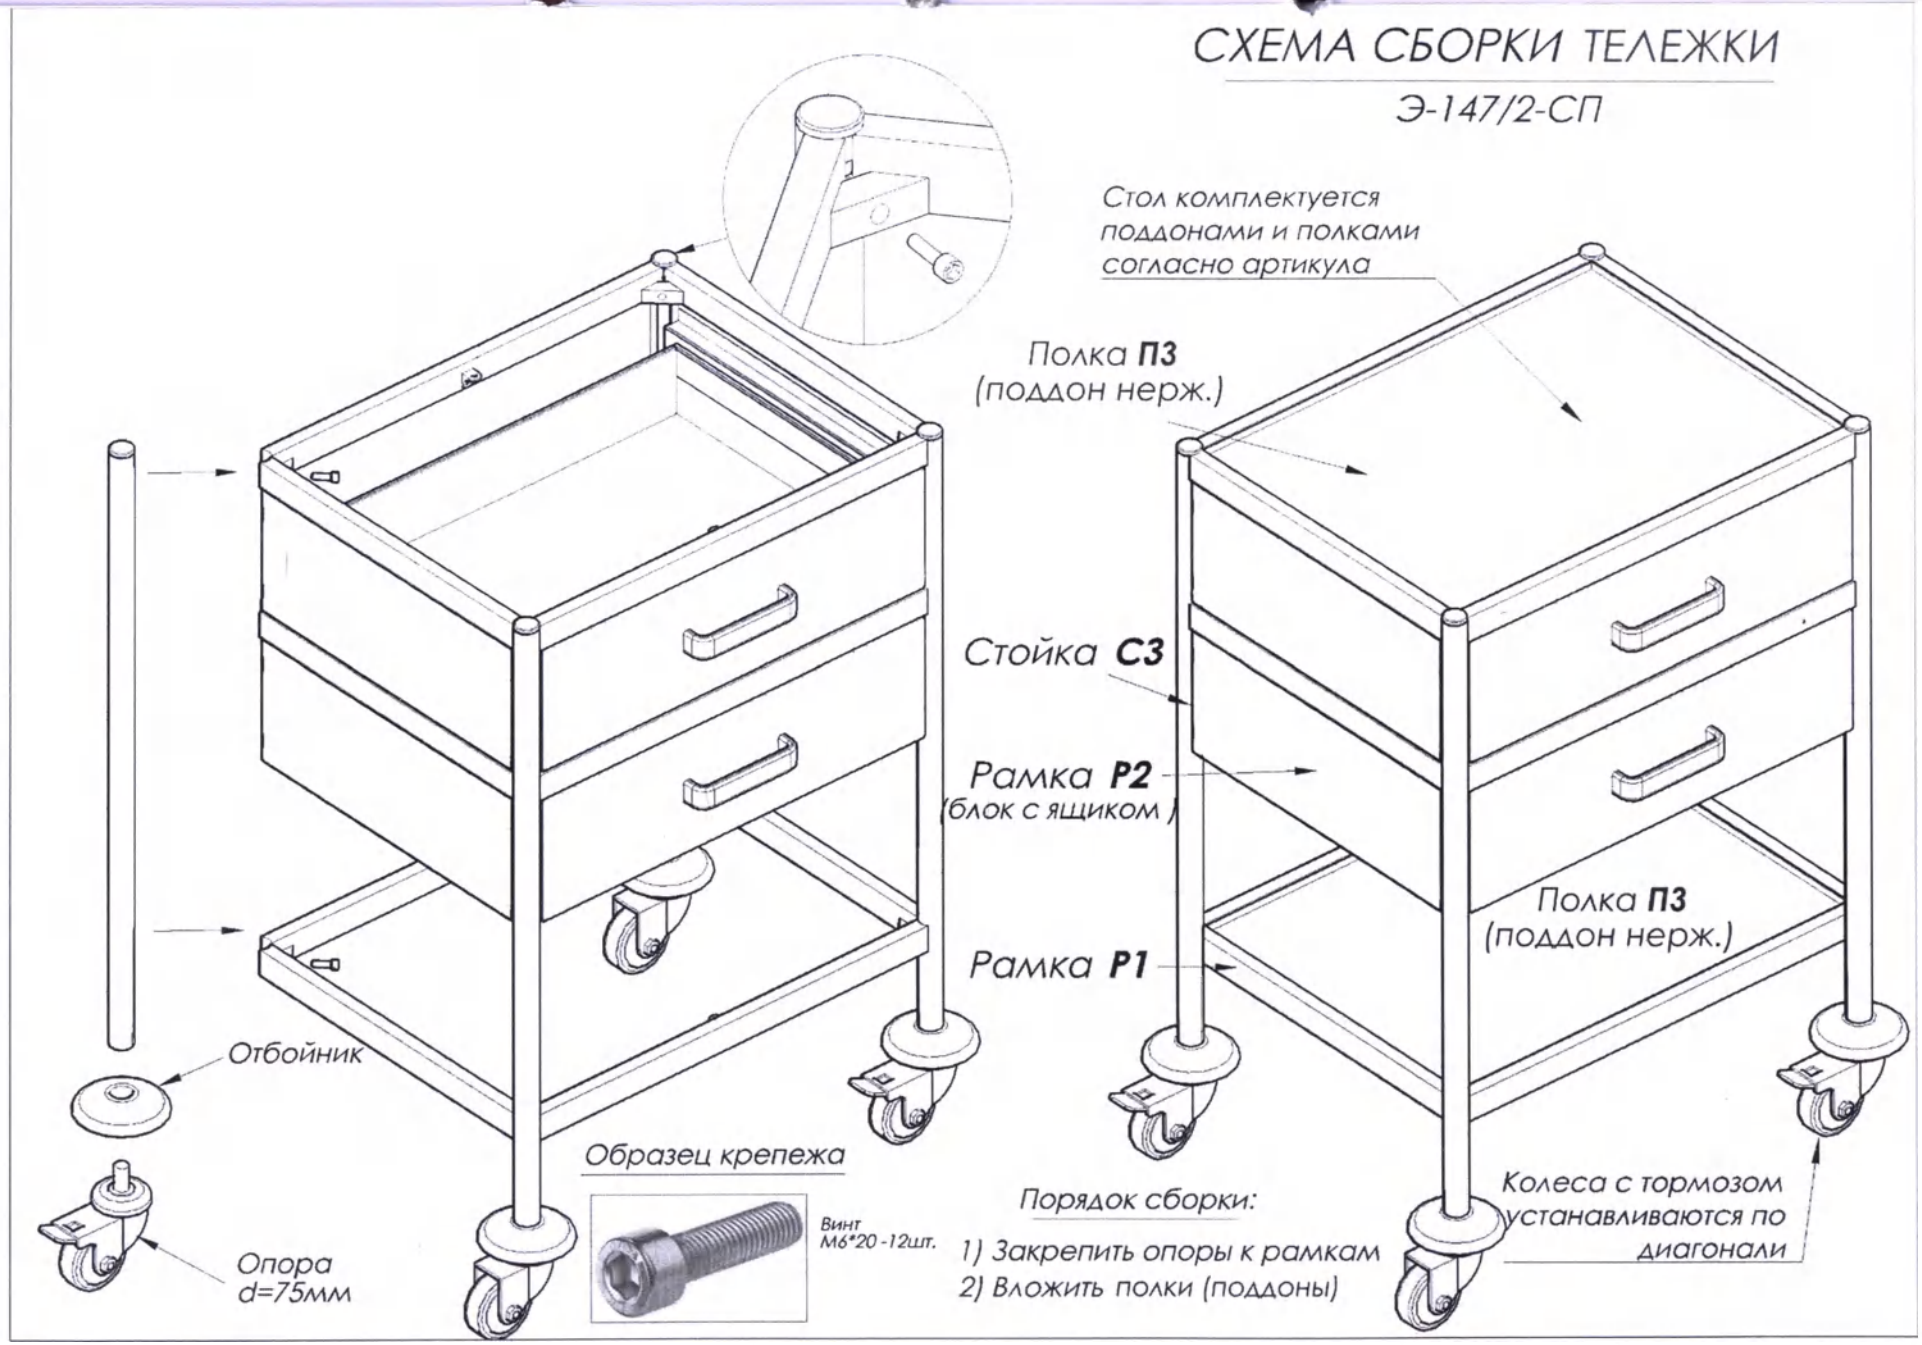

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-147/2-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-147/2-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-147/3-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-147/3-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	**550*345*770**	**33,3±0,5**		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
Р 2	Рамка с блоком ящика	3
С 3	Стойка с колесной опорой и отбойником	4
П 3	Полка (поддон нержавеющий)	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х20	12

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	33,3±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **С4** закрепить к трем рамкам **Р2,** тремя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить полку **П3** внутрь рамки полки **Р2.**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

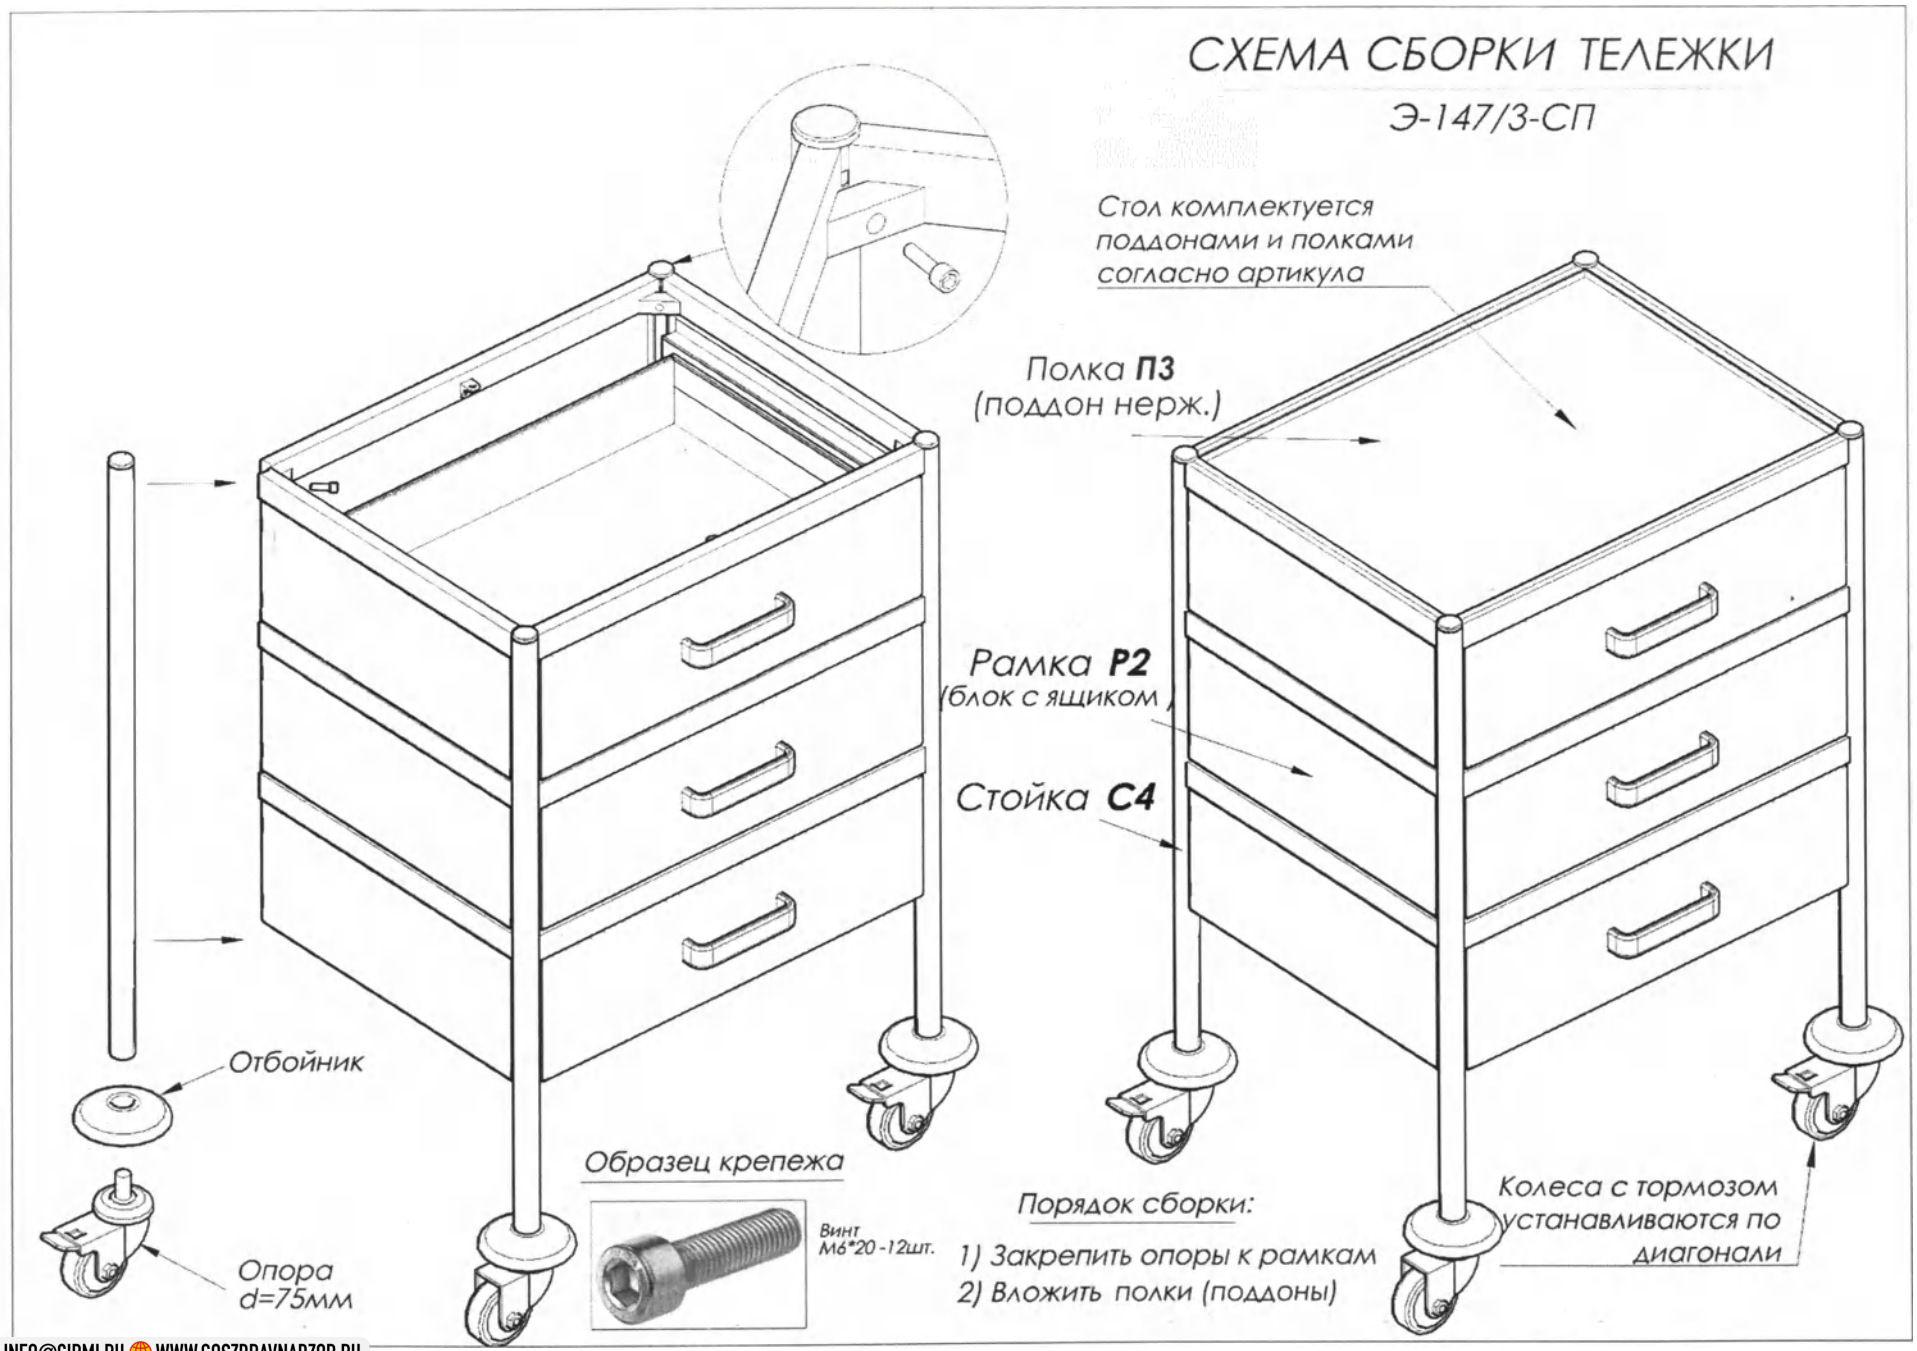

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-147/3-СП в количестве ____________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ________________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-147/3-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»___________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дроки Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-240-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-240-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	**630*420*860**	**12,85±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р1	Рамка полки	2
К1	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П2	Полка стеклянная	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	12,85±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К1** закрепить к двум рамкам **Р1** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку – поддон **П2**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-240-СП, Э-241-СП, Э-242-СП

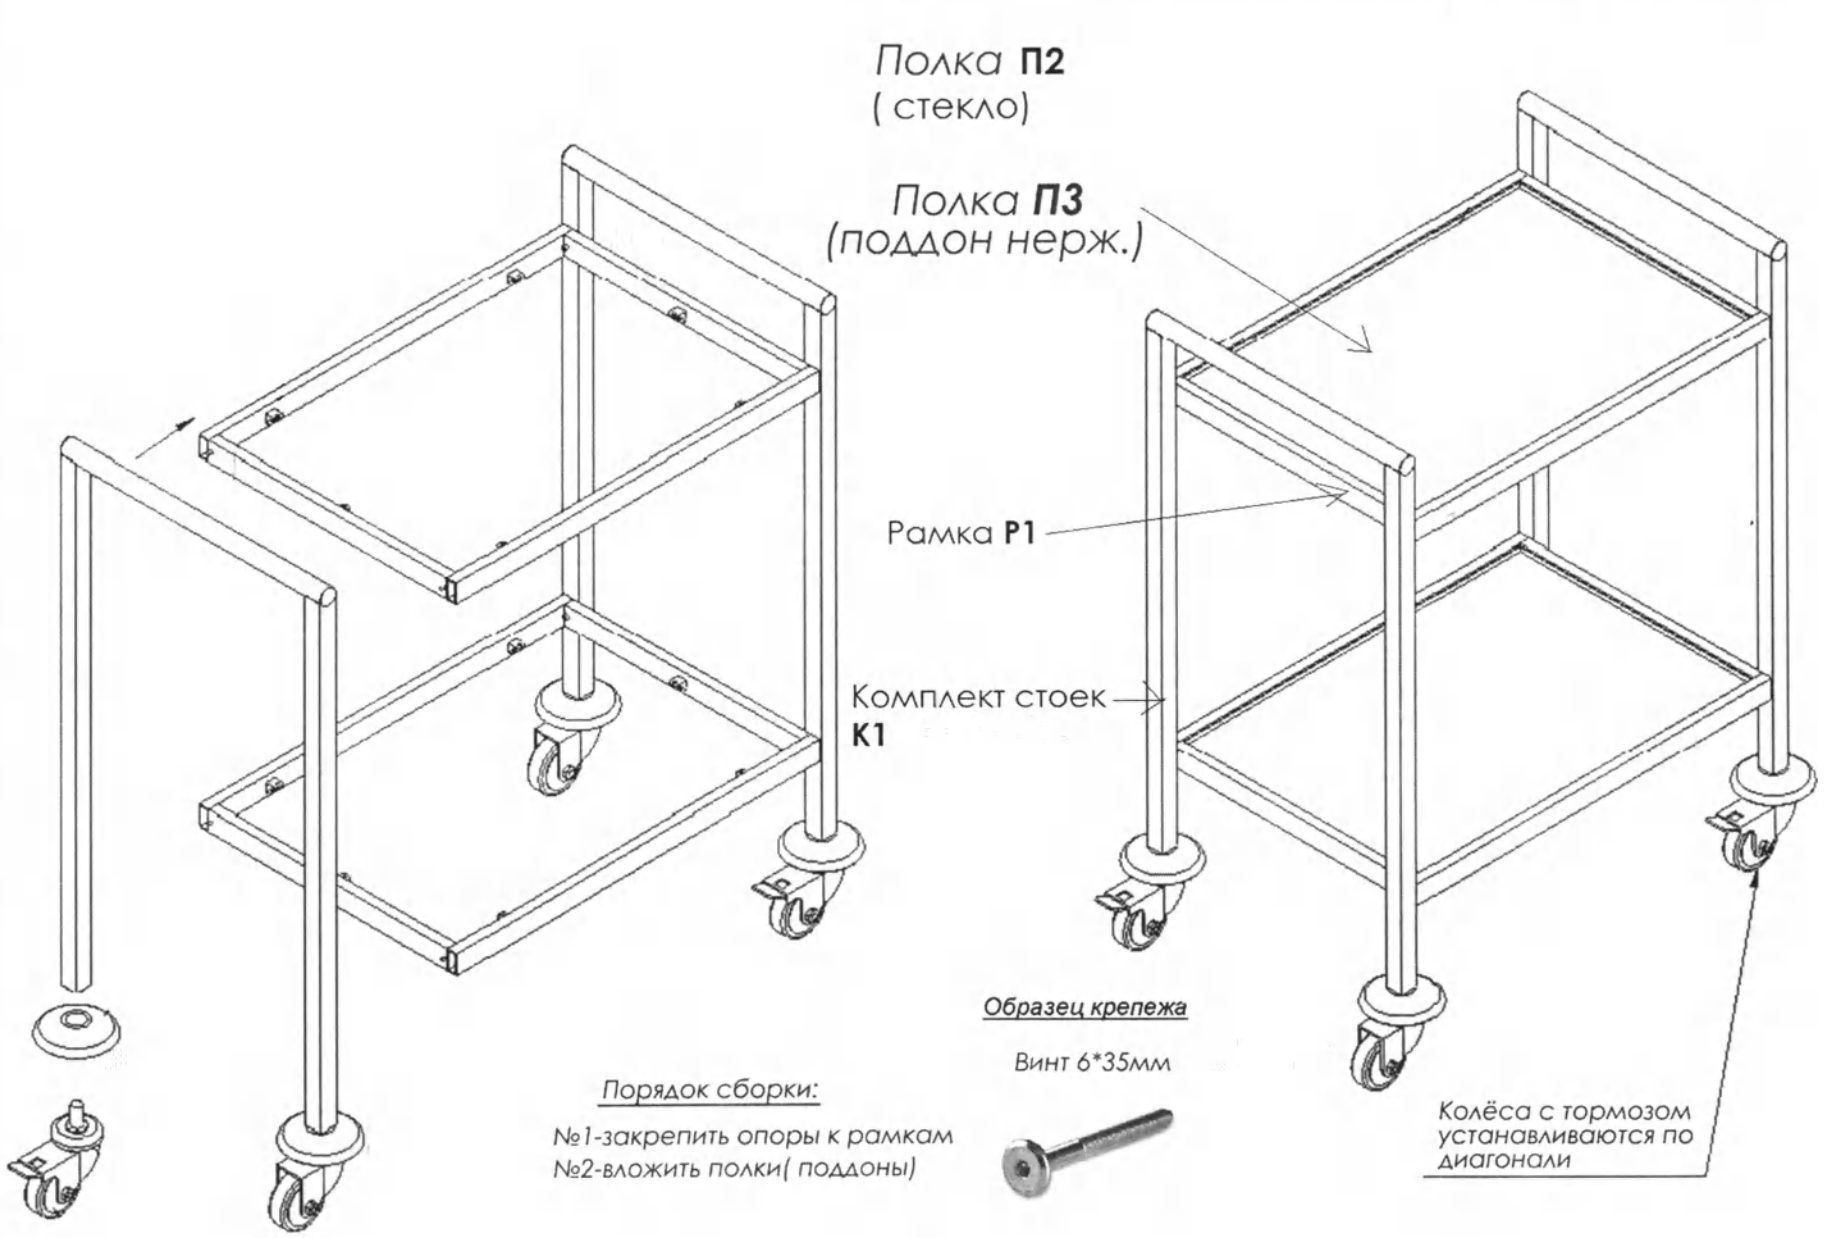

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси юрода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при инфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-240-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-240-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

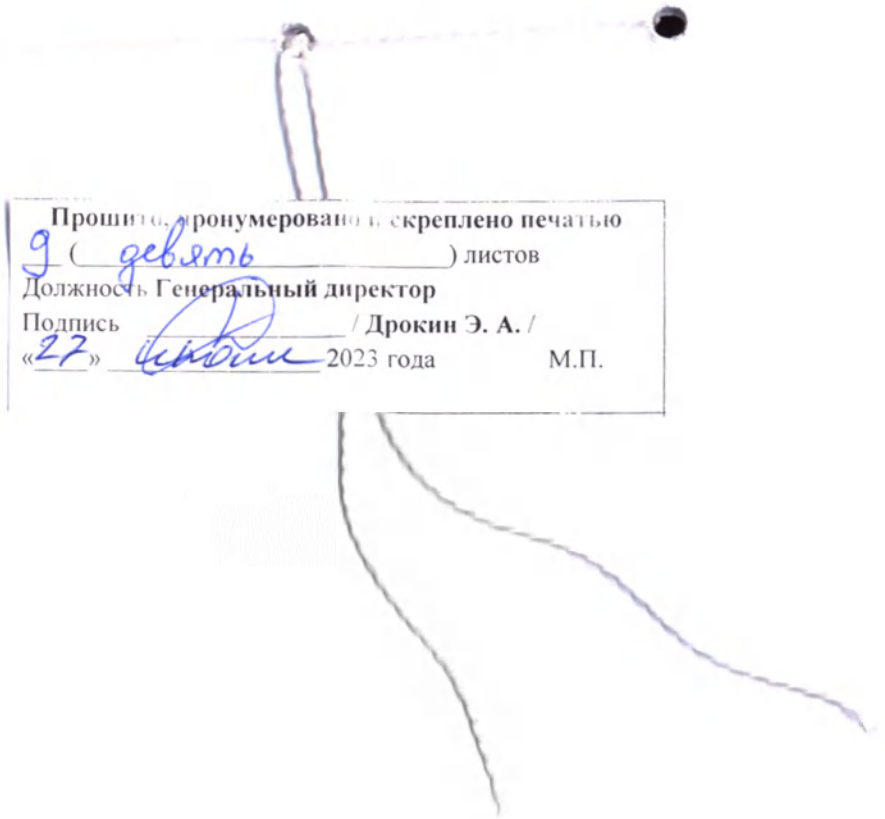
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» _____ 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-241-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-241-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	**630*420*860**	**11,95±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р1	Рамка полки	2
К1	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П2	Полка стеклянная	1
П3	Полка (поддон нержавеющий)	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	11,95±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К1** закрепить к двум рамкам **Р1** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку **Р1** полку **П2 и** поддон **П3**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-240-СП, Э-241-СП, Э-242-СП

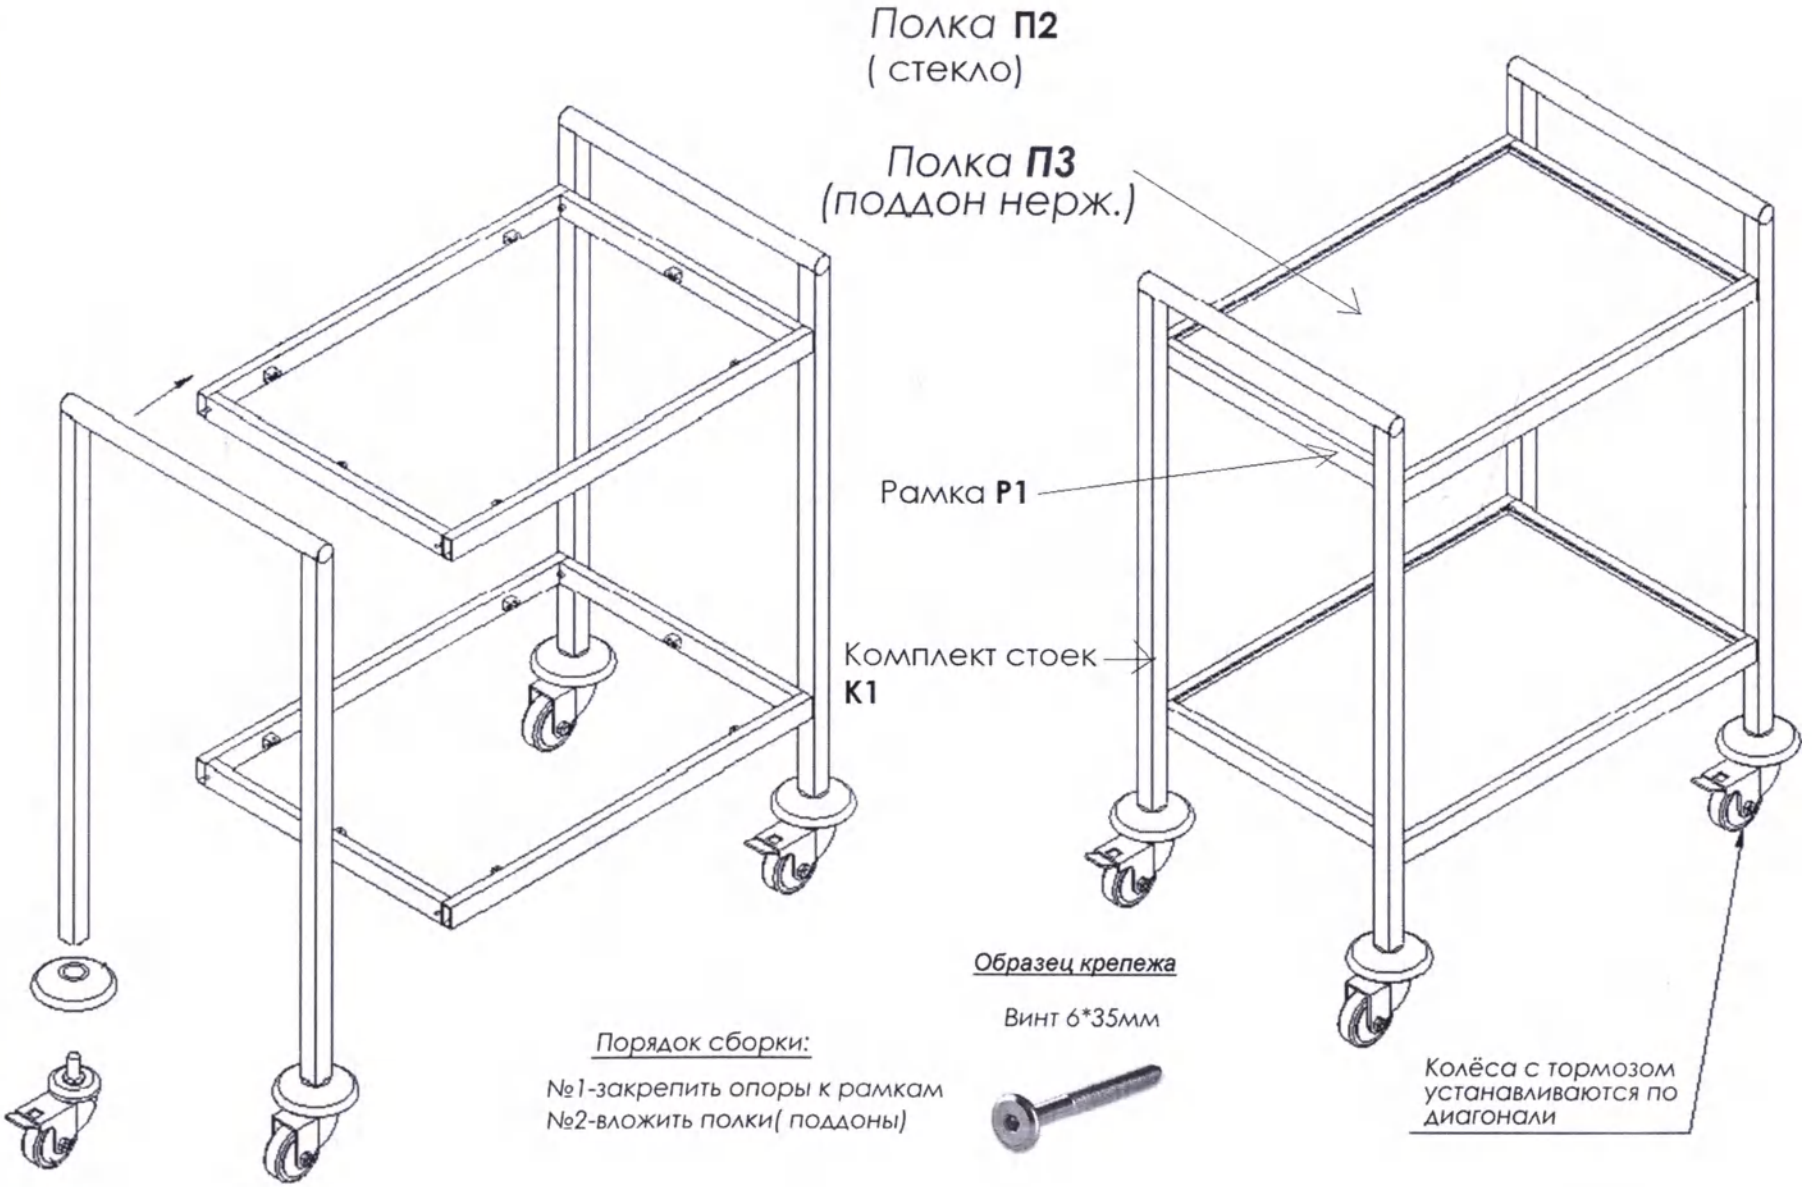

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-241-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-241-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-242-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-242-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона.
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	**630*420*860**	**11,14±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р1	Рамка полки	2
К1	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	11,14±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К1** закрепить к двум рамкам **Р1** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - поддон **П3**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для моделей тележек Э-240-СП, Э-241-СП, Э-242-СП

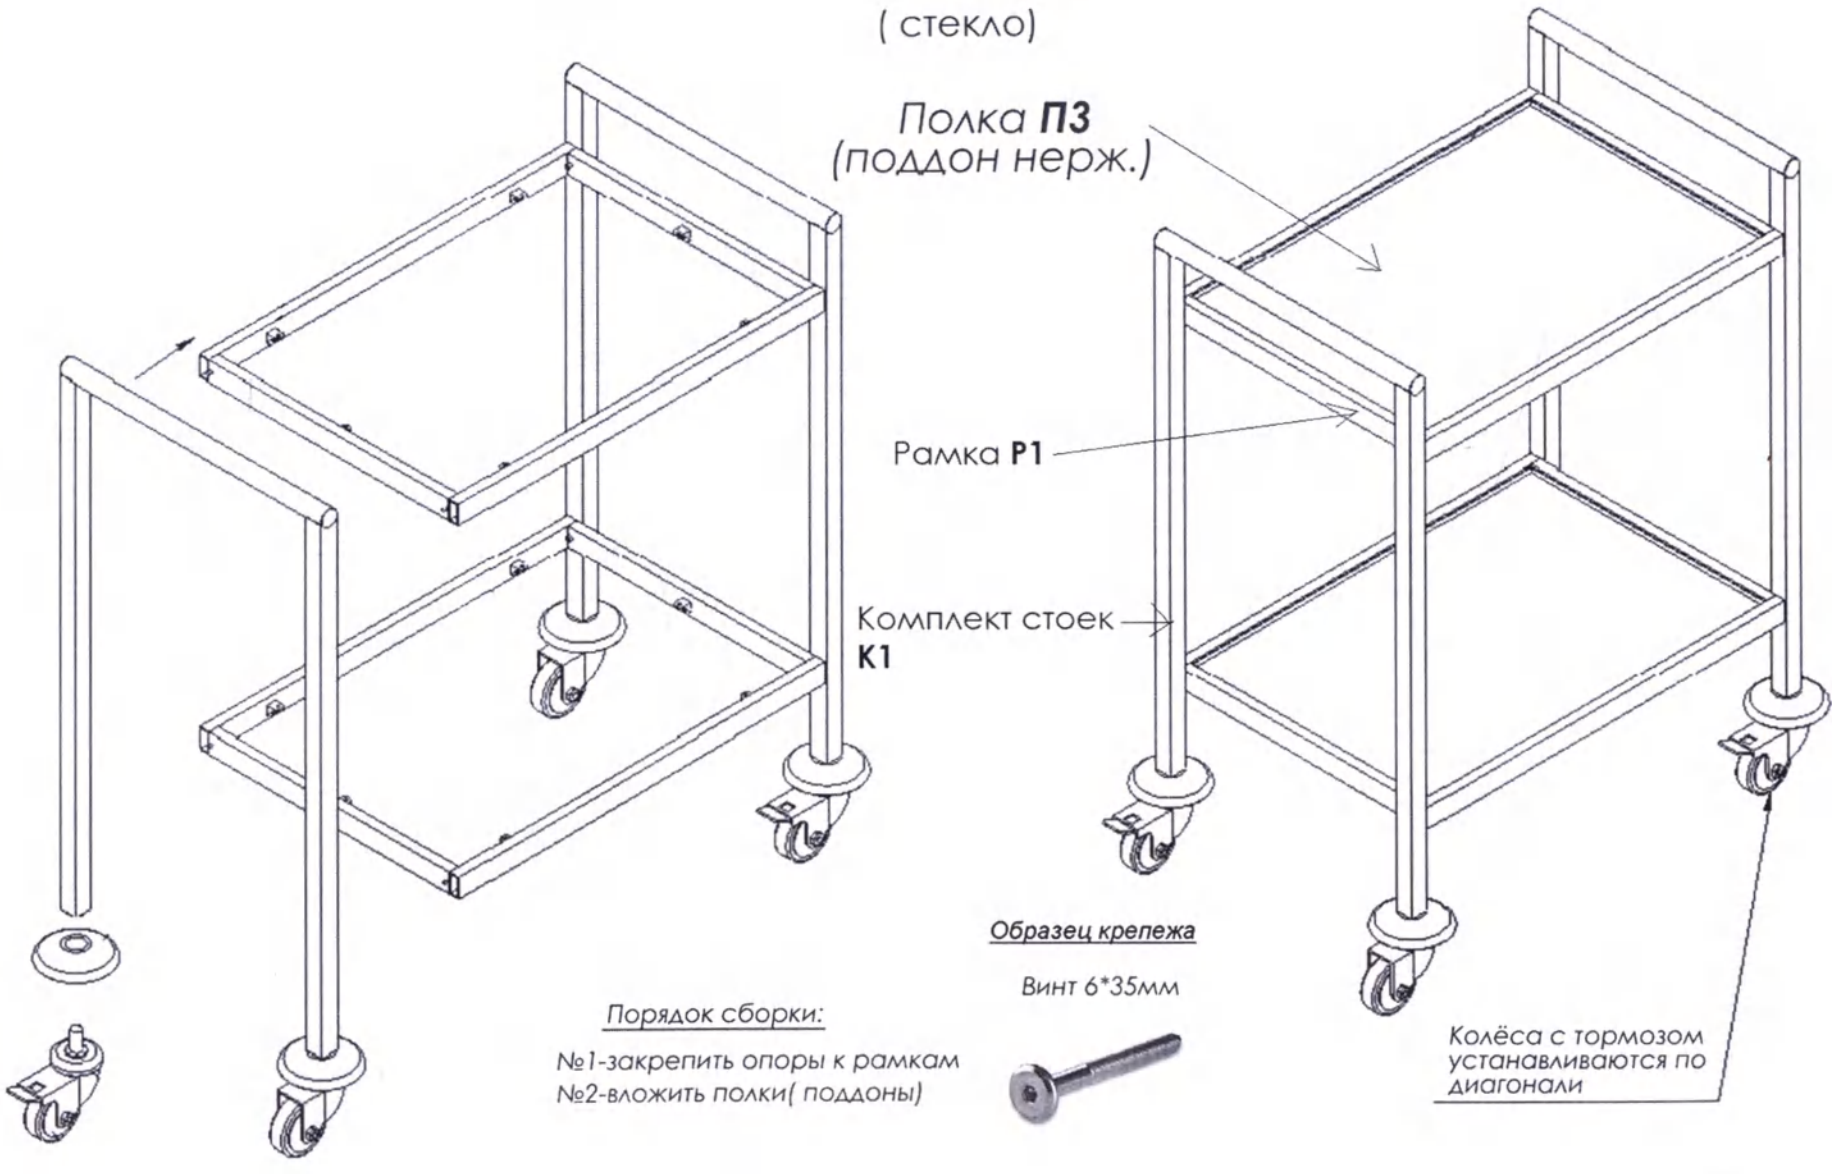

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси
юрода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при
инфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие
разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу
ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке
и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих
У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации
звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо
зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели
ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической
мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических
ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец
ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-242-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с
бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана
одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-242-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» ноября 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-243-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-243-СП** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка едицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	**630*420*860**	**16,9±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р1	Рамка полки	3
К2	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П2	Полка (стеклянная)	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	16,9±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К2** закрепить к трем рамкам **Р1** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - поддон **П2**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки тележек

Э-243-СП; Э-244-СП; Э-245-СП; Э-246-СП

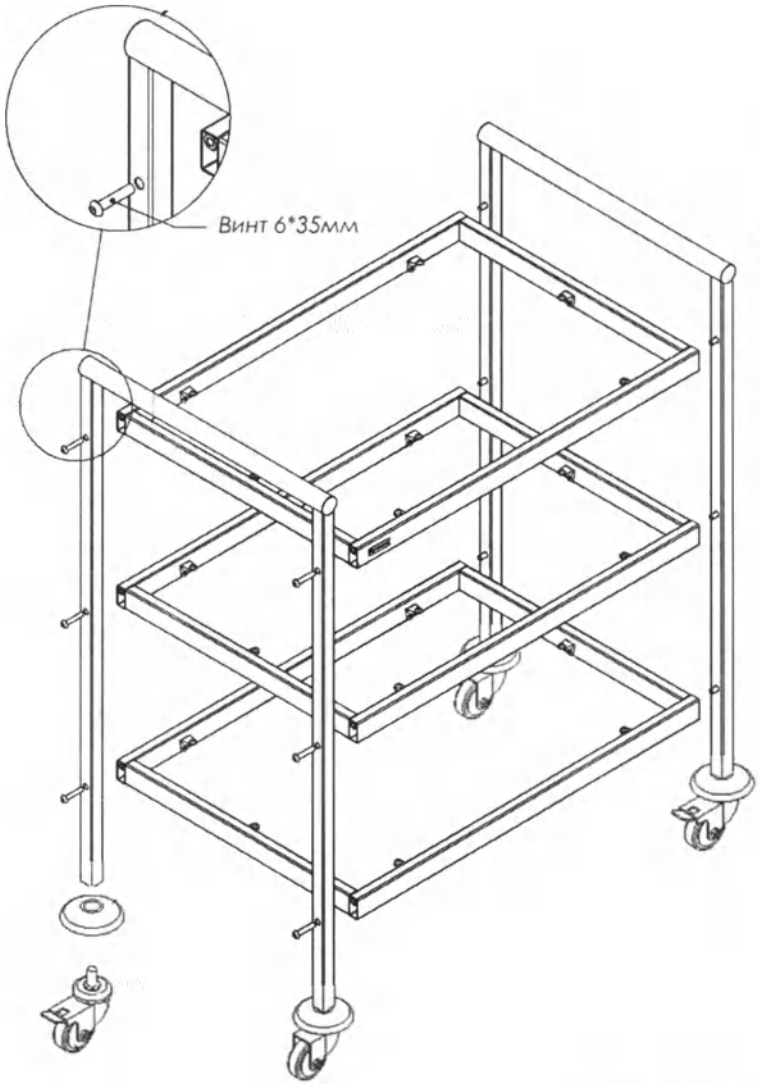

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

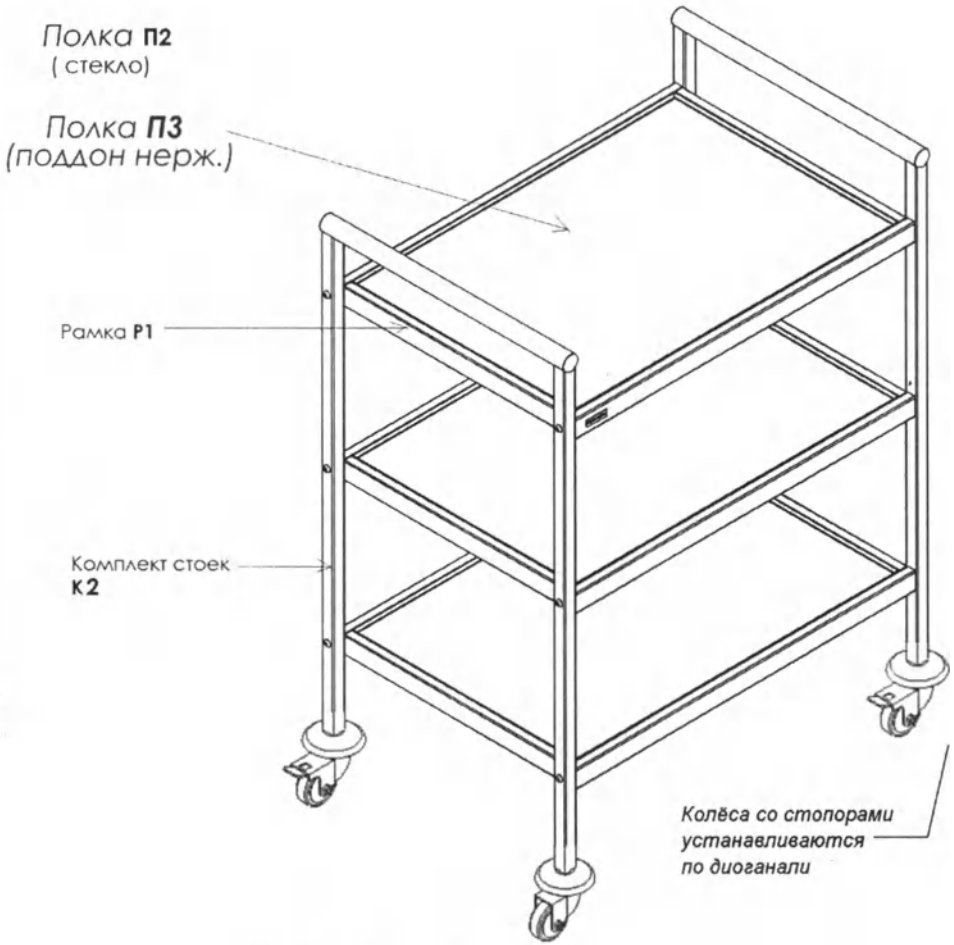

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам

№2 вложить полки(поддоны)

Образец крепежа

*Винт 6*35мм*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ᴉорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при ɪинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие ɔазивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ɔодов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-243-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана дным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-243-СП

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ Трокин Т. А.
«27» мая 2025 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-244-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-244-СП** (далее – тележка). Тележка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-12494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
12 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	**630*420*860**	**16±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
Р1	Рамка полки	3
К2	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П2	Полка стеклянная	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	16,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К2** закрепить к трем рамкам **Р1** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - Полки **П2 и П3**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки тележек

Э-243-СП; Э-244-СП; Э-245-СП; Э-246-СП

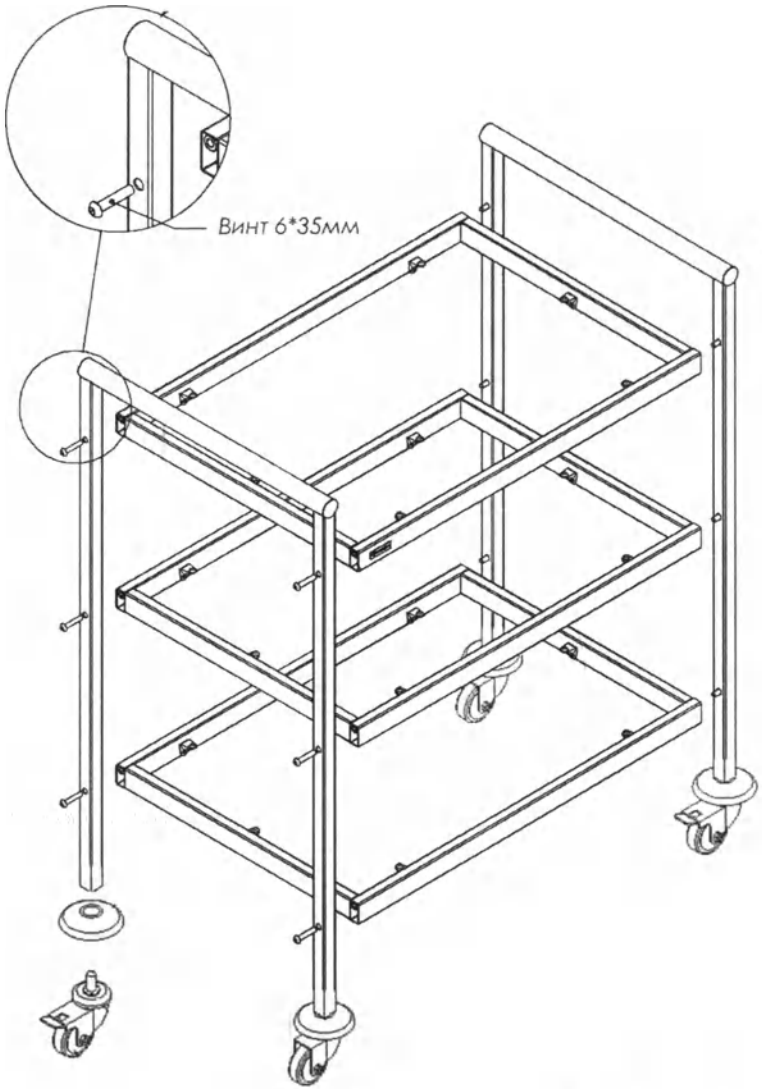

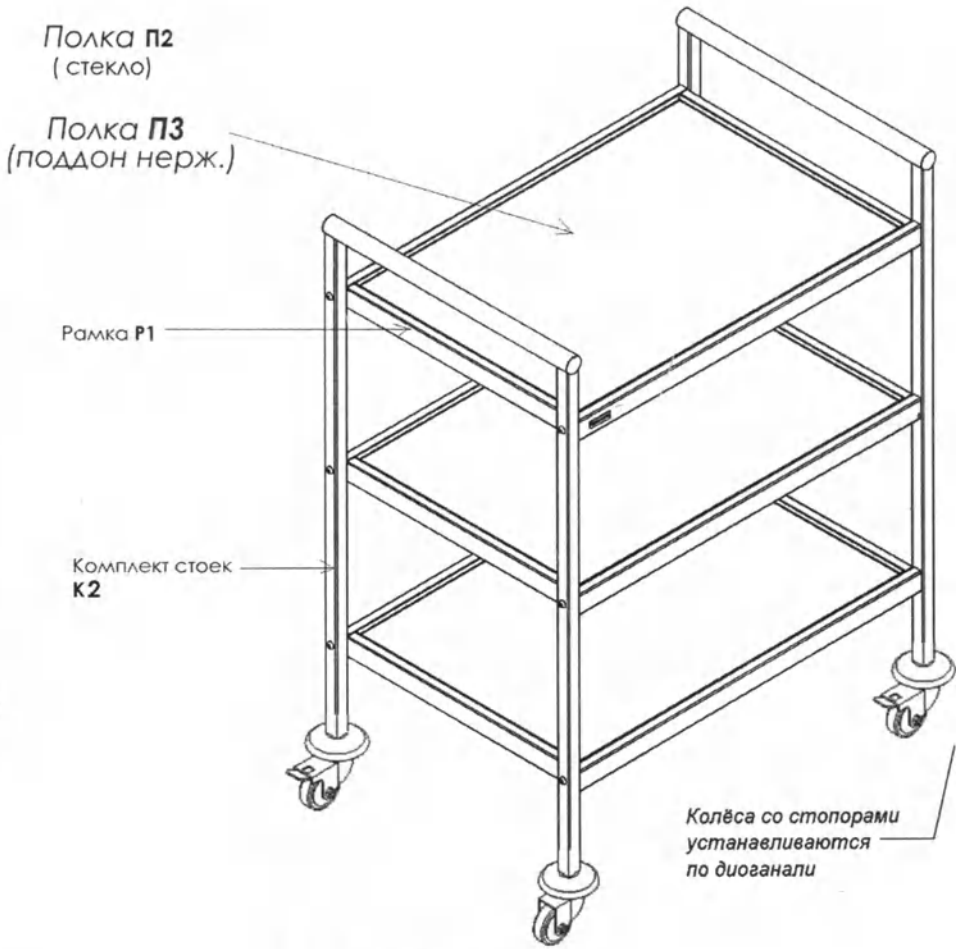

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам
№2 вложить полки(поддоны)

Образец крепежа

*Винт 6*35мм*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации езвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-244-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП _______________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-244-СП

Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________

Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» _____ 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-245-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-245-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
12 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	**630*420*860**	**15,2±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р1	Рамка полки	3
К2	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П2	Полка стеклянная	1
П3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки	Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	15,2±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К2** закрепить к трем рамкам **Р1** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку полки **П2 и П3**
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки тележек

Э-243-СП; Э-244-СП; Э-245-СП; Э-246-СП

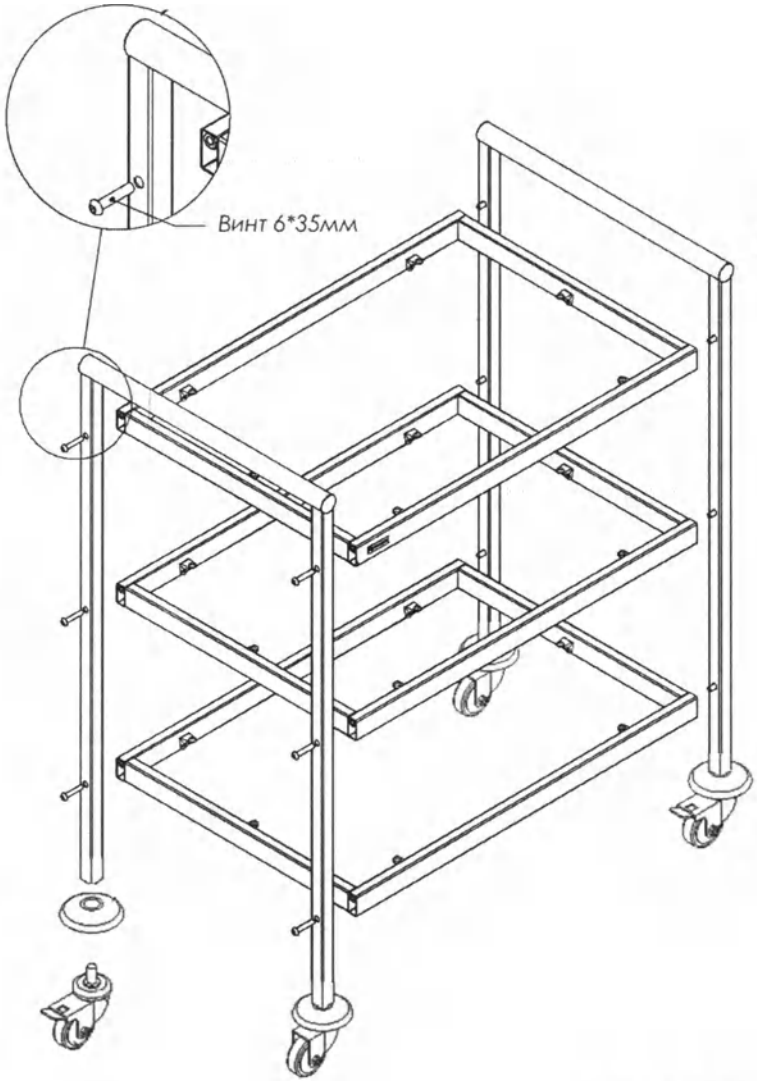

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

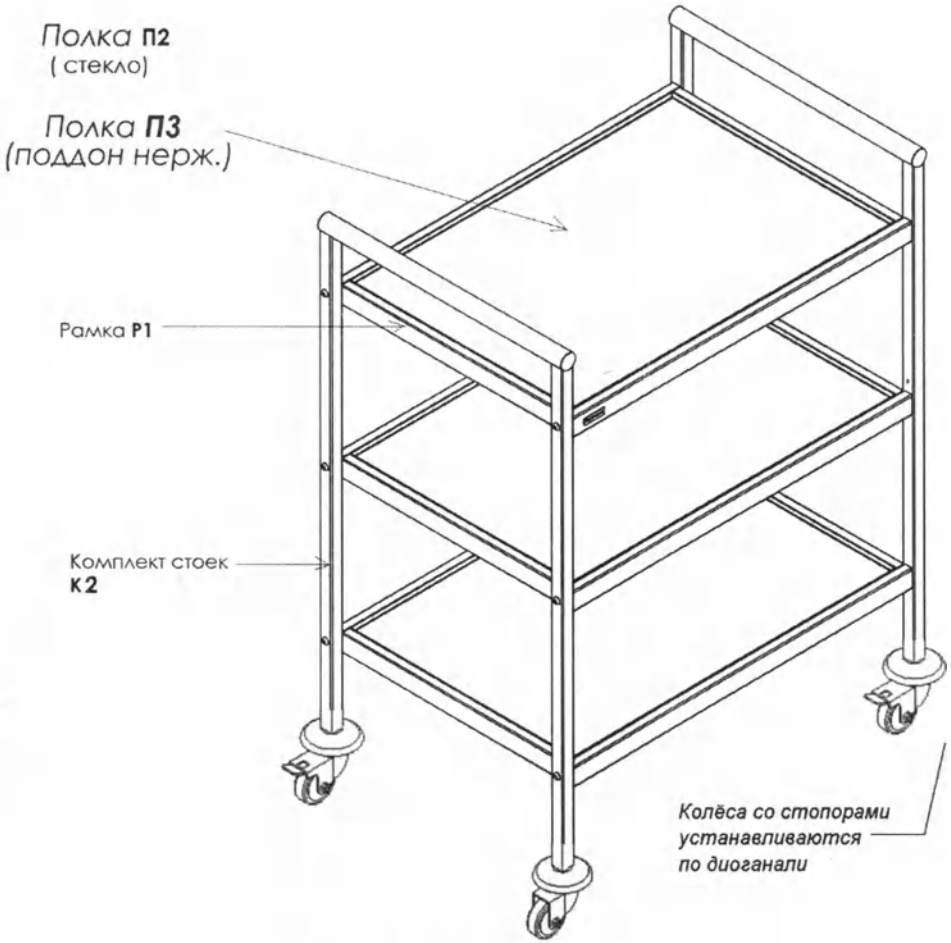

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам

№2 вложить полки(поддоны)

Образец крепежа

Винт 6*35мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-245-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-245-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А. /
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-246-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-246-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	**630*420*860**	**14,35±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
Р1	Рамка полки	3
К2	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	3
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	
Полки	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойки)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	14,35±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2Каждую стойку **К2** закрепить к трем рамкам **Р1** шестью винтами.
10.3Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - Полки **П2 и П3**
10.4 Тележка готова к эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки тележек

Э-243-СП; Э-244-СП; Э-245-СП; Э-246-СП

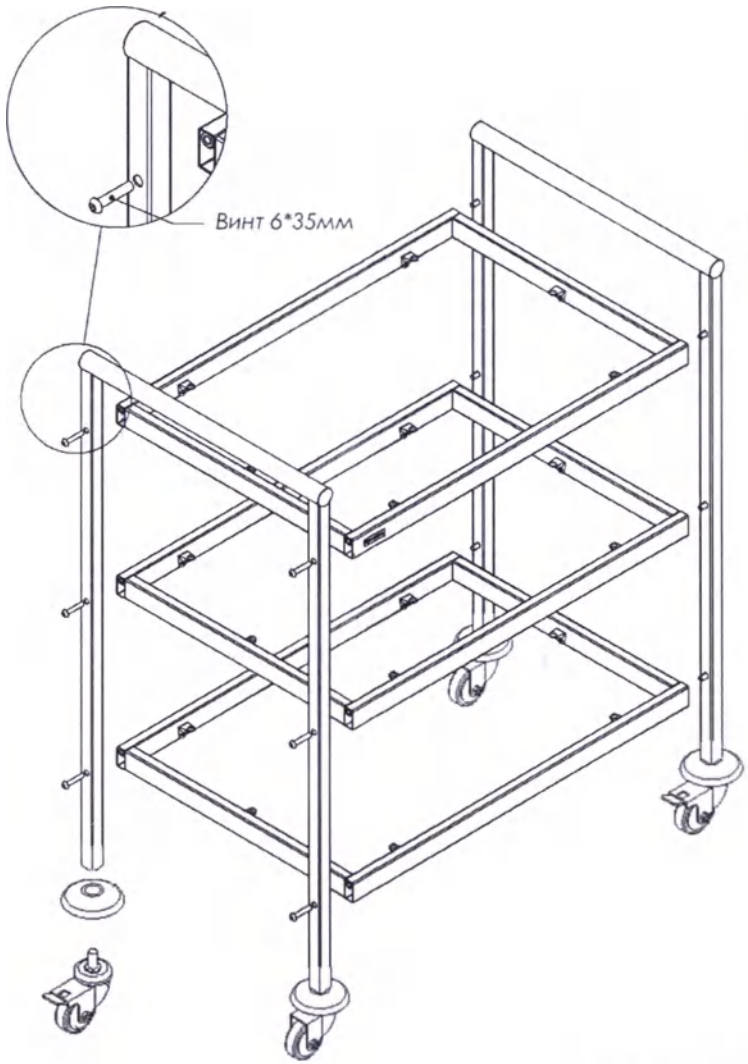

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

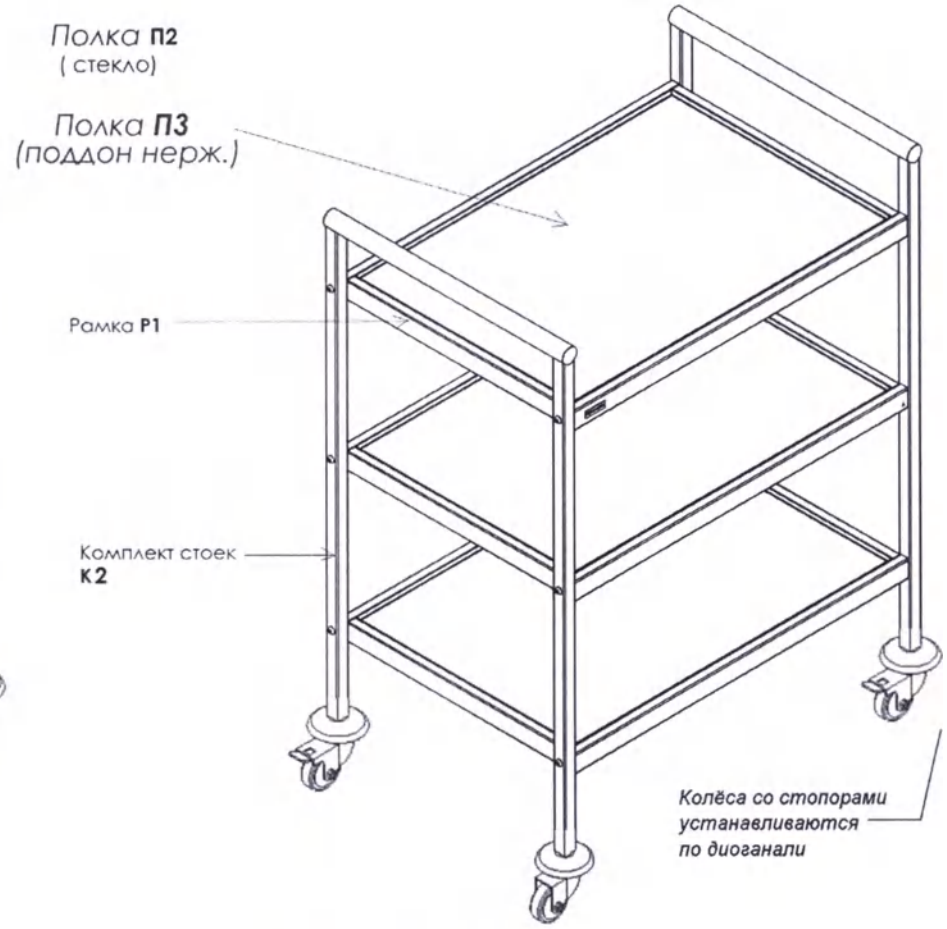

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам

№2 вложить полки(поддоны)

Образец крепежа

Винт 6*35мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-246-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тележка медицинская Э-246-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись / Дрокин Э. А. /

«27» сентября 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-247-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-247-СП** (далее – тележка). Тележка входит состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	**630*420*860**	**17,3±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р1	Рамка полки	1
Р2	Рамка с блоком ящика	1
К1	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	8

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки, ящик	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	17,3±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К1** закрепить к двум рамкам **Р1 и Р2** четырьмя винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - Полки **П3**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки тележек
Э-247-СП

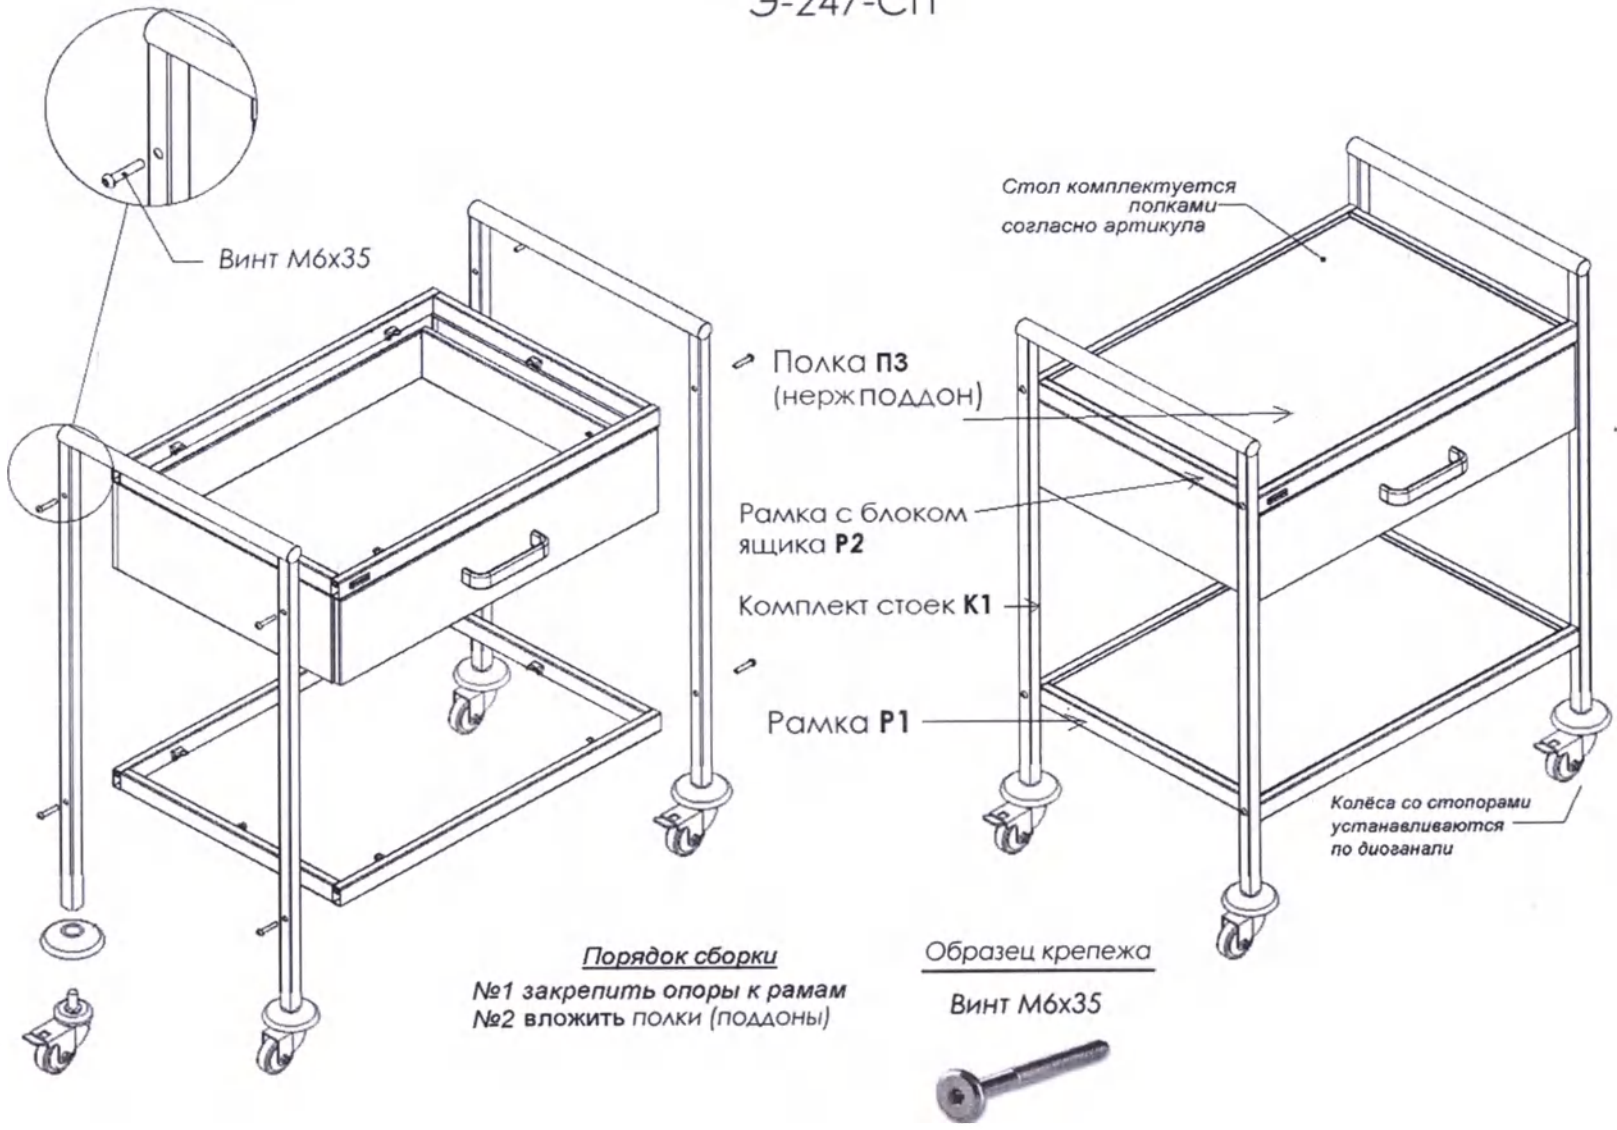

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ıи изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации ззвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели іделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических іециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-247-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-247-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

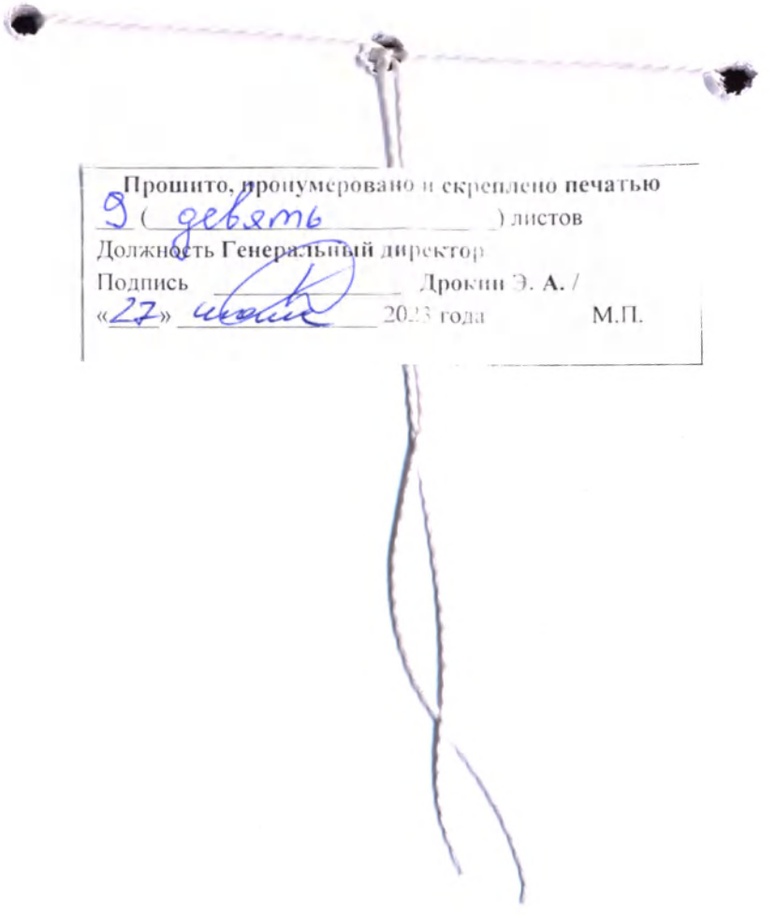
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ Дрокин Э. А. /
«27» июля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

___Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-247/2-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-247/2-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и нструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	**630*420*860**	**25,3±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
Р1	Рамка полки	1
Р2	Рамка с блоком ящика	2
К3	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П3	Полка (поддон нержавеющий)	2
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	12

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полки, ящики	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	25,3±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К1** закрепить к трем рамкам **Р1 и Р2** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - Полки **П3**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки тележек

Э-247/2-СП

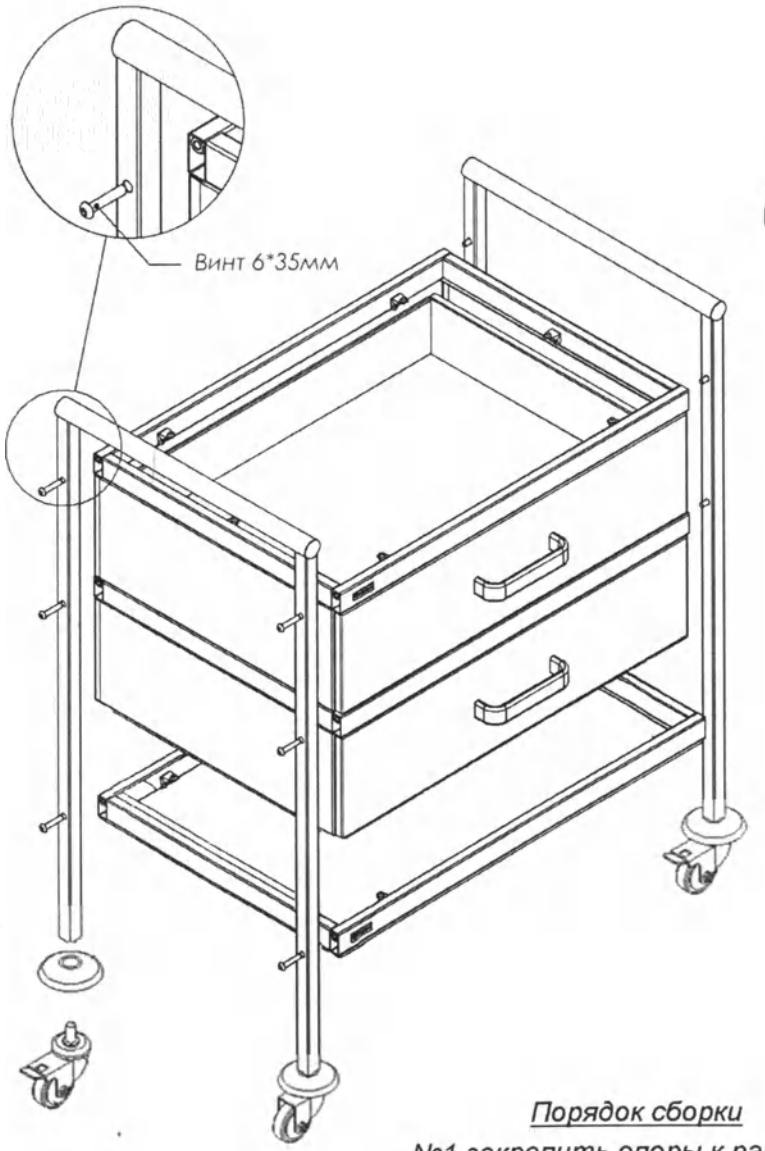

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

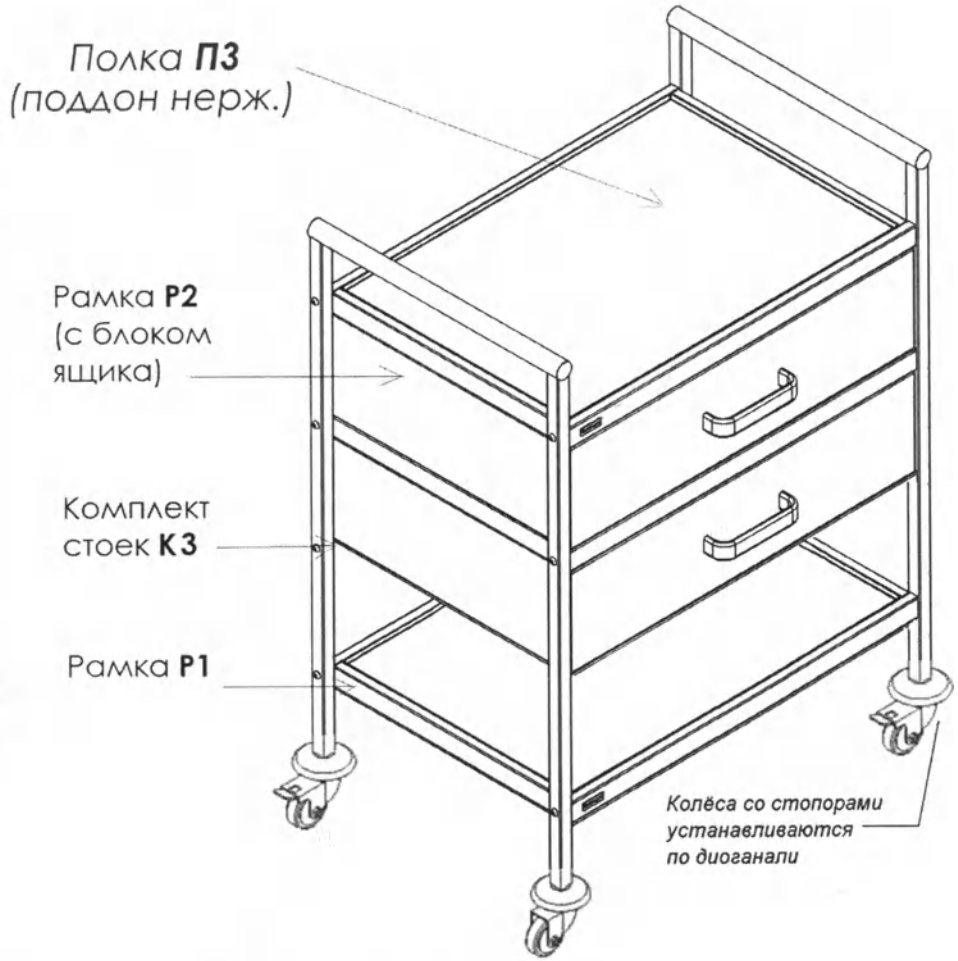

Порядок сборки

№1 закрепить опоры к рамам

№2 вложить полки(поддоны)

Образец крепежа

*Винт 6*35мм*

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-247/2-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана одным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Тележка медицинская Э-247/2-СП
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Тележка медицинская Э-247/3-СП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Тележка медицинская Э-247/3-СП** (далее – тележка). Тележка ходит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-2494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации тележки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий тележка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Тележка предназначена для перемещения, размещения и хранения медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы тележки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка едицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	**630*420*860**	**33,3±0,5**		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки тележки:

Обозначение на рисунке 1	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
Р2	Рамка полки с ящиком	3
К1	Стойка с колесными опорами и отбойниками	2
П3	Полка металлическая	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х35	12

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	
Полка, ящики	Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Каркас (рамка полки, стойка)	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	33,3±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали подставки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку шестигранную.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки тележки показана на рисунке 1.
10.2 Каждую стойку **К1** закрепить к трем рамкам **Р1 и Р2** шестью винтами.
10.3 Собранную конструкцию установить вертикально и вложить в каждую рамку - Полки **П3**.
10.4 Тележка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

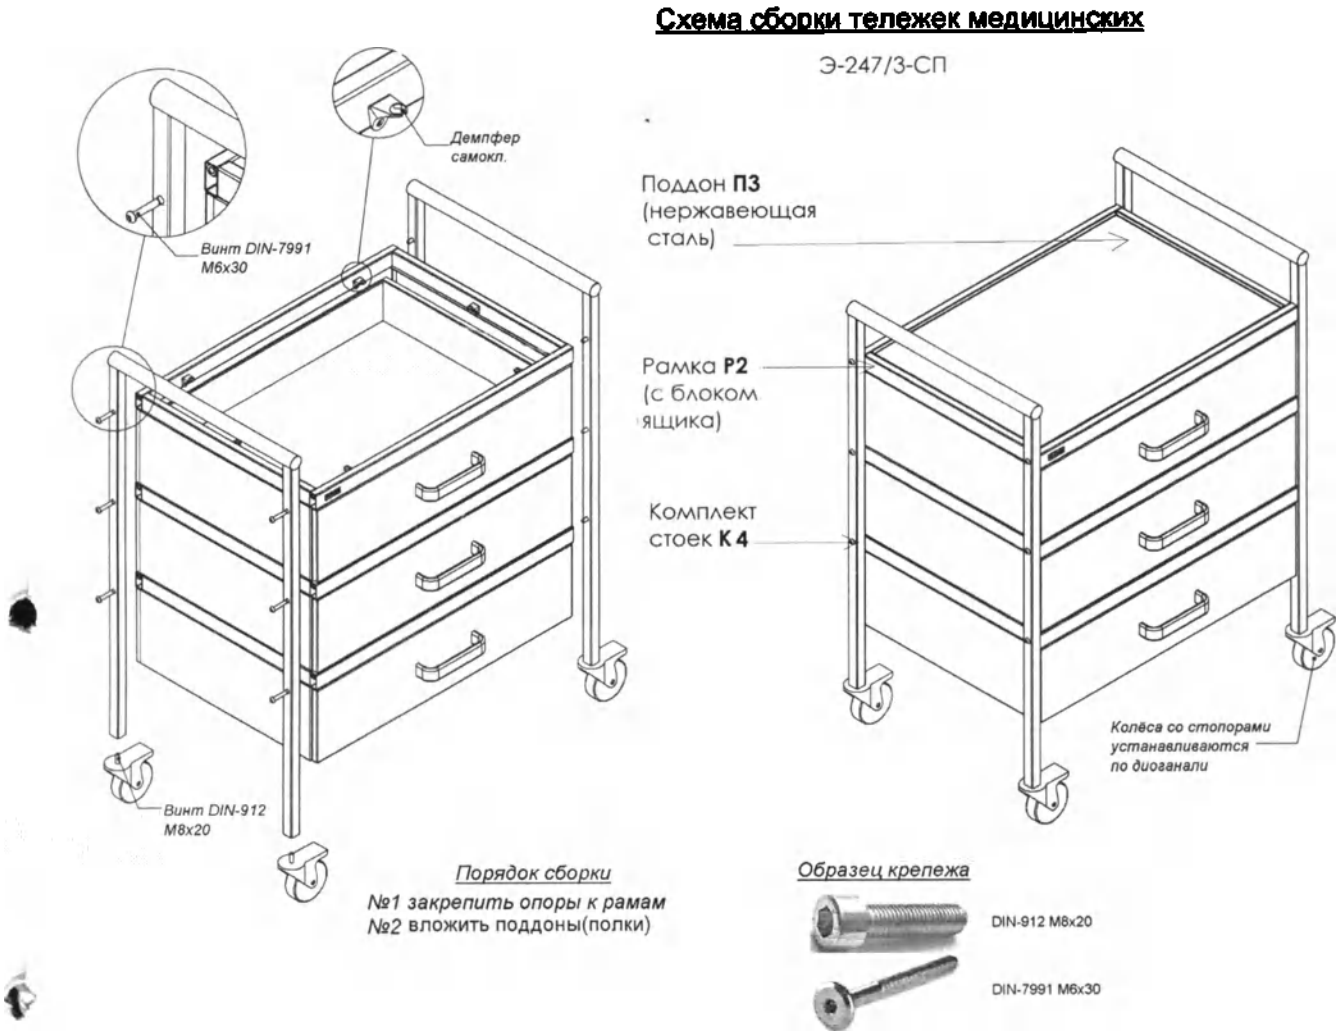

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: тележка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо целие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ıделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ıощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ıет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка медицинская Э-247/3-СП в количестве __________шт. принята в соответствии с ıзательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана ıным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Тележка медицинская Э-247/3-СП
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А.

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стойка инфузионная для капельниц Э-031-СР

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стойка инфузионная для капельниц Э-031-СР** (далее – стойка). тойка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стойка: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре ружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до % при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стойка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стойка с держателями для бутылок/пакетов с растворами предназначена для размещения на пределенной высоте флаконов или одноразовых систем с лекарственными растворами при роведении лечебных процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стойки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 0, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка нфузионная для апельниц	**Э-031-СР**	**Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм**	**2,5±0,3**	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф едицинский еталлический вухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стойки:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ 3	Стойка с винтом-фиксатором с держателями бутылок и пакетов	1
П 1	Опора стойки с колесом	3
С-2	Основание в сборе	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	3
	Гайка М6	3
	Винт М8х16	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания (опоры) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 Стальной тонкостенный профиль с гальваническим покрытием (стойка) Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	2,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стойки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1. Каждую опору стойки **П1** закрепить к основанию **С 2** винтом М6*35
10.2. В собранную конструкцию установить вертикально и сверху – стойку с ержателем бутылок и пакетов **СТ 3**, закрепить его винтом М8*16.
10.3. Инфузионная стойка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

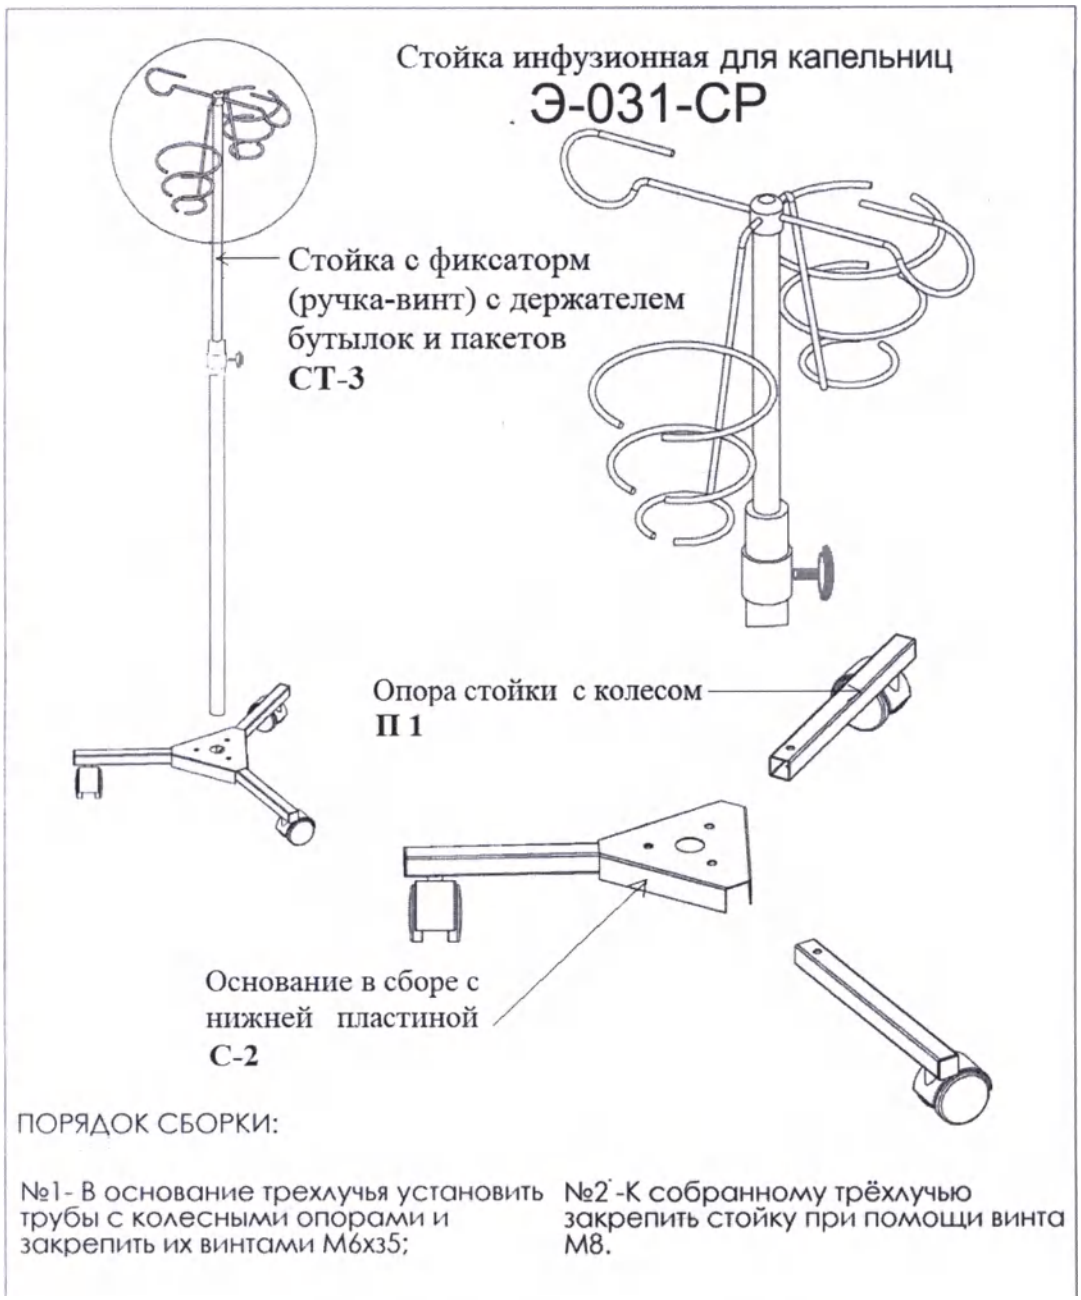

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стойка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка инфузионная для капельниц Э-031-СР в количестве __________шт. принят в соответствии обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и изнана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стойка инфузионная для капельниц Э-031-СР
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э.А./

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стойка инфузионная для капельниц Э-032-СР

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стойка инфузионная для капельниц Э-032-СР** (далее – стойка). тойка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стойки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стойка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стойка с держателями для бутылок/пакетов с растворами предназначена для размещения на пределенной высоте флаконов или одноразовых систем с лекарственными растворами при роведении лечебных процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стойки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 0, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	**Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм**	**3,6±0,3**		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стойки:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ 4	Стойка с винтом-фиксатором с держателями для пакетов	1
П 1	Опора стойки с колесом	3
С-2	Основание в сборе	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	3
	Гайка М6	3
	Винт М8х16	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания (опоры) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 Стальной тонкостенный профиль с гальваническим покрытием (стойка) Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	3,6±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стойки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1.Каждую опору стойки **П1** закрепить к основанию **С 2** винтом М6*35
10.2. В собранную конструкцию установить вертикально и сверху – стойку с держателем бутылок и пакетов **СТ 4**, закрепить его винтом М8*16
10.3. Инфузионная стойка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

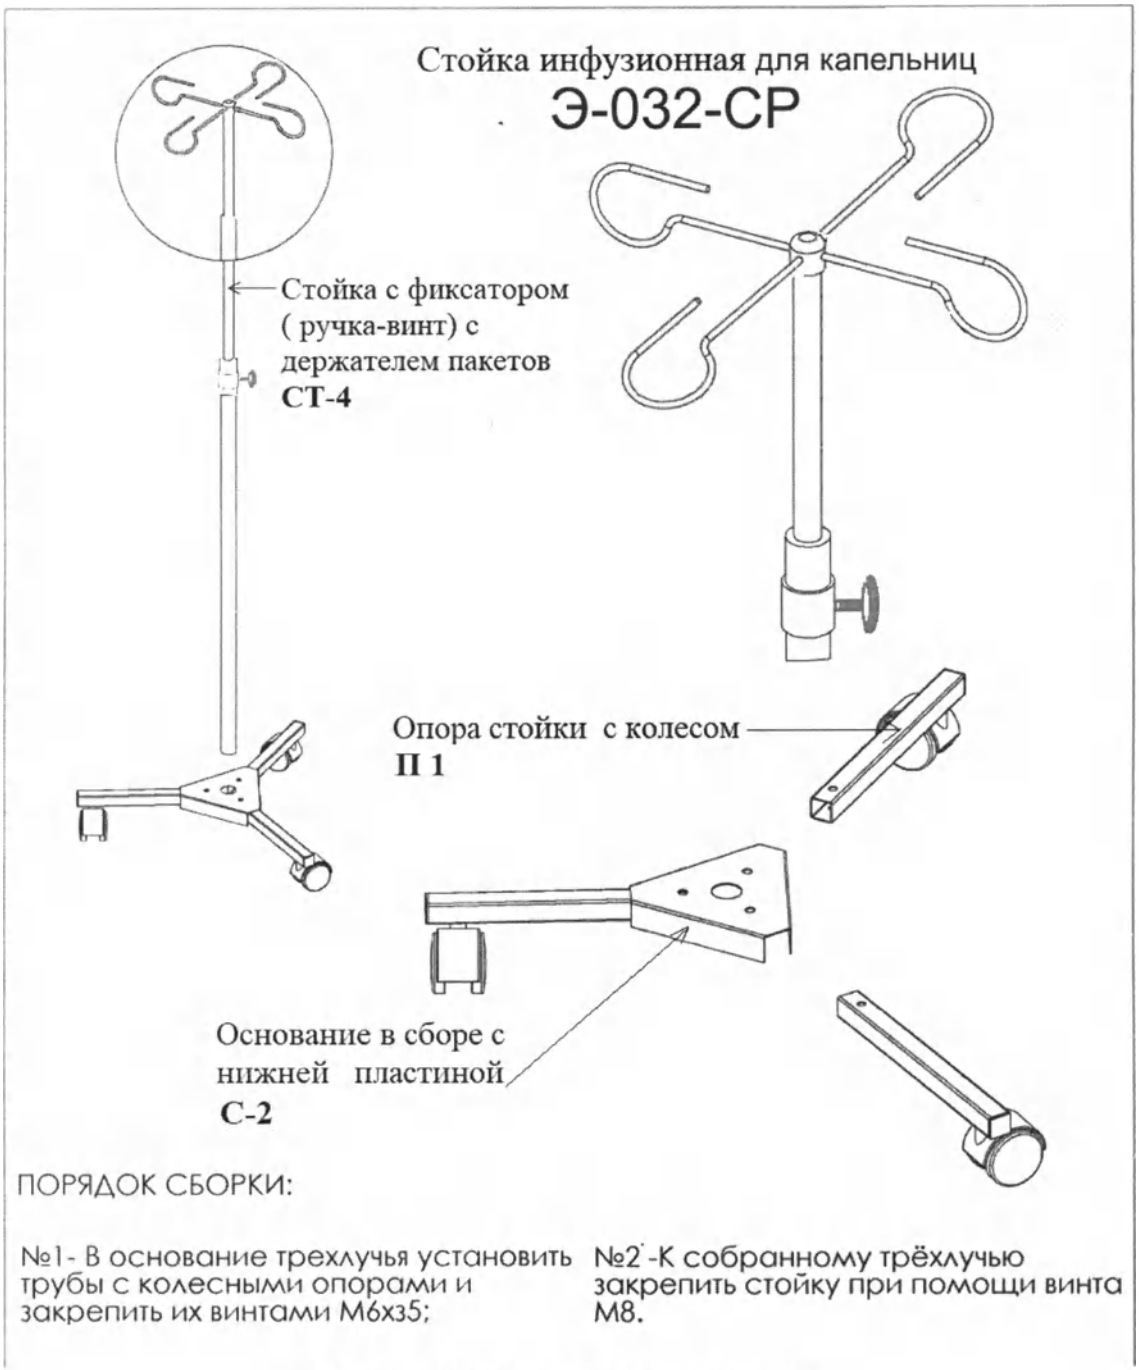

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стойка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие абразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка инфузионная для капельниц Э-032-СР в количестве __________шт. принят в соответствии язательными требованиями государственных стандартов и технической документации и изнана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стойка инфузионная для капельниц Э-032-СР
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность **Генеральный директор**
Подпись _____ / **Дрокин Д. А.**
«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стойка инфузионная для капельниц Э-131-СР

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стойка инфузионная для капельниц Э-131-СР** (далее – стойка). тойка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стойки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стойка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стойка с держателями для бутылок/пакетов с растворами предназначена для размещения на пределенной высоте флаконов или одноразовых систем с лекарственными растворами при роведении лечебных процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стойки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	**Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм**	**4,8±0,3**		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стойки:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ 5	Стойка с винтом-фиксатором с держателями бутылок и пакетов	1
П 2	Опора стойки с колесом	3
С-2	Основание в сборе	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х35	3
	Гайка М6	3
	Винт М8х16	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (опоры, стойка) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (основание, держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	4,8±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стойки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1.Каждую опору стойки **П2** закрепить к основанию **С 2** винтом М6*35
10.2. В собранную конструкцию установить вертикально и сверху – стойку с держателем бутылок и пакетов **СТ 5**, закрепить его винтом М8*16.
10.3. Инфузионная стойка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

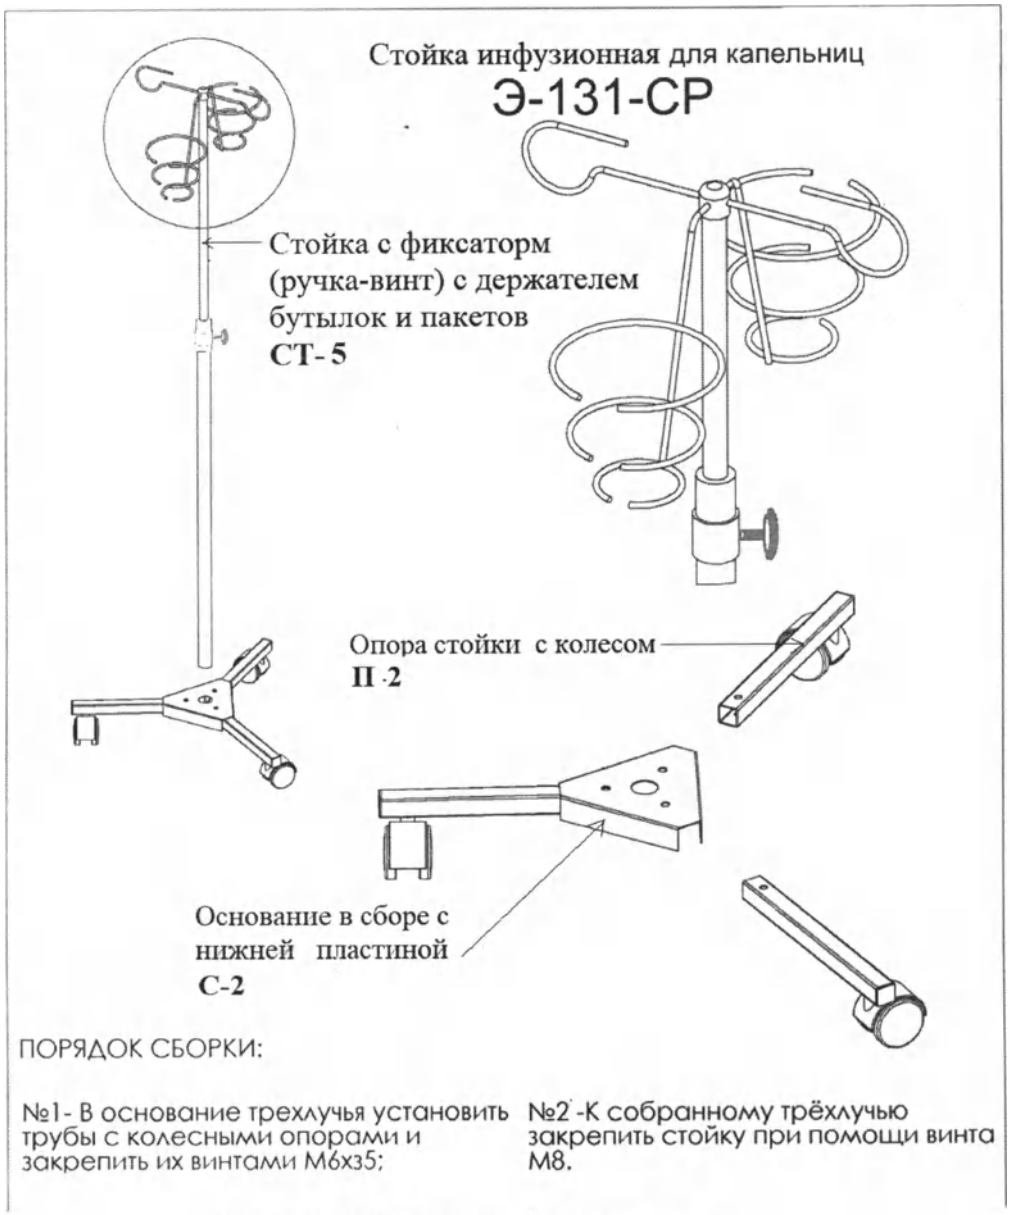

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стойка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка инфузионная для капельниц Э-131-СР в количестве __________шт. принят в соответствии обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и изнана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стойка инфузионная для капельниц Э-131-СР
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Э. А.
« 27 » июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стойка инфузионная для капельниц Э-132-СР

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стойка инфузионная для капельниц Э-132-СР** (далее – стойка). тойка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стойки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стойка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских бинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского рудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стойка с держателями для бутылок/пакетов с растворами предназначена для размещения на пределенной высоте флаконов или одноразовых систем с лекарственными растворами при роведении лечебных процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стойки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 0, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка нфузионная я капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	**Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм**	**4,4±0,3**		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стойки:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ 6	Стойка с винтом-фиксатором с держателями для пакетов	1
П 2	Опора стойки с колесом	3
С-2	Основание в сборе	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х35	3
	Гайка М6	3
	Винт М8х16	1

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (опоры, стойка) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (основание, держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	4,4±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стойки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1.Каждую опору стойки **П-2** закрепить к основанию **С 2** винтом М6*35
10.2. В собранную конструкцию установить вертикально и сверху – стойку с держателем бутылок и пакетов **СТ 6**, закрепить его винтом М8*16.
10.3. Инфузионная стойка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

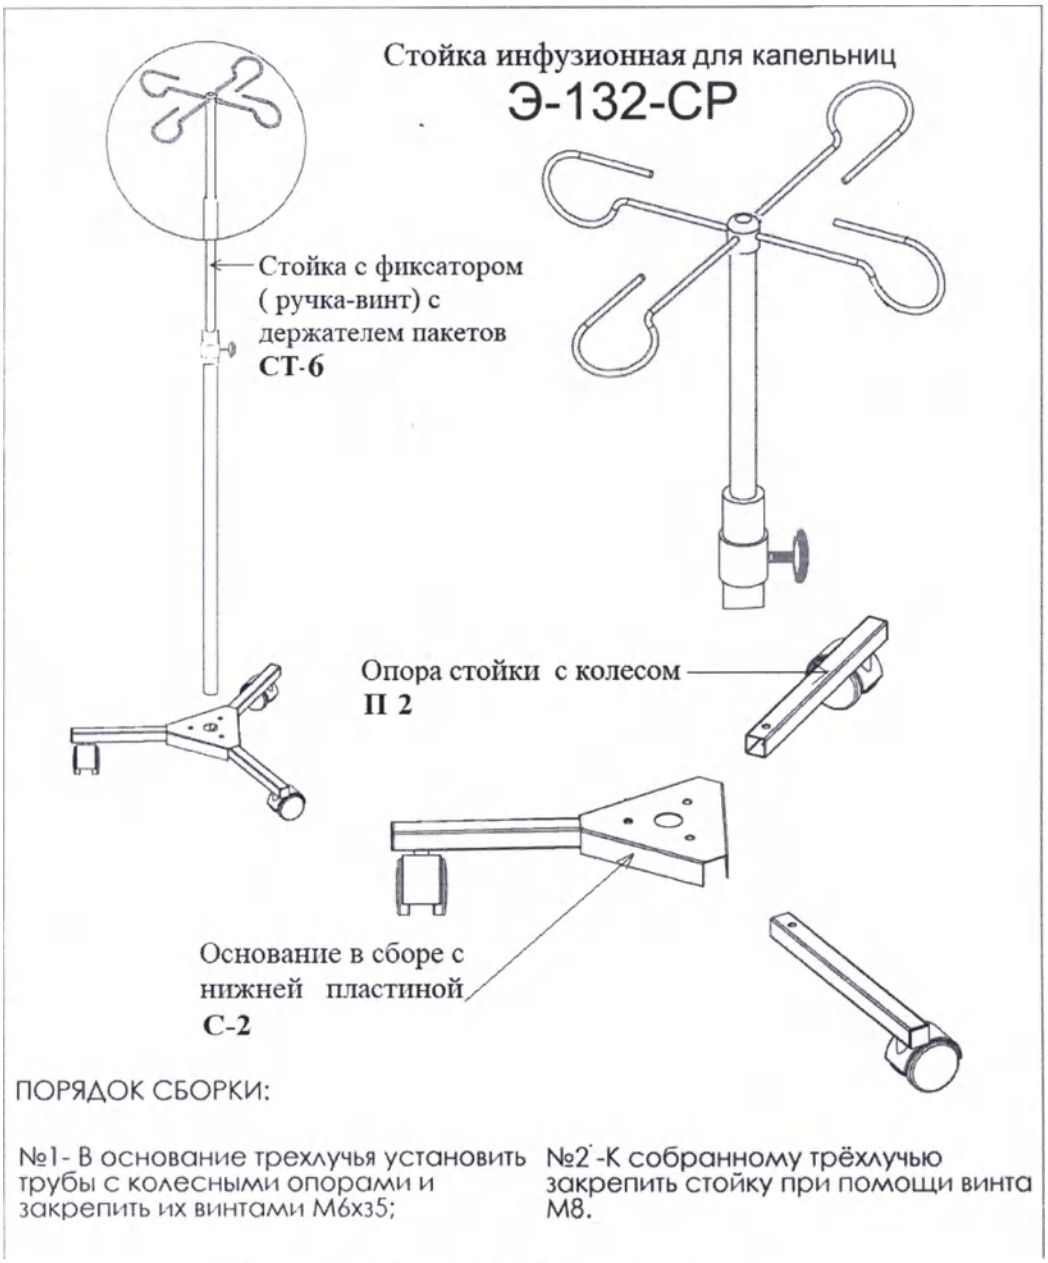

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стойка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели делец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка инфузионная для капельниц Э-132-СР в количестве __________шт. принят в соответствии бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и изнана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стойка инфузионная для капельниц Э-132-СР
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э.А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

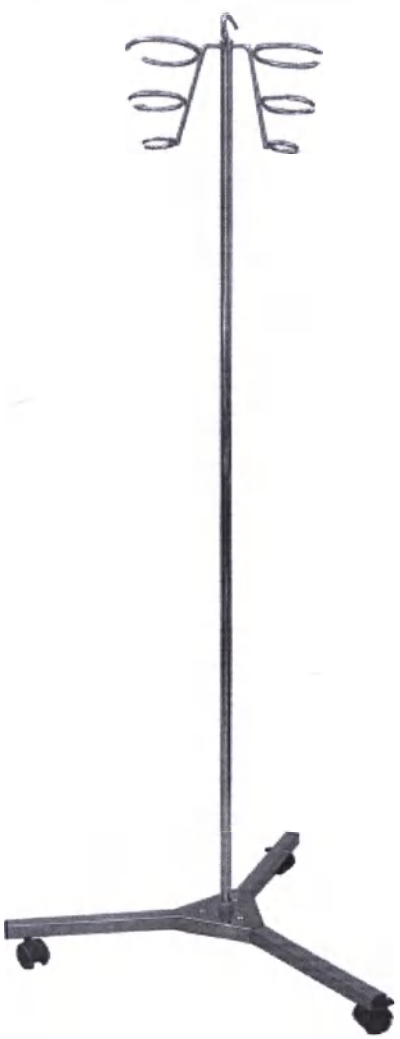

Стойка инфузионная для капельниц Э-031-СИ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стойка инфузионная для капельниц Э-031-СИ** (далее – стойка). Стойка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стойки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стойка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стойка с держателями для бутылок/пакетов с растворами предназначена для размещения на определенной высоте флаконов или одноразовых систем с лекарственными растворами при проведении лечебных процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стойки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	**Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.**	**3,5±0,3**		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

именование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стойки:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ 1	Стойка без фиксатора с держателями бутылок и пакетов	1
П 1	Опора стойки с колесом	3
С-2	Основание в сборе	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	3
	Гайка М6	3
	Винт М8х16	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания (опоры) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 Стальной тонкостенный профиль с гальваническим покрытием (стойка) Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (держатель)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	3,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стойки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных ерхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1.Каждую опору стойки **П1** закрепить к основанию **С 2** винтом М6*35
10.2. В собранную конструкцию установить вертикально и сверху – стойку с держателем бутылок и пакетов **СТ 1**, закрепить его винтом М8*16.
10.3. Инфузионная стойка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

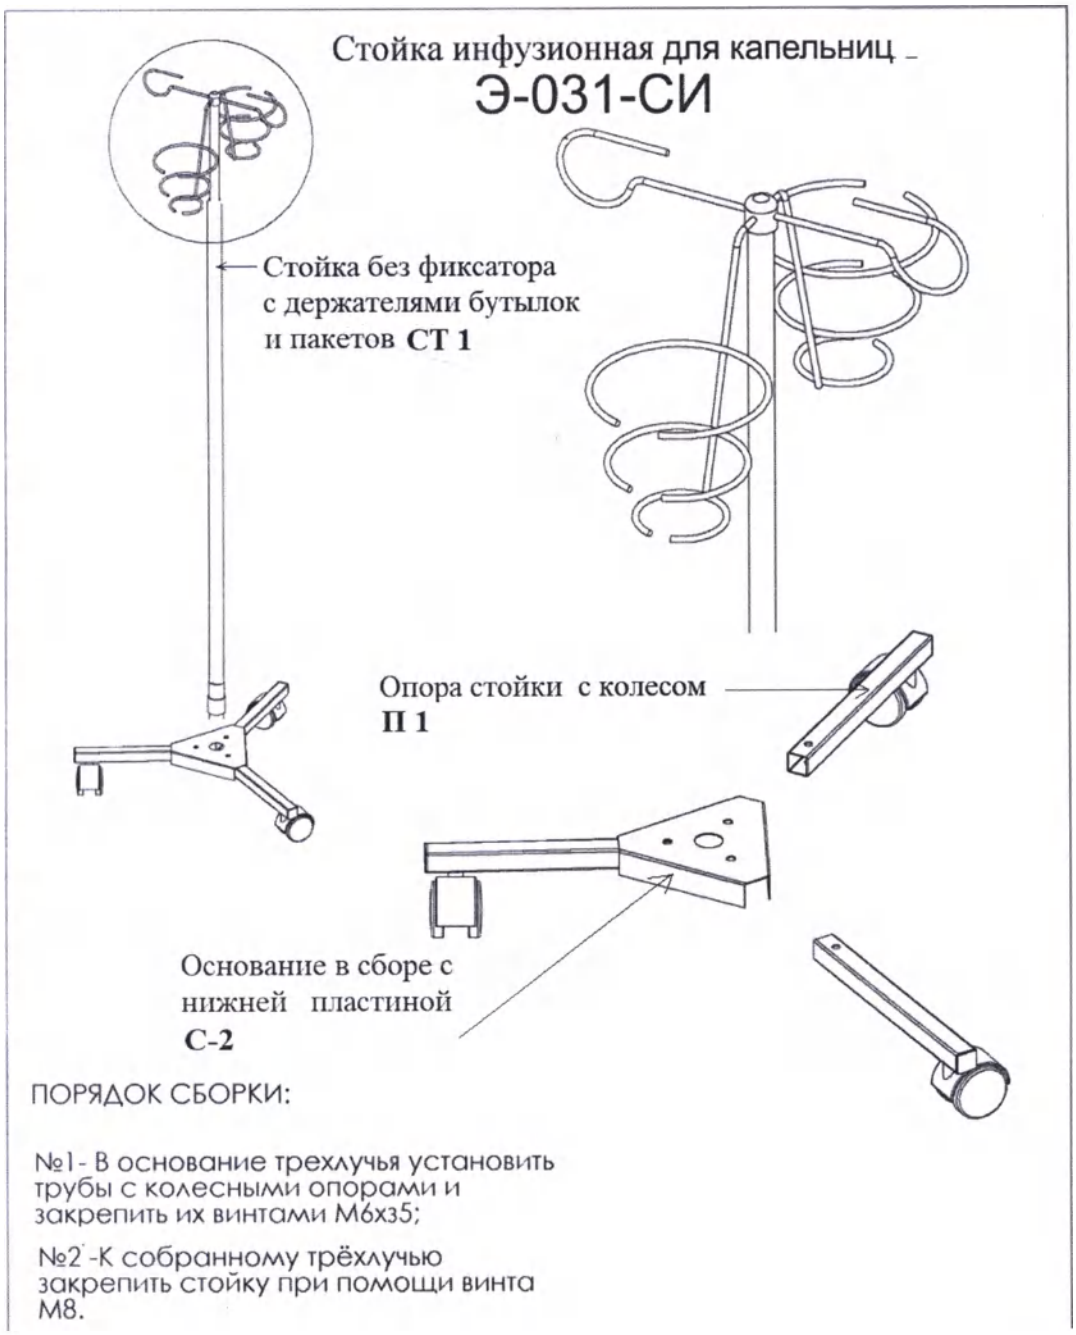

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стойка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка инфузионная для капельниц Э-031-СИ в количестве __________шт. принят в соответствии бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и изнана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стойка инфузионная для капельниц Э-031-СИ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дроки Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стойка инфузионная для капельниц Э-032-СИ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стойка инфузионная для капельниц Э-032-СИ** (далее – стойка). тойка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ .50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стойки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стойка носится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стойка с держателями для бутылок/пакетов с растворами предназначена для размещения на пределенной высоте флаконов или одноразовых систем с лекарственными растворами при роведении лечебных процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, еабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стойки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 0, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	**Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.**	**3,3±0,3**		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стойки:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ 2	Стойка без фиксатора с держателями пакетов	1
П 1	Опора стойки с колесом	3
С-2	Основание в сборе	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х35	3
	Гайка М6	3
	Винт М8х16	1

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль, с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания (опоры) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 Стальной тонкостенный профиль с гальваническим покрытием (стойка) Сталь по ГОСТ 13663 с покрытием краской порошковой эпоксиполиэфирной (держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	3,3±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стойки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1.Каждую опору стойки **П 1** закрепить к основанию **С 2** винтом М6*35
10.2. В собранную конструкцию установить вертикально и сверху – стойку с держателем пакетов **СТ 2**, закрепить его винтом М8*16.
10.3. Инфузионная стойка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

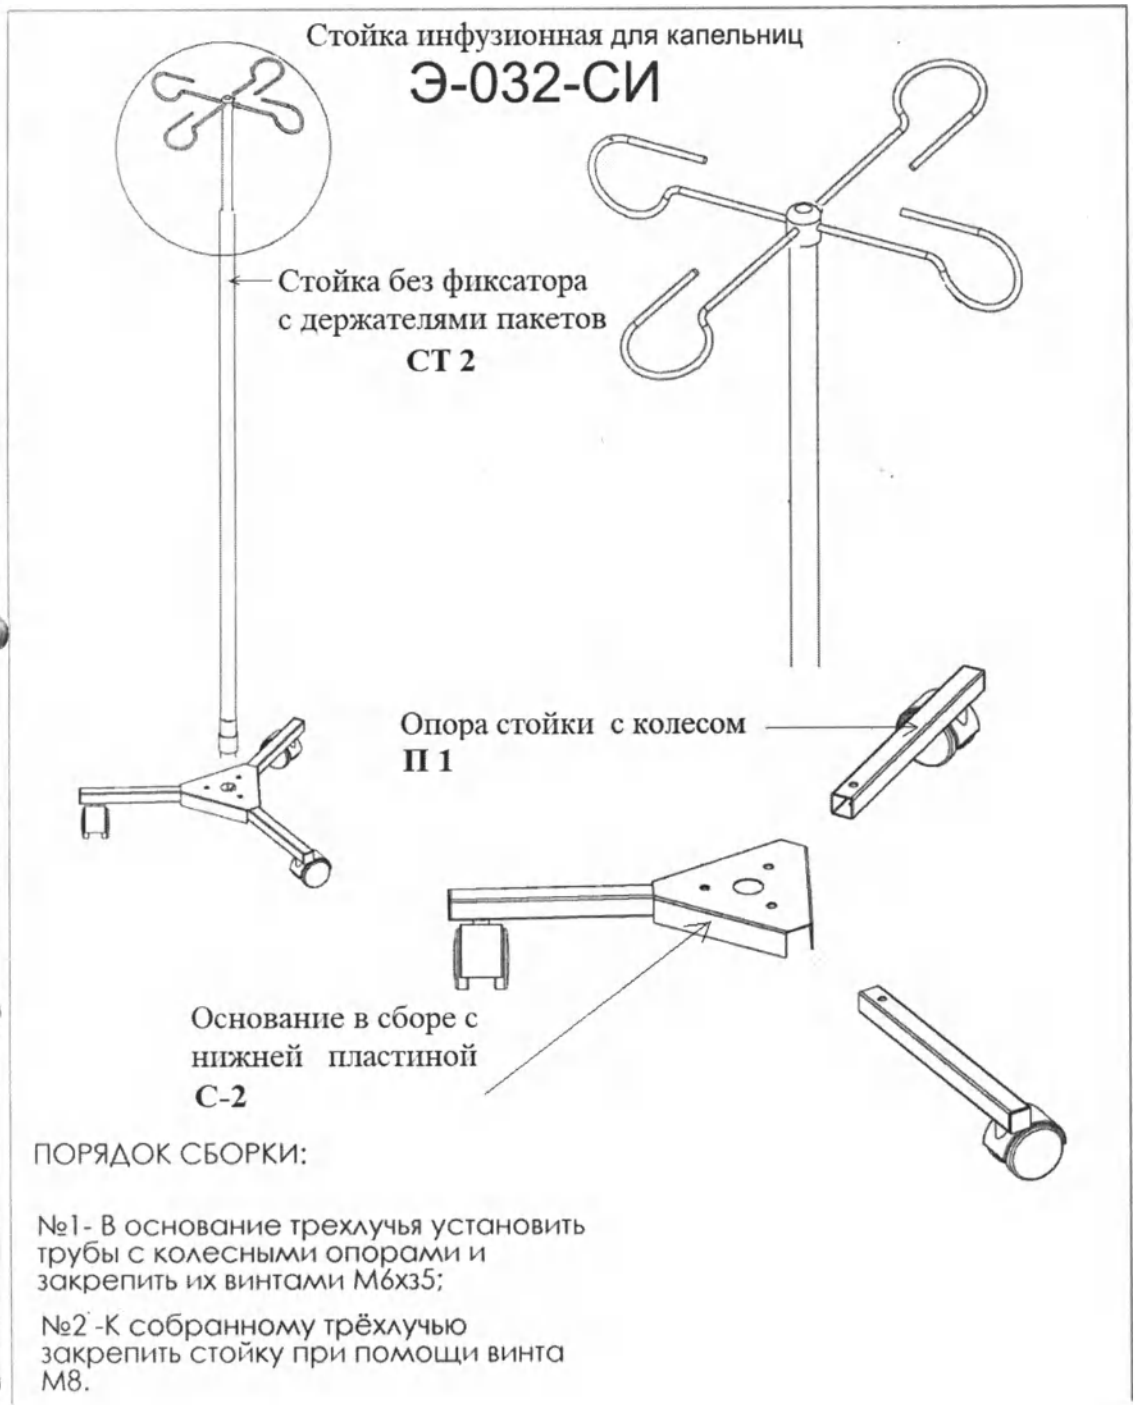

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: стойка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо целие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка инфузионная для капельниц Э-032-СИ в количестве __________шт. принят в соответствии бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и изнана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________

Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стойка инфузионная для капельниц Э-032-СИ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стойка инфузионная для капельниц Э-131-СИ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стойка инфузионная для капельниц Э-131-СИ** (далее – стойка). тойка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стойки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре кружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 0% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стойка тносится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских абинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского борудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования естринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных репаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стойка с держателями для бутылок/пакетов с растворами предназначена для размещения на пределенной высоте флаконов или одноразовых систем с лекарственными растворами при роведении лечебных процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, абилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного уководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стойки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	**Диаметр трехлучья: 700;** Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	**4,8±0,3**		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стойки:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ 7	Стойка с кнопкой-фиксатором с держателями бутылок и пакетов	1
П 2	Опора стойки с колесом	3
С-2	Основание в сборе	1
	Крепежные изделия	
	Винт М6х35	3
	Гайка М6	3
	Винт М8х16	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (опоры, стойка) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (основание, держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	4,8±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стойки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1.Каждую опору стойки **П2** закрепить к основанию **С 2** винтом М6*35
10.2. В собранную конструкцию установить вертикально и сверху – стойку с держателем бутылок и пакетов **СТ 7**, закрепить его винтом М8*16.
10.3. Инфузионная стойка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

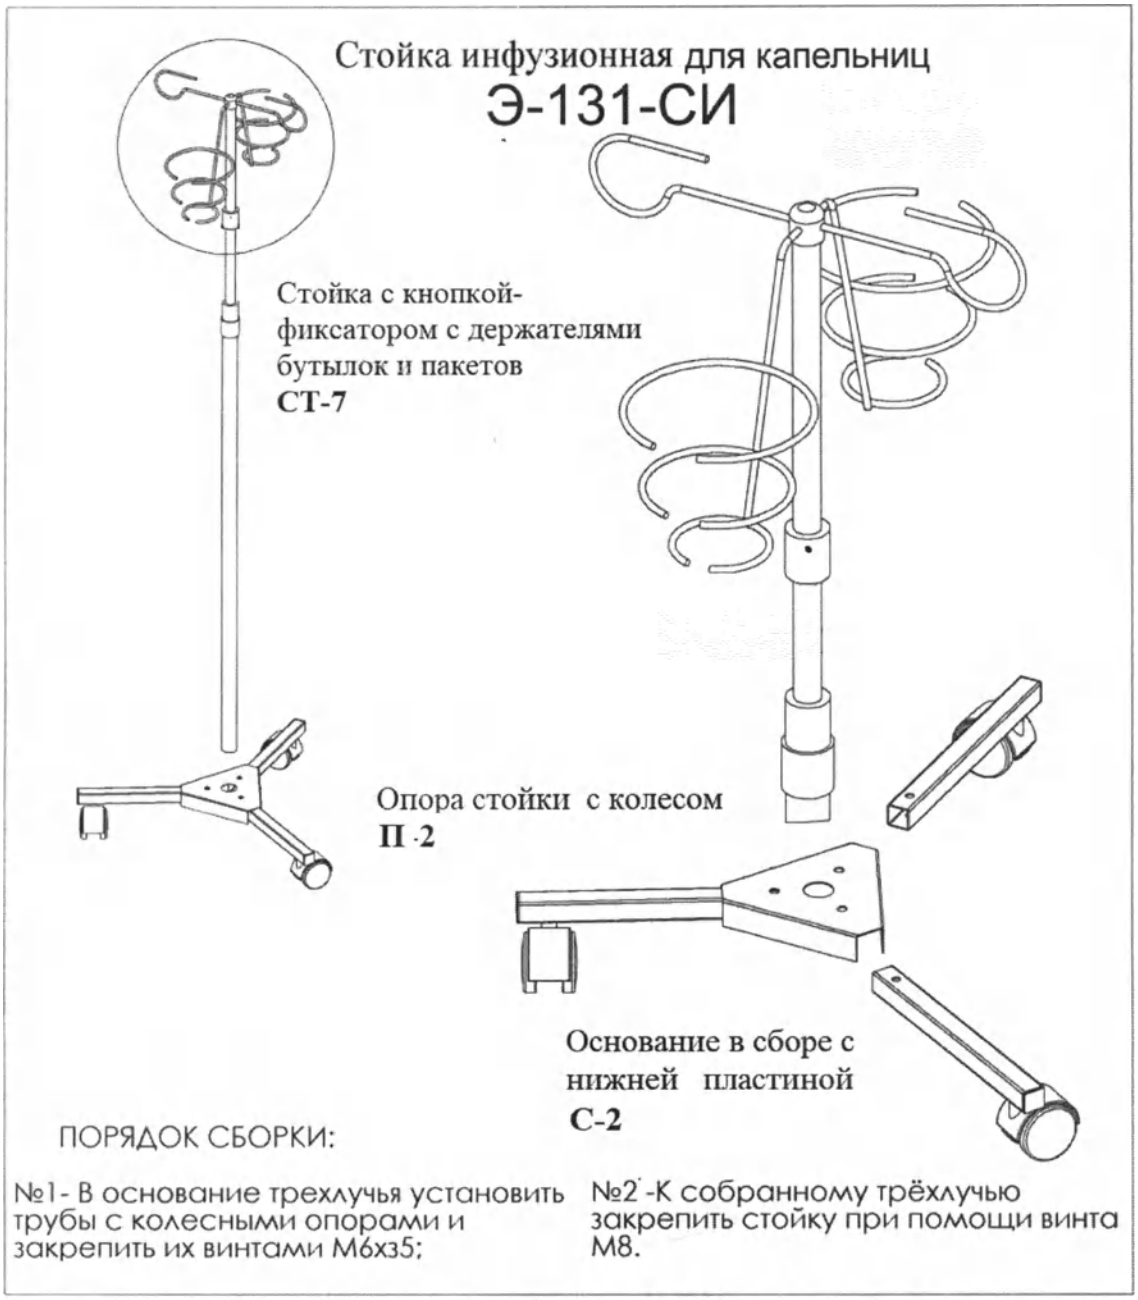

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стойка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ', при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка инфузионная для капельниц Э-131-СИ в количестве __________шт. принят в соответствии бязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и изнана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись распшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стойка инфузионная для капельниц Э-131-СИ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин А.

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

Стойка инфузионная для капельниц Э-132-СИ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Стойка инфузионная для капельниц Э-132-СИ** (далее – стойка). Стойка входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 2.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации стойки: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий стойка относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Стойка с держателями для бутылок/пакетов с растворами предназначена для размещения на определенной высоте флаконов или одноразовых систем с лекарственными растворами при проведении лечебных процедур.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы стойки составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	**Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм**	**4,4±0,3**		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки стойки:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ 8	Стойка с кнопкой-фиксатором с держателями пакетов	1
П 2	Опора стойки с колесом	3
С-2	Основание в сборе	1
Крепежные изделия		
	Винт М6х35	3
	Гайка М6	3
	Винт М8х16	1

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (опоры, стойка) Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (основание, держатель)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	4,4±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали стойки освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных верхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1.Каждую опору стойки **П2** закрепить к основанию **С 2** винтом М6*35
10.2. В собранную конструкцию установить вертикально и сверху – стойку с держателем бутылок и пакетов **СТ 8**, закрепить его винтом М8*16.
10.3.Инфузионная стойка готова к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

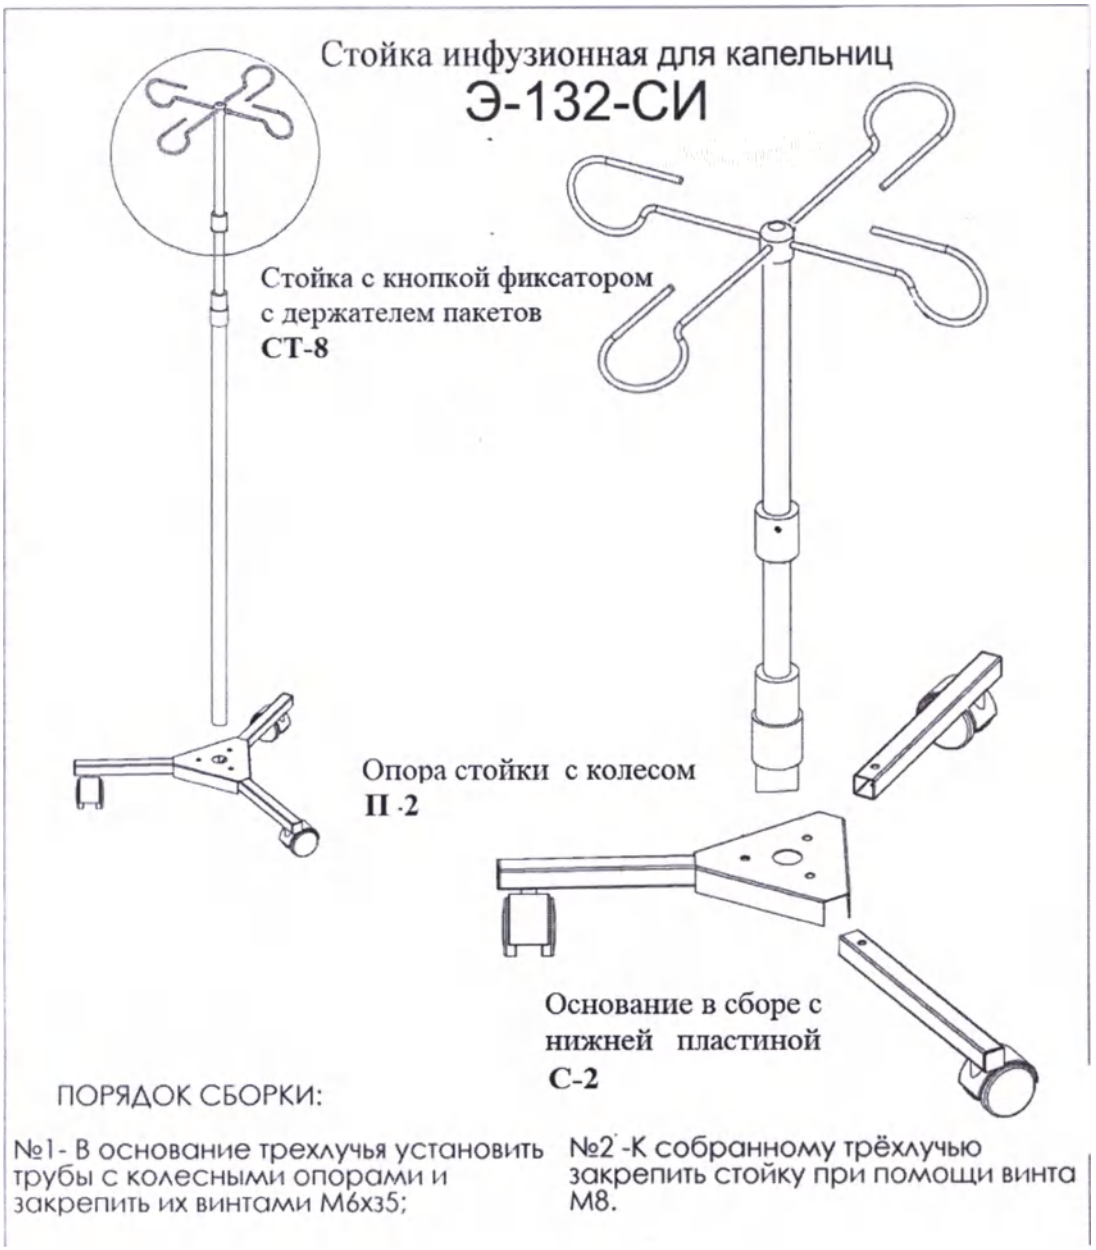

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: стойка обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка инфузионная для капельниц Э-132-СИ в количестве __________шт. принят в соответствии обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и изнана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Стойка инфузионная для капельниц Э-132-СИ
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А.

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

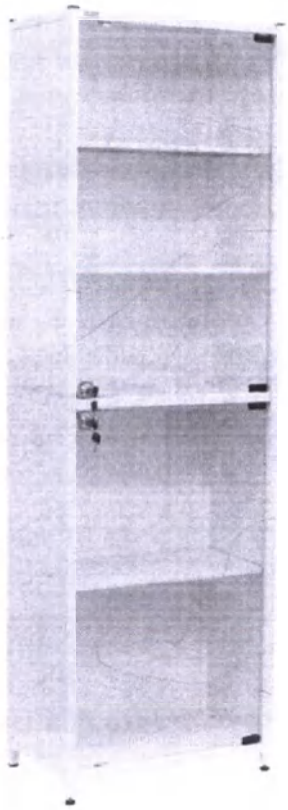

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-110-ШКЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-110-ШКЭ** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	**Э-110-ШКЭ**	**500*300*1650**	**32,7±0,5**	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 1	Полка верхняя	1
П 2	Полка средняя	1
П 3	Полка нижняя	1
СТ 2	Задняя стенка	2
Д 1	Дверца (стекло)	2
П 4	Полка вкладная	3
Крепежные изделия		
	Саморез 4,2х13	24
	Саморез со сверлом 4,2х13	9
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	2
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, Листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас, полки); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (двери)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	32,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 1** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 2** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 3** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ 2** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 1, П 2, П**3 .
10.6 В собранную конструкцию установить две двери **Д1** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П4**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-110-ШКЭ, Э-111-ШКЭ , Э-112-ШКЭ

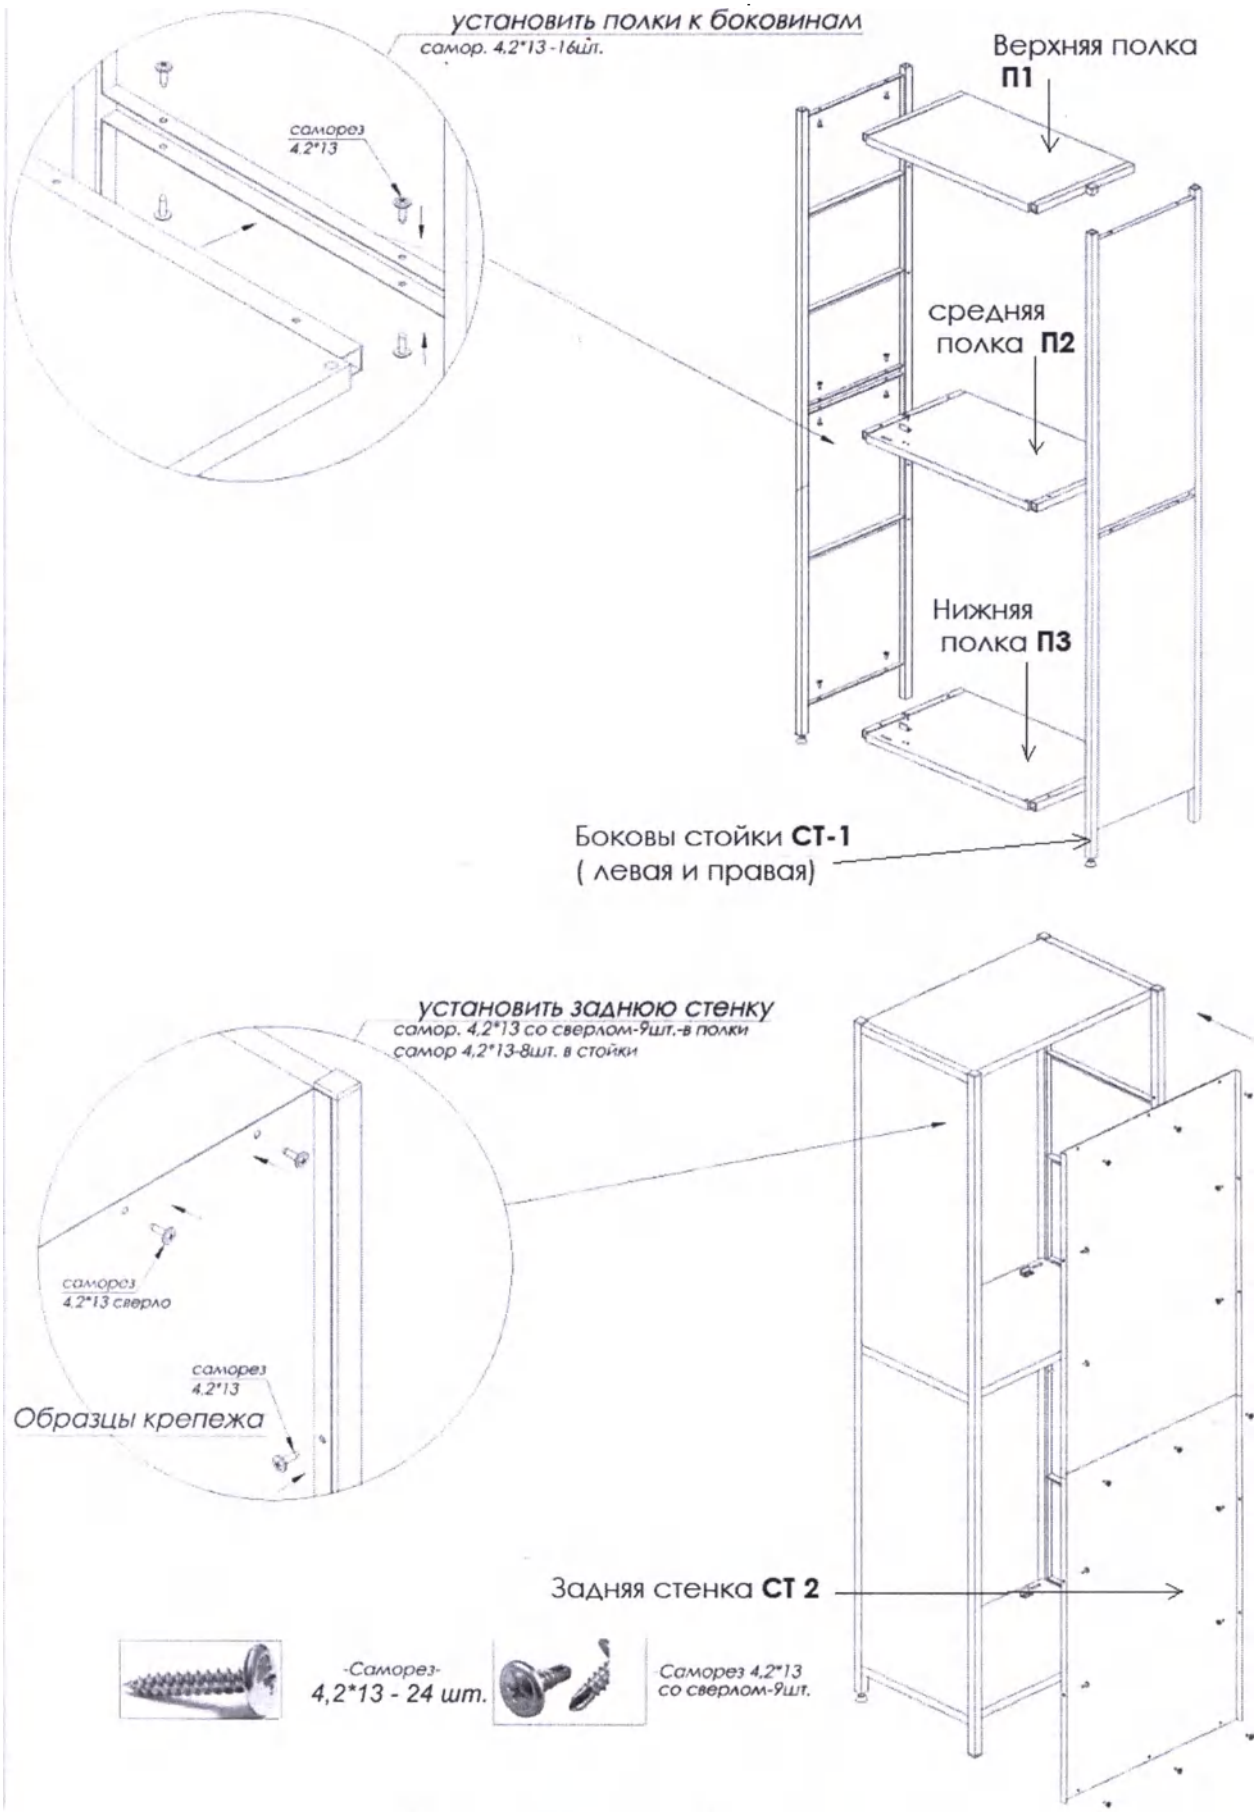

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

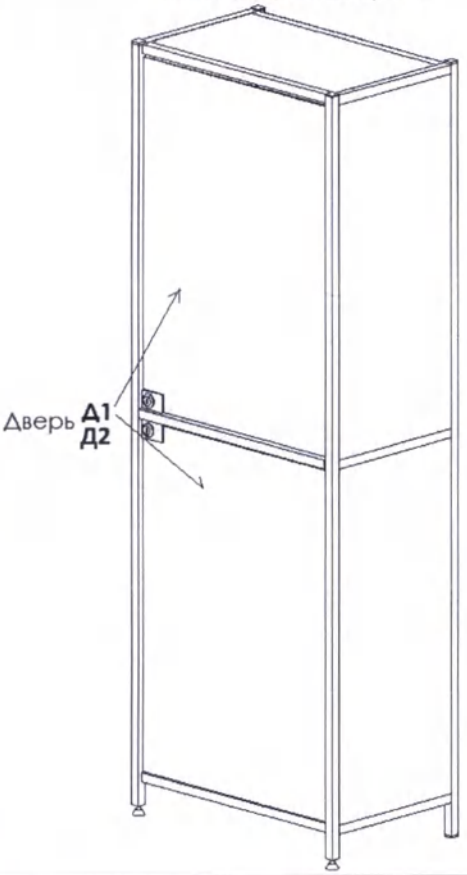

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

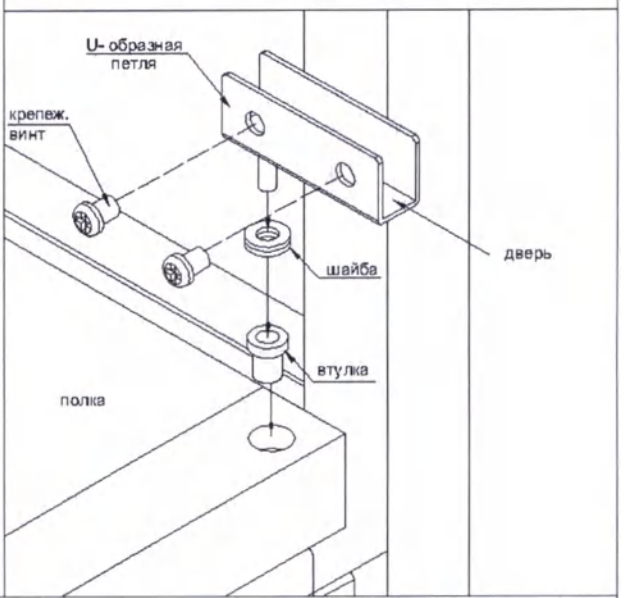

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

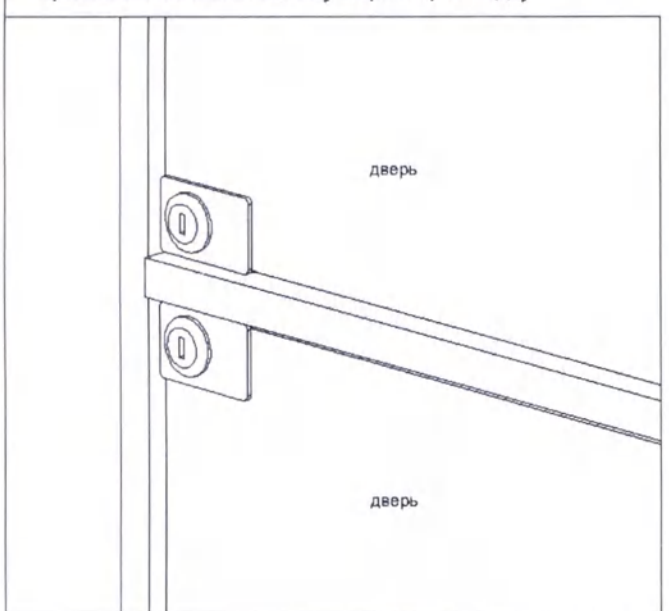

Замок для одной распашной двери
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ГУ, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо изделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели владелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической помощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических специалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец берет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-110-ШКЭ в количестве __________шт. принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-110-ШКЭ

Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________

Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«21» июля 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

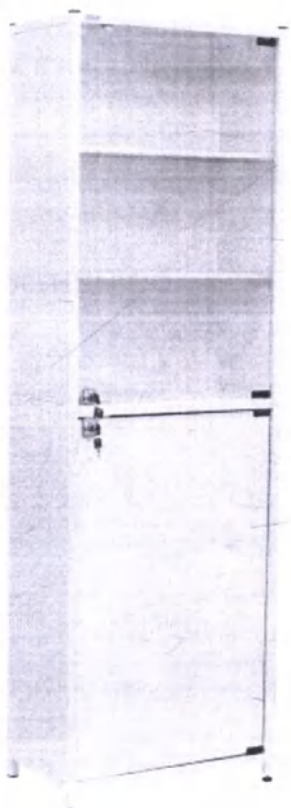

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-111-ШКЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-111-ШКЭ** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	**500*300*1650**	**30,0±0,5**		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
Деталь		
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 1	Полка верхняя	1
П 2	Полка средняя	1
П 3	Полка нижняя	1
СТ 2	Задняя стенка	2
Д 1	Дверца (стекло)	1
Д 2	Дверца (металл)	1
П 4	Полка вкладная	3
Крепежные изделия		
	Саморез 4,2х13	24
	Саморез со сверлом 4,2х13	9
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	2
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас, полки); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (двери)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	30,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 1** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 2** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 3** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ 2** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 1, П 2, П**3 .
10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1и Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П4**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов Э-110-ШКЭ, Э-111-ШКЭ , Э-112-ШКЭ

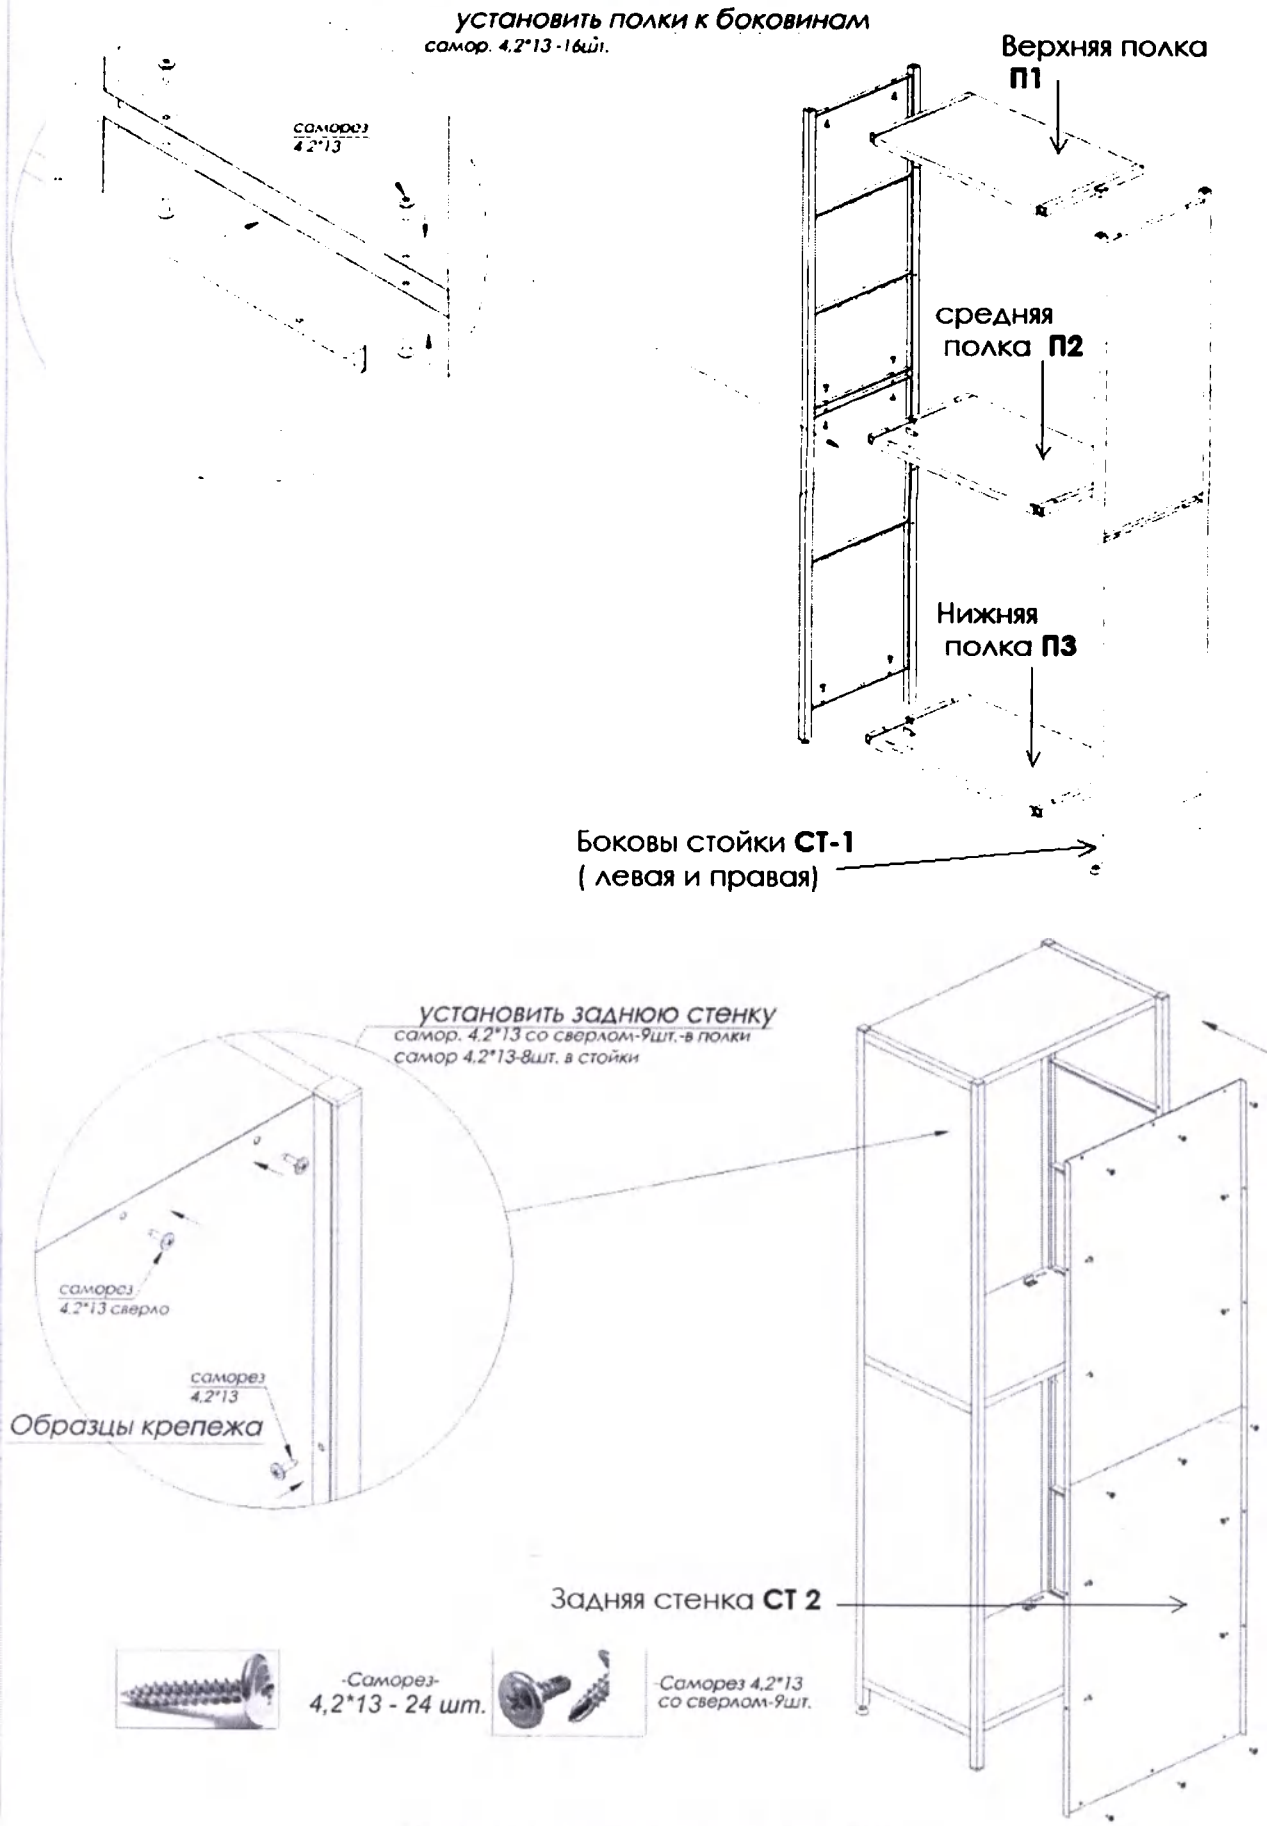

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

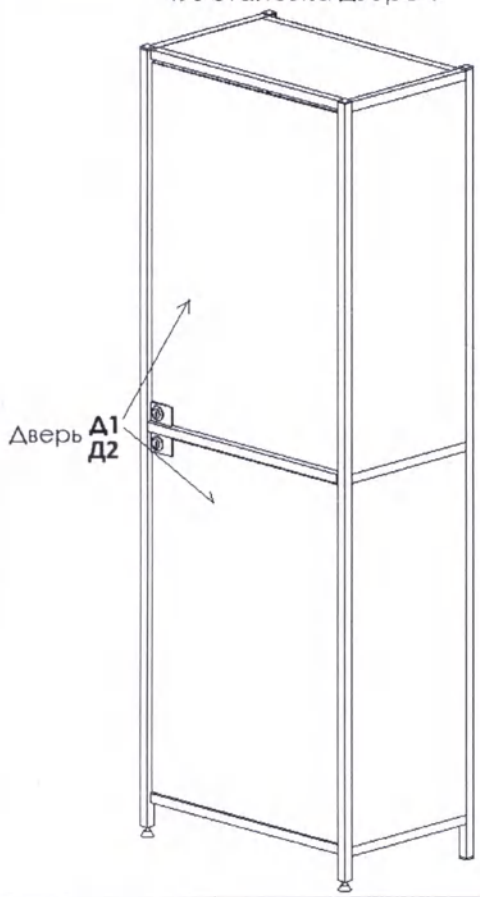

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

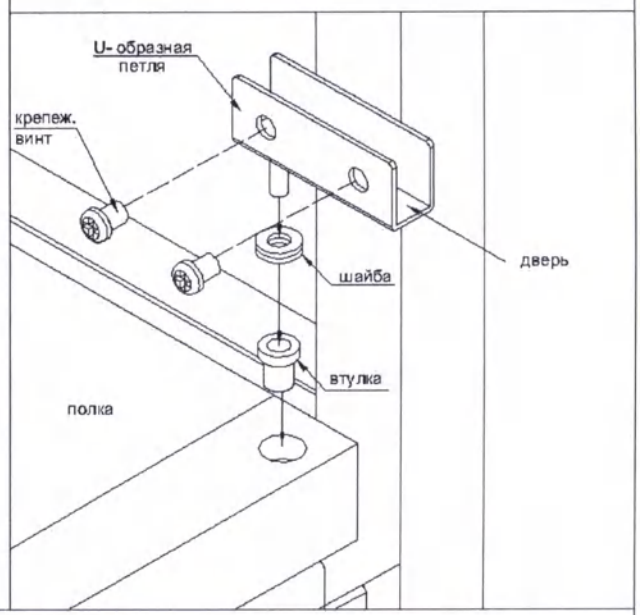

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

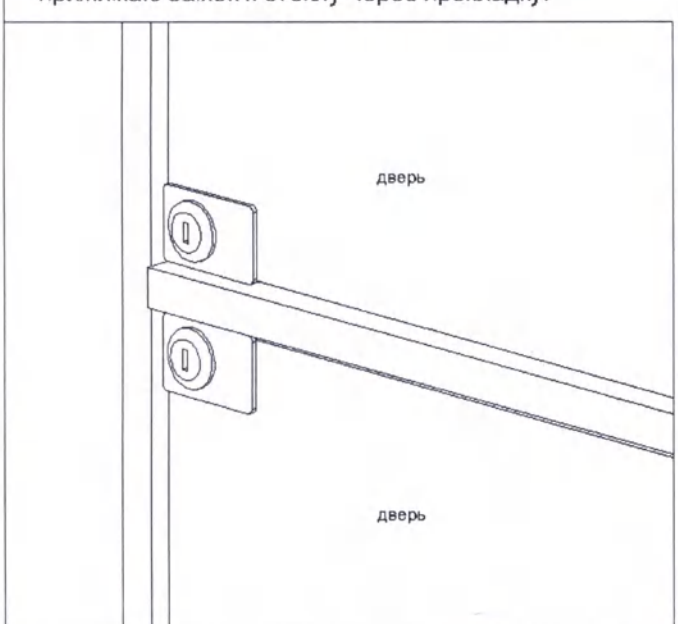

Замок для одной распашной двери
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке или изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ГУ, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации есвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-111-ШКЭ в количестве _____шт. принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медицинских учреждений Э-111-ШКЭ

Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____20__ г.

Дата_____

Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э.**

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

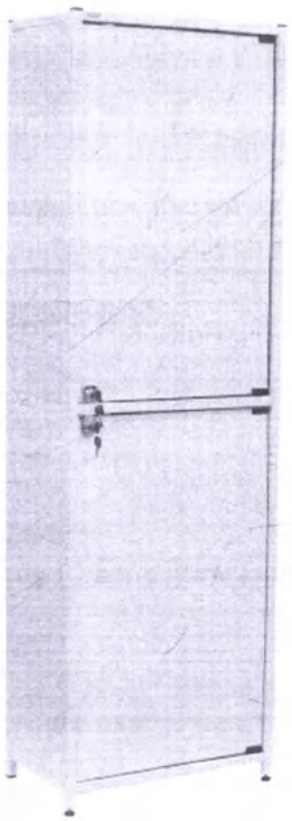

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-112-ШКЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-112-ШКЭ** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	**500*300*1650**	**31,9±0,5**		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 1	Полка верхняя	1
П 2	Полка средняя	1
П 3	Полка нижняя	1
СТ 2	Задняя стенка	2
Д 2	Дверца (металл)	2
П 4	Полка вкладная (металл)	3
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	24
	Саморез со сверлом 4,2х13	9
	Замок-ручка	2
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской. (каркас, полки, двери);
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	31,9±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 1** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 2** четырьмя саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 3** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ 2** и закрепить их саморезами к полкам **П 1, П 2, П**3 .
10.6 В собранную конструкцию установить две двери **Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки согласно схеме.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П4**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-110-ШКЭ, Э-111-ШКЭ , Э-112-ШКЭ

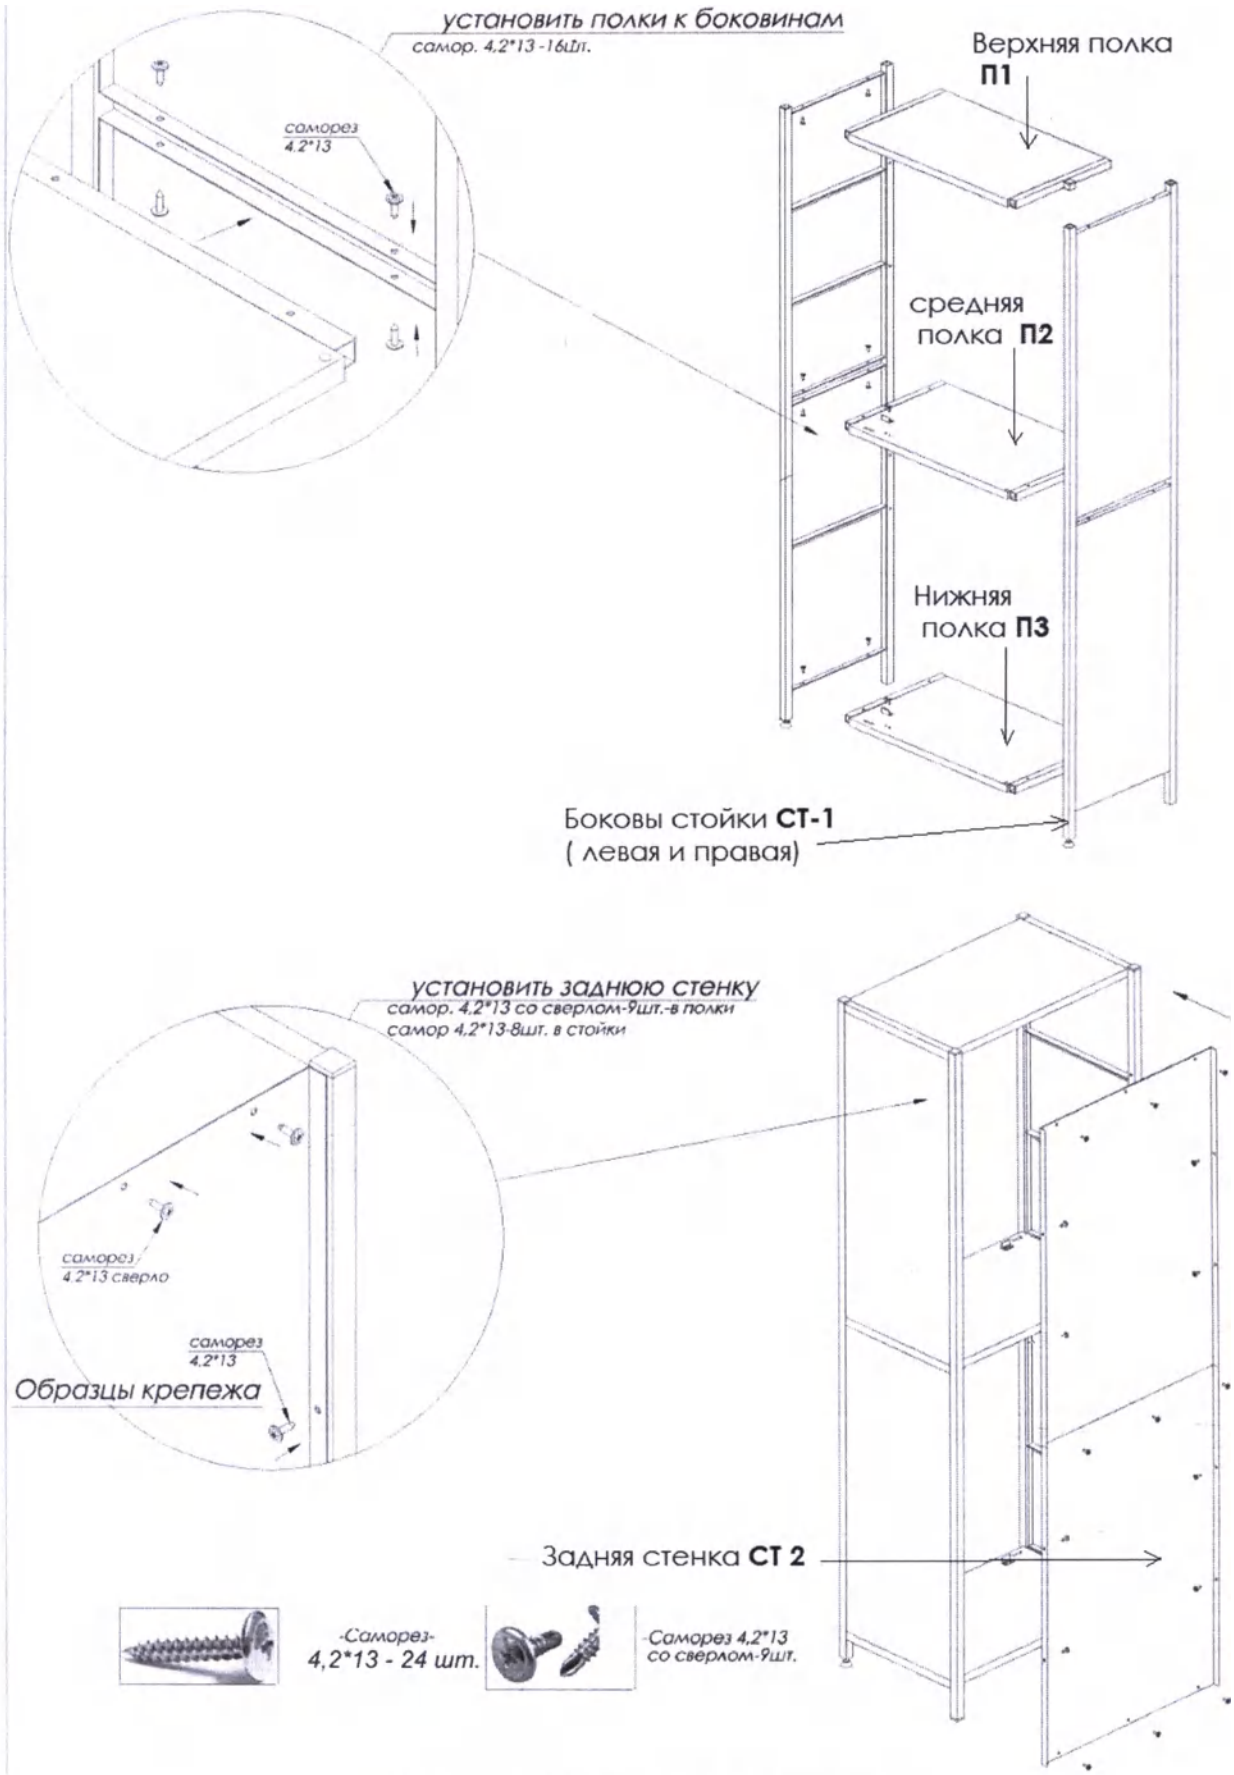

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

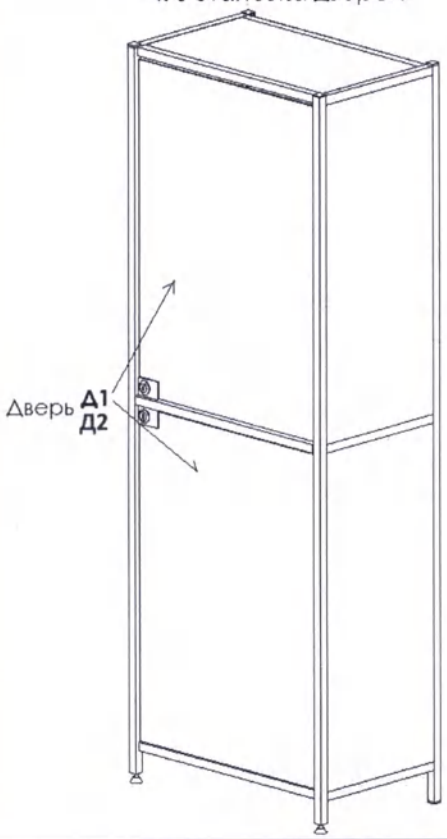

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

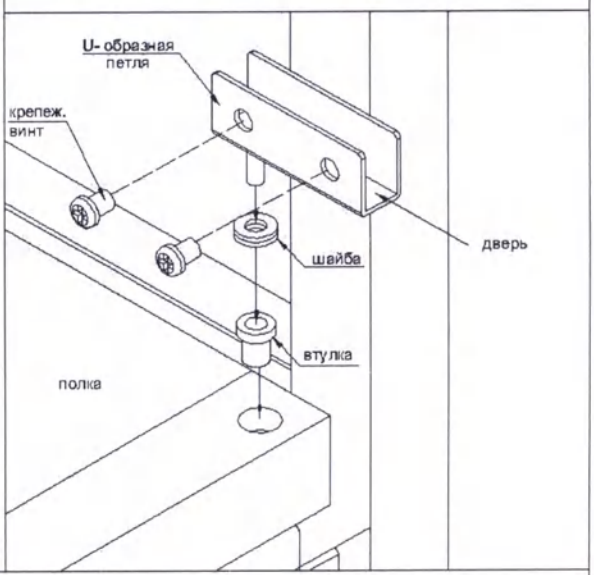

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

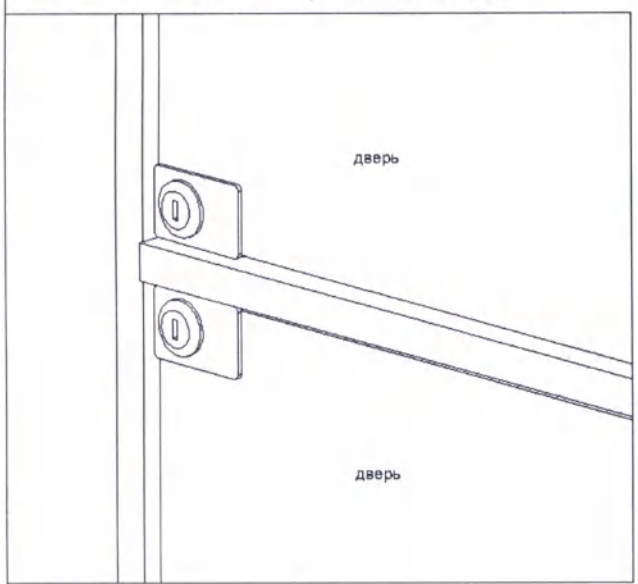

Замок для одной распашной двери
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие ̆бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ıходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации ̆возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ıаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-112-ШКЭ в количестве __________шт. принят в ̆оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической ̆окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-112-ШКЭ

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.**

«27» января 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

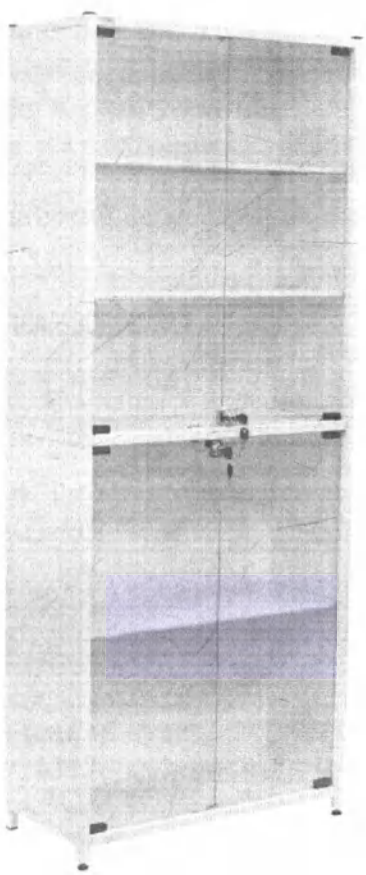

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-113-ШКЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-113-ШКЭ** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	**650*300*1650**	**38±0,5**		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 5	Полка верхняя	1
П 6	Полка средняя	1
П 7	Полка нижняя	1
СТ 3	Задняя стенка	4
Д 1	Дверца (стекло)	4
П 8	Полка вкладная	3
Крепежные изделия		
	Саморез 4,2х13	26
	Саморез со сверлом 4,2х13	18
	U-образная петля (комплект на одну дверь	4
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас, полки); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (двери)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	38,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 5** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 6** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 7** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ3** и закрепить их саморезами к полкам **П 5, П 6, П7** .
10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П8**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов Э-113-ШКЭ, Э-114-ШКЭ, Э-115-ШКЭ

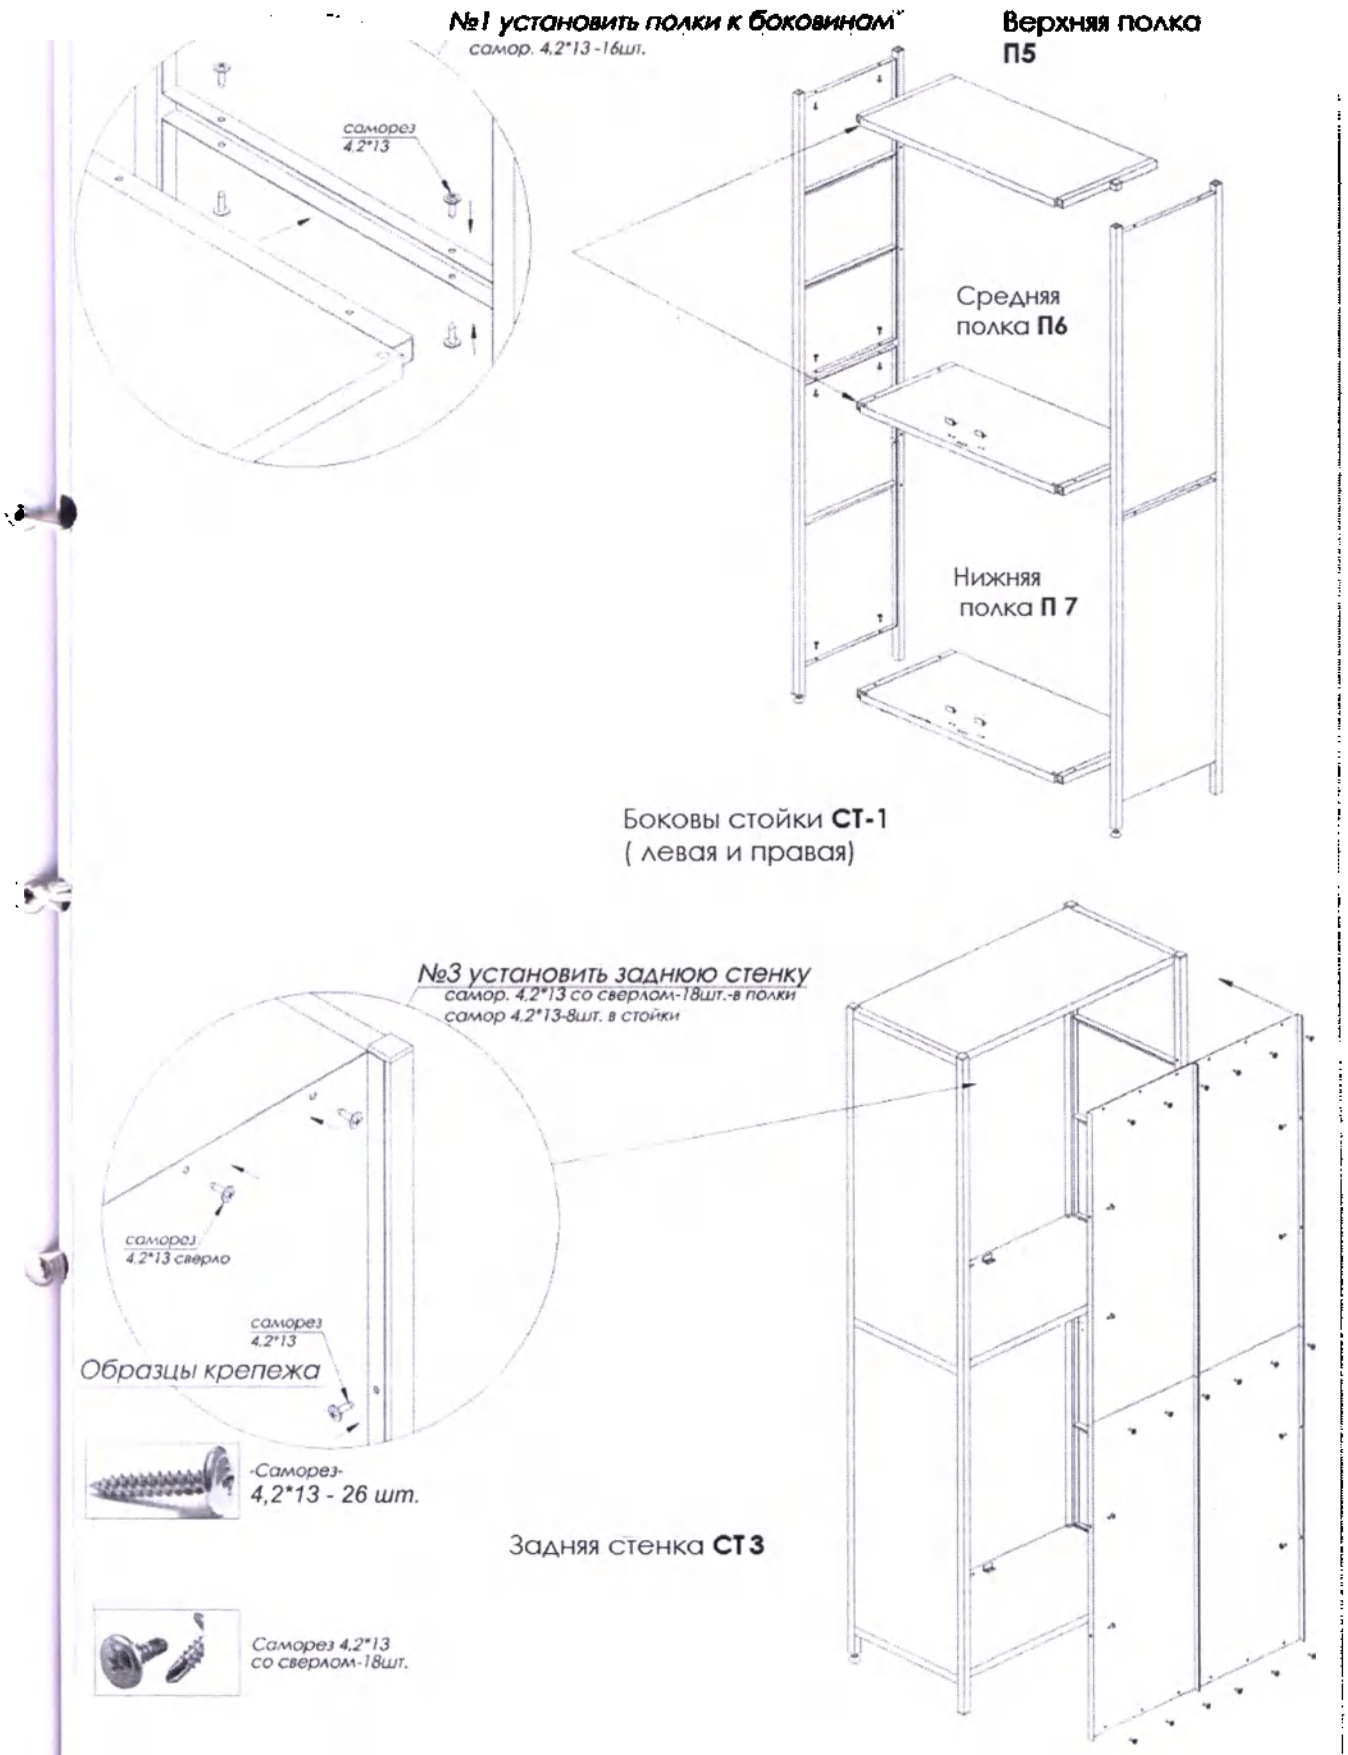

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

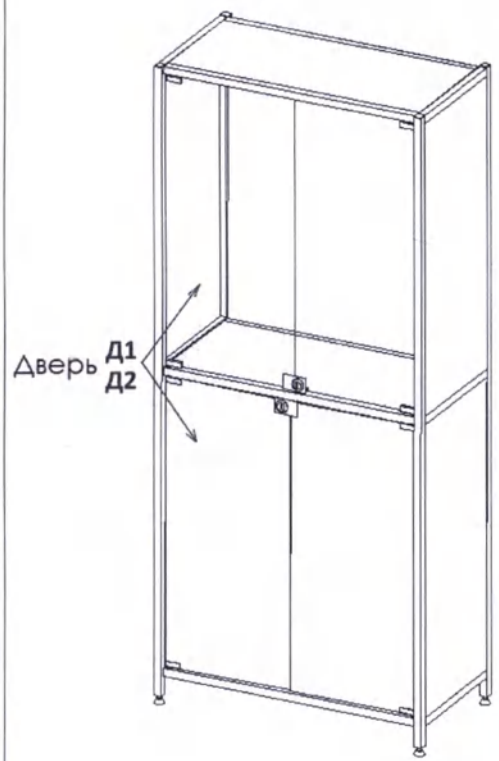

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

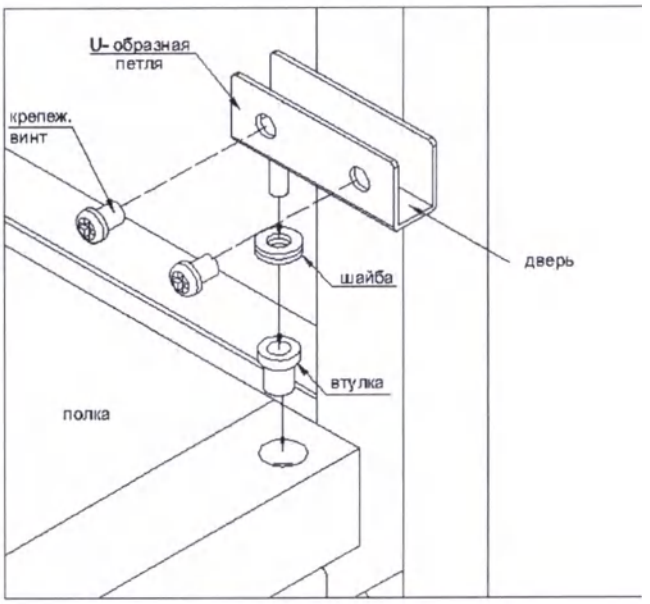

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

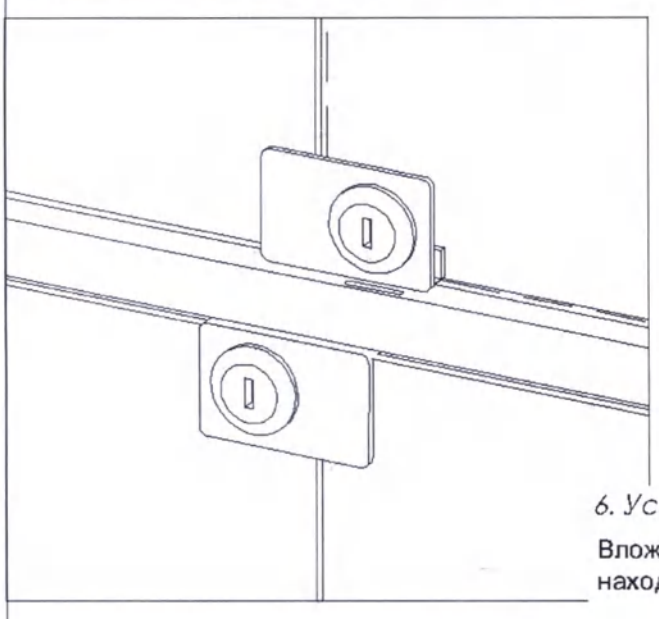

Замок для двух распашных дверей
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-113-ШКЭ в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-113-ШКЭ

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.**

«27» октября 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

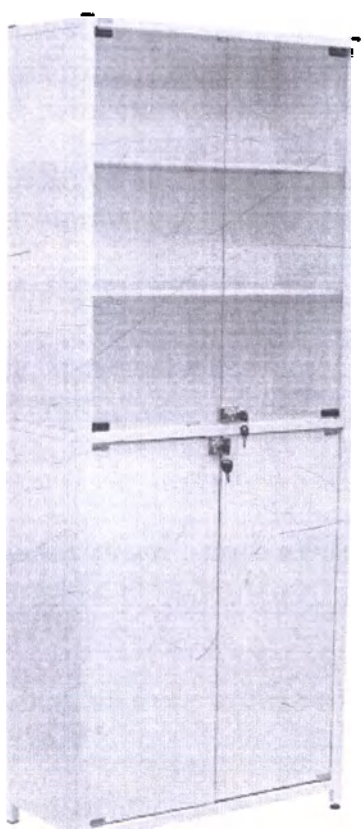

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-114-ШКЭ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-114-ШКЭ** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	**650*300*1650**	**37±0,5**		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2. Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 5	Полка верхняя	1
П 6	Полка средняя	1
П 7	Полка нижняя	1
СТ 3	Задняя стенка	4
Д 1	Дверца (стекло)	2
Д 2	Дверца (металл)	2
П 8	Полка вкладная	3
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	26
	Саморез со сверлом 4,2х13	18
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	4
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас, полки); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (двери)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	37,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 5** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 6** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 7** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ3** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 5, П 6, П7** .
10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1** и **Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П8**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкакфов
Э-113-ШКЭ, Э-114-ШКЭ, Э-115-ШКЭ

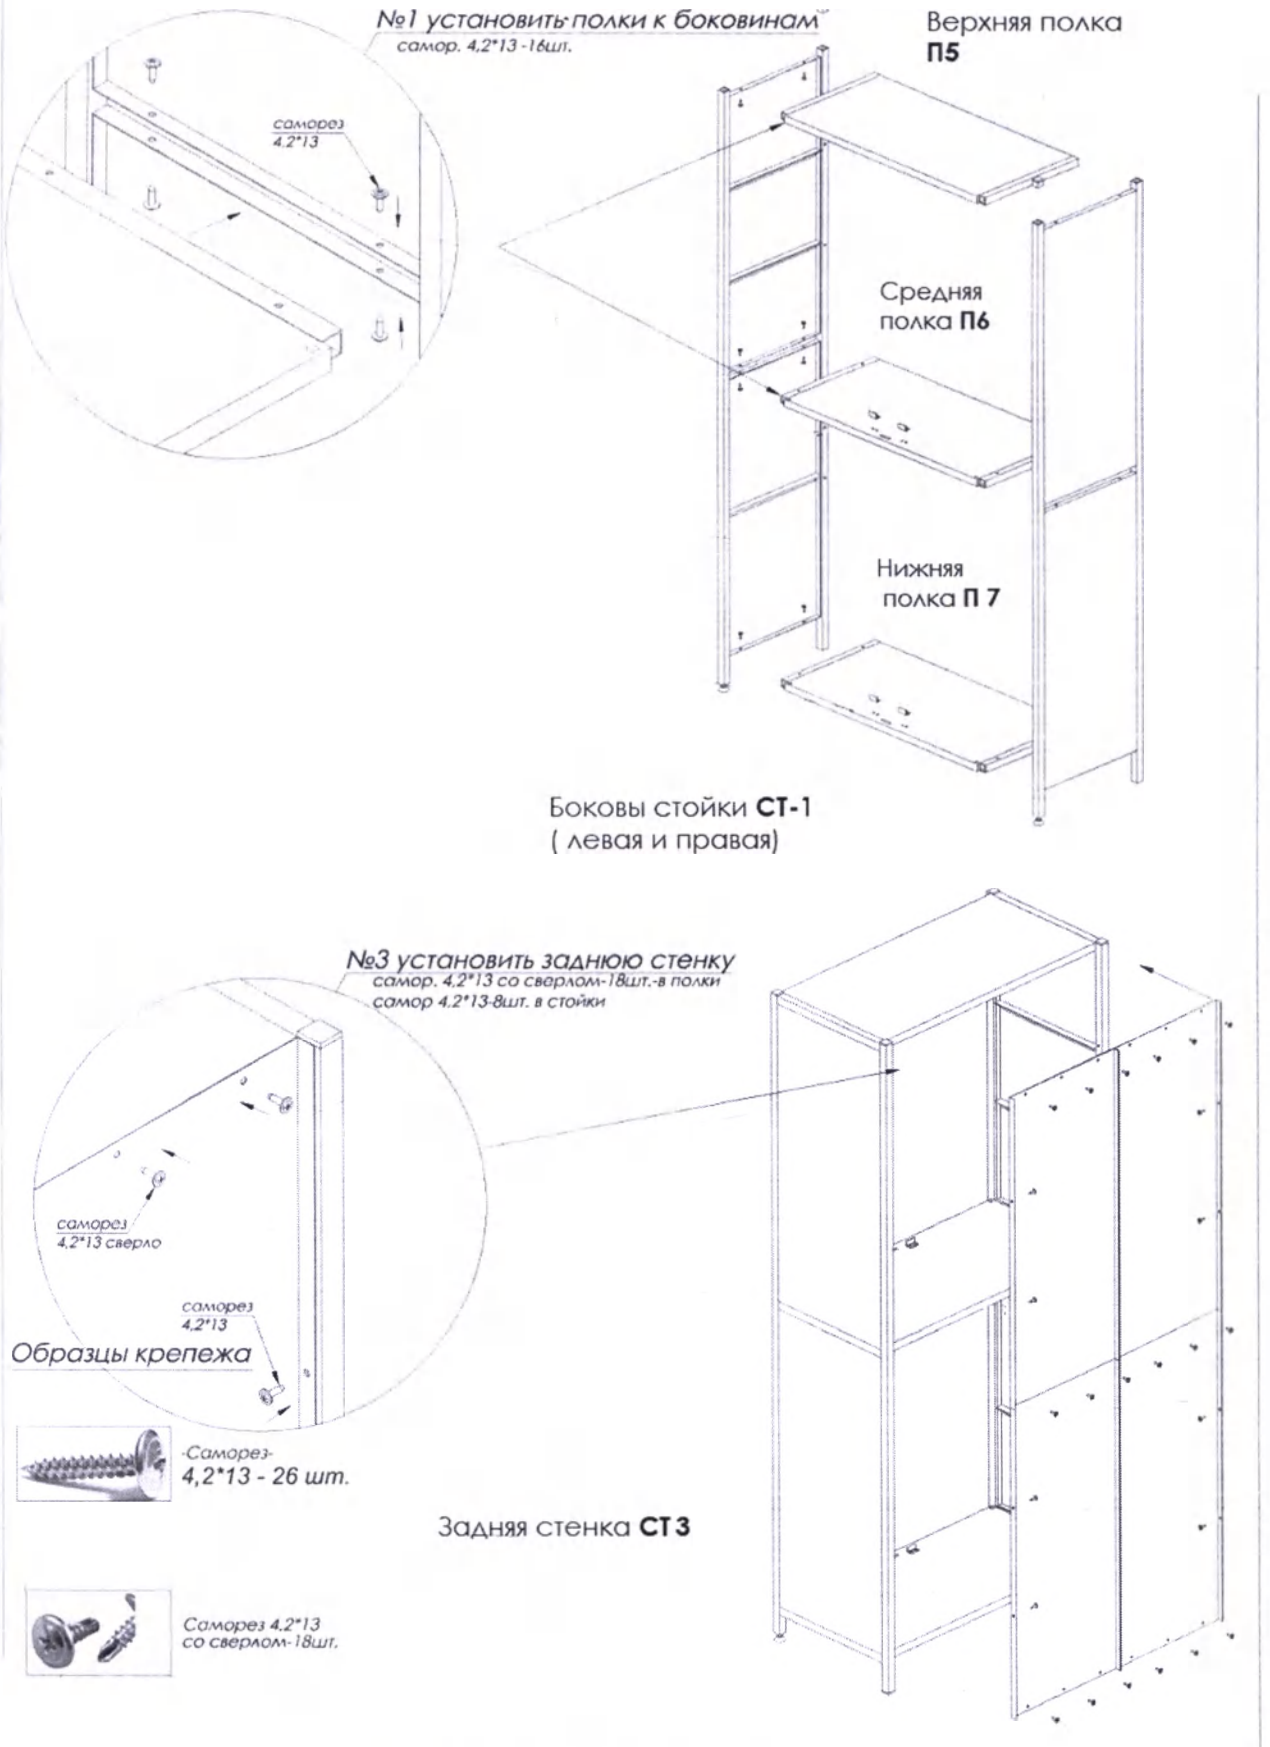

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

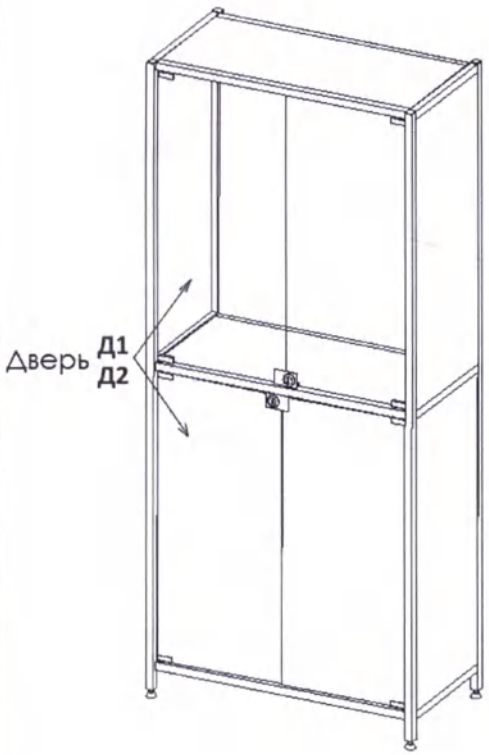

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

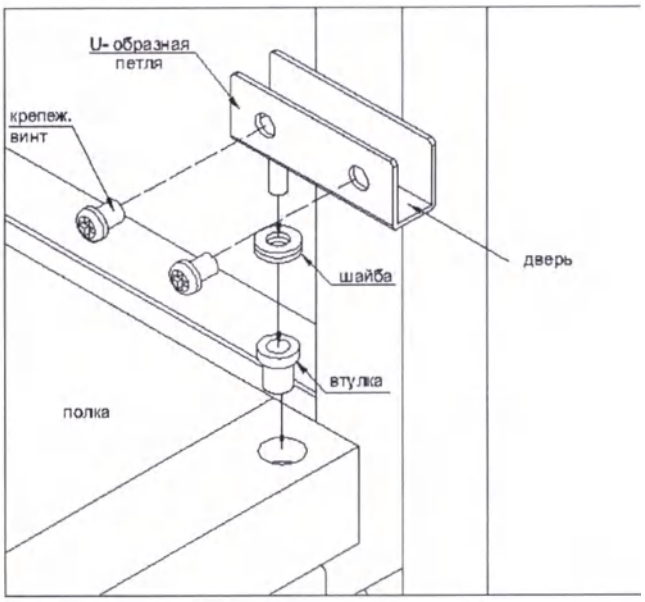

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

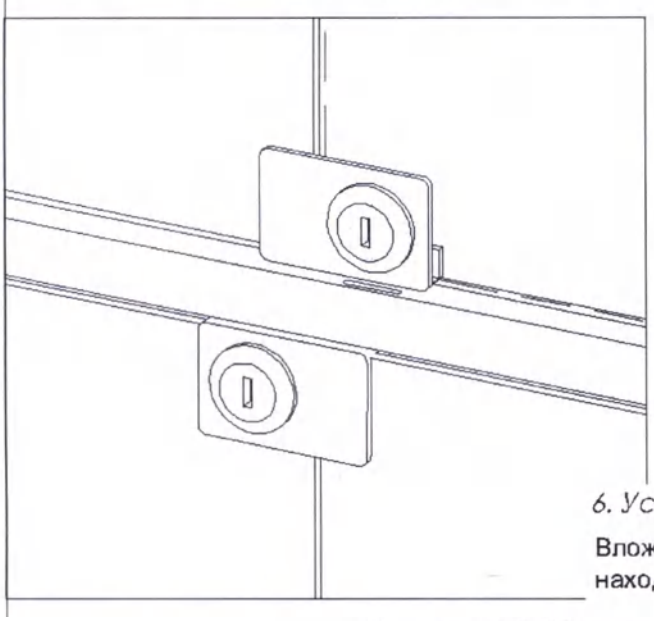

Замок для двух распашных дверей
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-114-ШКЭ в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медицинских учреждений Э-114-ШКЭ

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А./

«27» июня 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

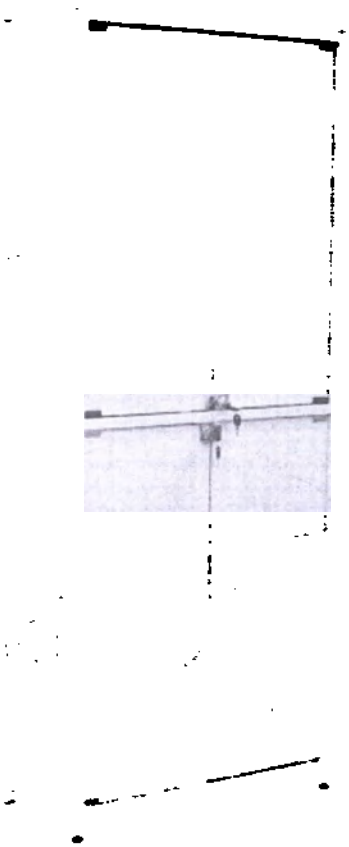

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-115-ШКЭ

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-115-ШКЭ** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	**650*300*1650**	**38±0,5**		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 5	Полка верхняя	1
П 6	Полка средняя	1
П 7	Полка нижняя	1
СТ 3	Задняя стенка	4
Д 2	Дверца (металл)	4
П 8	Полка вкладная	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	26
	Саморез со сверлом 4,2х13	18
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	4
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской. (каркас, двери).
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	38,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.

10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 5** четырьмя саморезами.

10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 6** восемью саморезами.

10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 7** четырьмя саморезами.

10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ3** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 5, П 6, П7** .

10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.

10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П8**.

10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкакфов
Э-113-ШКЭ, Э-114-ШКЭ, Э-115-ШКЭ

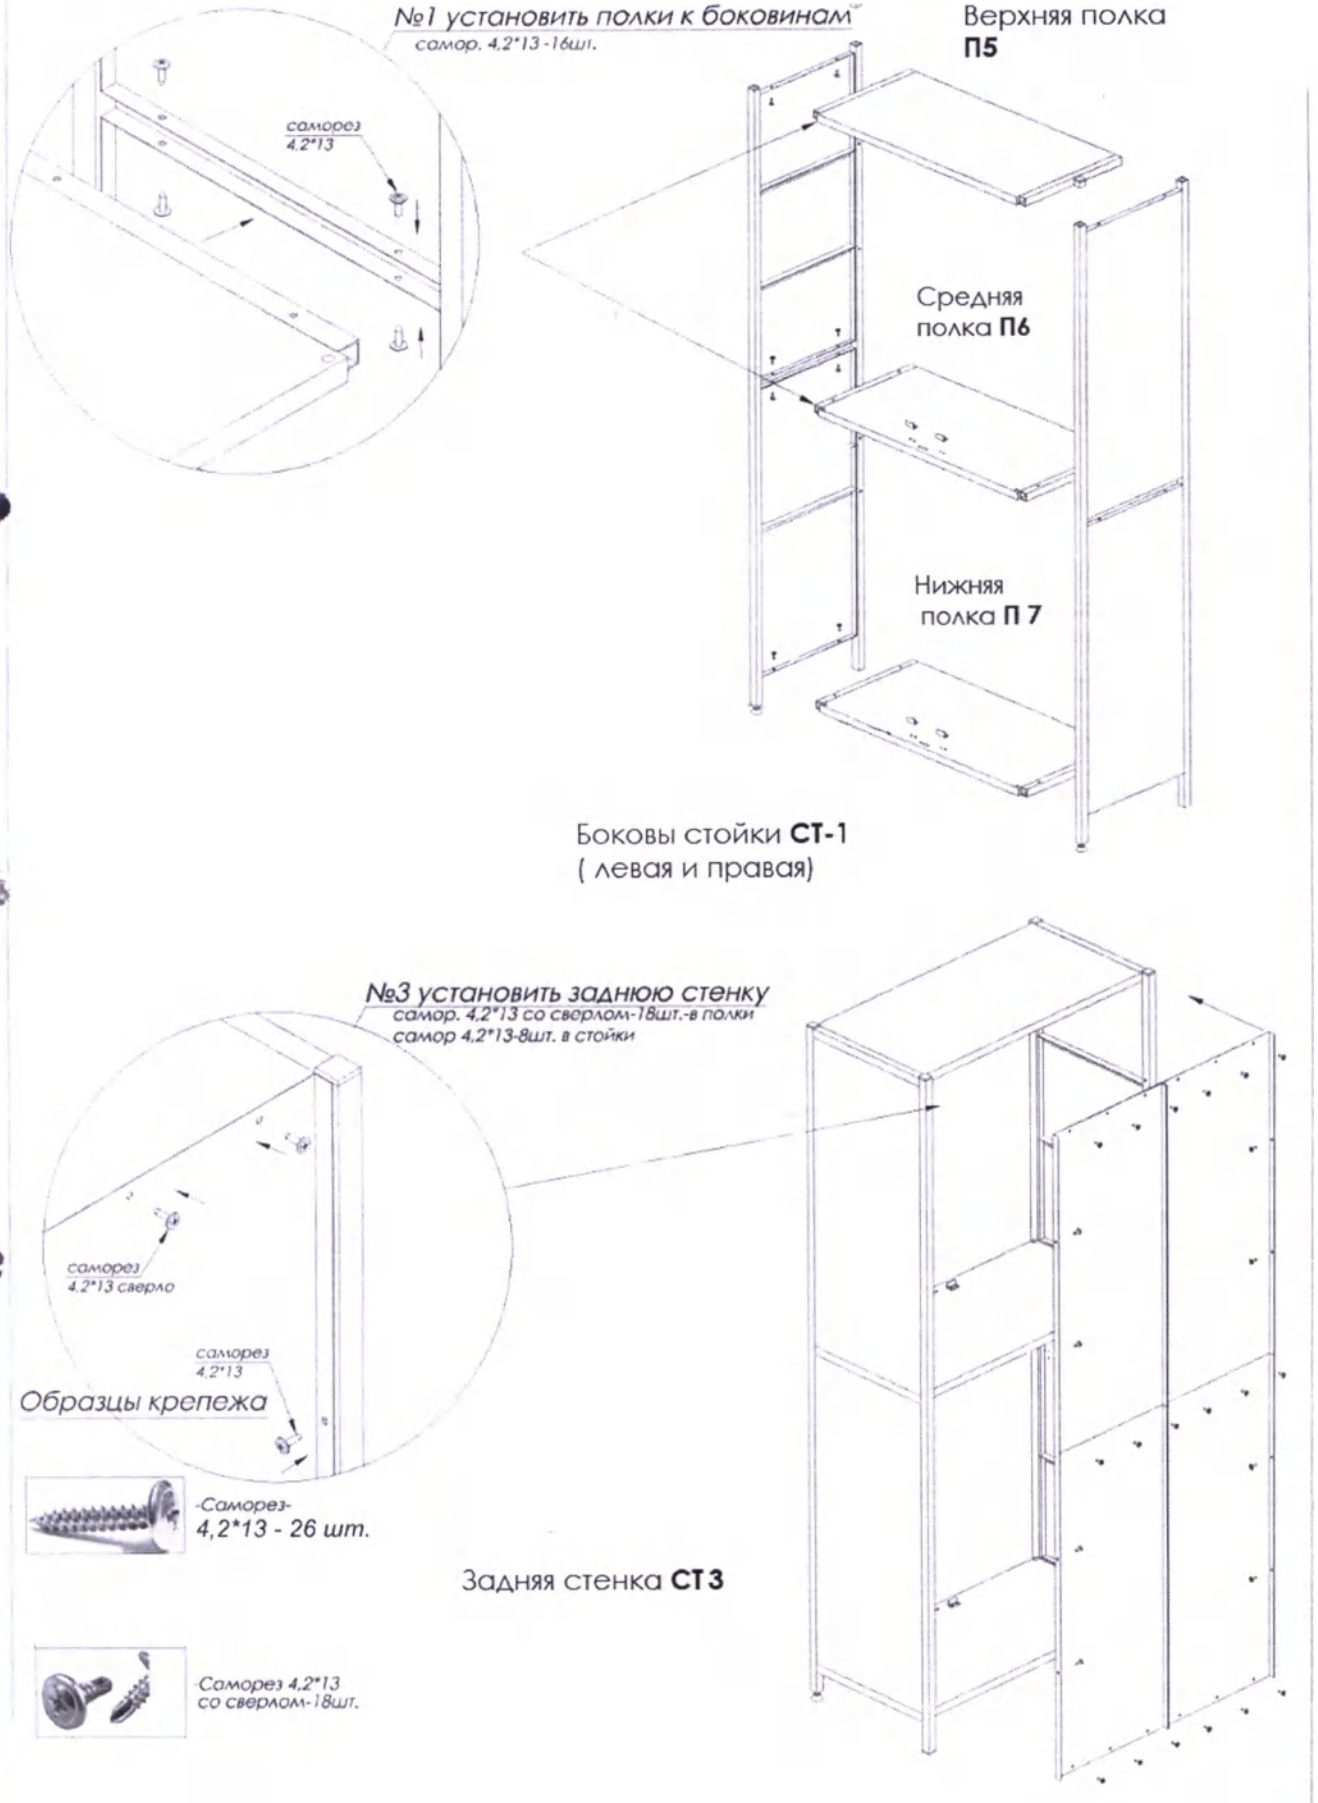

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

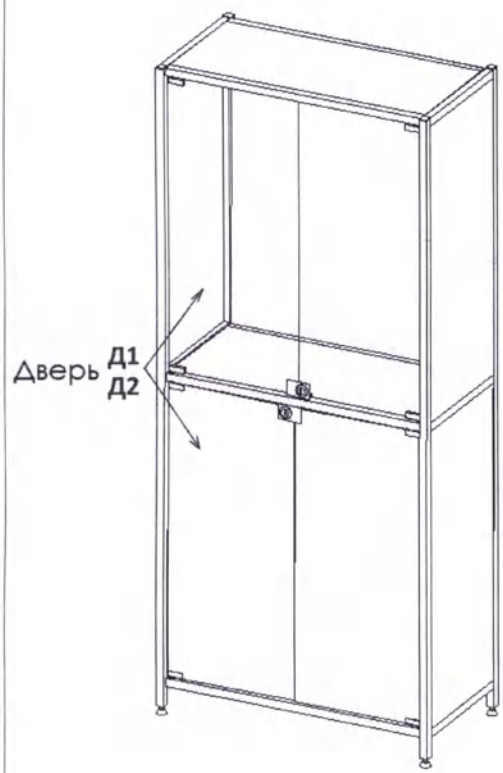

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

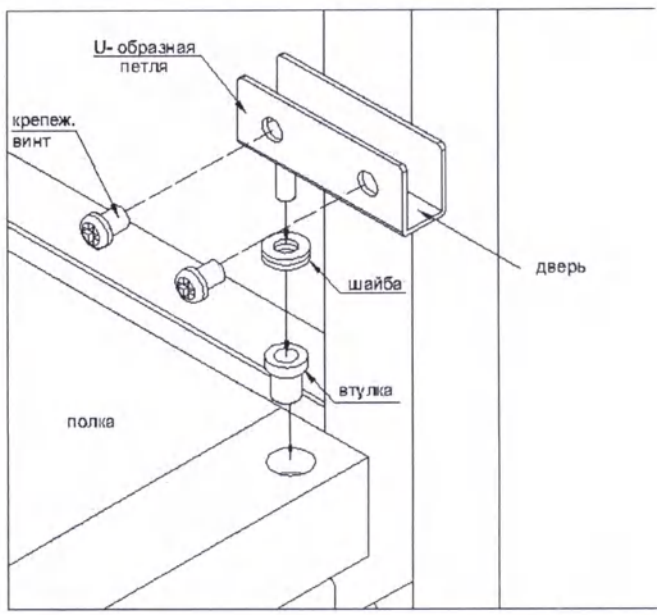

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

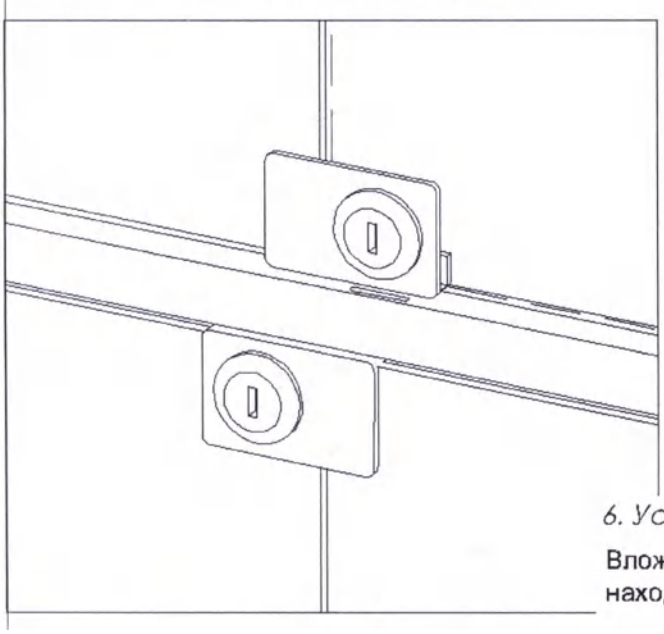

Замок для двух распашных дверей
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие ıразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ιходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ιаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ıециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-115-ШКЭ в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-115-ШКЭ

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А.

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

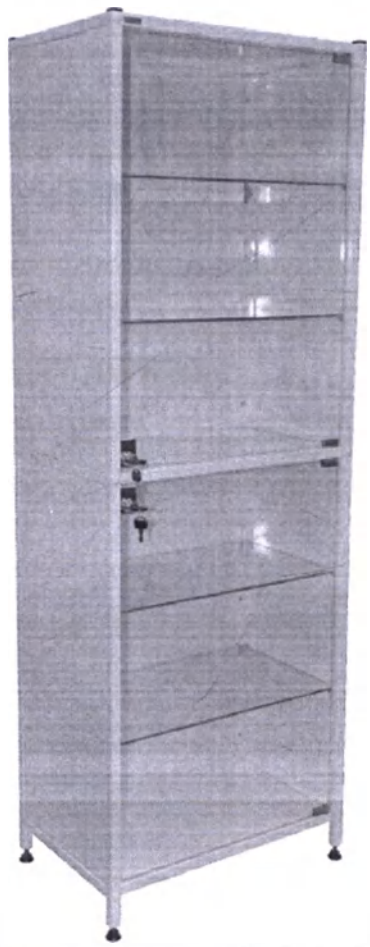

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-110-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-110-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	**570*360*1650**	**41±0,5**		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 1	Полка верхняя	1
П 2	Полка средняя	1
П 3	Полка нижняя	1
СТ 2	Задняя стенка	2
Д 1	Дверца (стекло)	2
П 4	Полка вкладная (стекло)	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	24
	Саморез со сверлом 4,2х13	9
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	2
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	41,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 1** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 2** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 3** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ 2** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 1, П 2, П3** .
10.6 В собранную конструкцию установить две двери **Д1** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П4**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-110-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-111-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-112-ШК, Э-112/Н-ШК

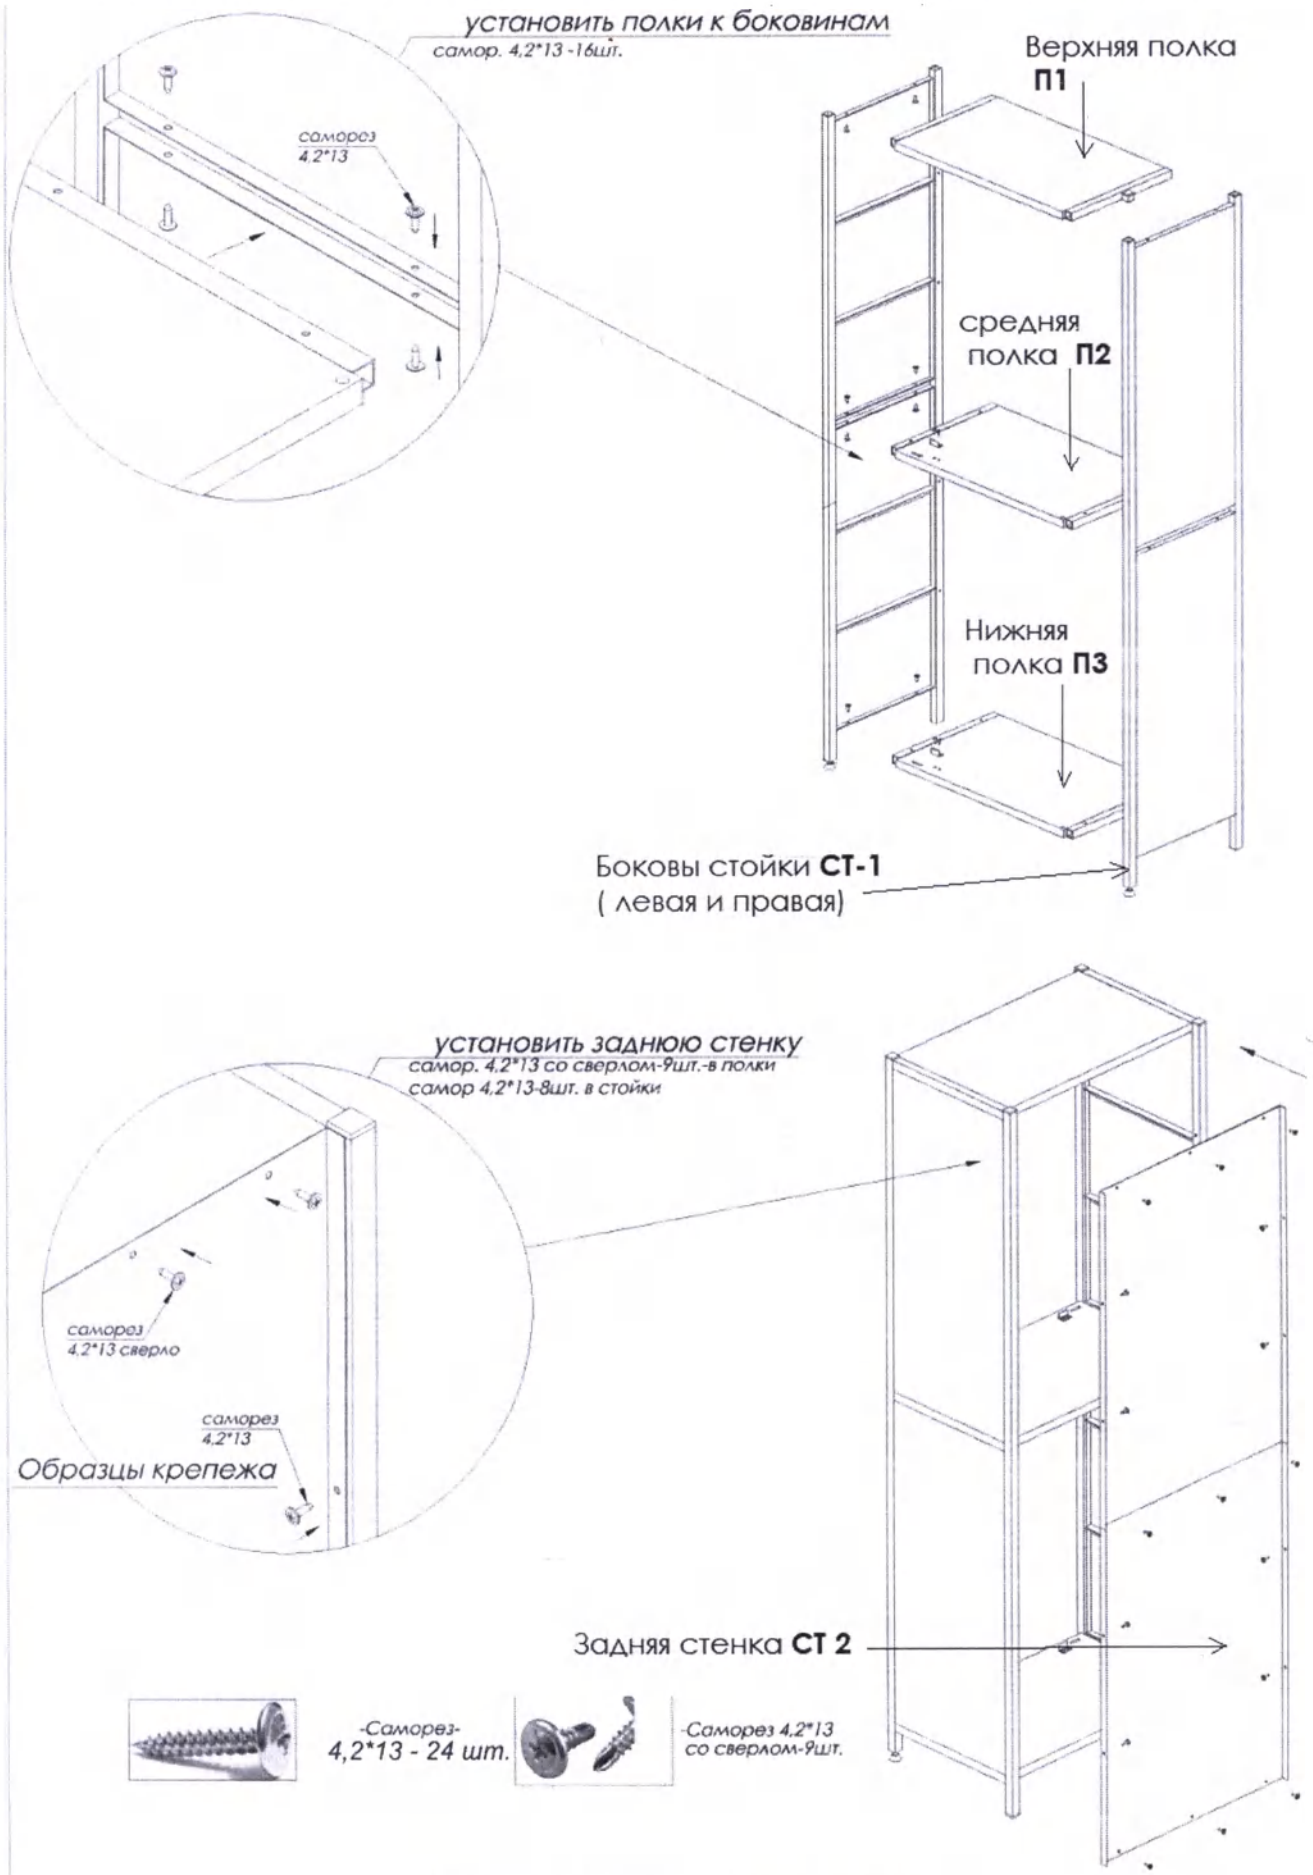

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

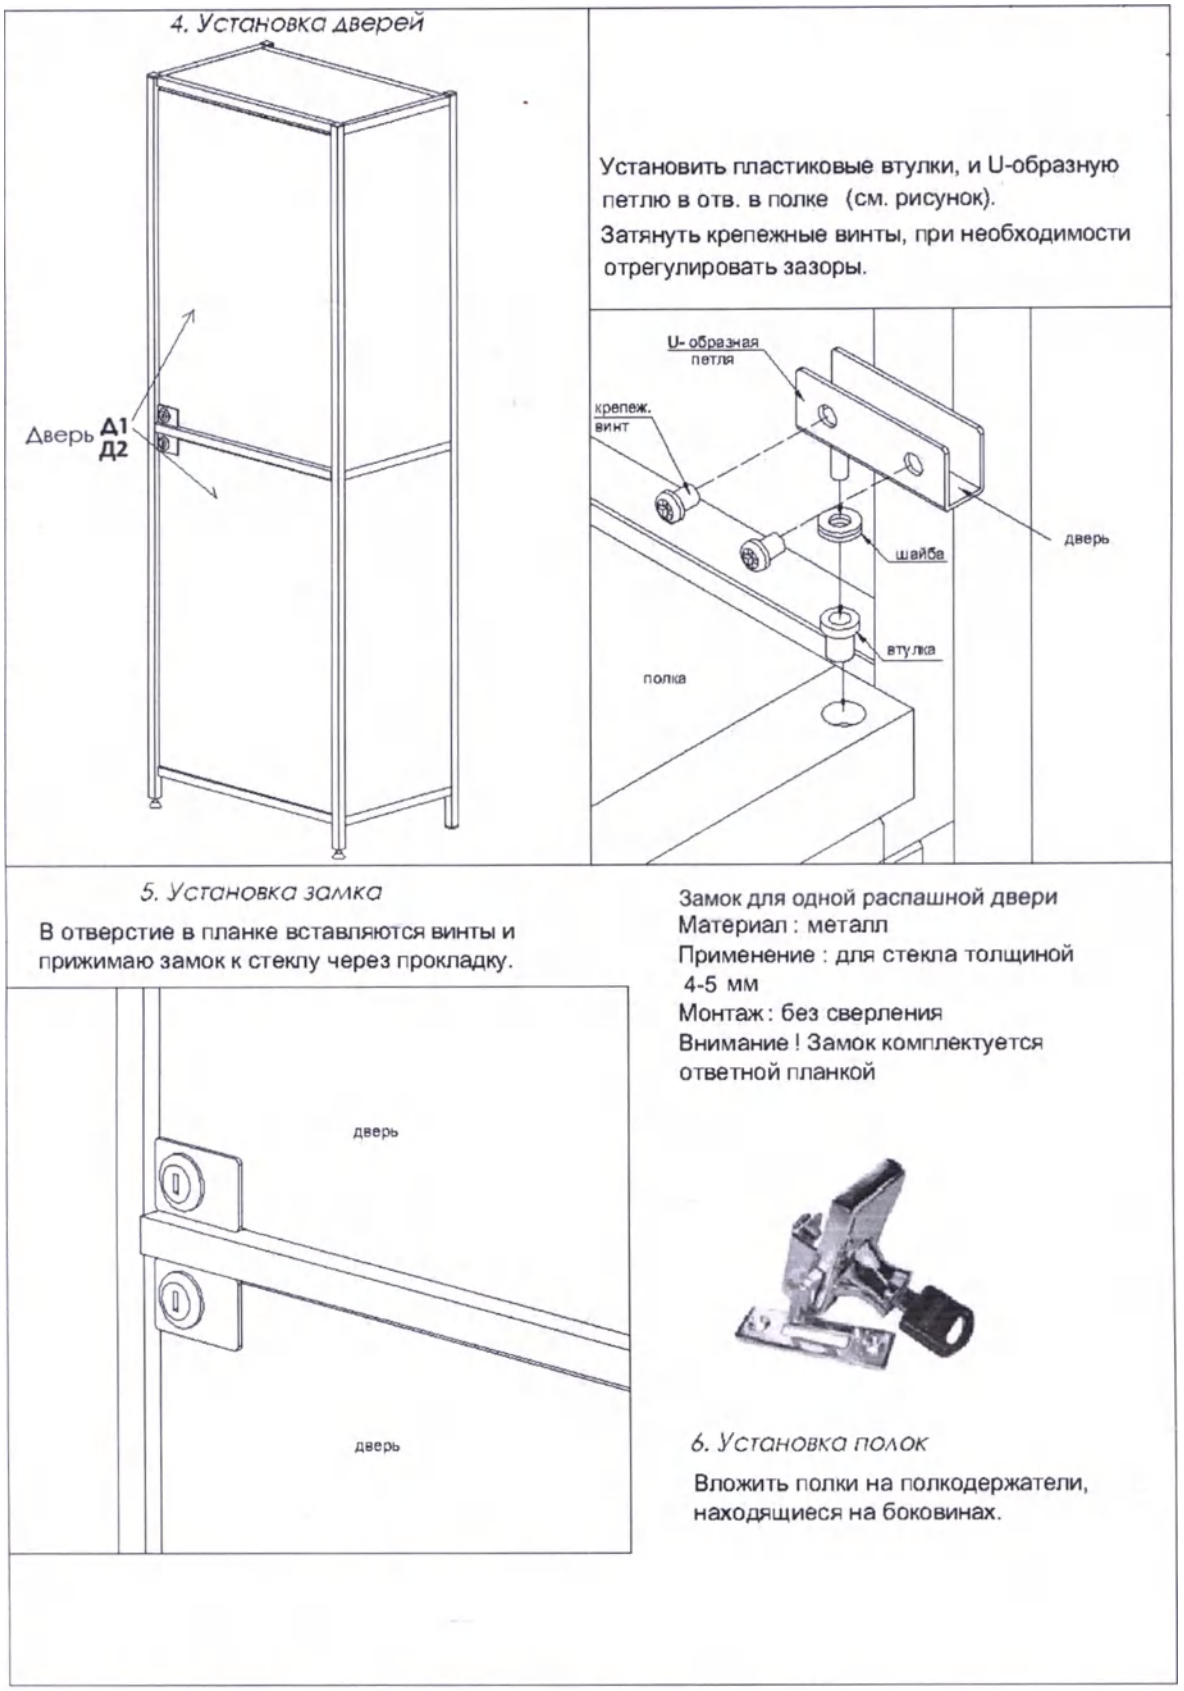

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси юдорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие Бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-110-ШК в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ _________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-110-ШК
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«23» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

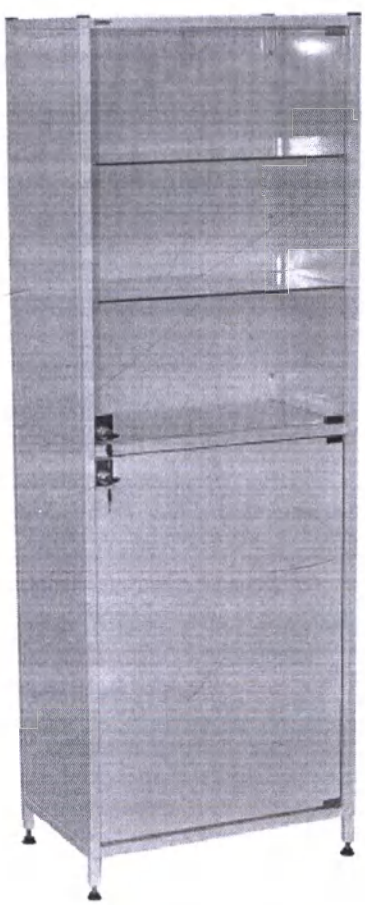

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-111-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-111-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	**570*360*1650**	**40±0,5**		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 1	Полка верхняя	1
П 2	Полка средняя	1
П 3	Полка нижняя	1
СТ 2	Задняя стенка	2
Д 1	Дверца (стекло)	1
Д 2	Дверца (металл)	1
П 4	Полка вкладная (стекло)	2
П 4	Полка вкладная (металл)	2
Крепежные изделия		
	Саморез 4,2х13	24
	Саморез со сверлом 4,2х13	9
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	2
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки, двери)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	40,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой обходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных оверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 1** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 2** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 3** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ 2** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 1, П 2, П**3 .
10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1** и **Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П4**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-110-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-111-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-112-ШК, Э-112/Н-ШК

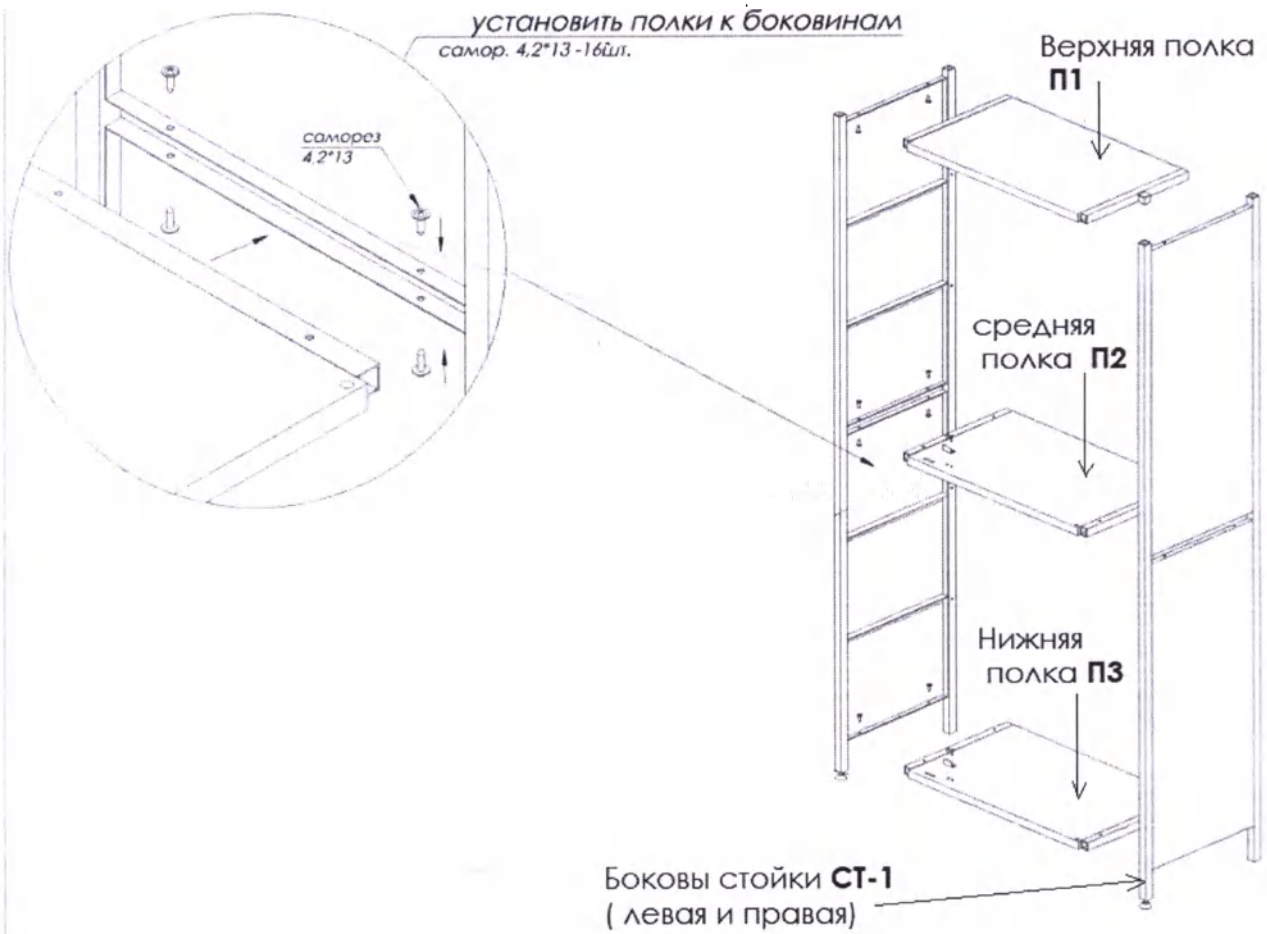

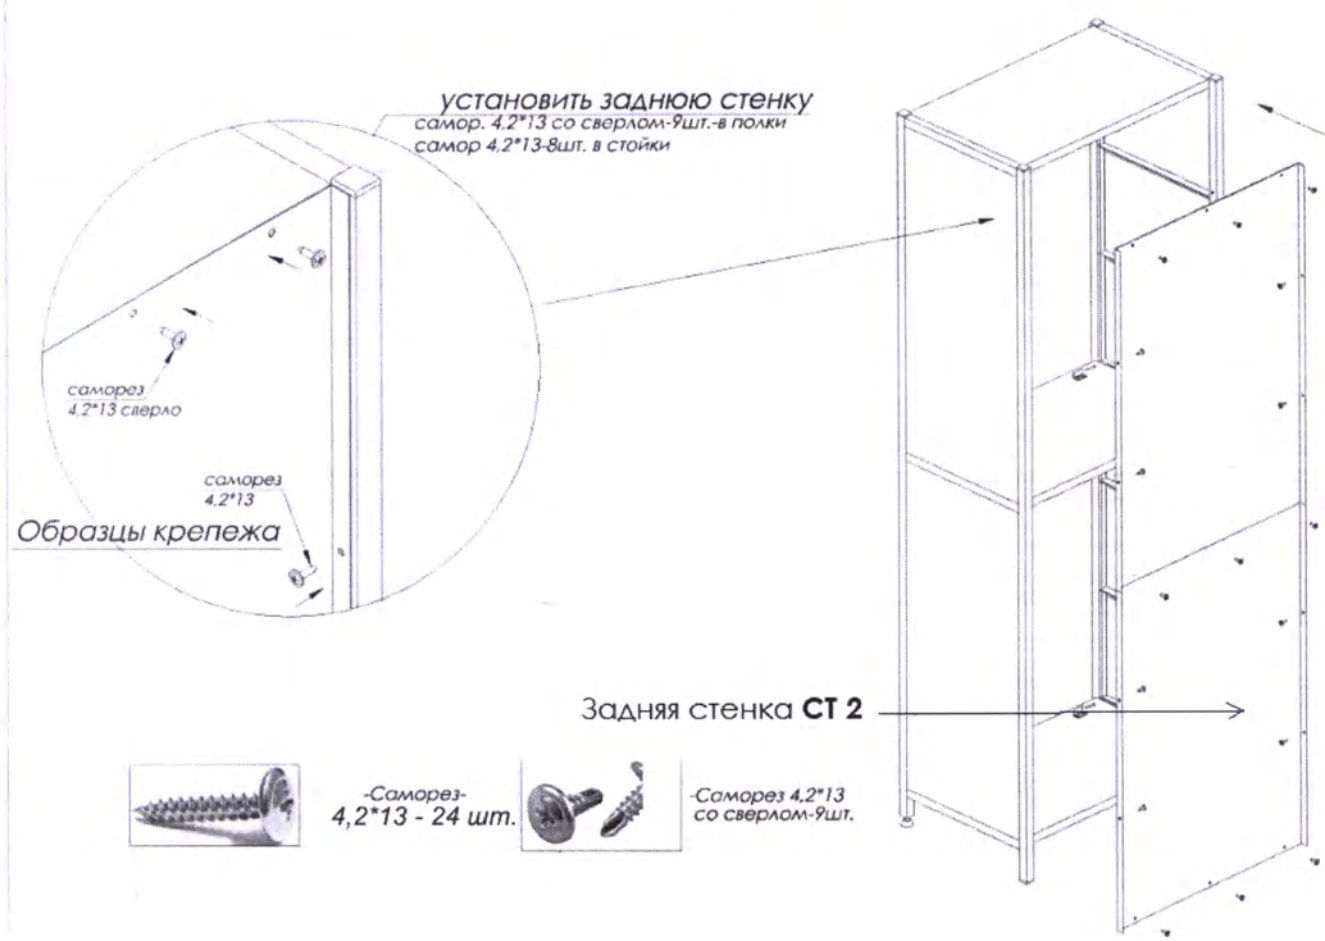

-Саморез- 4,2*13 - 24 шт.

-Саморез 4,2*13 со сверлом-9шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

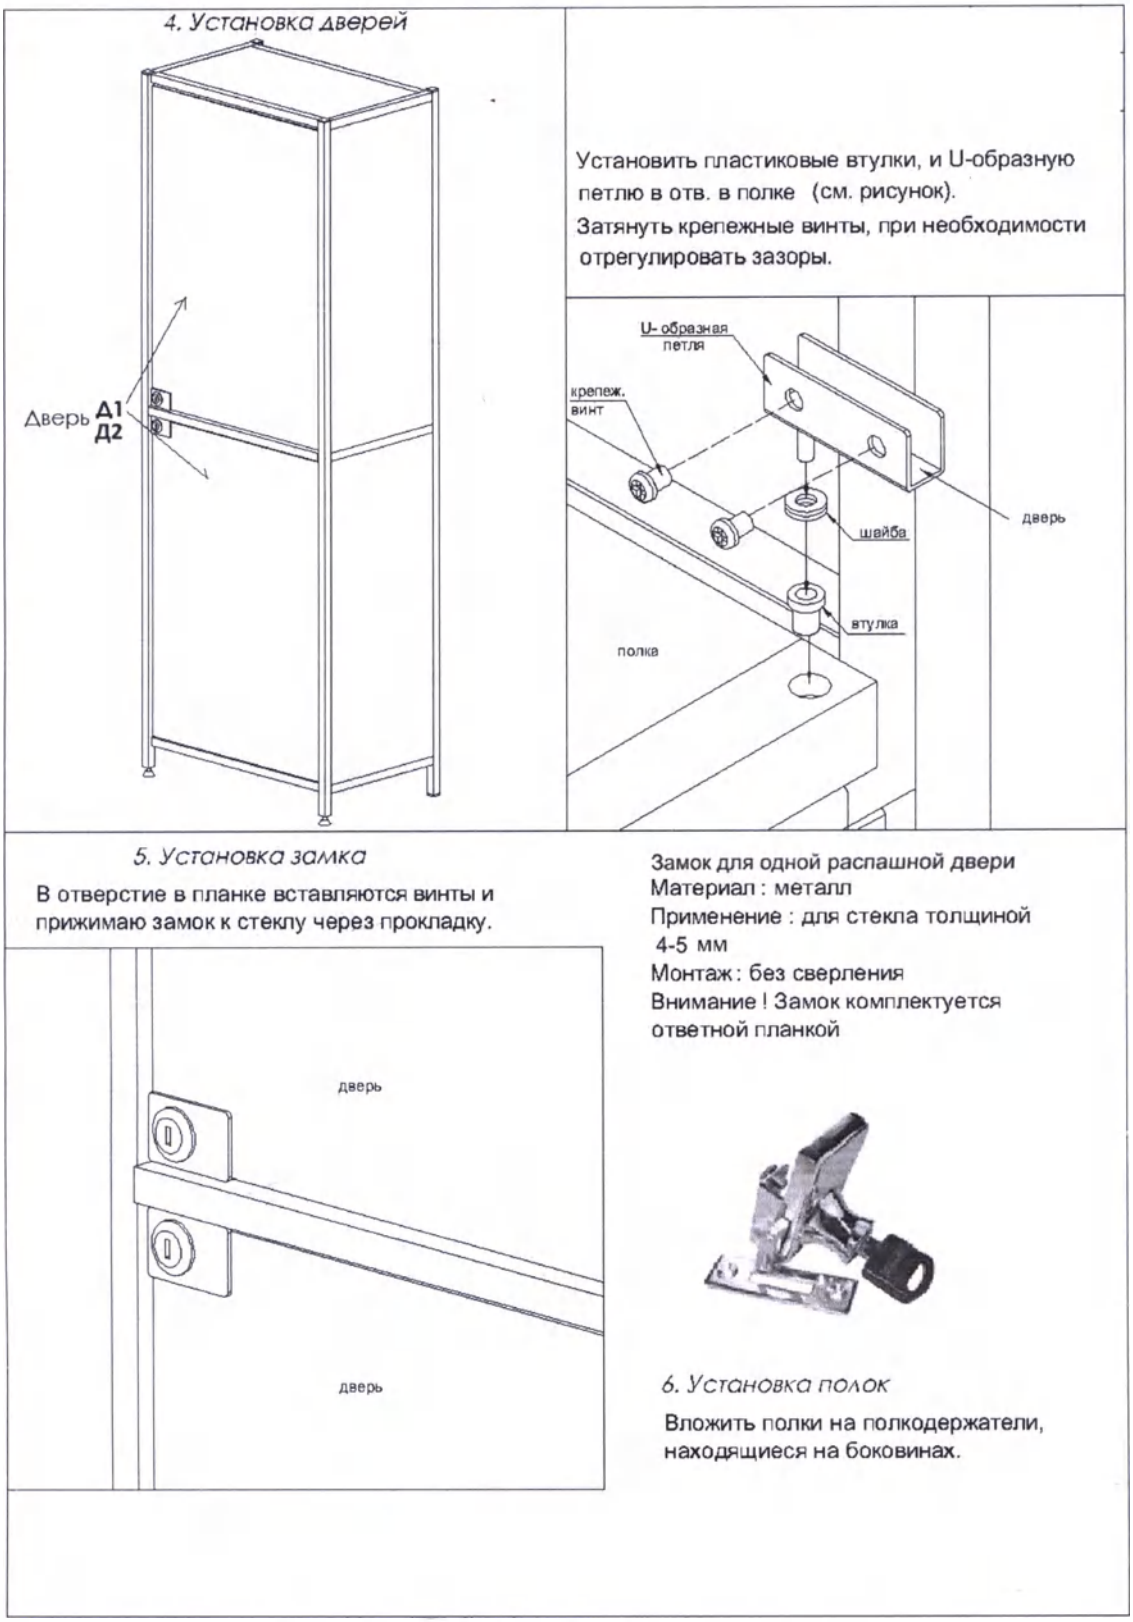

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие абразивные материалы и органические растворители.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ТУ, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо изделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели владелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической помощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических специалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец берет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-111-ШК в количестве __________шт. принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП _______________________ ____________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-111-ШК
Дата выпуска _____________, партия _____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата_______________
Начальник производства ________________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрёкин Э. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

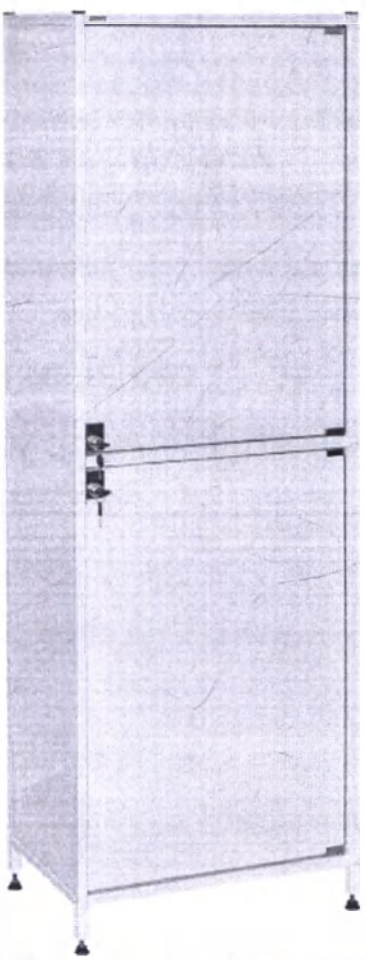

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-112-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-112-ШК** далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	**570*360*1650**	**37±0,5**		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ1	**Боковая стойка (левая и правая)**	2
П 1	Полка верхняя	1
П 2	Полка средняя	1
П 3	Полка нижняя	1
СТ 2	Задняя стенка	2
Д 2	Дверца (металл)	2
П 4	Полка вкладная (металл)	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	24
	Саморез со сверлом 4,2х13	9
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	2
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас двери); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}С	5 - 30
Масса нетто, кг	37,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 1** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 2** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 3** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ 2** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 1, П 2, П**3 .
10.6 В собранную конструкцию установить две двери **Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П4**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-110-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-111-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-112-ШК, Э-112/Н-ШК

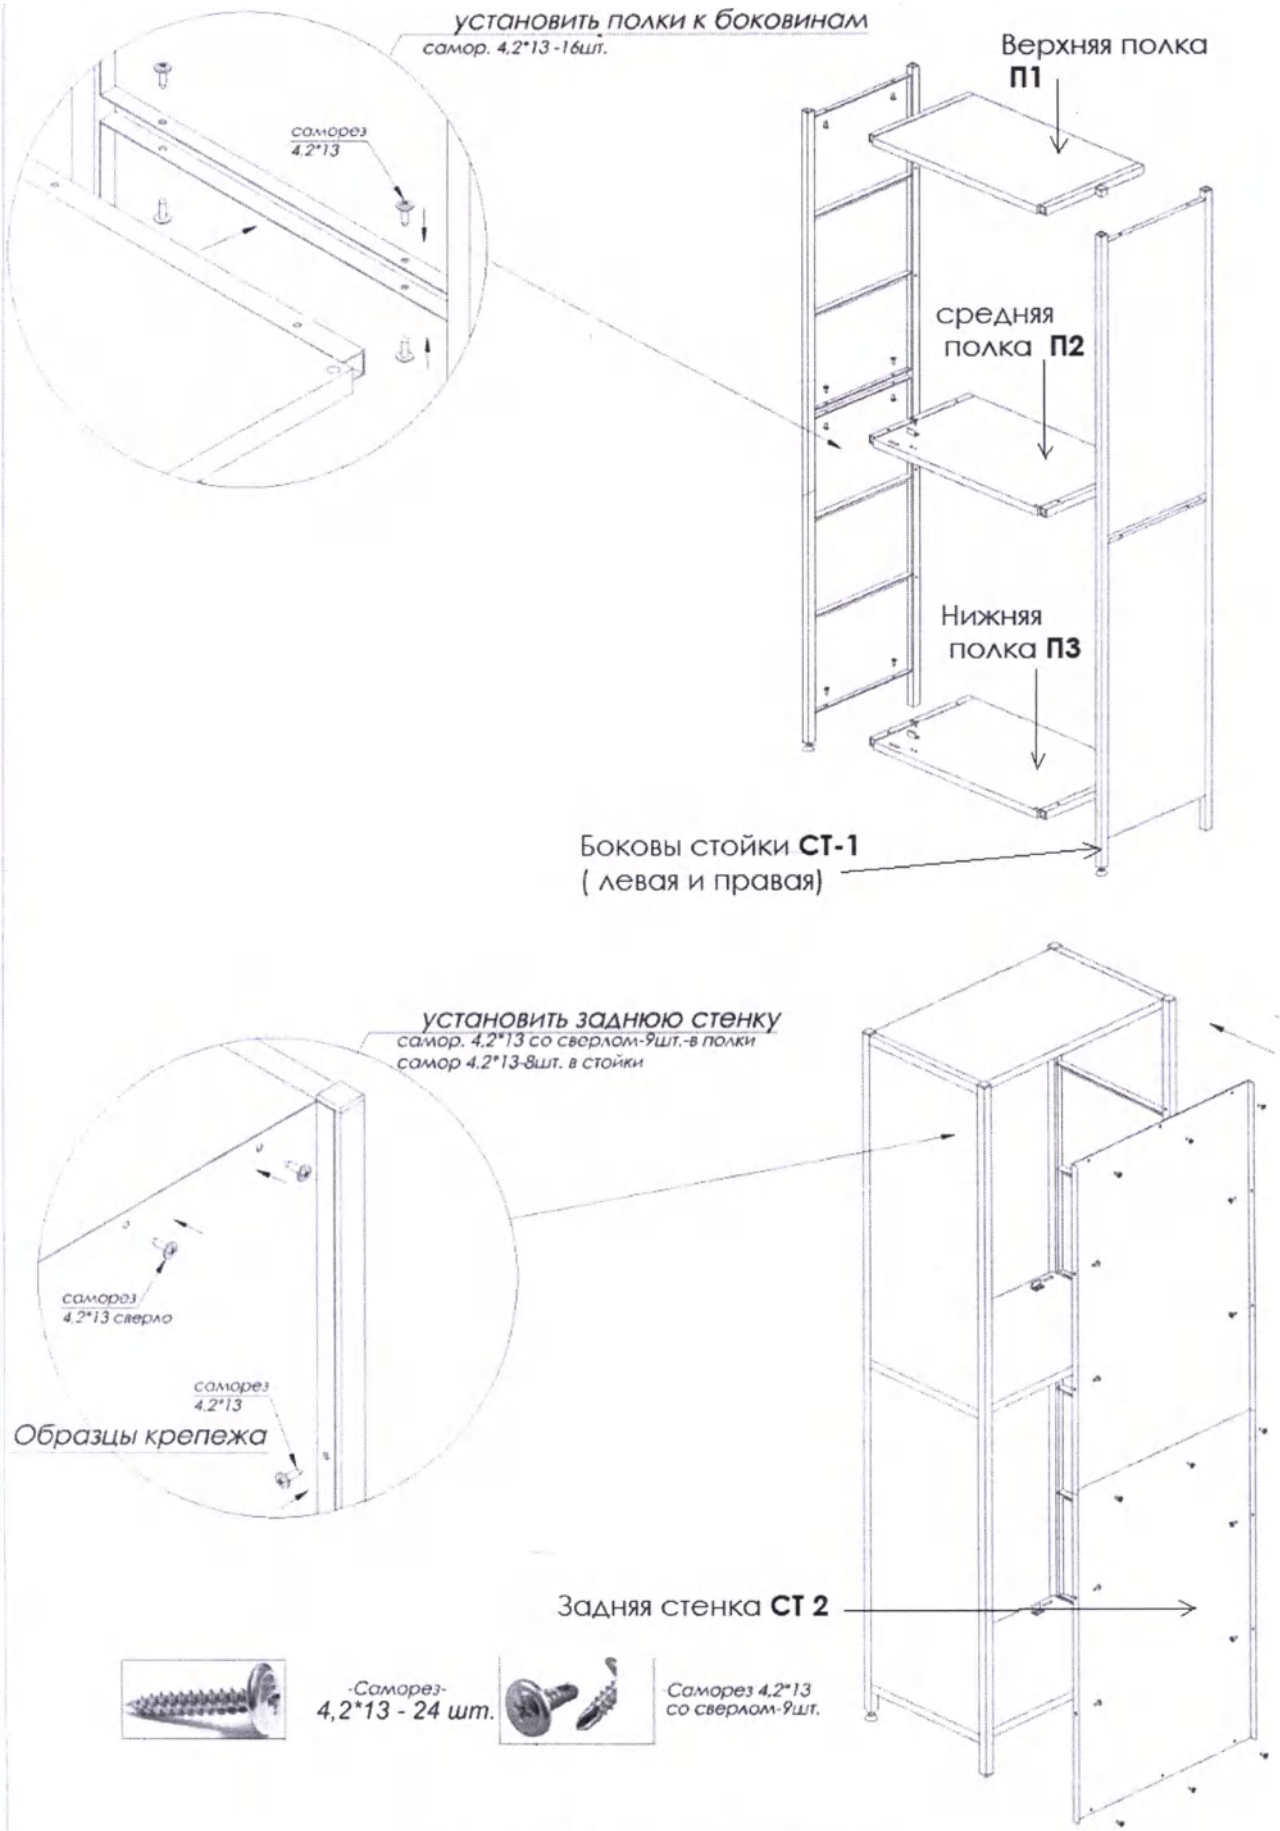

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

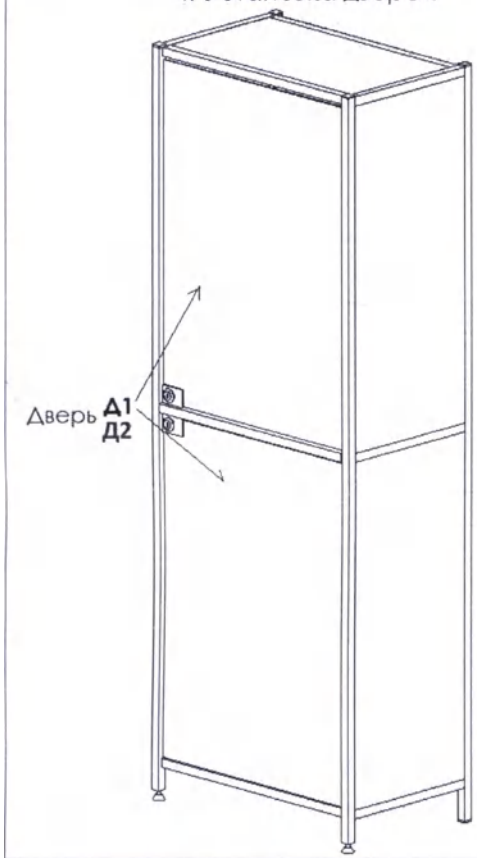

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

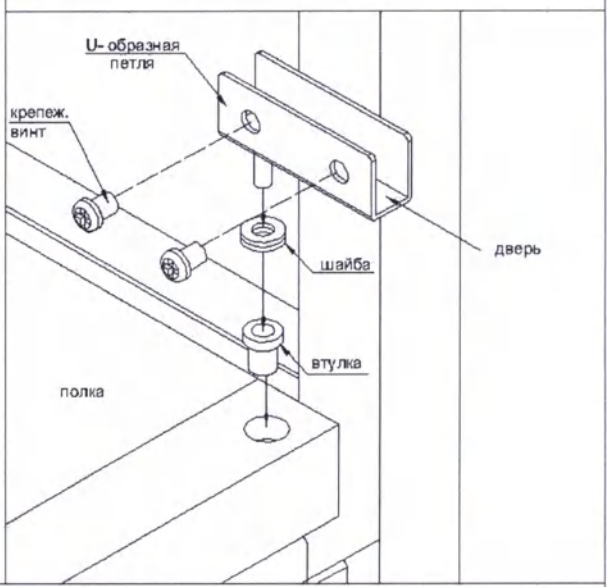

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

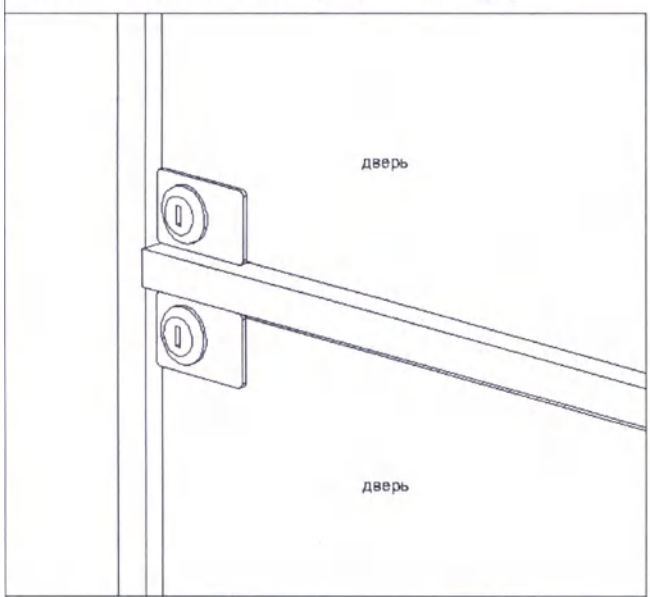

Замок для одной распашной двери
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси ...ода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при ...инфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих /, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-112-ШК в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_______________ Номер партии ______________

Начальник ОТК

МП ______________________ ____________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медицинских учреждений Э-112-ШК
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

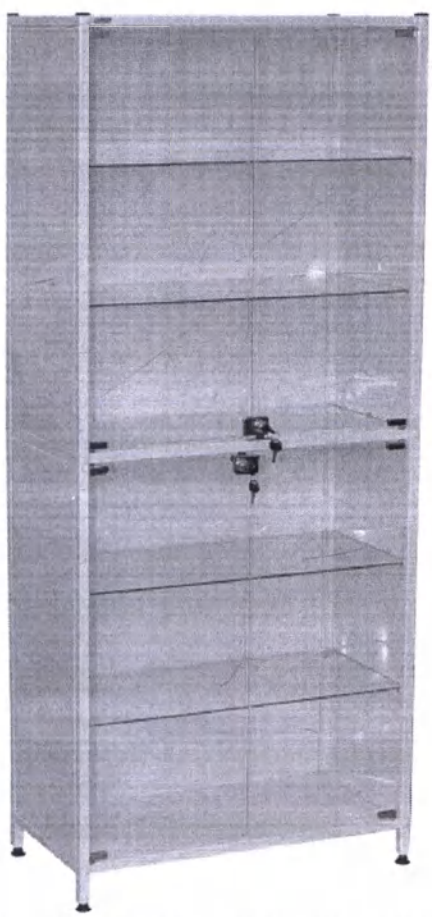

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-113-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-113-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	**700*360*1650**	**52,7±0,5**		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 5	Полка верхняя	1
П 6	Полка средняя	1
П 7	Полка нижняя	1
СТ 3	Задняя стенка	4
Д 1	Дверца (стекло)	4
П 8	Полка вкладная (стекло)	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	26
	Саморез со сверлом 4,2х13	18
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	4
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской. Листовая сталь по ГОСТ 9940 (каркас); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки, двери)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	52,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 5** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 6** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 7** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ3** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 5, П 6, П7** .
10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П8**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкакфов

Э-113-ШК, Э-113/Н-ШК, Э-114-ШК, Э-114/Н-ШК, Э-115-ШК, Э-115/Н-ШК

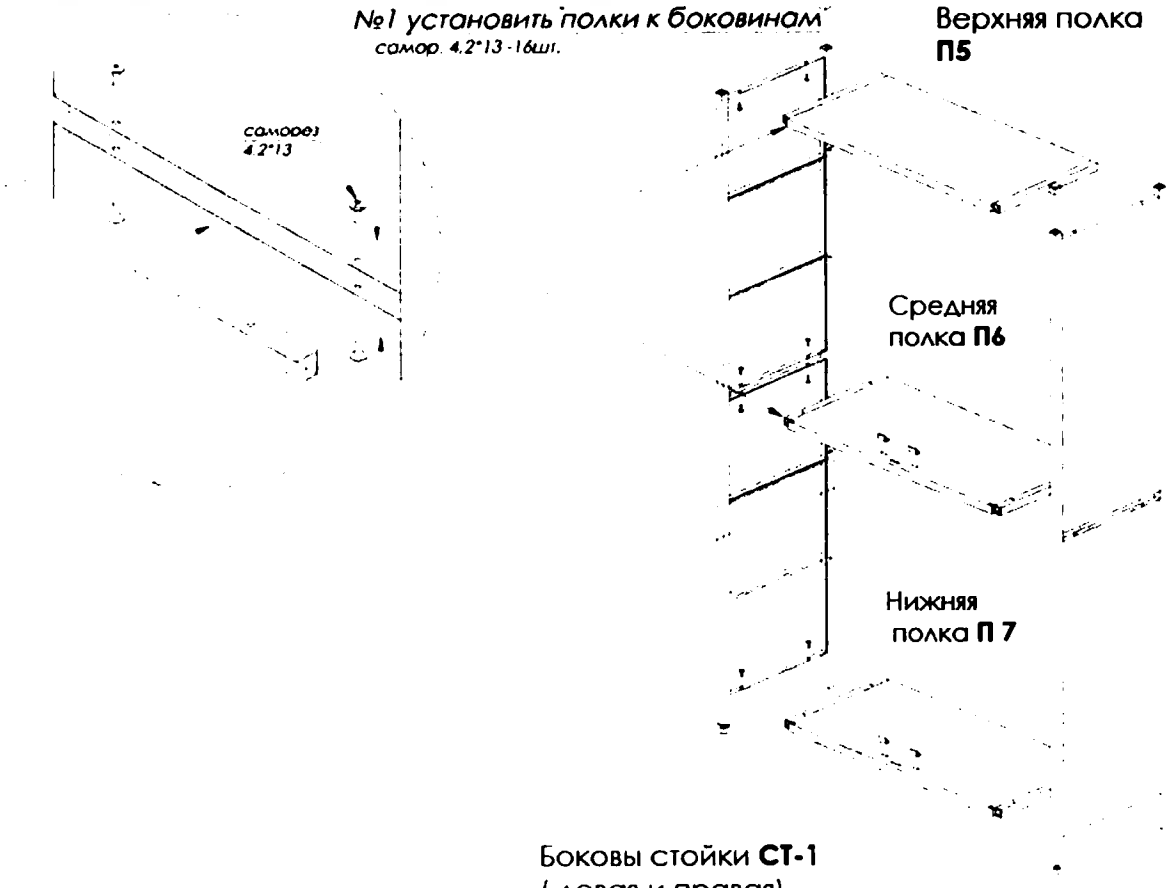

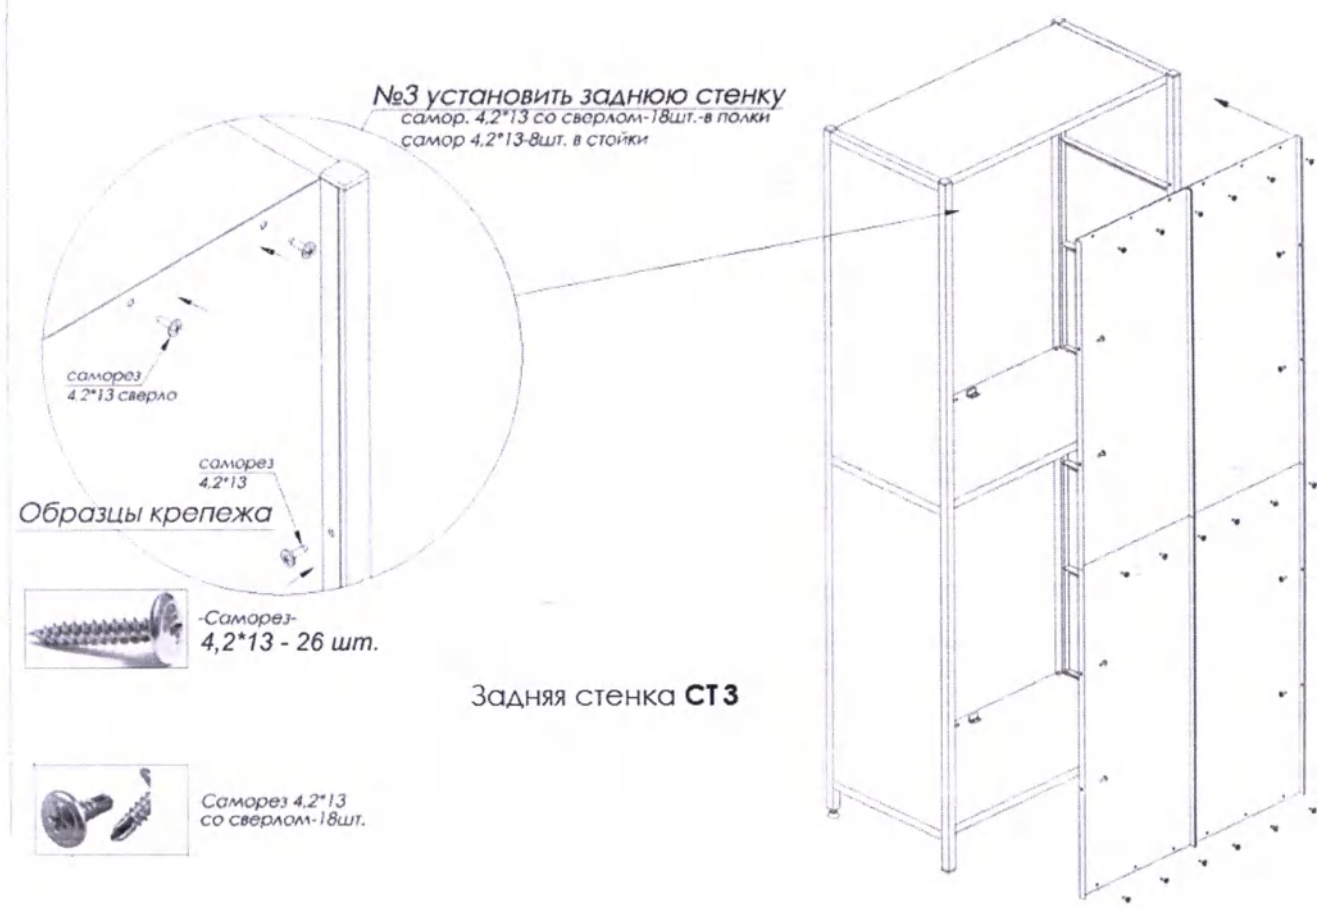

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

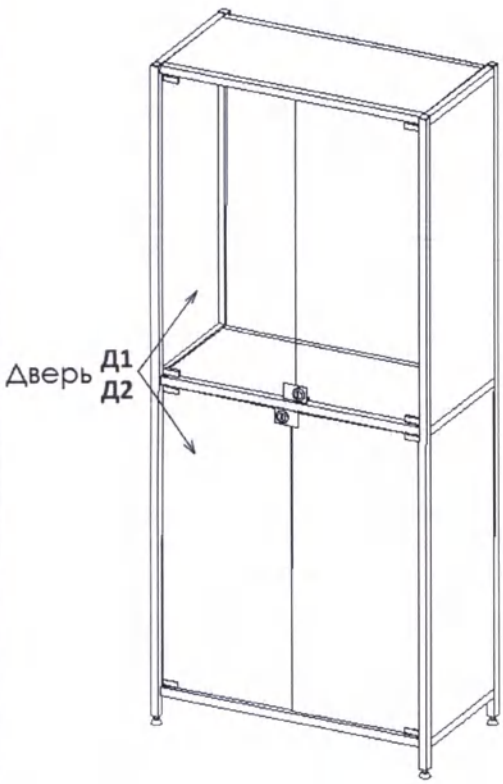

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

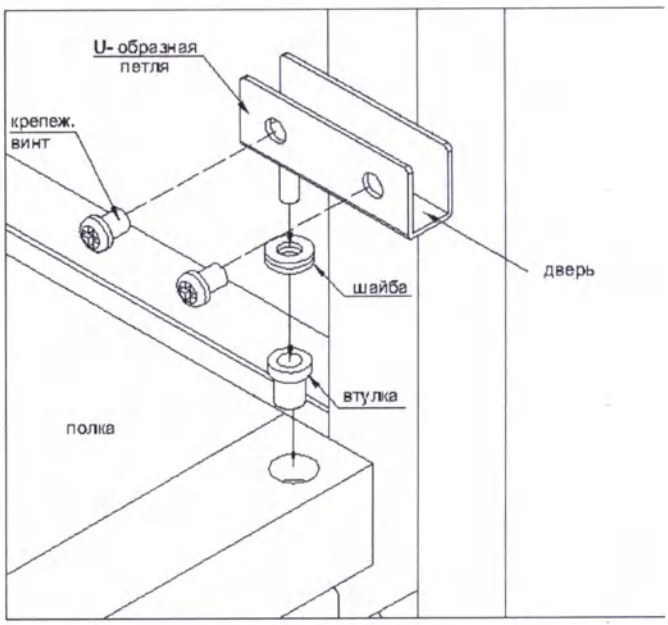

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

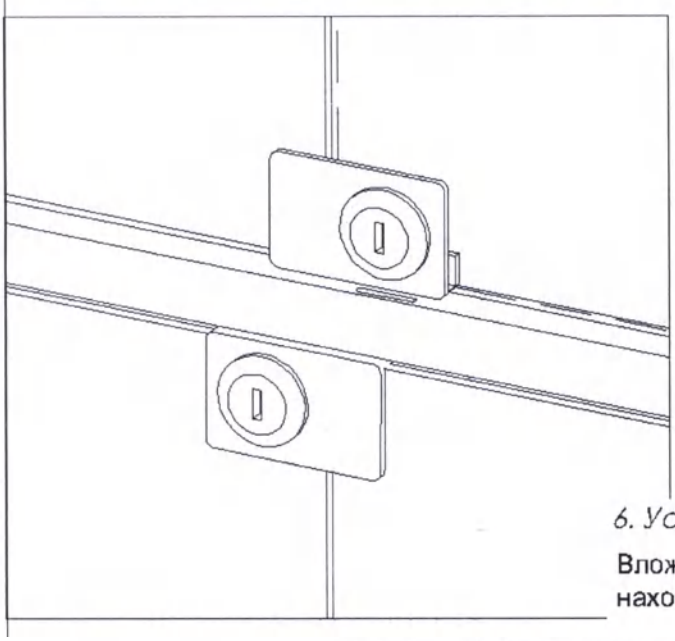

Замок для двух распашных дверей
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-113-ШК в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________ Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-113-ШК

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э.А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

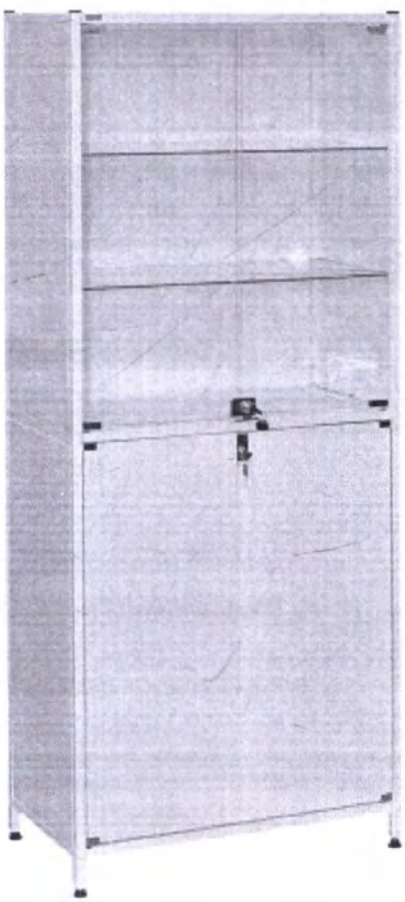

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-114-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-114-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	**700*360*1650**	**46,6±0,5**		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 5	Полка верхняя	1
П 6	Полка средняя	1
П 7	Полка нижняя	1
СТ 3	Задняя стенка	4
Д 1	Дверца (стекло)	2
Д 2	Дверца (металл)	2
П 8	Полка вкладная (металл)	2
П 8	Полка вкладная (стекло)	2
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	26
	Саморез со сверлом 4,2х13	18
	U-образная петля (комплект на одну дверь	4
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской (каркас, двери); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки, двери)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	46,6±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 5** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 6** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 7** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ3** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 5, П 6, П7** .
10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1** и **Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П8**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-113-ШК, Э-113/Н-ШК, Э-114-ШК, Э-114/Н-ШК, Э-115-ШК, Э-115/Н-ШК

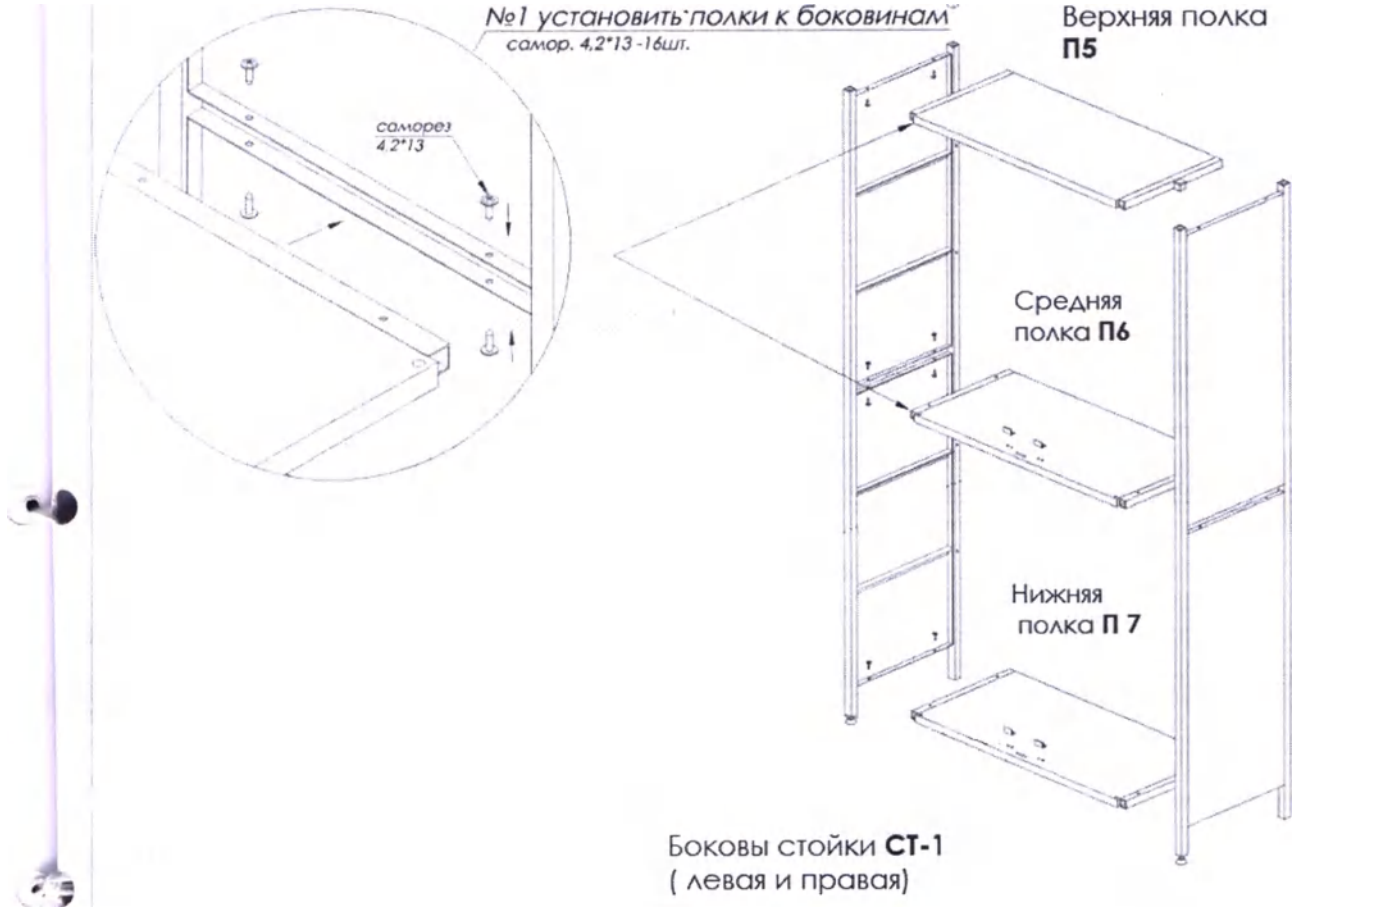

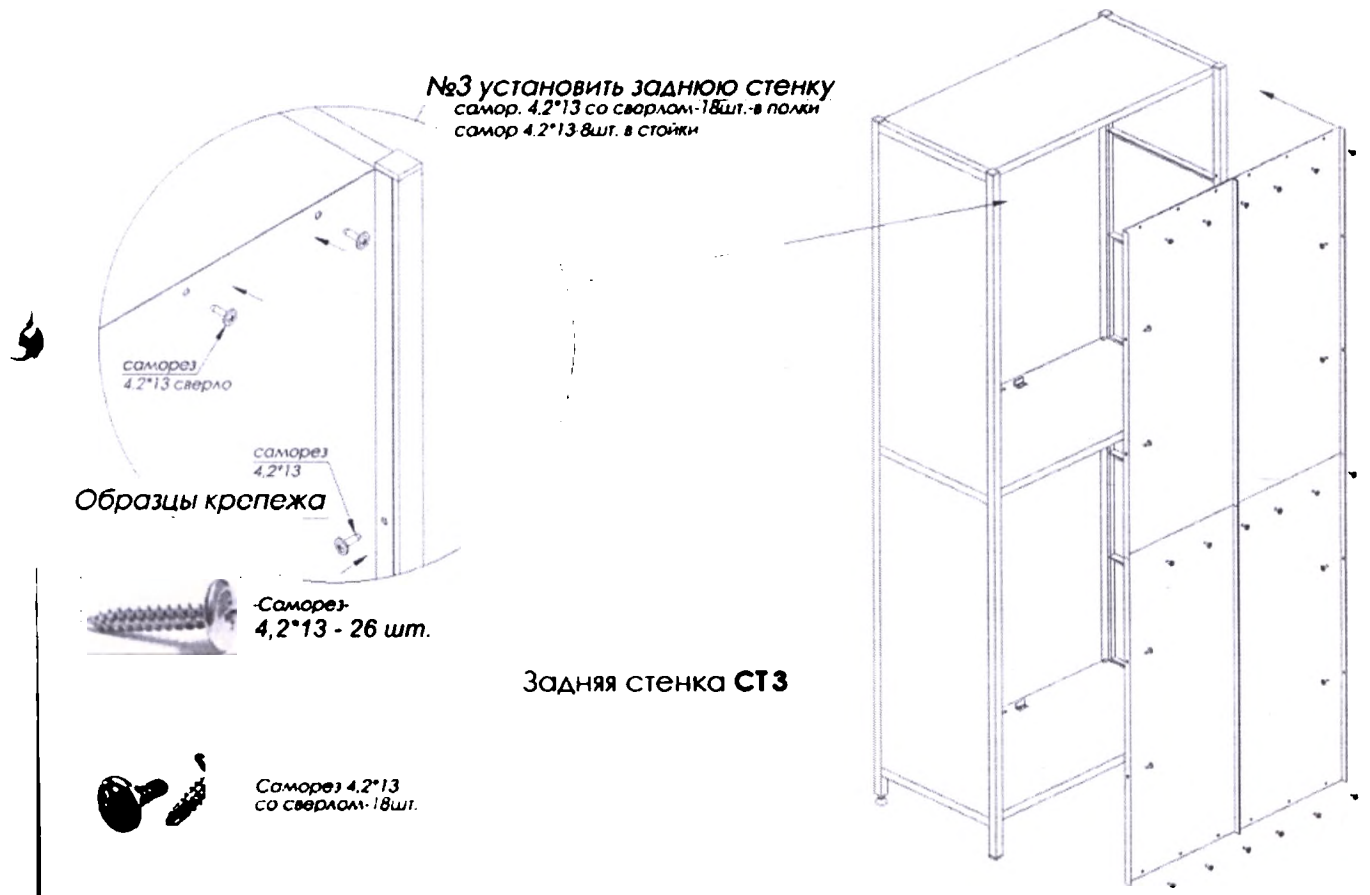

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

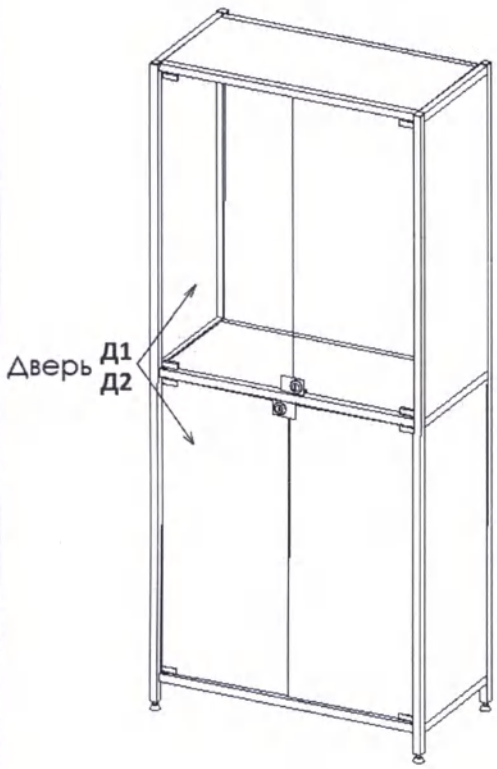

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

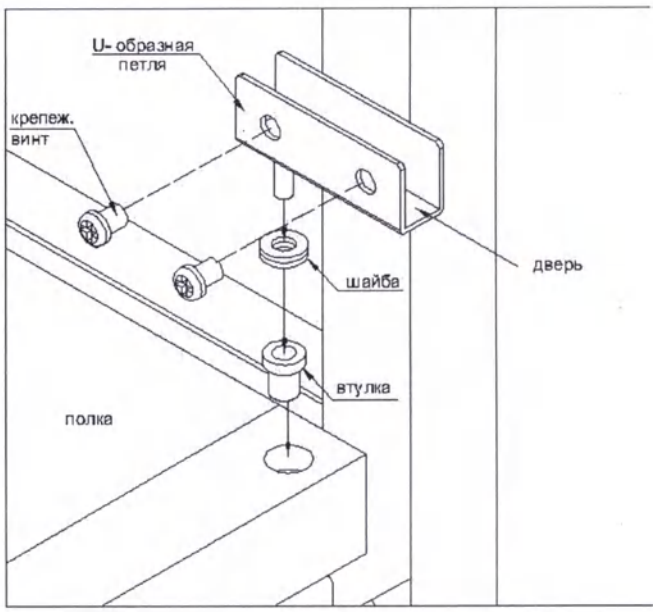

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

Замок для двух распашных дверей
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

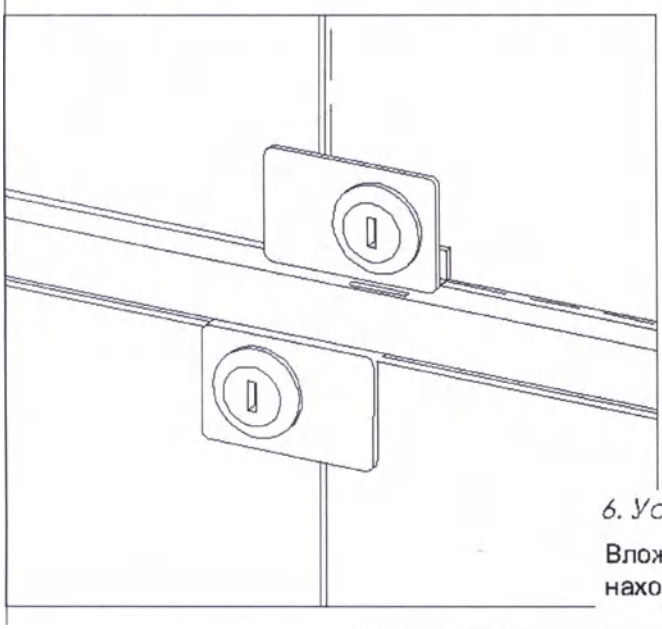

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие)разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации езвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо елие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических лециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-114-ШК в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-114-ШК
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дрокин Д. А. /
«27» июня 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

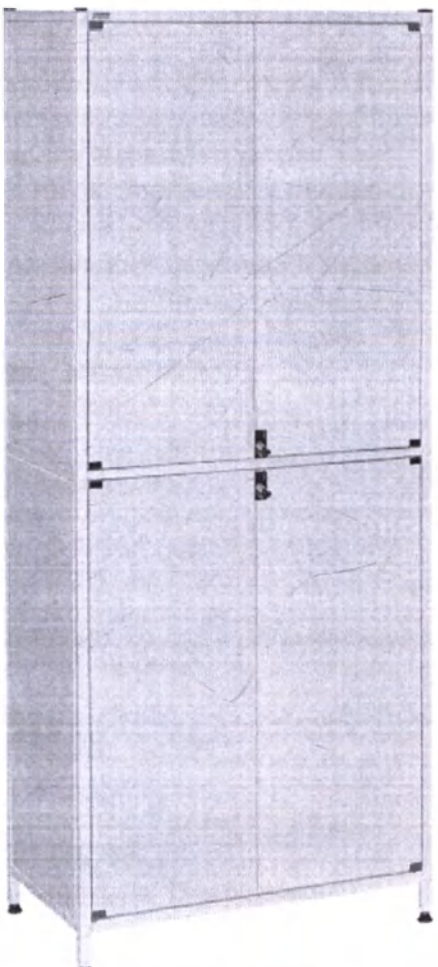

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-115-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-115-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	**700*360*1650**	**43±0,5**		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 5	Полка верхняя	1
П 6	Полка средняя	1
П 7	Полка нижняя	1
СТ 3	Задняя стенка	4
Д 1	Дверца (металл)	4
П 8	Полка вкладная (металл)	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	26
	Саморез со сверлом 4,2х13	18
	U-образная петля (комплект на одну дверь	4
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской. (каркас, двери); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки,)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	43,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 5** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 6** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 7** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ3** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 5, П 6, П7** .
10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П8**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкакфов

Э-113-ШК, Э-113/Н-ШК, Э-114-ШК, Э-114/Н-ШК, Э-115-ШК, Э-115/Н-ШК

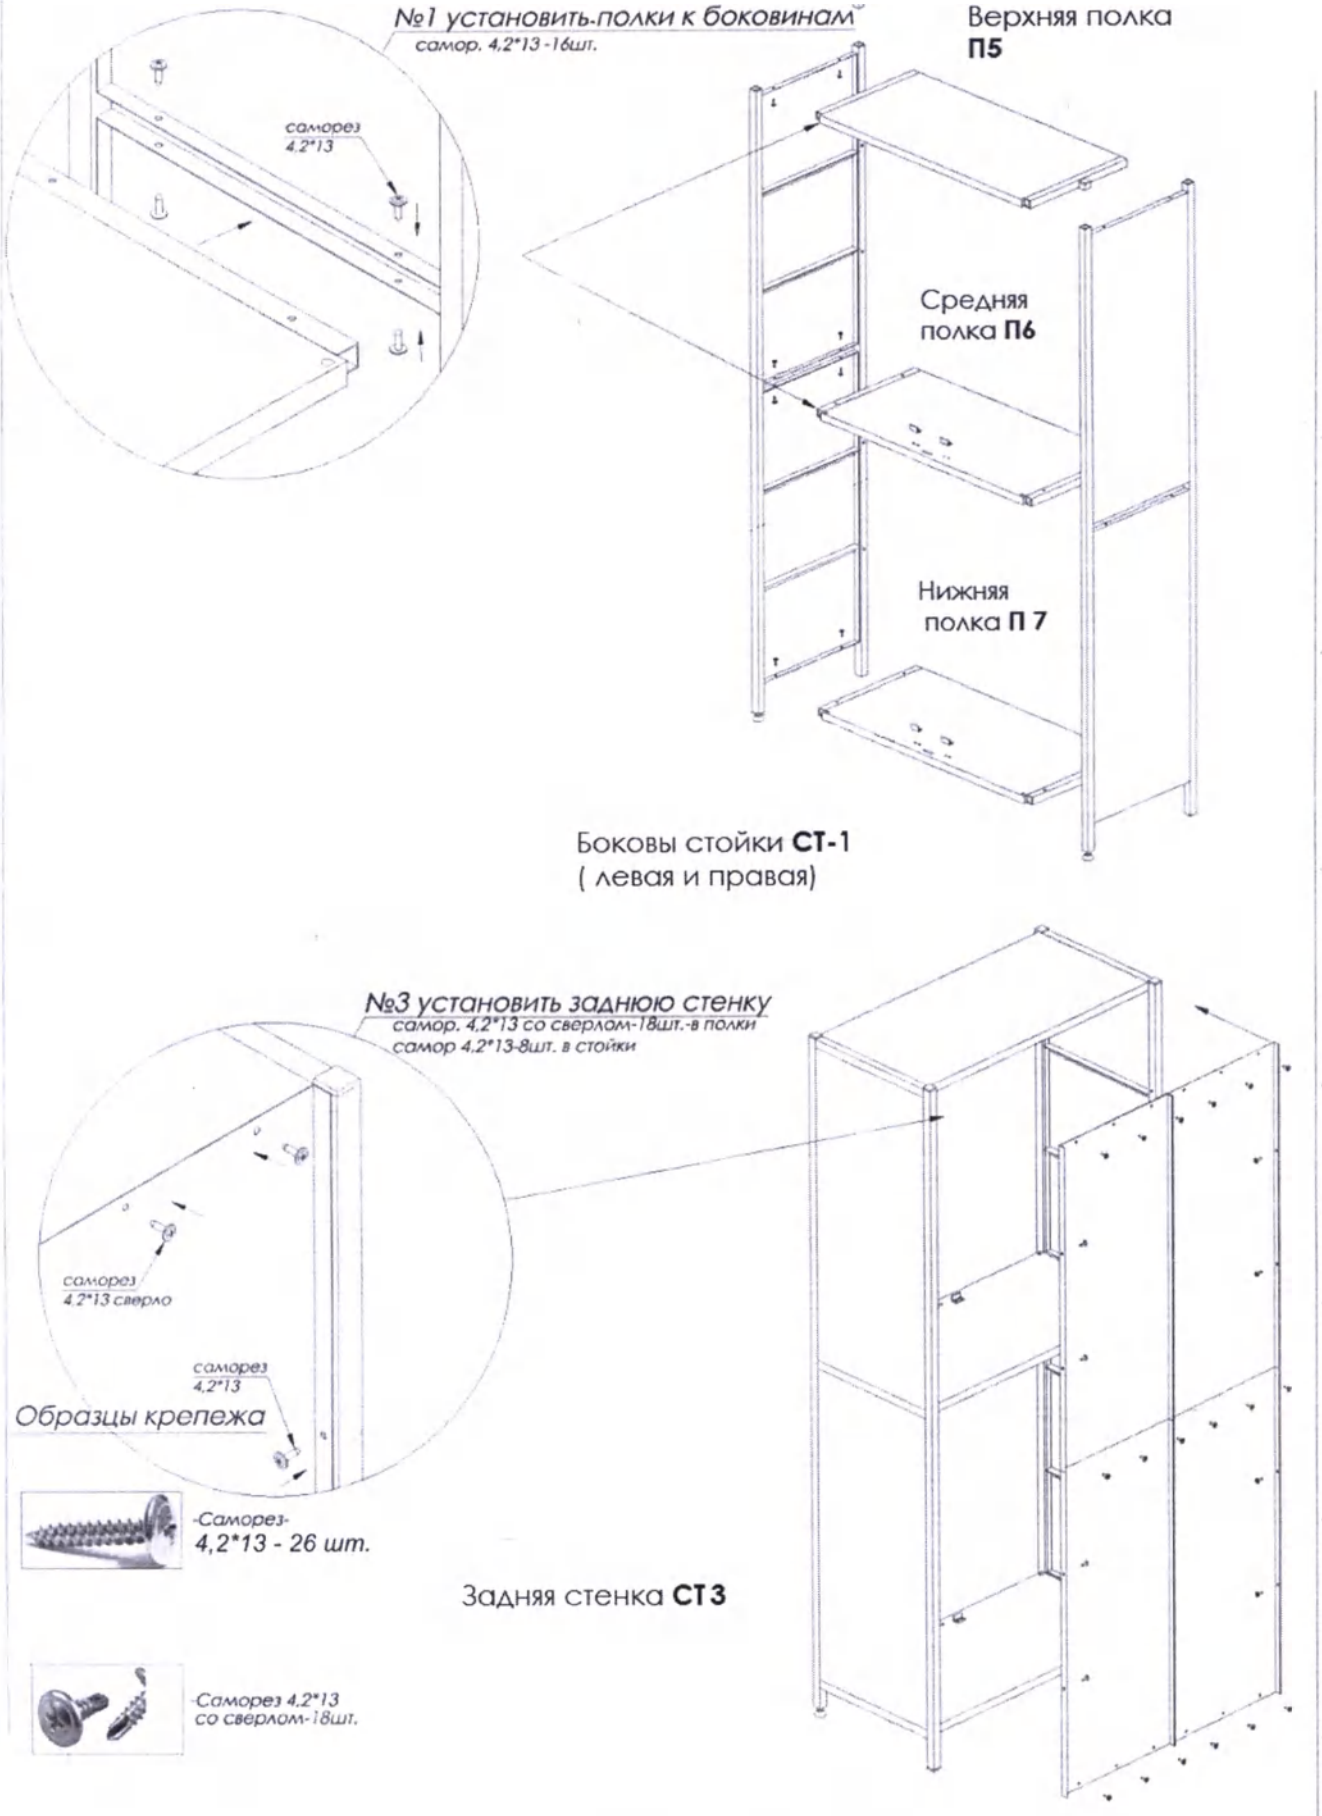

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

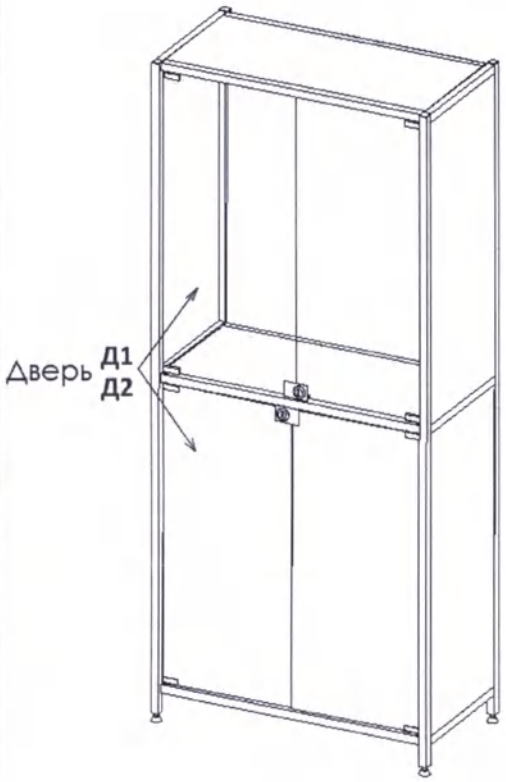

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

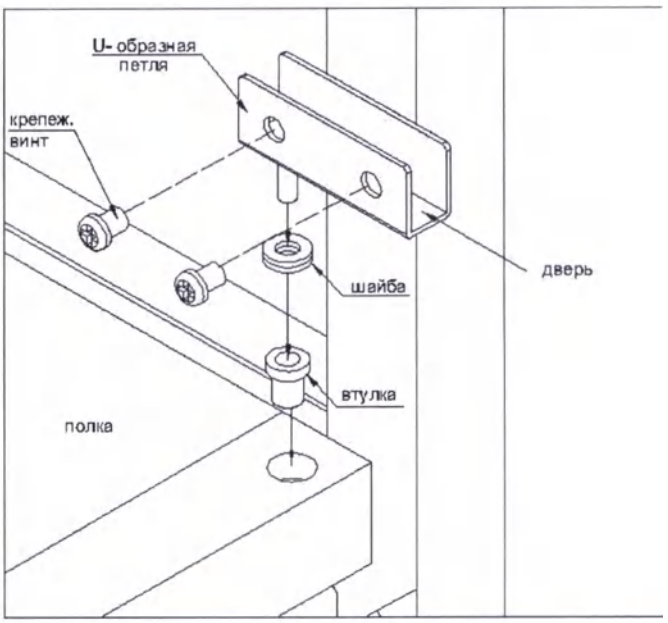

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

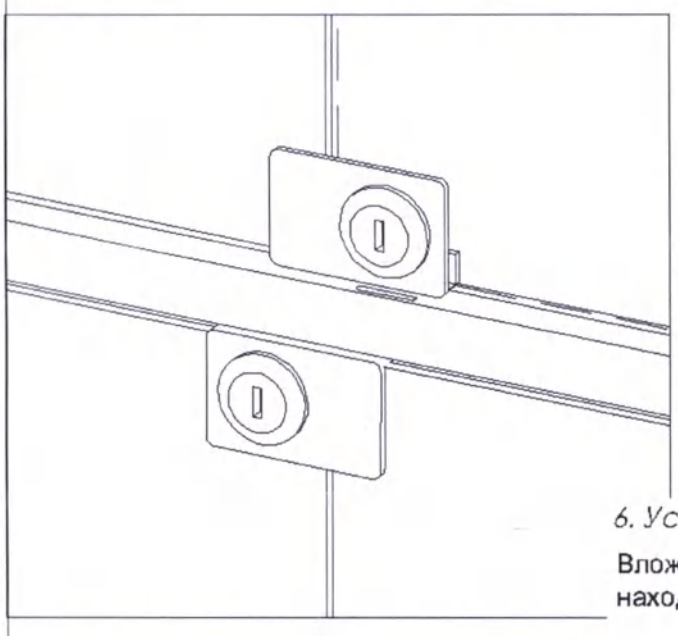

Замок для двух распашных дверей
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 1-2. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации езвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-115-ШК в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ___________________
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-115-ШК
Дата выпуска ___________, партия ___________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_________20__ г.

Дата_____________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э. А. /

«27» апреля 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

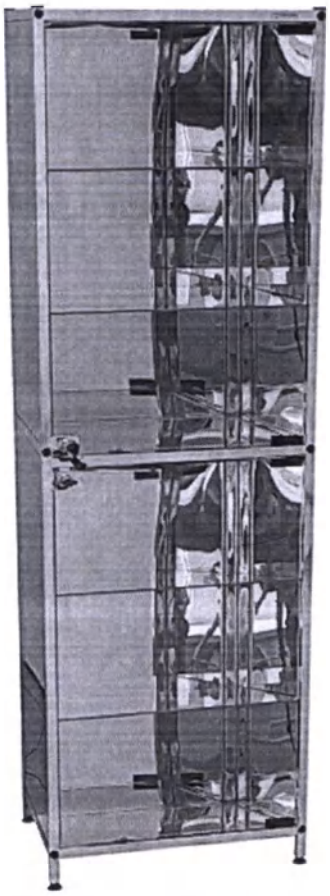

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-110/Н-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-110/Н-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	**570*360*1650**	**42±0,5**		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 1	Полка верхняя	1
П 2	Полка средняя	1
П 3	Полка нижняя	1
СТ 2	Задняя стенка	2
Д 1	Дверца (стекло)	2
П 4	Полка вкладная (стекло)	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	24
	Саморез со сверлом 4,2х13	9
	U-образная петля (комплект на одну дверь	2
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (полки) Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	42,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.

10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 1** четырьмя саморезами.

10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 2** восемью саморезами.

10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 3** четырьмя саморезами.

10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ 2** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 1, П 2, П3** .

10.6 В собранную конструкцию установить две двери **Д1** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.

10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П4**.

10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-110-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-111-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-112-ШК, Э-112/Н-ШК

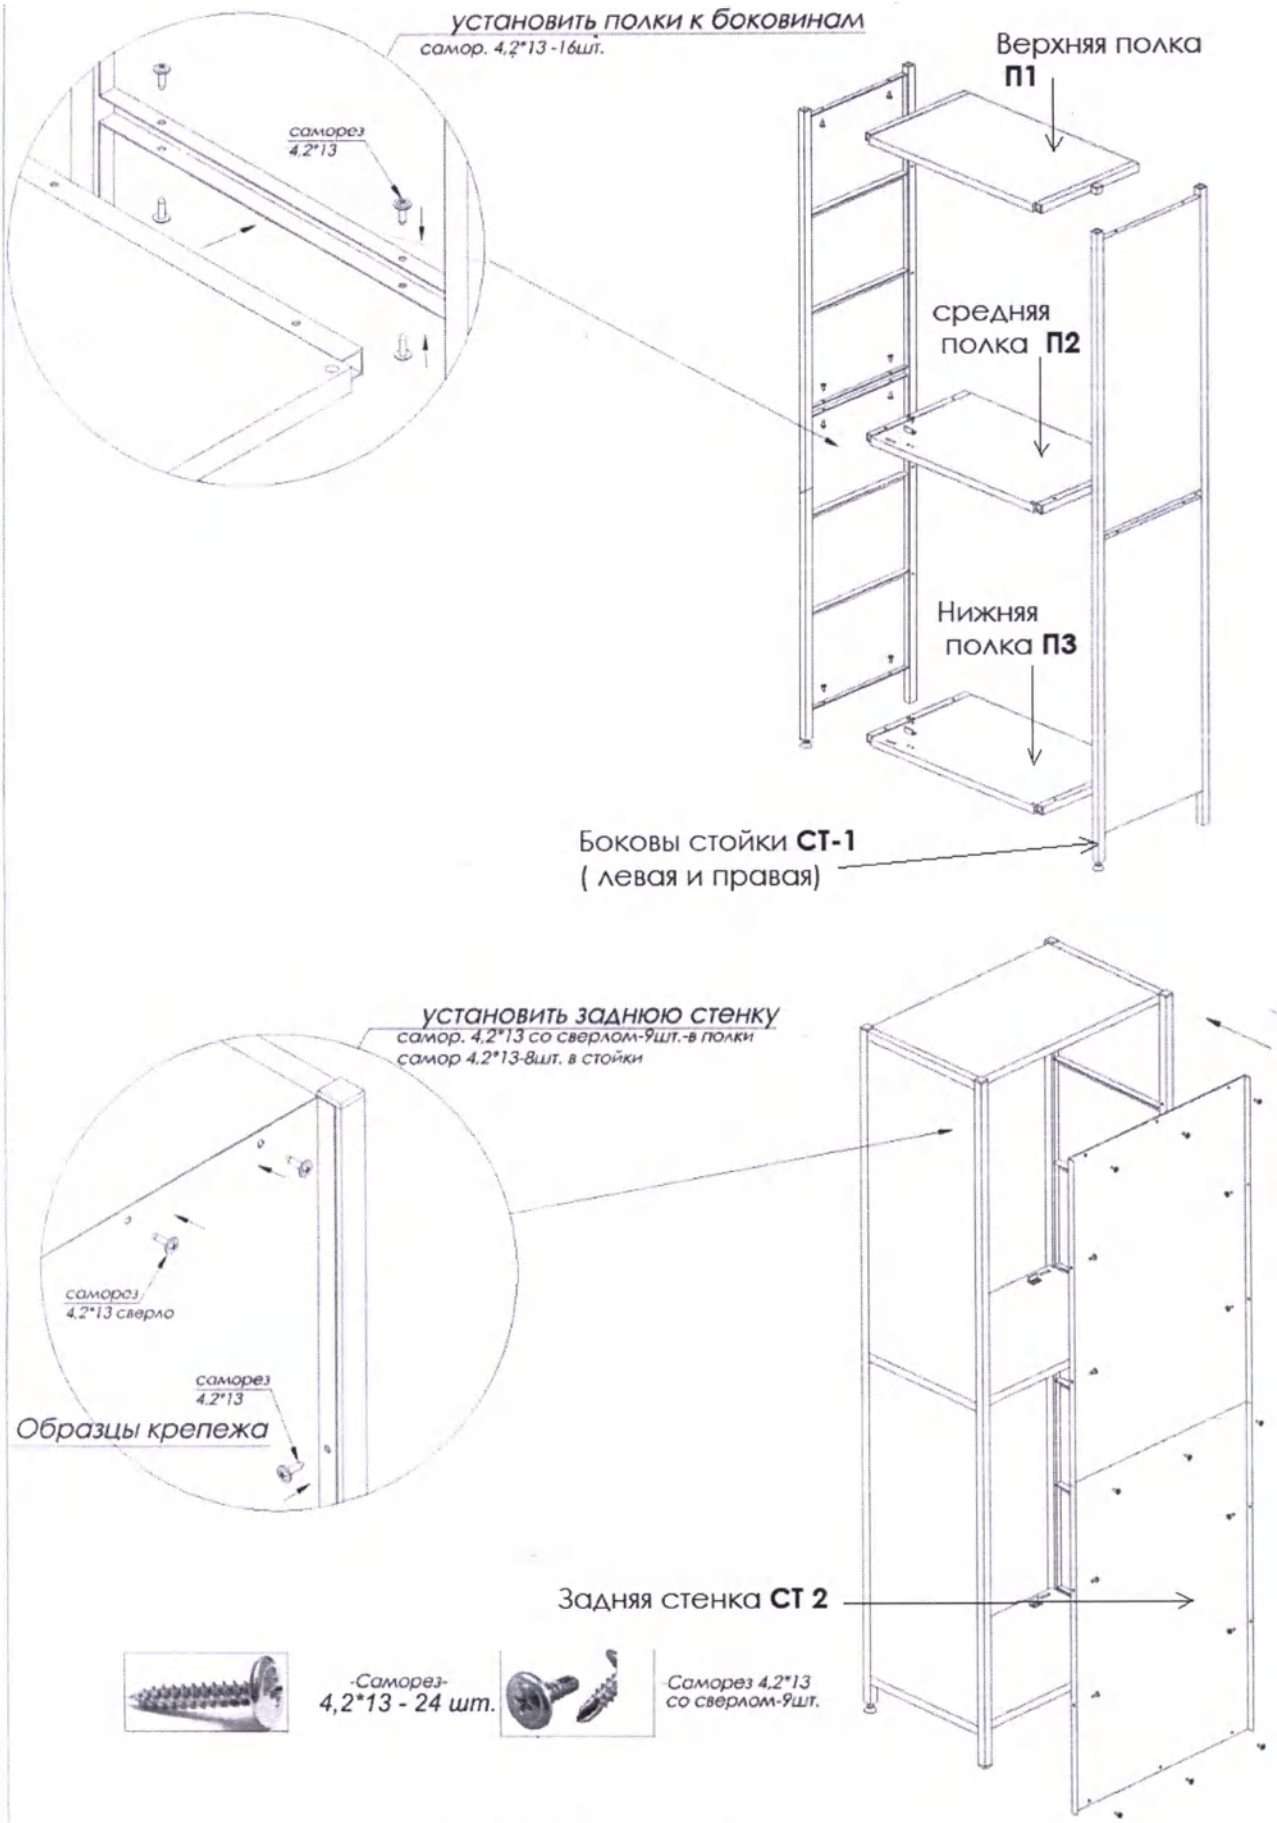

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

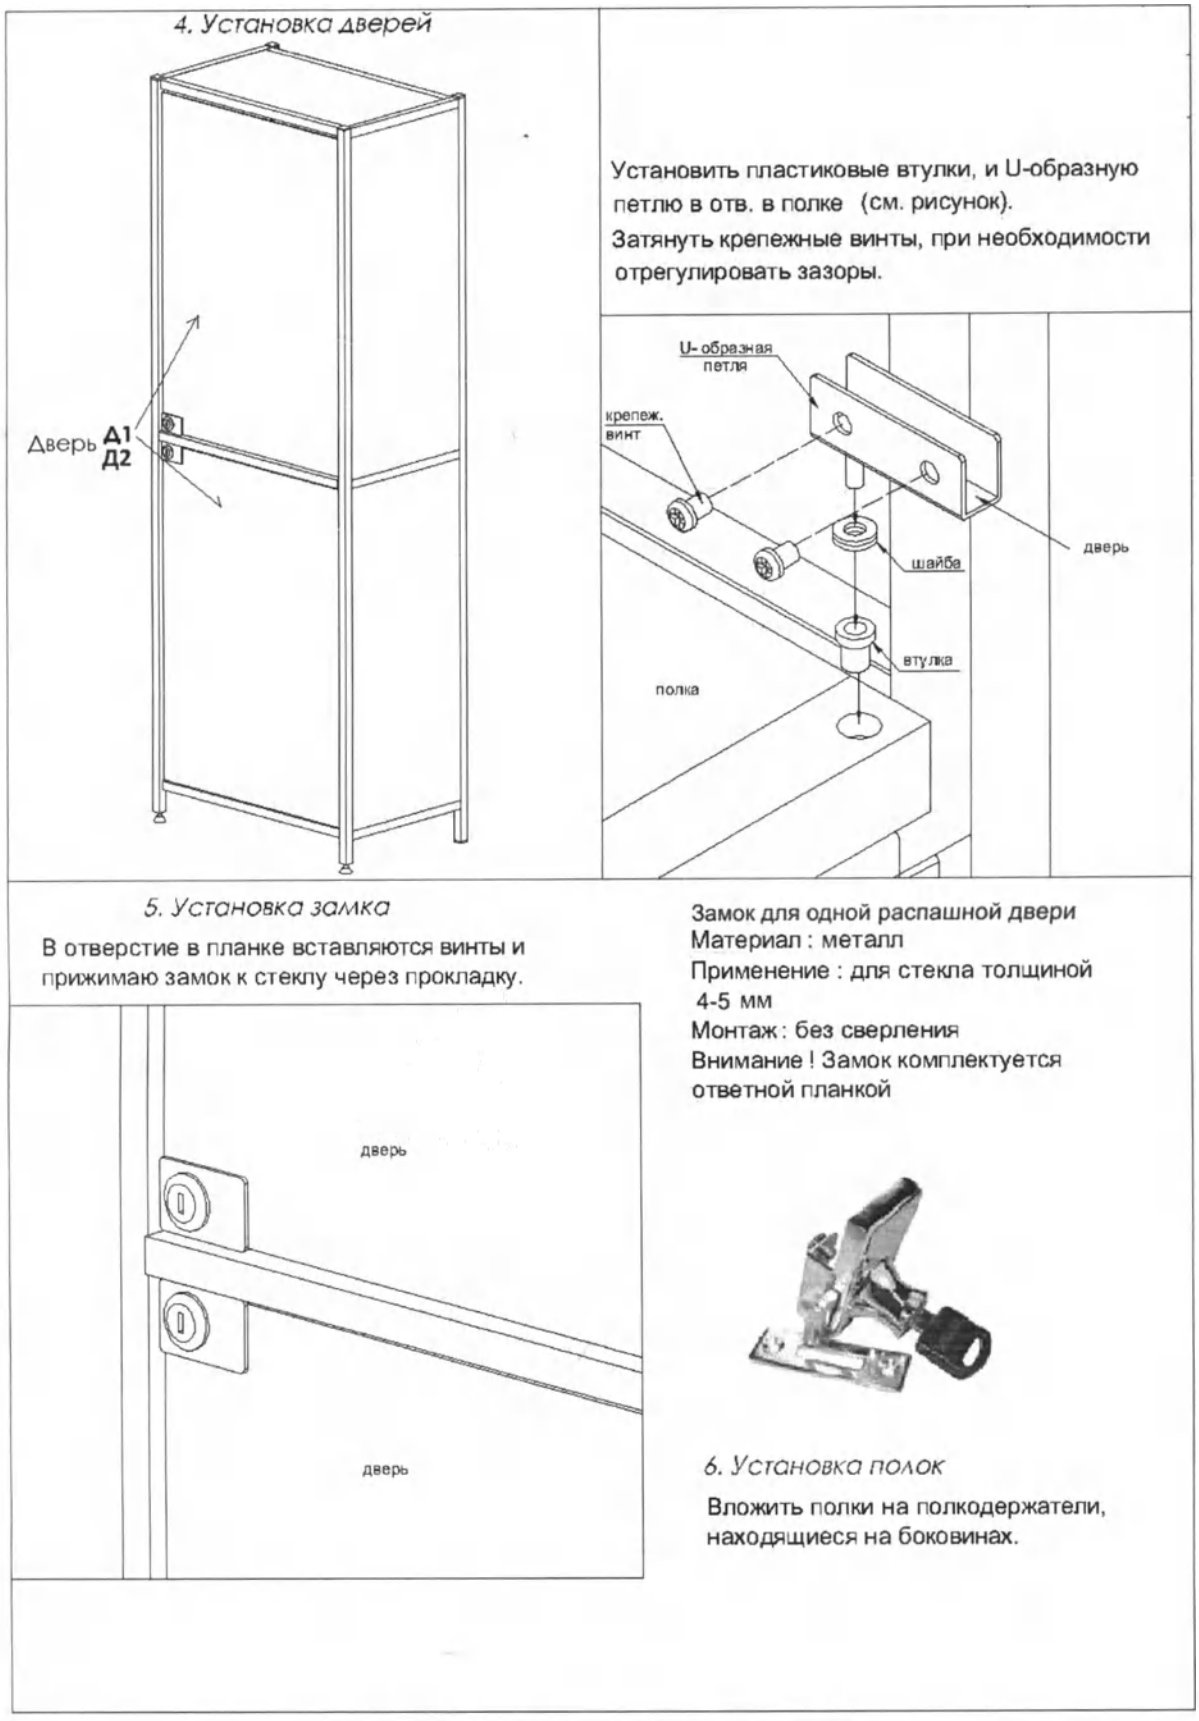

Рисунок 2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-110/Н-ШК в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-110/Н-ШК
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________
Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дроздин Э. А.

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

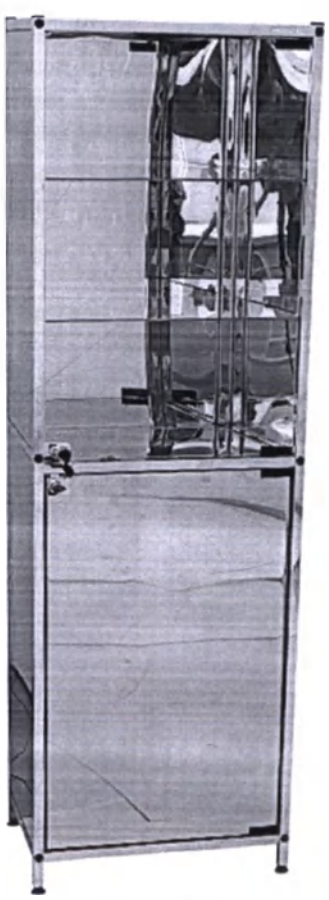

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-111/Н-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-111/Н-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
22 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	**570*360*1650**	**41±0,5**		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 1	Полка верхняя	1
П 2	Полка средняя	1
П 3	Полка нижняя	1
СТ 2	Задняя стенка	2
Д 1	Дверца (стекло)	1
Д 2	Дверца (металл)	1
П 4	Полка вкладная (стекло)	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	24
	Саморез со сверлом 4,2х13	9
	U-образная петля (комплект на одну дверь	2
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (полки) Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	41,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 1** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 2** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 3** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ 2** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 1, П 2, П**3 .
10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1 и Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П4**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-110-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-111-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-112-ШК, Э-112/Н-ШК

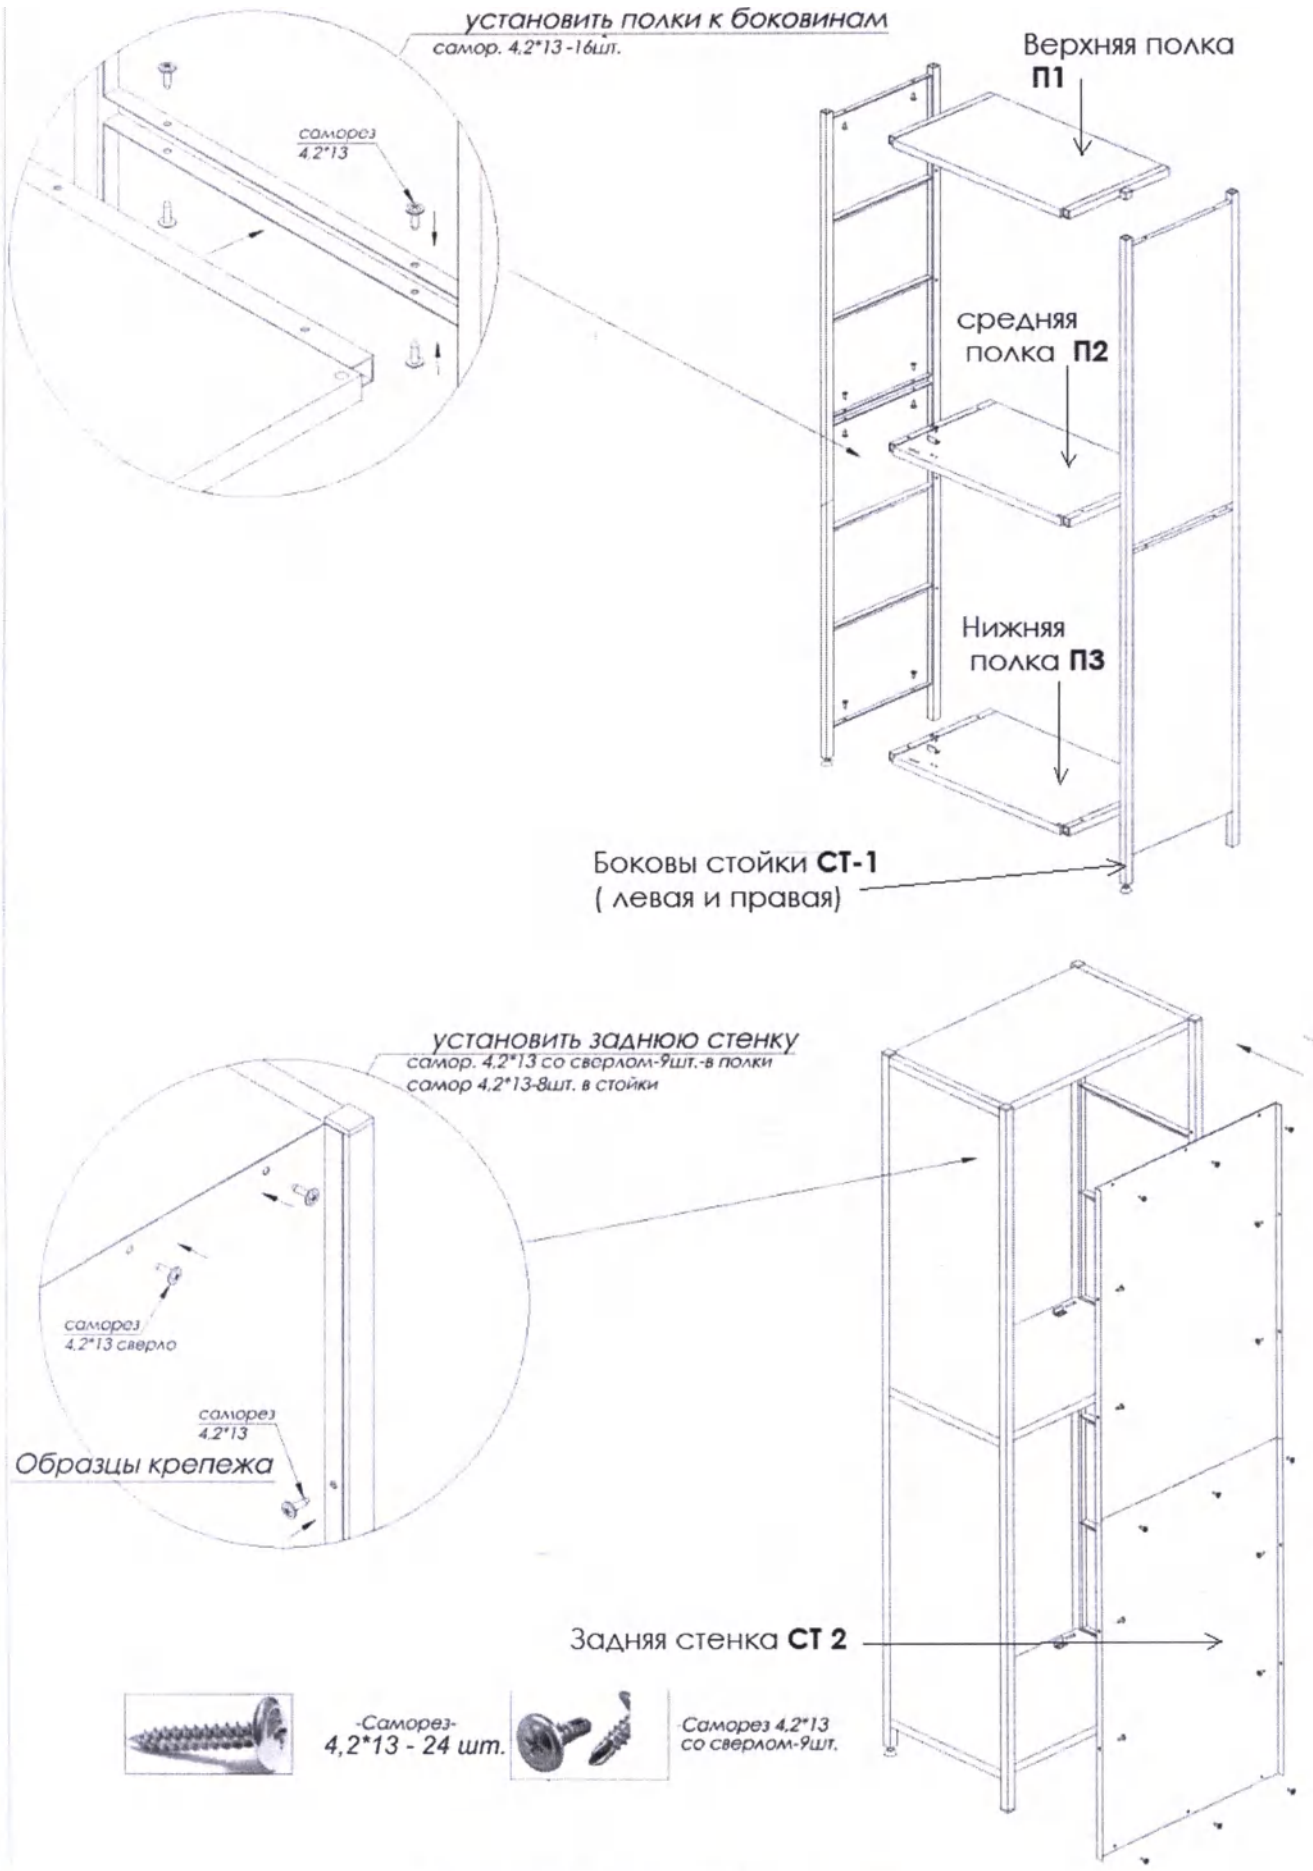

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

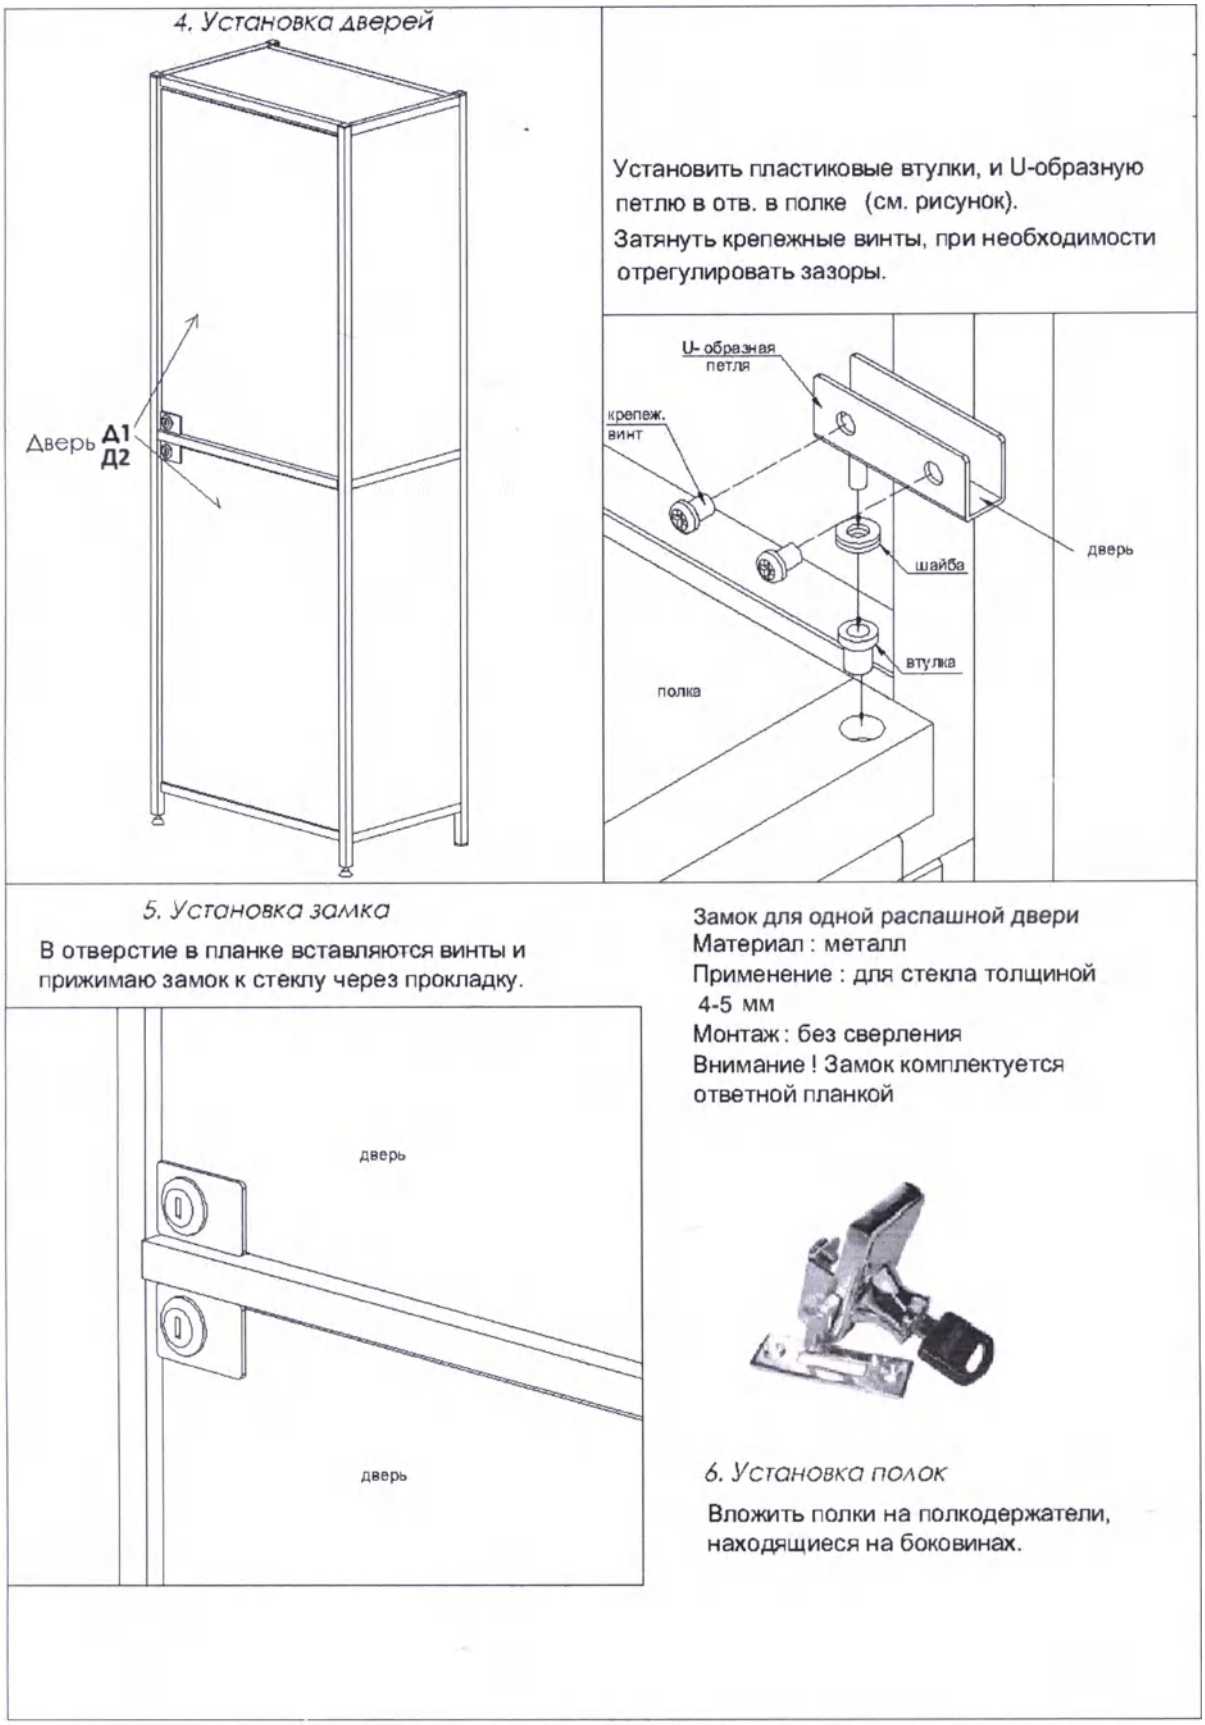

Рисунок 2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие ›разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации езвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических лециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-111/Н-ШК в количестве __________шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-111/Н-ШК

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрючин Э. А.** /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

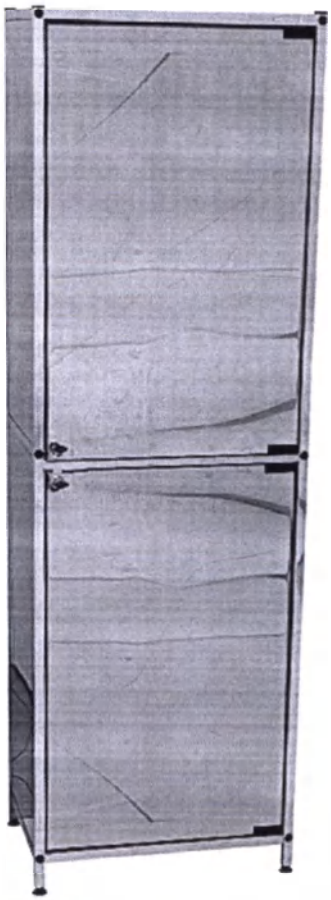

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-112/Н-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-112/Н-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	**570*360*1650**	**38±0,5**		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ1	**Боковая стойка (левая и правая)**	2
П 1	Полка верхняя	1
П 2	Полка средняя	1
П 3	Полка нижняя	1
СТ 2	Задняя стенка	2
Д 2	Дверца (металл)	2
П 4	Полка вкладная (стекло)	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	24
	Саморез со сверлом 4,2х13	9
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	2
	Замок-ручка	2

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (полки) Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	38,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.

10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 1** четырьмя саморезами.

10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 2** восемью саморезами.

10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 3** четырьмя саморезами.

10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ 2** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 1, П 2, П3** .

10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.

10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П4.**

10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-110-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-111-ШК, Э-110/Н-ШК, Э-112-ШК, Э-112/Н-ШК

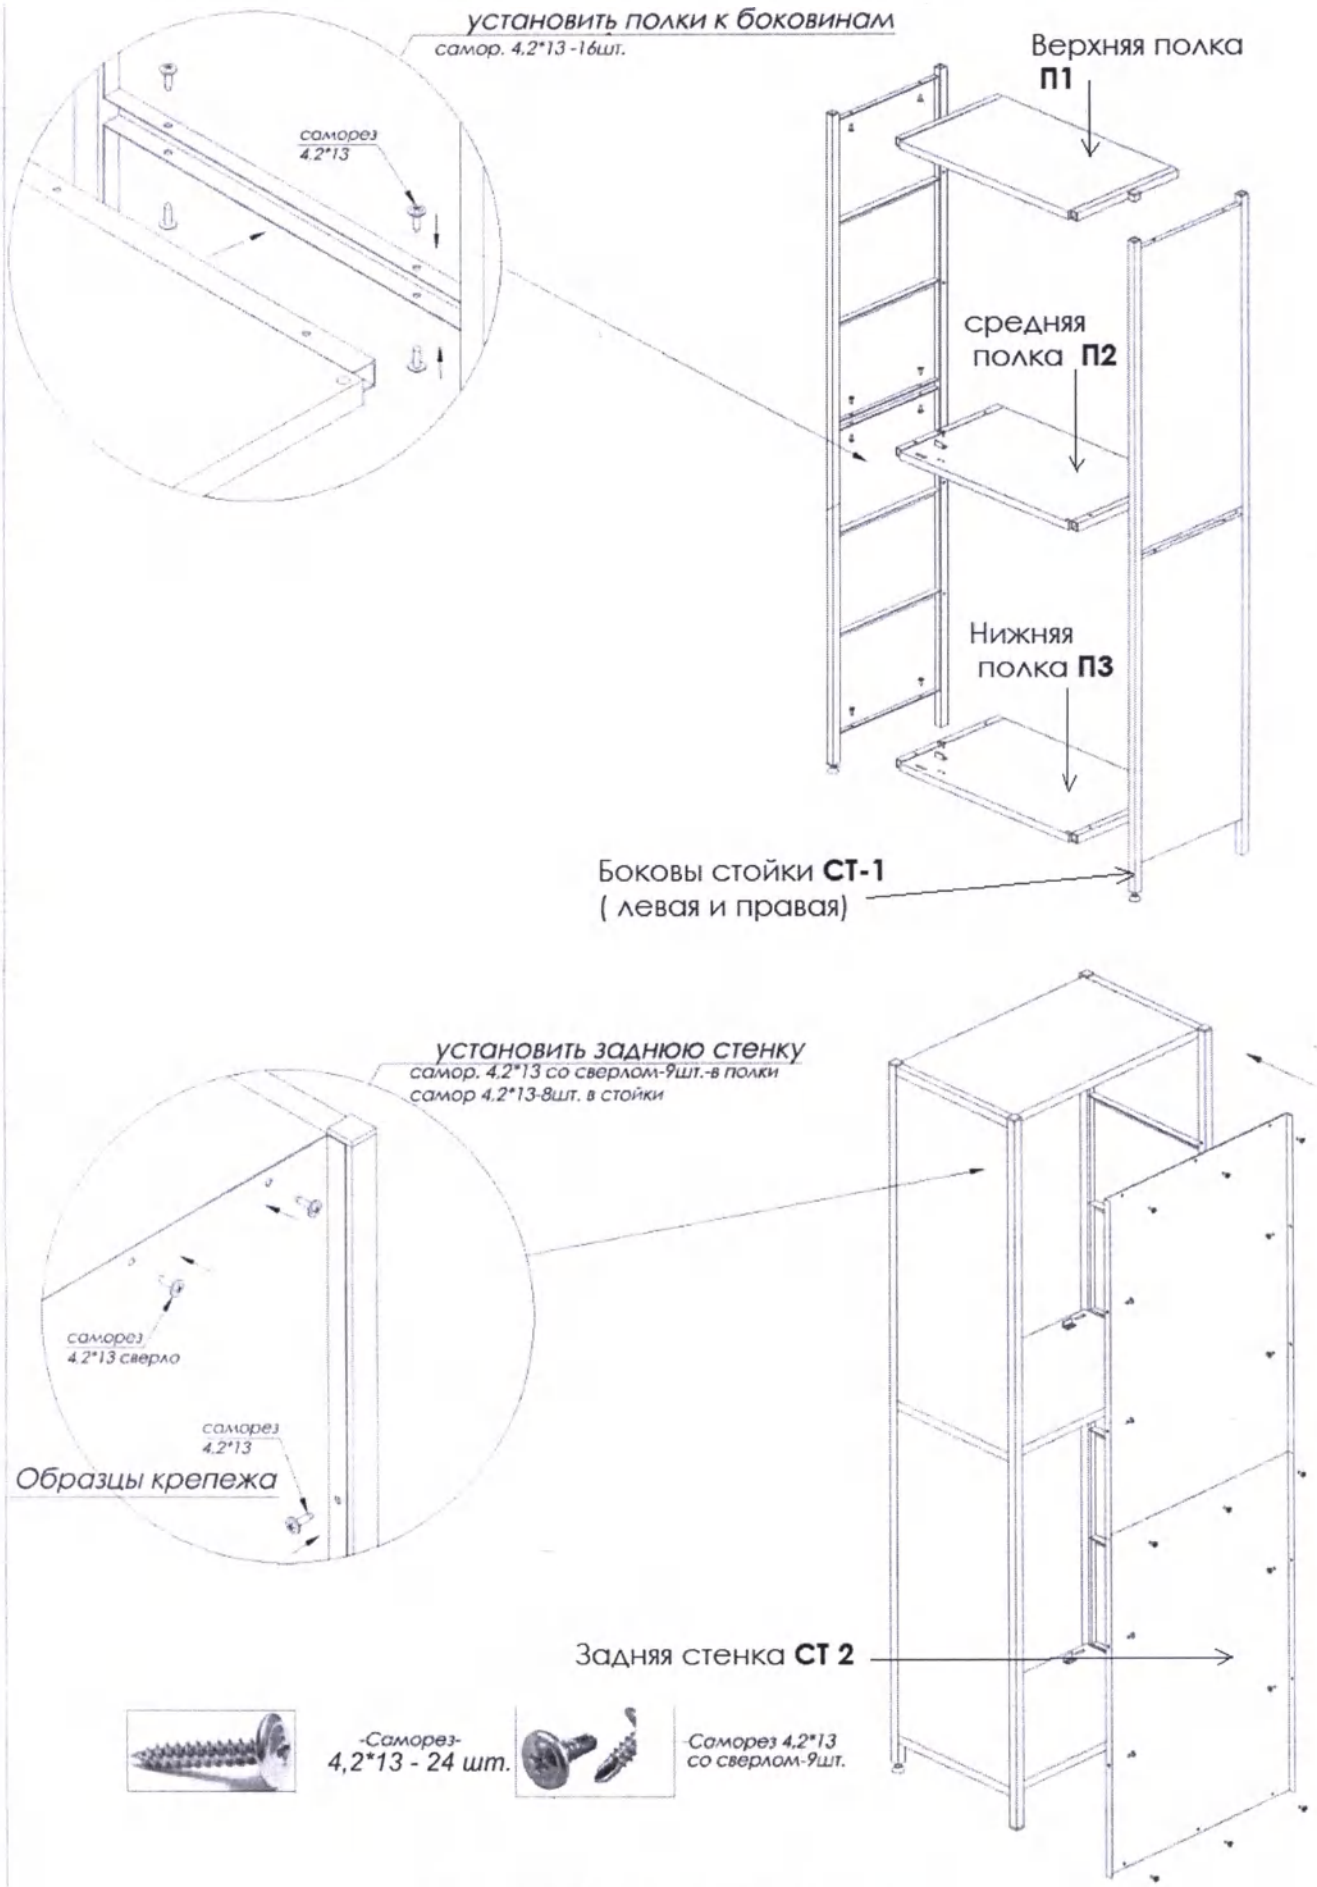

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

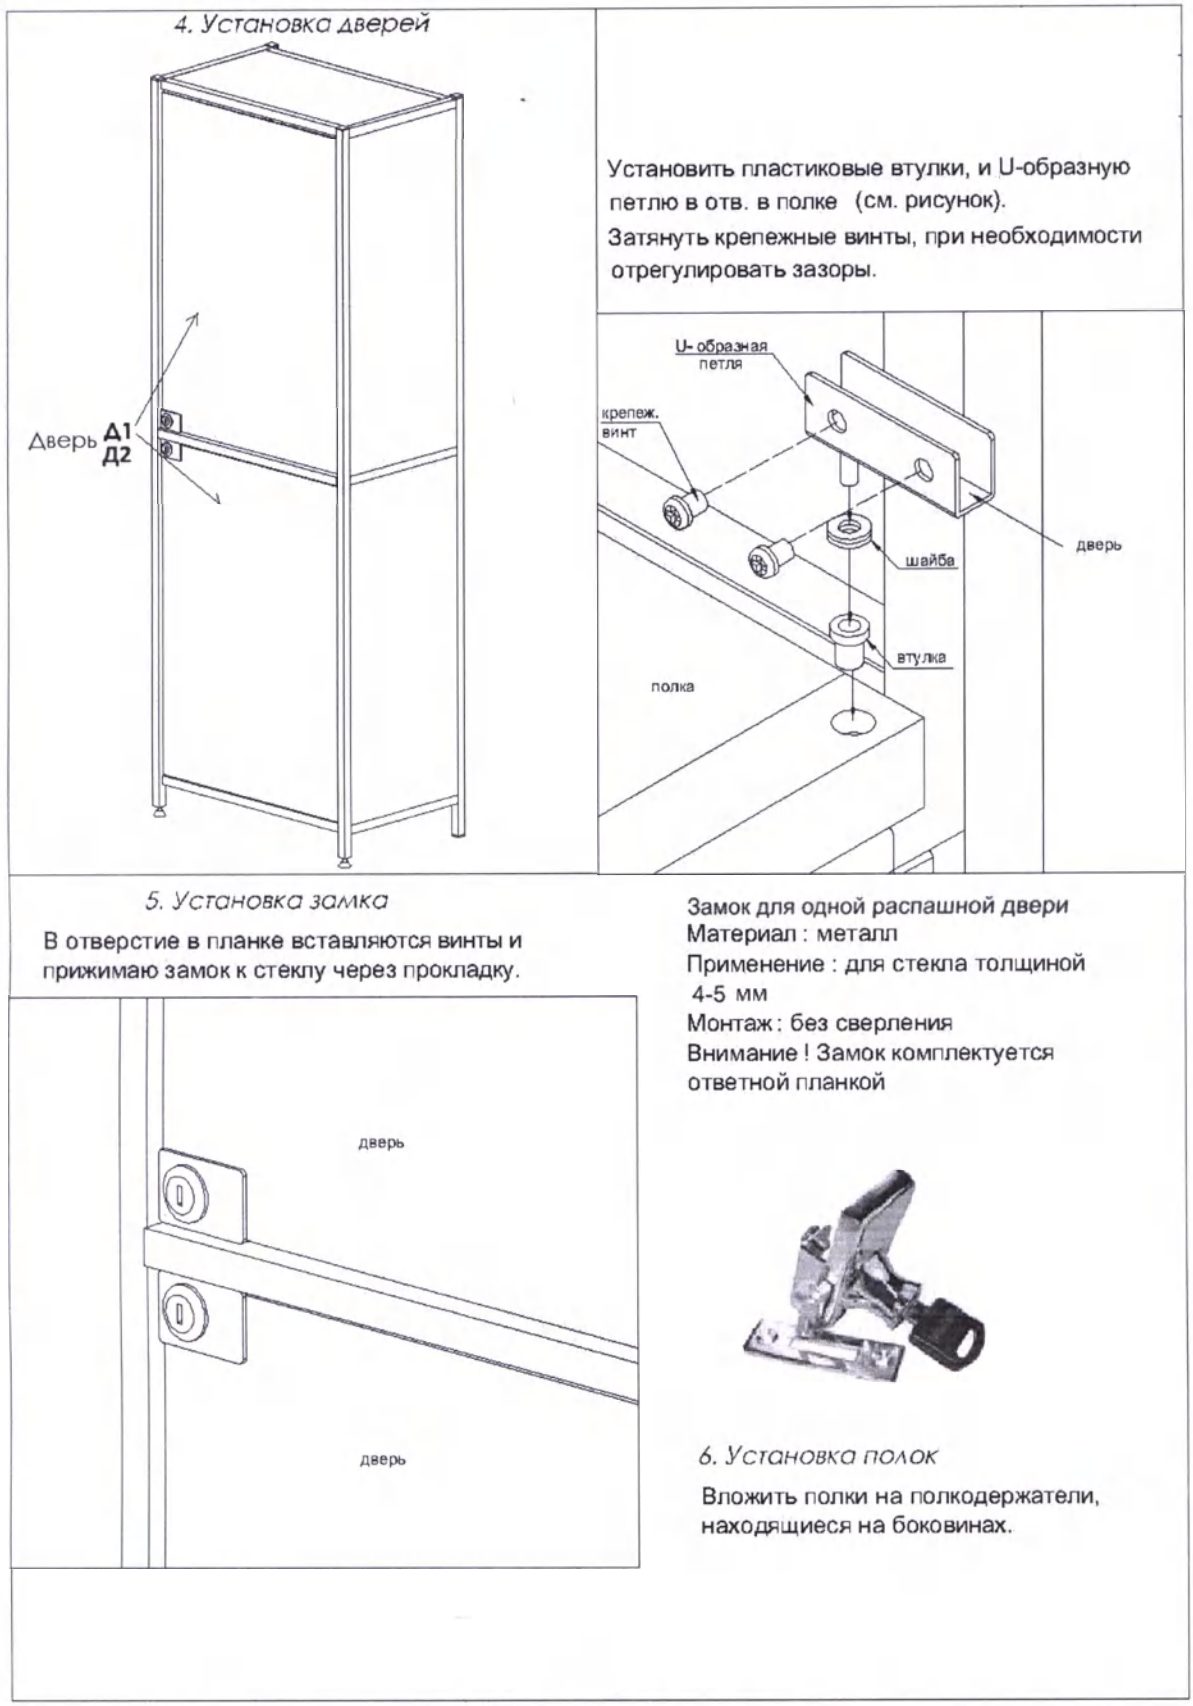

Рисунок 2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие абразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу отходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке или изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих ТУ, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо изделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели владелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической помощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических специалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец берет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-112/Н-ШК в количестве __________шт. принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-112/Н-ШК

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата____________________Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) лис

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дроздов З. А. /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

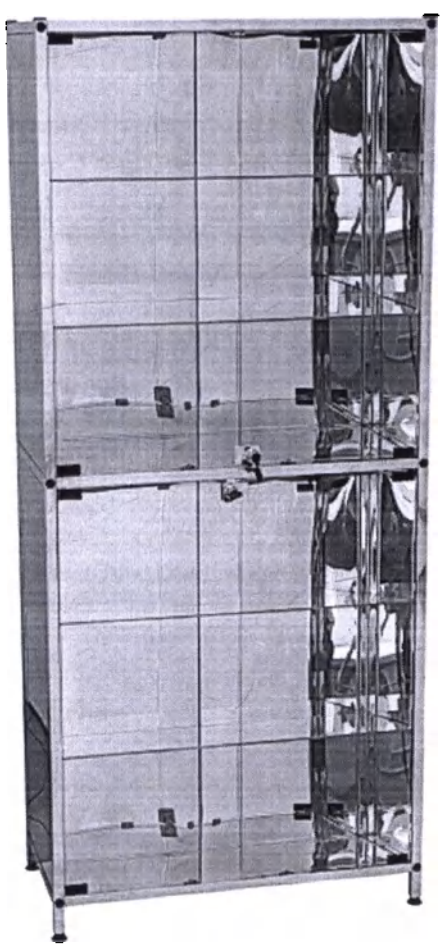

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-113/Н-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-113/Н-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	**700*360*1650**	**53,7±0,5**		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 5	Полка верхняя	1
П 6	Полка средняя	1
П 7	Полка нижняя	1
СТ 3	Задняя стенка	4
Д 1	Дверца (стекло)	4
П 8	Полка вкладная (стекло)	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	26
	Саморез со сверлом 4,2х13	18
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	4
	Замок-ручка	2

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (полки) Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	53,7±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.
10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 5** четырьмя саморезами.
10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 6** восемью саморезами.
10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 7** четырьмя саморезами.
10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ3** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 5, П 6, П7** .
10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.
10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П8**.
10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкакфов
Э-113-ШК, Э-113/Н-ШК, Э-114-ШК, Э-114/Н-ШК, Э-115-ШК, Э-115/Н-ШК

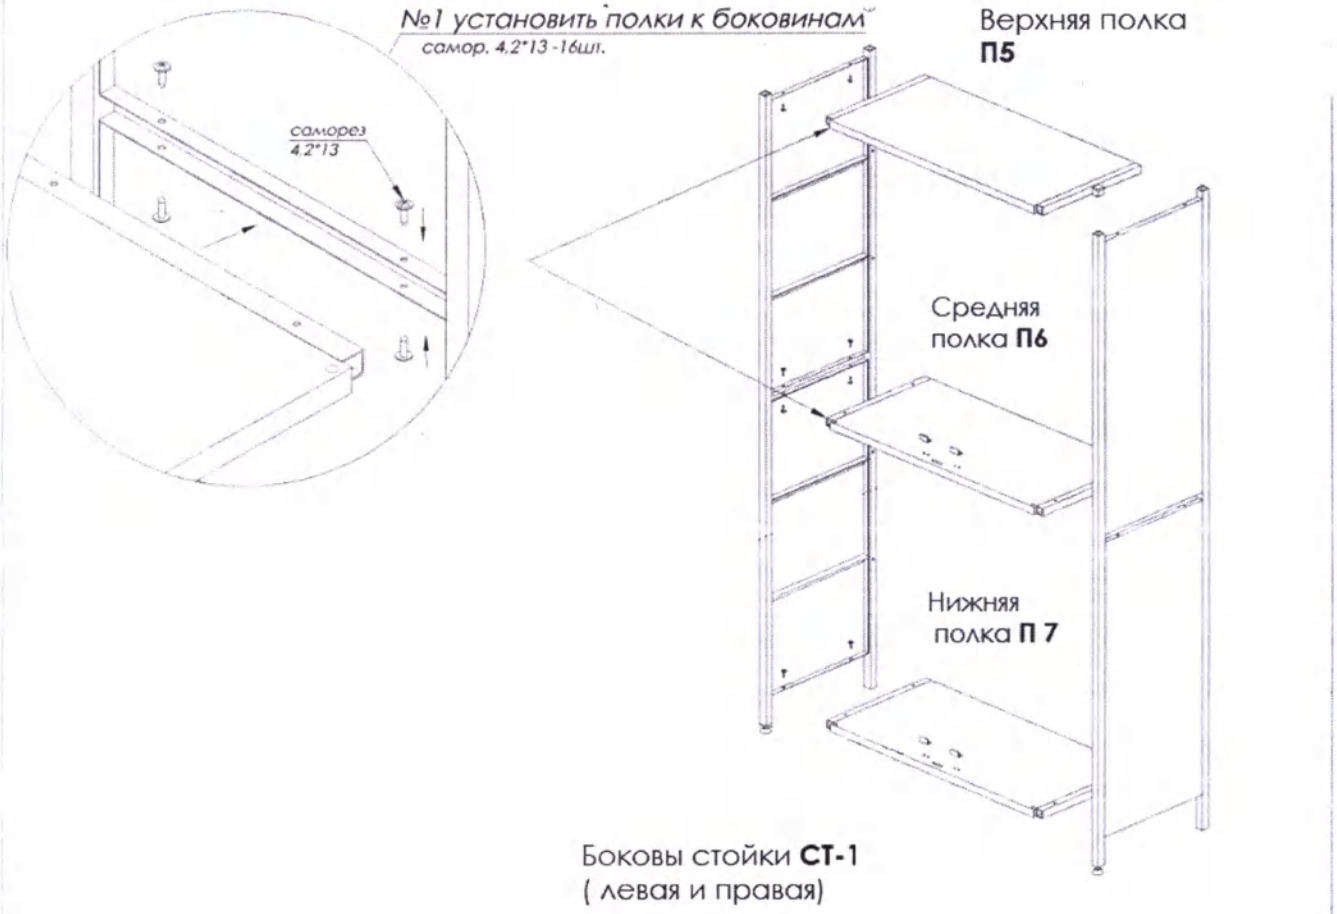

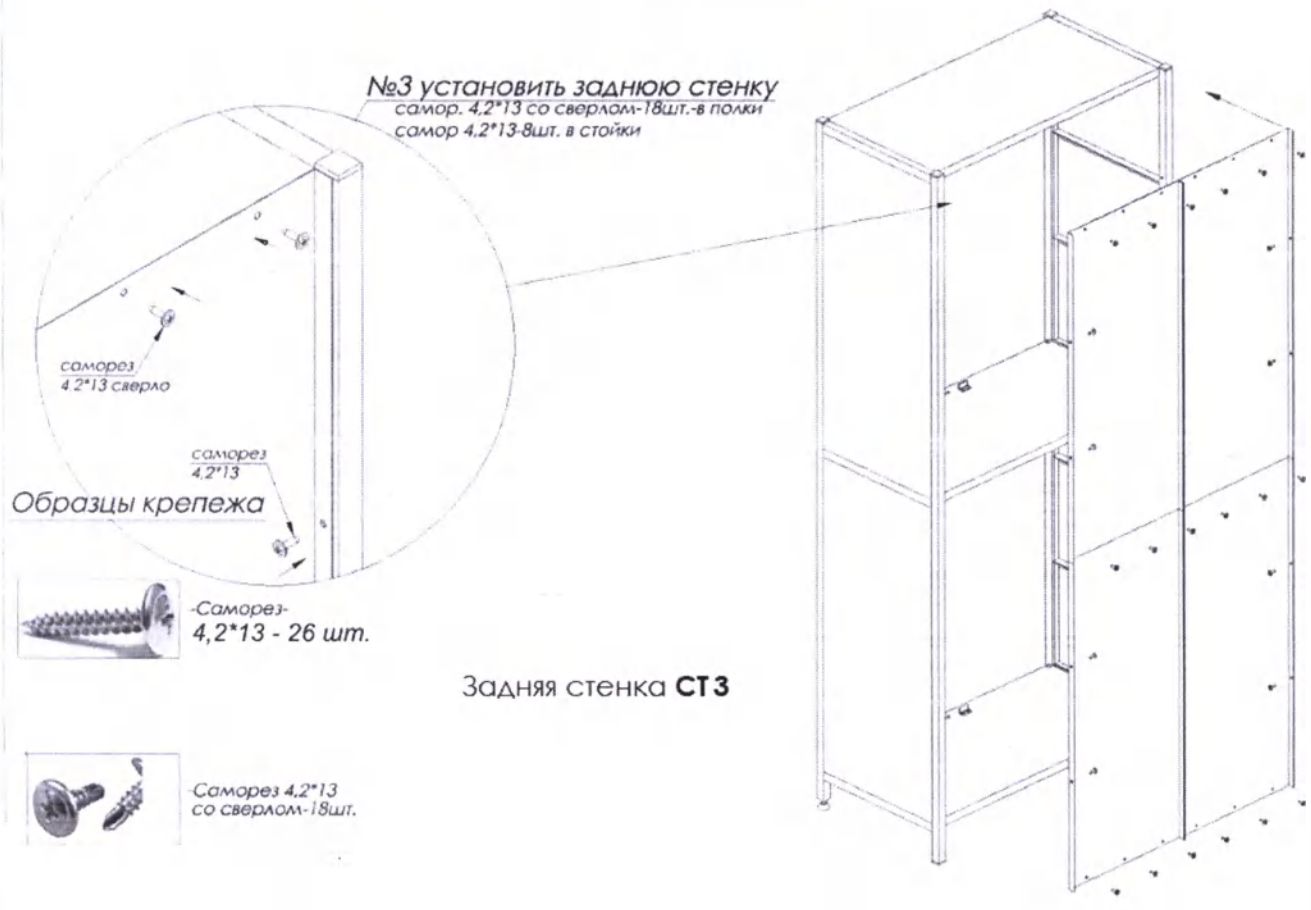

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

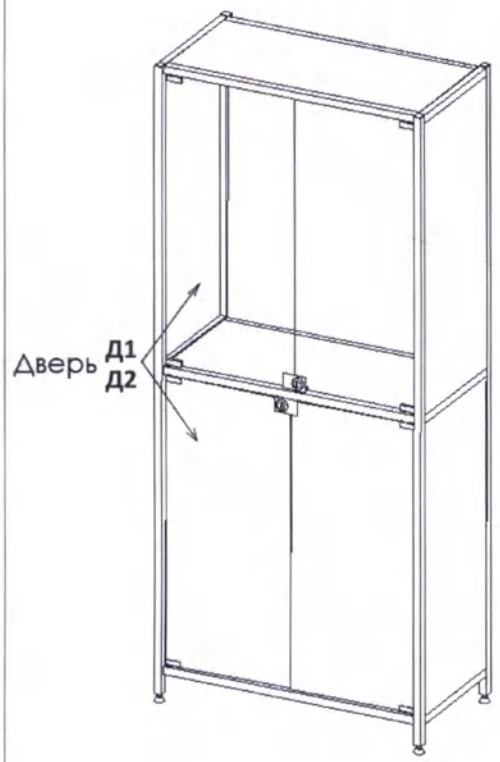

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

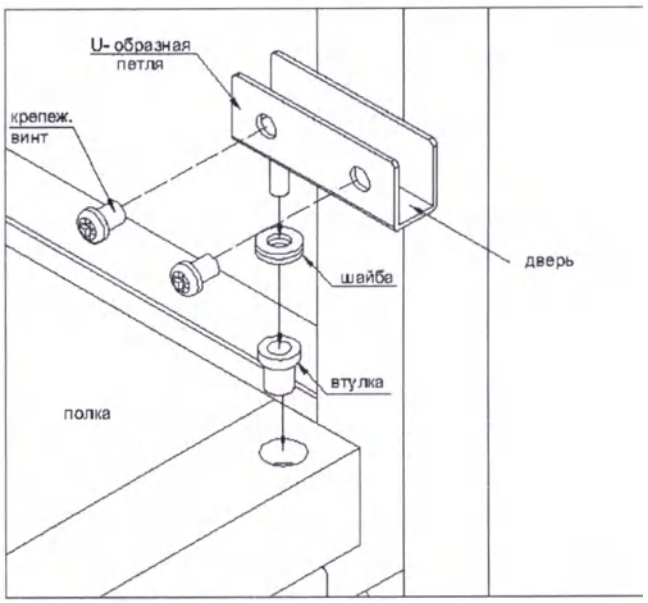

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

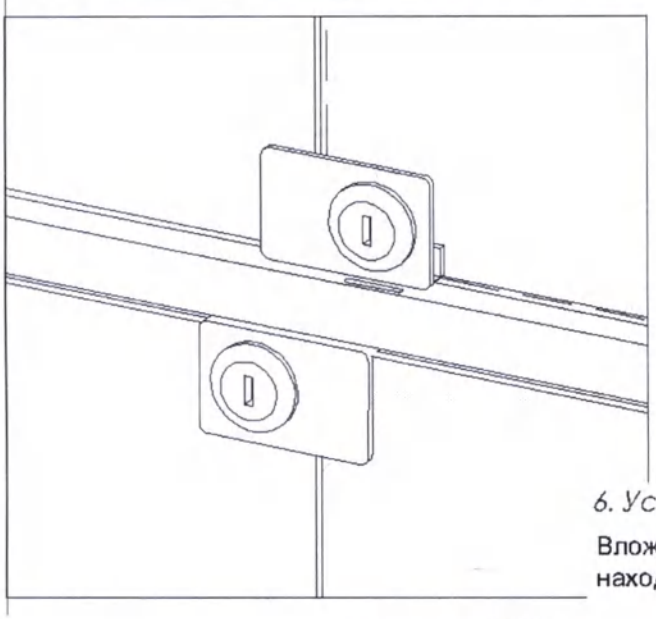

Замок для двух распашных дверей
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели іаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), *или же воспользоваться услугами иных технических* іециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-113/Н-ШК в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медицинских учреждений Э-113/Н-ШК
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________Начальник производства ______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность **Генеральный директор**

Подпись _____ / **Дрокин Э. А.** /

«27» июня 2023 года М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

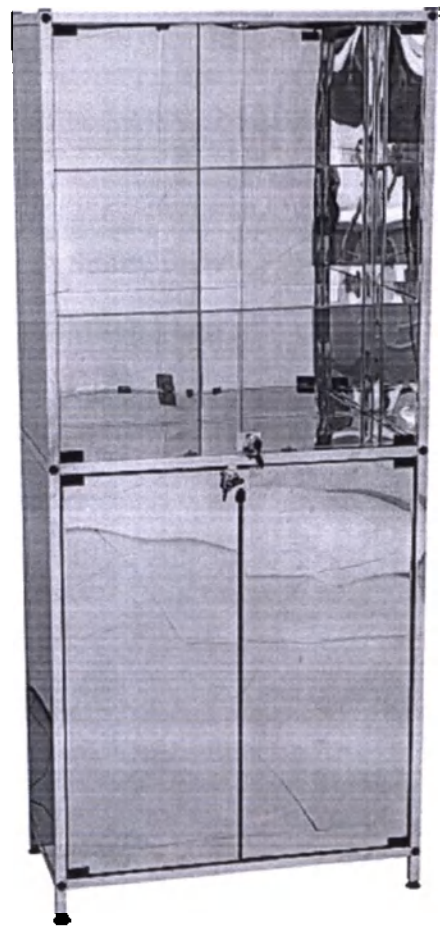

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-114/Н-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-114/Н-ПК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	**700*360*1650**	**47,5±0,5**		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
СТ1	Боковая стойка (левая и правая)	2
П 5	Полка верхняя	1
П 6	Полка средняя	1
П 7	Полка нижняя	1
СТ 3	Задняя стенка	4
Д 1	Дверца (стекло)	2
Д 2	Дверца (металл)	2
П 8	Полка вкладная (стекло)	4
	Крепежные изделия	
	Саморез 4,2х13	26
	Саморез со сверлом 4,2х13	18
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	4
	Замок-ручка	2

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (полки) Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	47,5±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.

10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 5** четырьмя саморезами.

10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 6** восемью саморезами.

10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 7** четырьмя саморезами.

10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ3** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 5, П 6, П7** .

10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д1и Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.

10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П8**.

10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкакфов

Э-113-ШК, Э-113/Н-ШК, Э-114-ШК, Э-114/Н-ШК, Э-115-ШК, Э-115/Н-ШК

№1 установить полки к боковинам
*самор. 4.2*13 -16шт.*

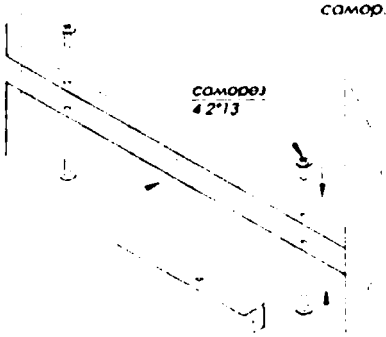

Верхняя полка **П5**

Средняя полка **П6**

Нижняя полка **П 7**

Боковы стойки **СТ-1**
(левая и правая)

№3 установить заднюю стенку
*самор. 4,2*13 со сверлом-18шт.-в полки*
*самор 4.2*13-8шт. в стойки*

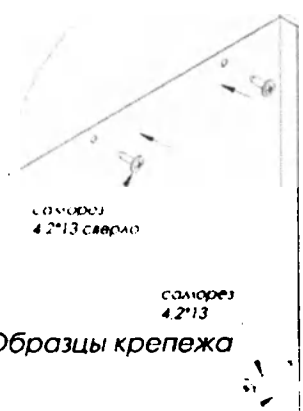

Образцы крепежа

Саморез
4,2*13 - 26 шт.

*Саморез 4,2*13*
со сверлом - 8шт.

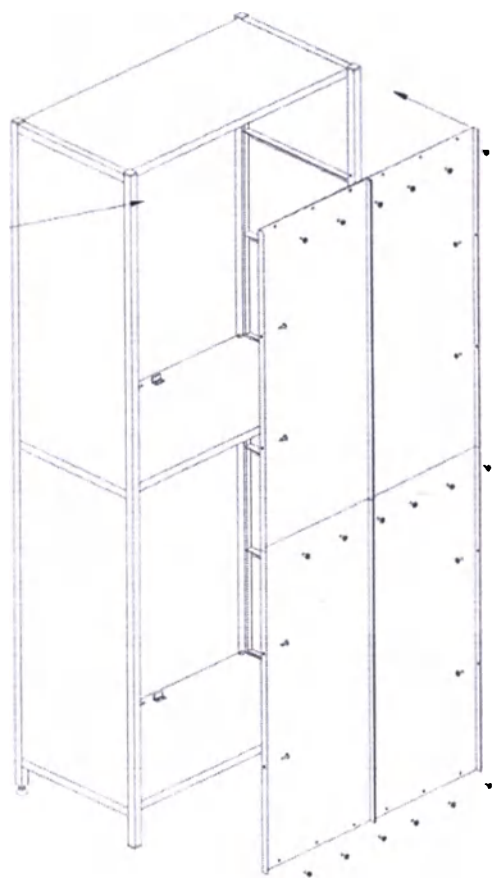

Задняя стенка **СТ 3**

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

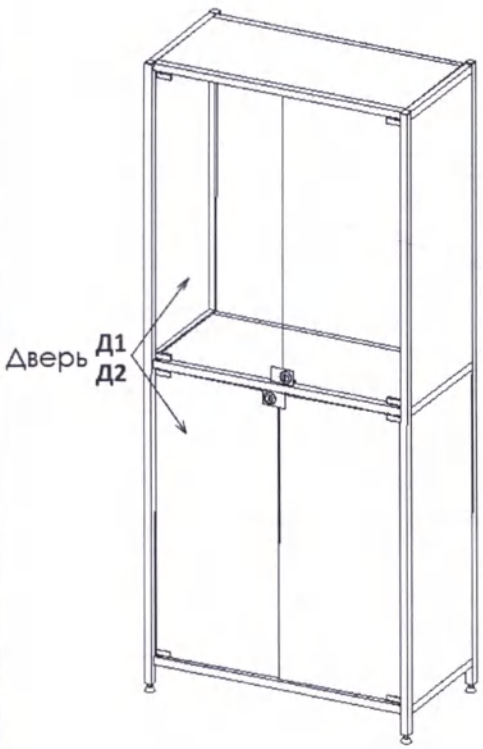

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

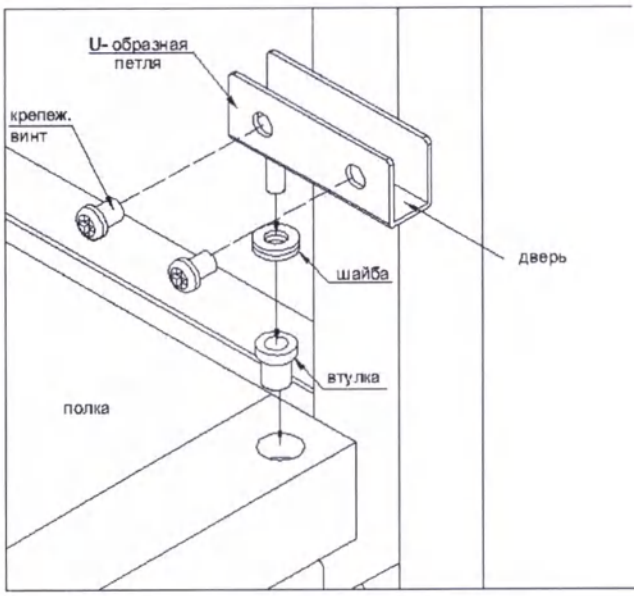

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

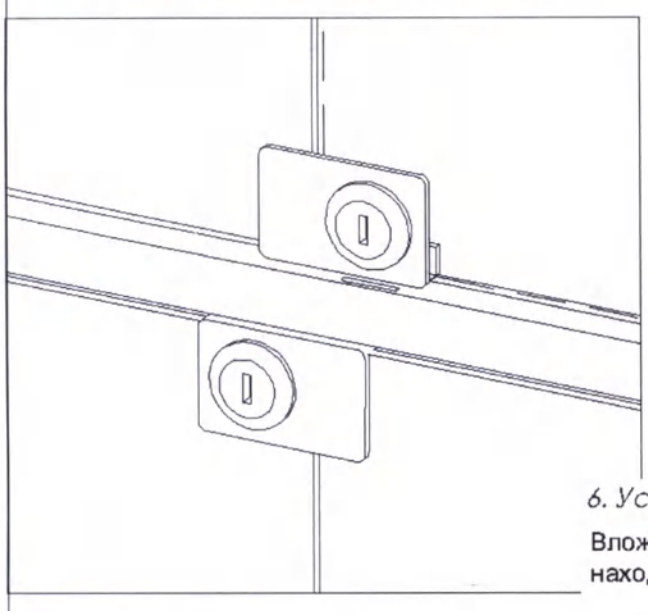

Замок для двух распашных дверей
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 2. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при дезинфекции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих 'У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации возмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-114/Н-ШК в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________

Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-114/Н-ШК
Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) листов
Должность Генеральный директор
Подпись _____ / Дроздин Э. А. /
«27» мая 2023 года

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

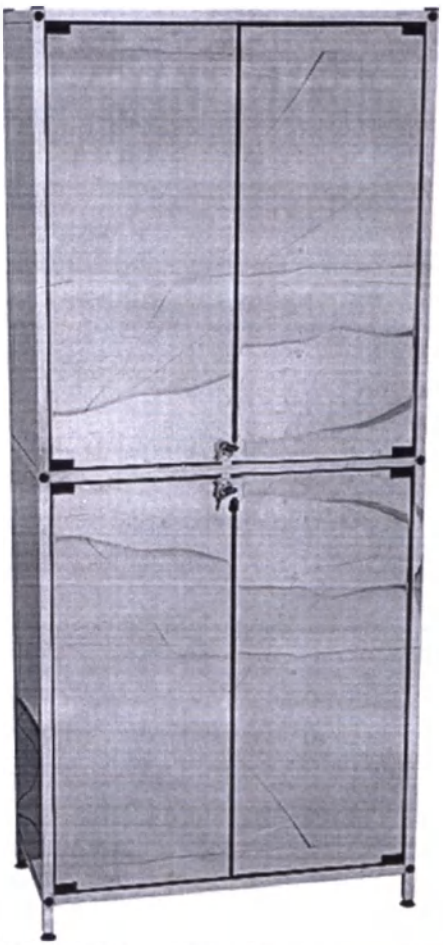

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-115/Н-ШК

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-115/Н-ШК** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	**700*360*1650**	**44±0,5**		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
Деталь		
СТ1	**Боковую стойка (левая и правая)**	2
П 5	Полка верхняя	1
П 6	Полка средняя	1
П 7	Полка нижняя	1
СТ 3	Задняя стенка	4
Д 2	Дверца (металл)	4
П 8	Полка вкладная (стекло)	4
Крепежные изделия		
	Саморез 4,2х13	26
	Саморез со сверлом 4,2х13	18
	U-образная петля (комплект на одну дверь)	4
	Замок-ручка	2

Эксплуатационная документация		
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной тонкостенный профиль из нержавеющей стали по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (каркас); Нержавеющая сталь по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 (полки) Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	44,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунках 1-2.

10.2 Каждую боковую стойку (левую и правую) **СТ 1** закрепить к верхней полке **П 5** четырьмя саморезами.

10.3 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к средней полке **П 6** восемью саморезами.

10.4 Каждую боковую стойку (левую и правую) закрепить к нижней полке **П 7** четырьмя саморезами.

10.5 С задней стороны собранной конструкции установить две задние стенки **СТ3** и закрепить их девятью саморезами к полкам **П 5, П 6, П7** .

10.6 В собранную конструкцию установить двери **Д2** с помощью U-образной петли, закрепить на них замки.

10.7 Внутрь шкафа уложить вкладные полки **П8**.

10.8 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Схема сборки для моделей шкафов
Э-113-ШК, Э-113/Н-ШК, Э-114-ШК, Э-114/Н-ШК, Э-115-ШК, Э-115/Н-ШК

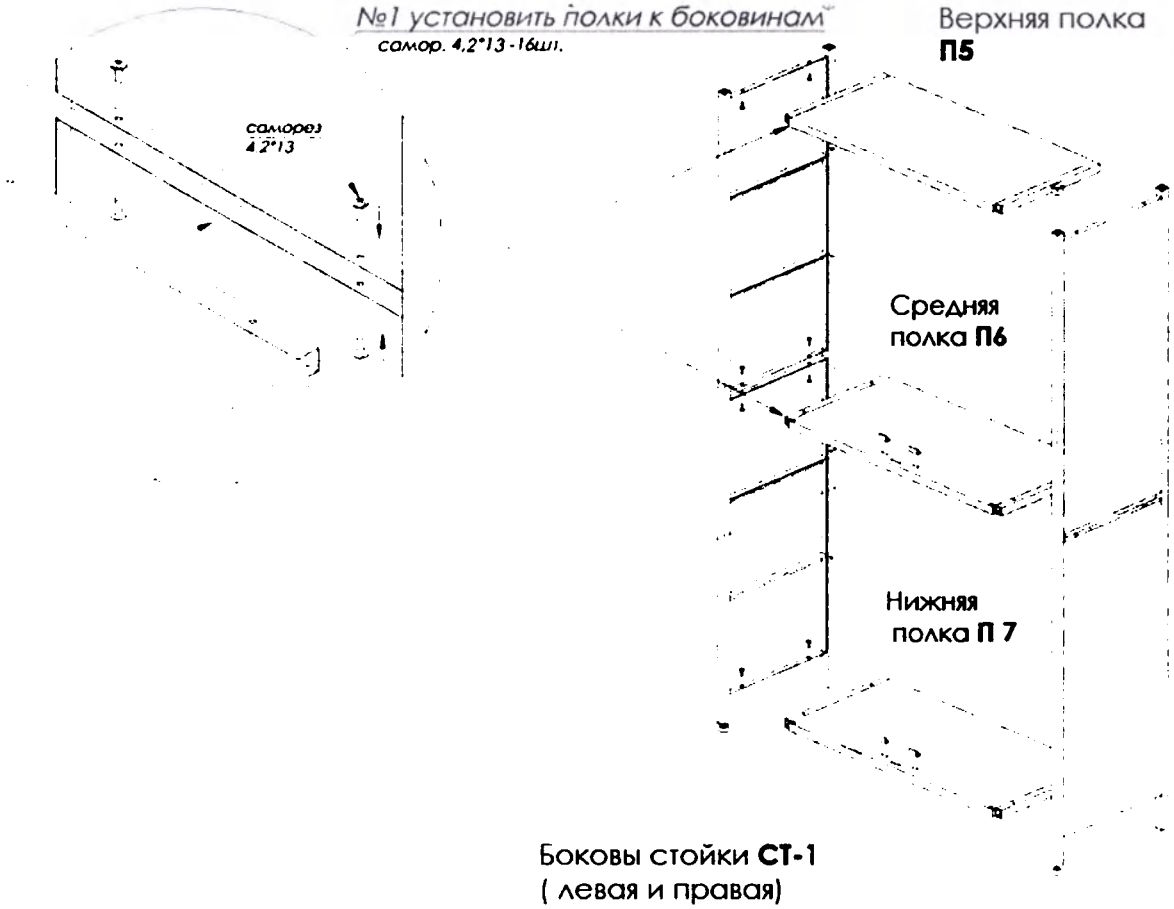

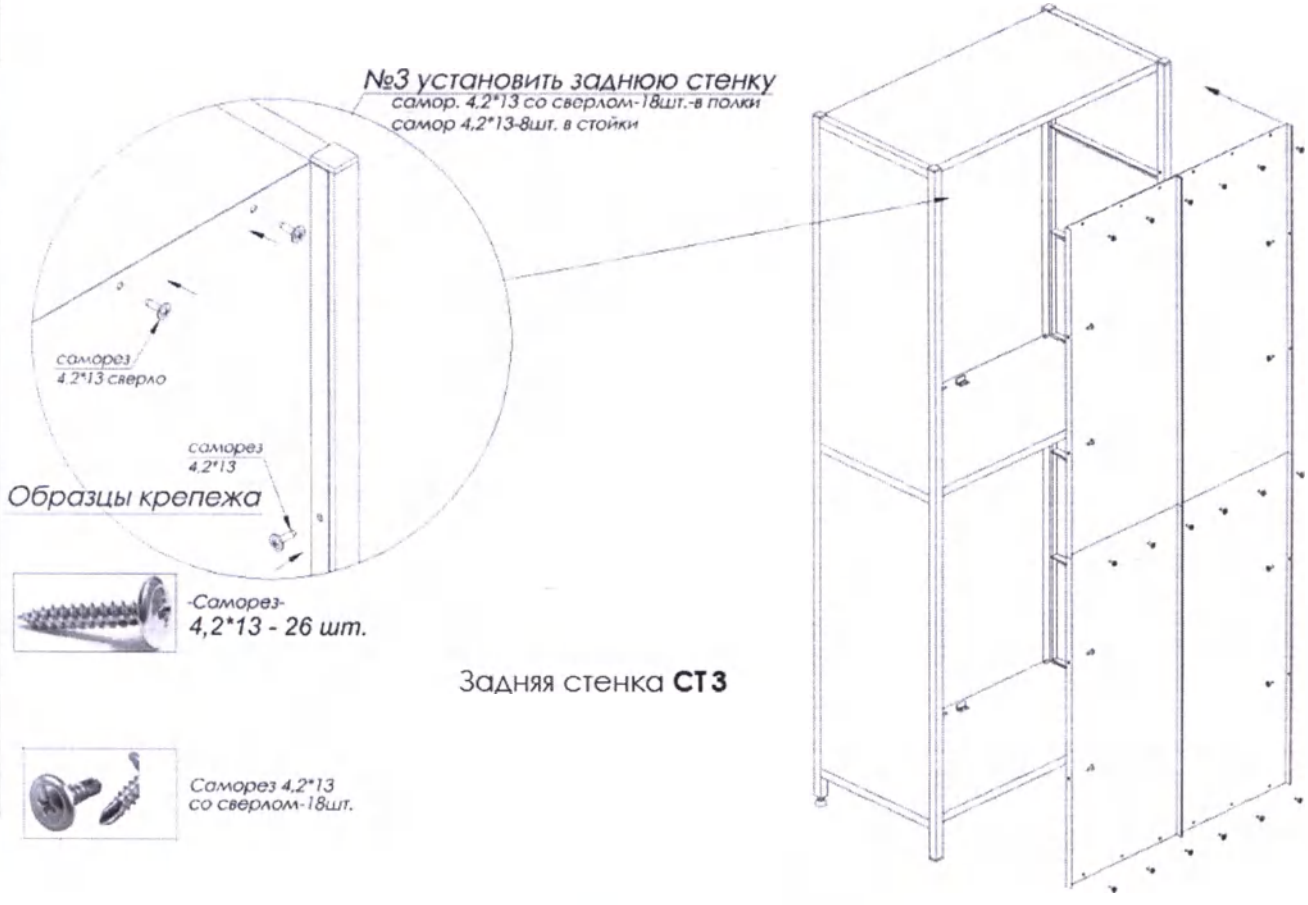

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Установка дверей

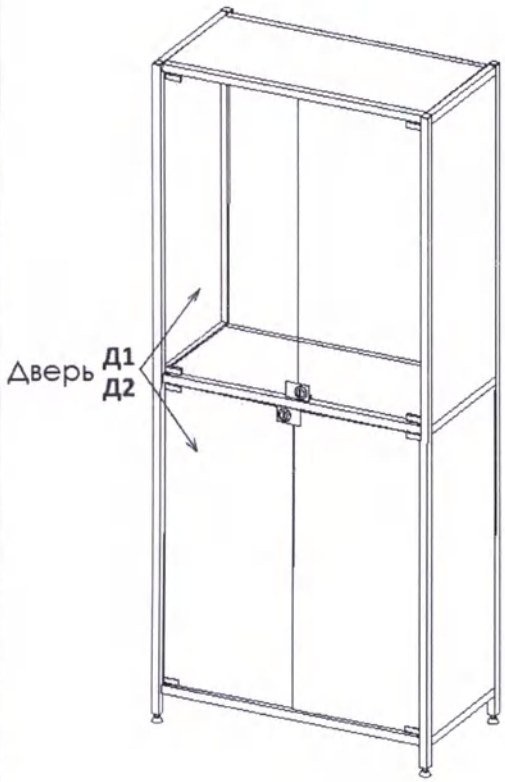

Установить пластиковые втулки, и U-образную петлю в отв. в полке (см. рисунок).
Затянуть крепежные винты, при необходимости отрегулировать зазоры.

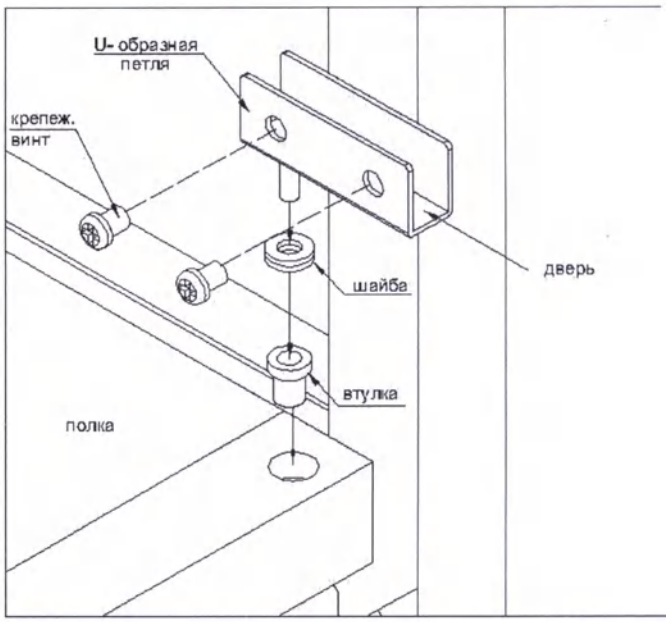

5. Установка замка

В отверстие в планке вставляются винты и прижимаю замок к стеклу через прокладку.

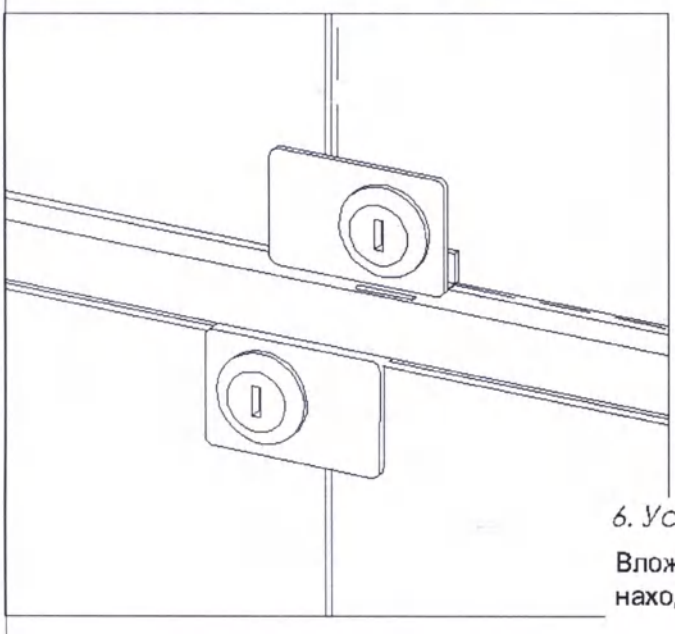

Замок для двух распашных дверей
Материал : металл
Применение : для стекла толщиной 4-5 мм
Монтаж : без сверления
Внимание ! Замок комплектуется ответной планкой

6. Установка полок

Вложить полки на полкодержатели, находящиеся на боковинах.

Рисунок 2. Порядок сборки изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу тходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации езвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических пециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-115/Н-ШК в количестве __________шт. принят в оответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-115/Н-ШК

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность Генеральный директор

Подпись _____ / Дрокин Э.

«27» июня 2023 года

М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

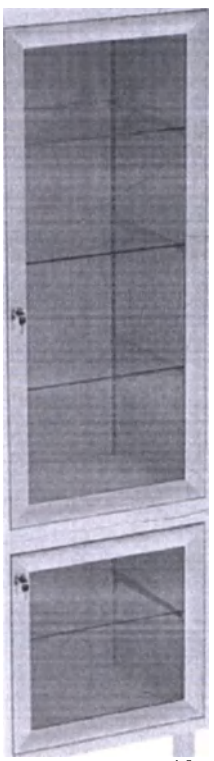

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-110-ШКП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-110-ШКП** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	**500*450*1900**	**56±0,5**		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
1	Секция нижняя	1
2	Секция верхняя	1
	Крепежные изделия	
3	Винт М6х30 DIN7420	4

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской - (каркас); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки, двери) Профиль из алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617 (двери)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	56,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунке 1.
10.2 Секцию верхнюю 2 установить на секцию нижнюю 1.
10.3 Выровнять.
10.4 Через открытую дверь секции 1 через соответствующие отверстия в верхней части винтами 3 М6х30 DIN7420 закрепить секцию 2.
10.5 Отрегулировать вертикальность шкафа опорами.
10.6 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

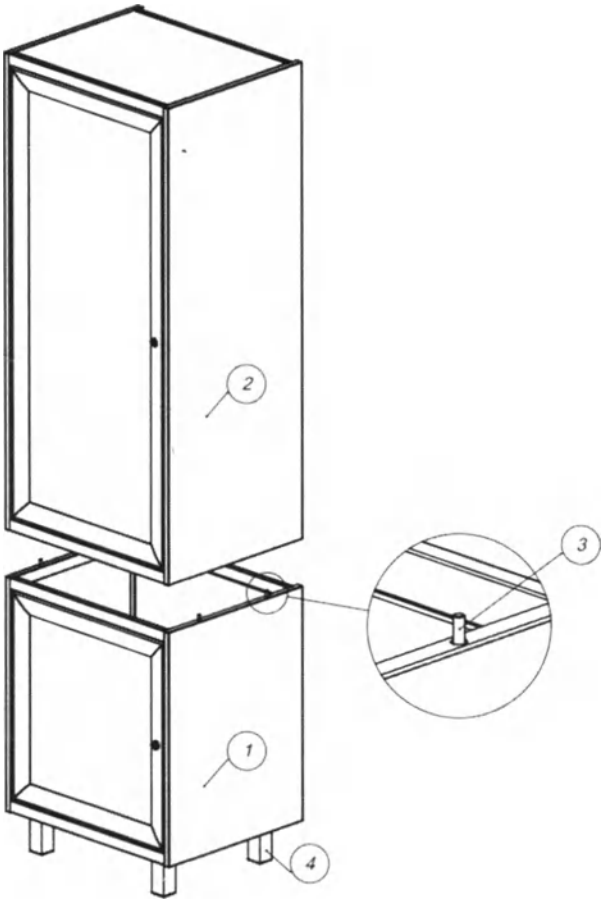

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.
13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-110-ШКП в количестве _____шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медицинских учреждений Э-110-ШКП
Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____20__ г.

Дата_____
Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и закреплено печатью 9
(девять) лист об

Генеральный директор

Дрокин Э.А.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

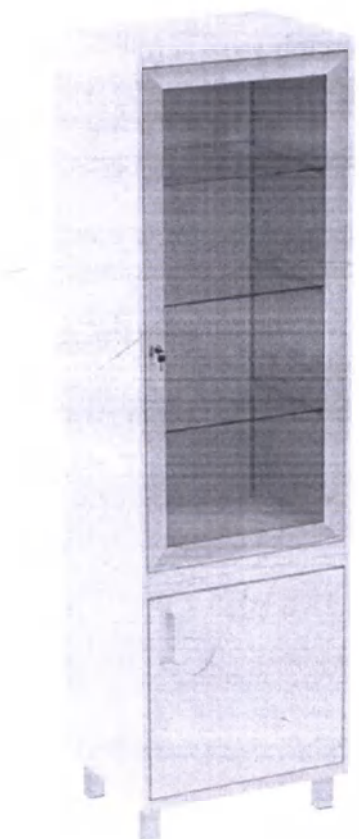

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-111-ШКП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-111-ШКП** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	**500*450*1900**	**58±0,5**		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
1	Секция нижняя	1
2	Секция верхняя	1
	Крепежные изделия	
3	Винт М6х30 DIN7420	4

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской - (каркас, дверь); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки, двери) Профиль из алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617 (дверь)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	58,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунке 1.
10.2 Секцию верхнюю 2 установить на секцию нижнюю 1.
10.3 Выровнять.
10.4 Через открытую дверь секции 1 через соответствующие отверстия в верхней части винтами 3 М6х30 DIN7420 закрепить секцию 2.
10.5 Отрегулировать вертикальность шкафа опорами.
10.6 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

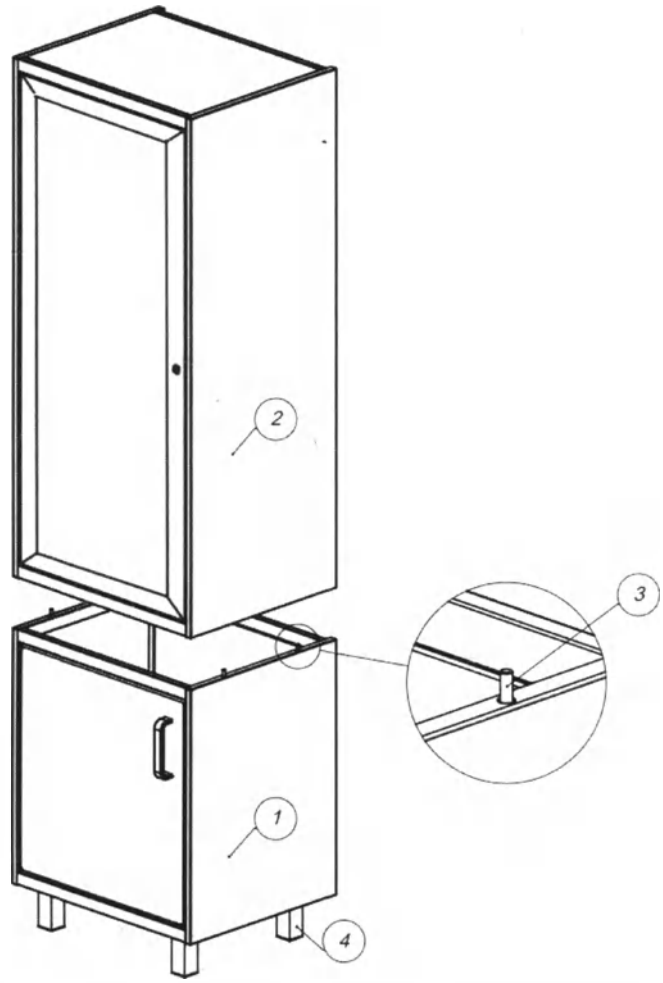

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих , при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо делие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-111-ШКП в количестве _____шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медицинских учреждений Э-111-ШКП
Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____20__ г.

Дата_____
Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и заверено печатью 9
(девять) лист об

Генеральный директор

Дрокин Э.А.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

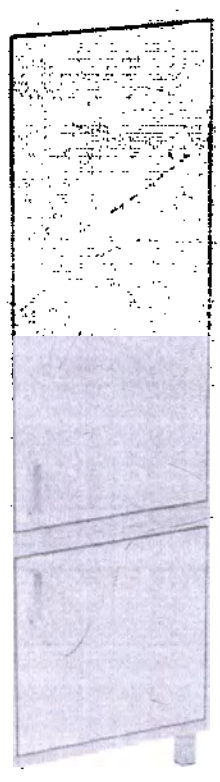

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-112-ШКП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-112-ШКП** далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	**500*450*1900**	**63±0,5**		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
1	Секция нижняя	1
2	Секция верхняя	1
	Крепежные изделия	
3	Винт М6х30 DIN7420	4

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской. - (каркас , двери); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	63,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунке 1.
10.2 Секцию верхнюю 2 установить на секцию нижнюю 1.
10.3 Выровнять.
10.4 Через открытую дверь секции 1 через соответствующие отверстия в верхней части винтами 3 М6х30 DIN7420 закрепить секцию 2.
10.5 Отрегулировать вертикальность шкафа опорами.
10.6 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

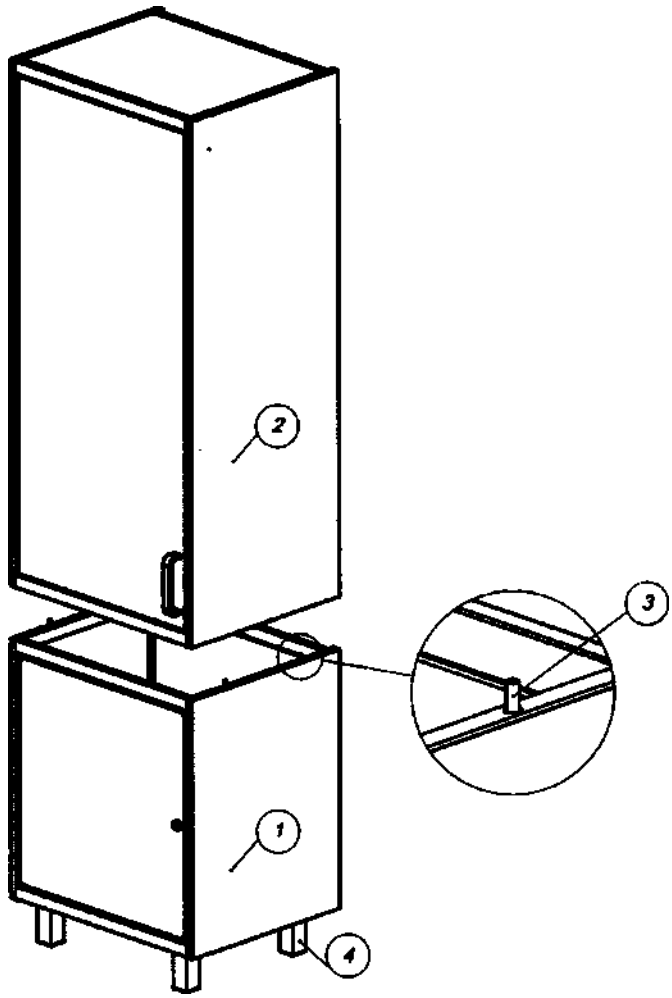

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации зевозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ıаделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической ɔмощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ıециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ɜрет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-112-ШКП в количестве __________шт. принят в ɔответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической ɔкументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП ______________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

- -

Шкаф для медицинских учреждений Э-112-ШКП

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и заверено печатью
9
(девять) лист[illegible]

Генеральный директор

Дроки З.А.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

_____Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

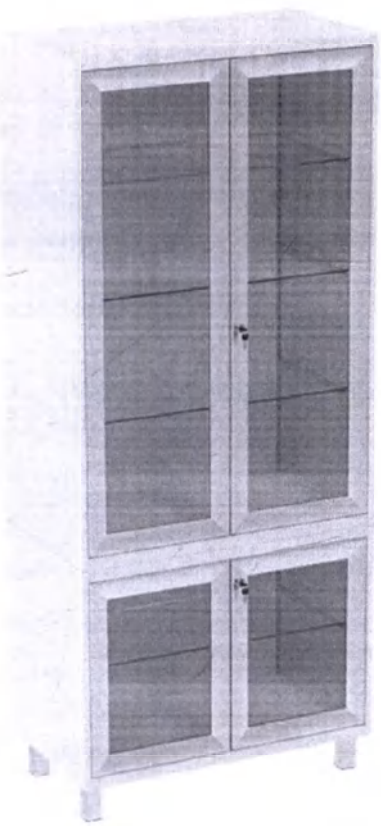

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-113-ШКП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-113-ШКП** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	**800*450*1900**	**77±0,5**		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
1	Секция нижняя	1
2	Секция верхняя	1
	Крепежные изделия	
3	Винт М6х30 DIN7420	4

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской. Листовая сталь по ГОСТ 9940- (каркас); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки, двери) Профиль из алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617 (двери)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	77,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунке 1.
10.2 Секцию верхнюю 2 установить на секцию нижнюю 1.
10.3 Выровнять.
10.4 Через открытую дверь секции 1 через соответствующие отверстия в верхней части винтами 3 M6x30 DIN7420 закрепить секцию 2.
10.5 Отрегулировать вертикальность шкафа опорами.
10.6 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

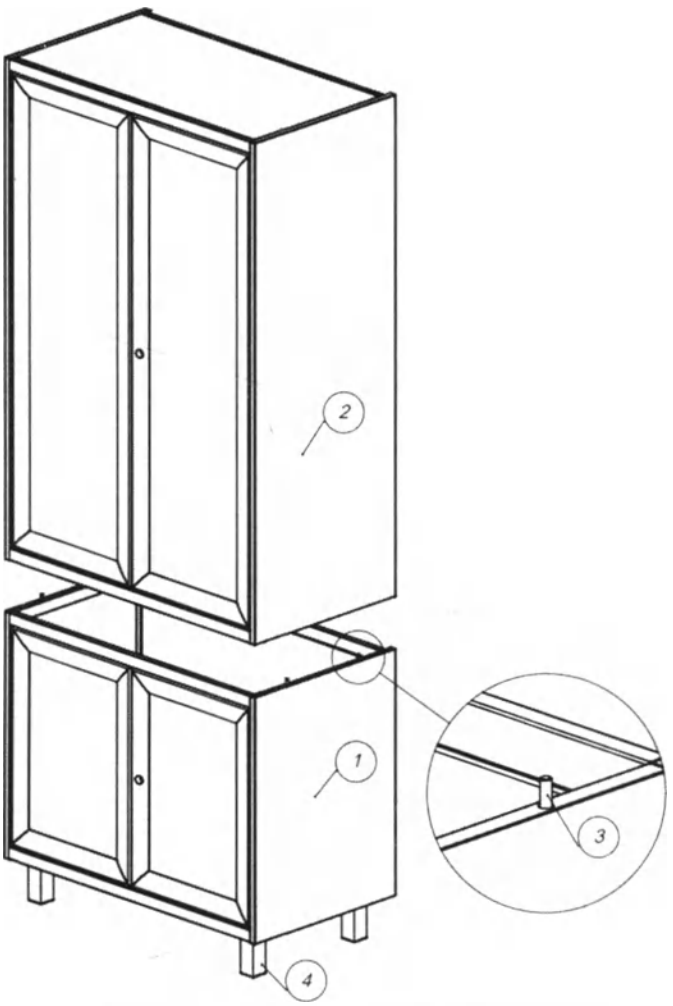

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при езинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке ли изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-113-ШКП в количестве _____шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медицинских учреждений Э-113-ШКП
Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____20__ г.

Дата_____
Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и заверено печатью 9
(девять) лист об

Генеральный директор
Дрокин Э.А.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

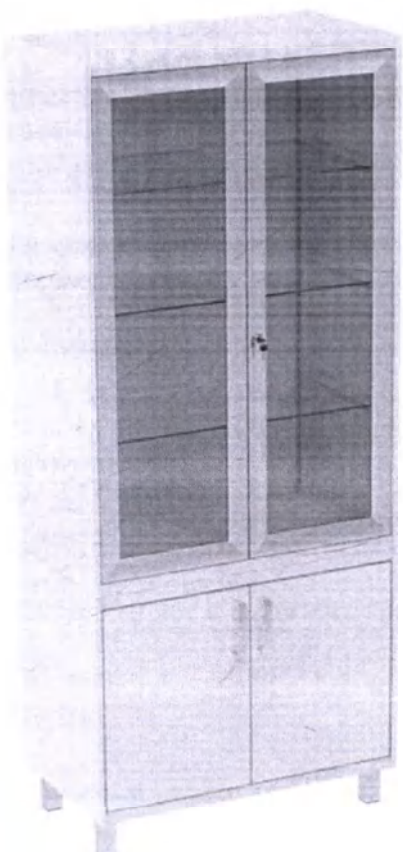

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-114-ШКП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-114-ШКП** (далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5		Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
2.2 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	**800*450*1900**	**78±0,5**		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	800*450*1900	79±0,5		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	Наименование детали и назначение	Кол-во, шт.
	Деталь	
1	Секция нижняя	1
2	Секция верхняя	1
	Крепежные изделия	
3	Винт М6х30 DIN7420	4

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской. Листовая сталь по ГОСТ 9940- (каркас, двери); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки, двери) Профиль из алюминиевых сплавов по ГОСТ 8617 (двери)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	78,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.

9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.

9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.

9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).

9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.

9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунке 1.

10.2 Секцию верхнюю 2 установить на секцию нижнюю 1.

10.3 Выровнять.

10.4 Через открытую дверь секции 1 через соответствующие отверстия в верхней части винтами 3 М6х30 DIN7420 закрепить секцию 2.

10.5 Отрегулировать вертикальность шкафа опорами.

10.6 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

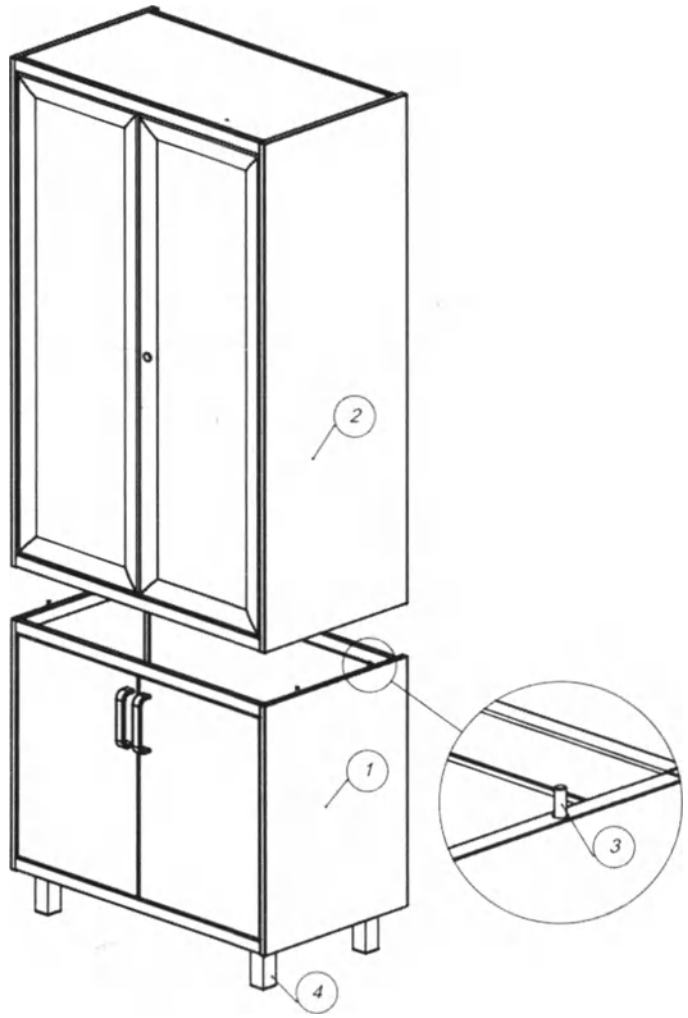

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция

Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси одорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.

11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие бразивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).

12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.

13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации езвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели аделец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической мощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических ециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец рет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-114-ШКП в количестве _____шт. принят в ответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической кументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Номер партии _____

Начальник ОТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медицинских учреждений Э-114-ШКП

Дата выпуска _____, партия _____

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»_____20__ г.

Дата_____

Начальник производства _____/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и заверено печатью 9
(девять) лист ов

Генеральный директор
Дрокин Э.А.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГОМЕДИКС"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эргомедикс»

Дрокин Э.А.

НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ КАБИНЕТА СЕСТРЫ-ХОЗЯЙКИ

по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020

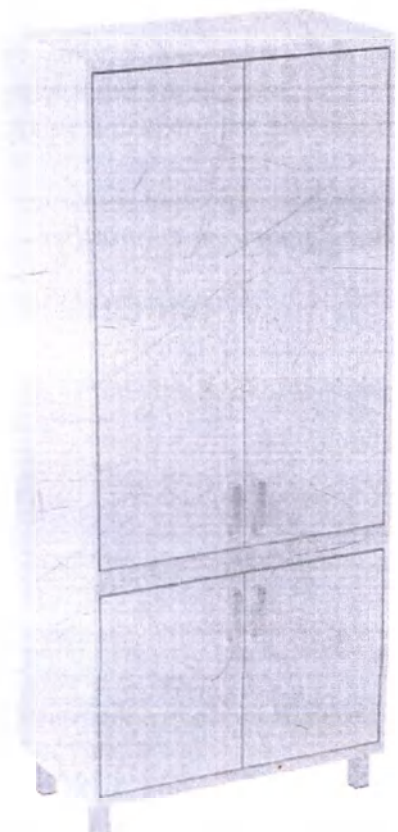

Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-115-ШКП

ПАСПОРТ

2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Наименование изделия: **Шкаф медицинский металлический двухсекционный Э-115-ШКП** далее – шкаф). Шкаф входит в состав **Набора мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки по ТУ 32.50.30-001-42494039-2020.**

1.2 Условия эксплуатации шкафа: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающей среды в диапазоне от 5°С до 30°С и относительной влажности окружающего воздуха до 70% при температуре 25°С.

1.3 По условиям воспринимаемых в процессе эксплуатации механических воздействий шкаф относится к группе 2 по классификации ГОСТ Р 50444, раздел 1.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской предназначен для оборудования специализированных медицинских кабинетов и палат с целью размещения, хранения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, или проведения медицинских процедур и осмотров.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки предназначен для оборудования сестринских кабинетов с целью размещения, хранения и удобного перемещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Шкаф предназначен для размещения лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и пациенты стационаров, реабилитационных, профилактических медицинских учреждений.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

При правильном транспортировании, хранении и использовании согласно указаниям данного руководства противопоказания отсутствуют.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы шкафа составляет 10 лет с даты изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эргомедикс»**
ОГРН: 1195476086585 ИНН: 5401996797.
Адрес: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, оф. 305/1.**
Почтовый адрес: **630082, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вавилова д. 7, кв. 7**
Адрес места производства: **630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комбинатская 10, пом. 1.**

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

7.1 Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки включает в себя:

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
2. Набор мебели медицинской для кабинета сестры-хозяйки					
2.1 Стеллаж передвижной медицинский	Э-048-СПЭ	700*500*1490	17,0±0,5	Не более 3 шт. (при необходимости)	Металлический каркас
	Э-048/Н-СПЭ	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-048-СП	700*500*1490	22,0±0,5		Металлический каркас

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-048-Н-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Металлический каркас, полка из нержавеющей стали
	Э-148-СП	550*340*1490	19,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения
	Э-248-СП	630*420*1490	22,0±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения
22 Тележка медицинская	Э-040-СПЭ	630*430*830	9,2±0,5	Не более 3 шт.	Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СПЭ	630*430*830	7,1±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СПЭ	630*430*830	9,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СПЭ	630*430*830	12,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СПЭ	630*430*830	11,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СПЭ	630*430*830	12±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СПЭ	630*430*830	10,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-047-СПЭ	630*430*830	17,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СПЭ	630*430*830	26,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СПЭ	630*430*830	34,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СПЭ	630*430*830	7,2±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СПЭ	630*430*830	9,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СПЭ	630*430*830	11,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СПЭ	630*430*830	12,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СПЭ	630*430*830	10,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СПЭ	630*430*830	17,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СПЭ	630*430*830	26,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СПЭ	630*430*830	34,6±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-040-СП	575*450*800	9,9±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-041-СП	575*450*800	9,3±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-042-СП	575*450*800	8,6±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-043-СП	575*450*800	13,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-044-СП	575*450*800	12,7±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-045-СП	575*450*800	12,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-046-СП	575*450*800	11,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 металлических поддона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-047-СП	575*450*800	15±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2-СП	575*450*800	23,2±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3-СП	575*450*800	31,4±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-041/Н-СП	575*450*800	9,4±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-042/Н-СП	575*450*800	8,7±0,5		Металлический каркас, 2 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-044/Н-СП	575*450*800	12,8±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 поддон из нержавеющей стали
	Э-045/Н-СП	575*450*800	12,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 поддона из нержавеющей стали
	Э-046/Н-СП	575*450*800	11,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 3 поддона из нержавеющей стали
	Э-047/Н-СП	575*450*800	15,1±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-047/2/Н-СП	575*450*800	23,3±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
	Э-047/3/Н-СП	575*450*800	31,5±0,5		Металлический каркас, 3 рамки, 2 поддона из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
	Э-140-СП	550*345*770	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-141-СП	550*345*770	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон
	Э-142-СП	550*345*770	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-143-СП	550*345*770	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-144-СП	550*345*770	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-145-СП	550*345*770	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-146-СП	550*345*770	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-147-СП	550*345*770	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-147/2-СП	550*345*770	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-147/3-СП	550*345*770	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали круглого сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
	Э-240-СП	630*420*860	12,85±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 полки из стекла
	Э-241-СП	630*420*860	11,95±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 1 полка из стекла, 1 металлический поддон

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-242-СП	630*420*860	11,14±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 2 рамки, 2 металлических поддона
	Э-243-СП	630*420*860	16,9±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 полки из стекла
	Э-244-СП	630*420*860	16±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 полки из стекла, 1 металлический поддон
	Э-245-СП	630*420*860	15,2±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 1 полка из стекла, 2 металлических поддона
	Э-246-СП	630*420*860	14,35±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 3 металлических поддона
	Э-247-СП	630*420*860	17,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 1 выдвижной ящик
	Э-247/2-СП	630*420*860	25,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 2 выдвижных ящика
	Э-247/3-СП	630*420*860	33,3±0,5		Каркас из нержавеющей стали прямоугольного сечения, 3 рамки, 2 металлических поддона, 3 выдвижных ящика
Стойка инфузионная для капельниц	Э-031-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	2,5±0,3	Не более 5 шт. (при необходимости)	Металлический каркас, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	3,6±0,3		Металлический каркас, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СР	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
	Э-031-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,5±0,3		Металлический каркас, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-032-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Высота: 1560.	3,3±0,3		Металлический каркас, 4 крючка для пакетов
	Э-131-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,8±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 2 подставки для бутылок и 2 крючка для пакетов
	Э-132-СИ	Диаметр трехлучья: 700; Регулируемая высота: 1100 – 2070 мм	4,4±0,3		Каркас из нержавеющей стали, регулируемая высота, 4 крючка для пакетов
Шкаф медицинский металлический двухсекционный	Э-110-ШКЭ	500*300*1650	32,7±0,5	Не более 3 шт.	Две стеклянные двери
	Э-111-ШКЭ	500*300*1650	30,0±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШКЭ	500*300*1650	31,9±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 стеклянные двери

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование	Обозначение вариантов исполнений	Размеры, (ширина* глубина*высота), мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Конструктивные особенности
	Э-114-ШКЭ	650*300*1650	37±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШКЭ	650*300*1650	38±0,5		4 металлические двери
	Э-110-ШК	570*360*1650	41±0,5		Две стеклянные двери
	Э-111-ШК	570*360*1650	40±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь
	Э-112-ШК	570*360*1650	37±0,5		2 металлические двери
	Э-113-ШК	700*360*1650	52,7±0,5		4 стеклянные двери
	Э-114-ШК	700*360*1650	46,6±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери
	Э-115-ШК	700*360*1650	43±0,5		4 металлические двери
	Э-110/Н-ШК	570*360*1650	42±0,5		Две стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-111/Н -ШК	570*360*1650	41±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, каркас из нержавеющей стали
	Э-112/Н -ШК	570*360*1650	38±0,5		2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-113/Н -ШК	700*360*1650	53,7±0,5		4 стеклянные двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-114/Н -ШК	700*360*1650	47,5±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-115/Н -ШК	700*360*1650	44±0,5		4 металлические двери, каркас из нержавеющей стали
	Э-110-ШКП	500*450*1900	56±0,5		Две стеклянные двери, усиленные полки
	Э-111-ШКП	500*450*1900	58±0,5		1 стеклянная дверь, 1 металлическая дверь, усиленные полки
	Э-112-ШКП	500*450*1900	63±0,5		2 металлические двери, усиленные полки
	Э-113-ШКП	800*450*1900	77±0,5		4 стеклянные двери, усиленные полки
	Э-114-ШКП	800*450*1900	78±0,5		2 стеклянные двери, 2 металлические двери, усиленные полки
	Э-115-ШКП	**800*450*1900**	**79±0,5**		4 металлические двери, усиленные полки

7.2 Комплектация поставки шкафа:

Обозначение	**Наименование детали и назначение**	**Кол-во, шт.**
	Деталь	
1	Секция нижняя	1
2	Секция верхняя	1
	Крепежные изделия	
3	Винт М6х30 DIN7420	4

	Эксплуатационная документация	
	Руководство по эксплуатации	1
	Паспорт	1

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЩИЙ ВИД

8.1 Основные технические характеристики

Наименование параметра	**Значение**
Используемые материалы	Стальной профиль по ГОСТ 13663 и/или ГОСТ 9940, листовая сталь по ГОСТ 9940 с покрытием порошковой эпоксиполиэфирной краской - (каркас двери); Стекло листовое бесцветное по ГОСТ 111 (полки)
Номинальное отклонение габаритных размеров, не более, мм	4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование параметра	Значение
Климатический класс	УХЛ 4.2
Температура окружающей среды при эксплуатации, ^{0}C	5 - 30
Масса нетто, кг	79,0±0,5
Назначенный срок службы, лет	10

9. ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

9.1 После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в условиях положительных температур в течение 24 часов.
9.2 Детали шкафа освободить от упаковочной пленки, убедиться в целостности.
9.3 Проверить комплектность согласно спецификации поставки.
9.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки подобных поверхностей (см. раздел 11).
9.5 Подготовить инструмент: шуруповерт с шестигранной битой или отвертку крестовую.
9.6 Для сборки изделия не требуется специальной квалификации. Самостоятельная сборка изделия покупателем не влияет на гарантийные обязательства, изложенные в разделе 13, при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Сборку необходимо осуществлять строго по схеме, изложенной в разделе 10.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10.1 Схема сборки шкафа показана на рисунке 1.
10.2 Секцию верхнюю 2 установить на секцию нижнюю 1.
10.3 Выровнять.
10.4 Через открытую дверь секции 1 через соответствующие отверстия в верхней части винтами 3 М6х30 DIN7420 закрепить секцию 2.
10.5 Отрегулировать вертикальность шкафа опорами.
10.6 Шкаф готов к эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

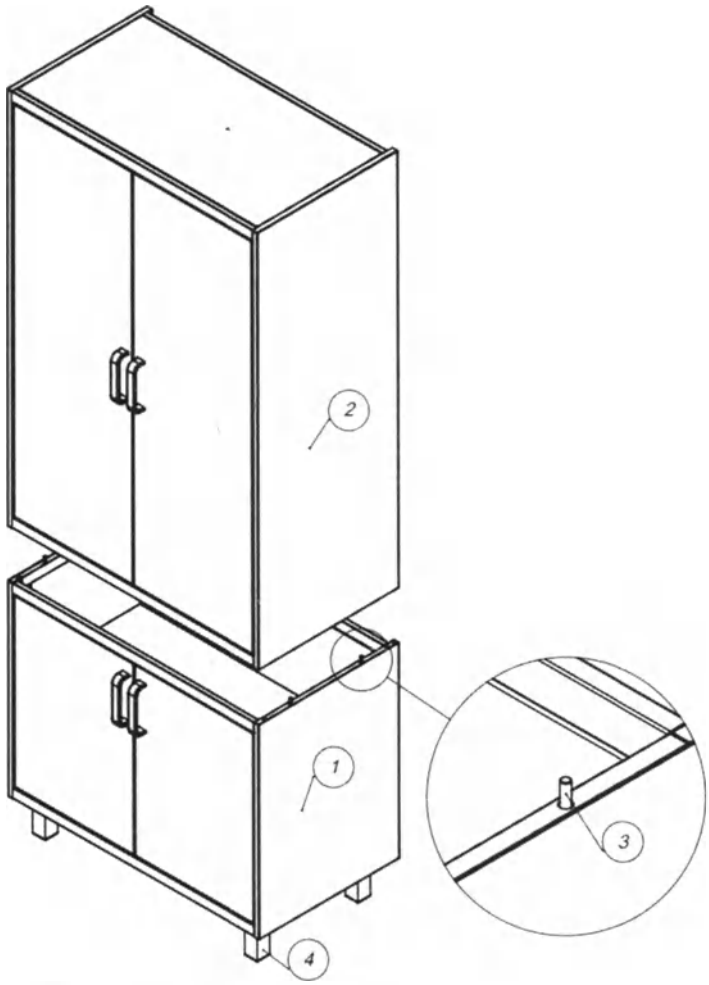

Рисунок 1. Порядок сборки изделия

11. ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ

11.1 Текущая дезинфекция
Способ обработки: шкаф обрабатывается 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси дорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства, применяемым при зинфекции.
11.2 Для удаления загрязнений рекомендуется использовать моющие средства, не содержащие разивные материалы и органические растворители.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ

12.1 Изделия утилизируются в соответствии с СП 2.1.7.1386 и СанПиН 2.1.3684 (по классу ходов А).
12.2 Хранить подлежащее утилизации изделие допускается на открытой контейнерной площадке и изолированном помещении в корпусе ЛПУ.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие изделий мебели требованиям настоящих У, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
13.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления мебели.
13.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации звозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части изделий, либо зделие полностью, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации в случае выявления дефектов мебели ладелец может обратиться на предприятие-изготовитель за квалифицированной технической омощью (за денежное вознаграждение), или же воспользоваться услугами иных технических тециалистов (при этом всю ответственность за внесенные изменения в процессе ремонта владелец ерет на себя).

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф для медицинских учреждений Э-115-ШКП в количестве __________шт. принят в ютветствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической окументации и признана годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________ Номер партии _____________

Начальник ОТК

МП _____________________ ___________________

личная подпись расшифровка подписи

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Шкаф для медицинских учреждений Э-115-ШКП

Дата выпуска ____________, партия ____________

товарная накладная отсутствует (образец) № ___ от «___»__________20__ г.

Дата______________

Начальник производства _______________/ФИО/

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и заверено печатью 9
(девять) лист об

Генеральный директор

Дрокин Э.А.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU