

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МатриксМед»

Пироев В.Г.

«16» июля 2024 г.




**Периметр автоматический АПП/СДН по ТУ 26.60.12-001-32631898-
2019, варианты исполнения**

Фотографические изображения

Периметр автоматический АПП/СДП, вид спереди




Периметр автоматический АПП/СДП, вид сбоку

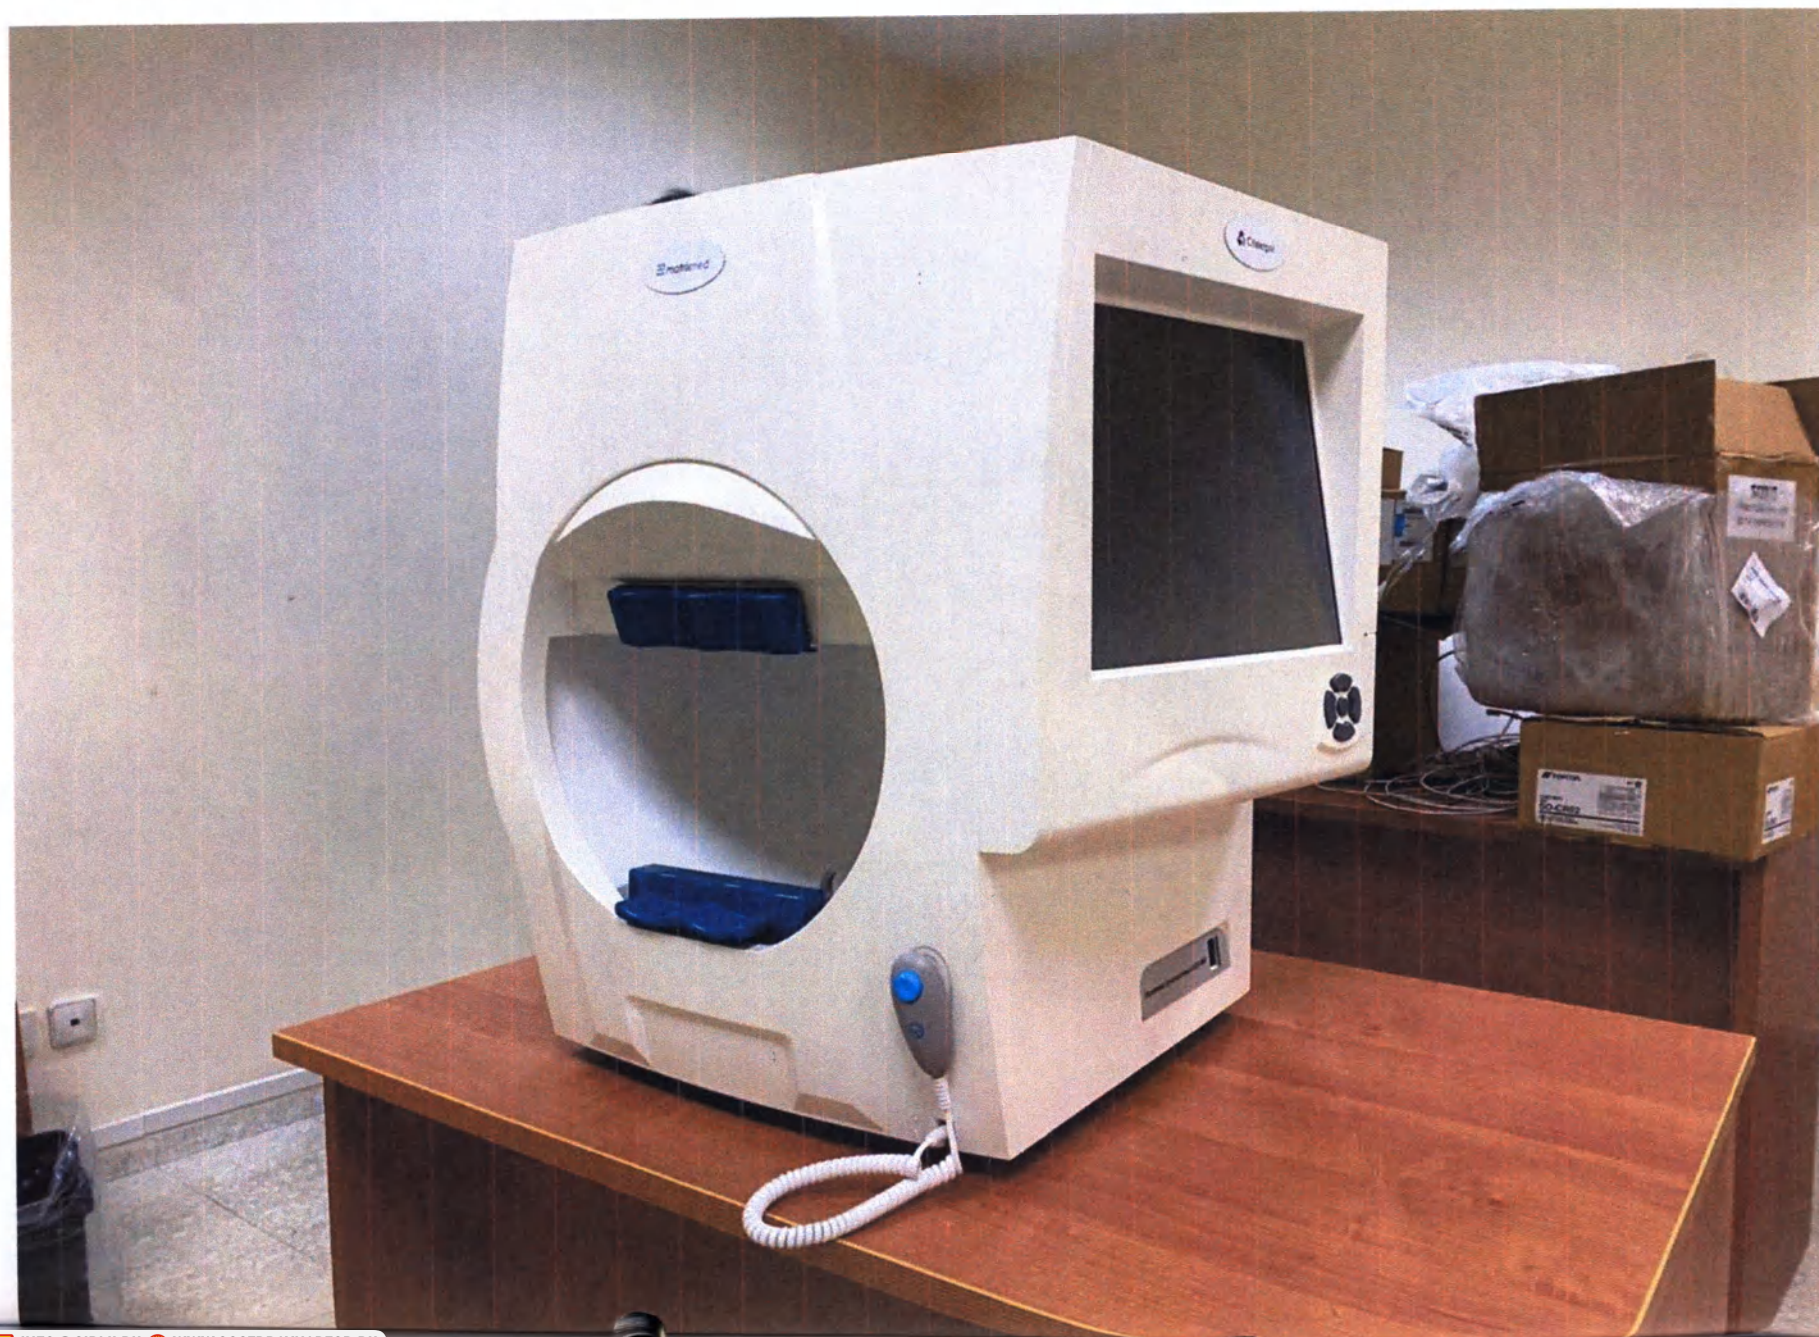


Периметр автоматический АПП/СДП: Опоры для лба и подбородка



Периметр автоматический АПП/СДП, опоры для лба и подбородка, устройство для контроля положения зрачка

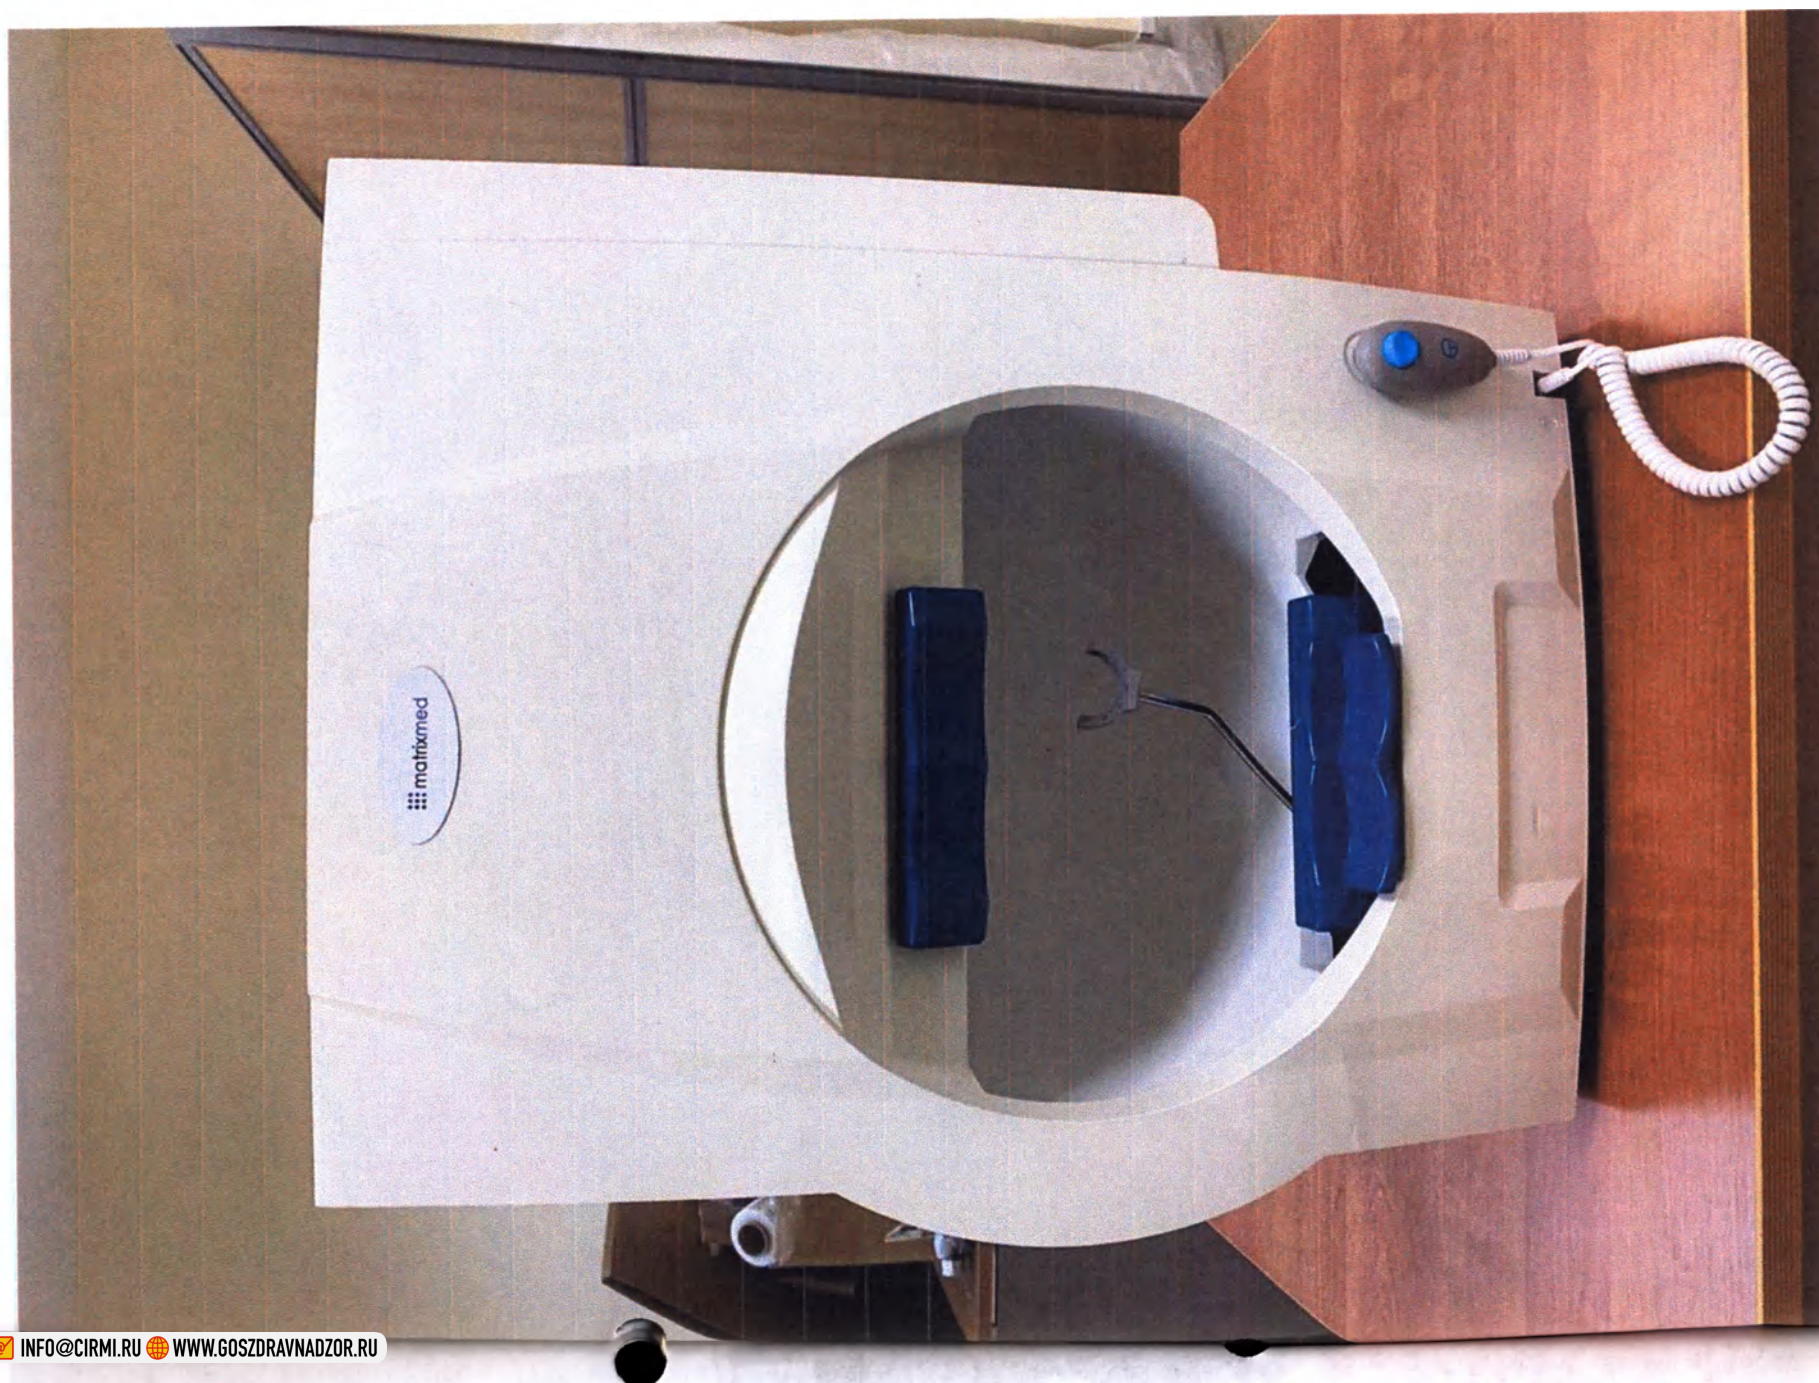

Периметр автоматический АПП/СДП, вид сбоку.

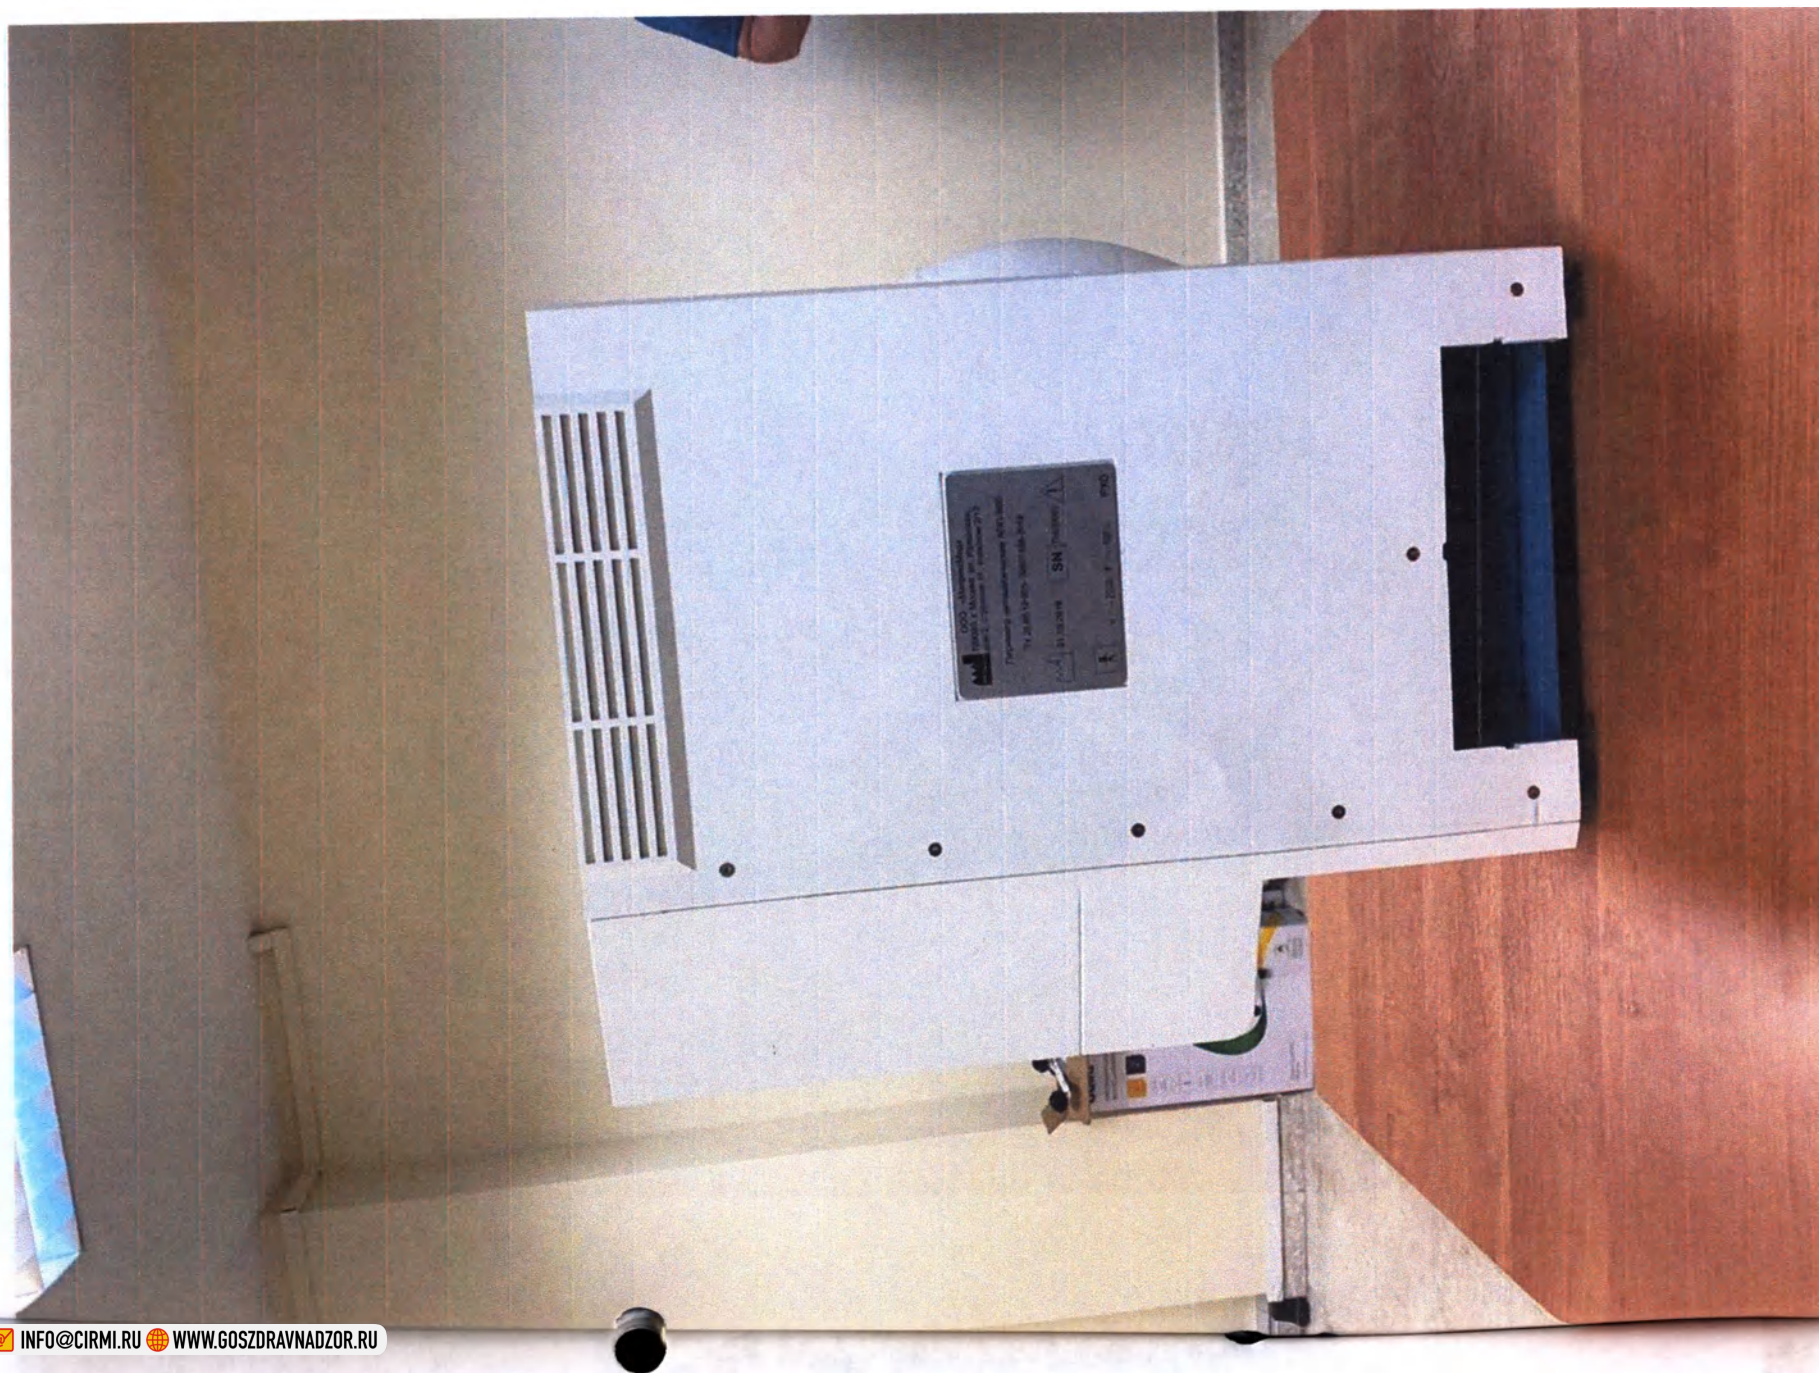

Периметр автоматический АПП, маркировка




ООО "МатриксМед"
115230, г. Москва, Электролитный проезд,
дом 3, строение 2, помещение 21

Периметр автоматический АПП-960
ТУ 26.60.12-001-32631898-2019



SN

500001




V ~ 220В

f ~ 50Гц

IP20

Периметр автоматический АПП/СДП, вид сзади

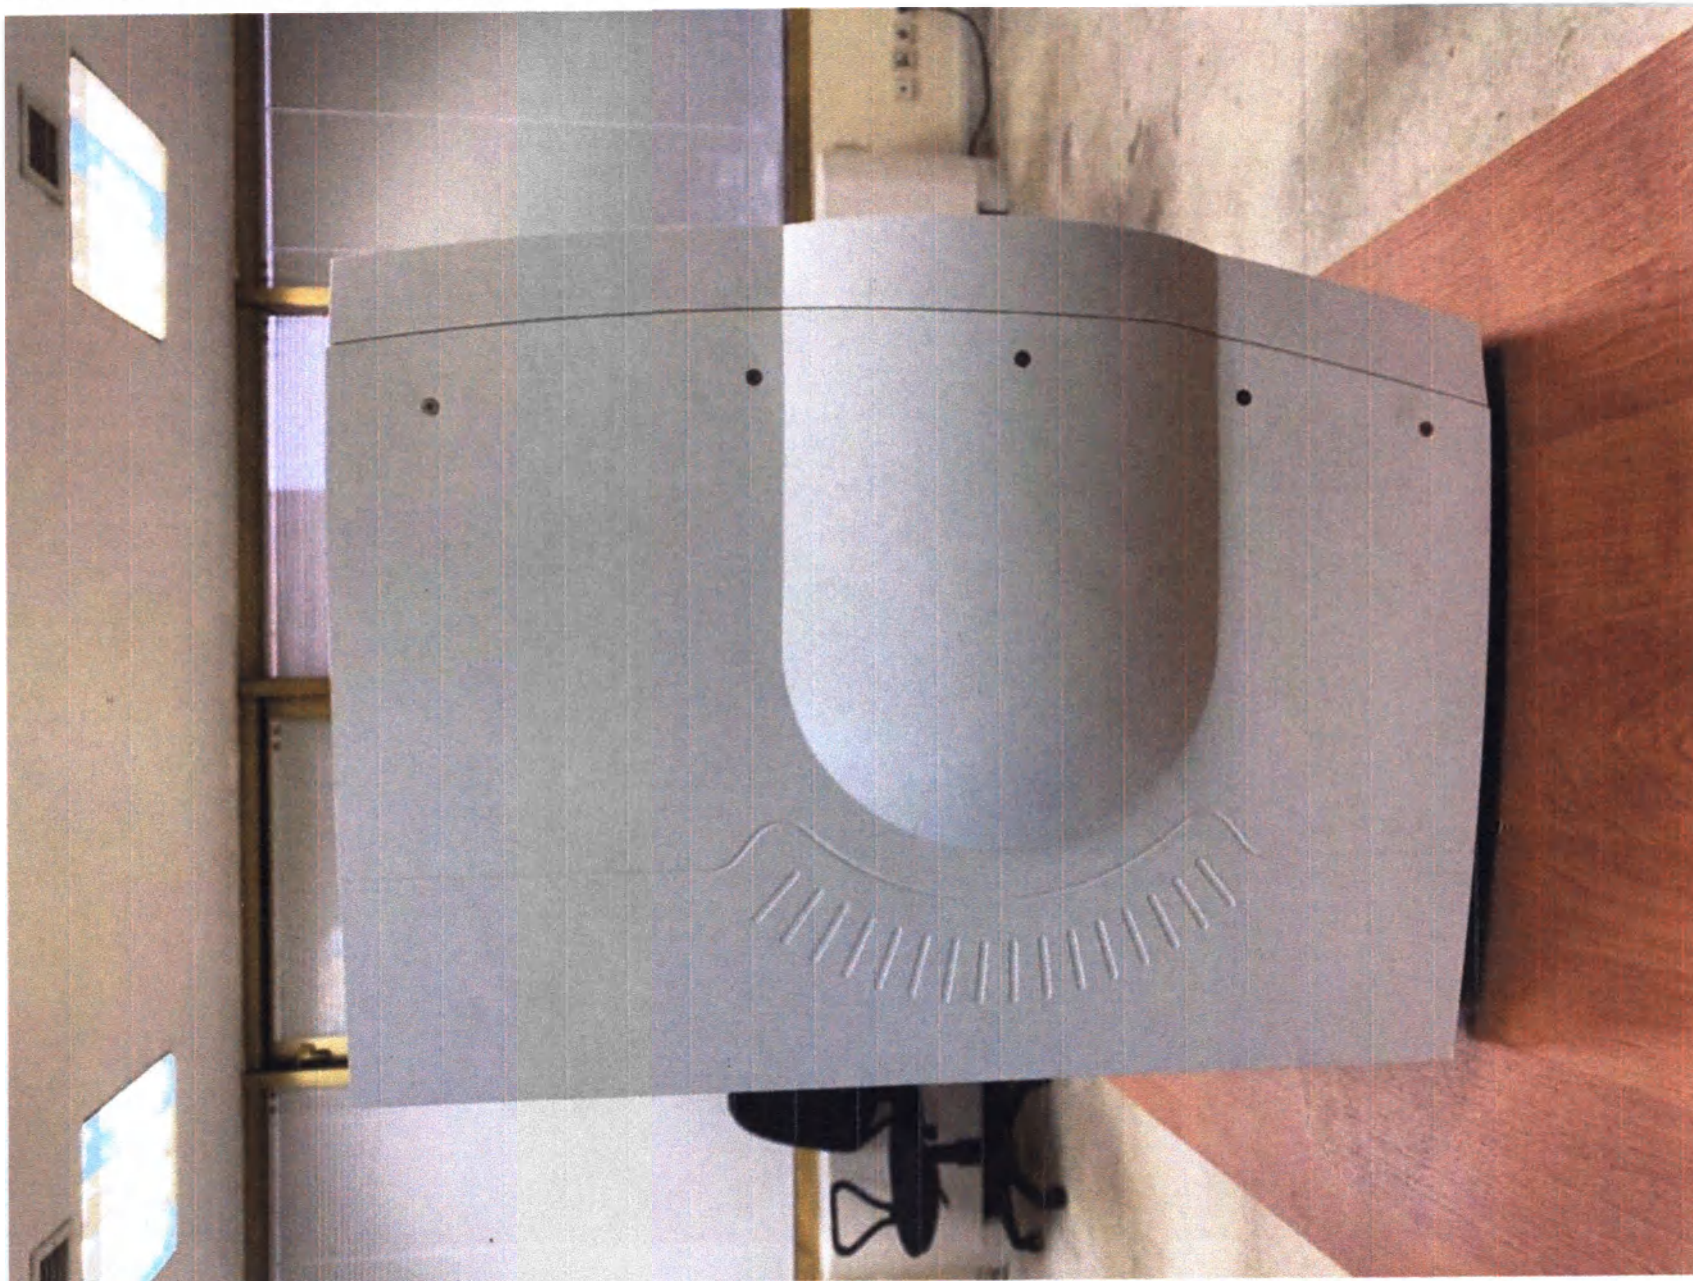

Кнопка для регистрации ответа пациента



Внешний вид транспортной тары.





