



Общество с ограниченной ответственностью «Эй энд Ди РУС»
Юр. адрес: 117545 г. Москва, ул. Дорожная, д.3, корп.6, комн. 86
Почтовый адрес: 121357 г. Москва, ул. Вере́йская, д. 17
Телефон: +7 (495) 937-3344, факс: +7 (495) 937-5566
E-mail: info@and-rus.ru, www.and-rus.ru
ОГРН 1067746787294
ИНН 7731547200

ПОДТВЕРЖДАЮ
Операционный директор
ООО «Эй энд Ди РУС»
Исаенков А.А.

«29»

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ И МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

«Монитор артериального давления и частоты пульса суточный, модели: ТМ-2430,
ТМ-2440, ТМ-2441 с принадлежностями»

Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430: Общий вид



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный TM-2430:
Монитор-основной блок в корпусе**



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:
Монитор-основной блок в корпусе



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:
Монитор-основной блок в корпусе**



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:
Ремень**



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:
Наплечный пояс**



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:
Манжета (стандартная) для взрослых для левой руки**



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:
Зажим



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:
Элемент питания



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:
Руководство по эксплуатации**




The TM-2430 Ambulatory Blood Pressure Monitor

For your information

Blood pressure value changes depending upon physical activity. By knowing variability of blood pressure for 24 hrs of day, you can know BP value in each condition, and effectiveness of antihypertensive treatment. Therefore, since this Activity Record will be an important document, please read the contents of this sheet carefully, and fill in the Activity Record in accordance with the instructions.

How to operate TM-2430

Basically, TM-2430 is fully automatic. However there are some cases when measurements have to be interrupted for batching.



[A] mark

- This mark is displayed when the device is in measurement mode.

[B] mark

- This mark is displayed when the device is in standby mode.

[S] mark

- This mark is displayed when the device is in interval measurement mode.

re Monitor

the patient.

Technical information on

Read the contents of the manual mentioned.

It may be helpful to know the following similar activities.

to matic measure-

y is low.

Interval measurement mode

Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:

Принадлежность:

Чехол на манжету



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:

Принадлежность:

Чехол (кейс) для переноски



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430:
Макет упаковки



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2430

Производитель:

A&D Company, Limited, 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, 3-23-14, Хигаши-Икебукуро, Тошима-ку, Токио, 170-0013, Япония

Место производства:

1) A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, 1-243 Асахи, Китамото-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония;

2) A&D Manufacturing Company, Limited (Tsukuba Factory), 4210-15, Takasai, Shimotsuma-shi, Ibaraki-ken, 304-0031, Japan / Эй энд Ди Мануфэкчеринг Компани, Лимитед (Цукуба Фэктори), 4210-15, Такасаи, Шимотсума-ши, Ибараки-кен, 304-0031, Япония.

Импортер:

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», Россия, 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д.3, к.6, ком. 86.

Бесплатный телефон горячей линии: **8 800-200-03-80.**

Отзывы и предложения оставляйте на **www.and-rus.ru**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/221 от XX.XX.2023 г.

Штрих-код

Упаковано: месяц, год



МОНИТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА СУТОЧНЫЙ

МОДЕЛЬ: ТМ-2430

Диапазон измерений: 40-280 мм рт.ст.

Питание:  3.6В 3x1.2В AA NiMH
 4.5В 3x1.5В AA LR6

A&D

Разработано "A&D Company, Limited", Япония
Сделано в Японии.



IP20



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный TM-2440:
Общий вид



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Монитор-основной блок в корпусе**



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Монитор-основной блок в корпусе



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Монитор-основной блок в корпусе**



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Манжета (стандартная) для взрослых для левой руки**




Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:


Ремень



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Зажим**

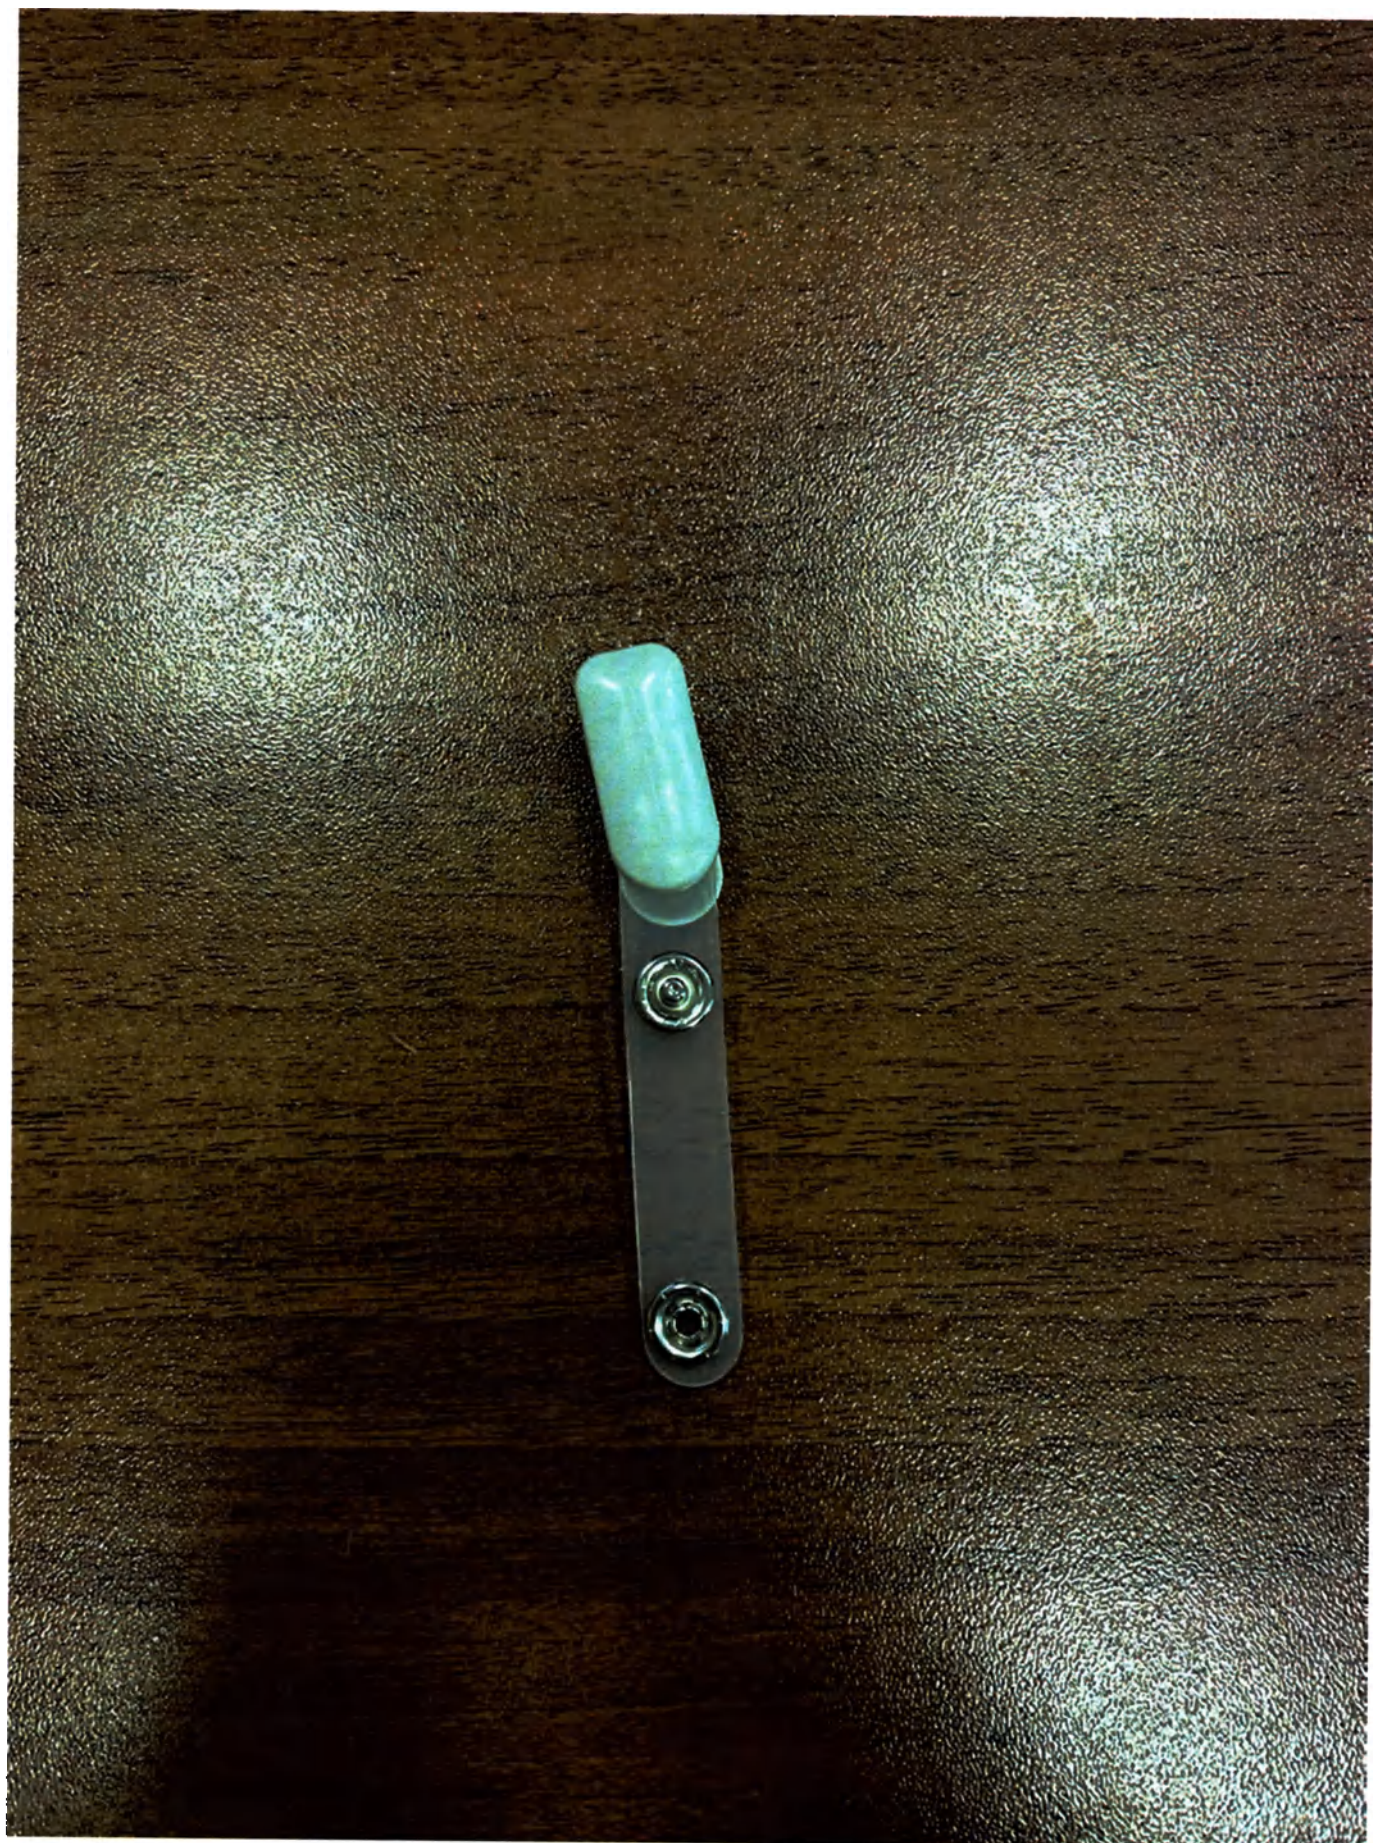

**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Элемент питания**

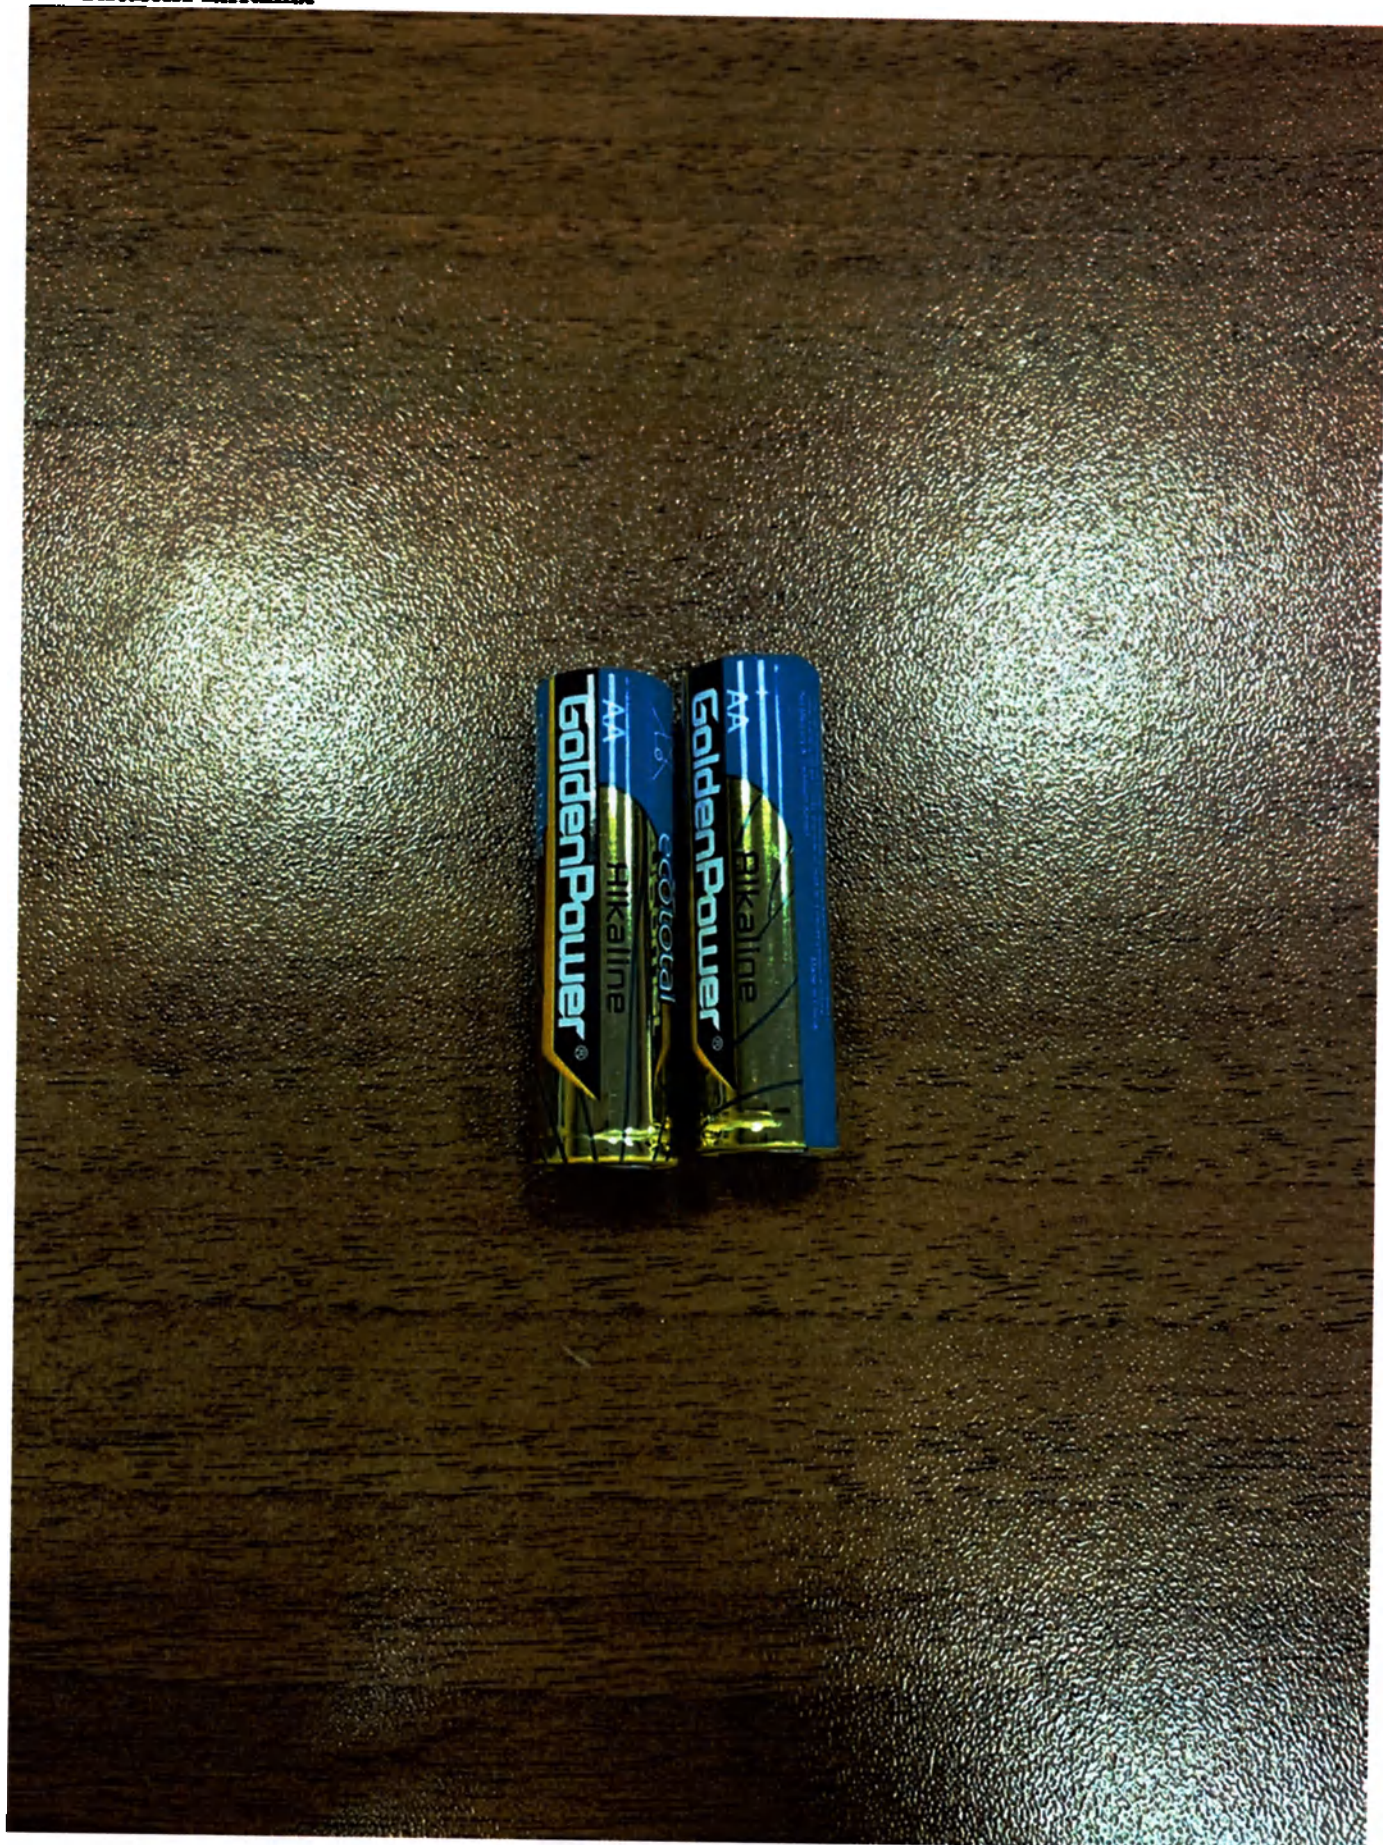


**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Руководство по эксплуатации**



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный TM-2440

Принадлежность:

Лист записи

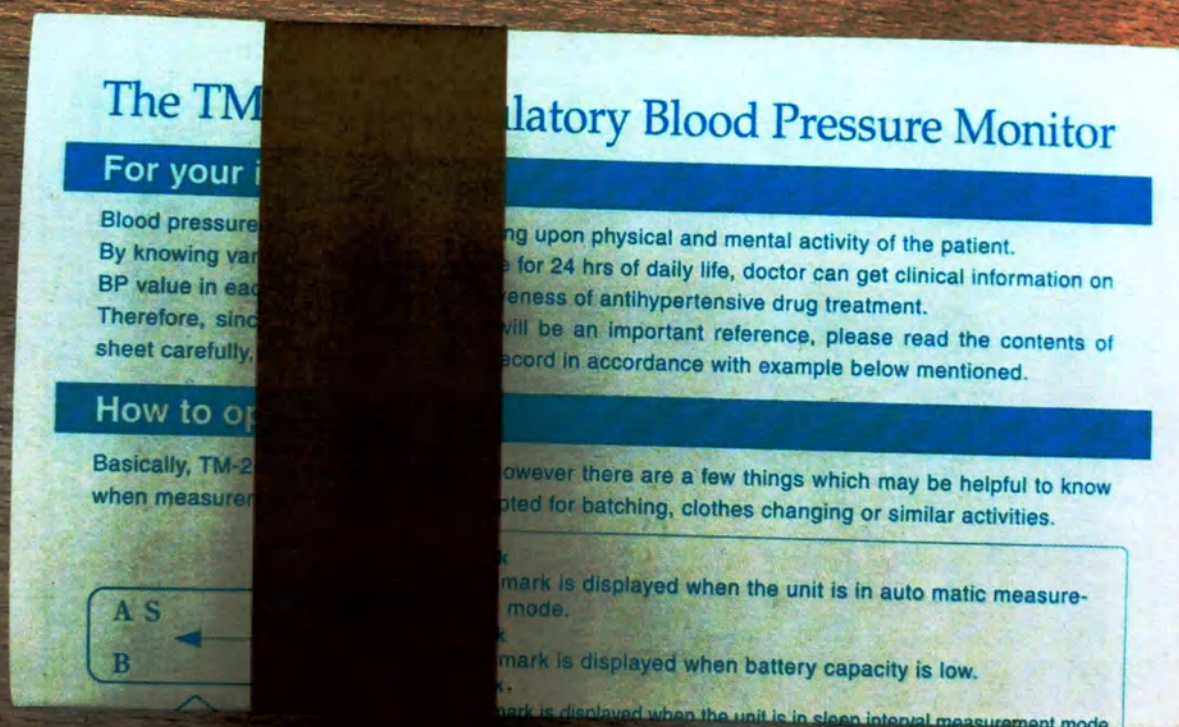


Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:

Принадлежность:


Чехол на манжету




Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Принадлежность:
Чехол (кейс) для переноски

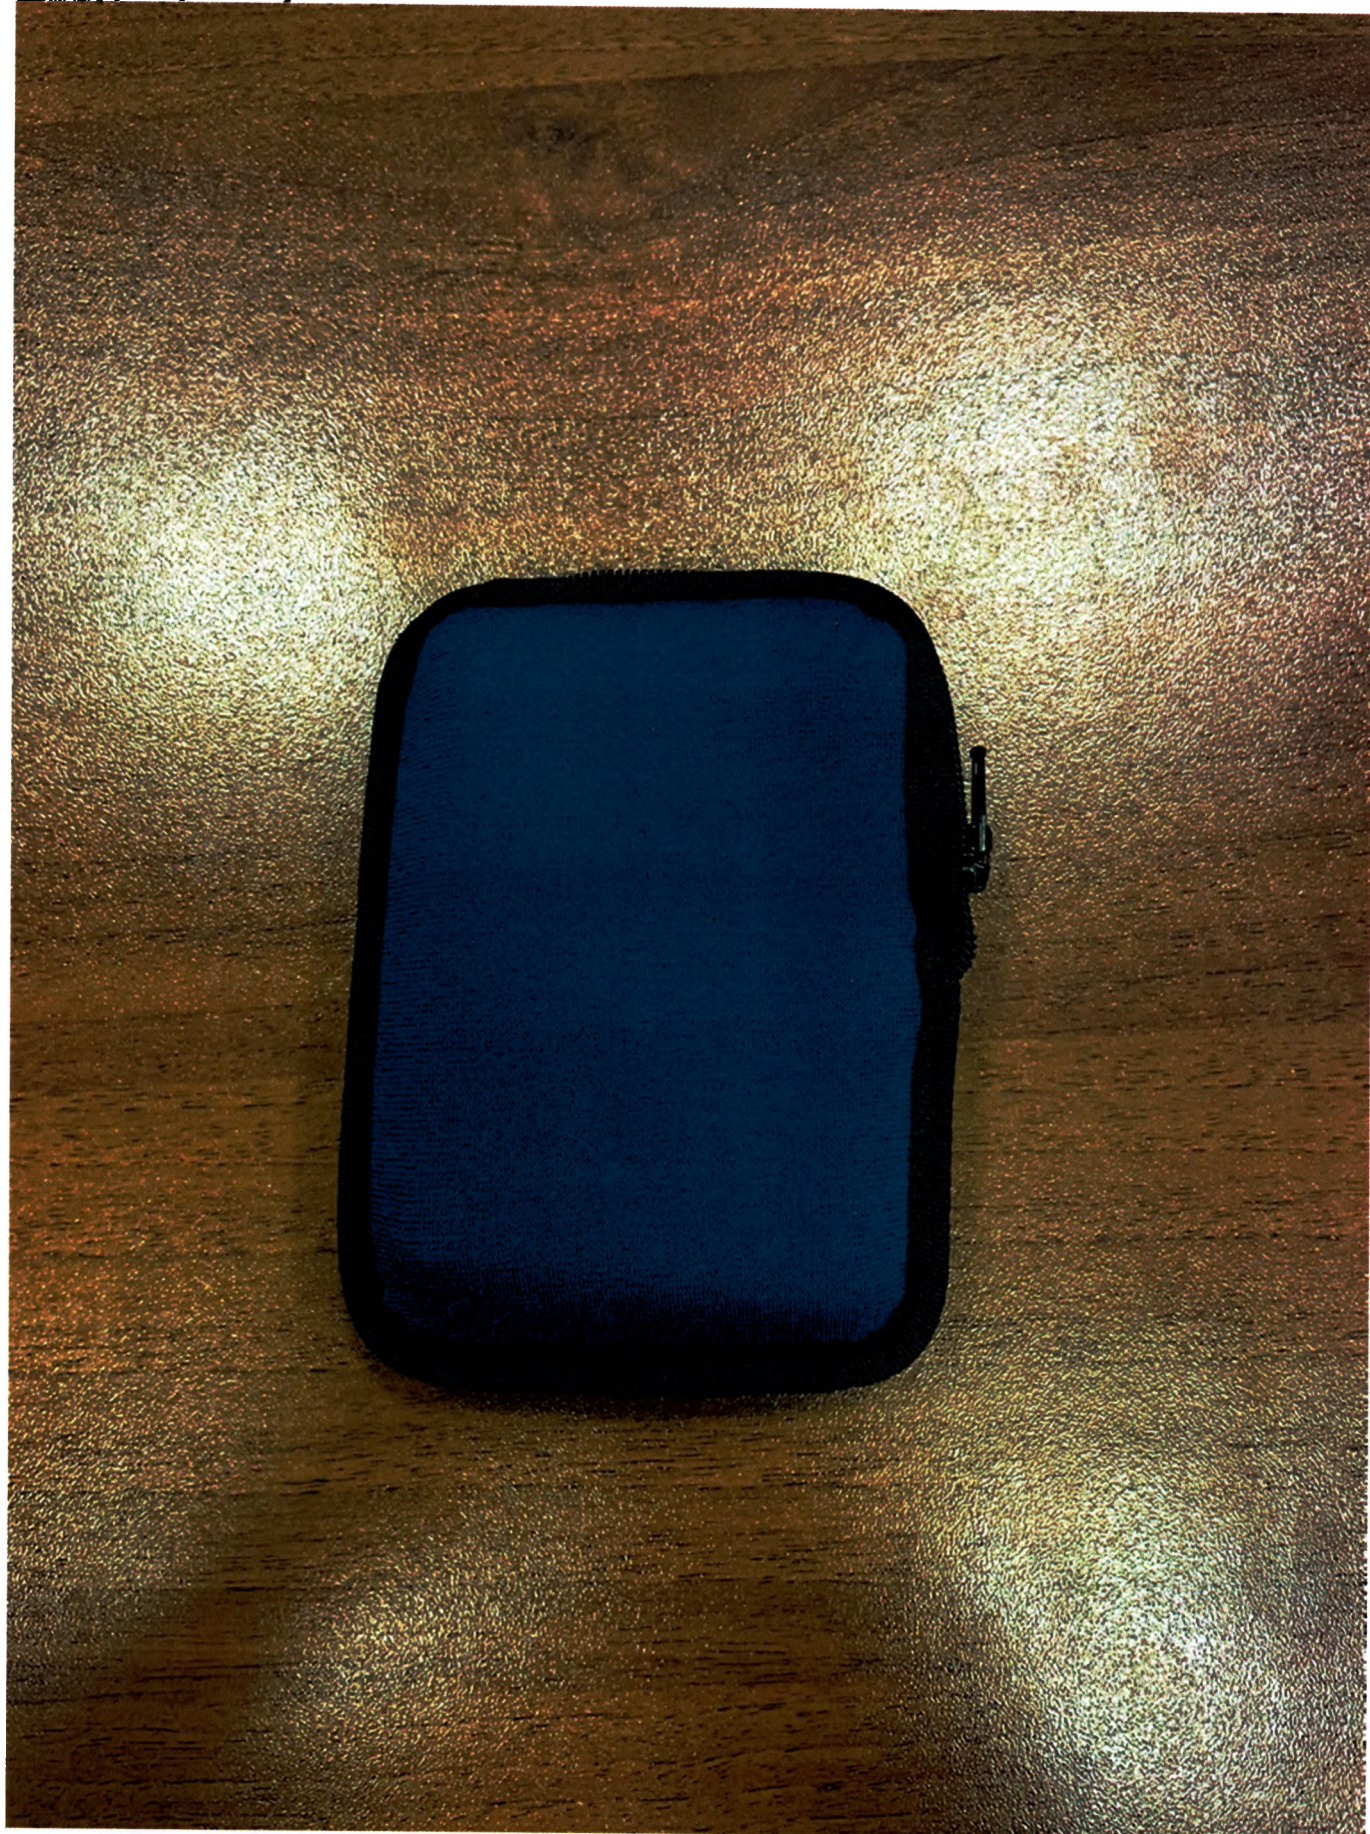

Монитор артериального давления и частоты пульса суточный TM-2440:
Принадлежность:
Сумка-чехол (кейс) для хранения

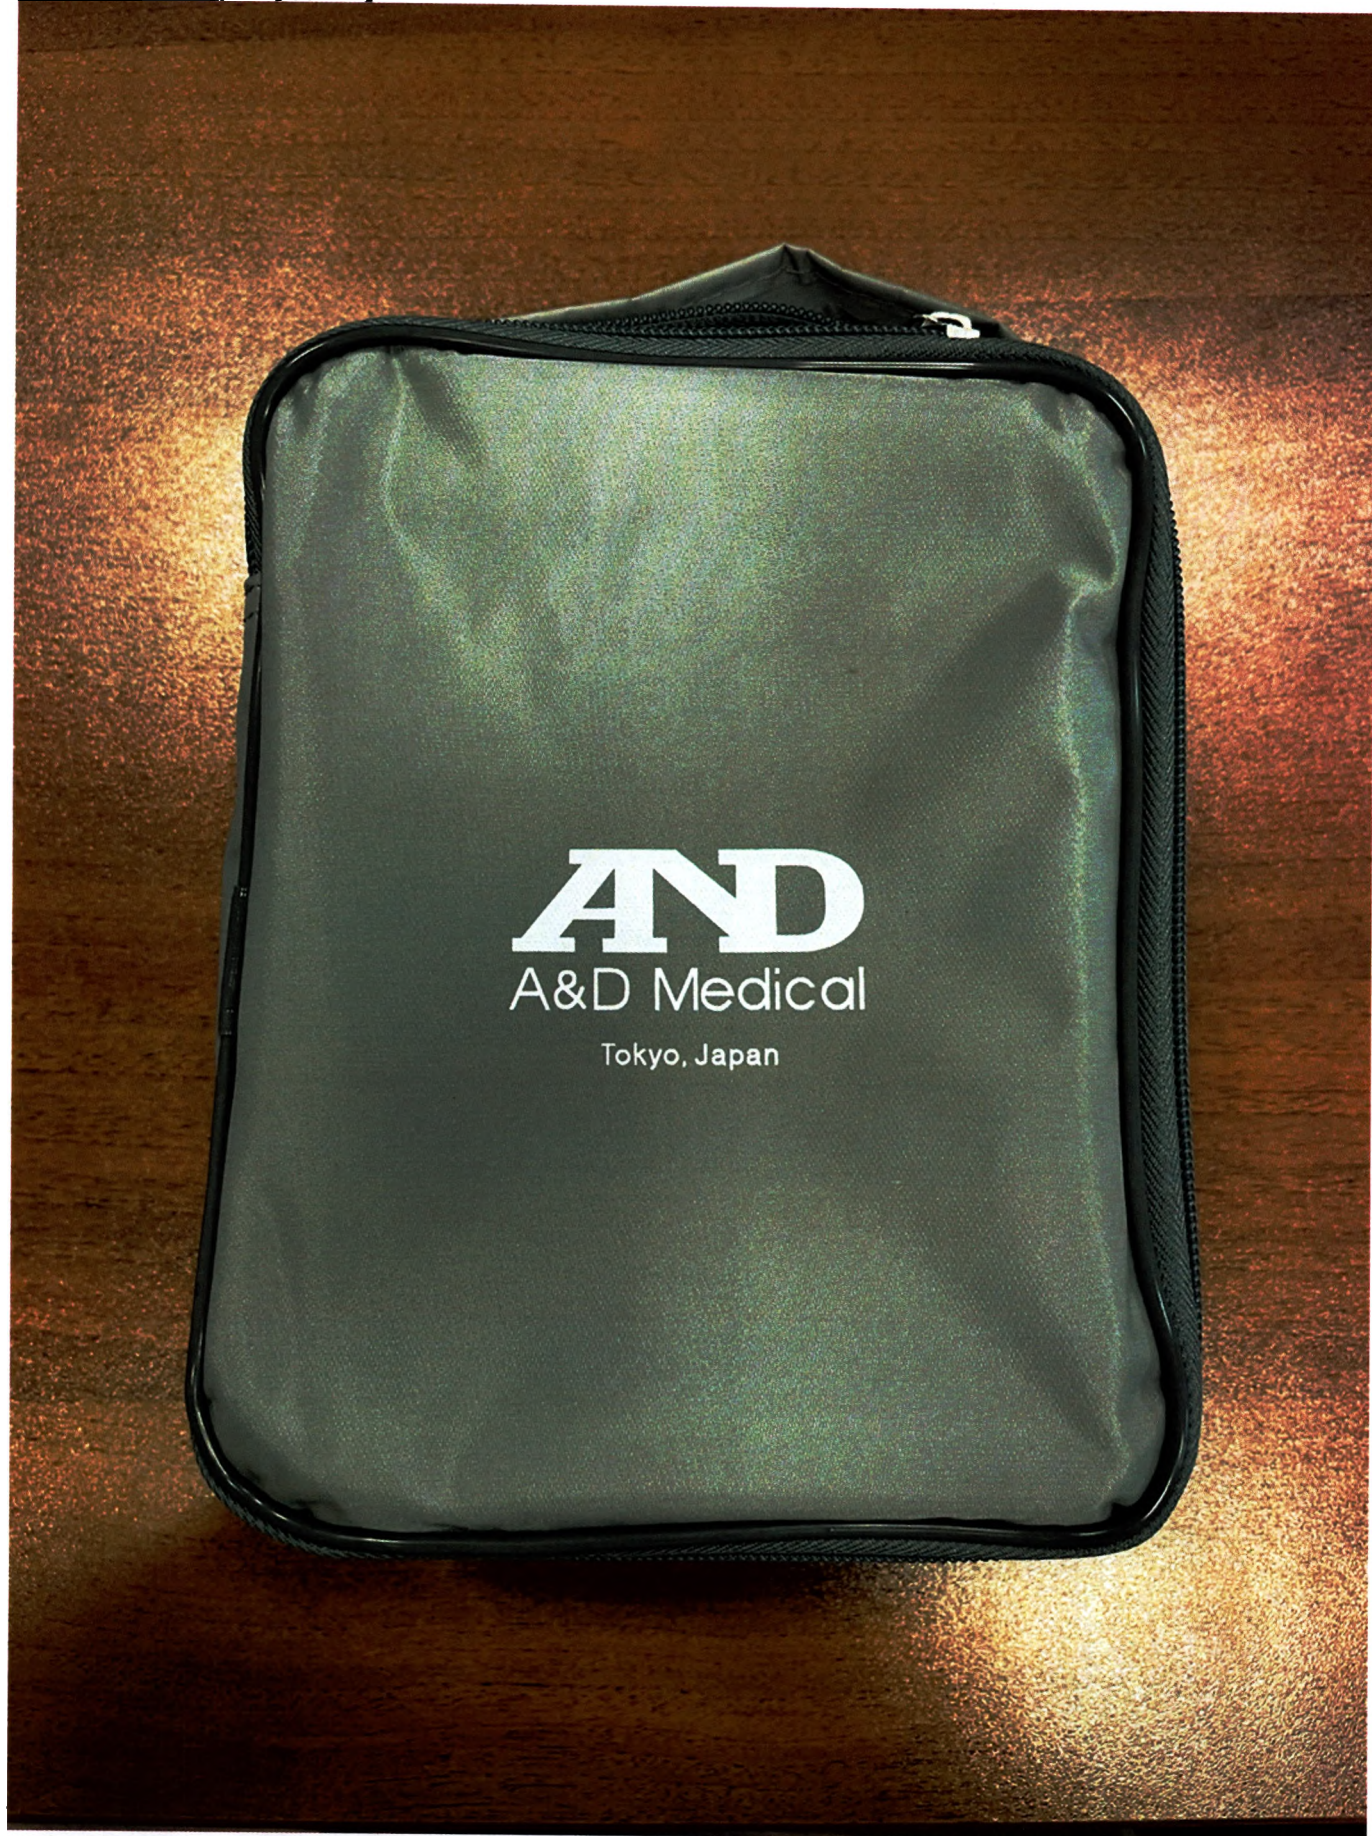

Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Принадлежность:
Кабель USB

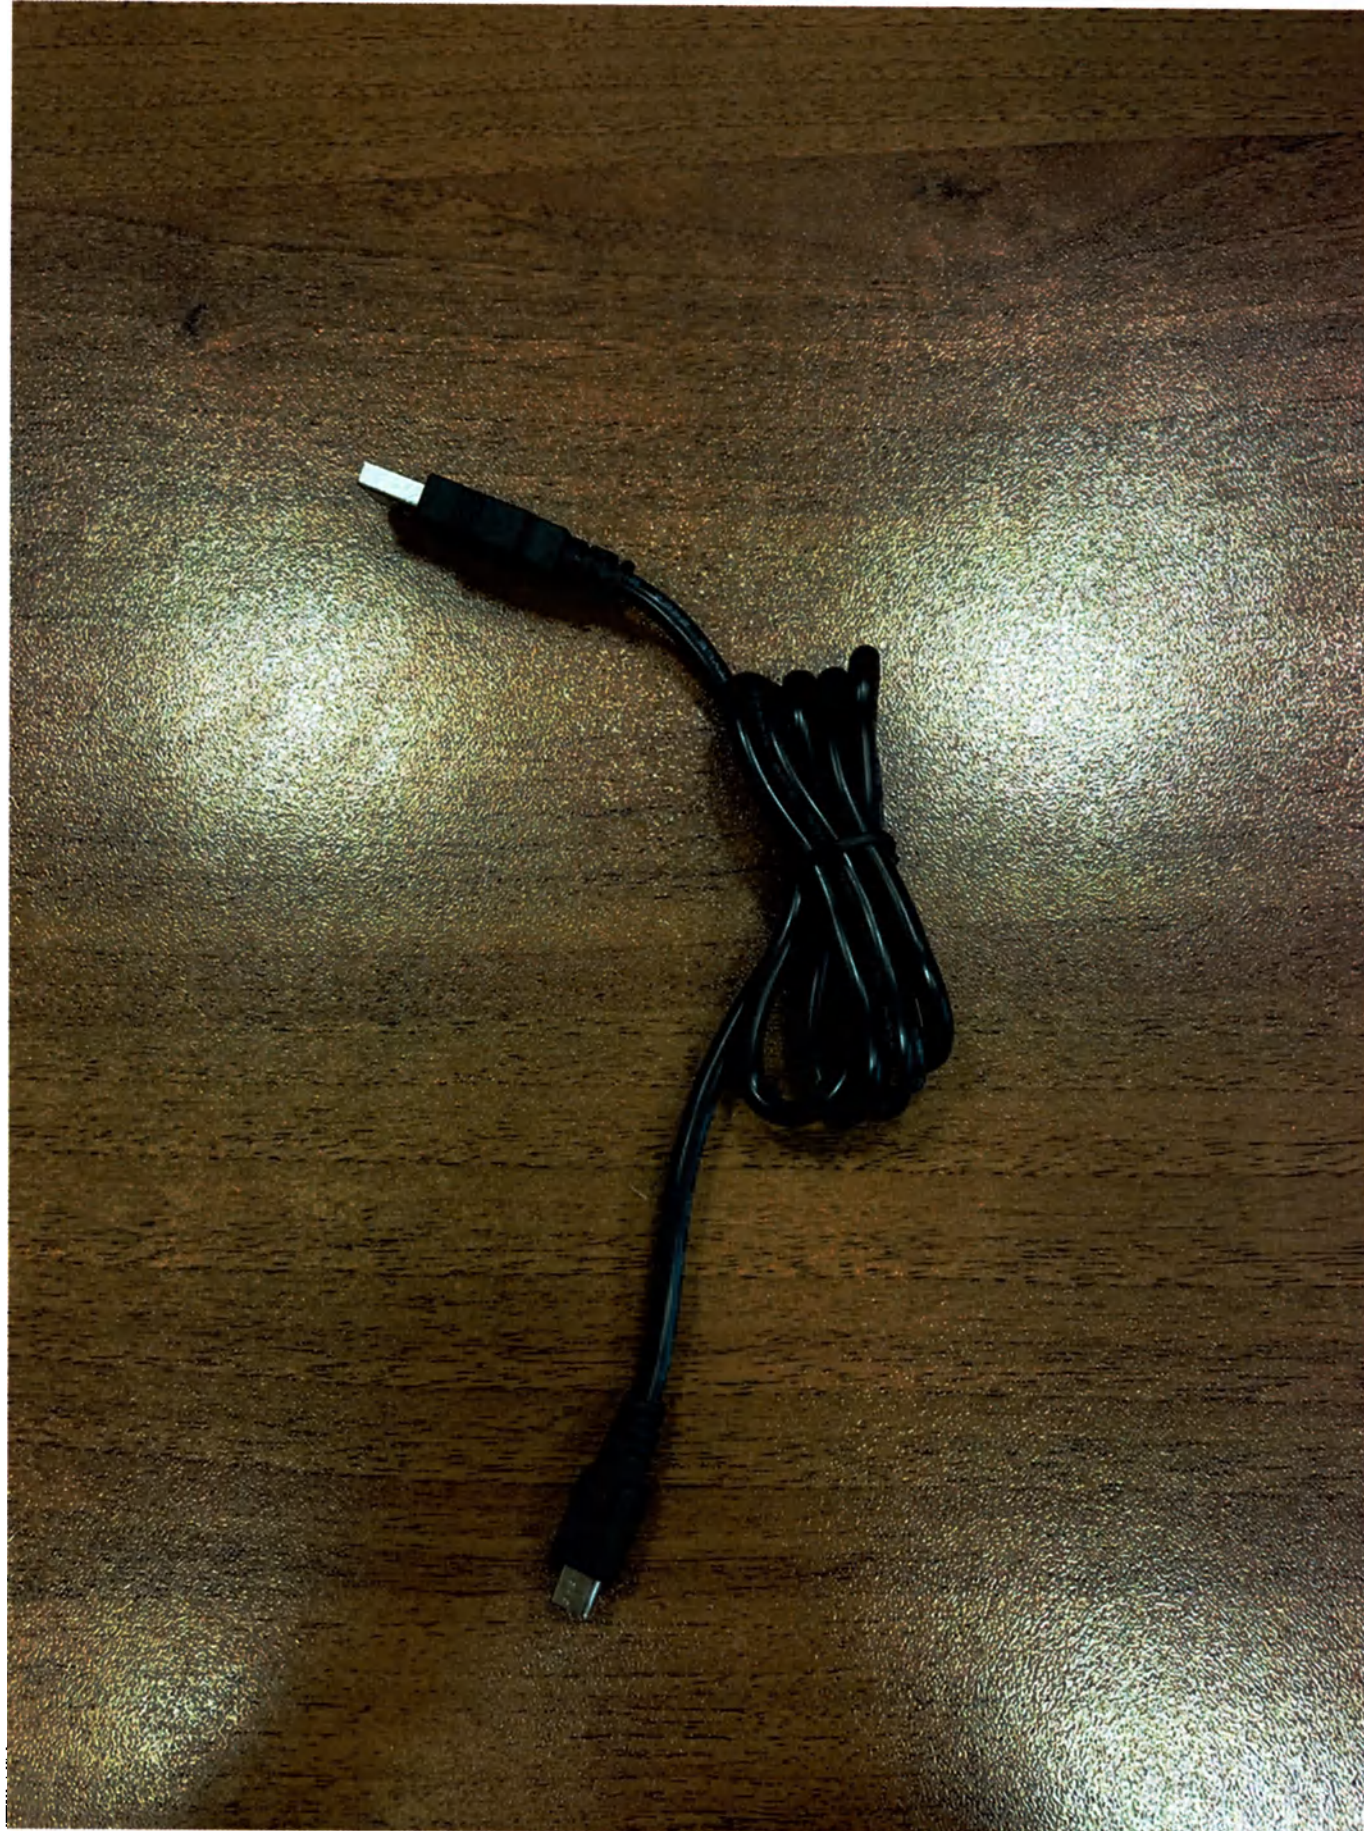

Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440:
Макет упаковки



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2440

Производитель:

A&D Company, Limited, 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, 3-23-14, Хигаши-Икебукуро, Тошима-ку, Токио, 170-0013, Япония

Место производства:

1) A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, 1-243 Асахи, Китамото-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония;

2) A&D Manufacturing Company, Limited (Tsukuba Factory), 4210-15, Takasai, Shimotsuma-shi, Ibaraki-ken, 304-0031, Japan / Эй энд Ди Мануфэкчеринг Компани, Лимитед (Цукуба Фэктори), 4210-15, Такасаи, Шимотсума-ши, Ибараки-кен, 304-0031, Япония.

Импортер:

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», Россия, 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д.3, к.6, ком. 86.

Бесплатный телефон горячей линии: **8 800-200-03-80.**

Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/221 от XX.XX.2023 г.

Штрих-код

Упаковано: месяц, год



МОНИТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА СУТОЧНЫЙ

МОДЕЛЬ: ТМ-2440

Диапазон измерений: 30-280 мм рт.ст.

Питание:  3.0В 2x1.5В AA LR6
 2.4В 2x1.2В AA HR6

A&D

Разработано "A&D Company, Limited", Япония
Сделано в Японии.



IP22



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный TM-2441:
Общий вид



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Монитор – основной блок в корпусе**



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Монитор – основной блок в корпусе



A blue and black portable electronic device, likely a heart rate monitor, resting on a dark wooden surface. The device features a small screen, a green button with a diamond and circle icon, and a control panel with buttons labeled 'ON', 'OFF', 'AUTO', and '16'.

**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Монитор-основной блок в корпусе**



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Манжета (стандартная) для взрослых для левой руки**



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Манжета (большая) для взрослых для левой руки**




**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Ремень**



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Зажим**



**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Элемент питания**

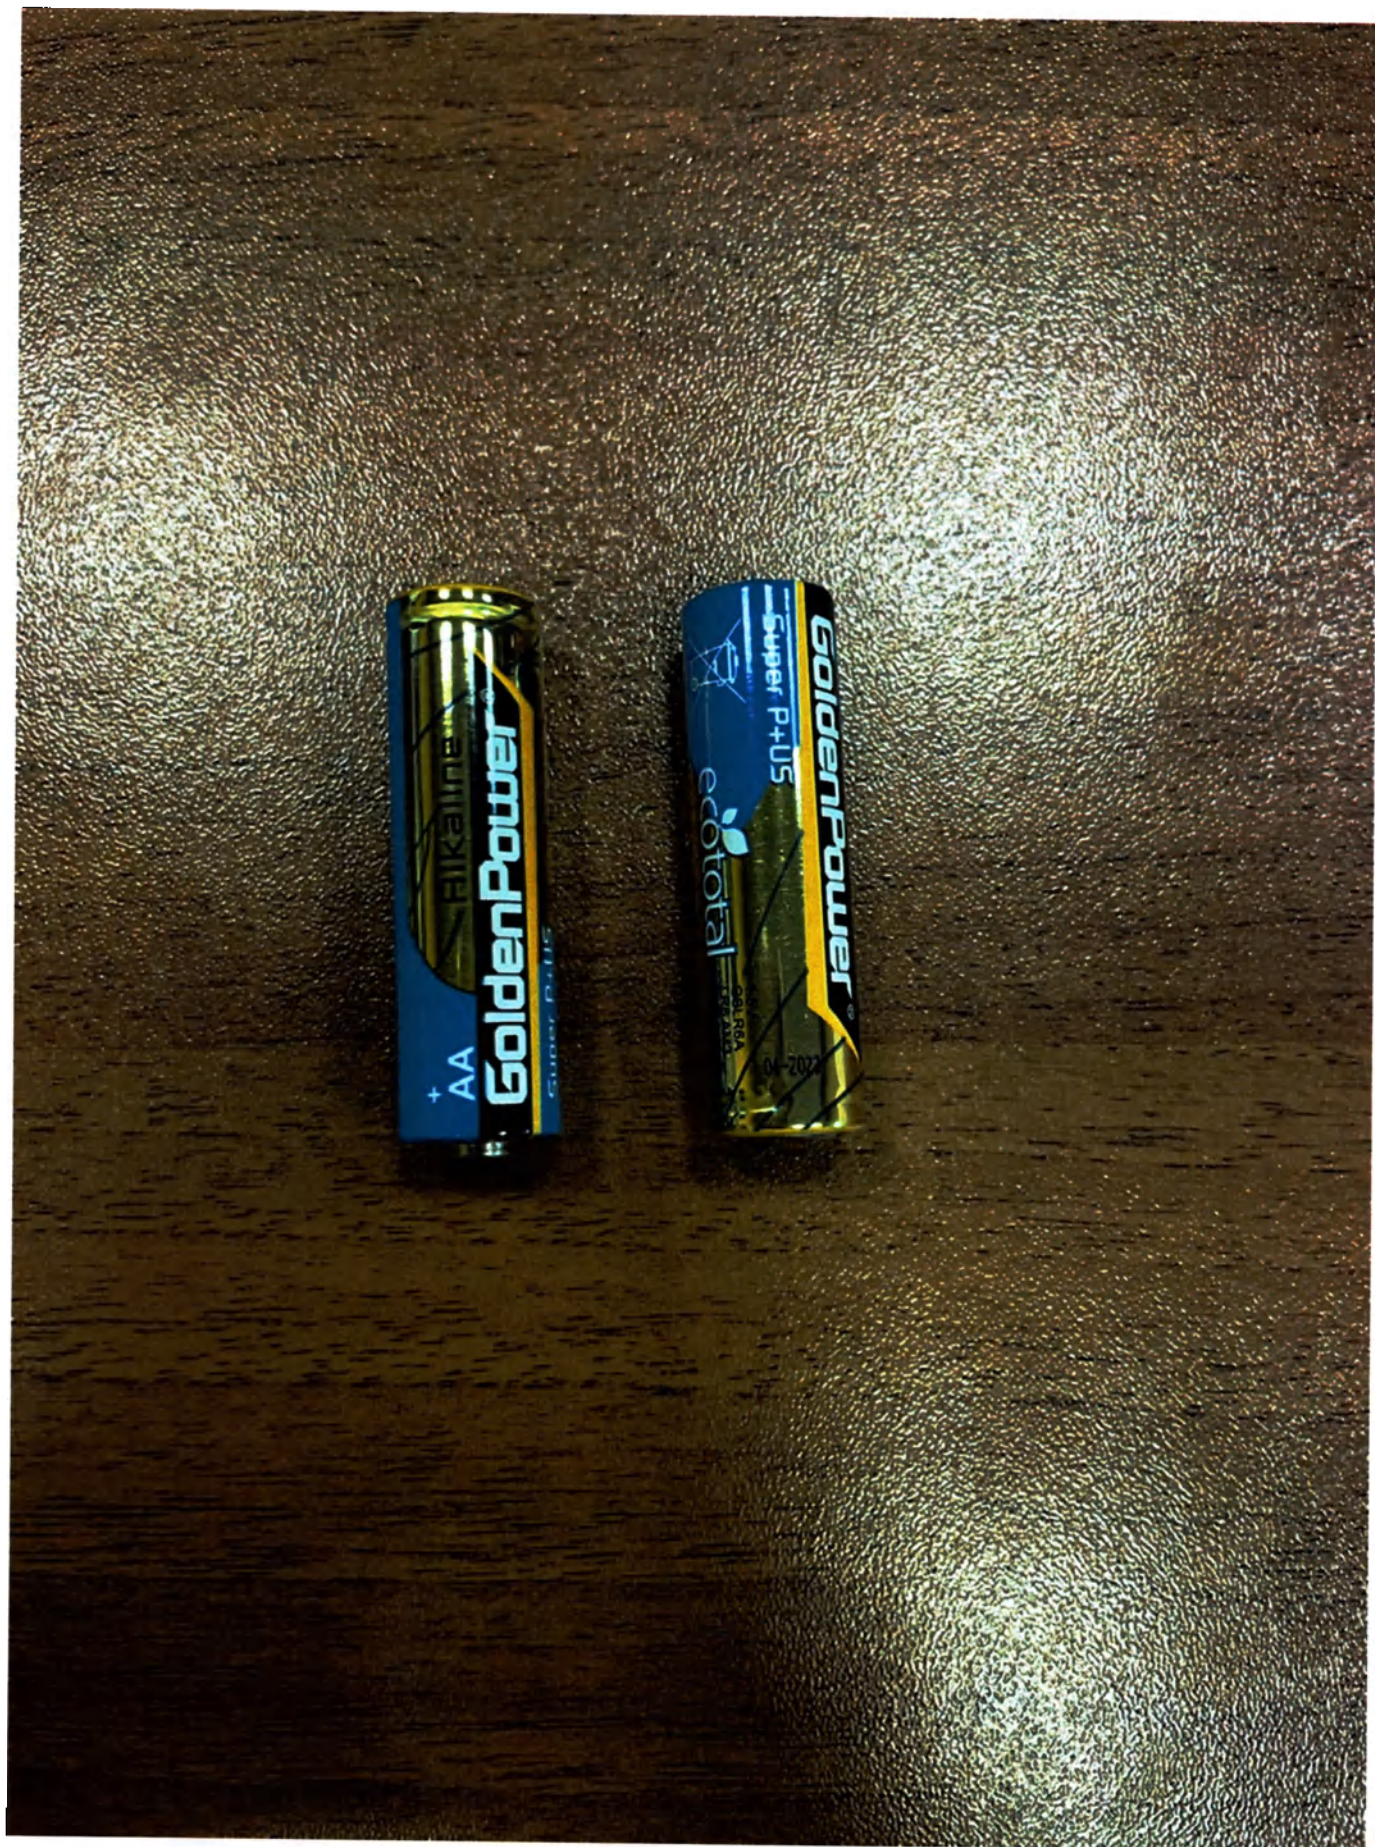


**Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Руководство по эксплуатации**



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный TM-2441:

Принадлежность:

Лист записи

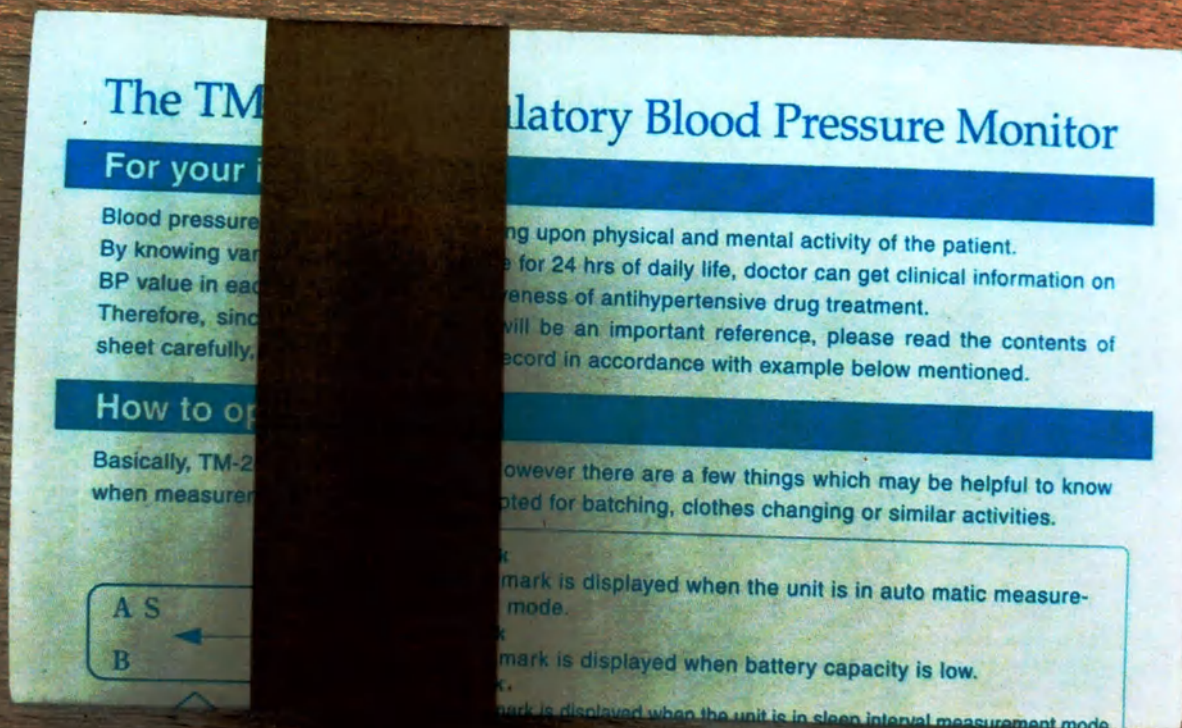

Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:

Принадлежность:

Чехол на манжету (стандартный)



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:

Принадлежность:

Чехол на манжету (большой)



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:

Принадлежность:


Чехол (кейс) для переноски



Монитор артериального давления и частоты пульса суточный TM-2441:

Принадлежность:

Сумка-чехол (кейс) для хранения

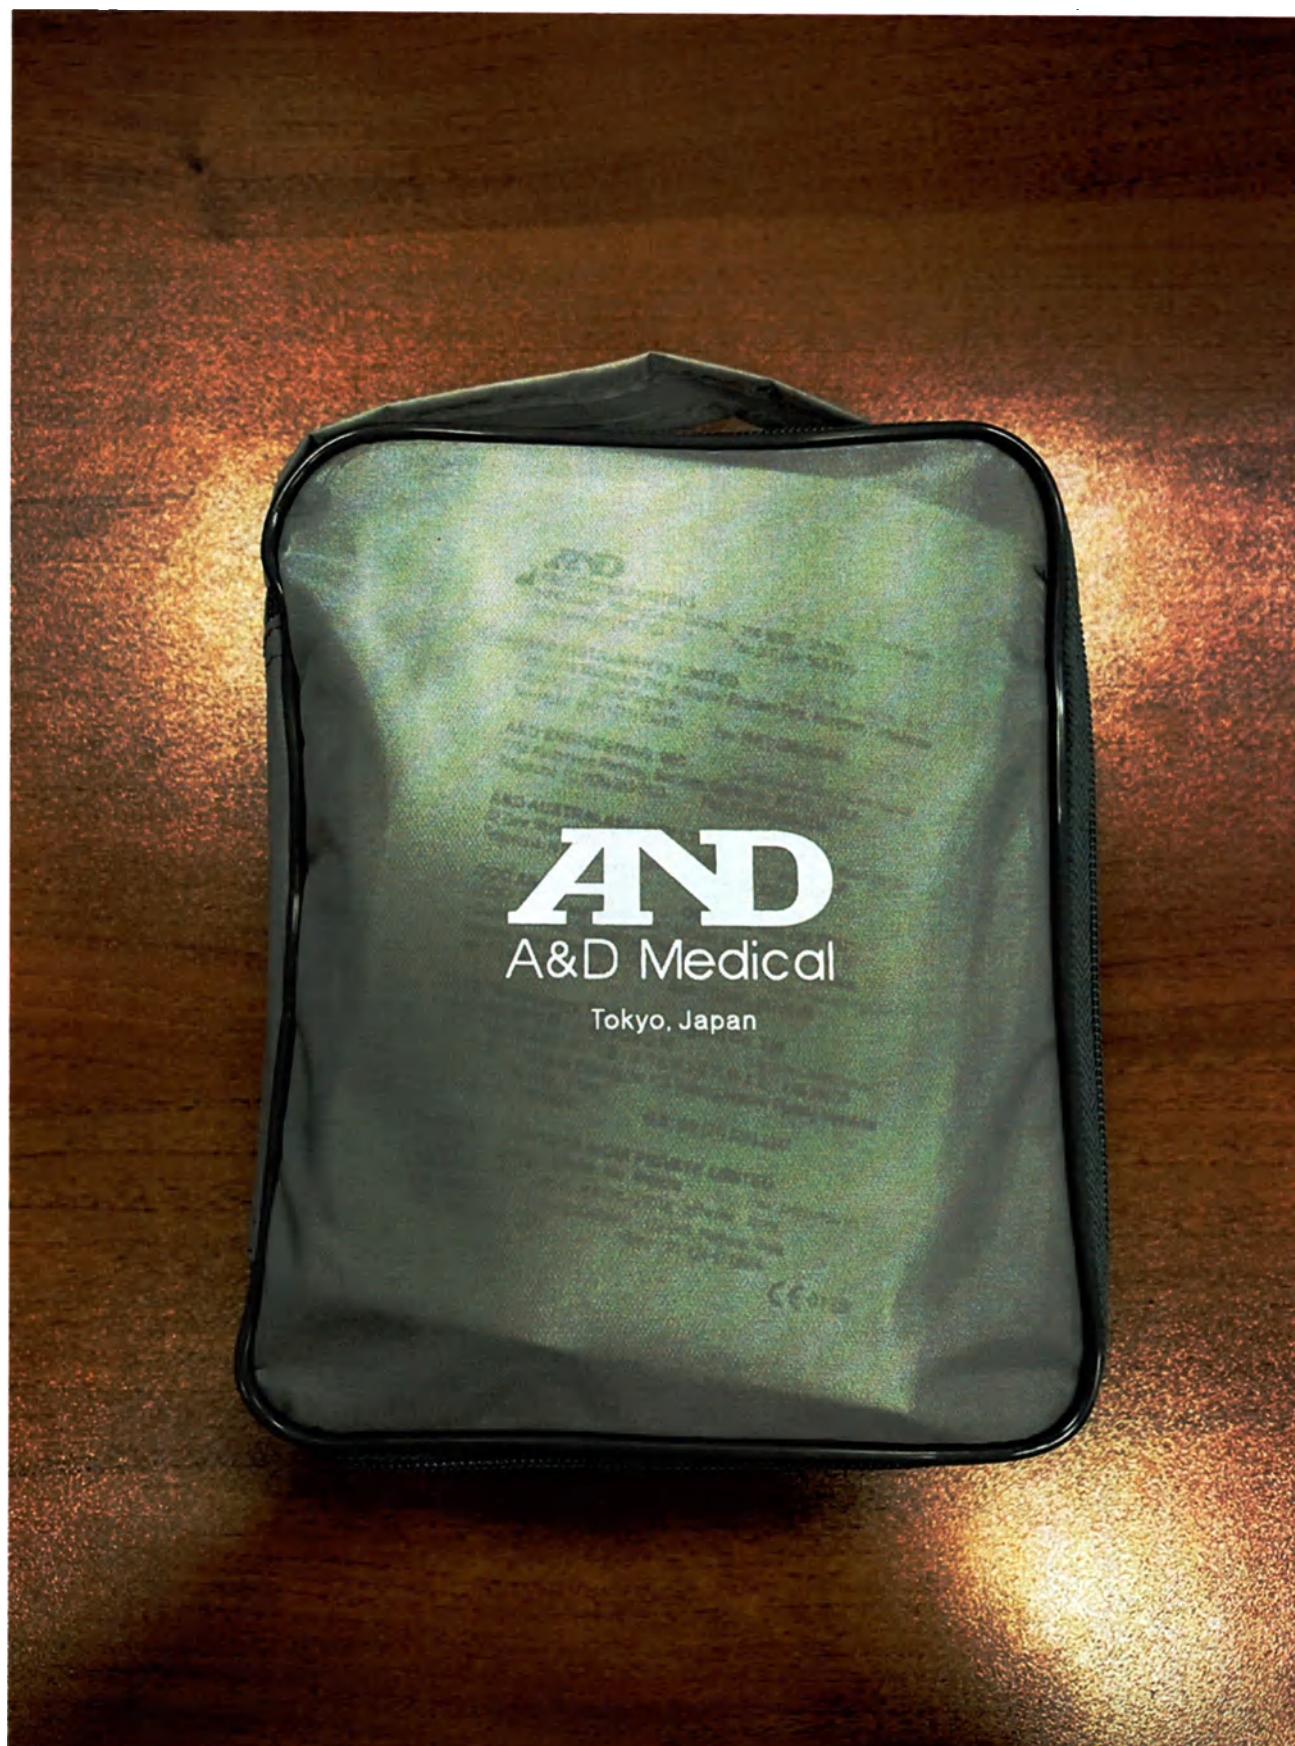

Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441:
Принадлежность:
Кабель USB





Монитор артериального давления и частоты пульса суточный ТМ-2441

Производитель:

A&D Company, Limited, 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, 3-23-14, Хигаши-Икебукуро, Тошима-ку, Токио, 170-0013, Япония

Место производства:

1) A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, 1-243 Асахи, Китамото-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония;

2) A&D Manufacturing Company, Limited (Tsukuba Factory), 4210-15, Takasai, Shimotsuma-shi, Ibaraki-ken, 304-0031, Japan / Эй энд Ди Мануфэкчеринг Компани, Лимитед (Цукуба Фэктори), 4210-15, Такасаи, Шимотсума-ши, Ибараки-кен, 304-0031, Япония.

Импортер:

ООО «Эй энд Ди РУС», Россия, 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д.3, к.6, ком. 86.

Бесплатный телефон горячей линии: **8 800-200-03-80.**

Отзывы и предложения оставляйте на **www.and-rus.ru**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/221 от XX.XX.2023 г.

Штрих-код

Упаковано: месяц, год



МОНИТОР АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА СУТОЧНЫЙ

МОДЕЛЬ: ТМ-2441

Диапазон измерений: 30-280 мм рт.ст.

Питание:  3.0В 2x1.5В AA LR6
 2.4В 2x1.2В AA HR6

A&D

Разработано "A&D Company, Limited", Япония
Сделано в Японии.



IP22



CE



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
54 (Пятьдесят четыре) листа(ов)

Операционный директор
ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»
Исаенков А.А. _____

