

Medtronic

ООО «Медтроник»
Вн. тер. г., м.о. Пресненский
Пресненская наб., д.10
Башня С
9 эт., пом. III, ком.41
г. Москва, 123112
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77
Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Е.В. Плясунова

_____ 2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Датчик для церебрального/соматического оксиметра в вариантах
исполнения с принадлежностями,**


производства Covidien llc, USA
(Ковидиен Ллс, США)

1. Общий вид


1.1. "Датчик rSO₂ для взрослых INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению"

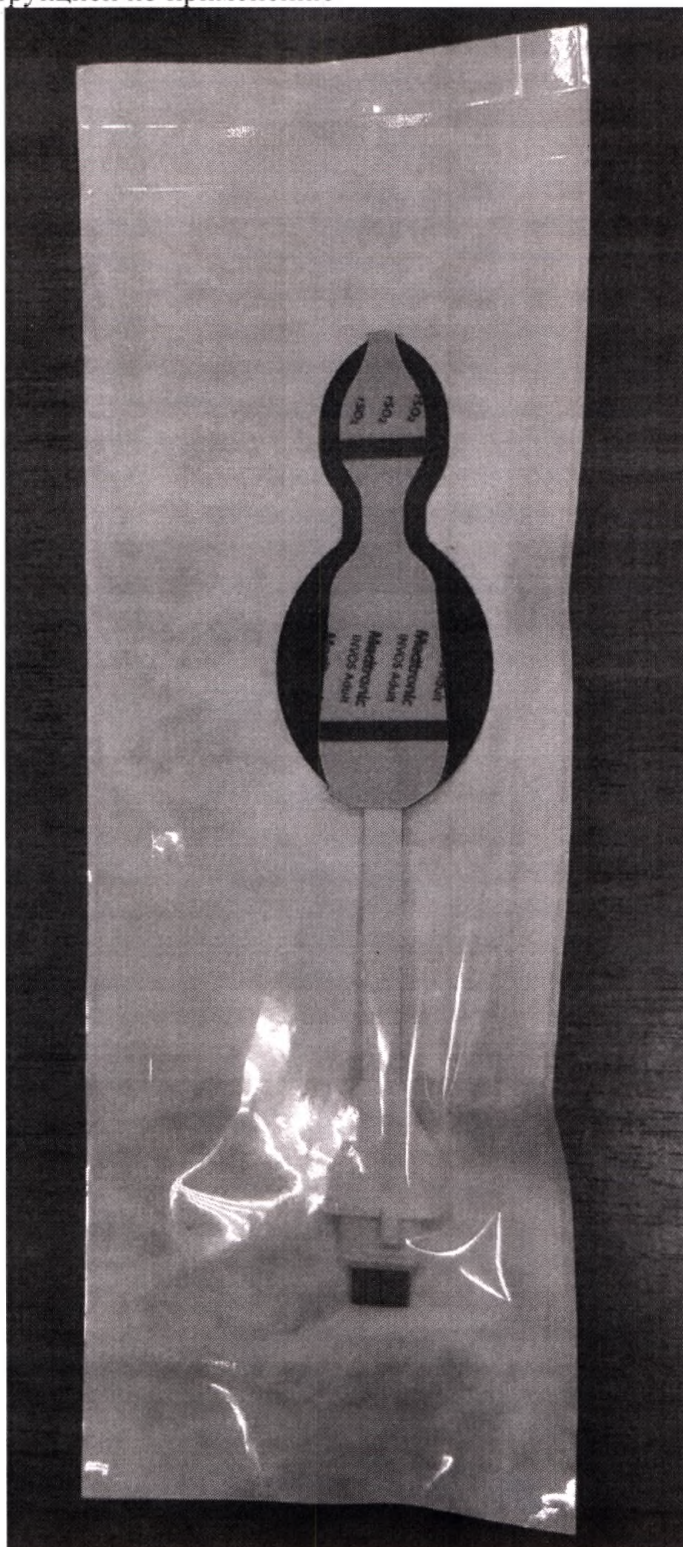


1.2. "Датчик rSO2 детский INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению"

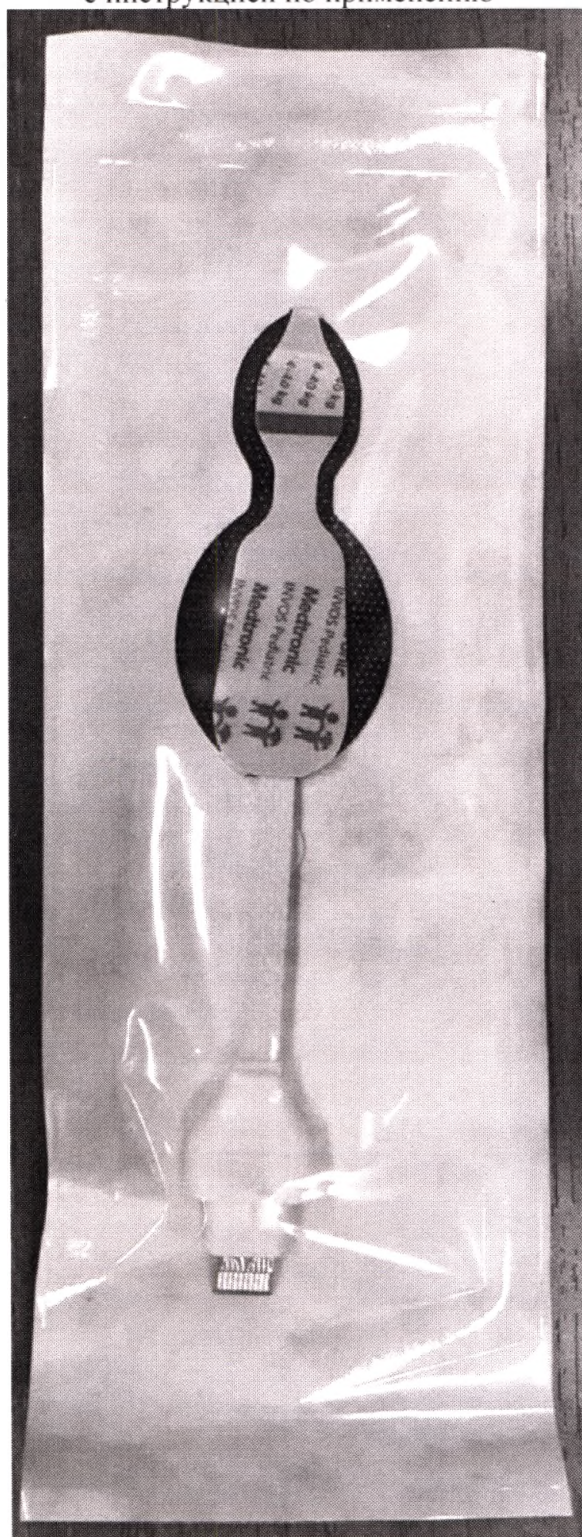


- 1.3. «Одноразовый региональный датчик насыщения кислородом для новорожденных OxyAlert NIRSensor для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению, с принадлежностями»

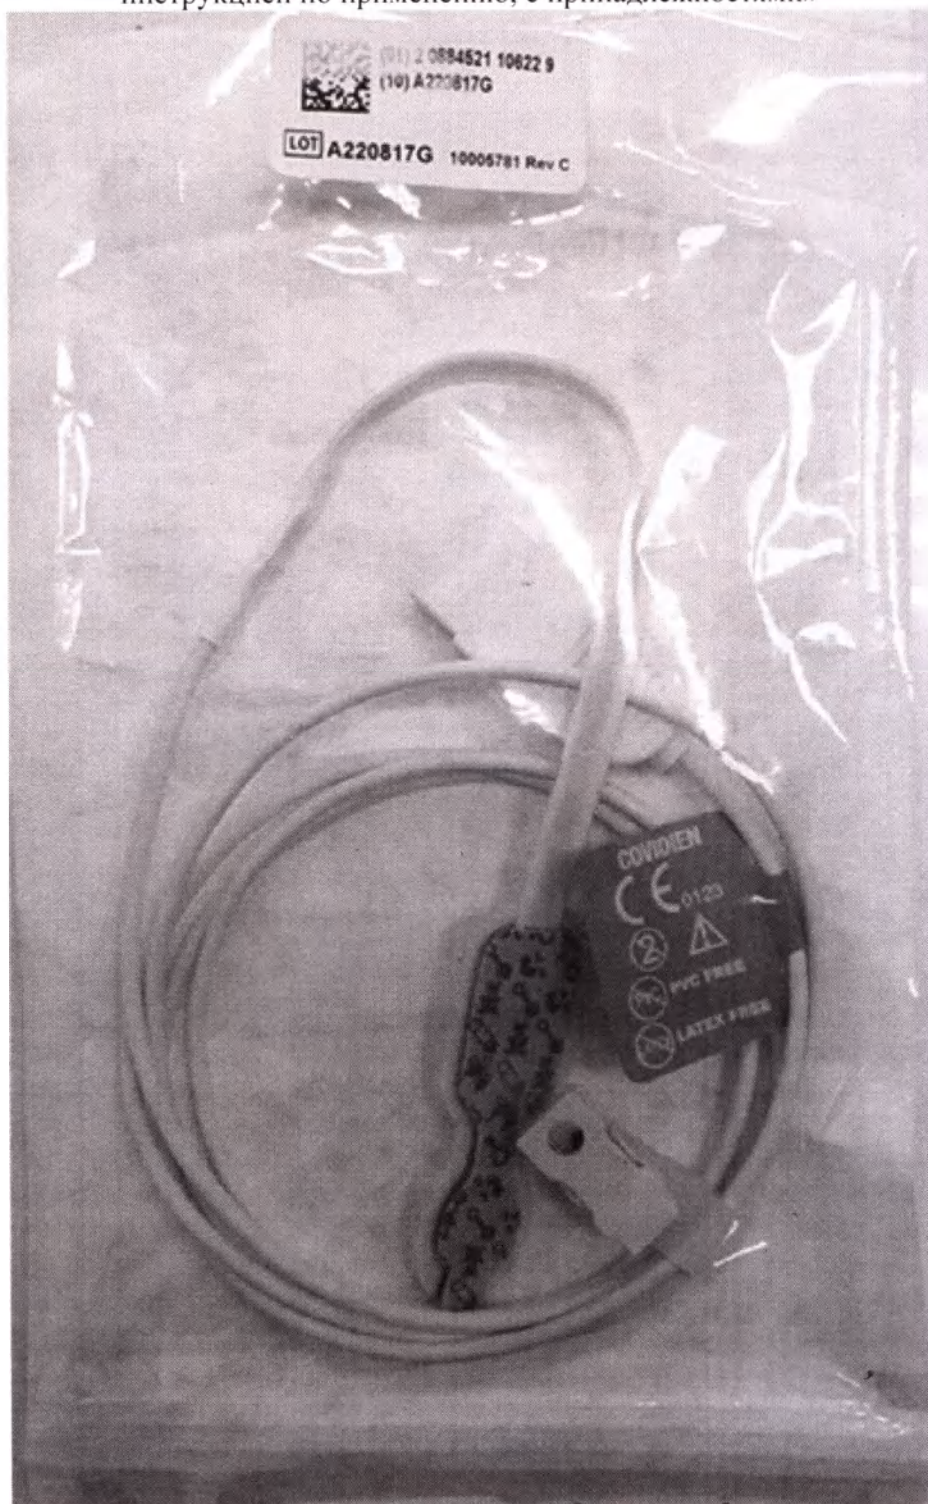


1.4. Принадлежность «Кабель адаптера многоразового, датчика для детей раннего возраста для РМ7100»

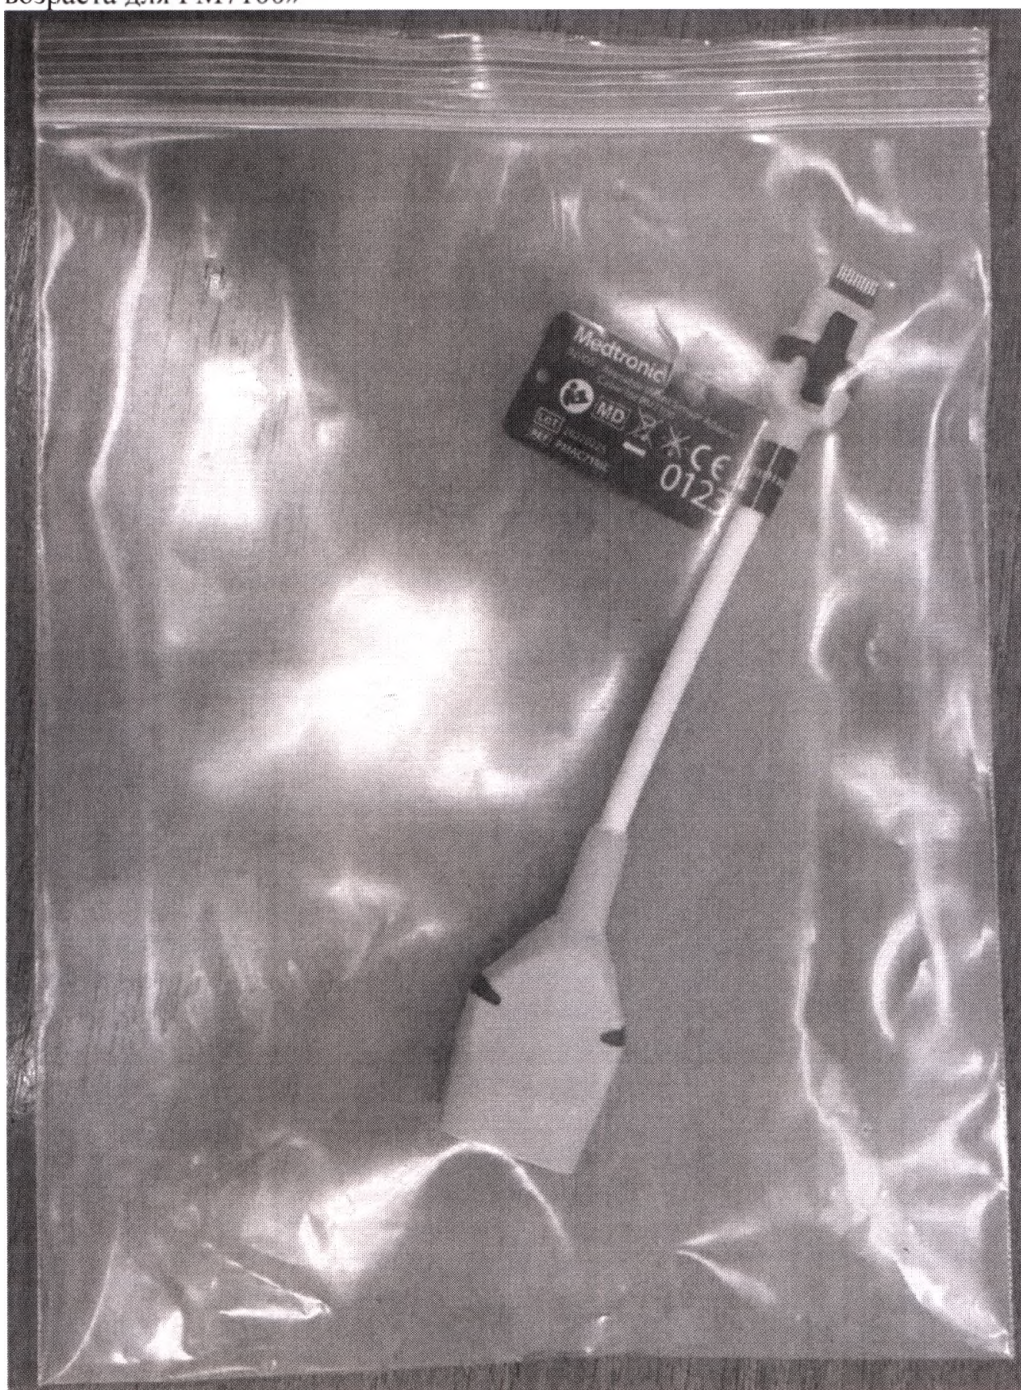

2. Маркировка индивидуальной упаковки
 - 2.1. «Датчик rSO₂ для взрослых INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению»

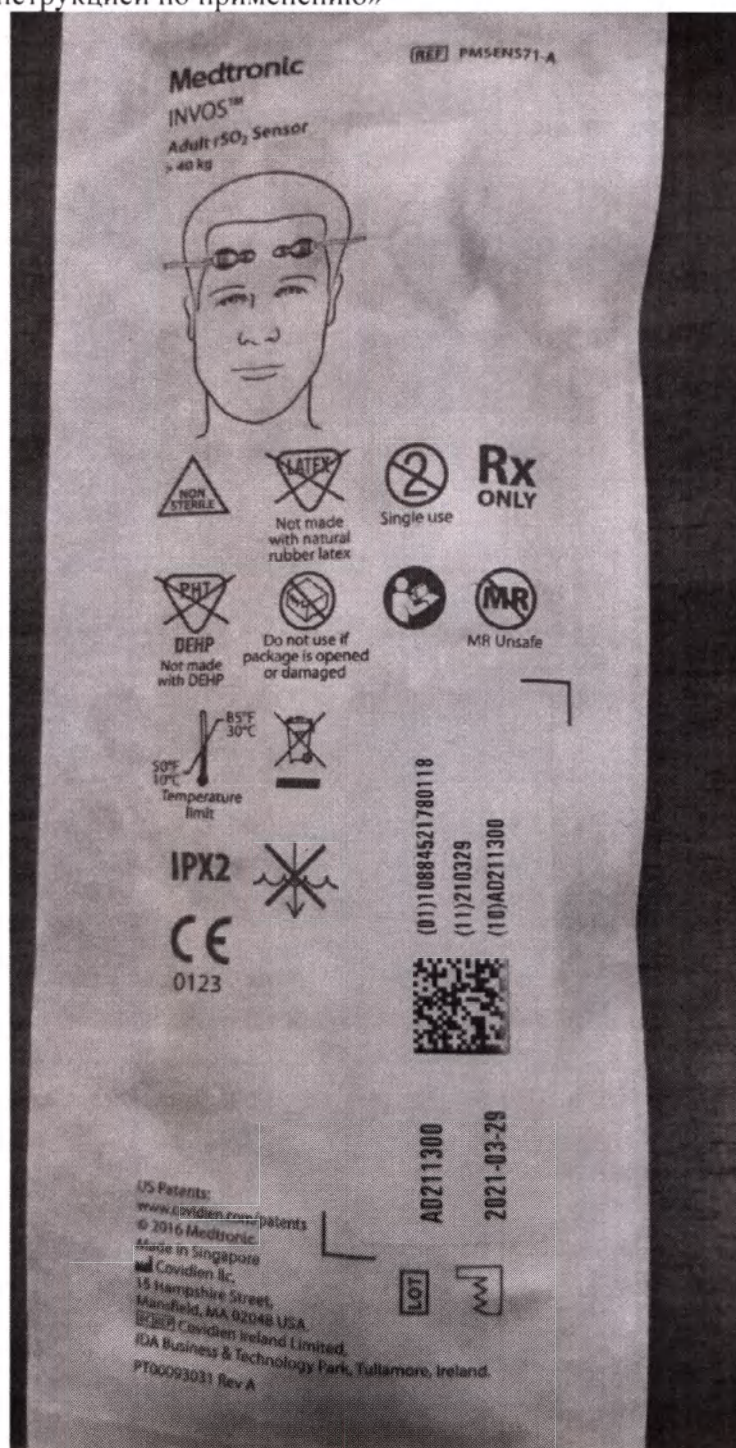

2.2. Датчик rSO₂ детский INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению

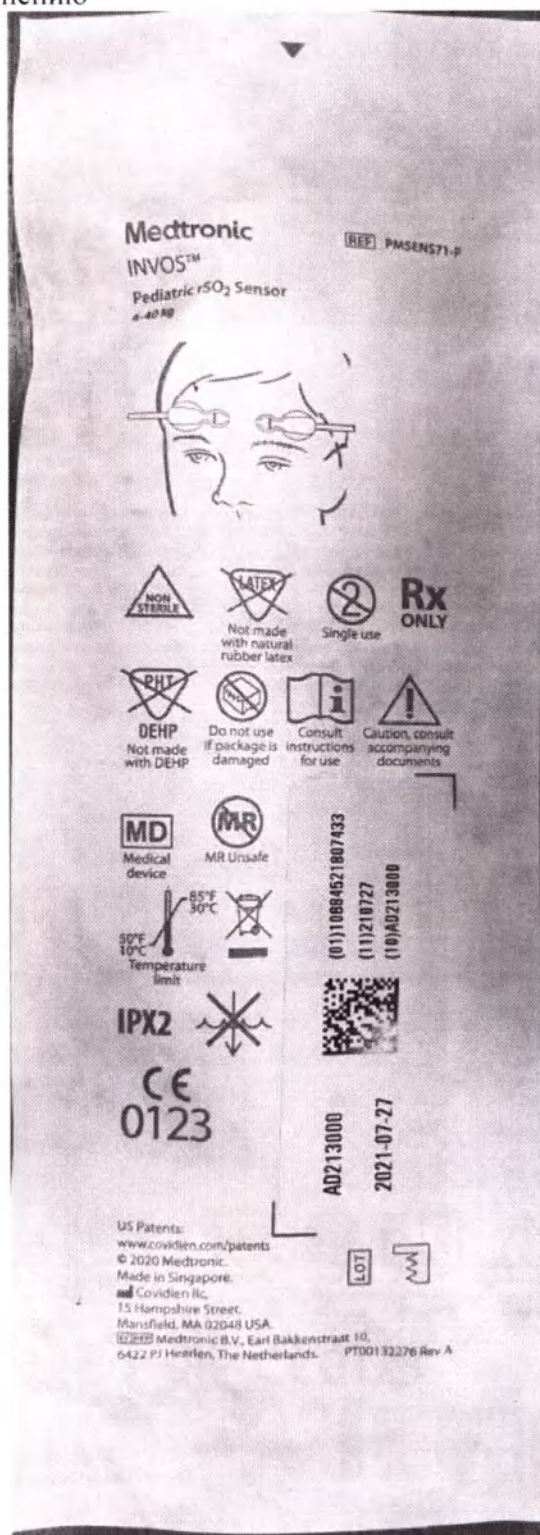

2.3. Одноразовый региональный датчик насыщения кислородом для новорожденных OxyAlert NIRSensor для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению, с принадлежностями

COVIDIEN™

REF CNN/SNN

INVOS™

Infant Regional Saturation Sensor


Cerebral/Somatic - Neonatal

< 5 kg only

Capteur d'oxymétrie régionale

(cérebrale/somatique) pour nourrisson/nouveau-né

Infant Regional Saturation Sensor, Cerebral/Somatic - Neonatal - Regionaler Sättigungs-sensor für Säuglinge, cerebraler/somatischer - Neugeborenen - Regionale Sättigungssensor voor zuigelingen, cerebraler/somatisch - neonataal - Sensor pediatric regional de saturação, cerebral/somático - neonatal - Senzor de saturação regional para bebés, cerebral/somático - neonatal - Regional oxymétriseur pour bébé, Cerebral/Somatisk - Neonatal - Skandienzsensor til regional mætning, cerebral/somatisk - neonatal - Regional mætnings sensor for spedbarn, cerebral/somatisk - nyfødt - Paikallinen saturations anturi vauvoille, aripain ja kirkon alke - vastasyntyneet - Senzor de saturação regional para bebés, cerebral/somático - neonatal - Sensor Neonatal da Saturação Regional, Cerebral/Somático - Recém-nascidos - Senzor per nouroepiek - cerypaque dla noworodków, cerebral/somatyczny - dla noworodków - Cijepnik saturacji tlenu w regionie głowiczym u noworodka, mierzący somatyczny - noworodka - Senzor regional de saturação a kopci, cerebral/somatik - neonatal - Senzor lokalnog saturacije pri dojenčadi, cerebral/somatik - novorođenč - Senzor regional de saturación za dojenčad, cerebral/somatik - neonatal - Regionalis saturációs szenzor csecsemőknek, cerebral/somatikus - újszülött - Regionalis doeltirpoc, regionalis naipoc, regionalis /Laportnik - Neugeborene - Infant Regional Saturation Sensor, Cerebral/Somatic - Neonatal - Senzor saturacije regionala i penje nogi, cerebral/somatik - novorođenč - Senzor regionalnog zasićenja u dojenčadi, cerebral/somatik - neonatal - Senzor regionalne saturacije za dojenčad, cerebral/somatik - novorođenč

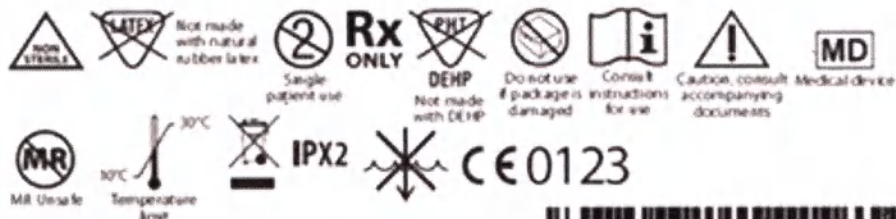


© 2020 Covidien. Made in Ireland.
Covidien IR, 15 Rungtoun Street, Wexford, Wexford, Ireland.
Covidien Ireland Ltd, 15 Rungtoun Street, Wexford, Ireland.
PT00122348 Rev A



PT00122348

3. Маркировка групповой упаковки

3.1. Датчик rSO₂ для взрослых INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению

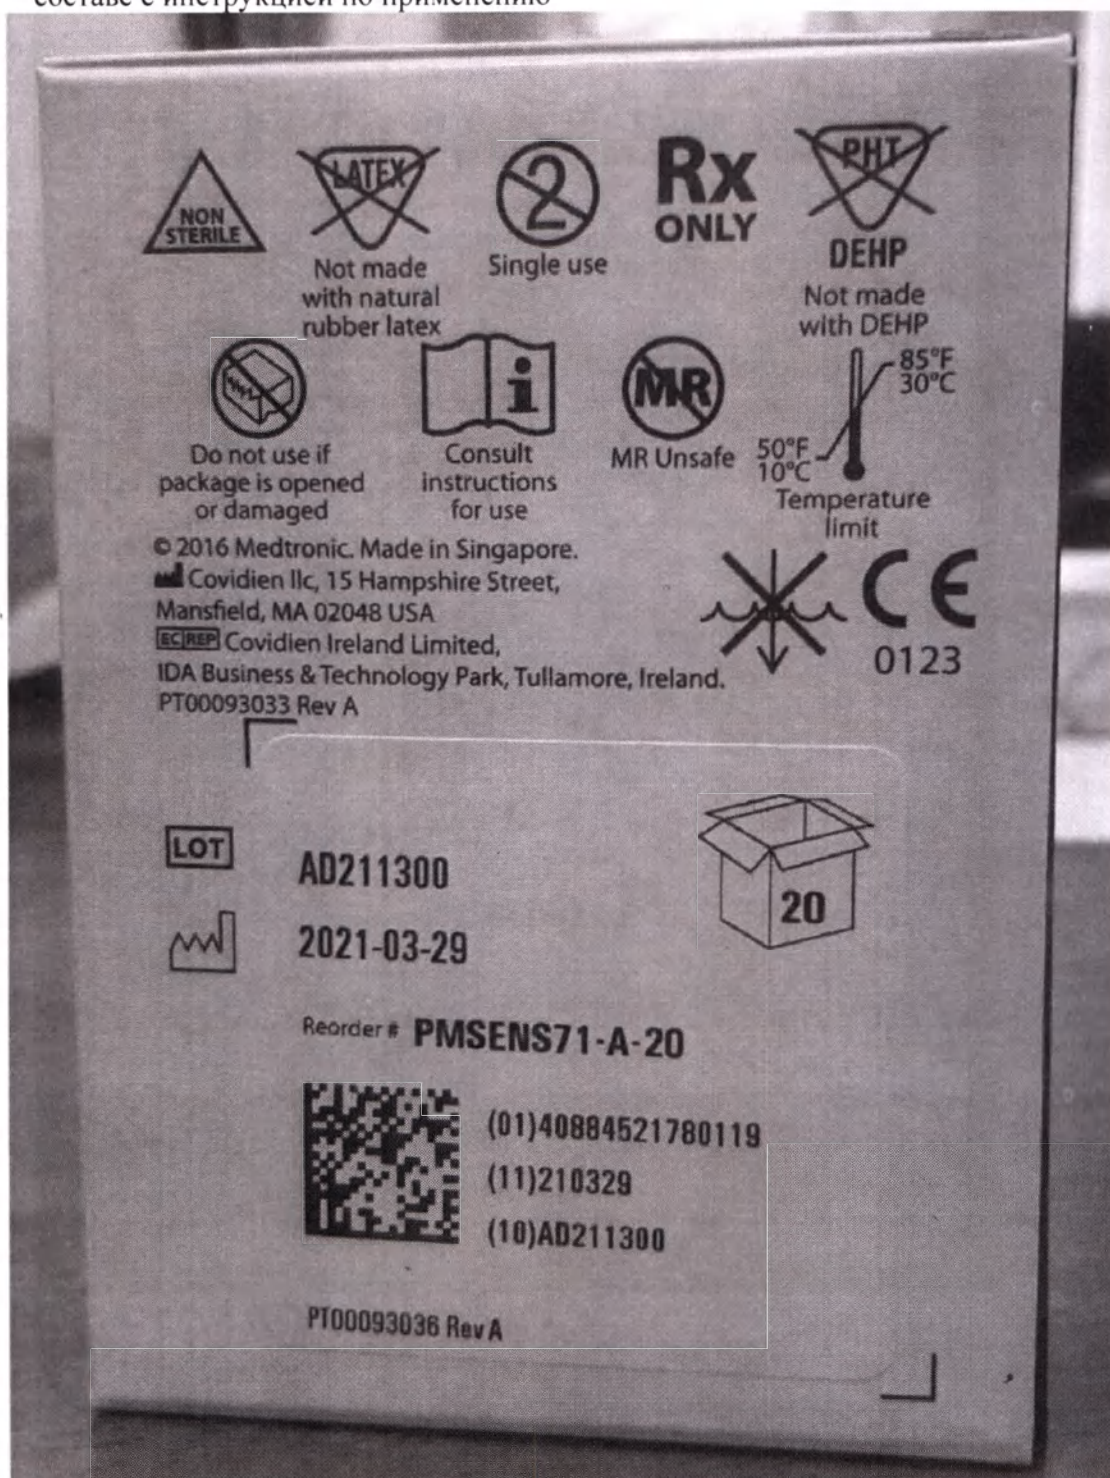

3.2. Датчик rSO2 детский INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению



3.3. Одноразовый региональный датчик насыщения кислородом для новорожденных ОхуAlert NIRSensor для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению, с принадлежностями

COVIDIEN™

INVOS™

Infant Regional Saturation Sensor

Cerebral/Somatic - Neonatal

< 5 kg only

REF CNN/SNN

Infant Regional Saturation Sensor, Cerebral/Somatic - Neonatal - Capteur d'oxymétrie régionale (cérébrale/somatique) pour nourrisson/nouveau-né - Regionaler Sättigungssensor für Säuglinge, zerebral/somatisch - Neugeborene - Regionale saturatiesensor voor zuigelingen, cerebraal/somatisch - neonaten - Sensore pediatrico per ossimetria regionale, cerebrale/somático - neonatale - Sensor de saturación regional para bebés: cerebral y somático (neonatos) - Regional syremättnadssensor för barn, Cerebral/Somatisk - Neonatal - Spædbørnssensor til regional mætning, cerebraal/somatisk - neonatal - Regional metningsensor for spedbarn, cerebraal/somatisk - nyfødte - Paikallisen saturaatiosensori vauvoille, aivojen ja kehon alue - vastasyntyneet - Sensor de saturação regional para bebés, cerebral/somático - neonatal - Sensor Neonatal da Saturação Regional, Cerebral/Somática - Recém-nascidos - Датчик периферической сатурации для младенцев: церебральный/соматический — для новорожденных - Czujnik saturacji tlenowej regionalnego krążenia u noworodków, mózgowo-somatyczny - noworodki - Senzor regionalni saturacije u kojenčů, cerebraľni/somatický - novorozenecký - Snimač lokalnej saturácie pre dojčatá, cerebraľny/somatický - novorodenci - Senzor regionalne nasićenosti za dojenčke, cerebraľni/somatski - novorojenčki - Regionális szaturációs szenzor csecsemőknek, cerebraľis/szomatikus - újszülött - Βρεφικός μοθητικός μετρούμενο κορεσμού, Εγκεφαλικός/Σωματικός - Νεογνικός - Infant Bölgesel Satürasyon Sensörü, Serebral/Somatik - Neonatal - Senzor saturatie regională pentru copii, cerebraľ/somatic - nou-născuți - Senzor regionalnog zasićenja za dojenčad, cerebraľni/somatski - neonatalni - Senzor za regionalnu saturaciju za odojčad, cerebraľni/somatski - novorođenčad

CE0123

© 2020 Covidien. Made in Ireland.
Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.
Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands.
PT00122349 Rev A

COVIDIEN™

INVOS™

Infant Regional Saturation Sensor

Cerebral/Somatic - Neonatal

< 5 kg only

REF CNN/SNN

NOT STERILE

Not made with natural rubber latex

Single patient use

Rx ONLY

DEHP Not made with DEHP

Do not use if package is damaged

Consult instructions for use

Caution, consult accompanying documents

Medical device


MR Unsafe

10°C - 30°C Temperature limit

PT00122350 Rev A



4.2. Датчик rSO₂ детский INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению

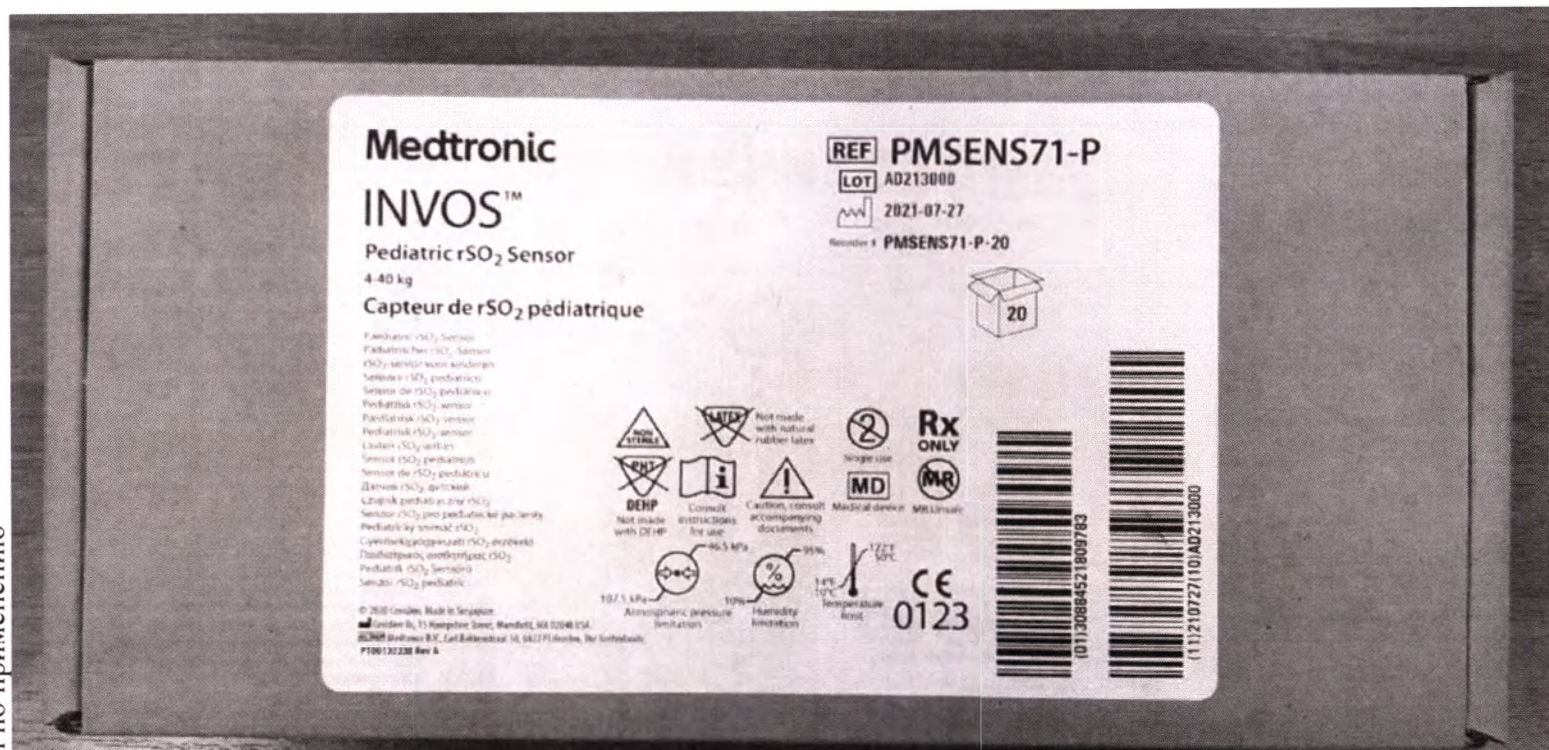

[illegible]

4.4. Принадлежность «Кабель адаптера многоразового, датчика для детей раннего возраста для PM7100»



5. Макет русскоязычного стикера

Датчик для церебрального/соматического оксиметра в вариантах исполнения с принадлежностями: Датчик rSO2 для взрослых INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению	
Производитель:	Ковидиен ЛЛС Covidien LLC, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA
Страна происхождения:	Код UPN
Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник», 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.10, эт.9, пом. III, ком. 41	
Регистрационное Удостоверение № 2022/16908 от XX.XX.XXXX	
Дата изготовления/ Серия/Использовать до:	См. упаковку См. инструкцию по применению См. символы на упаковке Изделие нетоксично 

Макет русскоязычного стикера Датчик rSO2 для взрослых INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению

Датчик для церебрального/соматического оксиметра в вариантах исполнения с принадлежностями: Датчик rSO2 детский INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению	
Производитель:	Ковидиен ЛЛС Covidien LLC, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA
Страна происхождения:	Код UPN
Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник», 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.10, эт.9, пом. III, ком. 41	
Регистрационное Удостоверение № 2022/16908 от XX.XX.XXXX	
Дата изготовления/ Серия/Использовать до:	См. упаковку См. инструкцию по применению См. символы на упаковке Изделие нетоксично 

Макет русскоязычного стикера Датчик rSO2 детский INVOS для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению

Датчик для церебрального/соматического оксиметра в вариантах исполнения с принадлежностями: Одноразовый региональный датчик насыщения кислородом для новорожденных OxyAlert NIRSensor для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению, с принадлежностями	
Производитель:	Ковидиен ЛЛС Covidien LLC, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA
Страна происхождения:	Код UPN
Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник», 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.10, эт.9, пом. III, ком. 41	
Регистрационное Удостоверение № 2022/16908 от XX.XX.XXXX	
Дата изготовления/ Серия/Использовать до:	См. упаковку См. инструкцию по применению См. символы на упаковке Изделие нетоксично 

Макет русскоязычного стикера Одноразовый региональный датчик насыщения кислородом для новорожденных OxyAlert NIRSensor для церебрального/соматического оксиметра в составе с инструкцией по применению, с принадлежностями

Датчик для церебрального/соматического оксиметра в вариантах исполнения с принадлежностями: - Кабель адаптера многоцветного, датчика для детей раннего возраста для PM7100	
Производитель:	Ковидиен ЛЛС Covidien LLC, 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA
Страна происхождения:	Код UPN
Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник», 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.10, эт.9, пом. III, ком. 41	
Регистрационное Удостоверение № 2022/16908 от XX.XX.XXXX	
Дата изготовления/ Серия/Использовать до:	См. упаковку См. инструкцию по применению См. символы на упаковке Изделие нетоксично

Макет русскоязычного стикера принадлежности Кабель адаптера многоцветного, датчика для детей раннего возраста для PM7100



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
17 листа(ов)

