

Фотографические изображения
медицинского изделия

*Система ультразвуковая диагностическая меди-
цинская Voluson S с принадлежностями*

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела по регистрации
и сертификации Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б. Парахина

« 20 » декабря 2018г.





GE Ultrasound Korea Ltd ,
Sunhwan-ro 214 beon-gil,
Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea

121 kg

Класс 1

100-120 V~, 50/60 Hz, 900 VA

220-240 V~, 50/60 Hz, 900 VA

VOLUSON S6

5669994



VOLUSON S6 BT16



2018-01



VS6001057



(01)0000000000000000

(11)000000(21)0000000000





GE Ultrasound Korea, Ltd.

9, Sunhwan-ro 214beon-gil,

Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

100-120V~, 50/60Hz, 900VA 220-240V~, 50/60Hz, 900VA

VOLUSON S8

121 kg Класс I



2018-01



VOLUSON S8 BT18

1234567




123456789




(01)0000000000000000

(11)000000(21)00000000




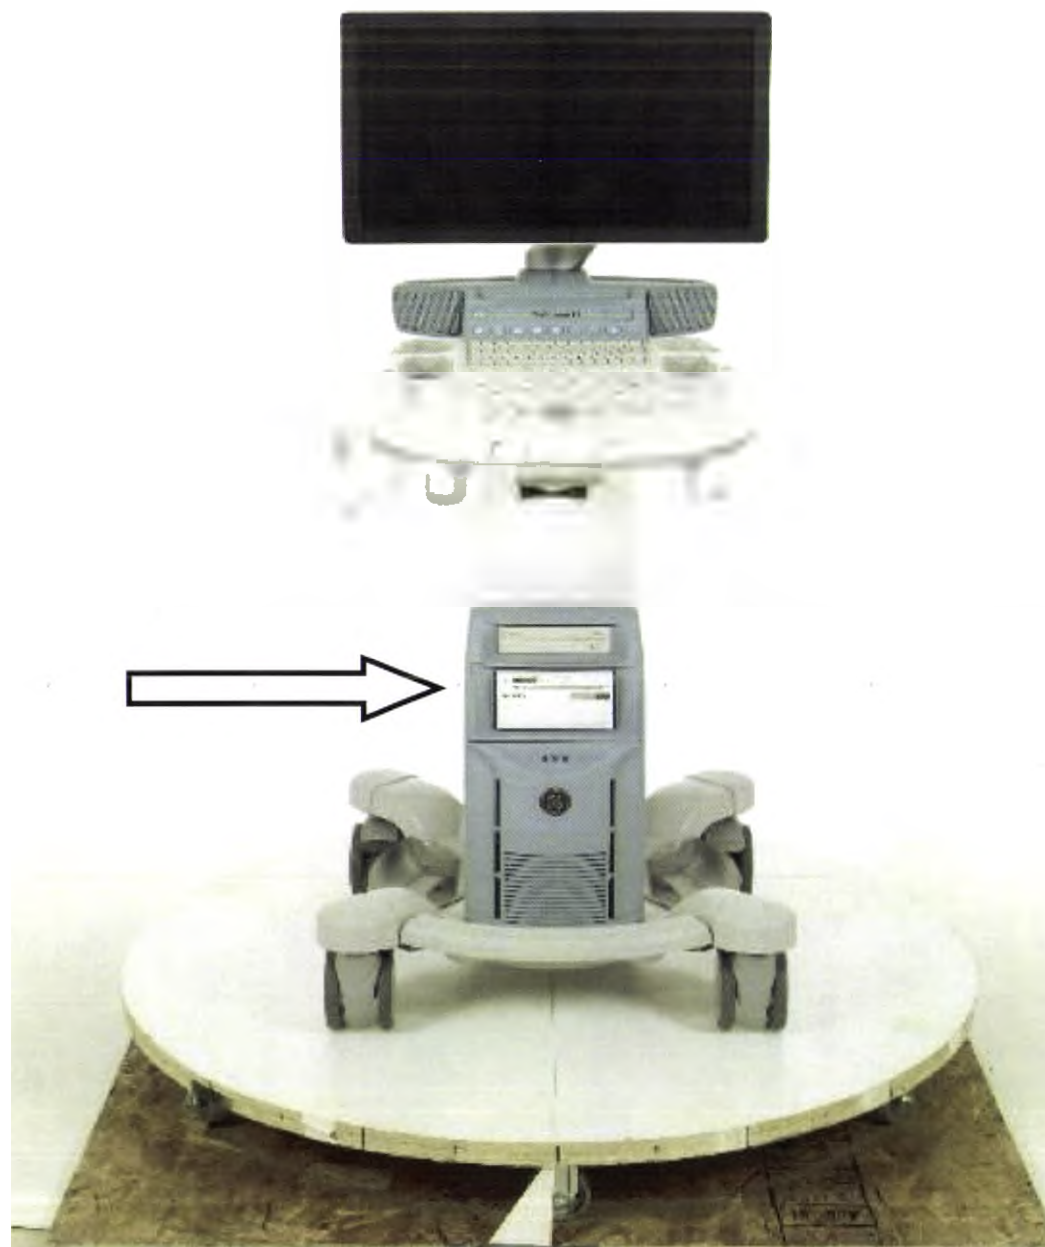


2.Монитор.

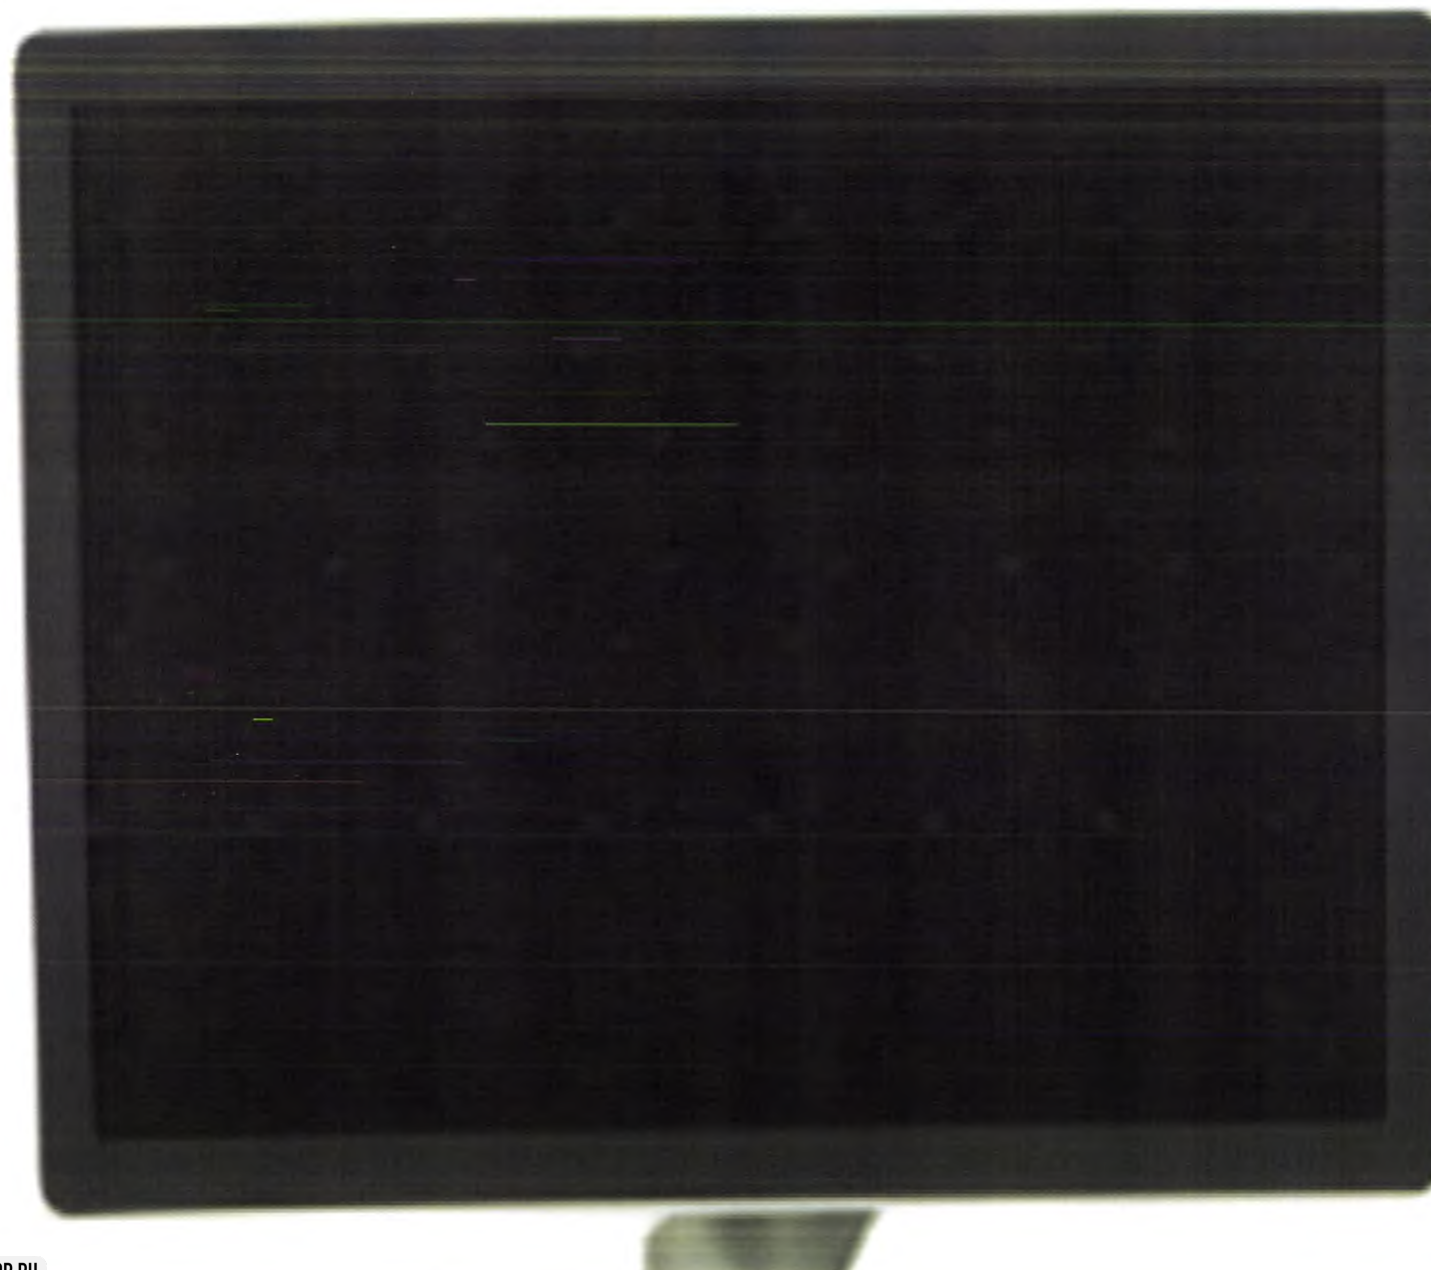


3. Кабель электропитания.

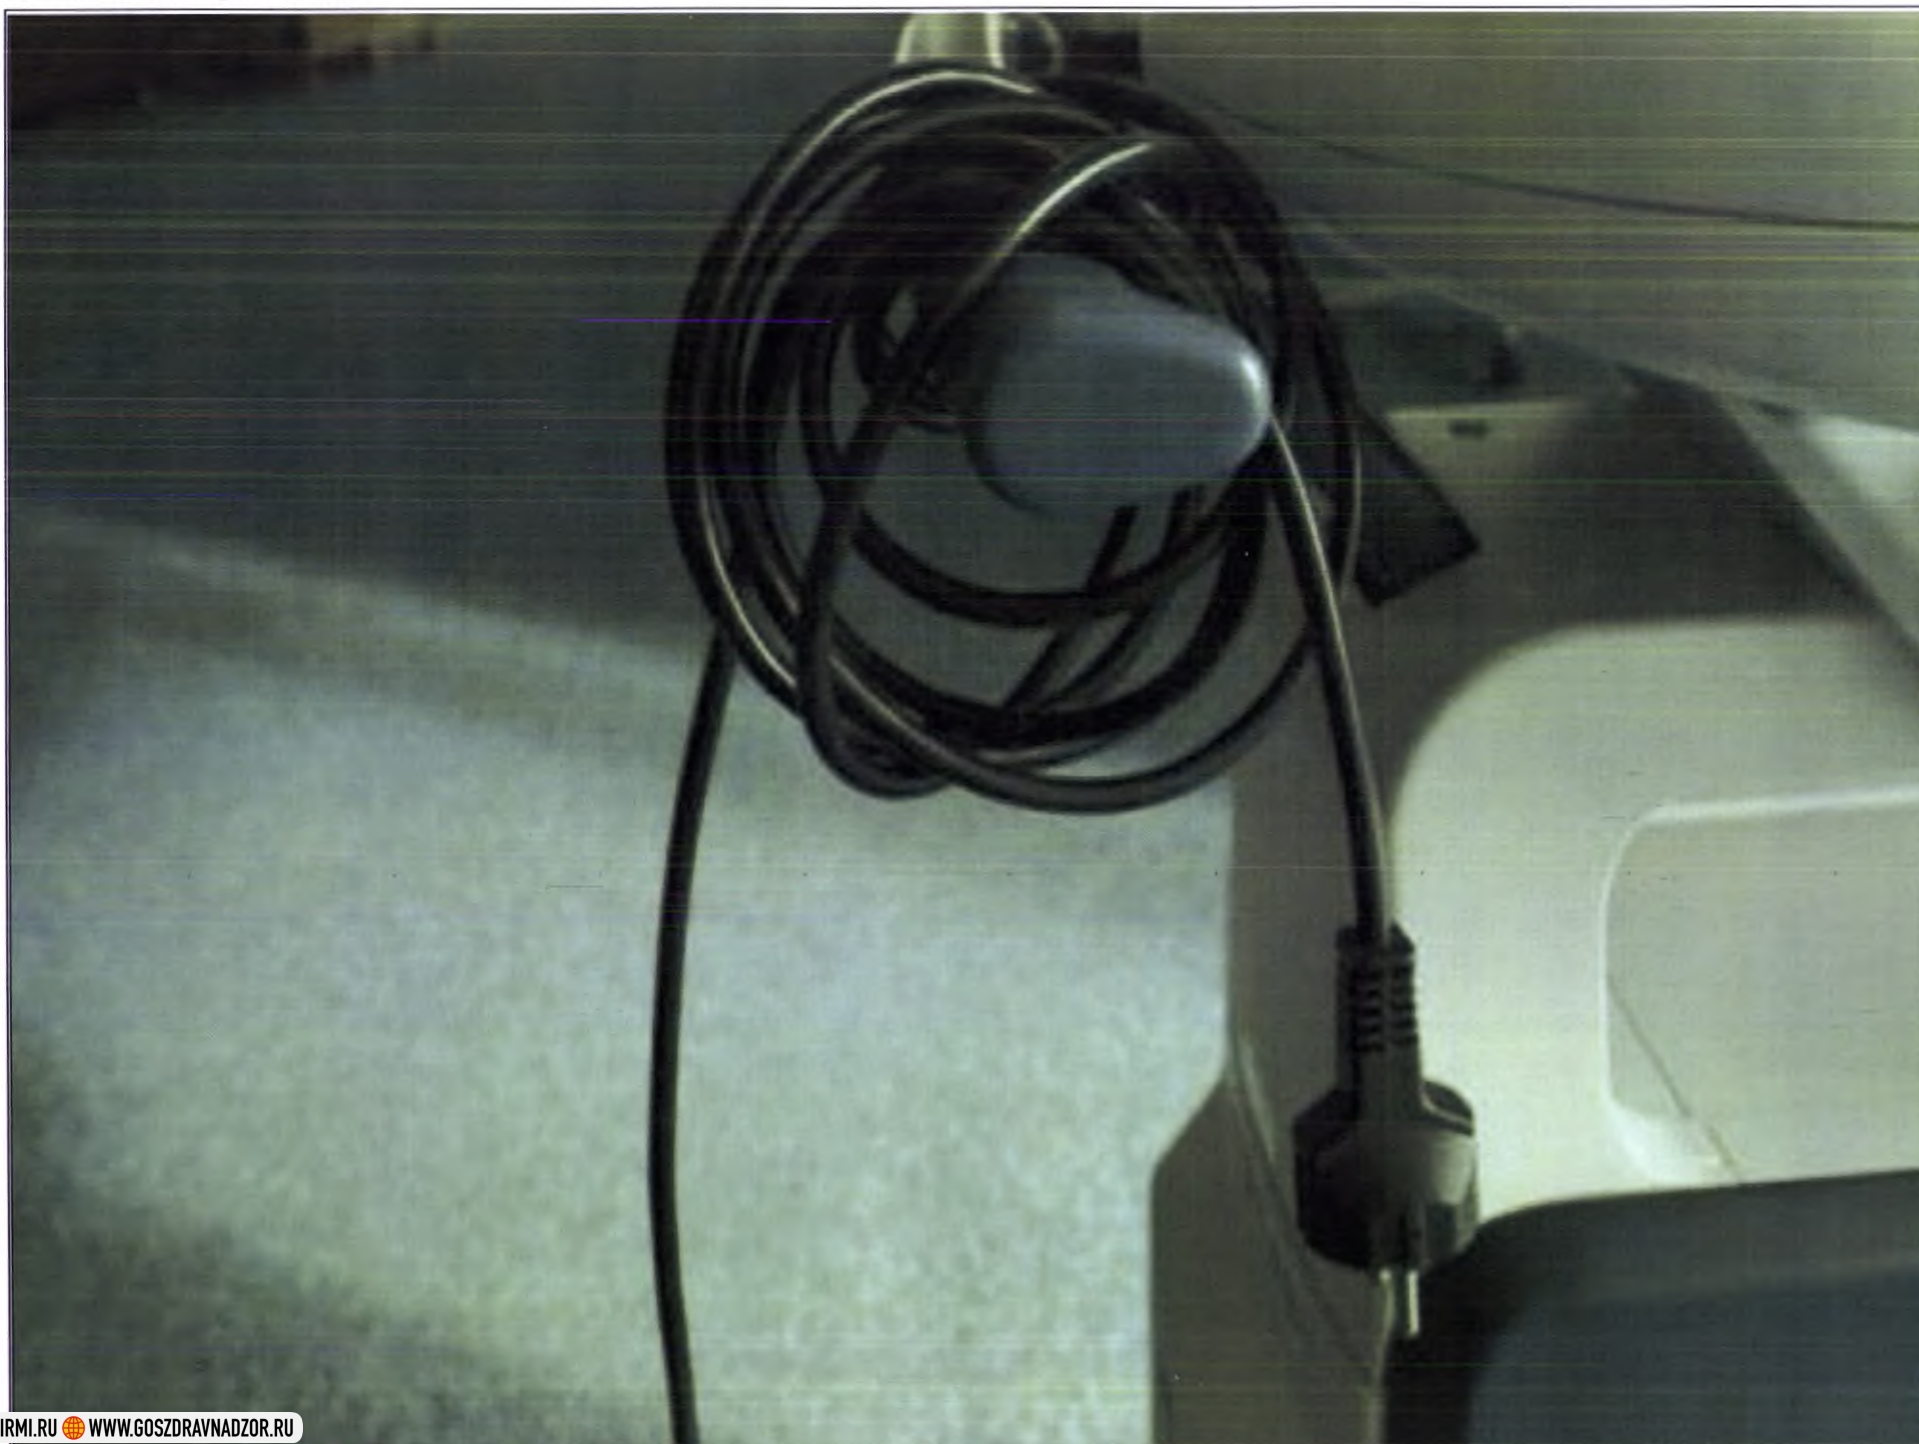

4. Руководства пользователя.

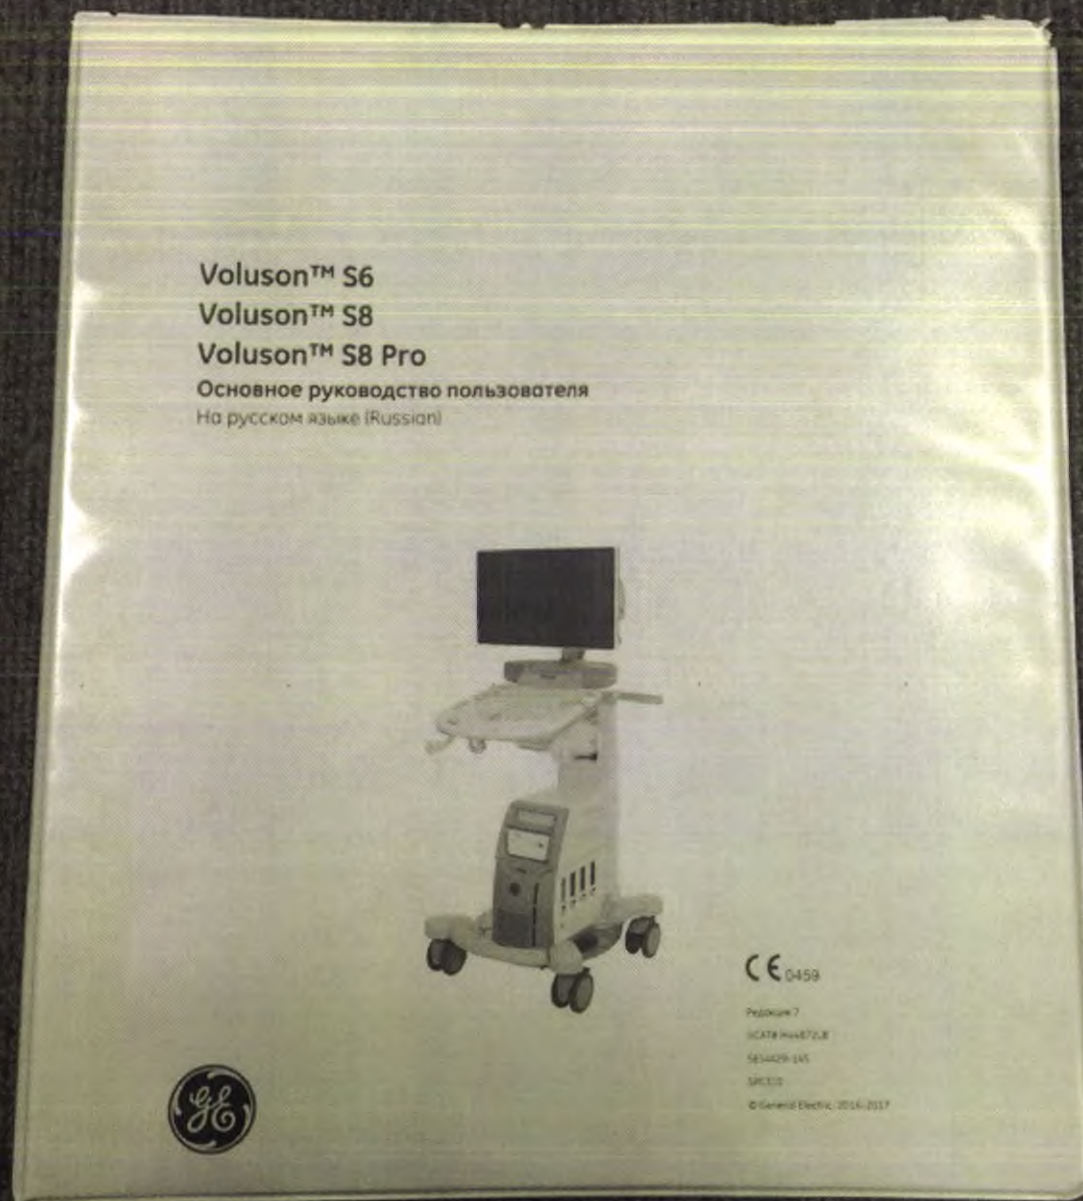

4. Руководства пользователя.

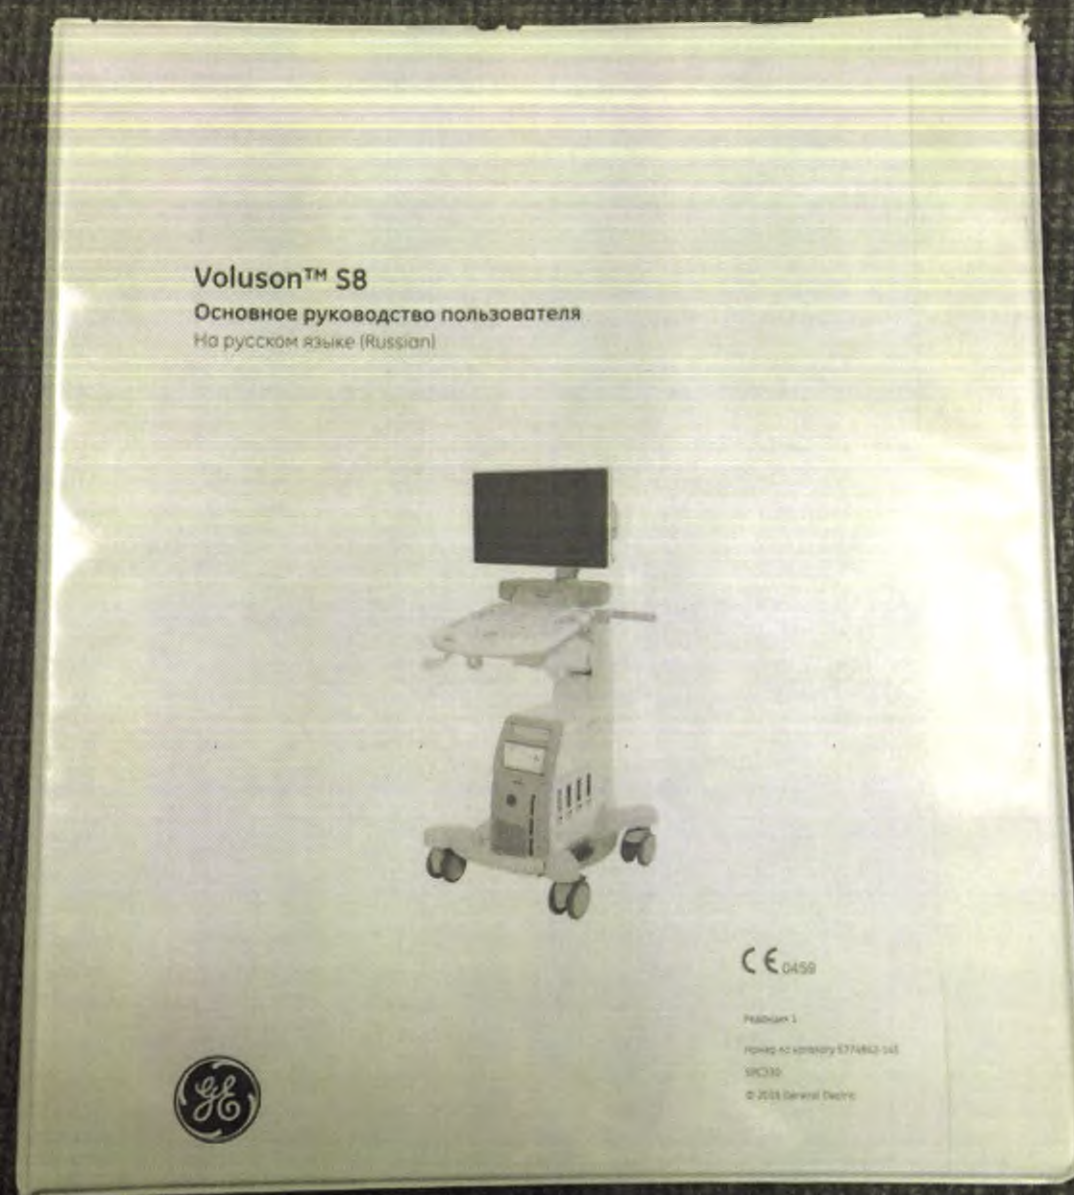

1. Программное обеспечение Voluson S.

Probe Select



IC9



C4-8



RAB2-6




RAB6


2. Руководство пользователя на русском языке.



2. Руководство пользователя на русском языке.

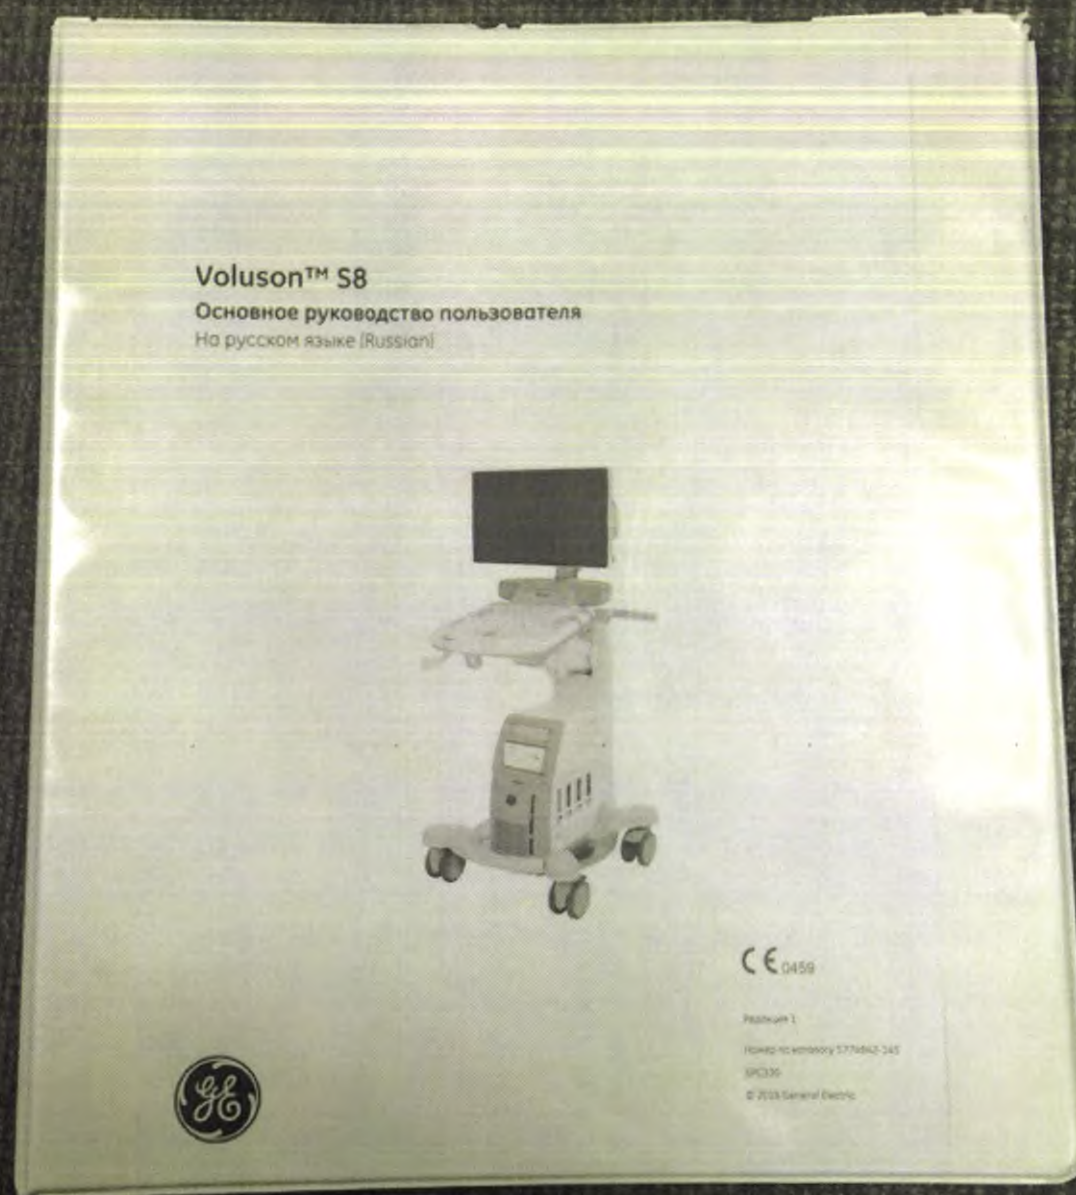

3. Руководство пользователя на английском языке.

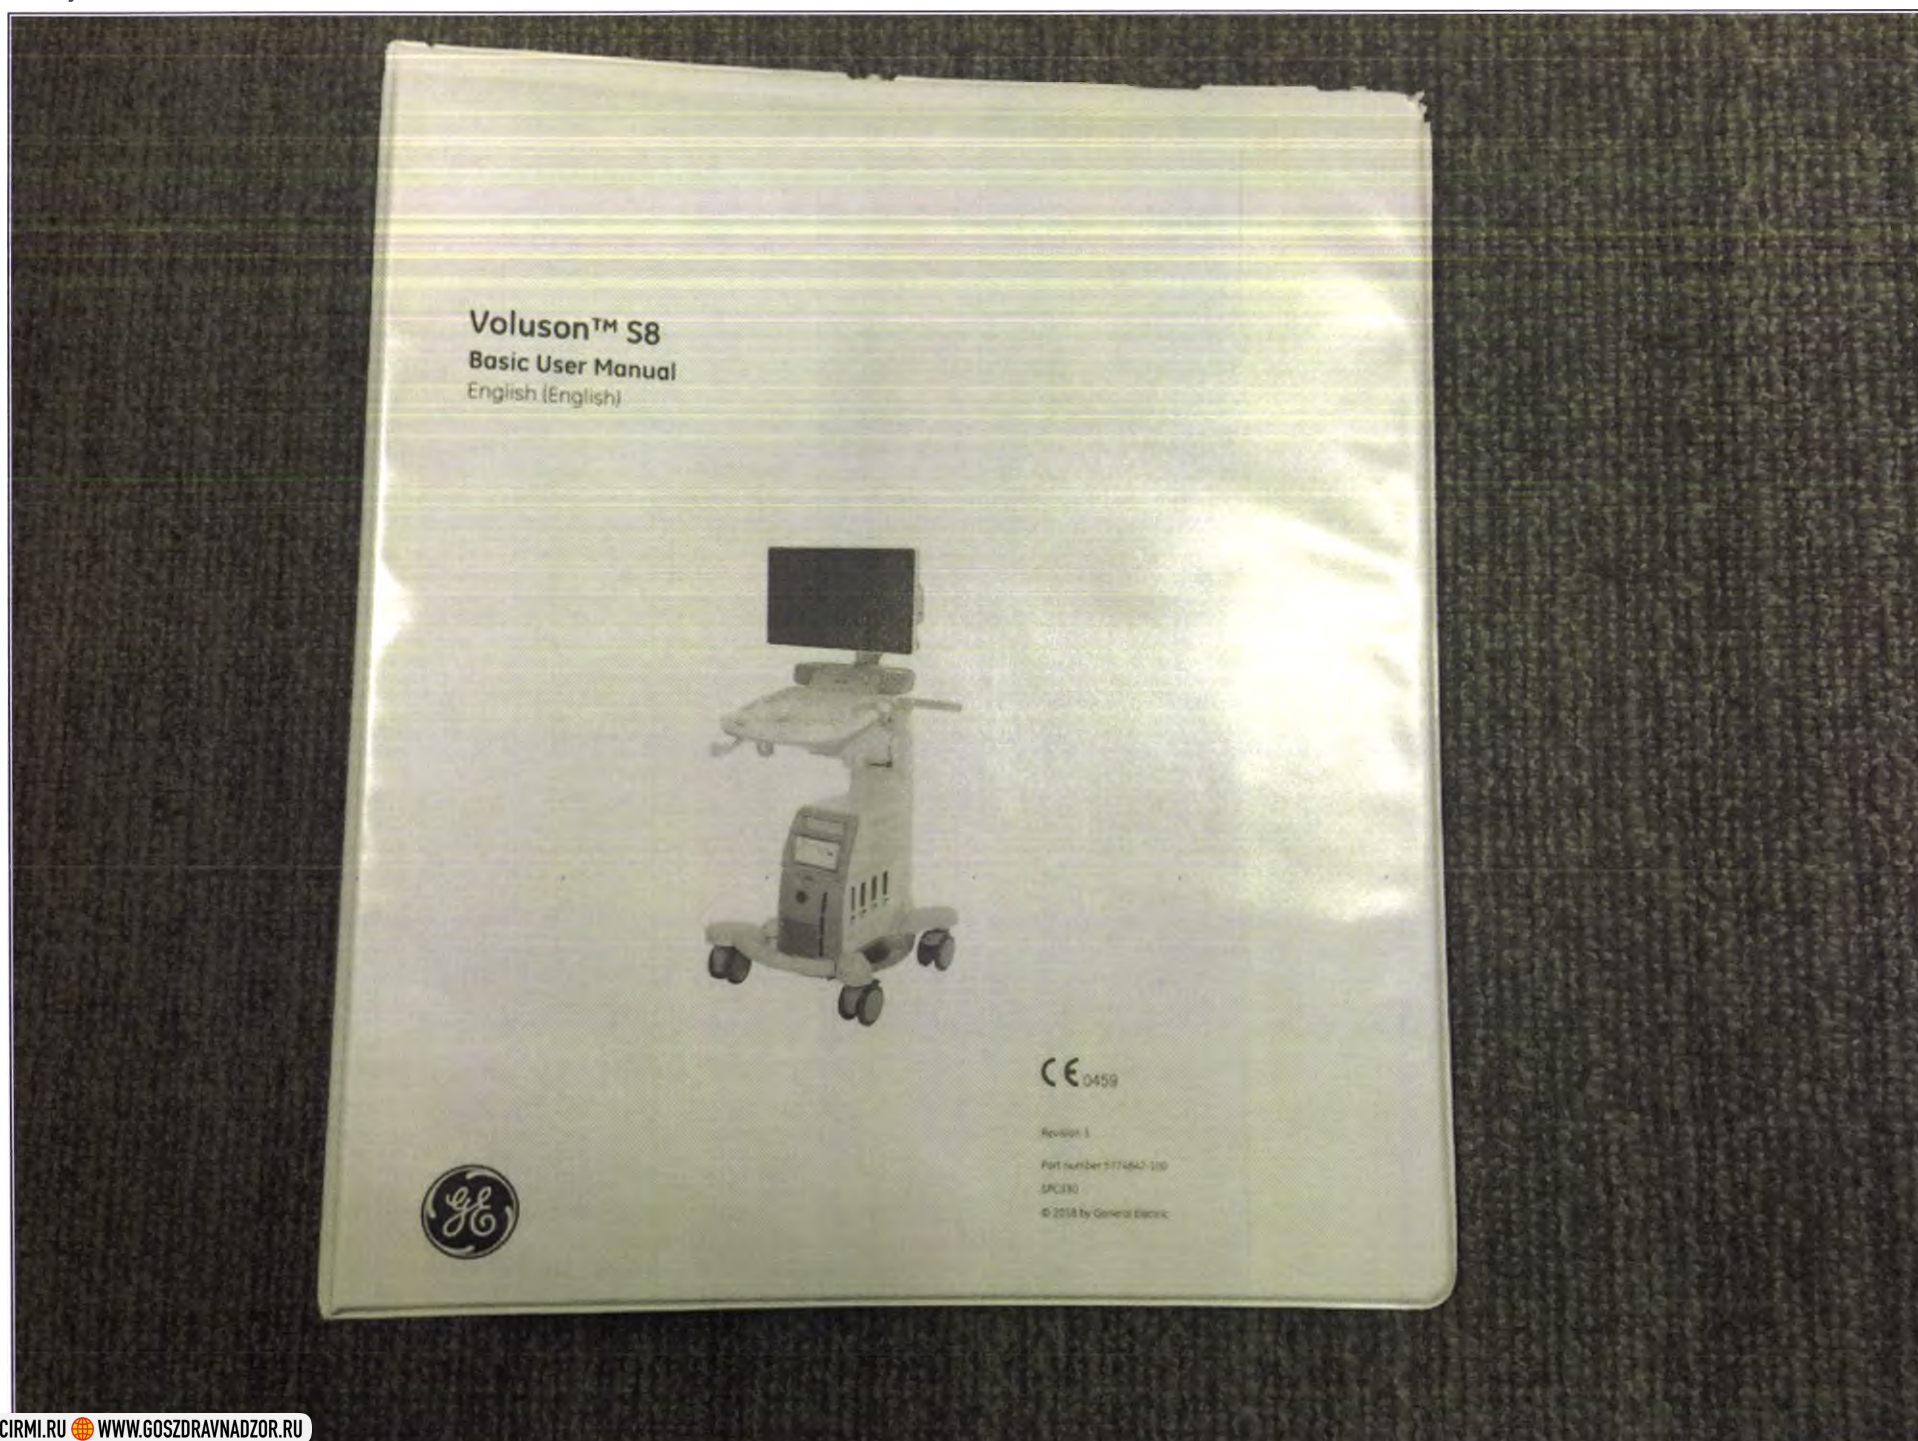


4. Накладки на клавиатуру.




5. Датчики конвексные (не более 20 шт.).



5. Датчики конвексные (не более 20 шт.).

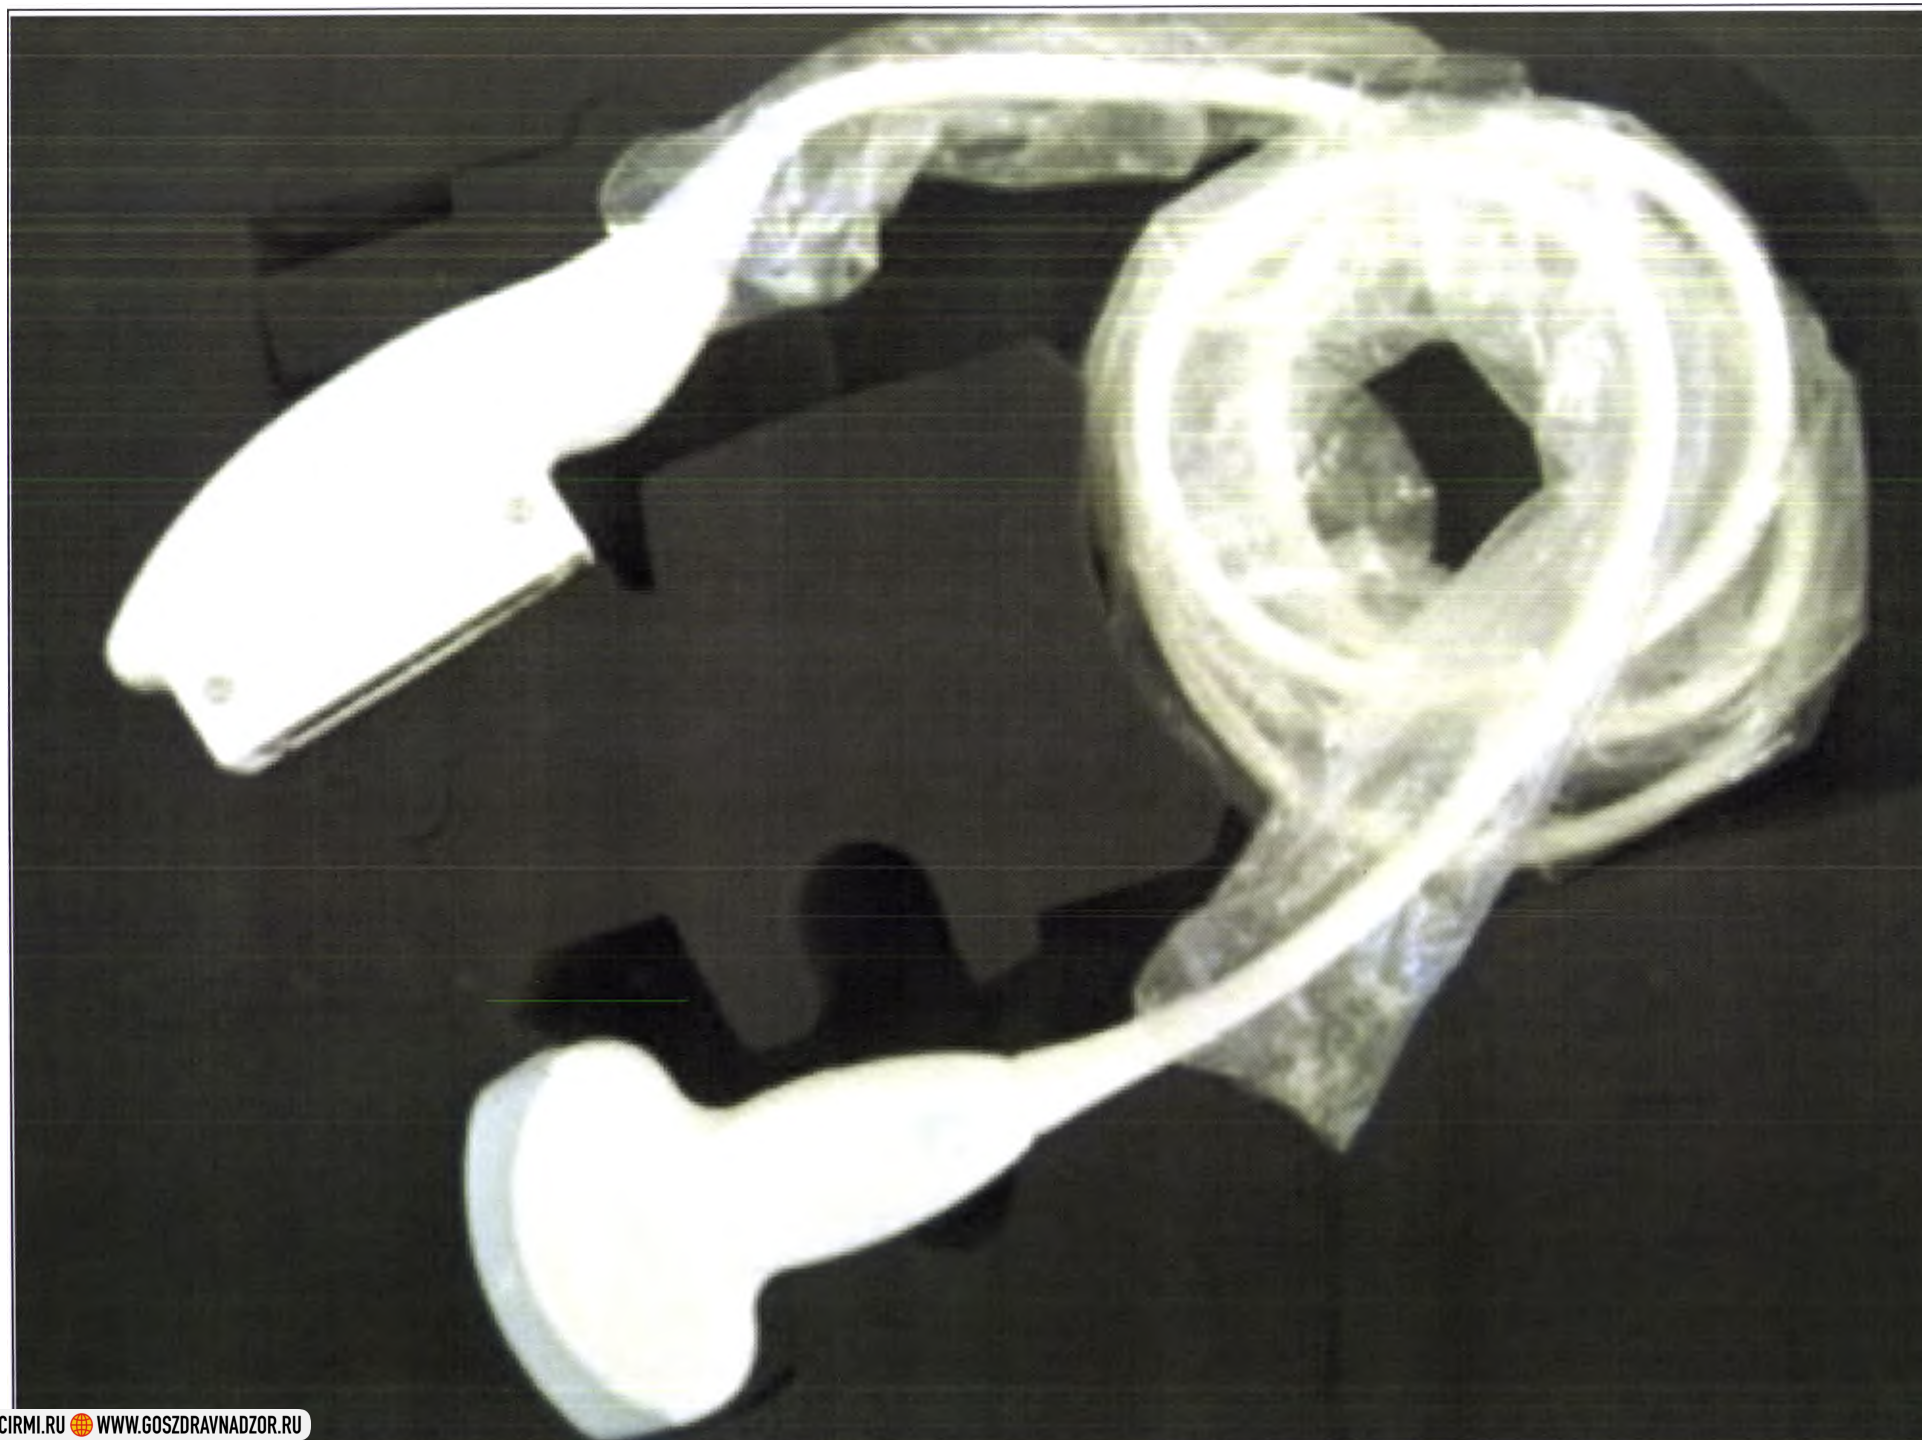

5. Датчики конвексные (не более 20 шт.).

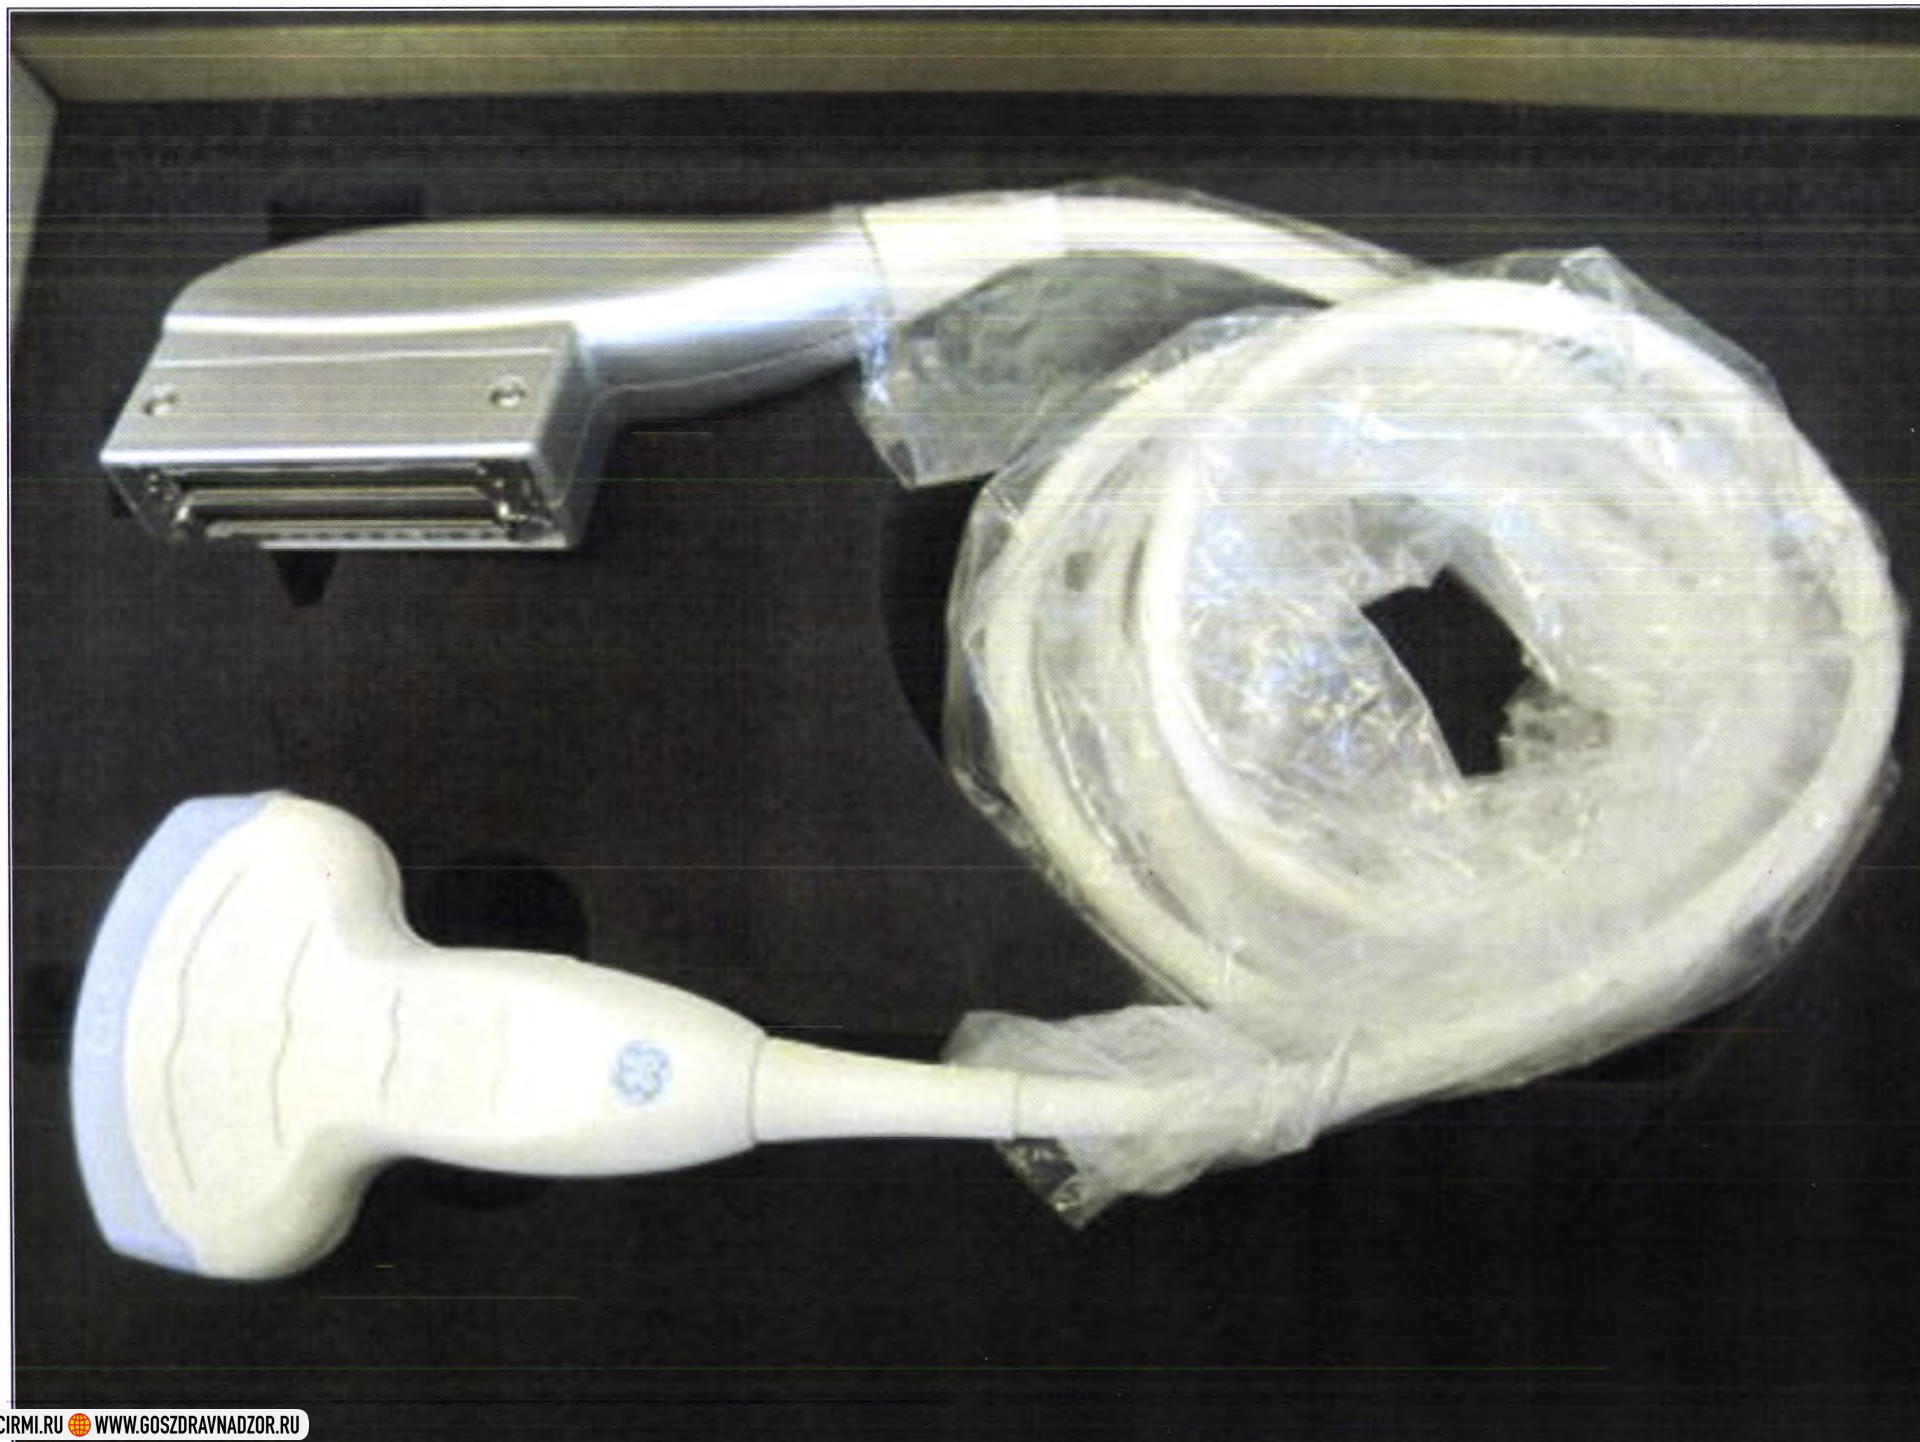

6. Биопсийные насадки для конвексных датчиков (не более 20 шт.).




6. Биопсийные насадки для конвексных датчиков (не более 20 шт.).




7. Датчики микроконвексные (не более 20 шт.)



8. Биопсийные насадки для микроконвексных датчиков (не более 20 шт.)

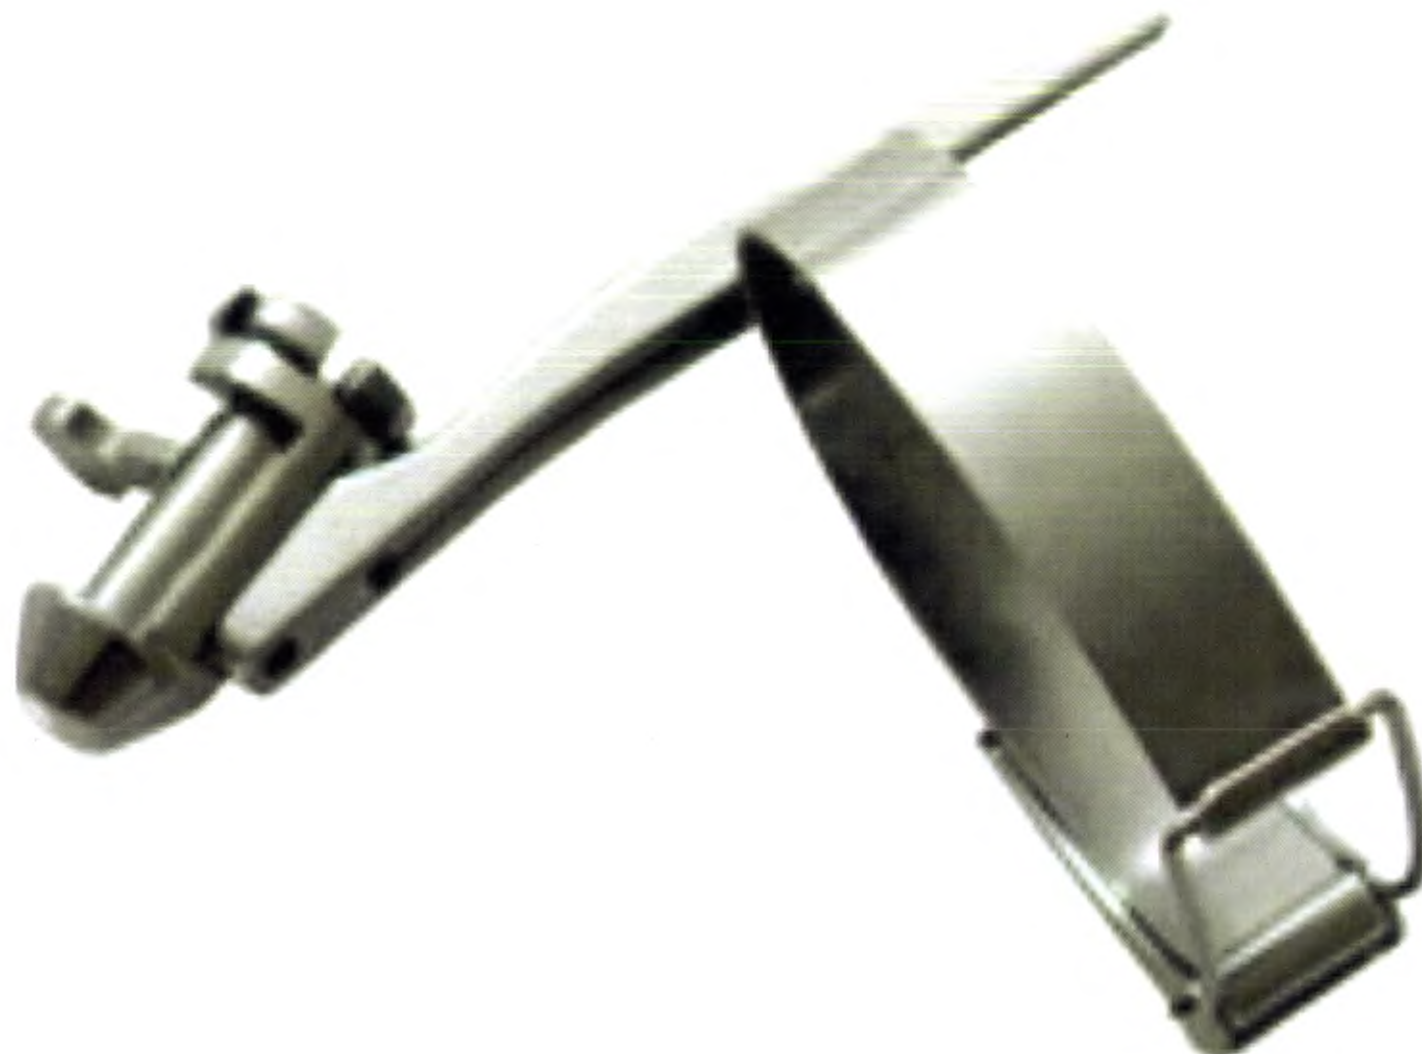

9. Датчики матричные (не более 20 шт.)

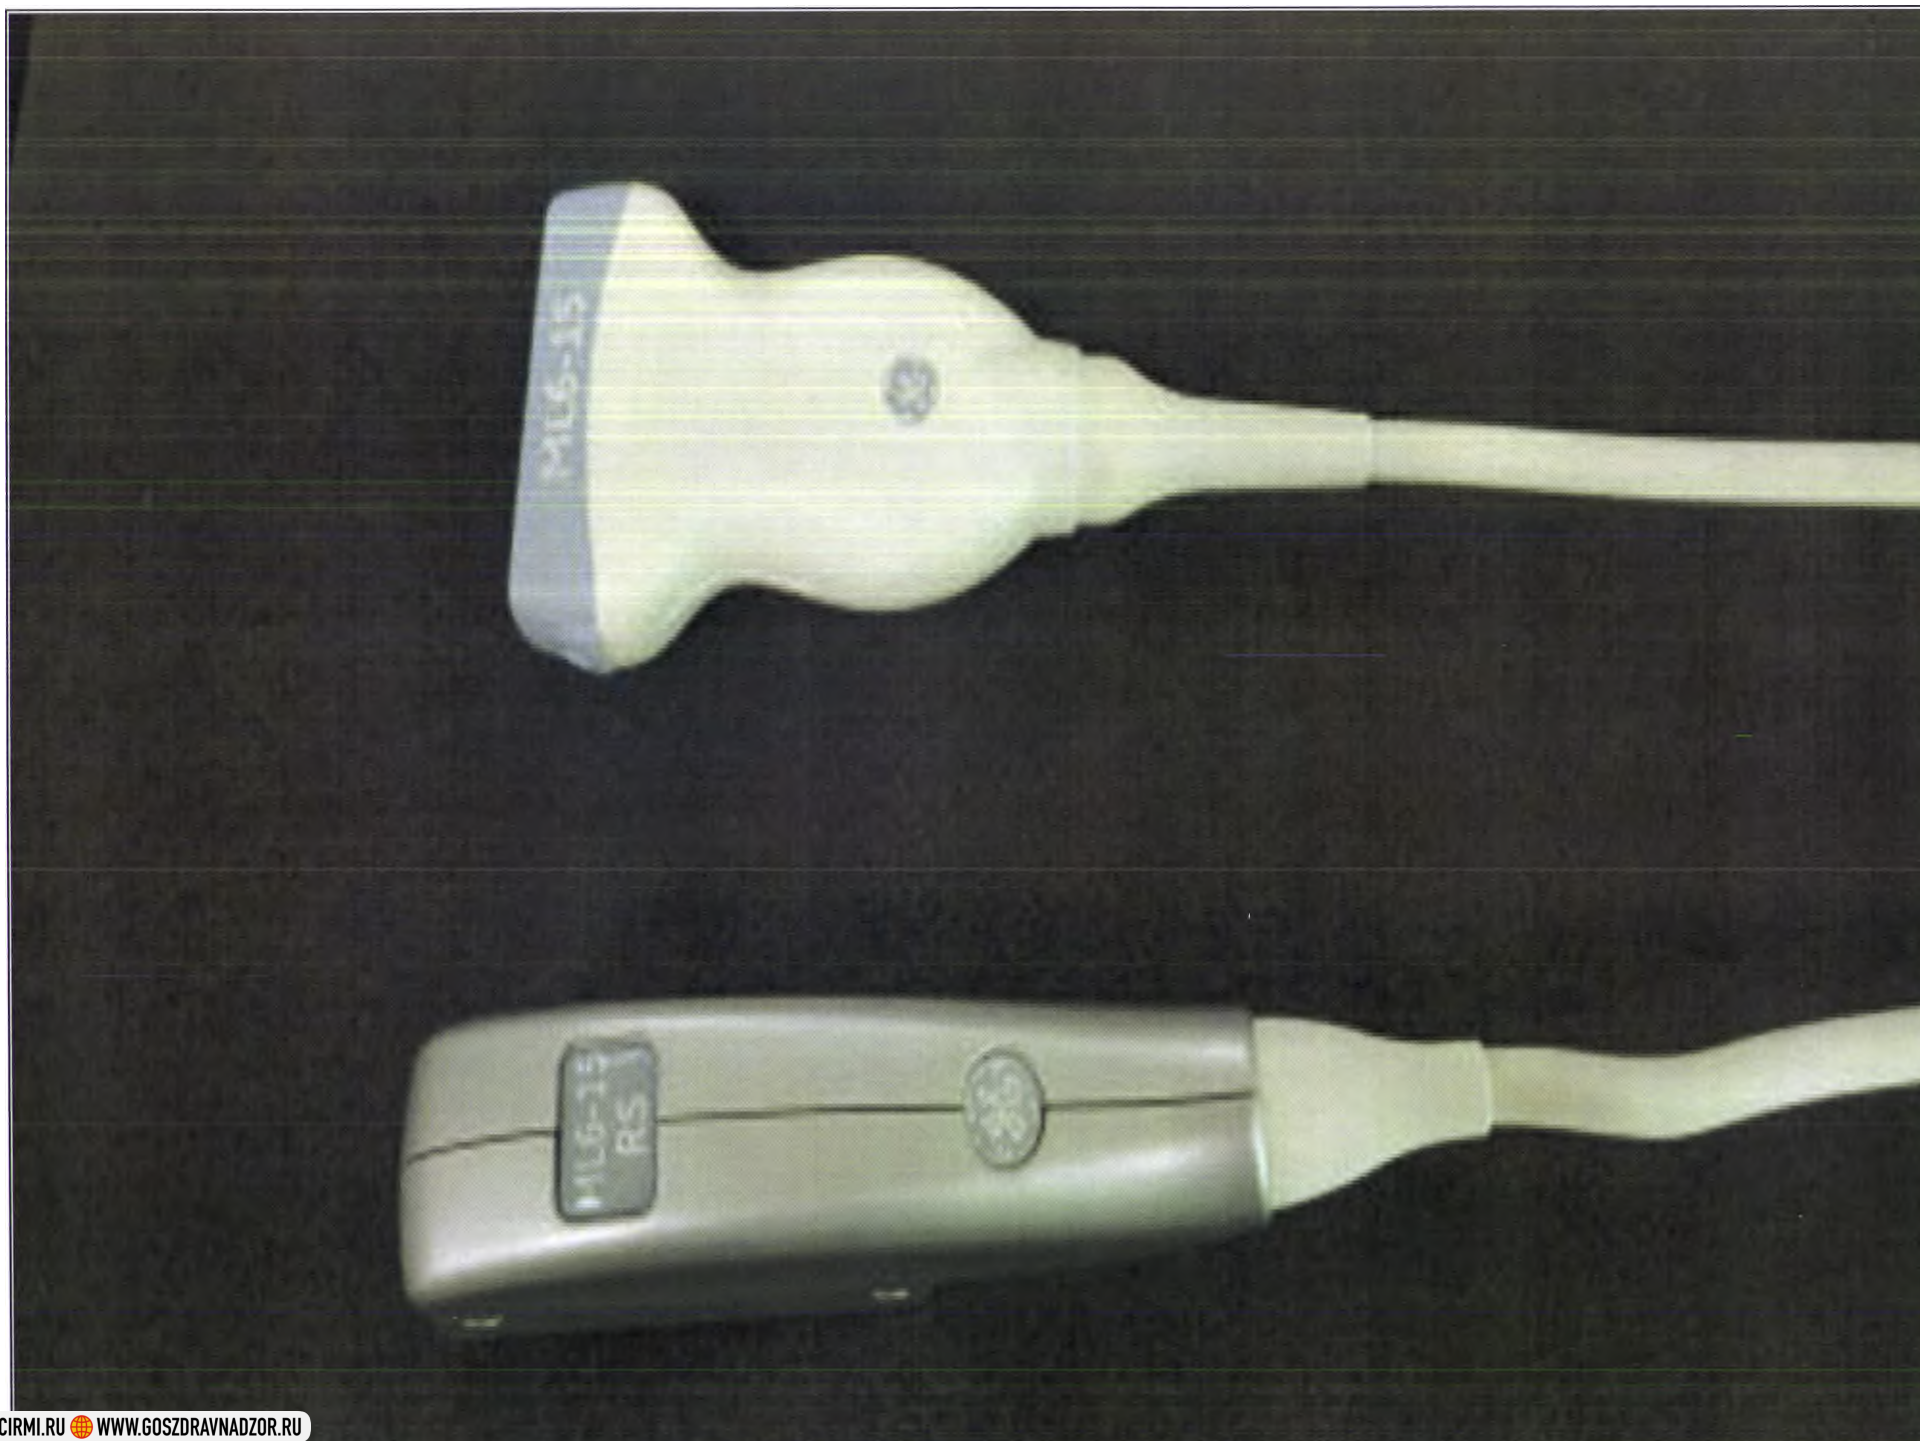

10. Биопсийные насадки для матричных датчиков (не более 20 шт.)



11. Датчики линейные (не более 20 шт.)



11. Датчики линейные (не более 20 шт.)



11. Датчики линейные (не более 20 шт.)



12. Биопсийные насадки для линейных датчиков (не более 20 шт.)



12. Биопсийные насадки для линейных датчиков (не более 20 шт.)




13. Датчики секторные (не более 20 шт.)



13. Датчики секторные (не более 20 шт.)



13. Датчики секторные (не более 20 шт.)

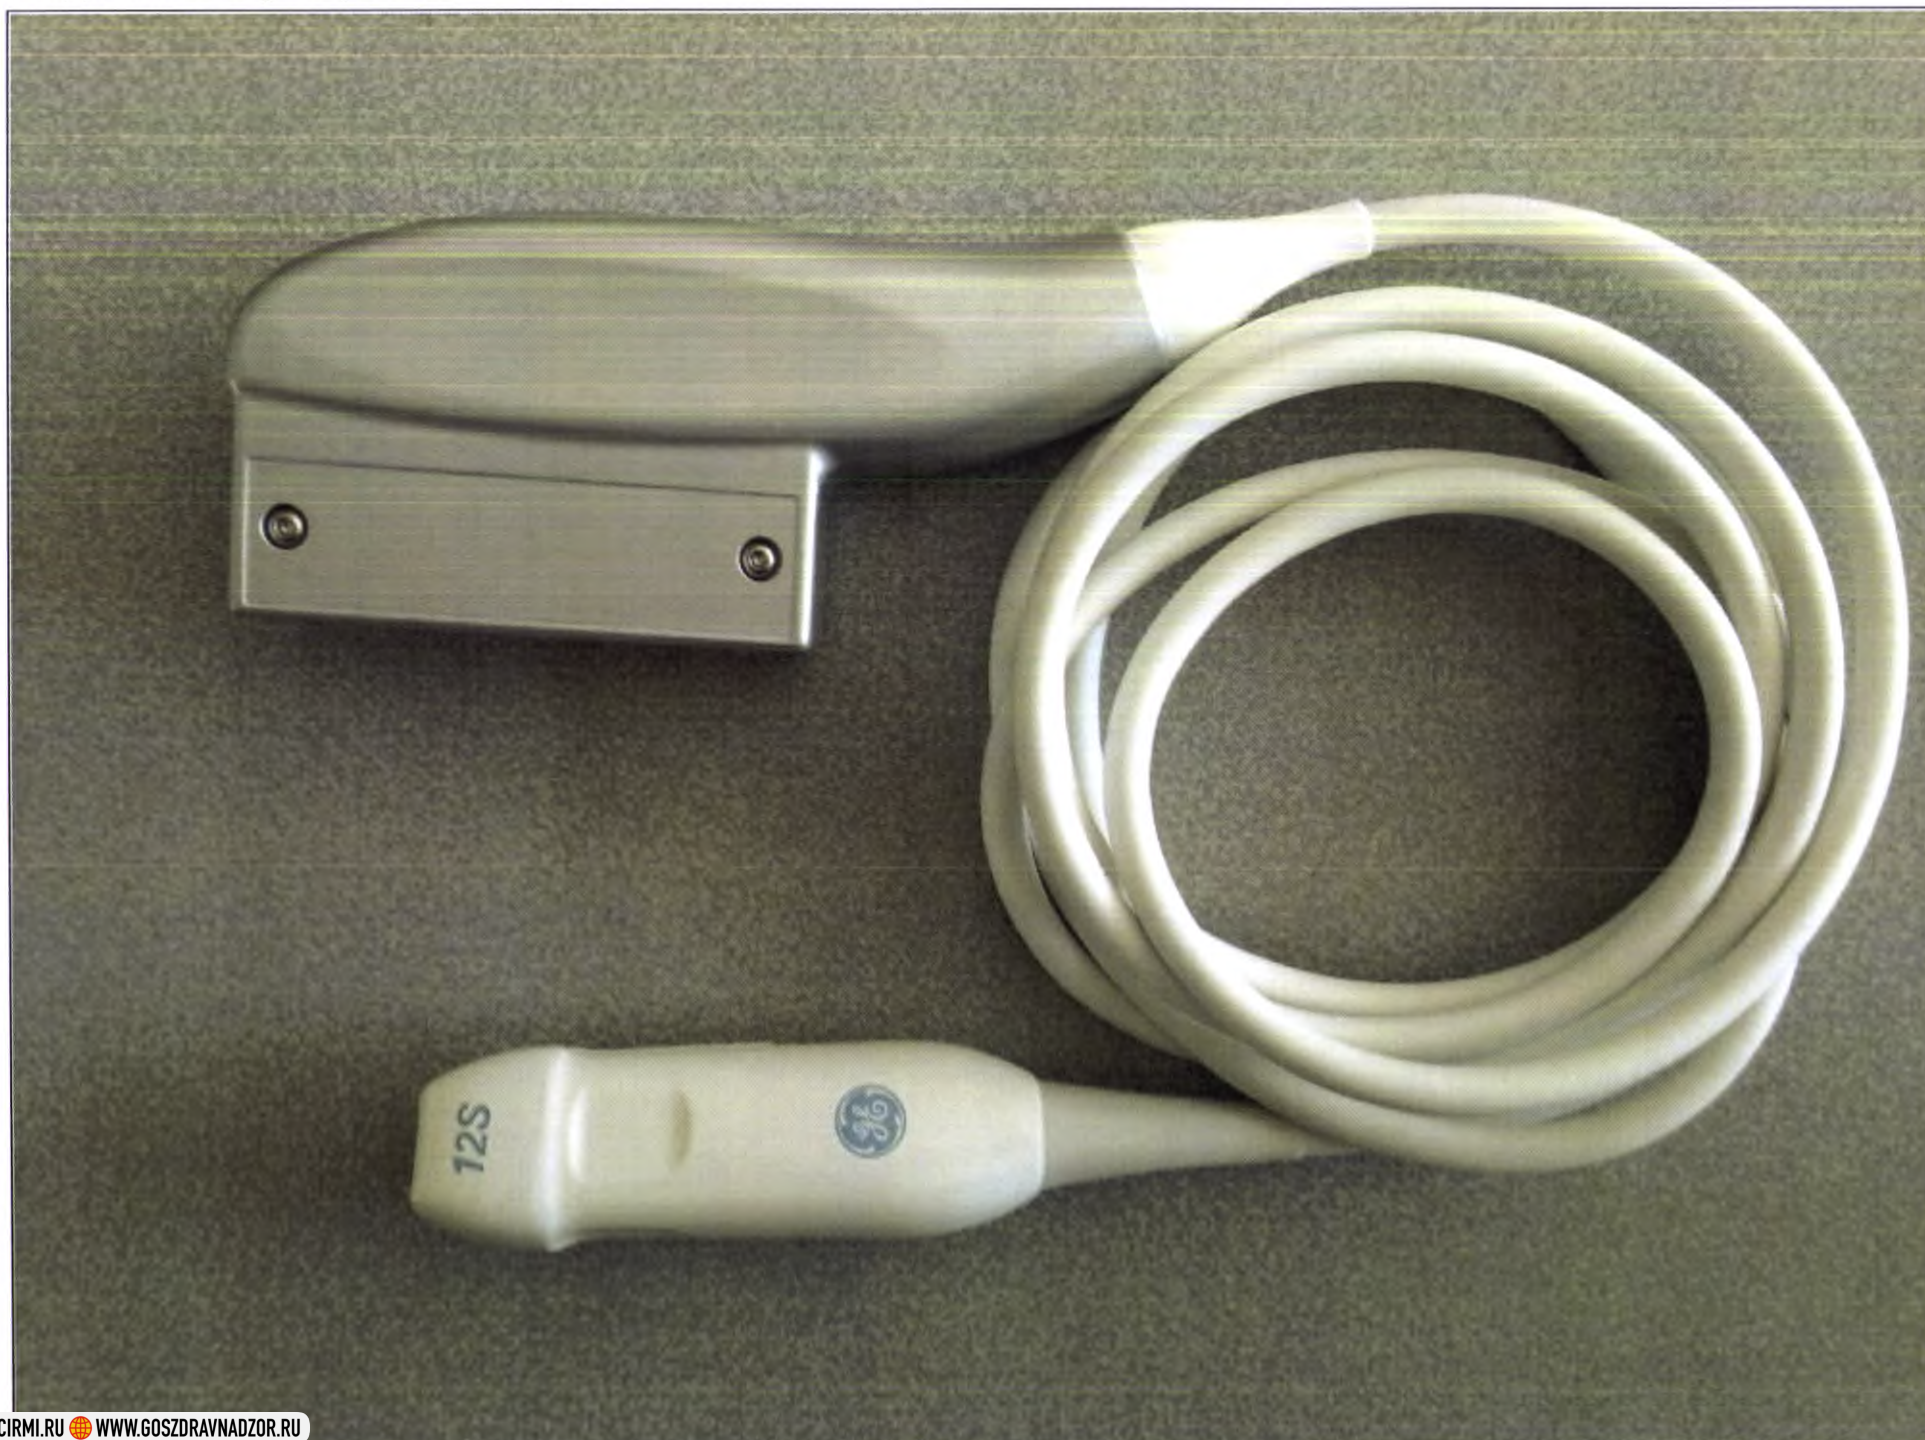

14. Биопсийные насадки для секторных датчиков (не более 20 шт.)



15. Датчики микроконвексные внутриполостные (не более 5 шт.)




15. Датчики микроконвексные внутрисполостные (не более 5 шт.)



15. Датчики микроконвексные внутриполостные (не более 5 шт.)



15. Датчики микроконвексные внутрисполостные (не более 5 шт.)

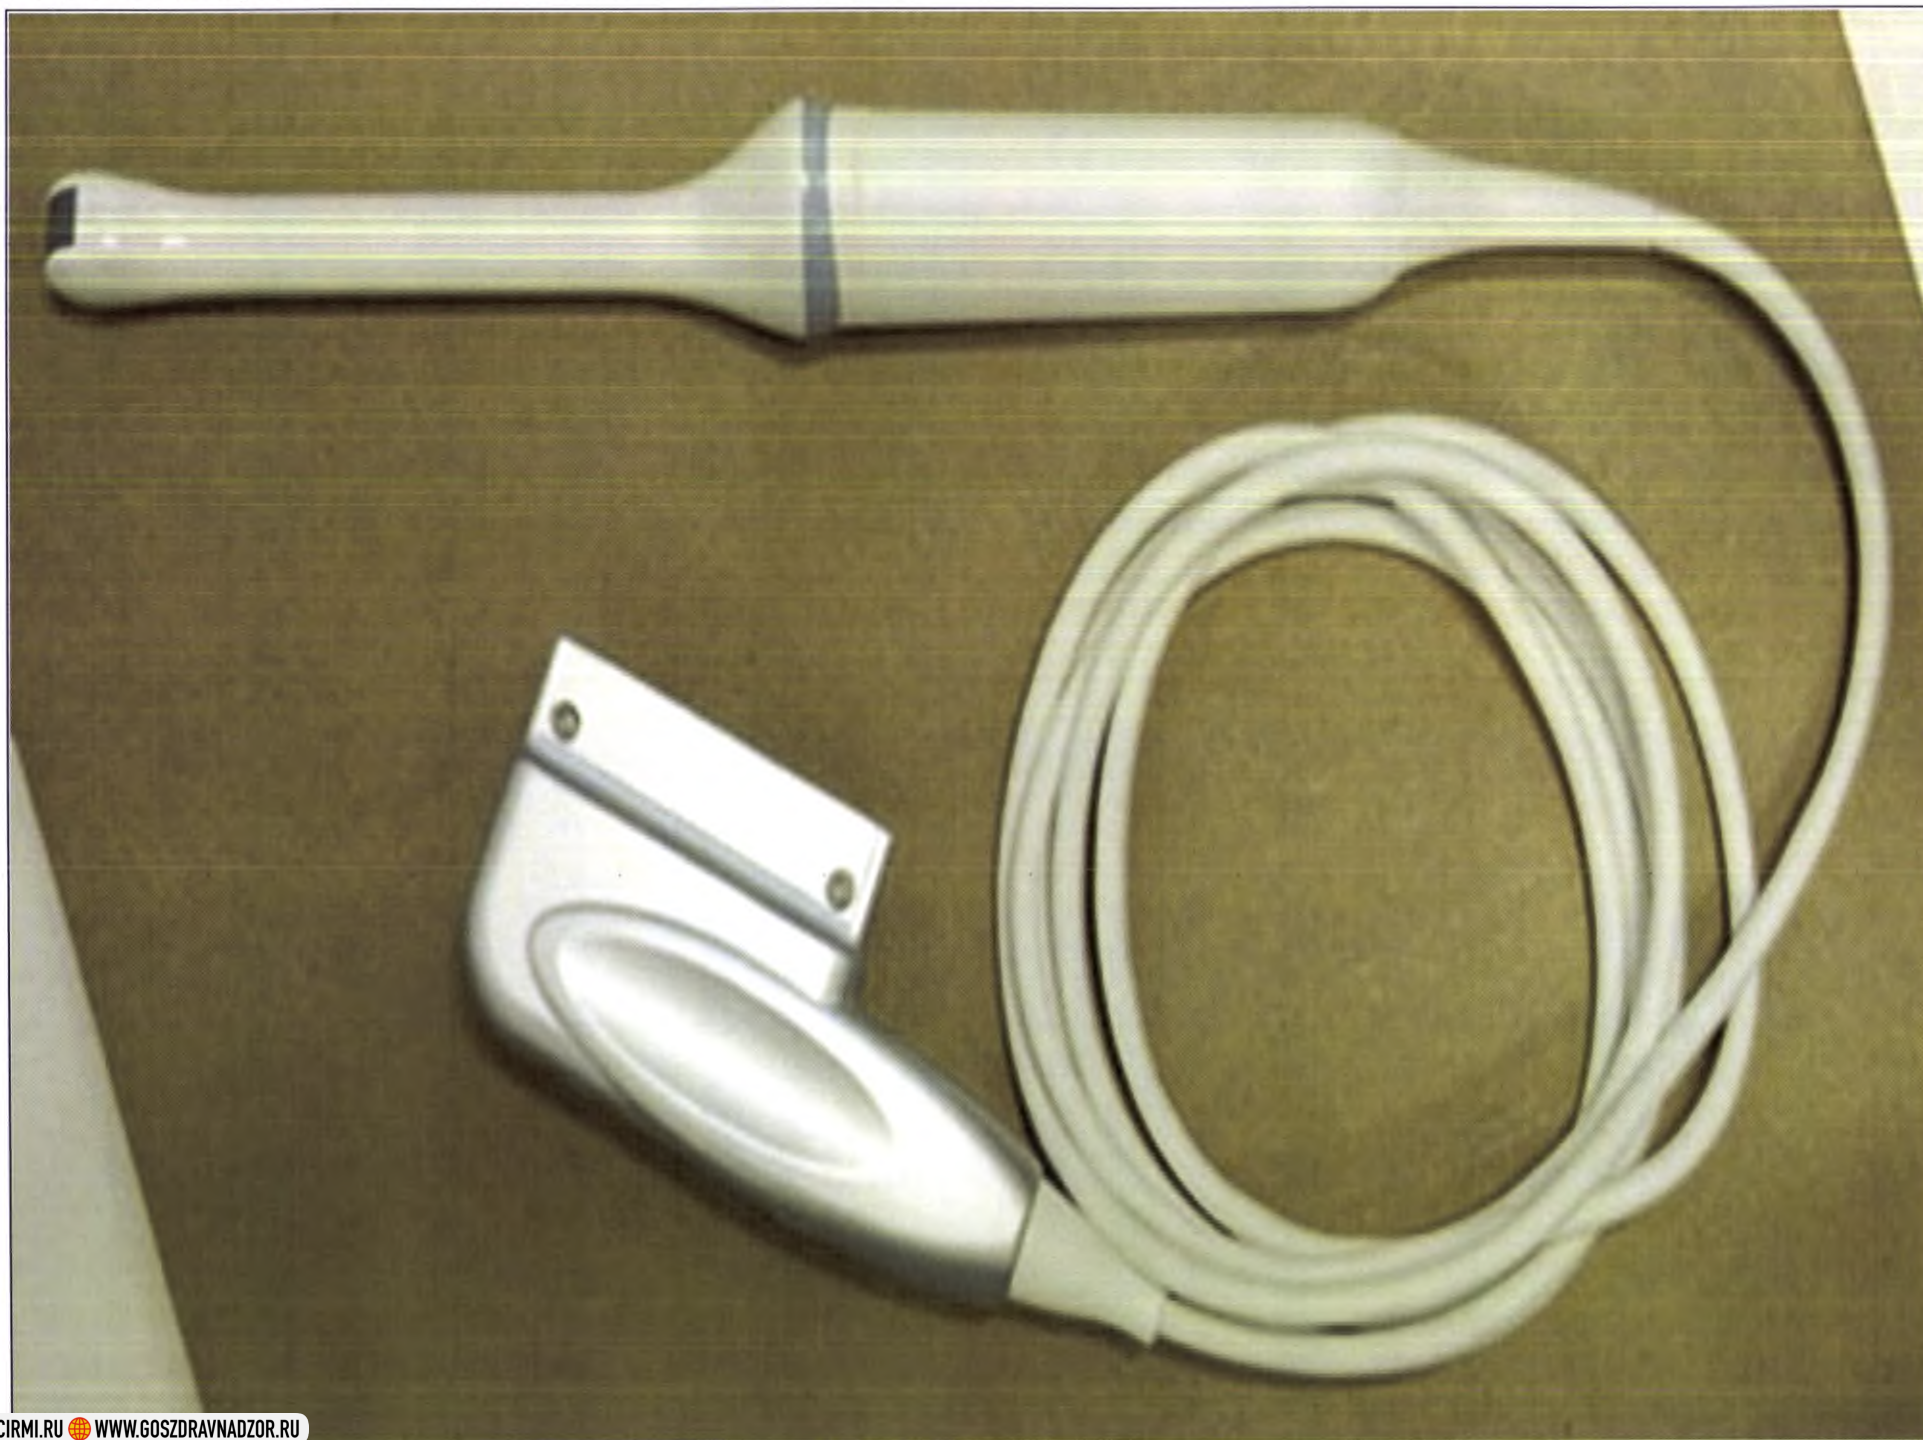

16. Биопсийные насадки для микроконвексных внутривполостных датчиков (не более 10 шт.)



16. Биопсийные насадки для микроконвексных внутрисполостных датчиков (не более 10 шт.)



16. Биопсийные насадки для микроконвексных внутриполостных датчиков (не более 10 шт.)



17. Датчики 4D конвексные мультимастотные (не более 20 шт.)



17. Датчики 4D конвексные мультитемпературные (не более 20 шт.)



17. Датчики 4D конвексные мультитемпературные (не более 20 шт.)



18. Биопсийные пилы для конвексных 4D датчиков (не более 20 шт.).




18. Биопсийные насадки для конвексных 4D датчиков (не более 20 шт.).




19. Датчики 4D внутриполостные мультимастотные (не более 20 шт.)



19. Датчики 4D внутриполостные мультимастотные (не более 20 шт.)

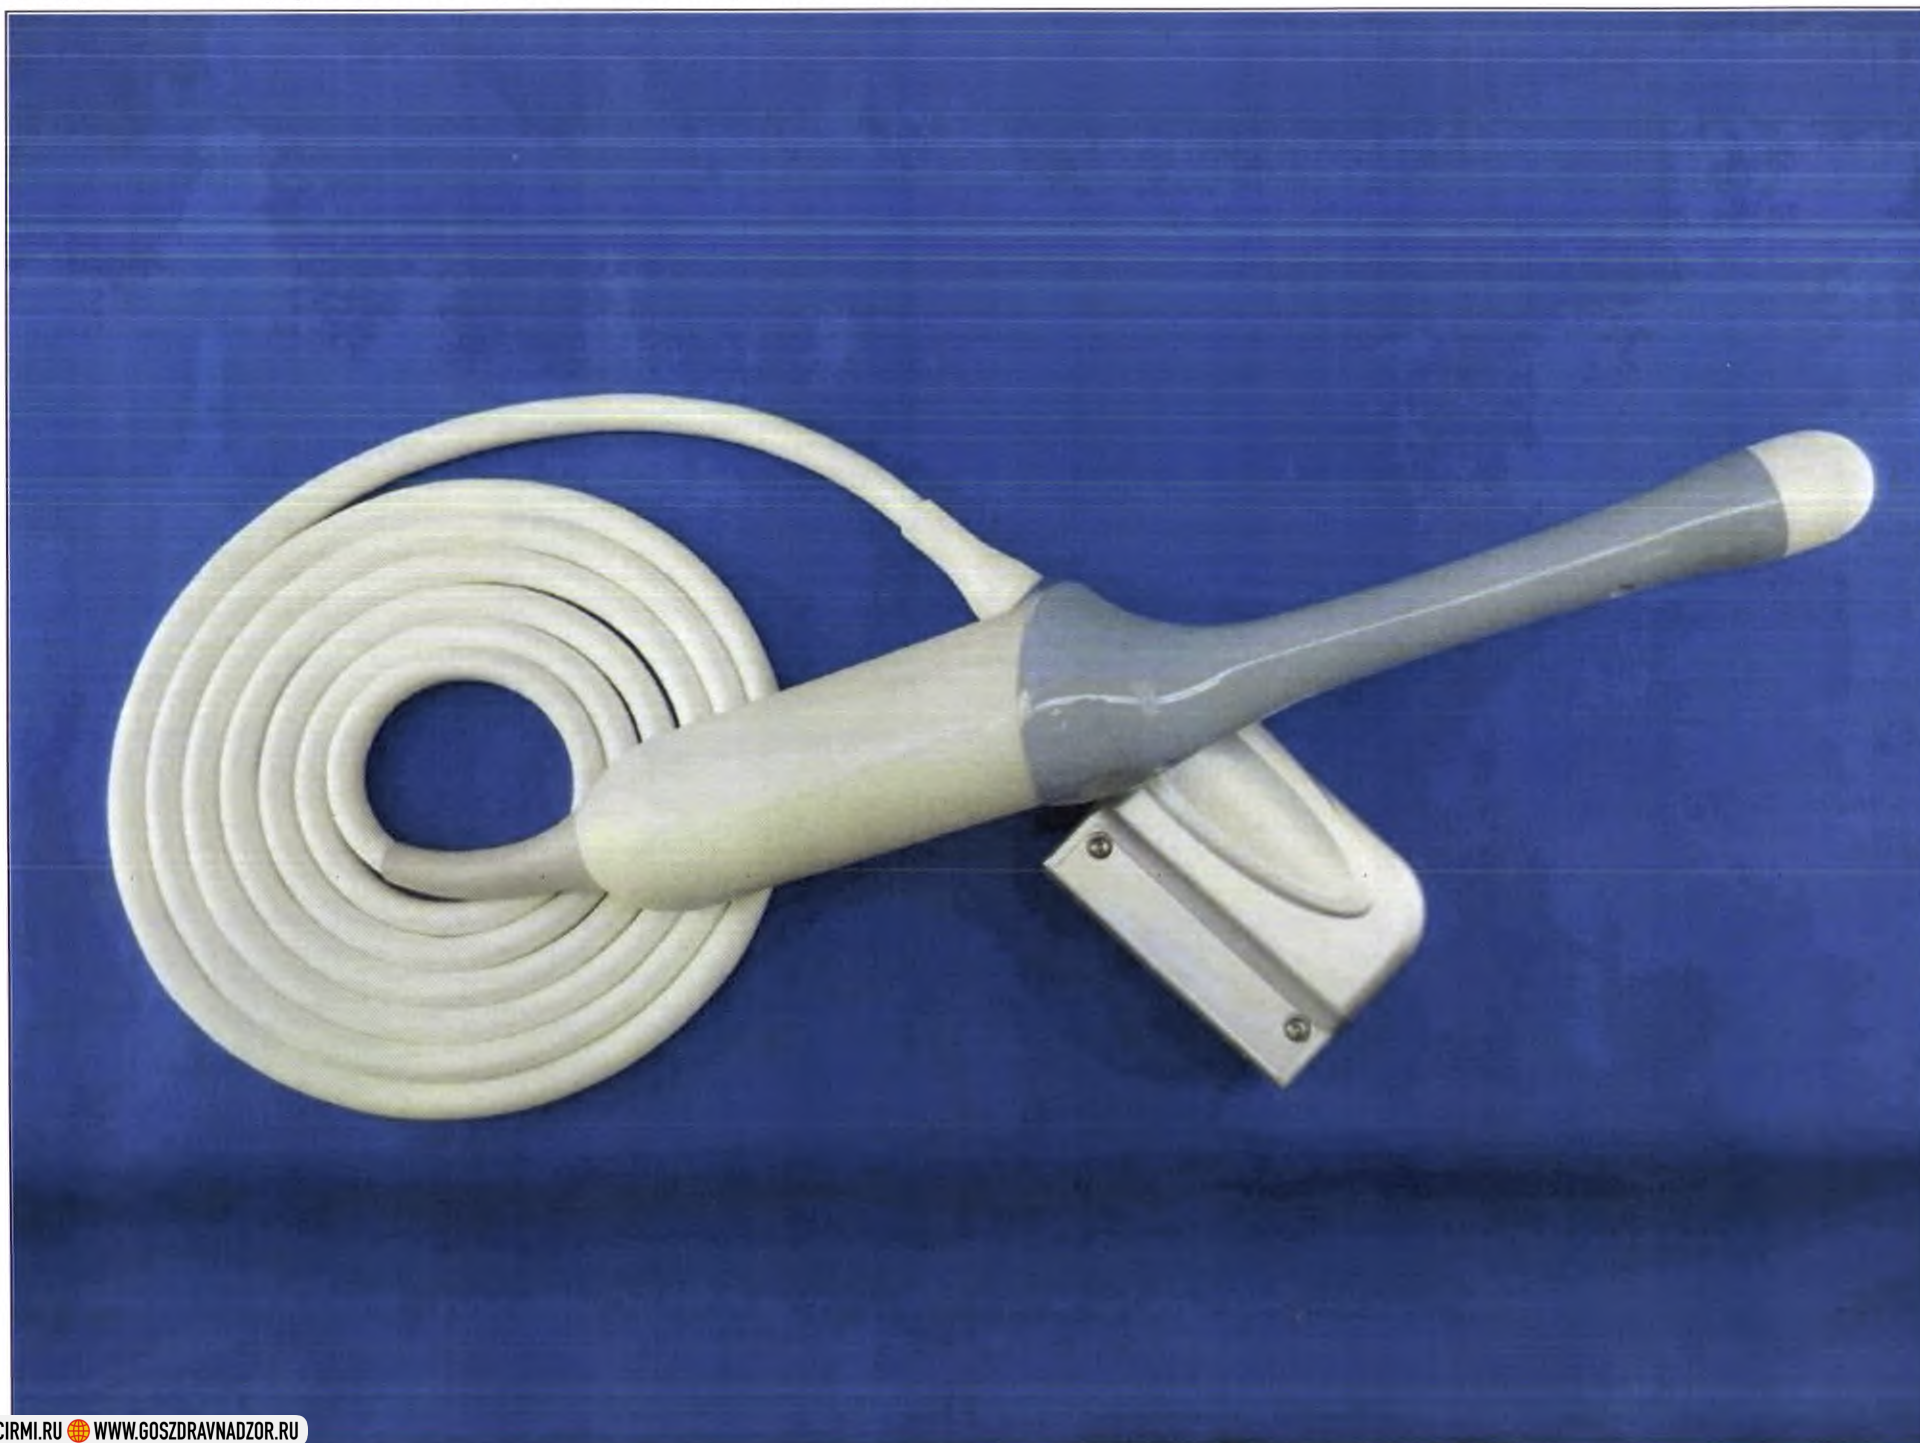

20. Биопсийные насадки для внутриполостных 4D датчиков (не более 20 шт.)

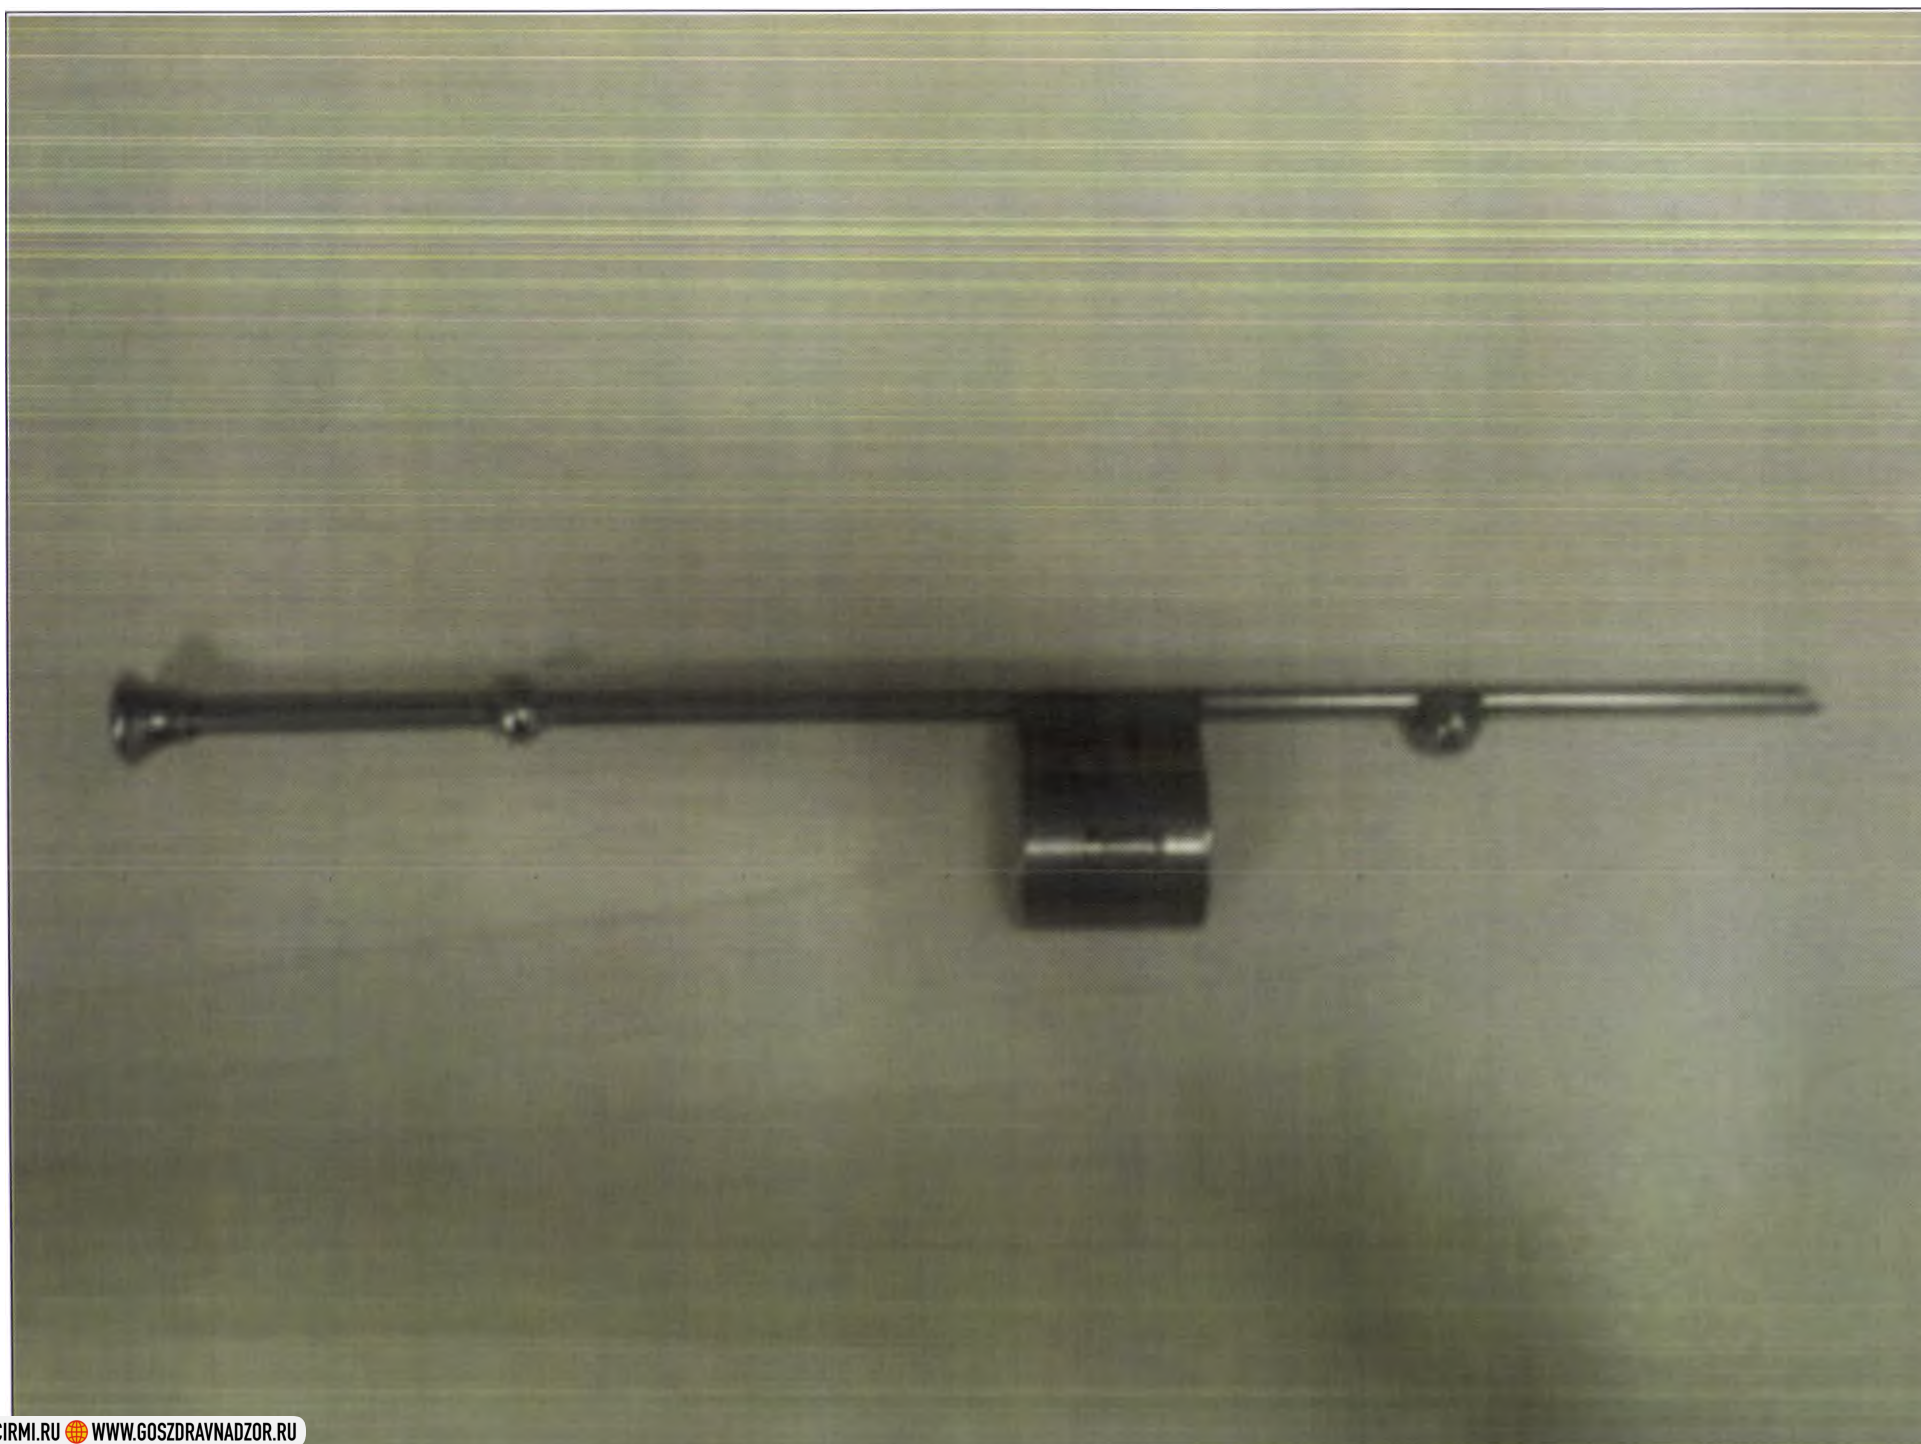


20. Биопсийные насадки для внутриполостных 4D датчиков (не более 20 шт.)



21. Начальные блоки для биопсии (не болсс 20 шт.)



22. Блок программ акушерский стандартный

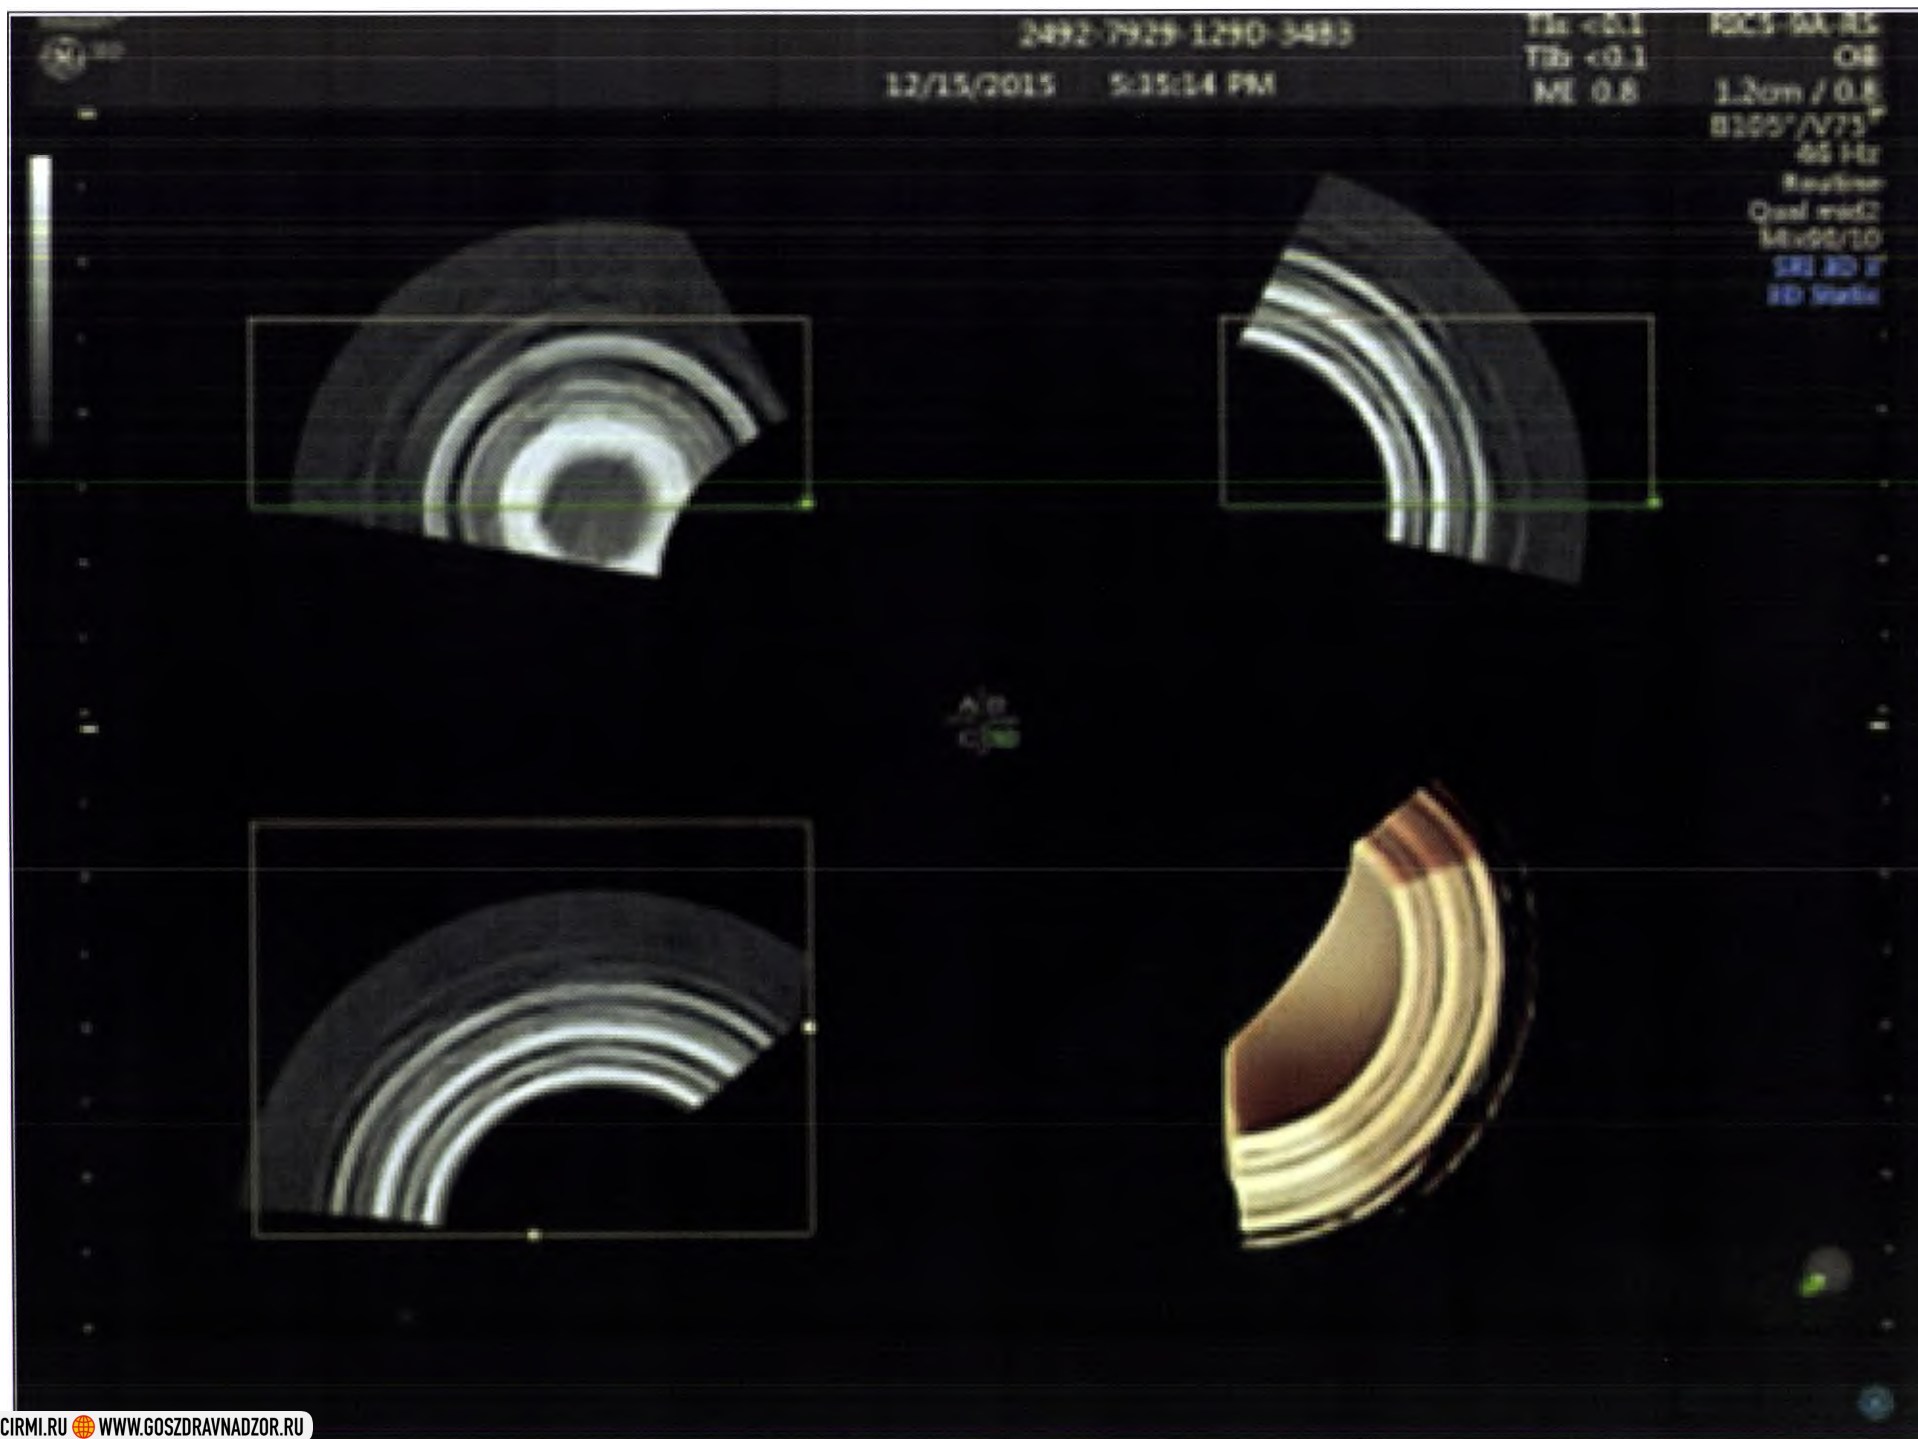

24. Дополнительное программное обеспечени Advanced 4D





26. Программа, обеспечивающая возможность передачи данных – DICOM 3

Source **DICOM Server** Search **Patient Name** **B** **Query Patients**

☒ Patients & Exams ☐ Exams Only

Patients

B	Patient ID	Patient Name	Birthdate	E	Sex	Last Exam
	3D-06, 3D HD-Flow	Bauer Andrea Alexandra	12.10.1980	2	F	26.07.2006

Query Exams


Exams

B	Exam Date	Exam Time	Exam Type	H	Img	Exam Comment	Exam Comment
	26.07.2006	12:06:45	etype2	11	2		
	26.07.2006	12:06:45	ex2 1img	11	1		

Retrieve Image




27. Программа анализа и обработки трехмерных изображений на рабочей станции 4D View.

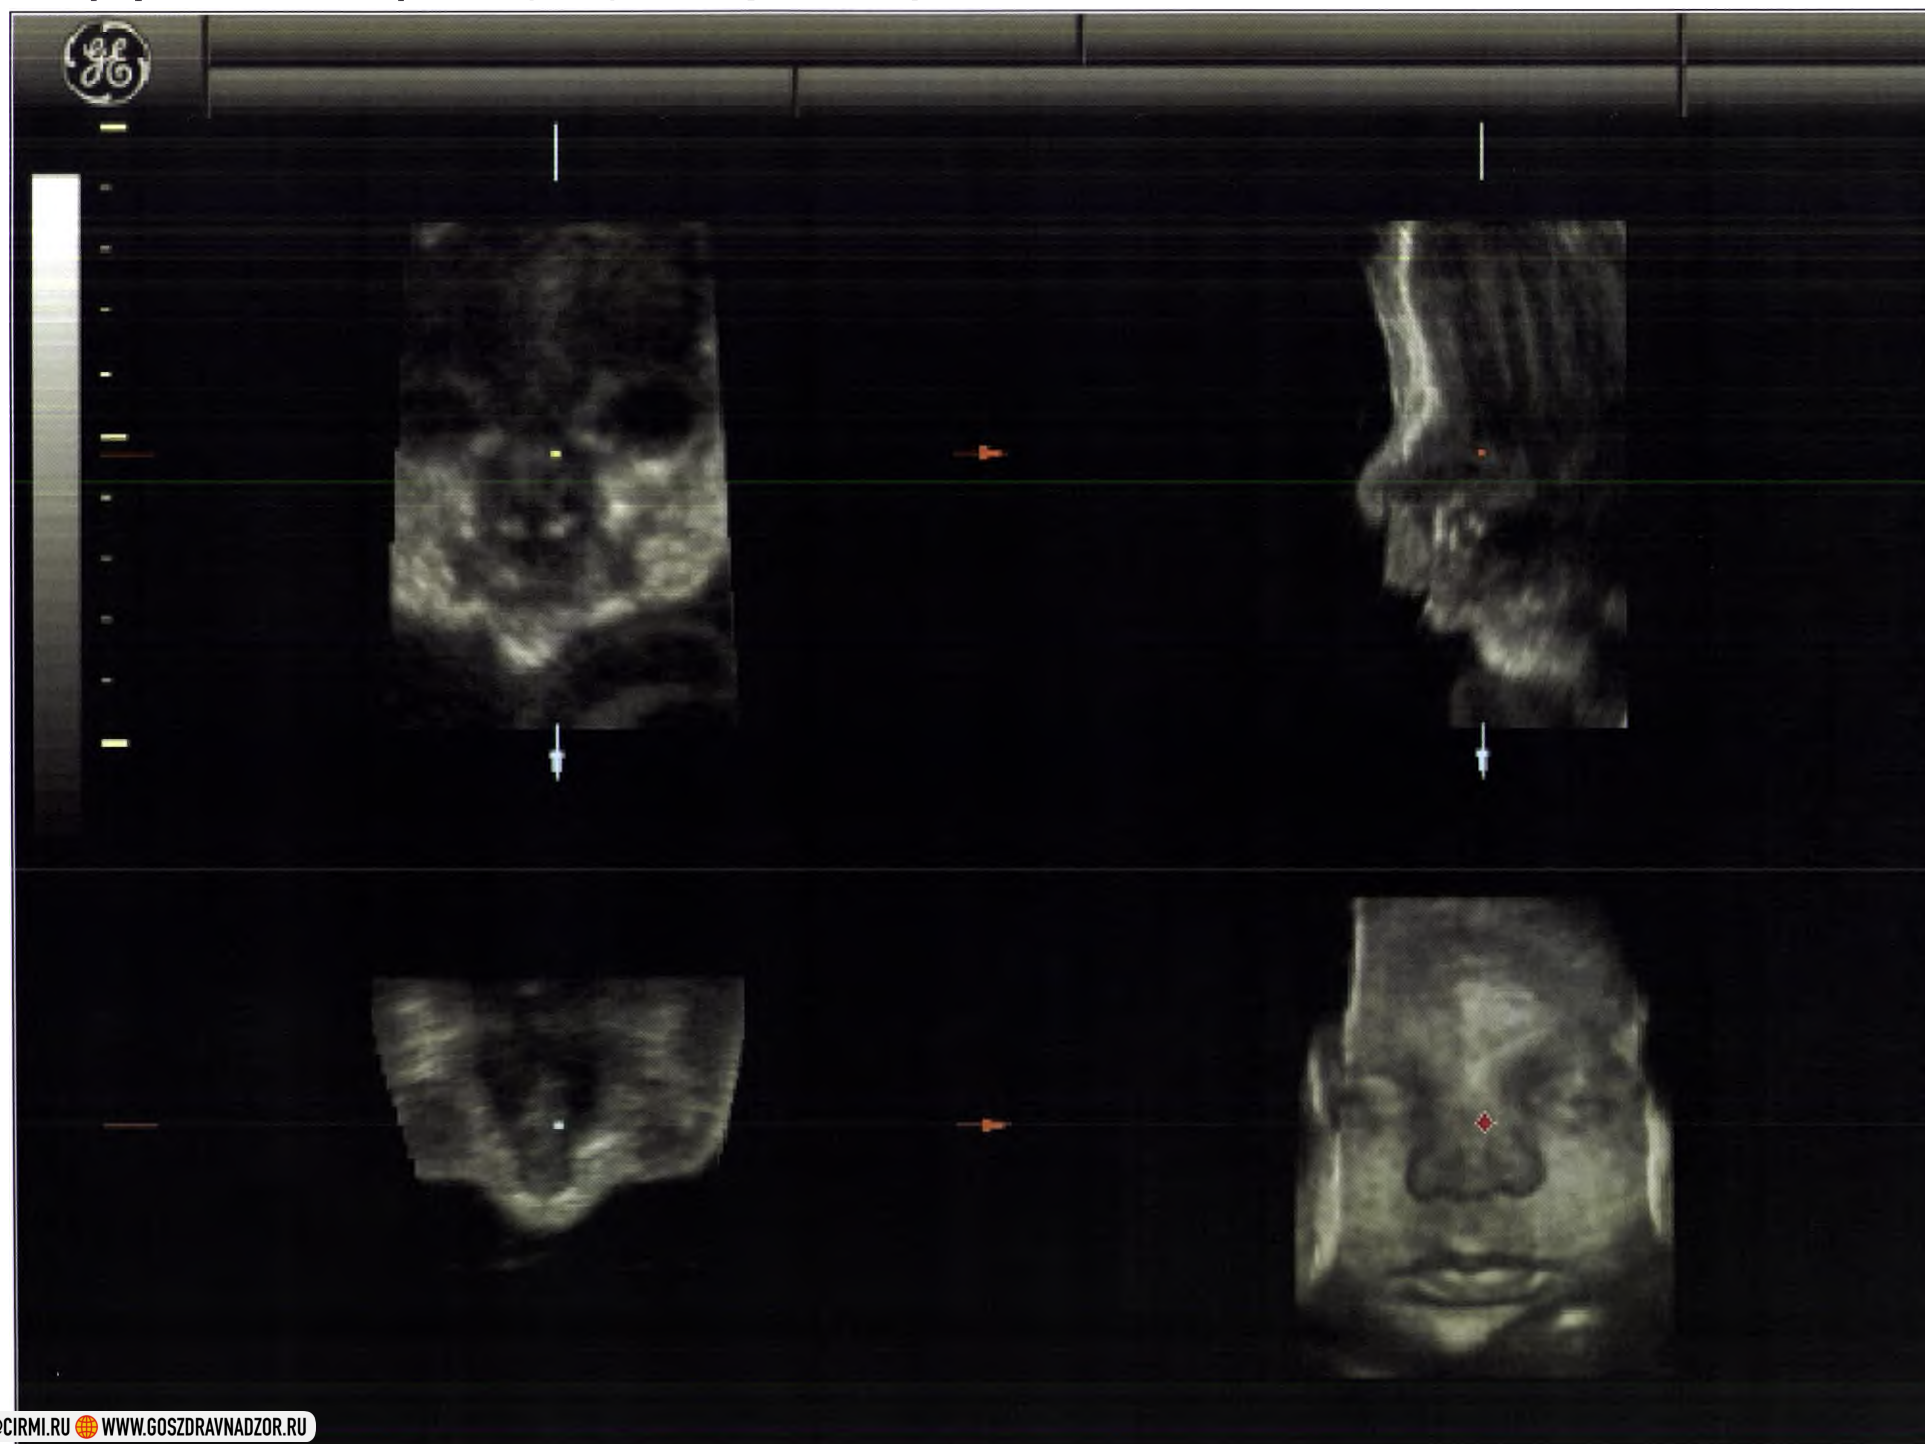

28. Программа обработки изображений



29. Программа определения плотности ткани




30. Программа недоплеровской визуализации кровотока B – Flow.




31. Программа панорамного сканирования




32. Программа анагомического М – режима

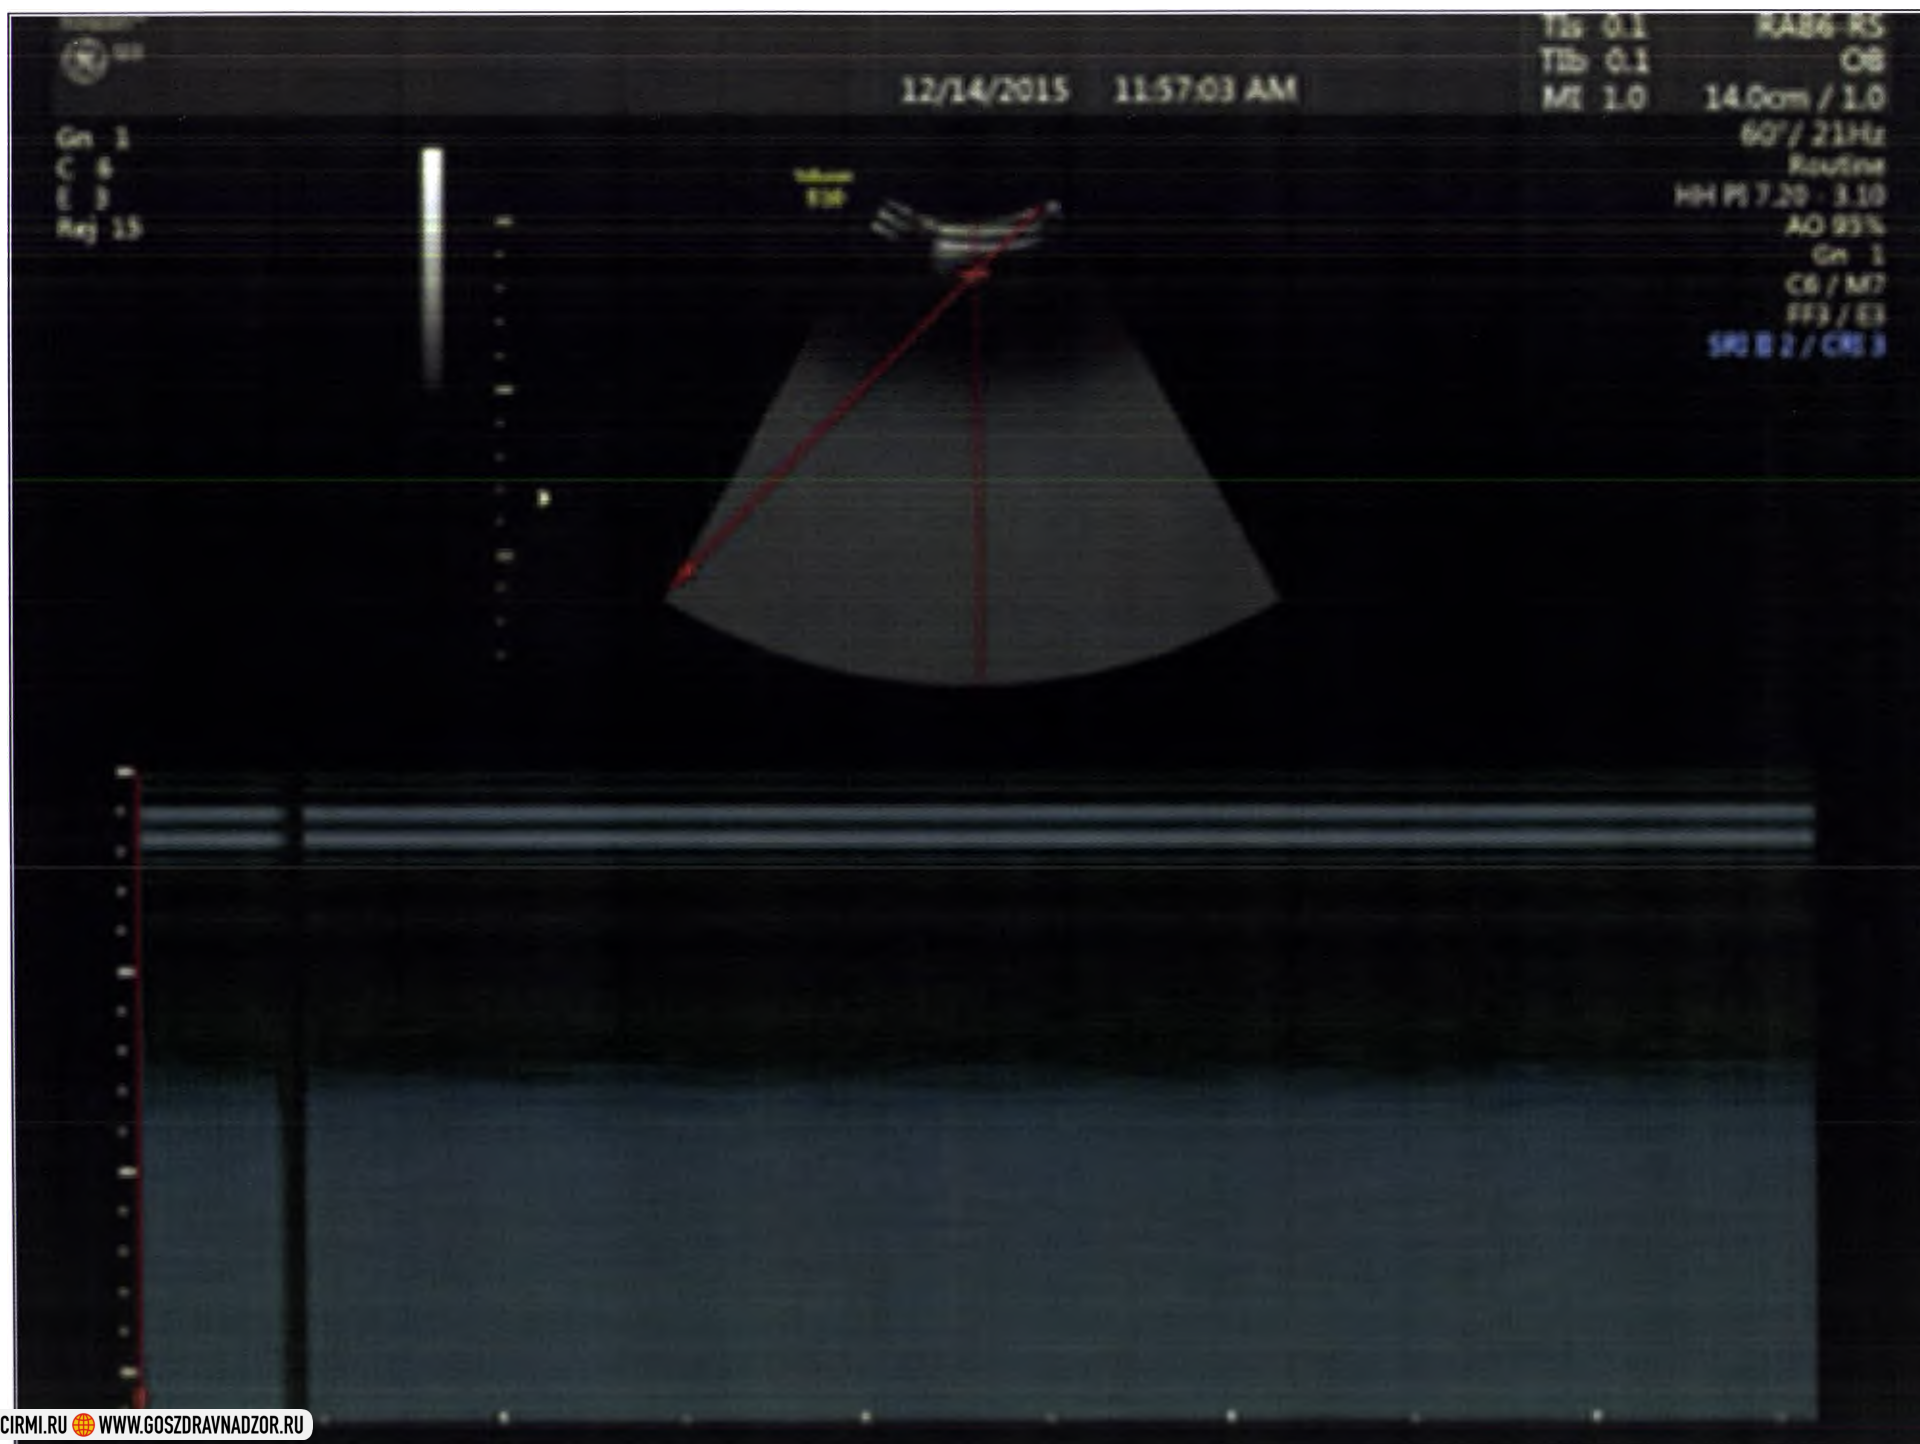

34. Программа оптимизации изображения

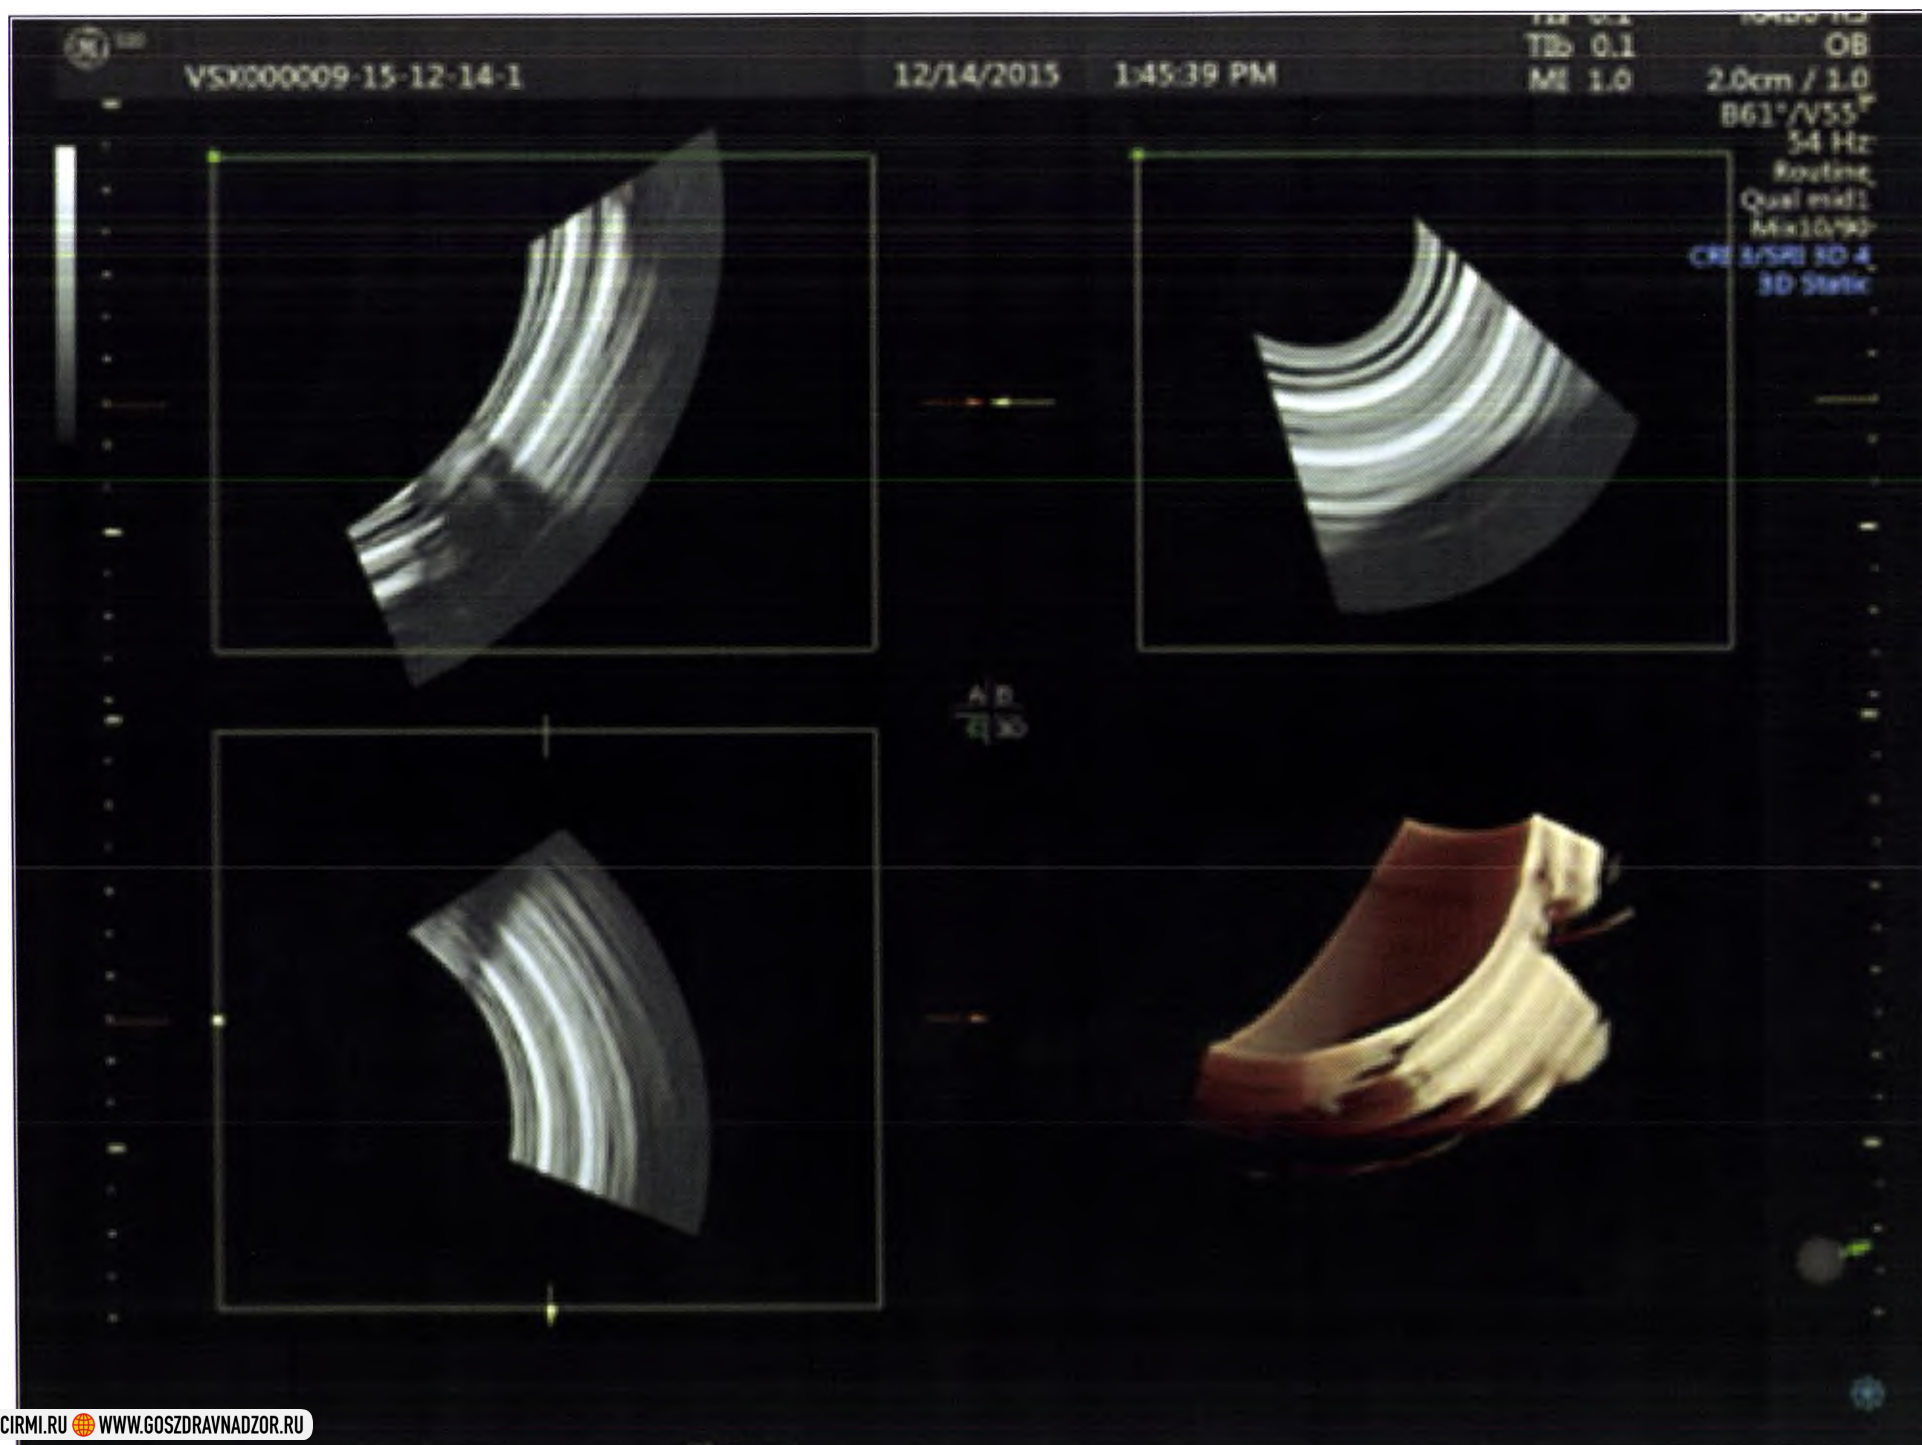


35. Программа синхронизации изображений

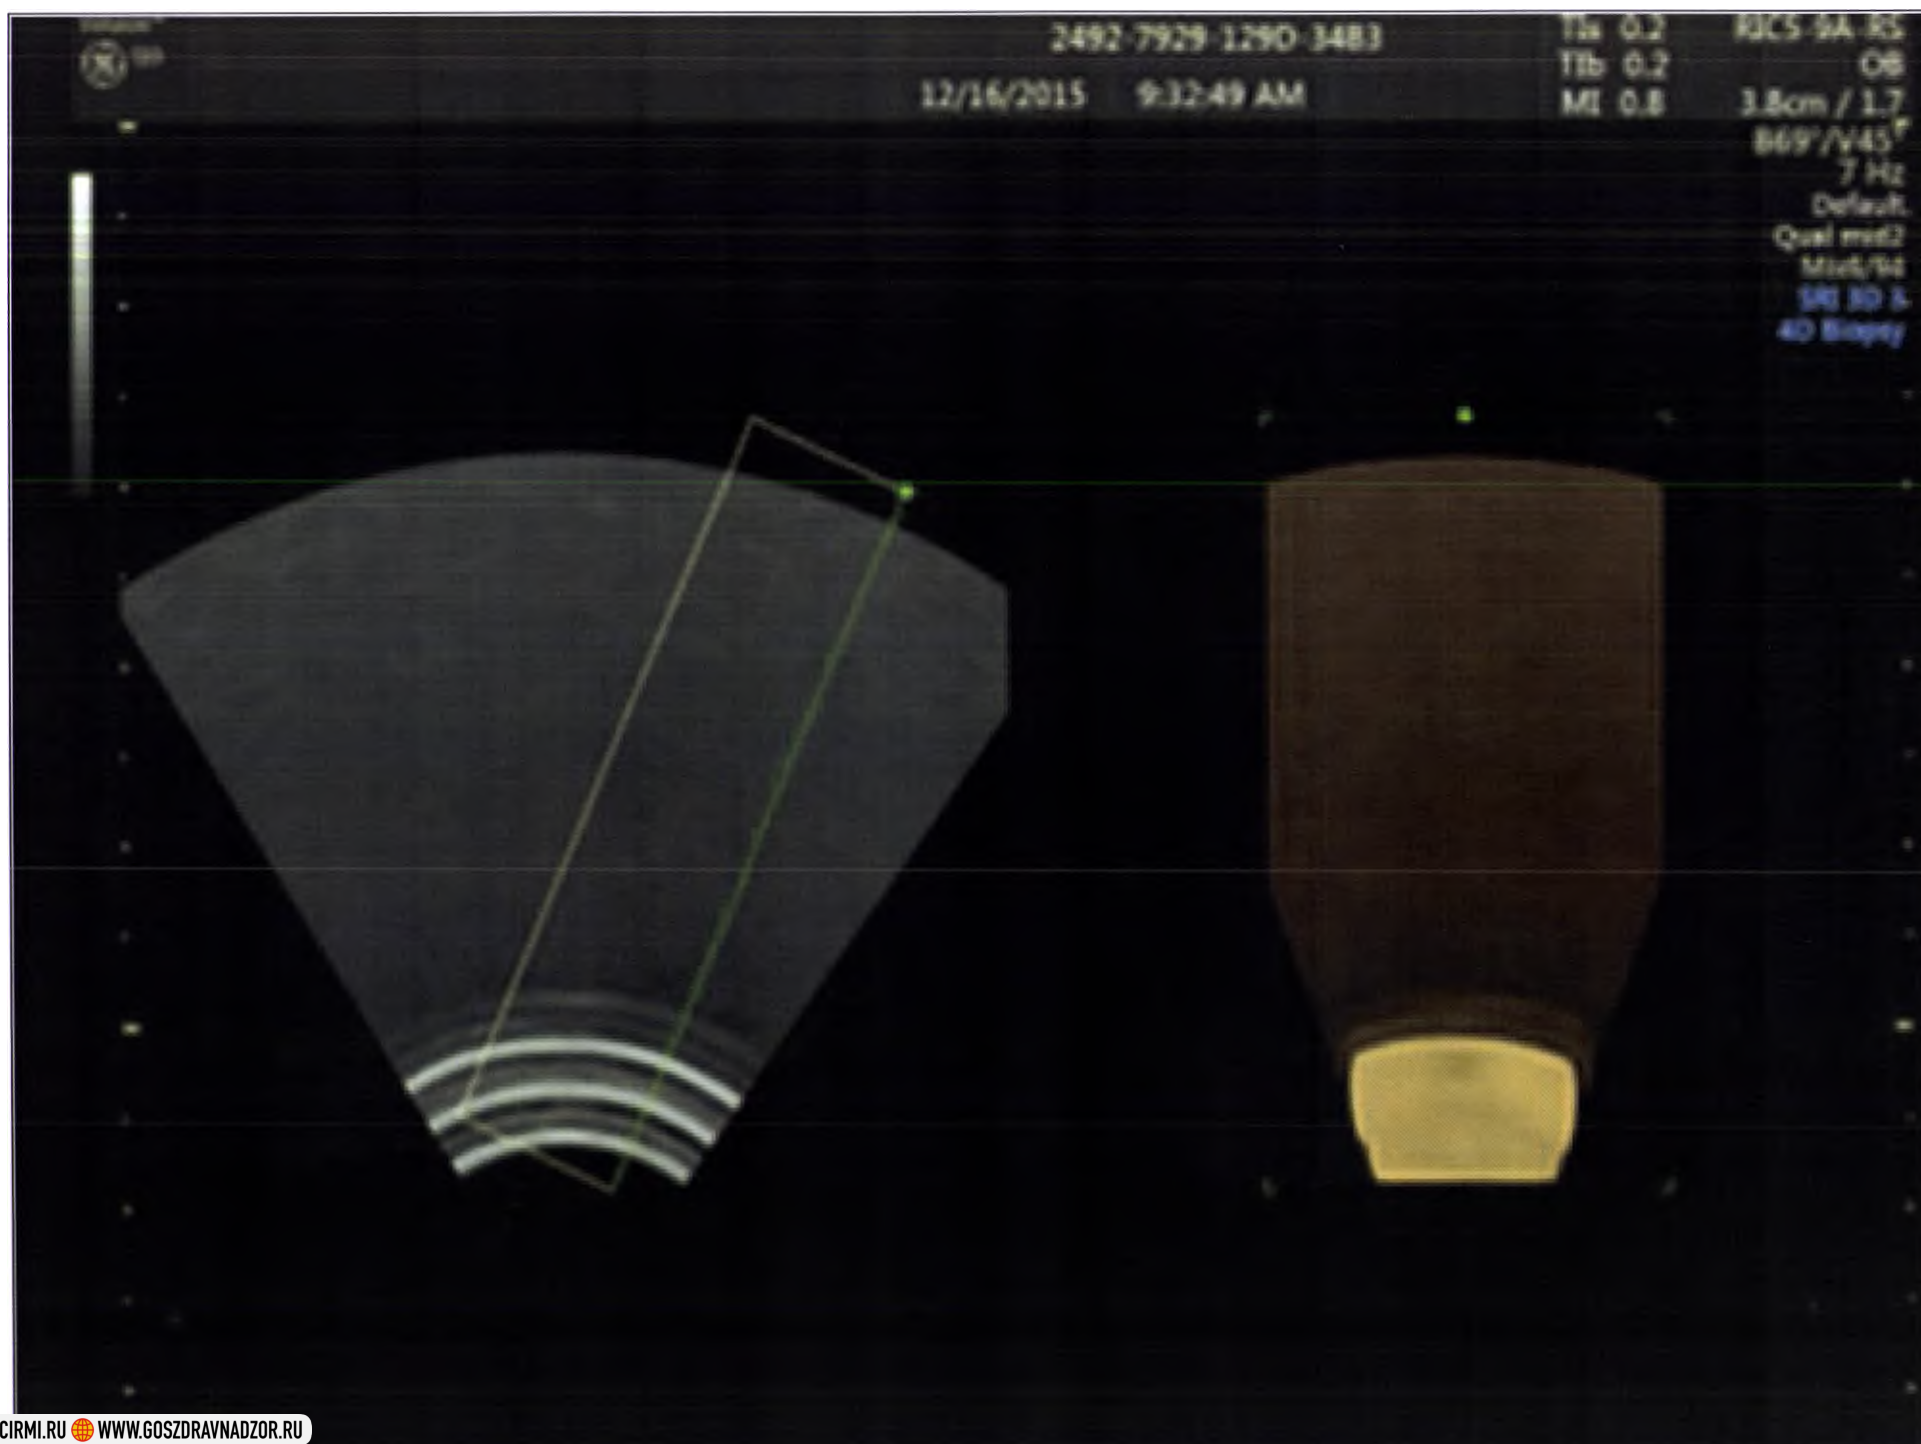


36. Программа регистрации работы сердца плода в режиме 4D – STIC



37. Программа дополнительного объемного контрастного изображения

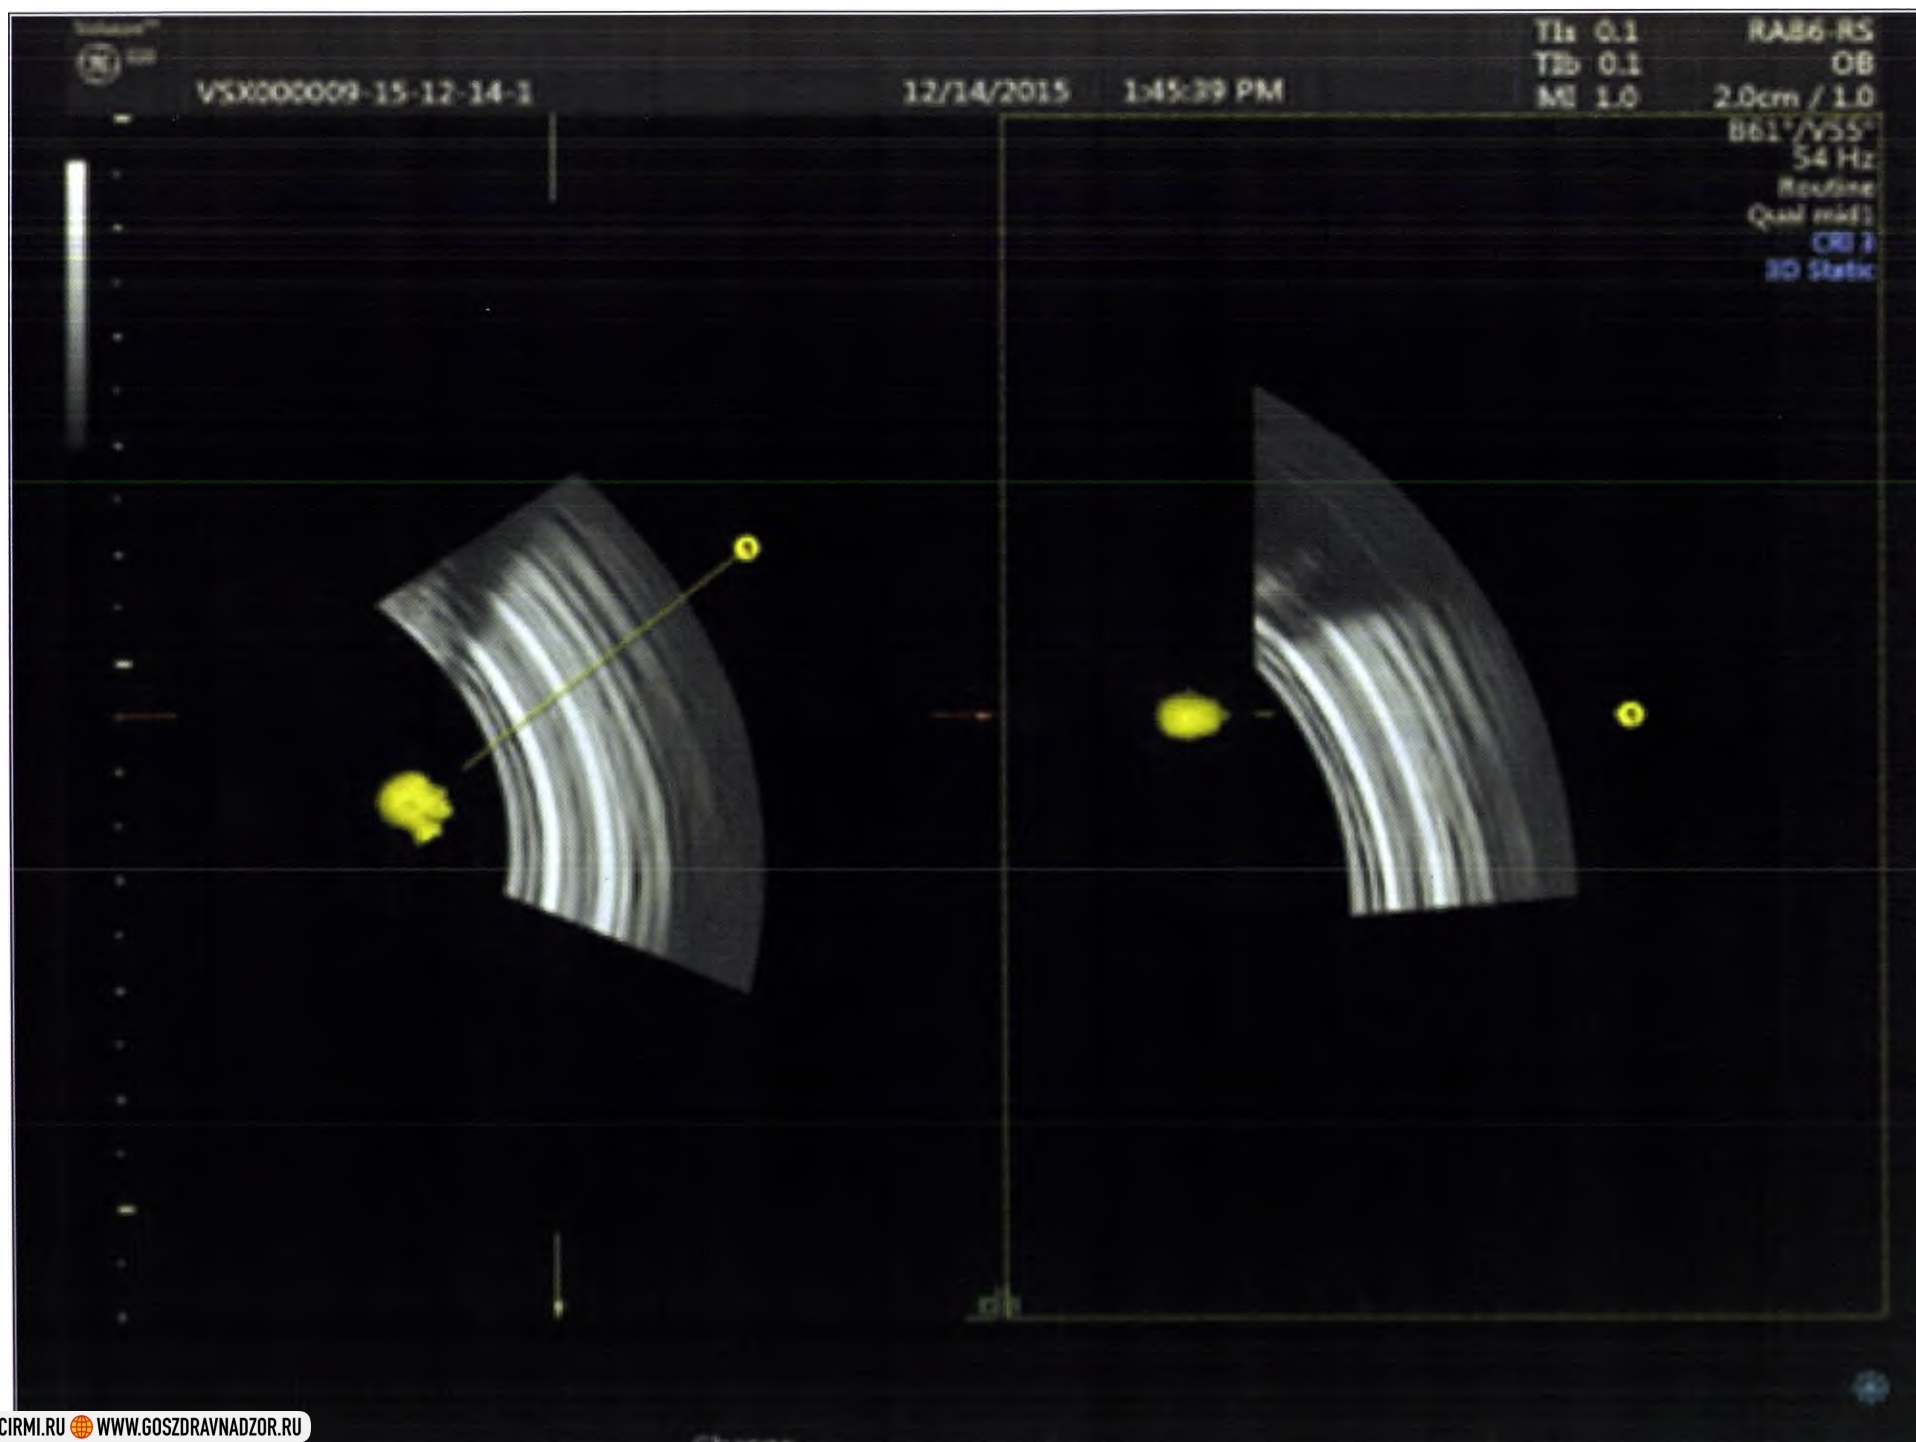


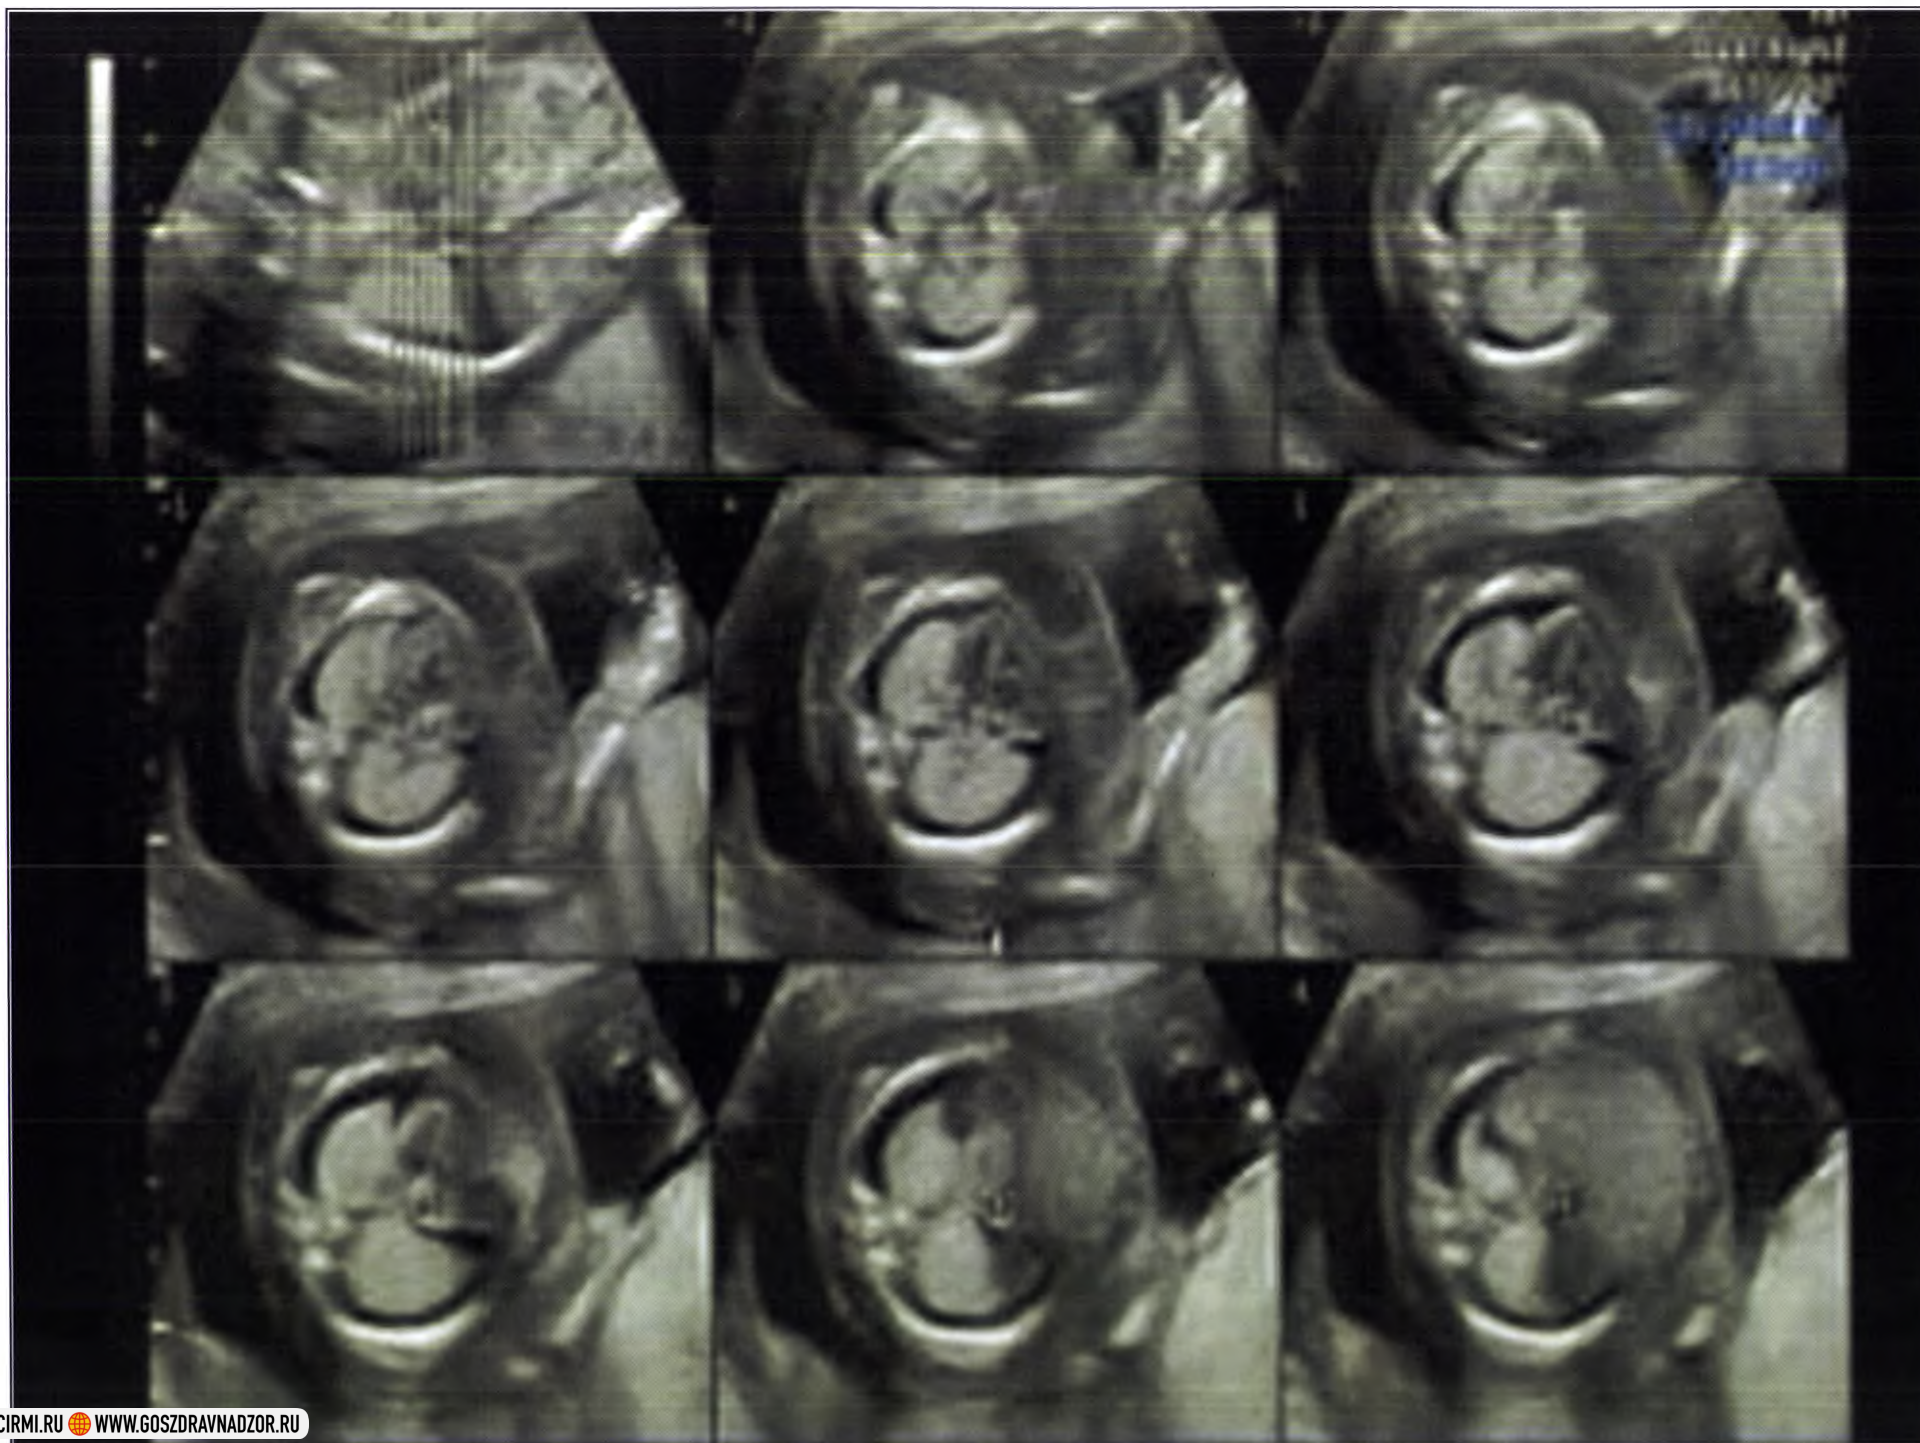

39. Программа компьютерного диагностического анализа сердца в объеме.




40. Программа компьютерного диагностического анализа плода в родах

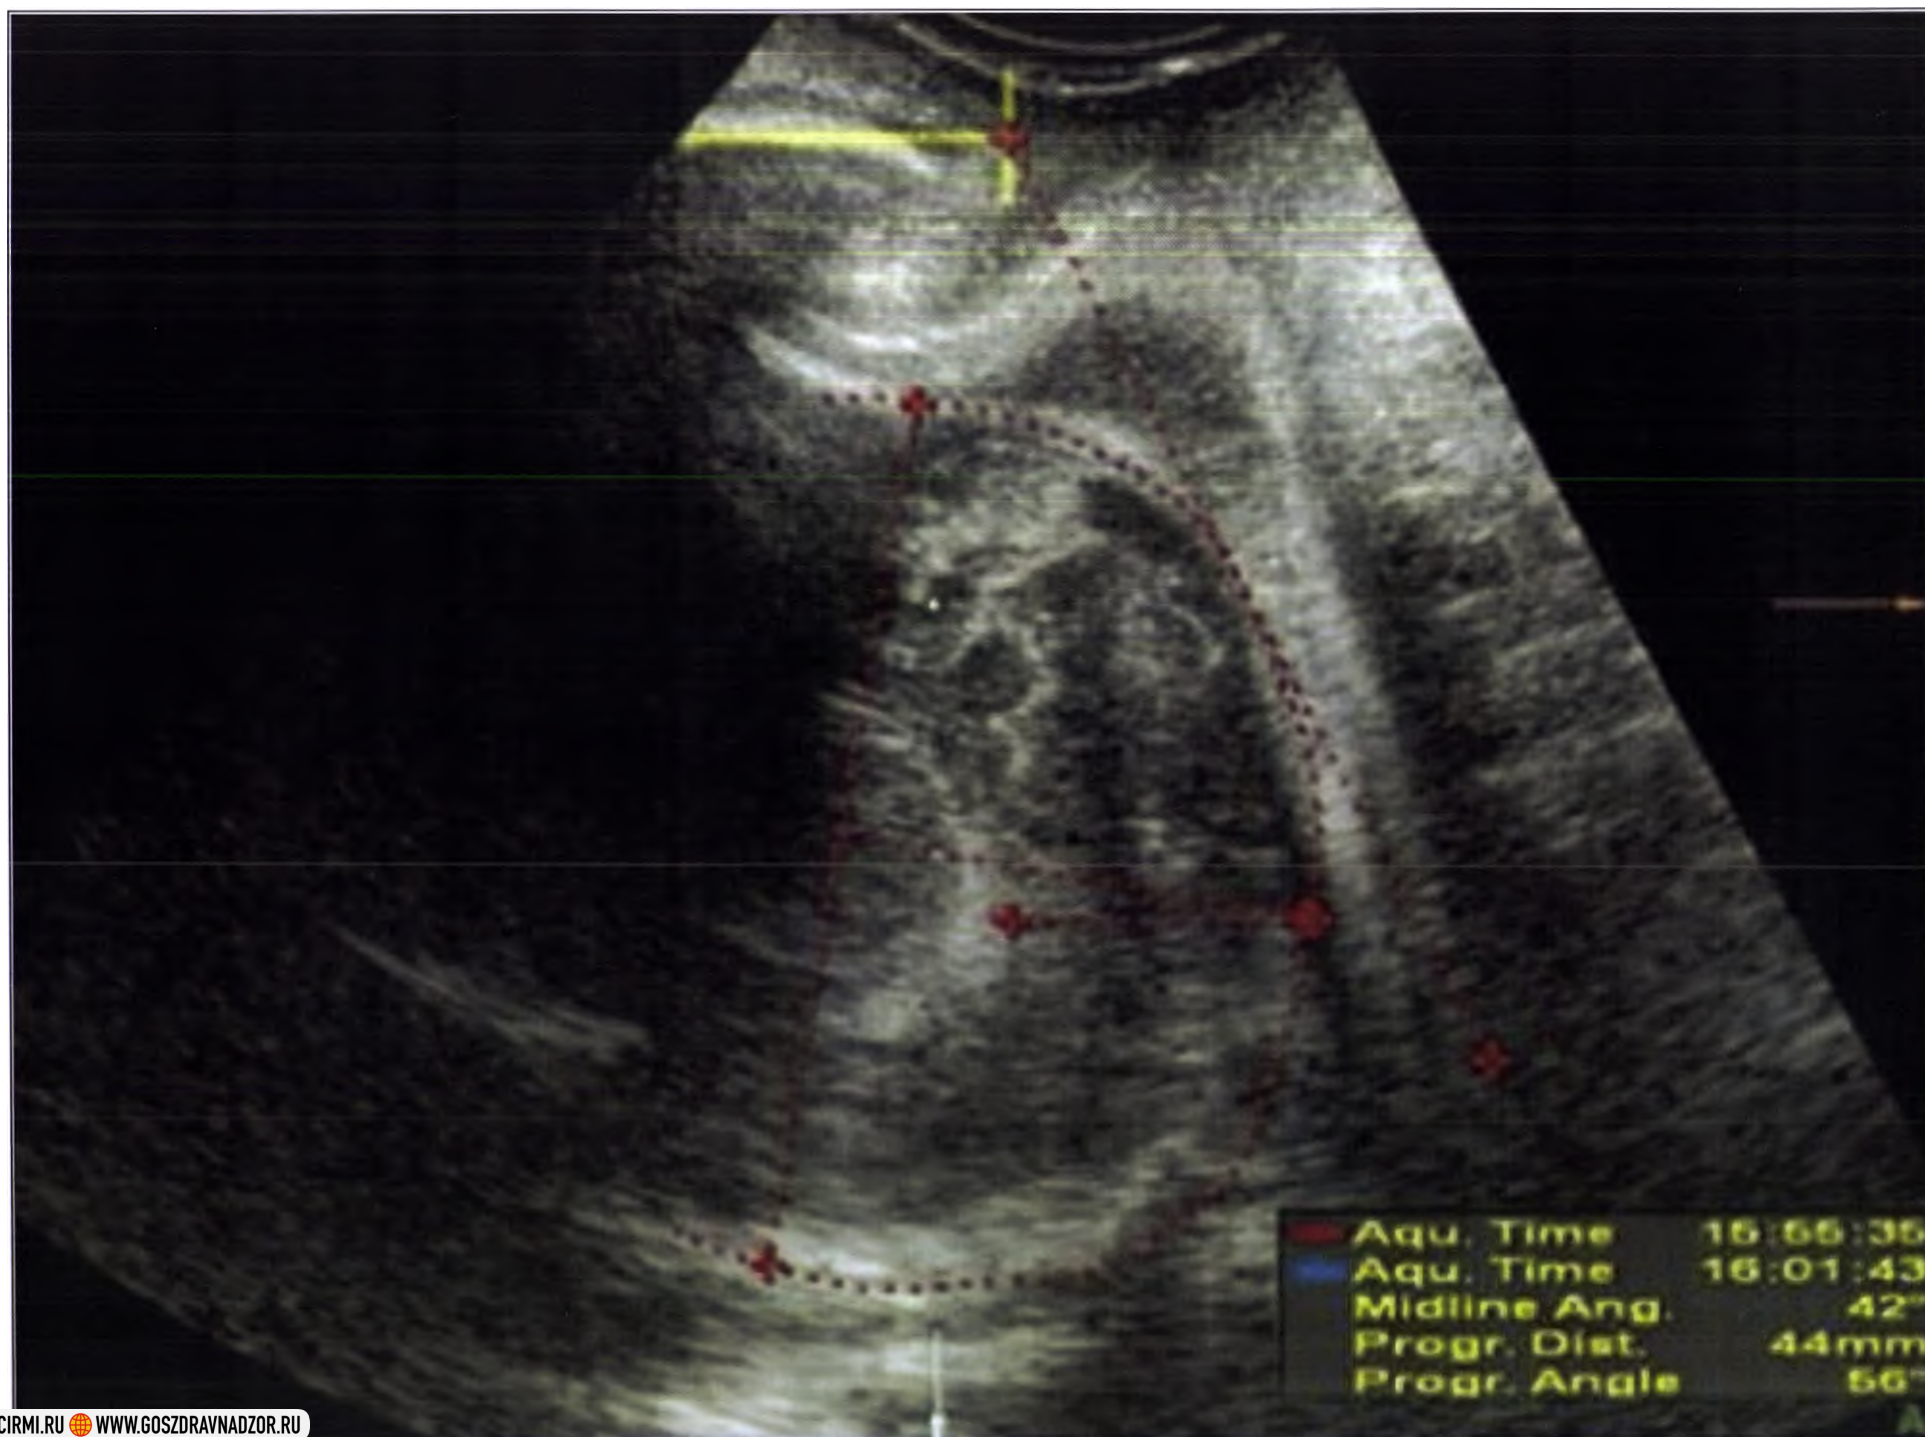

41. Программа для оценки воротникового пространства Sono NT




42. Программа обработки данных в 3D

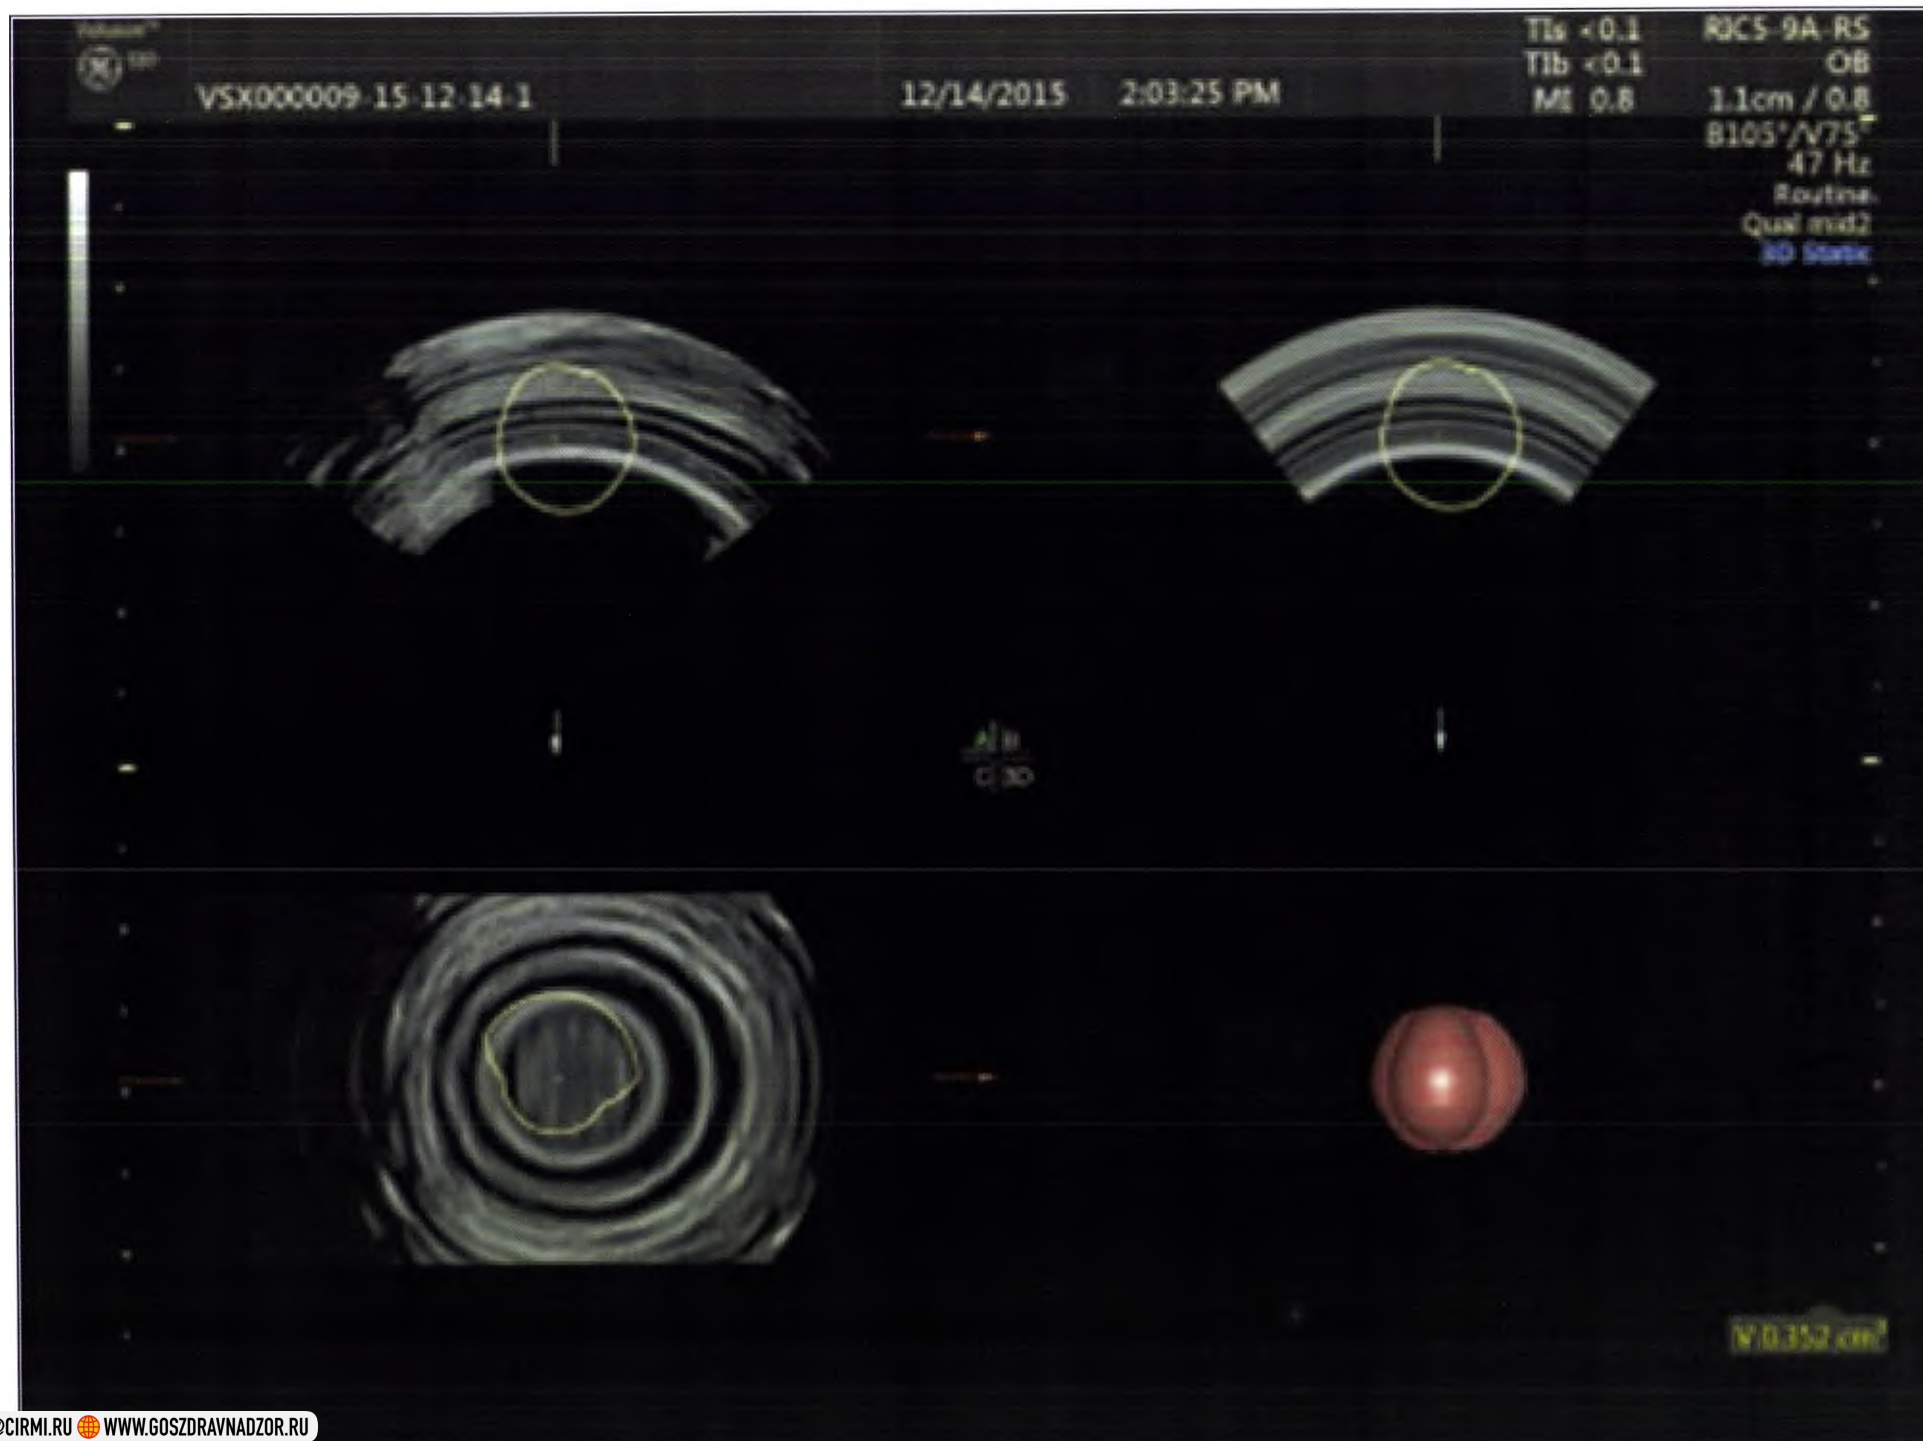

43. Программа обработки данных в 4D



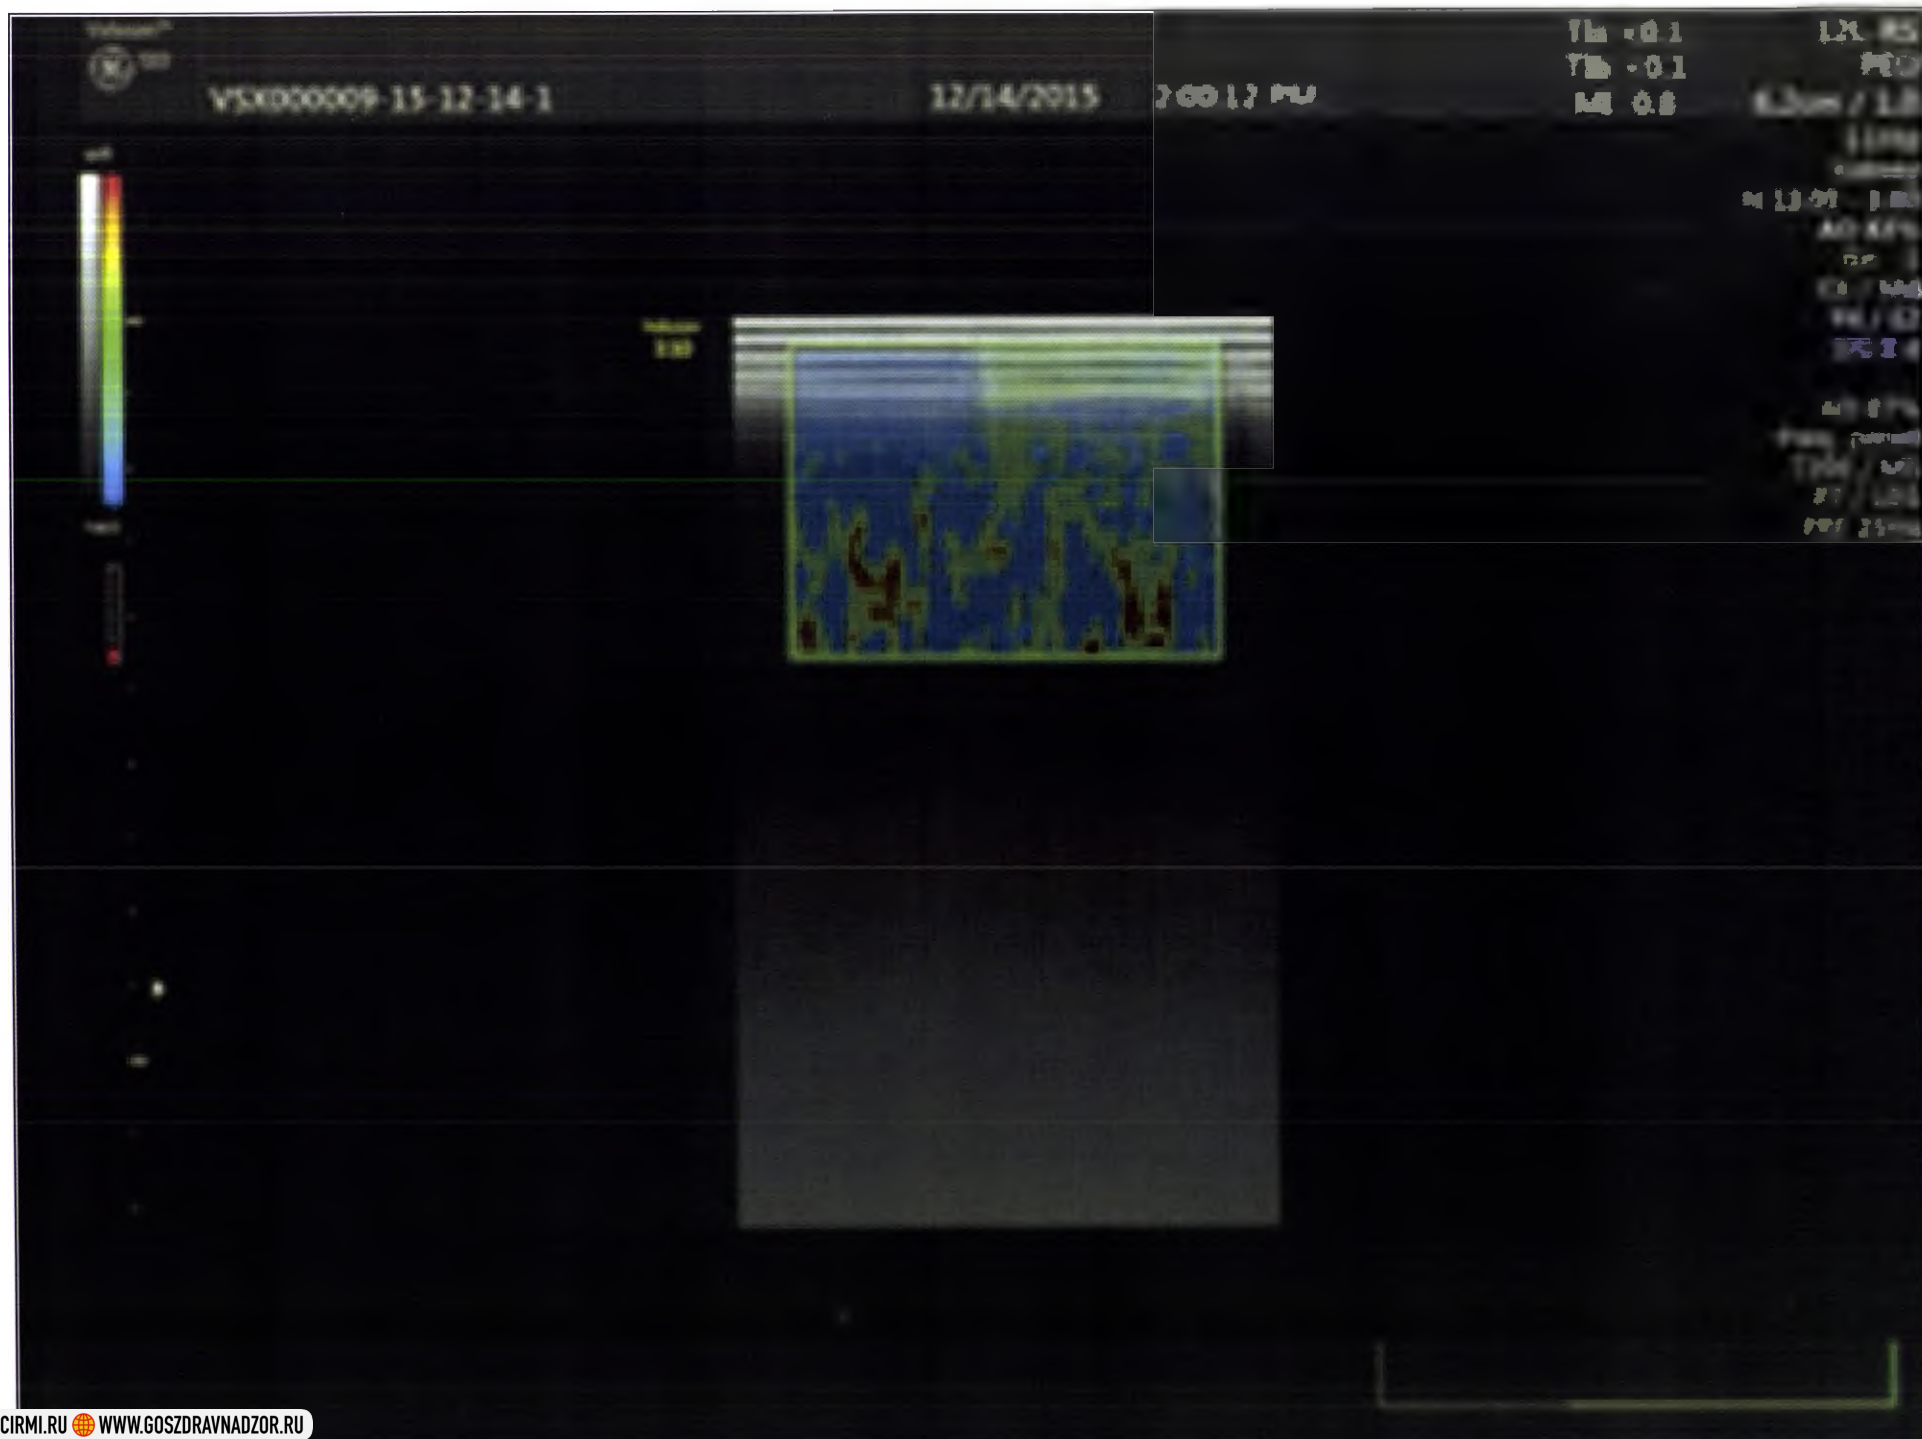


45. Программа регистрации тканей различной плотности




46. Программа визуализации тканей различной плотности




47. Программа компьютерного диагностического анализа жидкостных образований

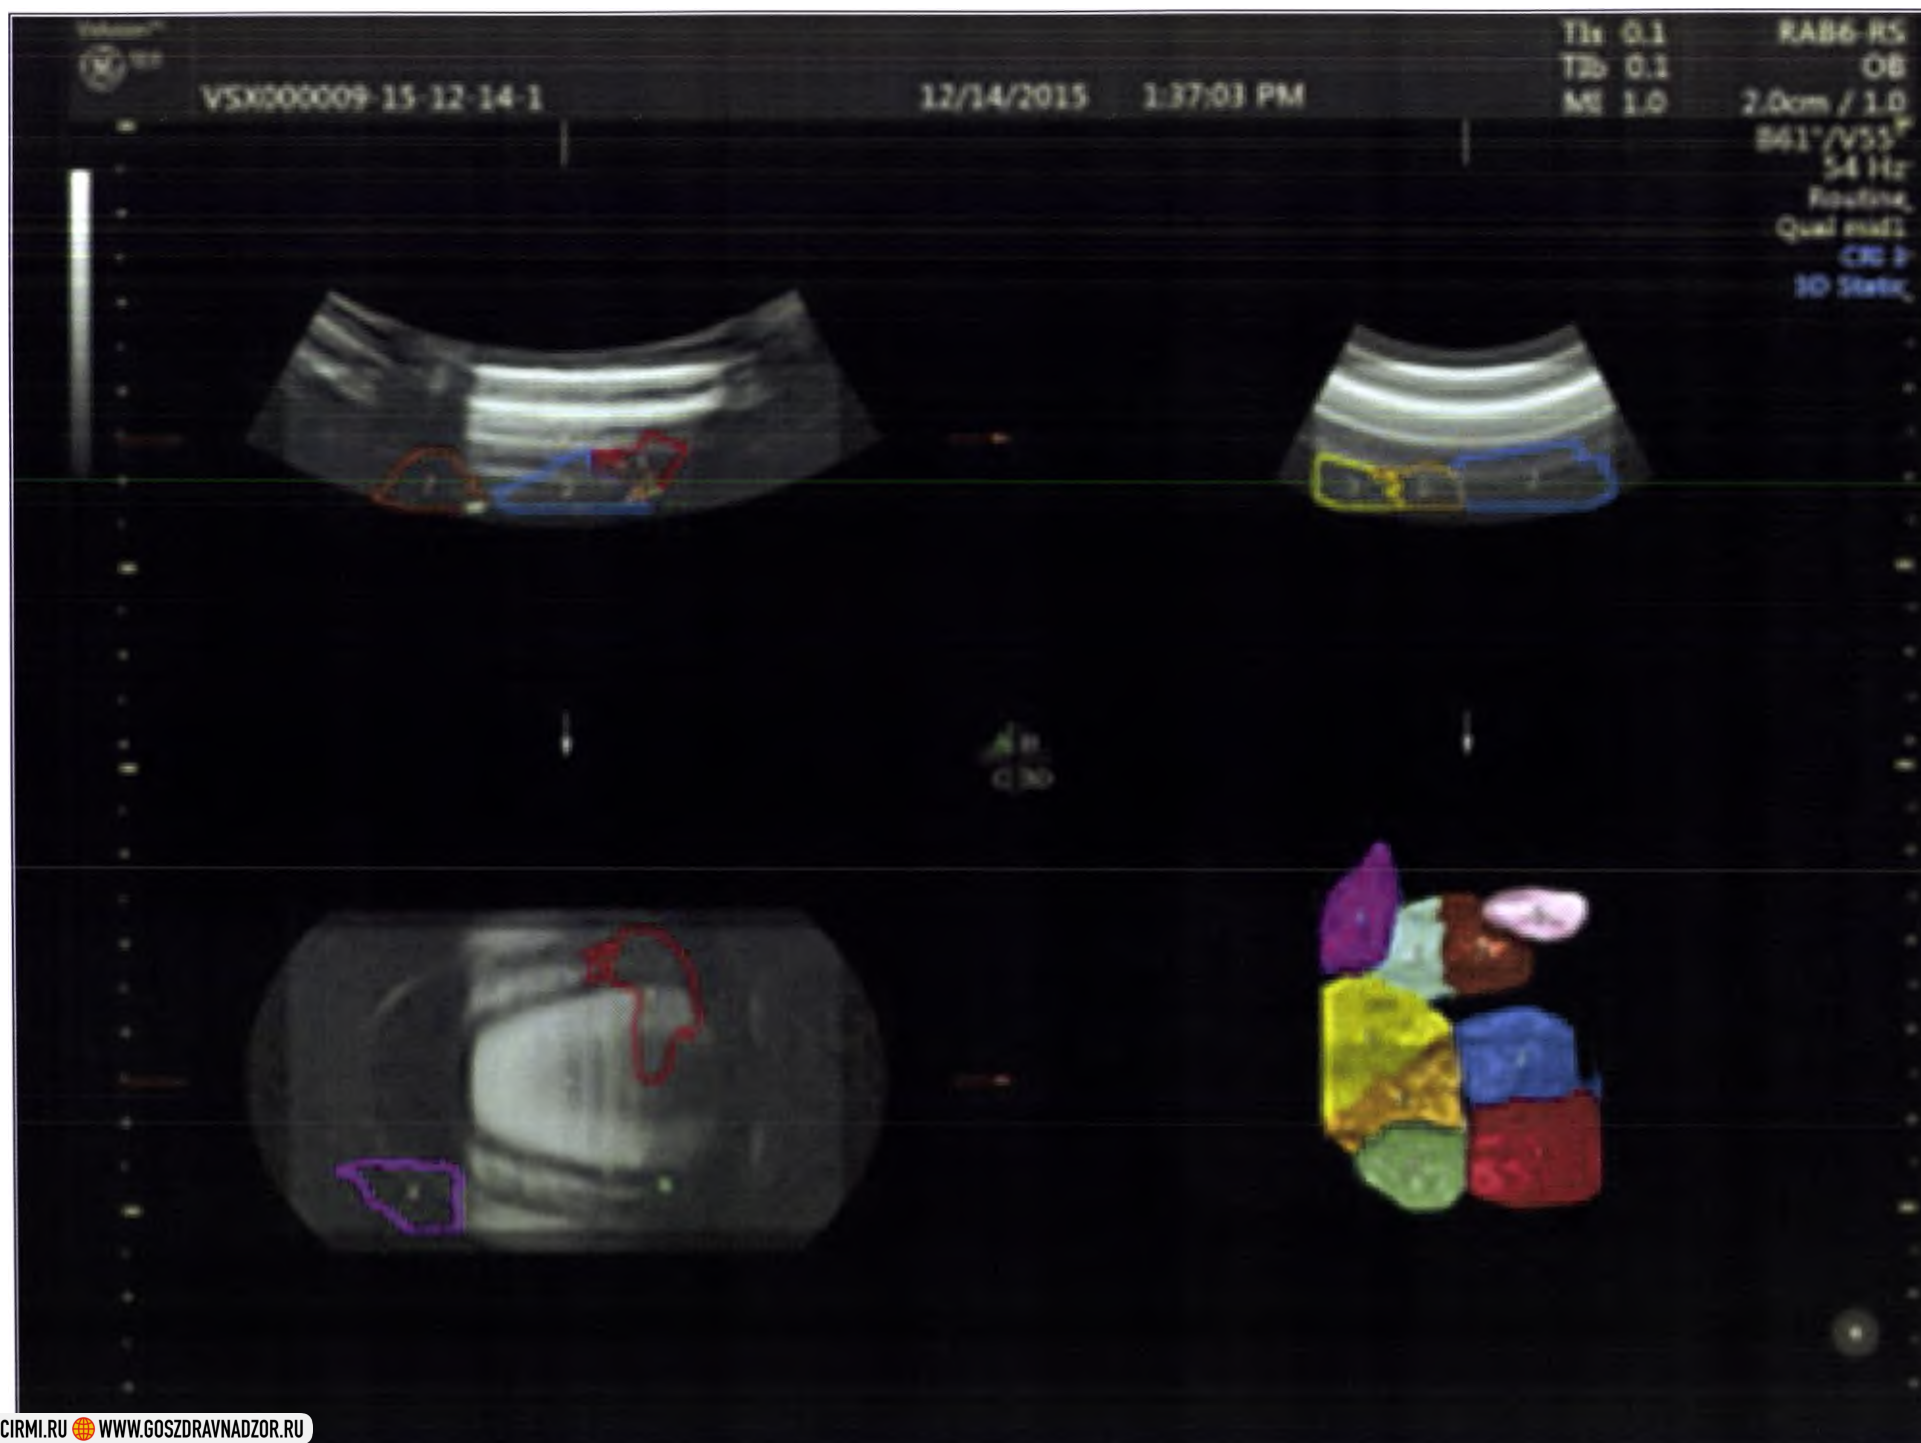

48. Блок постоянно-волнового доплера

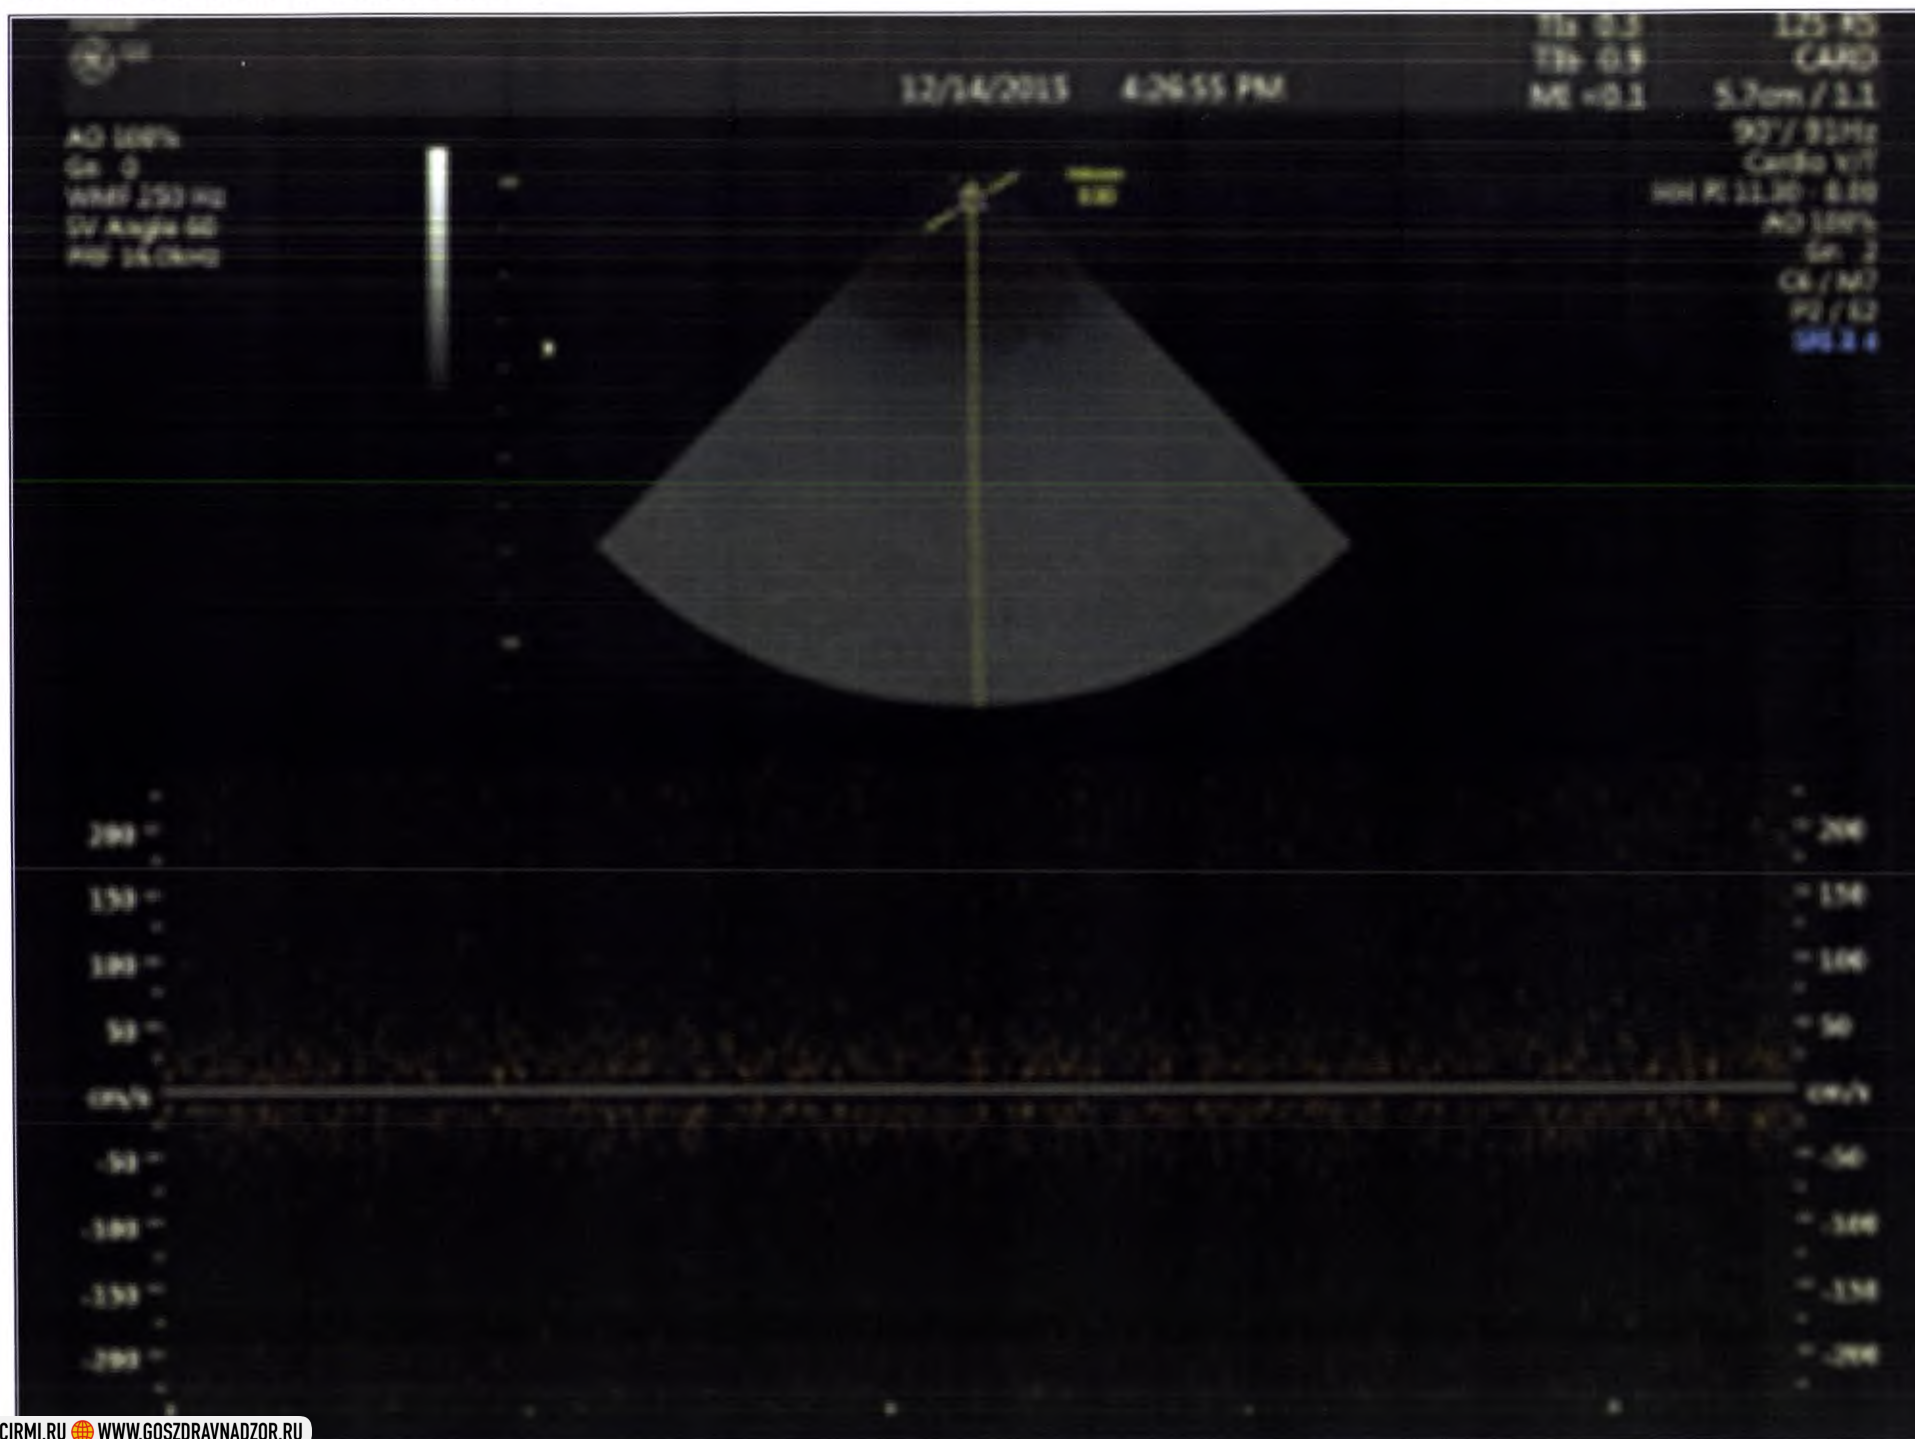

49. Модули для печати отчетов на принтере Connection Module (не более 5 шт)

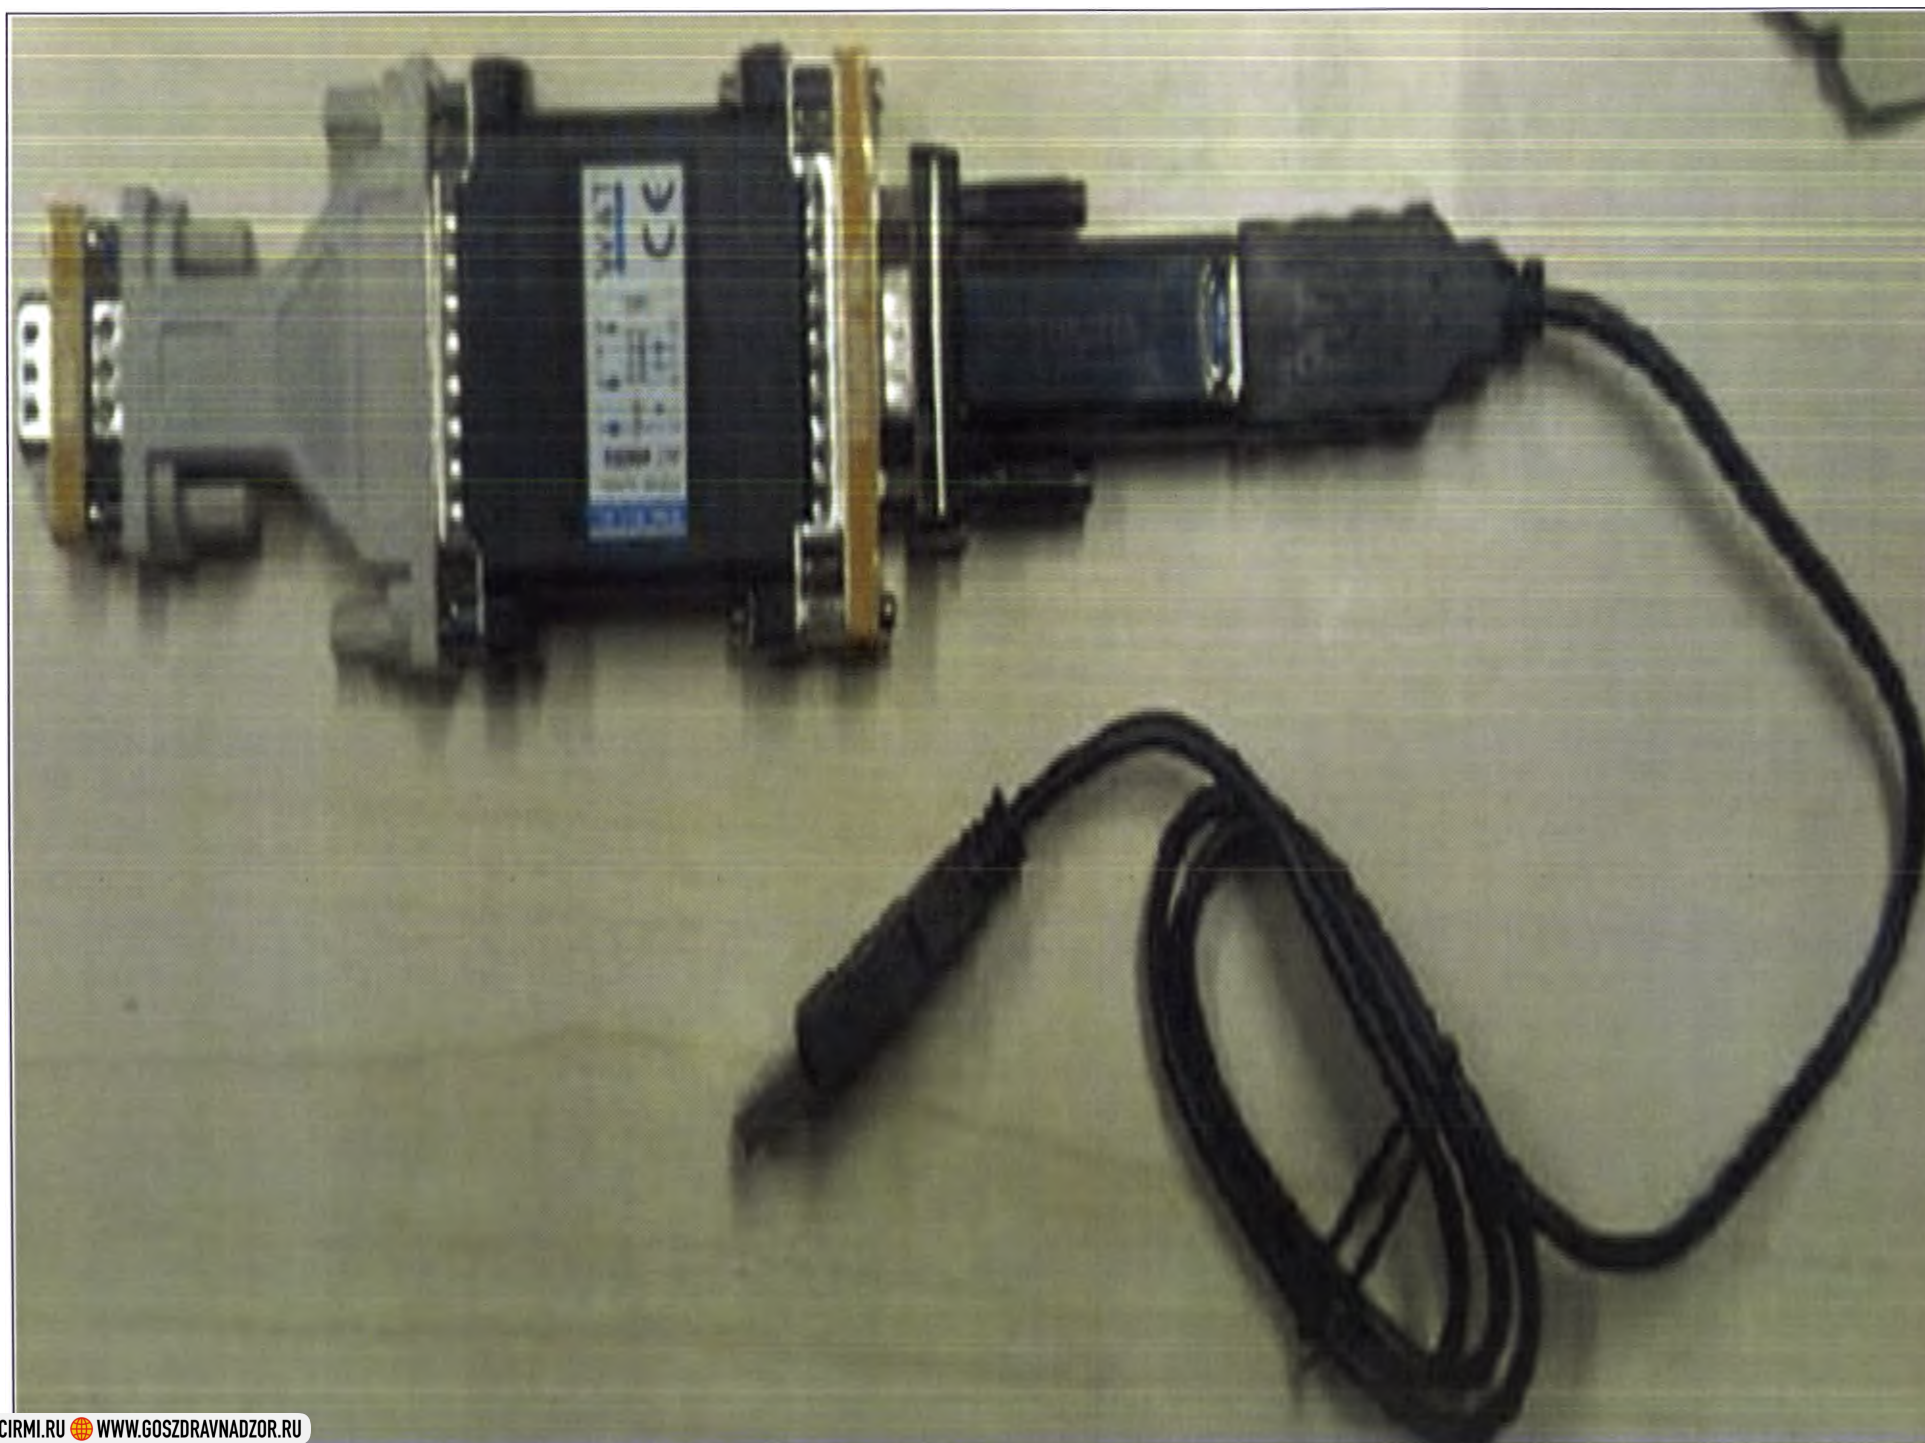

50. USB модуль для беспроводной связи аппарата с компьютерными сетями



51. Программа Scan Assistant



52. Устройства, печатающие черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения или без них (не более 3 шт.)



53. Устройства, печатающие цветные ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения или без них (не более 3 шт.)



54. Устройства для подключения печатающих устройств (не более 3 шт.)



54. Устройства для подключения печатающих устройств (не более 3 шт.)



55. Кабели (не более 50 шт.)




56. Ножные педали/ переключатели (не более 3 шт.)



57. Модули для детекции физиологических сигналов (не более 3 шт.)



58. Внешние дополнительные мониторы (не более 5 шт.)

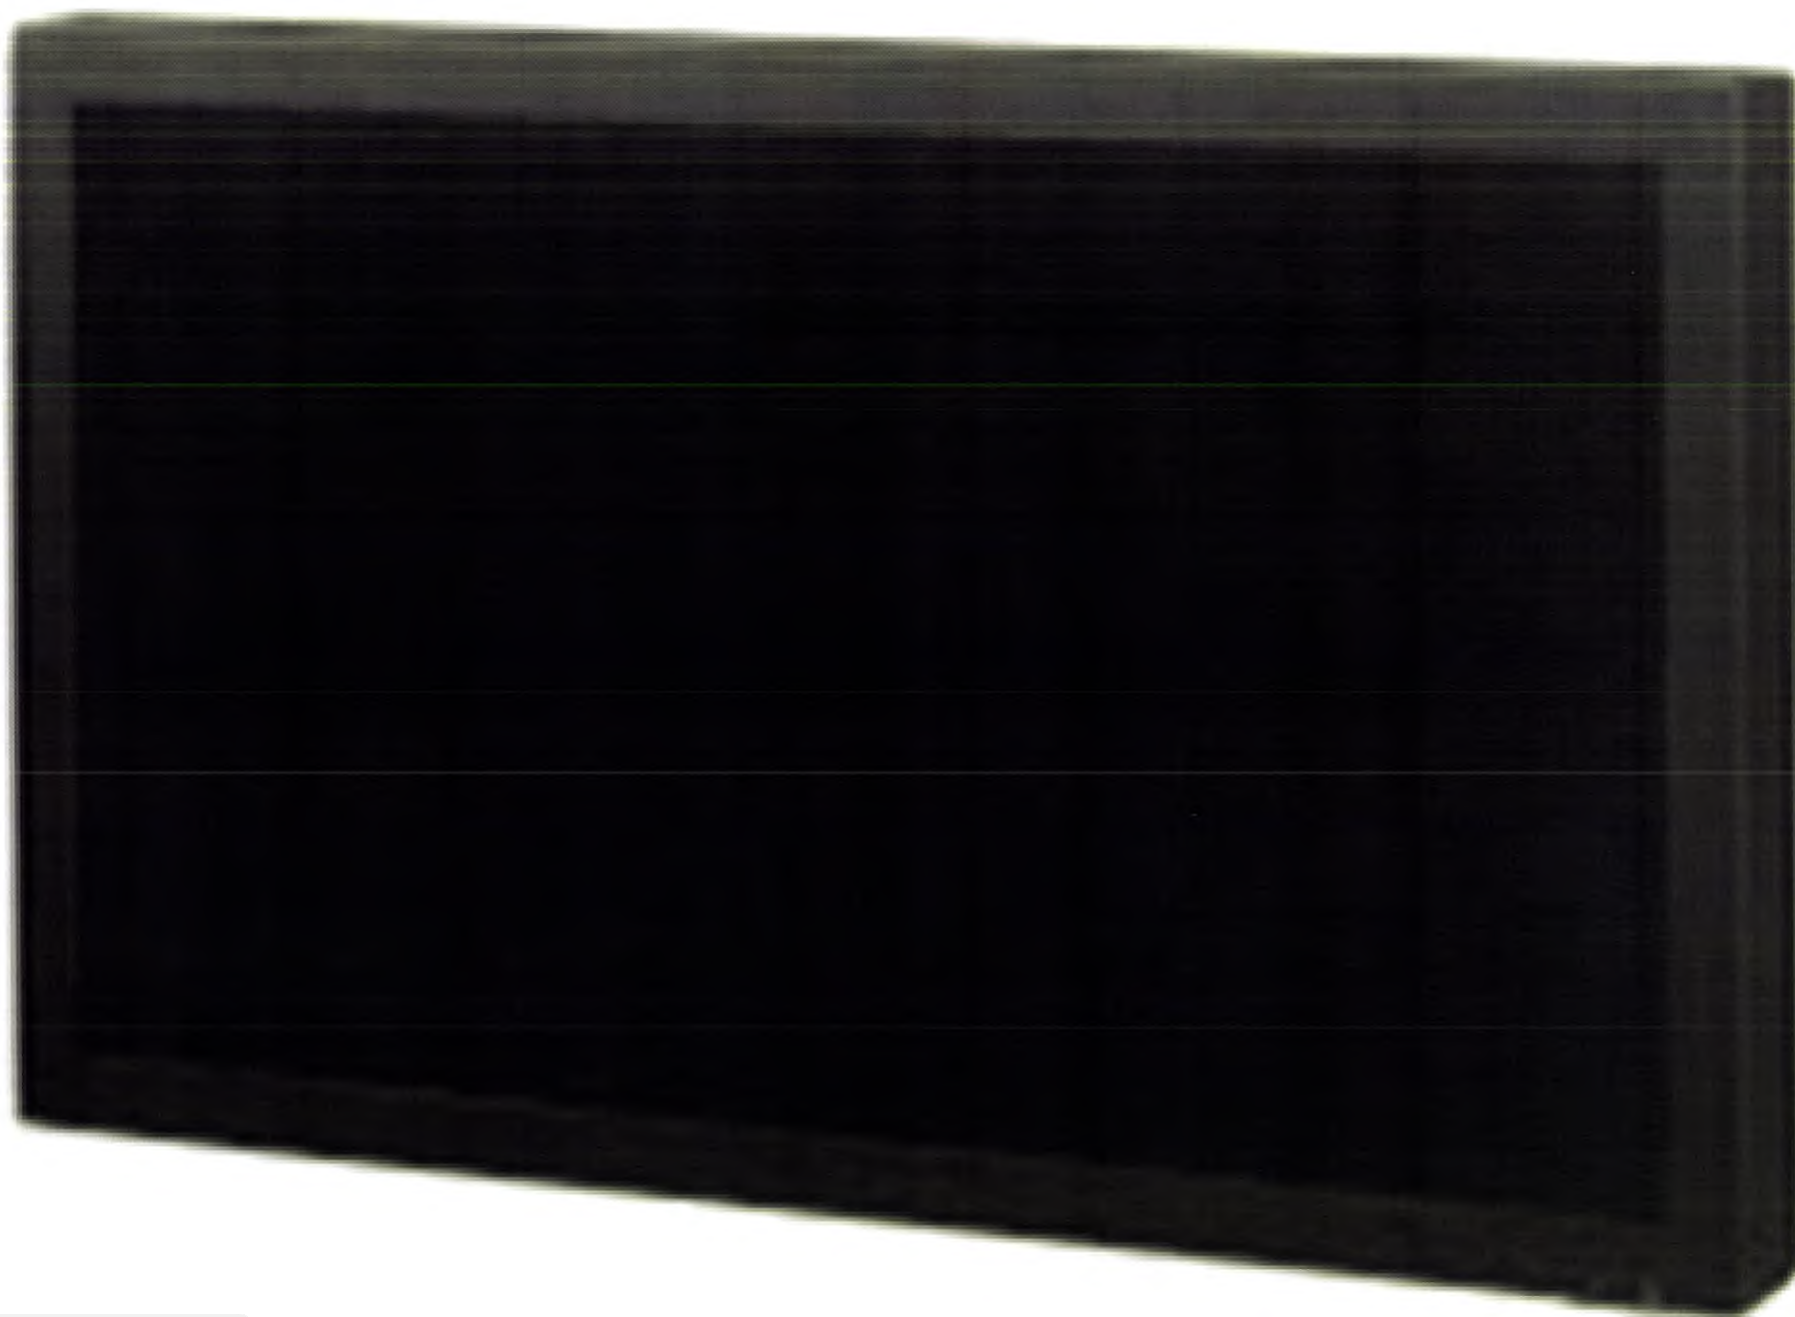

59. Преобразователь видеосигнала (не болсе 5 шт.)



60. Видеоконвертеры (не более 5 шт.)




61. Видеоадаптеры (не более 5 шт.)



61. Видеоадаптеры (не более 5 шт.)



62. Изоляционные трансформаторы (не более 3 шт.)

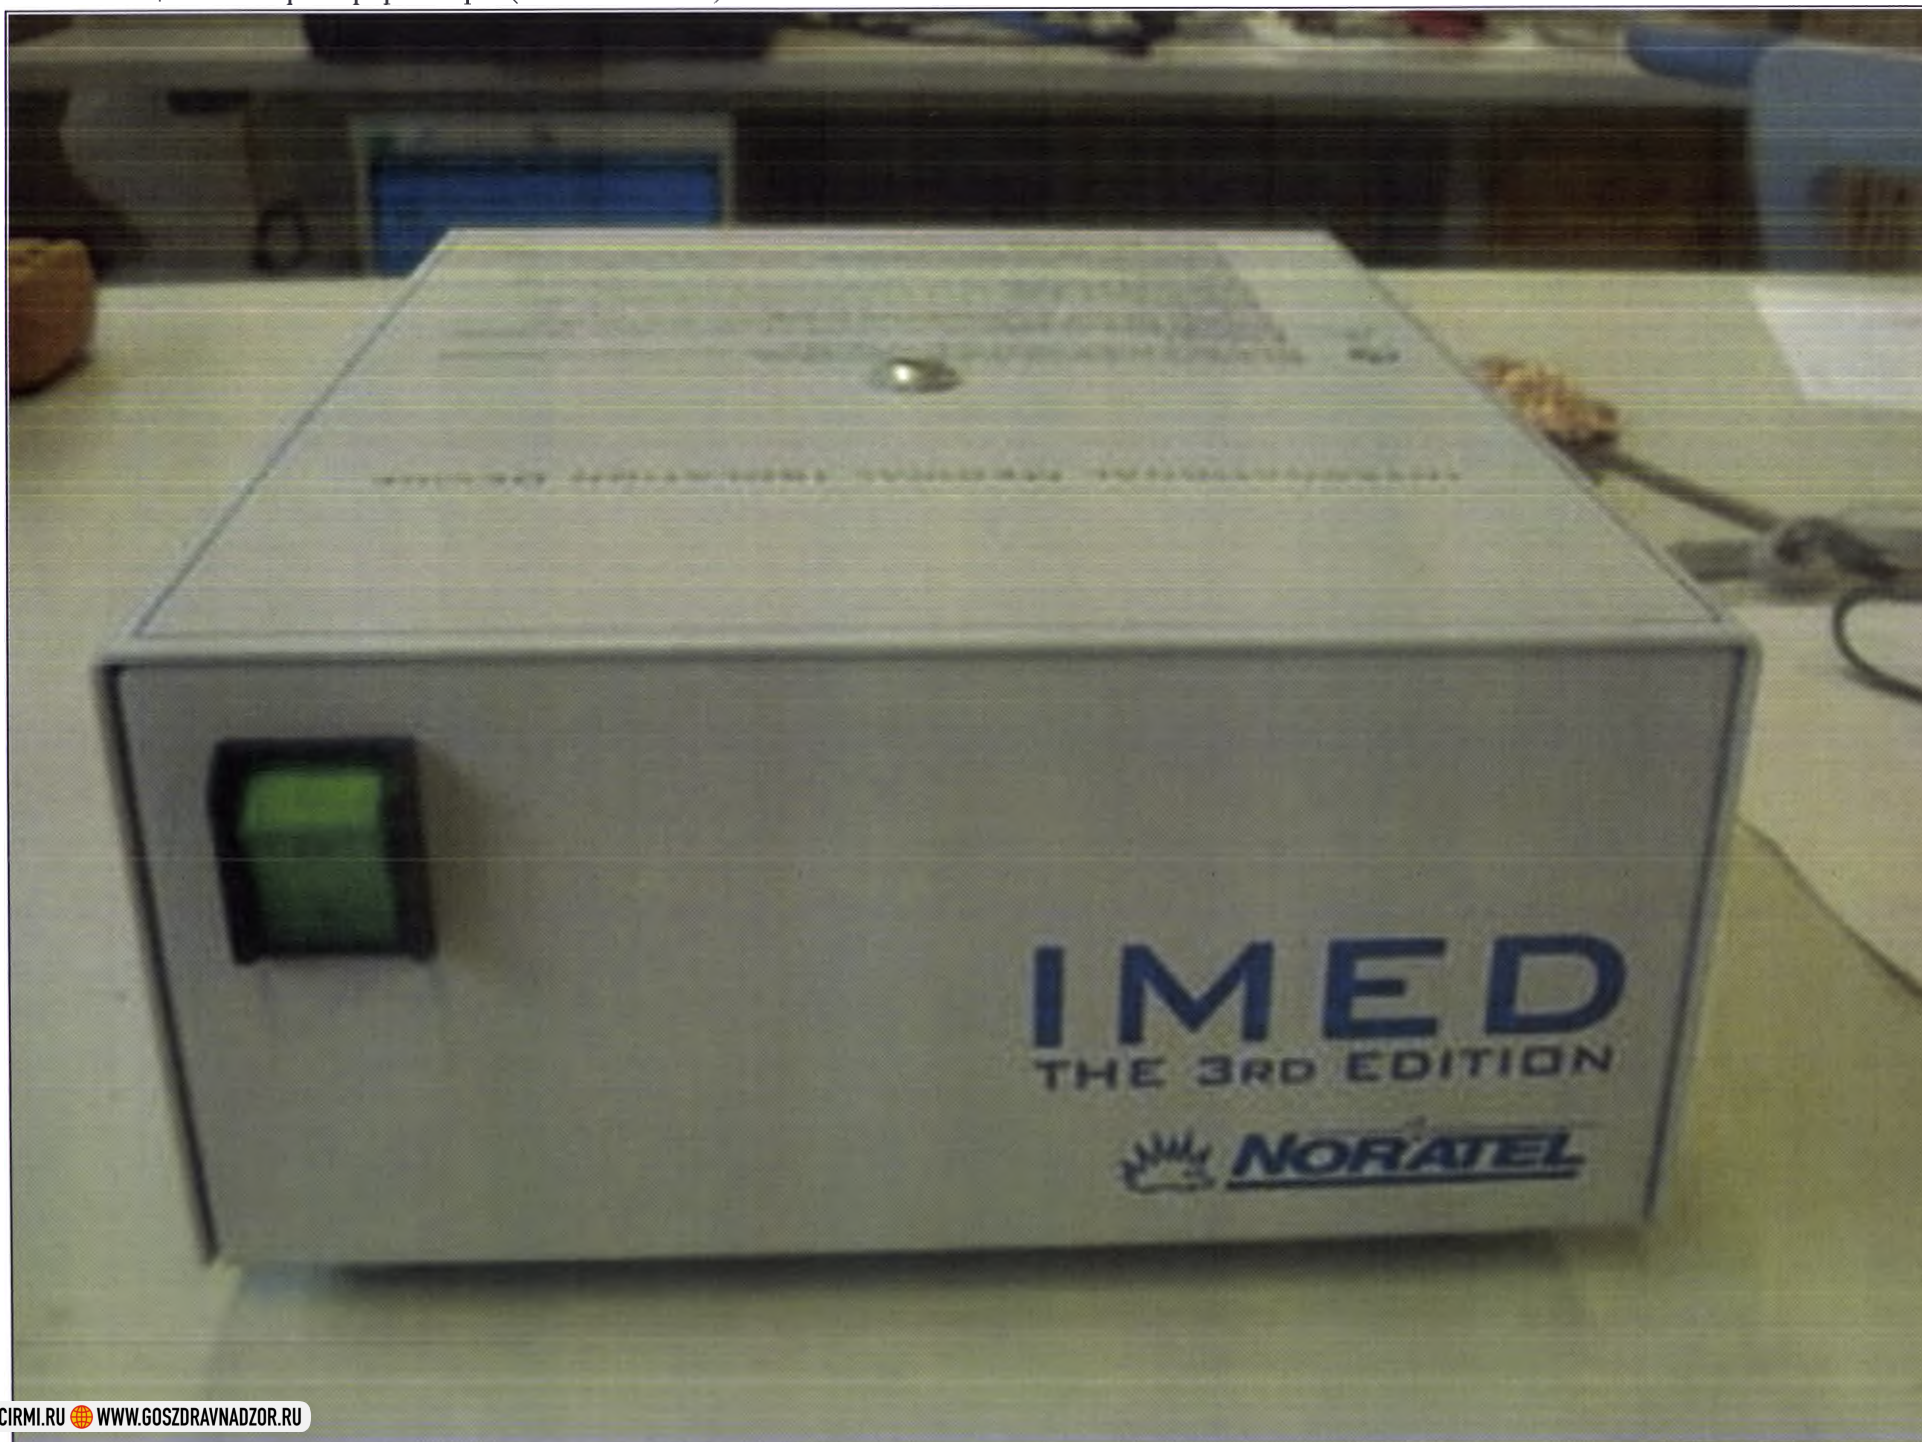

62. Изоляционные трансформаторы (не более 3 шт.)




62. Изоляционные трансформаторы (не более 3 шт.)




63. Адаптеры для компьютерной сети (не более 3 шт.)




64. Расширенное руководство пользователя (не более 3 шт.)

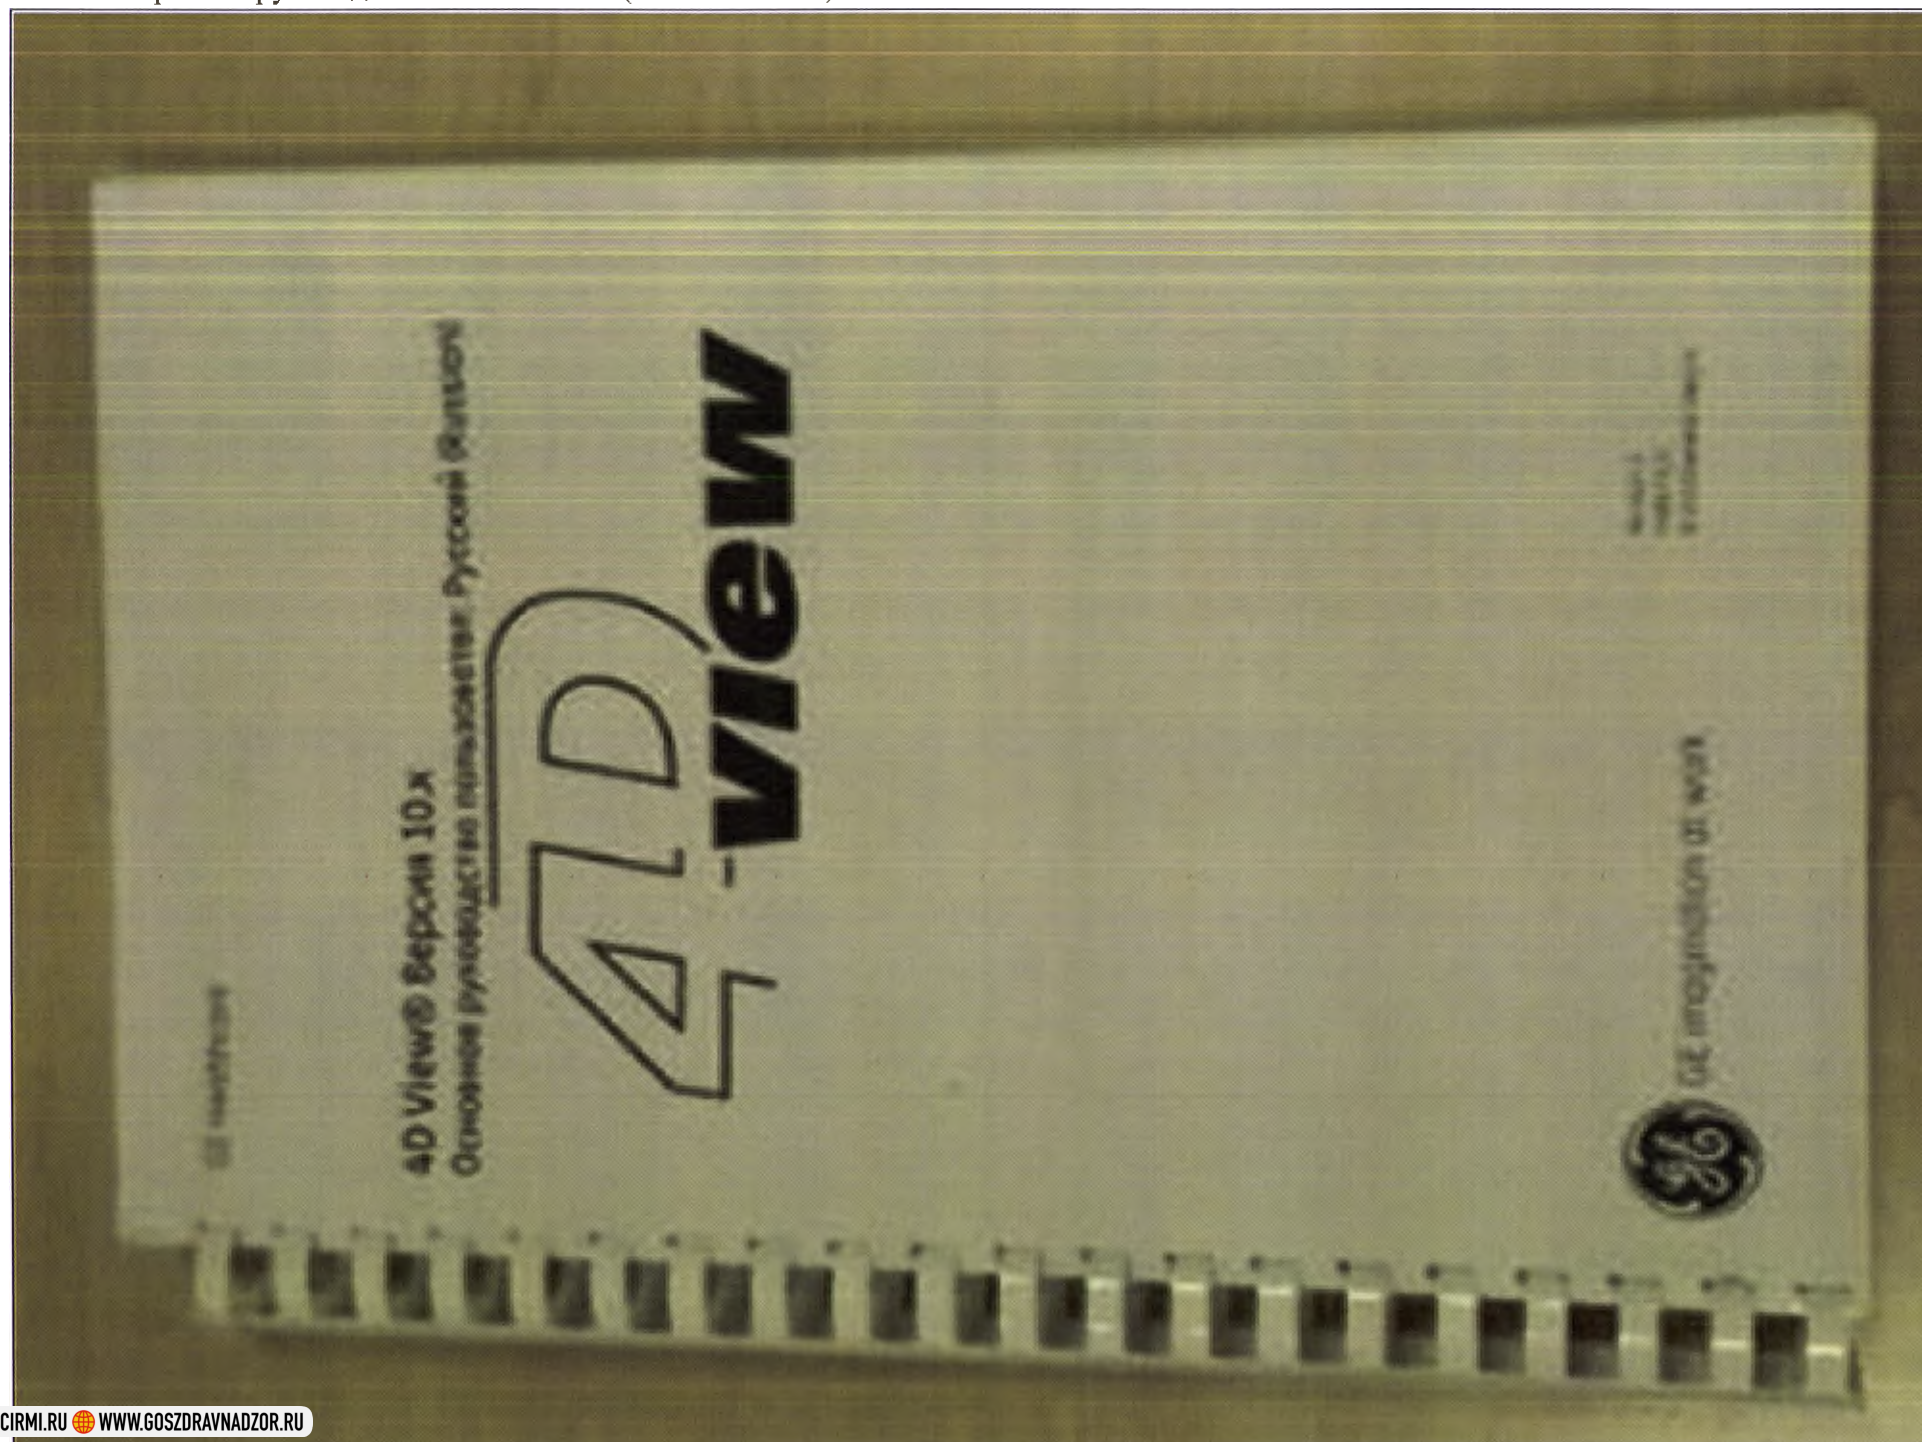

64. Расширенное руководство пользователя (не более 3 шт.)

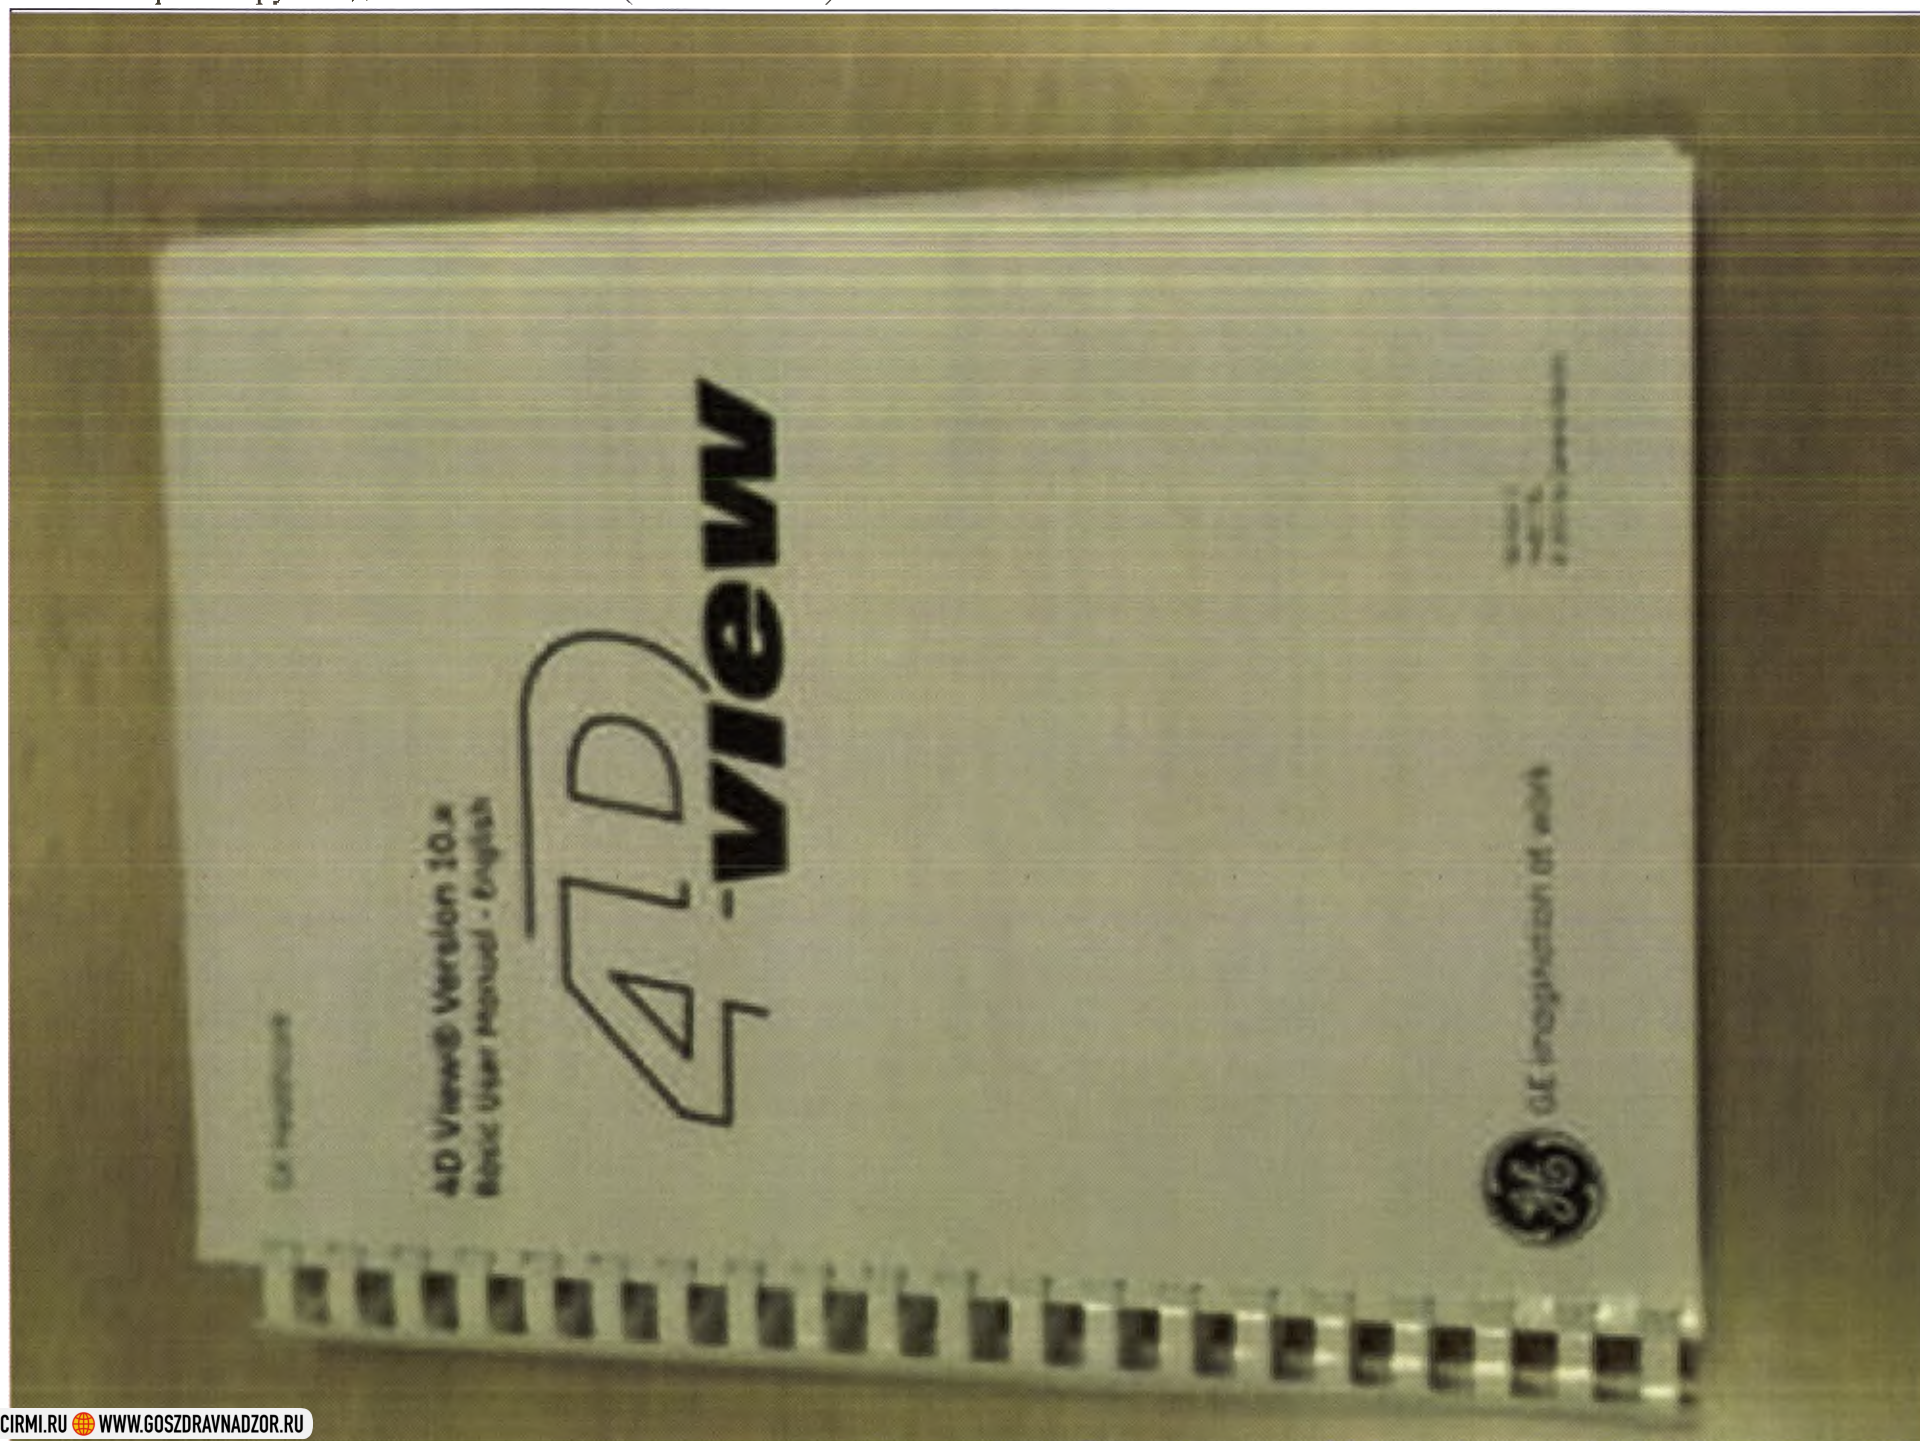

65. Устройства видеозаписывающих (не более 3 шт.)

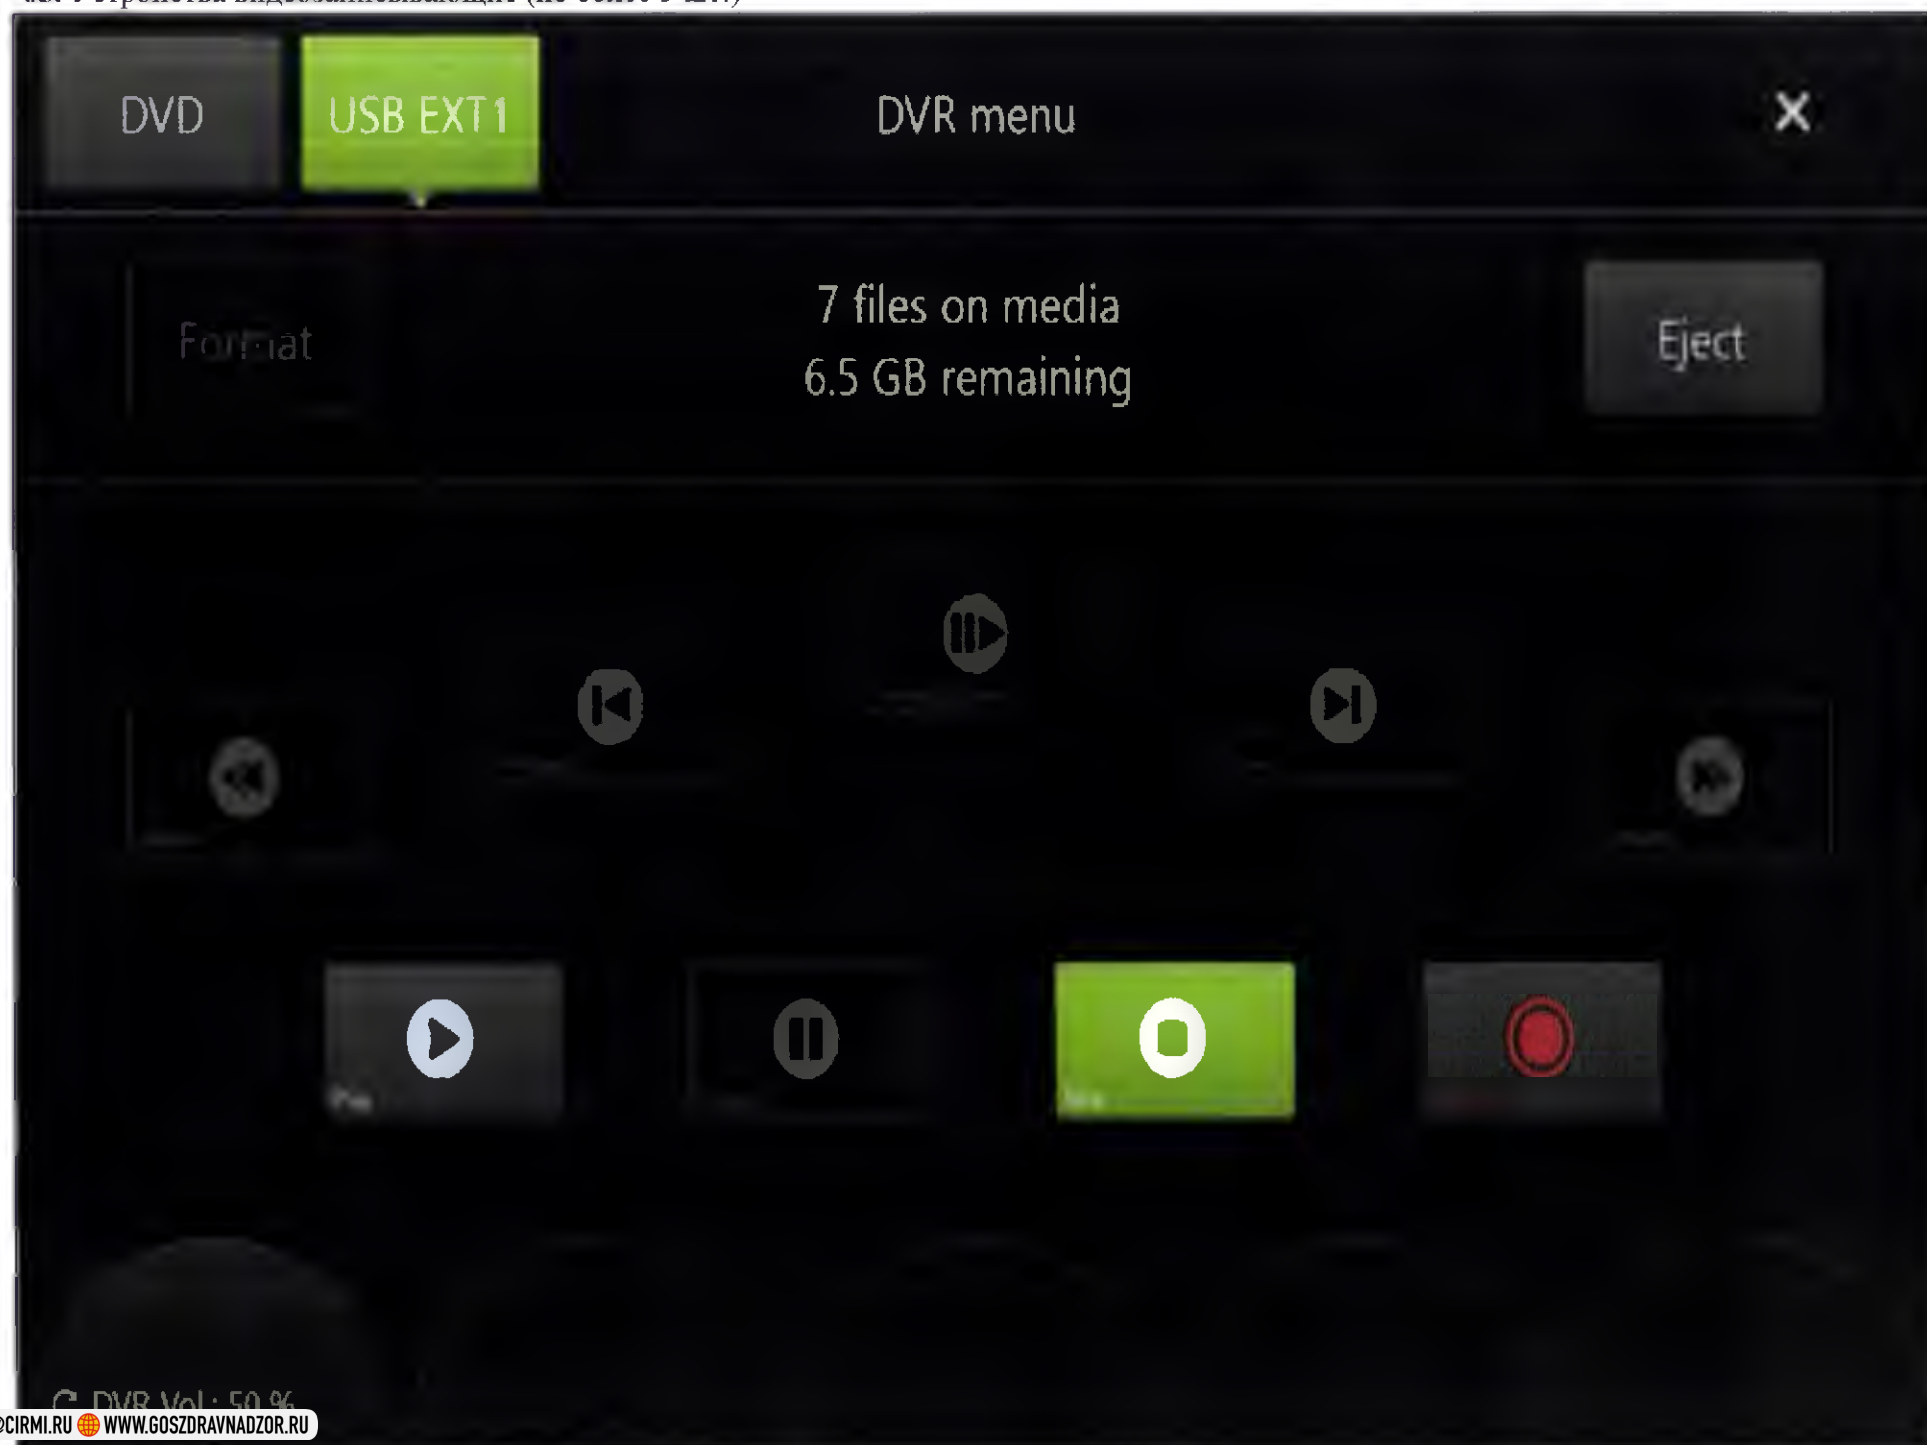


66. Устройства монтажные для видеозаписывающего устройства (не более 5 шт.)



67. Бумага для устройства печатающего черно-белые ультразвуковые изображения (не более 50 шт.)



68. Бумага для устройства печатающего цветные ультразвуковые изображения (не более 50 шт.)

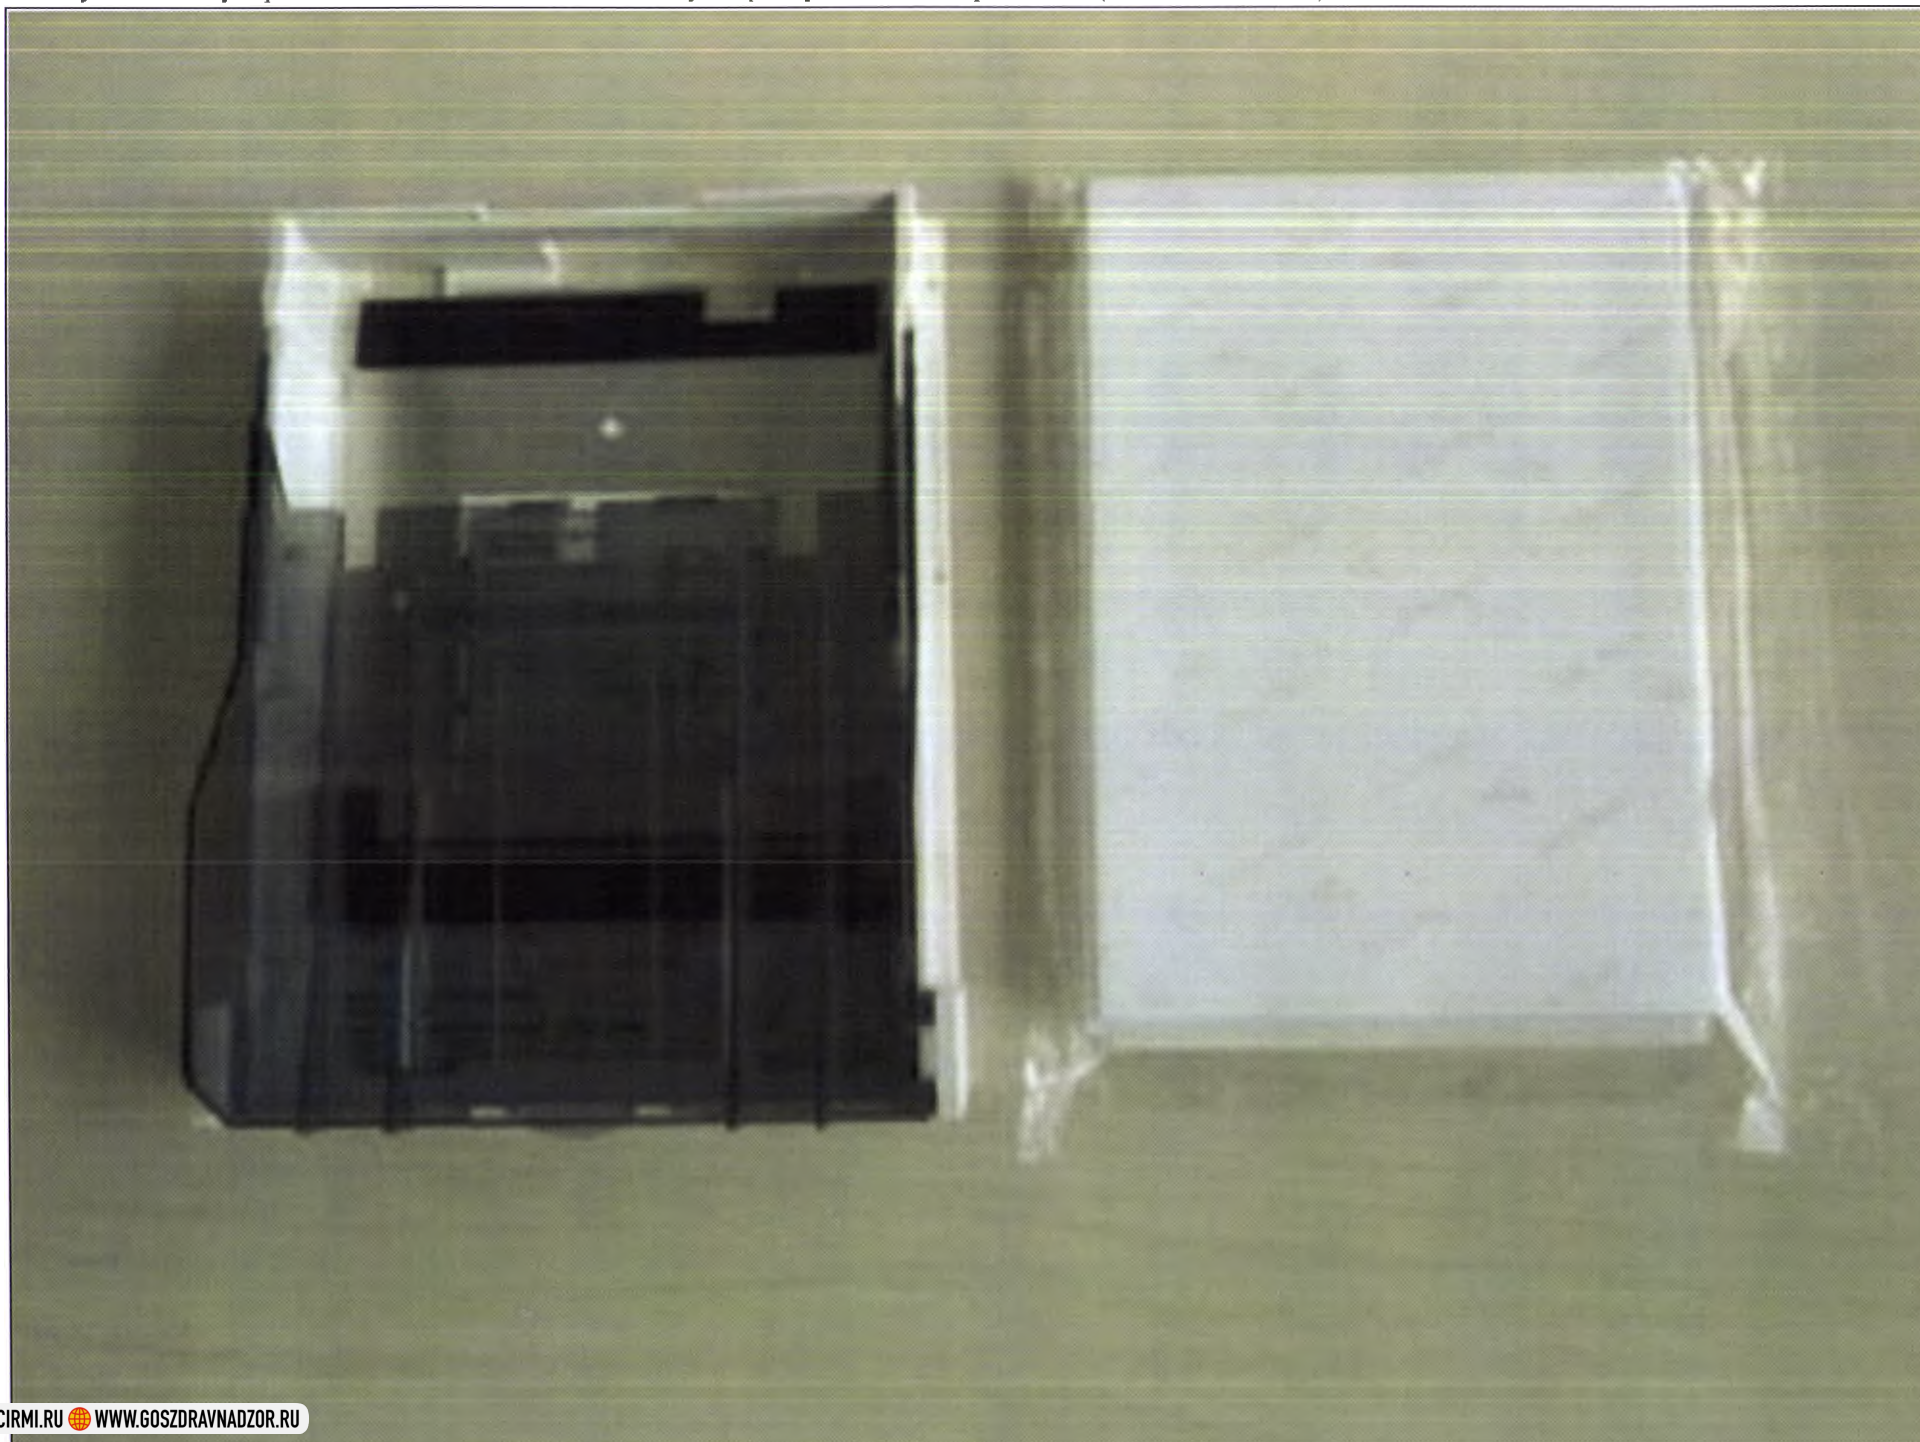


69. Монтажные блоки для устройства печатающего цветные ультразвуковые изображения (не более 6 шт.)



70. Держатели для датчика (не более 5 шт.)



70. Держатели для датчика (не более 5 шт.)

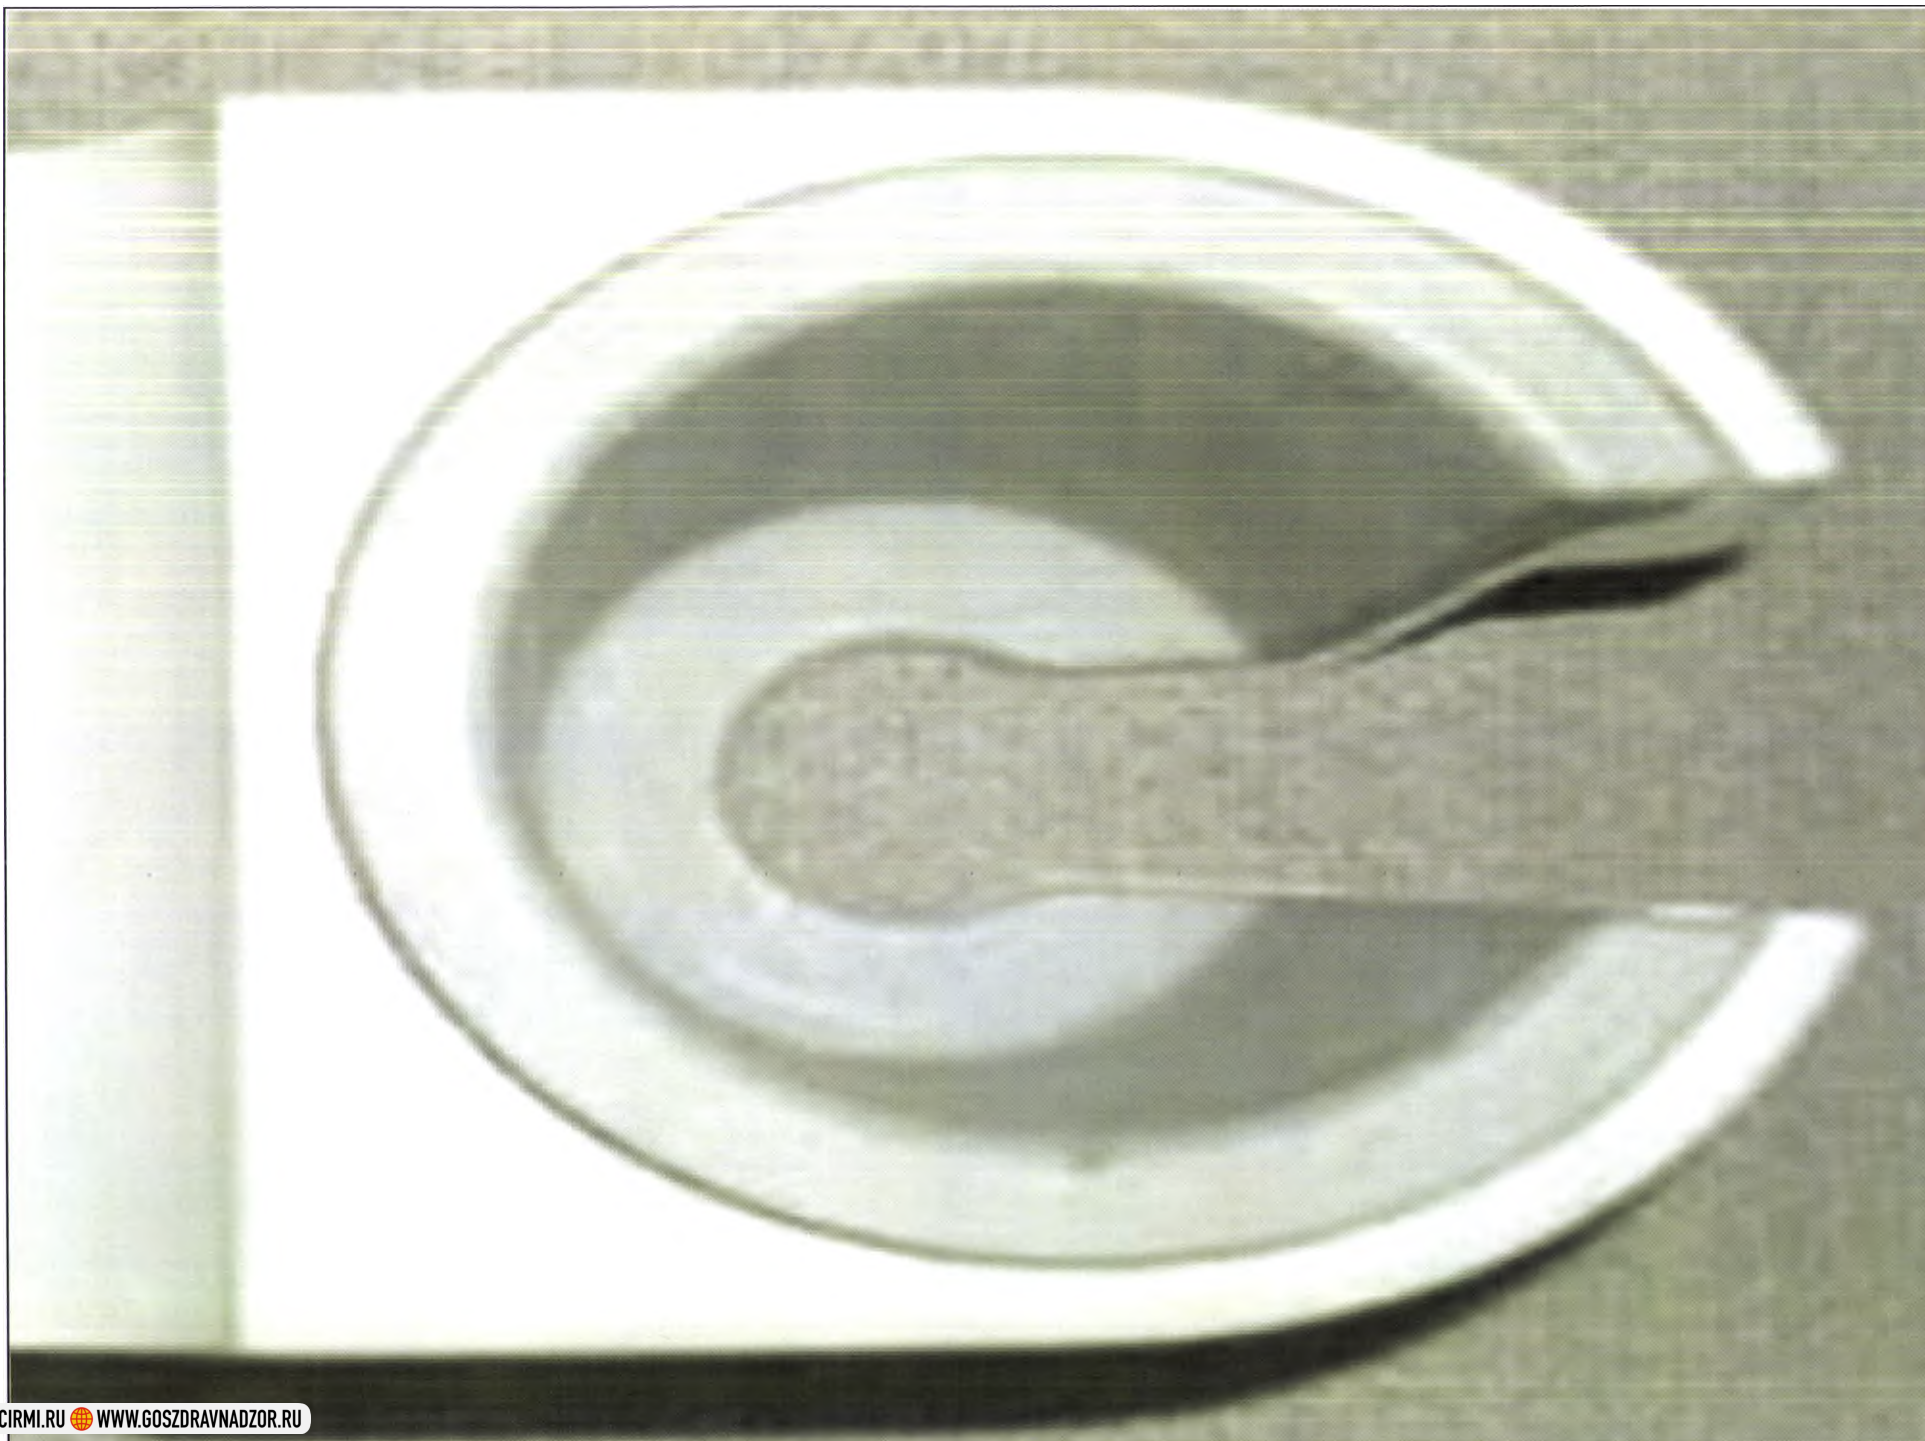




72. Трансформаторные блоки (не более 3 шт.)



73. Программное обеспечение (не более 10 шт.)

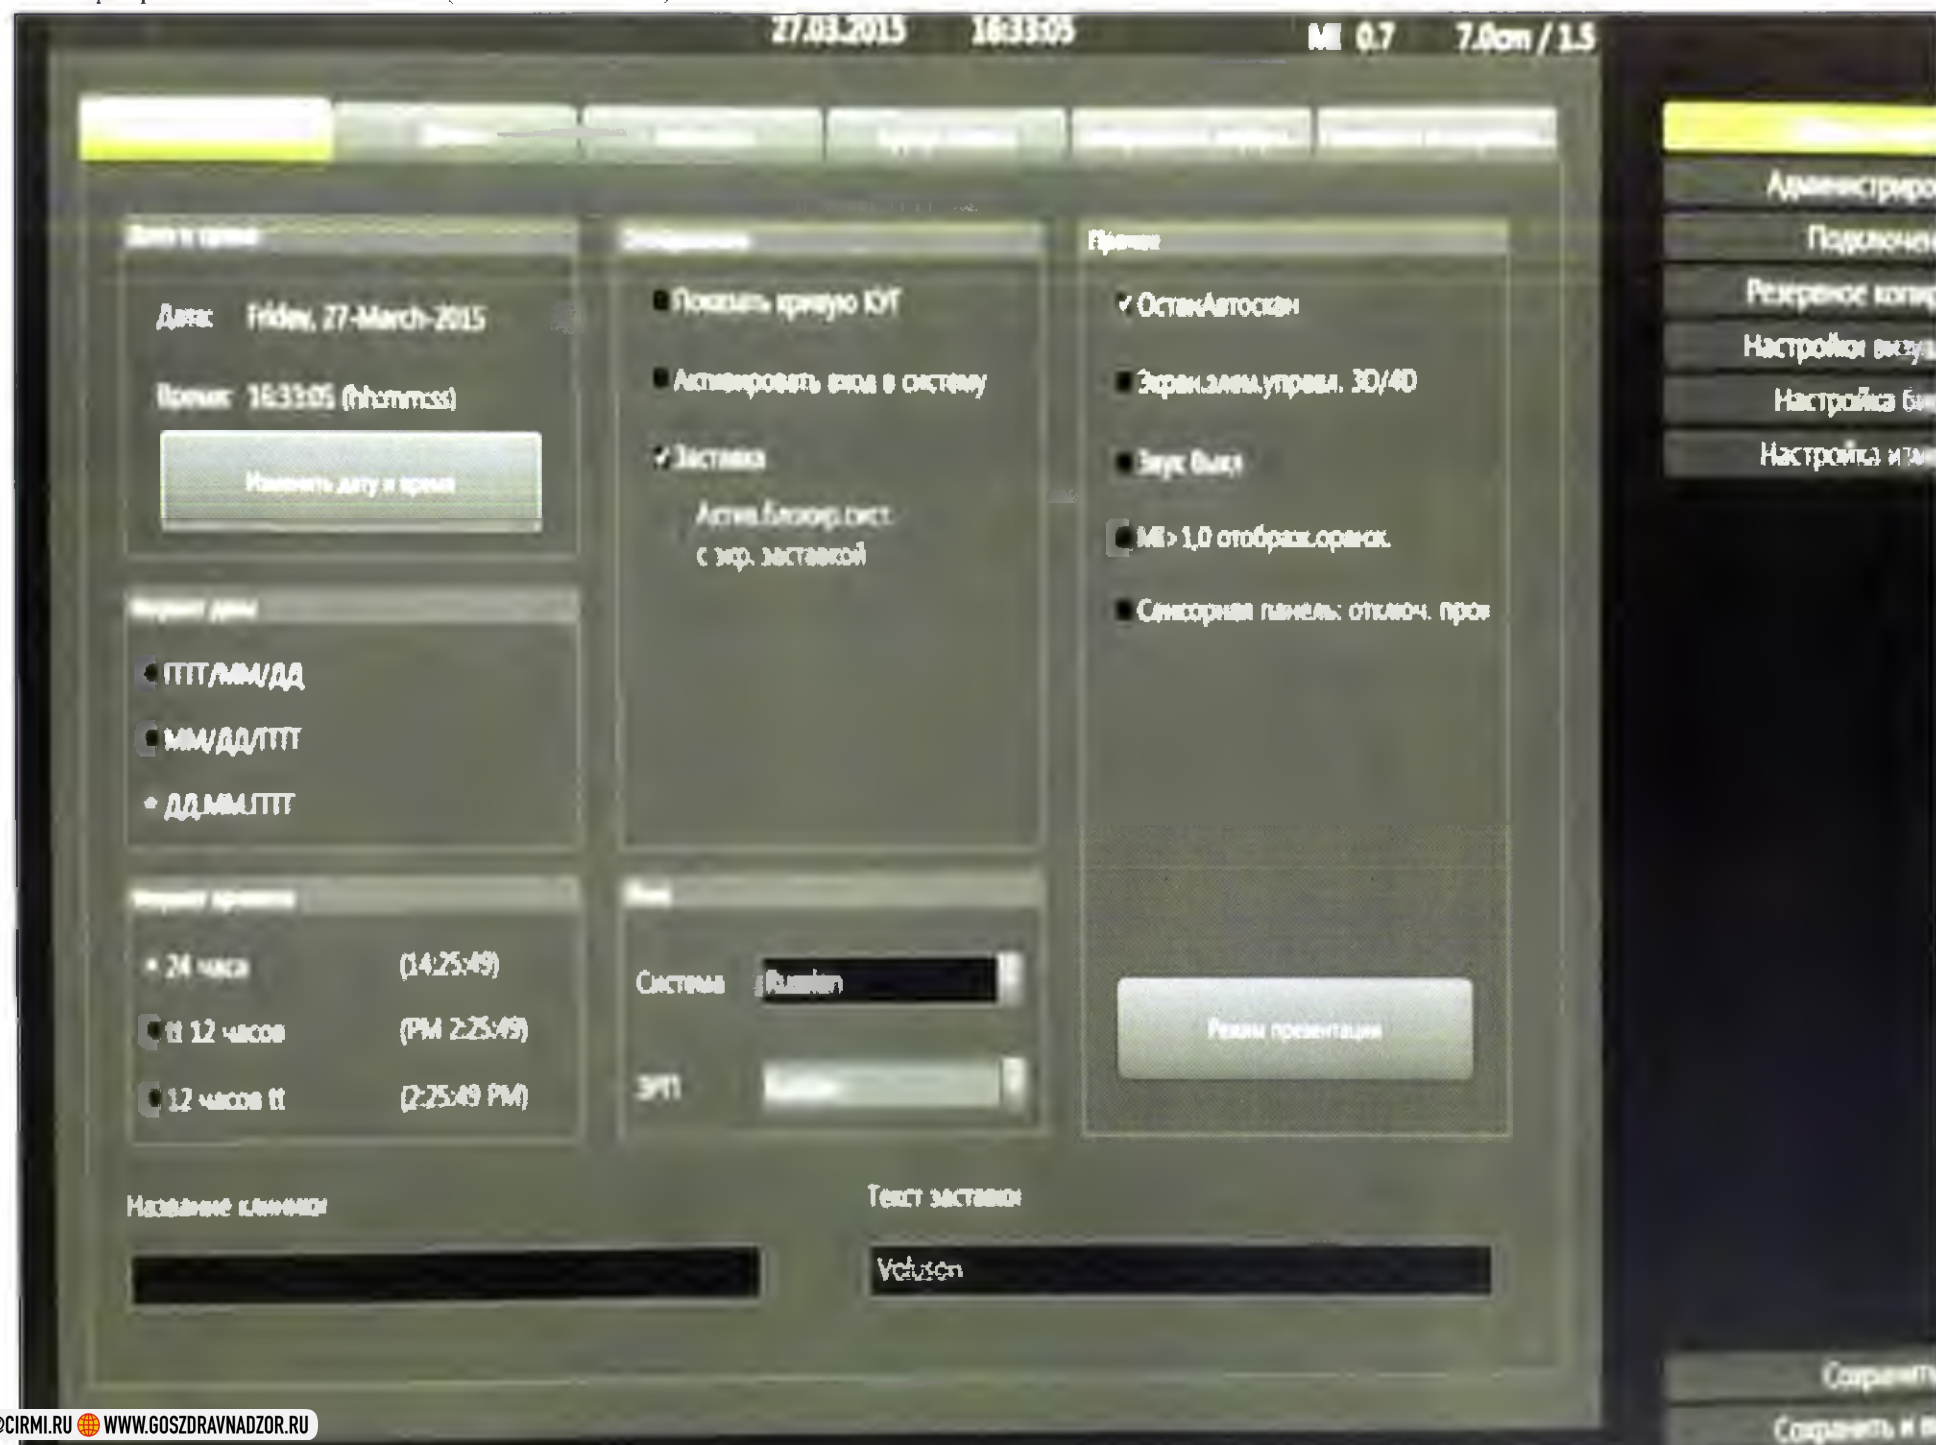

74. Блоки батарей (не более 3 шт.)



ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 109

