

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КЛОВЕРМЕД»
Засеева О.В.
«25» августа 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Производство компании:

Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС)
98 Bledsoe Road,
Newnan, Georgia, 30265
USA, США

**Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Микротонкая пластина/ Micro Thin Sheet, в составе:**

1. Микротонкая пластина/ Micro Thin Sheet OP8438 30мм x 50мм x 0.45мм, помещенная в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5 шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1 шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1 шт.



MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP8438

LOT



013011222

Qty



0001



(01)00855421005027(7001)3011222(17)202712-01

MTX-OP8438-L1.06

Made in the USA

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
Вариант исполнения: Микротонкая пластина/ Micro Thin Sheet

Артикул: OP8438

Размер: 30мм x 50мм x 0.45мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО


«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,

эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Ультратонкие пластины/ Ultra Thin Sheets, в составе:

1. Ультратонкая пластина/ Ultra Thin Sheet, помещенная в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт,
- вариант исполнения:
-OP7210 38мм x 50мм x 0.85мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка дляклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

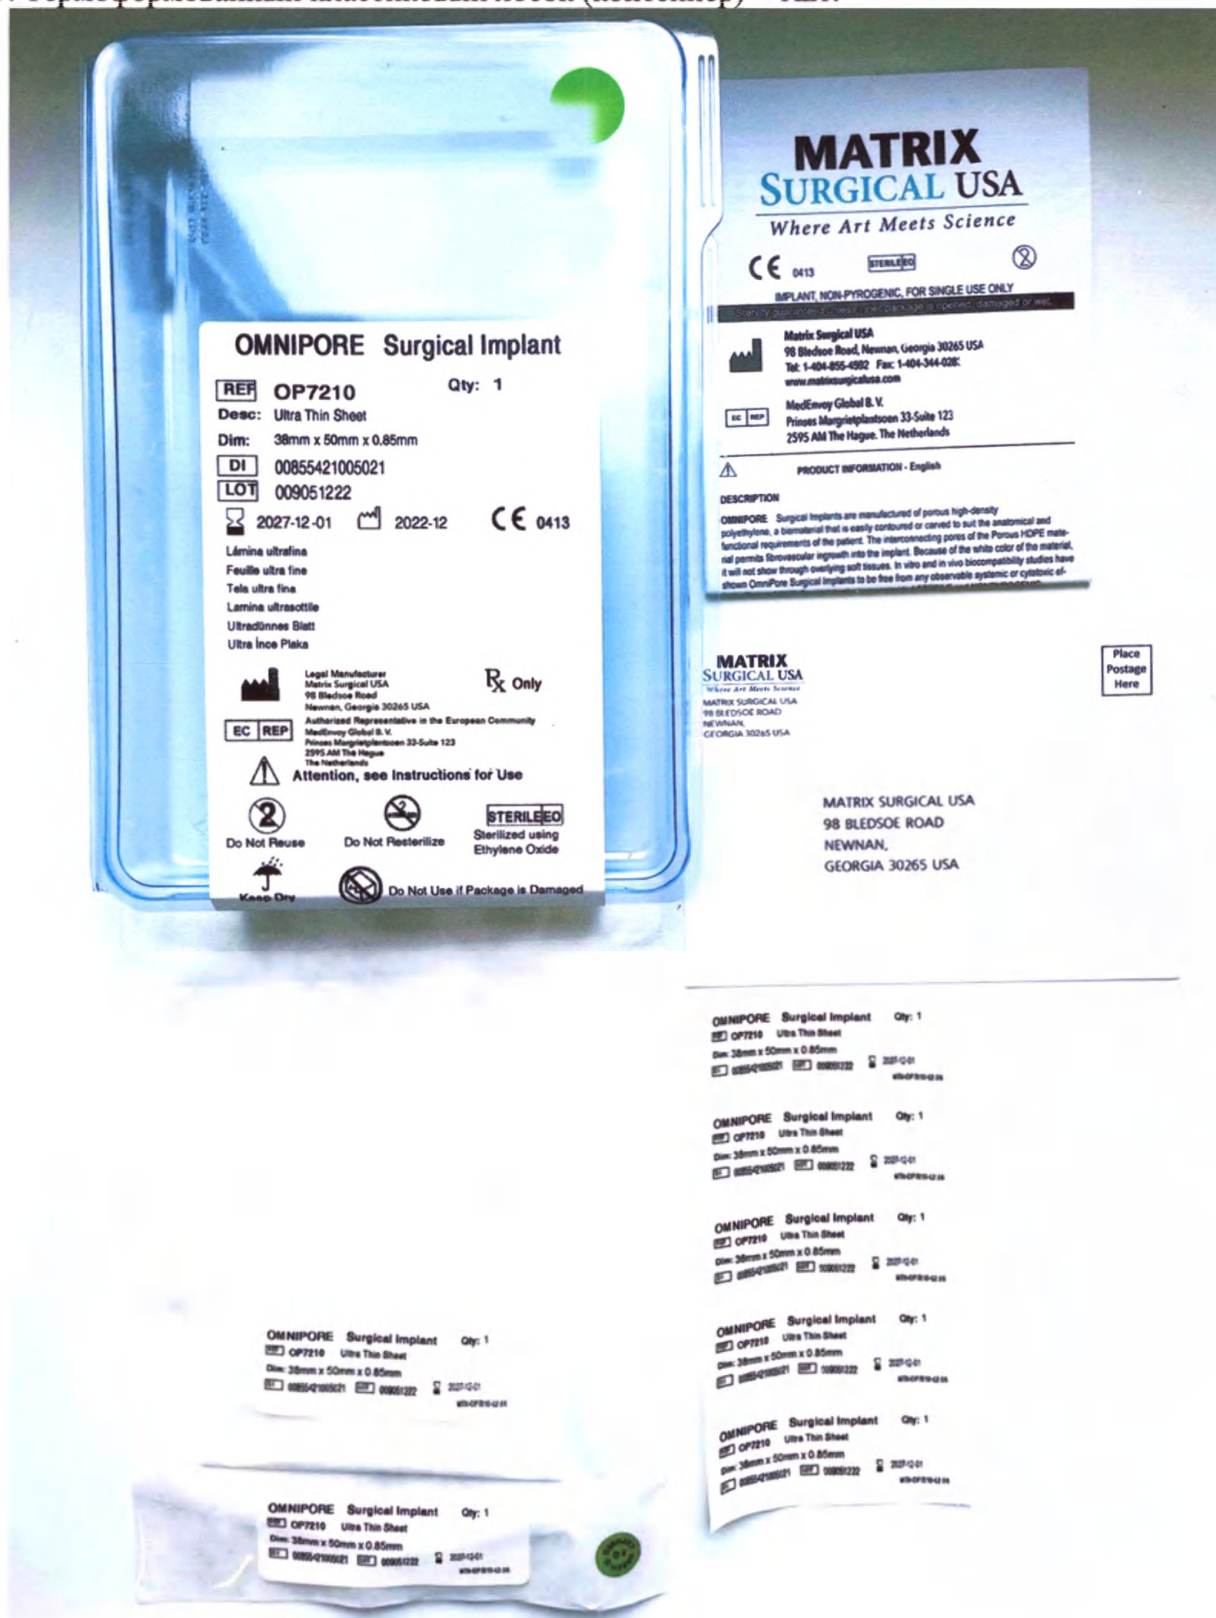

MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF

LOT

Qty



OP7210



009051222



0001



(01)00855421005021(00)0090512225(17)202712-01

MTX-OP7210-L1.08

Made in the USA

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Ультратонкие пластины/ Ultra Thin Sheets

Артикул: OP7210

Размер: 38мм x 50мм x 0.85мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал

Холдинг, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдинг, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91% , атмосферное давление 86 - 106

кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,


эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные вариант исполнения: Пластины/Sheets, в составе:

1. Пластина/Sheet, помещенная в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт,
вариант исполнения:
-OP6330 38мм x 50мм x 1.5мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

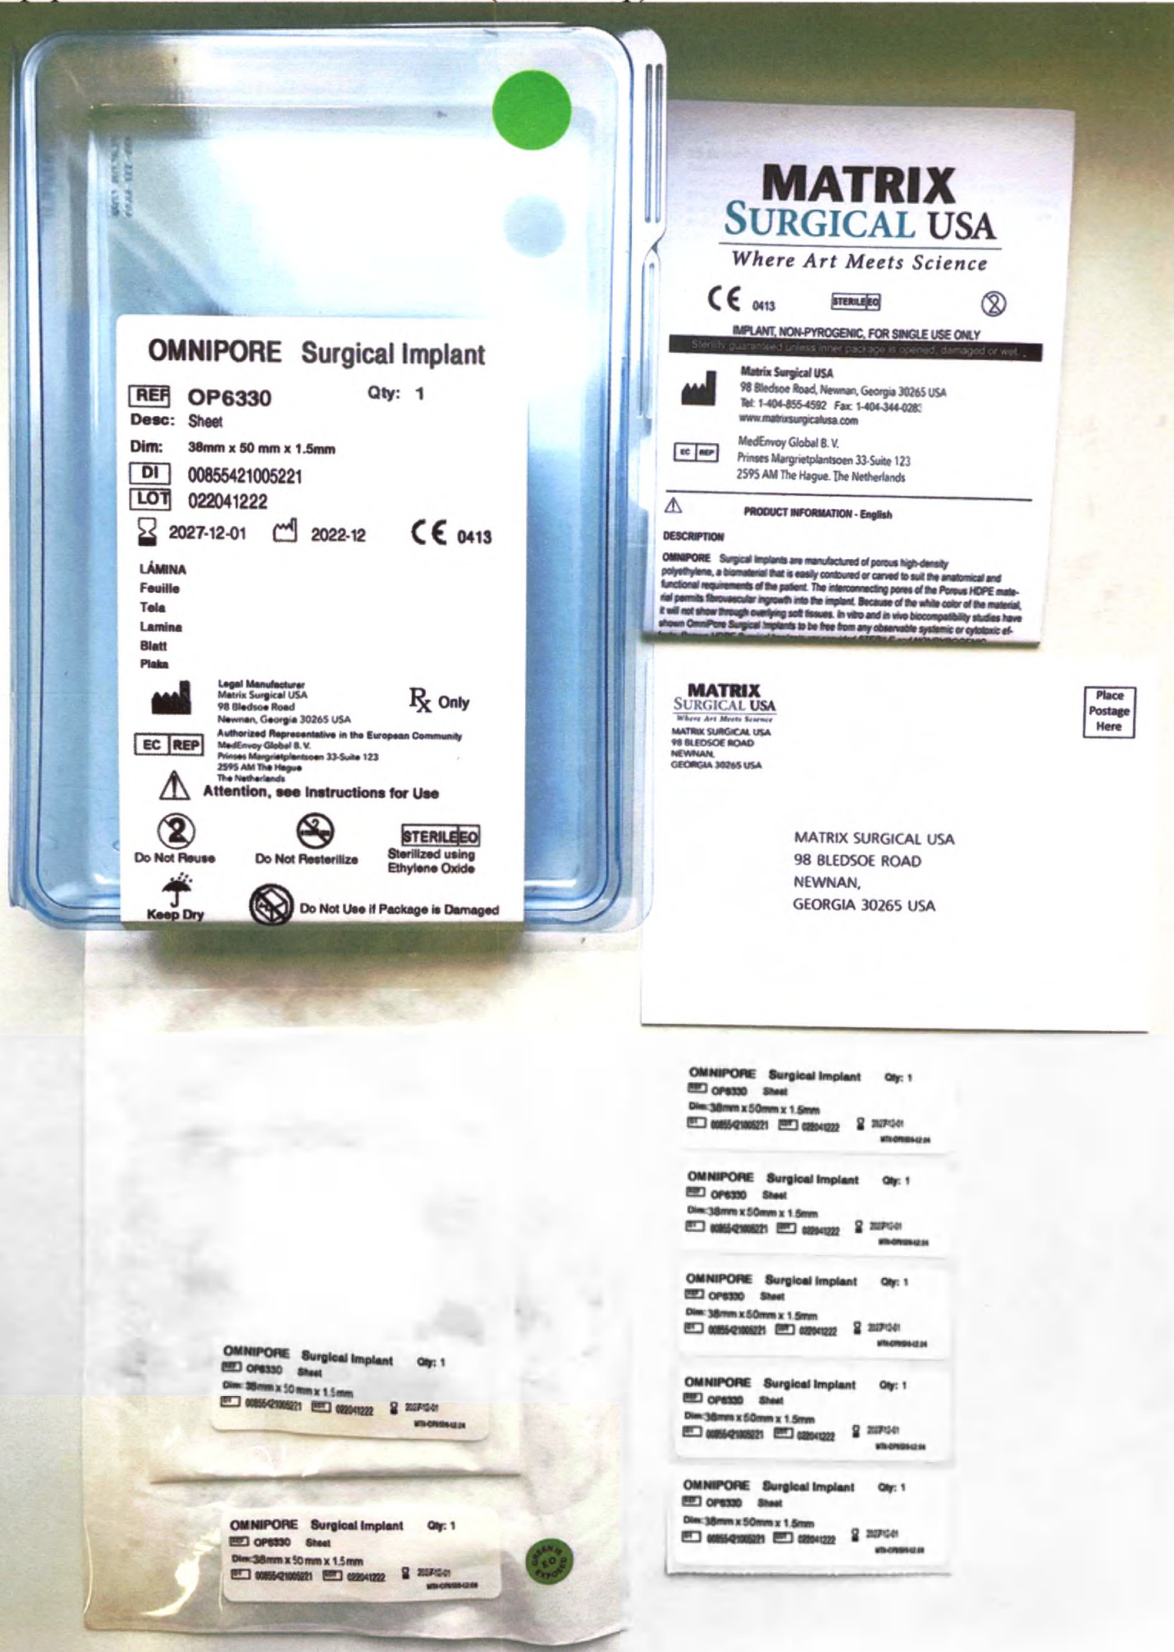



MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP6330

LOT



022041222

Qty



0001



(01)00855421005221(90)022041222(17)202712-01

MTX-OP6330-L1.06

Made in the USA

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Пластины/Sheets

Артикул: OP6330

Размер: 38мм x 50мм x 1.5мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал

Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,


эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



**Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Орбитальные сферы/ Orbital Spheres, в составе:**

1. Орбитальная сфера/ Orbital Sphere, помещенная в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1шт, вариант исполнения:
-OP6316 – Ø 14мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт

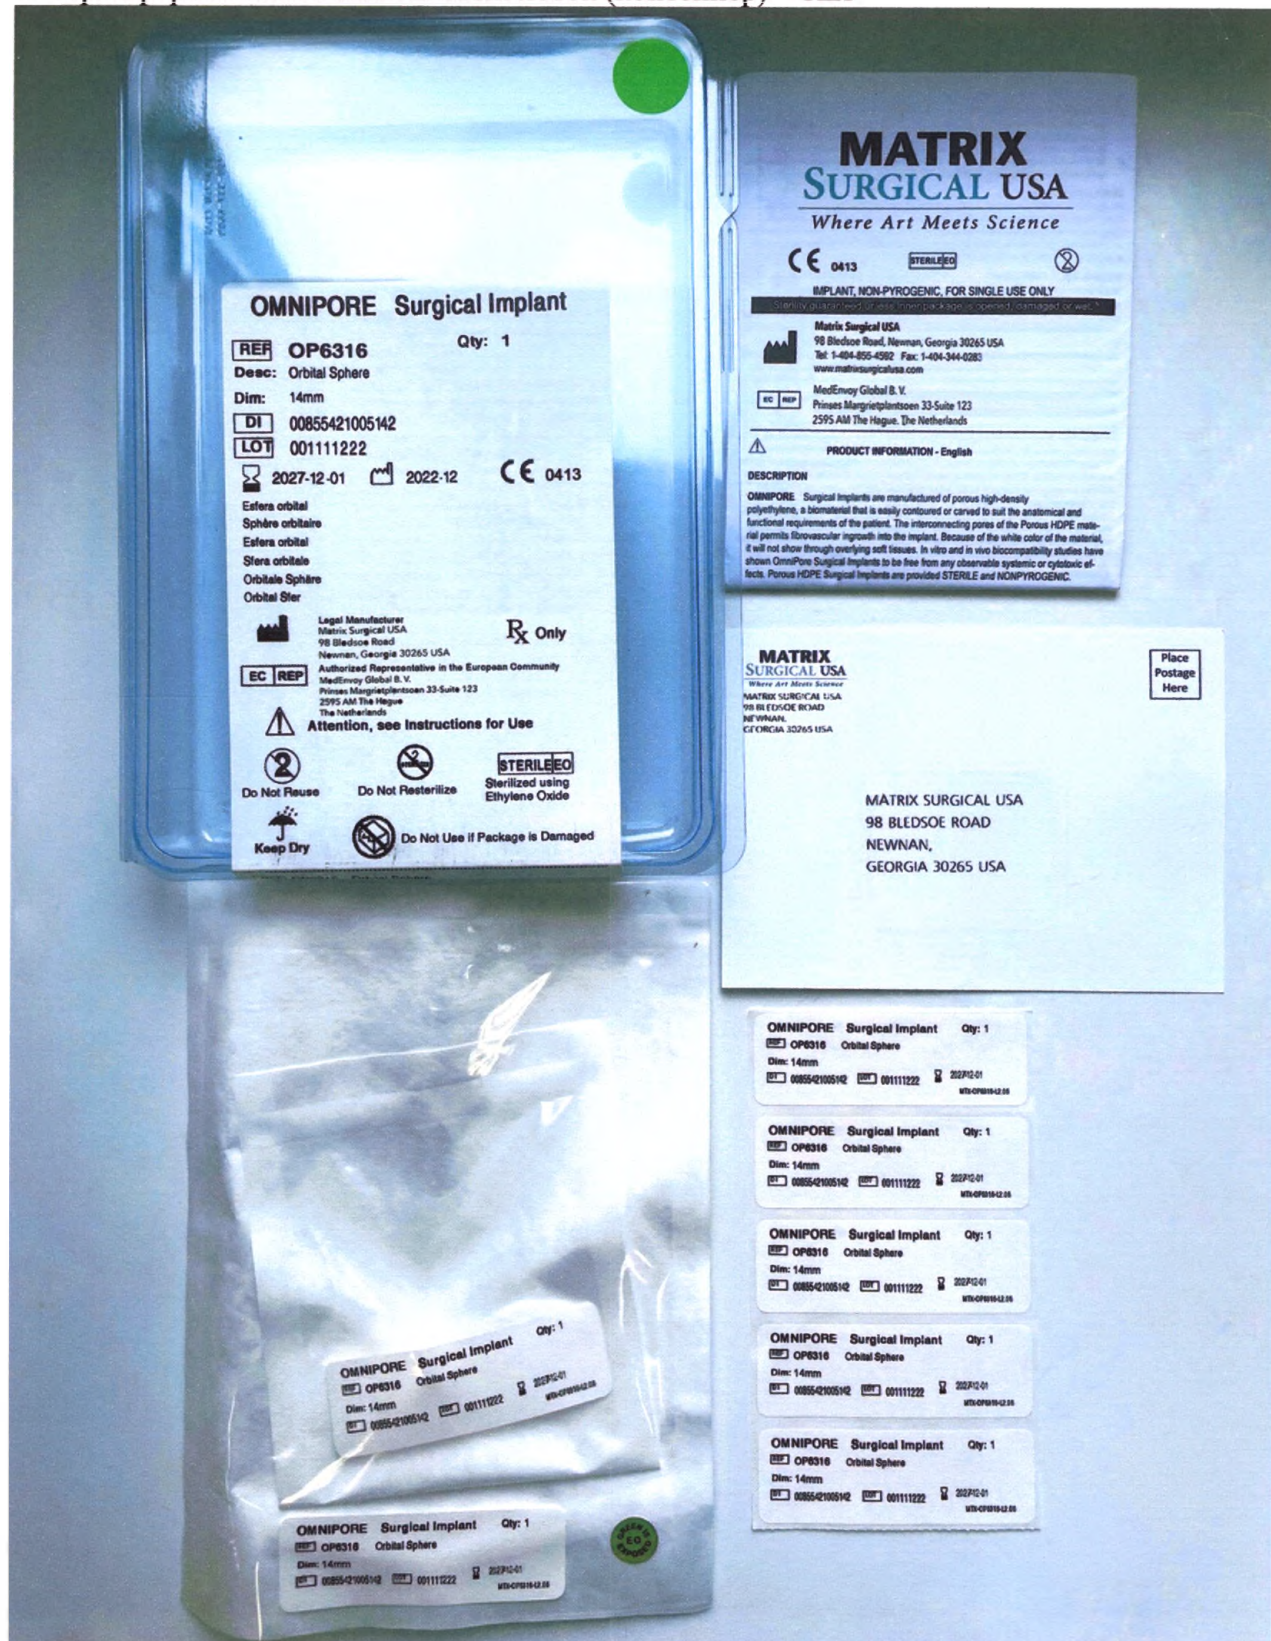



Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Составные имплантаты для пластики подбородка/Two-Piece
Chin, в составе:

1. Составной имплантат для пластики подбородка/Two-Piece Chin, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт, вариант исполнения:
 - OP8320 - Малый 62мм x 27мм x 5мм.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5 шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1 шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1 шт.





MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP8320

LOT



007011222

Qty



0001



(01)0085542100525860007011222(17)202712-01

MTX-OP8320-L1.06

Made in the USA

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Составные имплантаты для пластики подбородка/Two-Piece Chin

Артикул: OP8320

Размер: Малый 62мм x 27мм x 5мм

Материал: полистилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,


относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛОВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,


эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

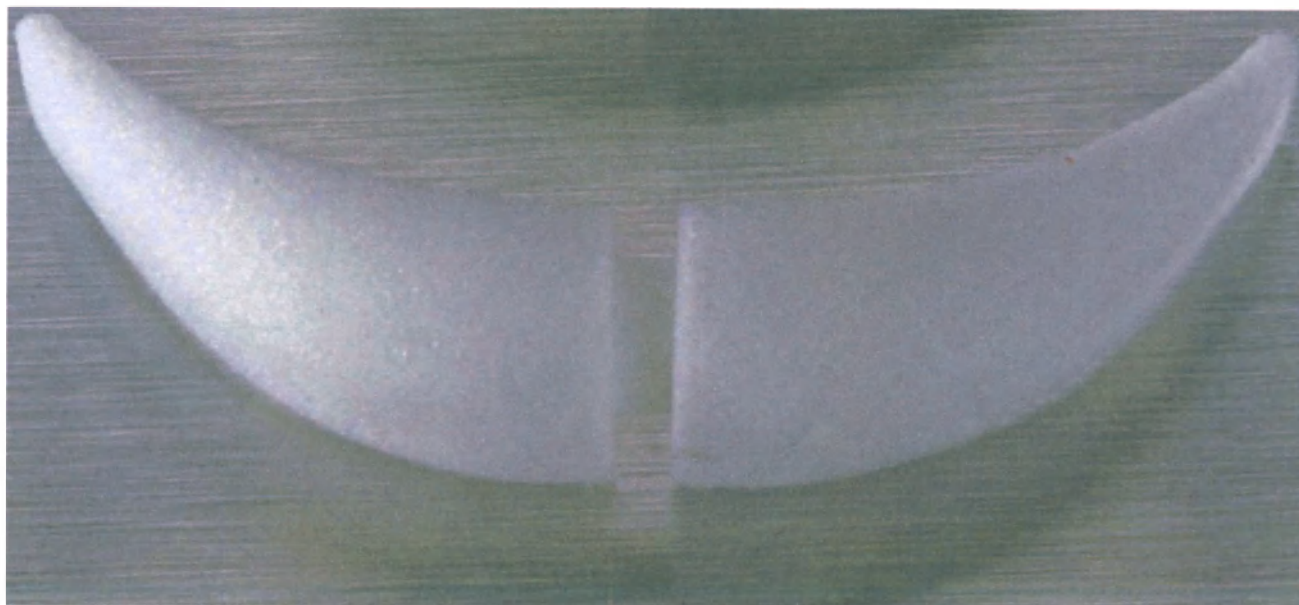

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные вариант исполнения: Клиновидные имплантаты для коррекции энофтальма/Enophthalmos Wedge, в составе:

1. Клиновидный имплантат для коррекции энофтальма/Enophthalmos Wedge, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт, вариант исполнения:
- OP9542 Стандартный правый 31мм x 22мм x 6.5мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

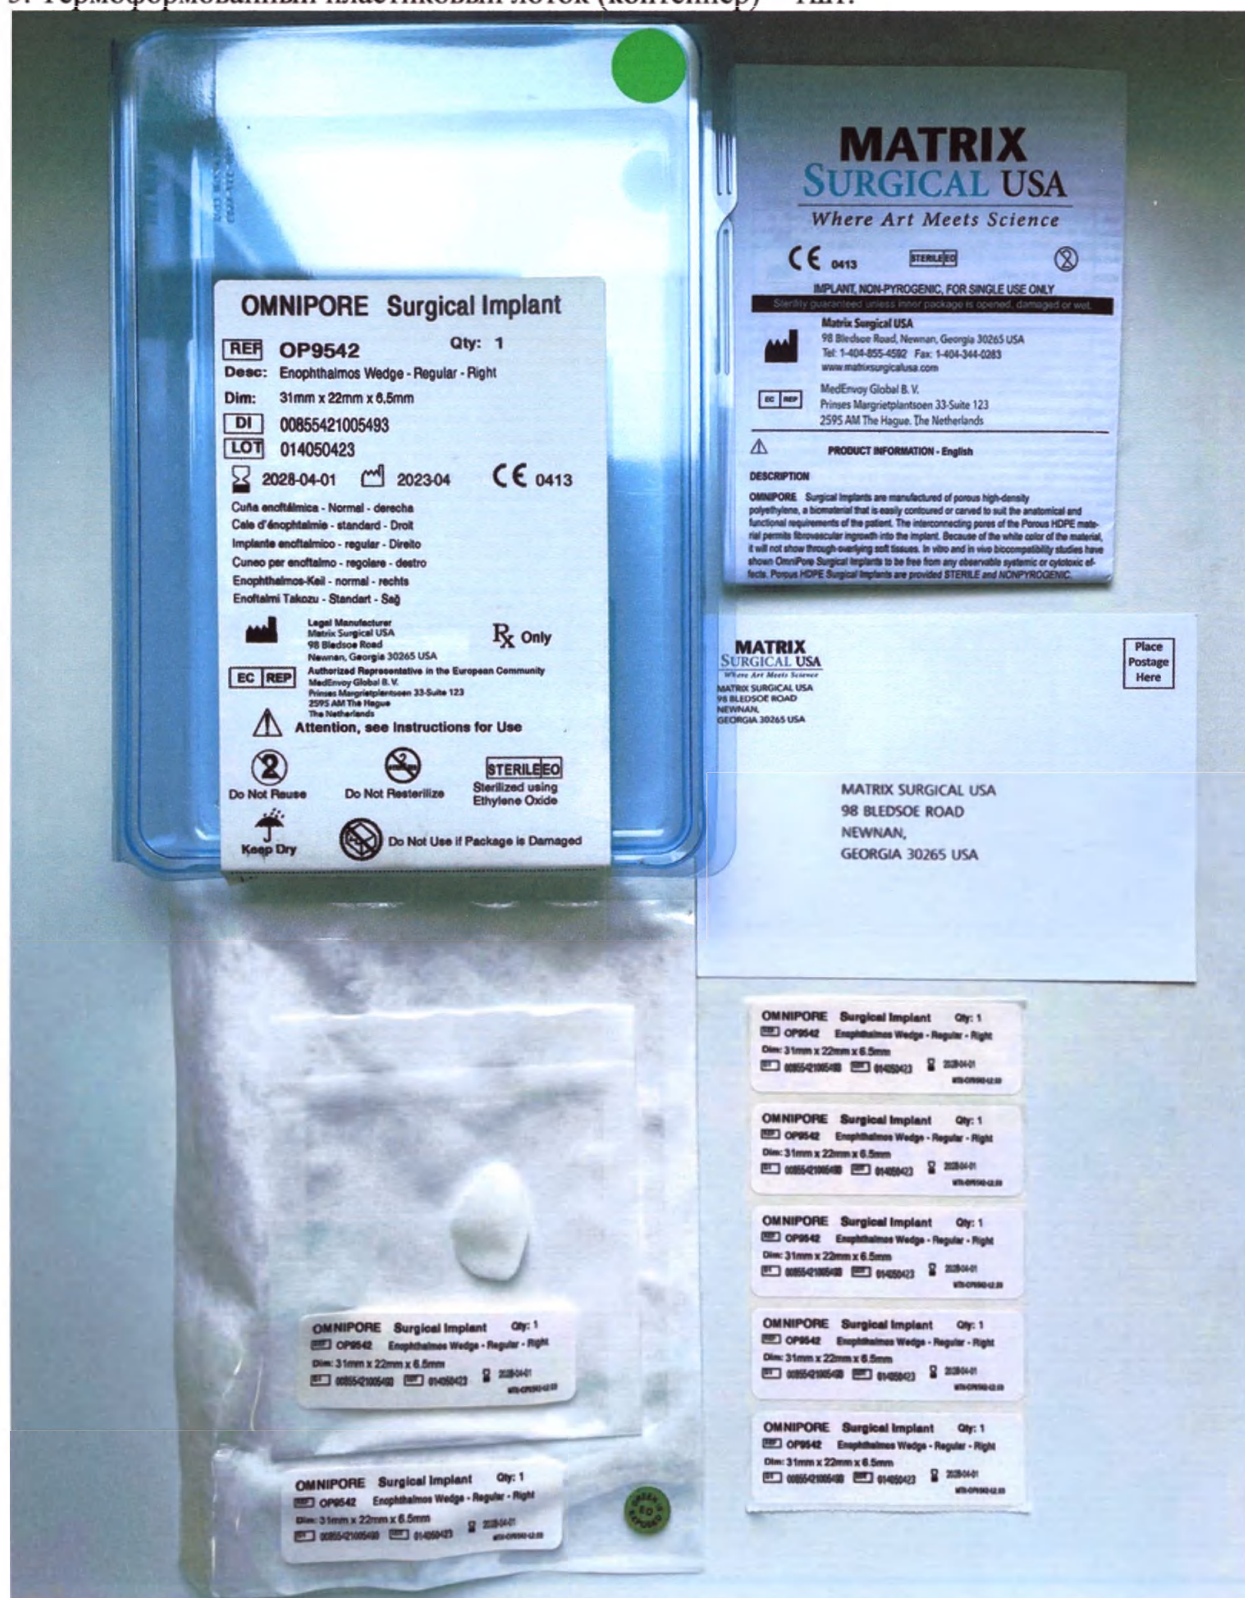



MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP9542

LOT



014050423

Qty



0001



(01)00855421005493(30)014050423(17)202804-01

MTX-OP9542-L1.04

Made in the USA

Имплантаты Ompiroge для черепно-лицевой хирургии, стерильные
Вариант исполнения: Клиновидные имплантаты для коррекции
энофтальма/Enophthalmos Wedge

Артикул: OP9542

Размер: Стандартный правый 31мм x 22мм x 6.5мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал
Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical
USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс
Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,
относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,
относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление
650-800 мм рт.ст


Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО
«КЛОВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,
эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные вариант исполнения: Скуловые имплантаты /Design Y Malar, в составе:

1. Скуловой имплантат /Design Y Malar, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevrton – 1 шт, вариант исполнения:
- OP9513 Малый правый 52мм x 26мм x 3мм.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1 шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1 шт.

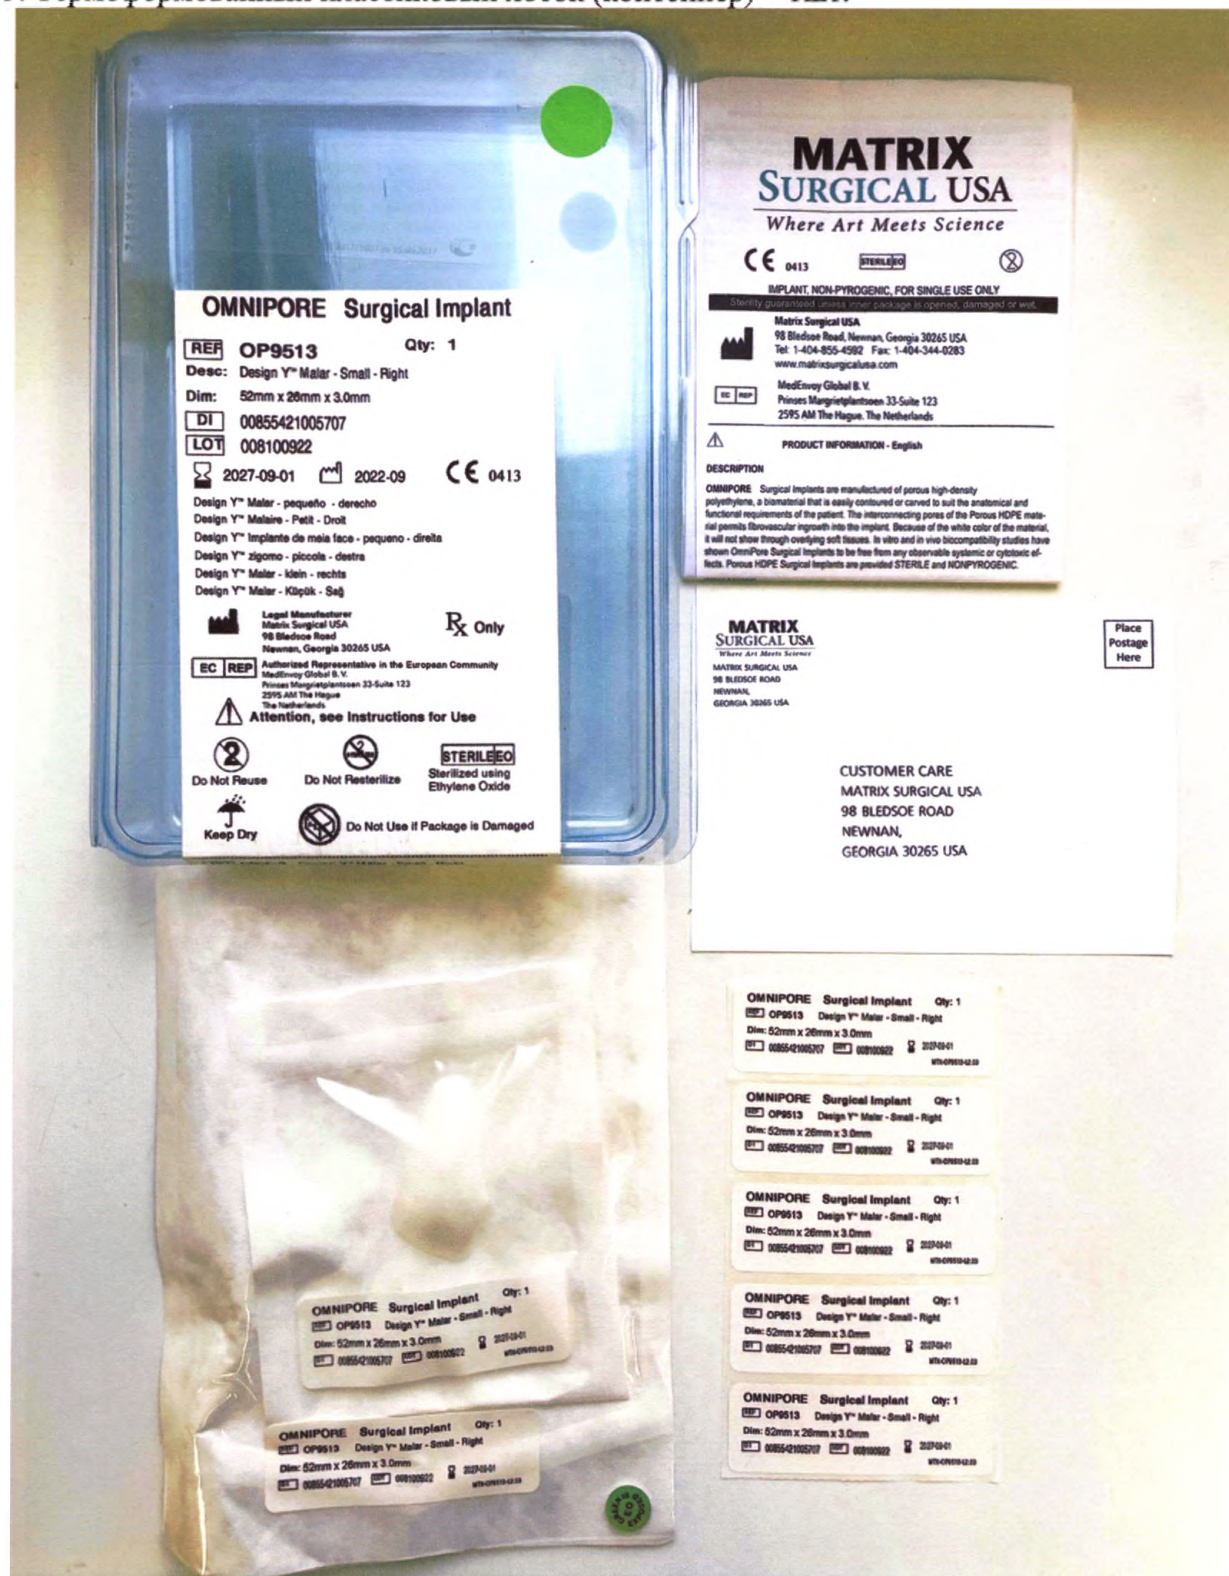



MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP9513

LOT



008100922

Qty



0001



(01)0085542100570770008100922(17)202709-01

MTX-OP9513-L1.05

Made in the USA

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Скуловые имплантаты /Design Y Malar

Артикул: OP9513

Размер: Малый правый 52мм x 26мм x 3мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). **Апирогенно. Не токсично.**

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО


«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,

эт. 5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Пластина для ринопластики/Nasal Sheet, в составе:

1. Пластина для ринопластики/Nasal Sheet OP9536 40мм x 9мм x 1.1мм, помещенная в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

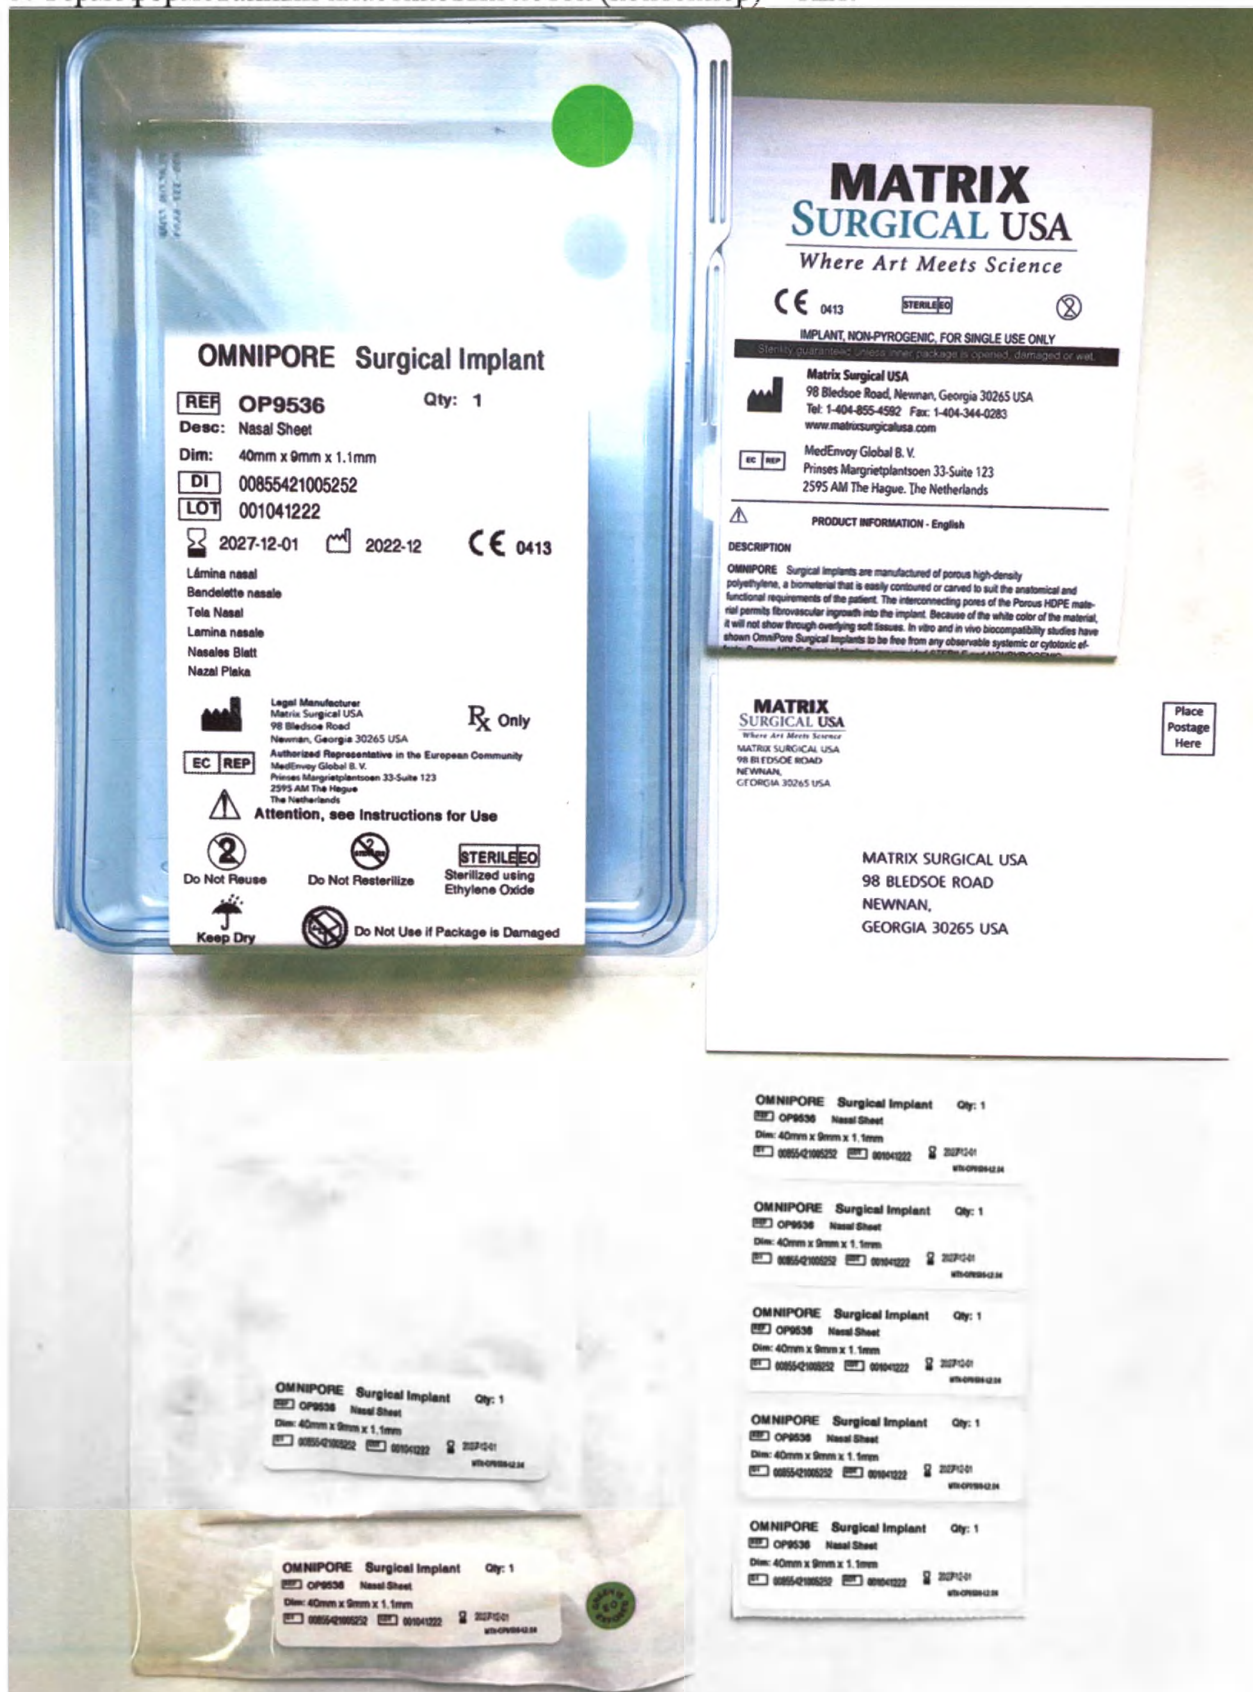



MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP9536

LOT



001041222

Qty



0001



(01)00855421005252(90)001041222(17)202712-01

MTX-OP9536-L1.06

Made in the USA

Имплантаты Ompipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Пластина для ринопластики/Nasal Sheet

Артикул: OP9536

Размер: 40мм x 9мм x 1.1мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление


650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр. 1, пом. 1,


эт. 5, ком. 1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

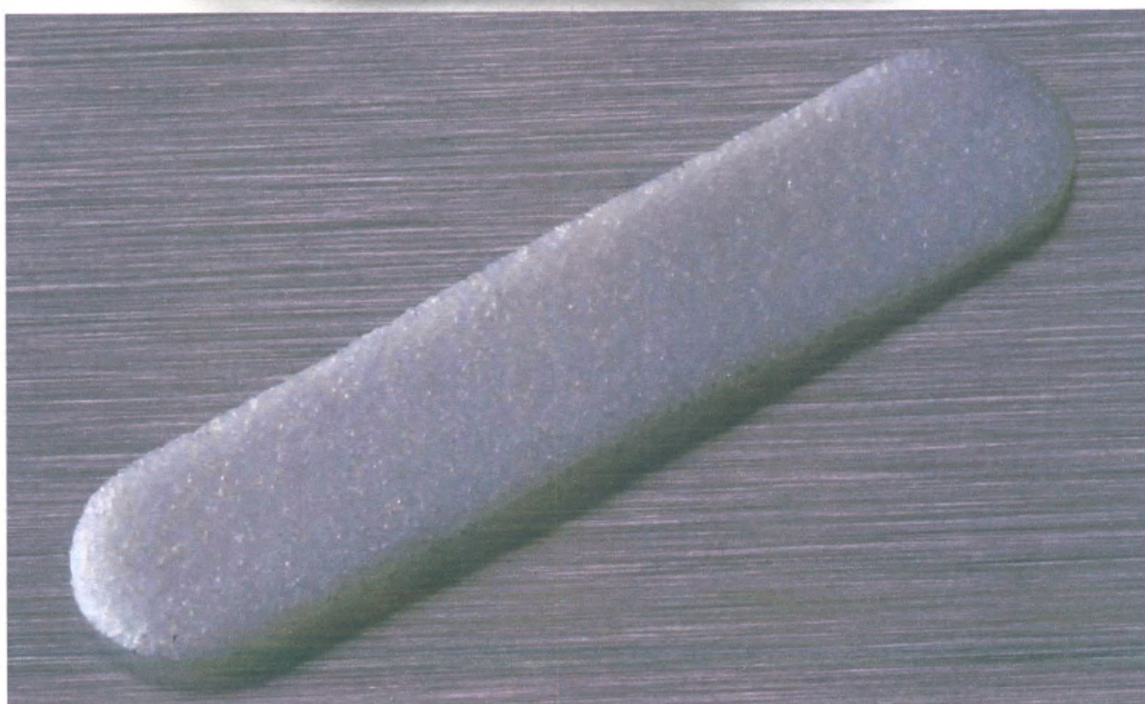

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Форма основания уха/Ear Base Shapes, в составе:

1. Форма основания уха/Ear Base Shapes, помещенная в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevon – 1 шт, вариант исполнения:
 - OP8330 Правая – 35мм x 53мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт

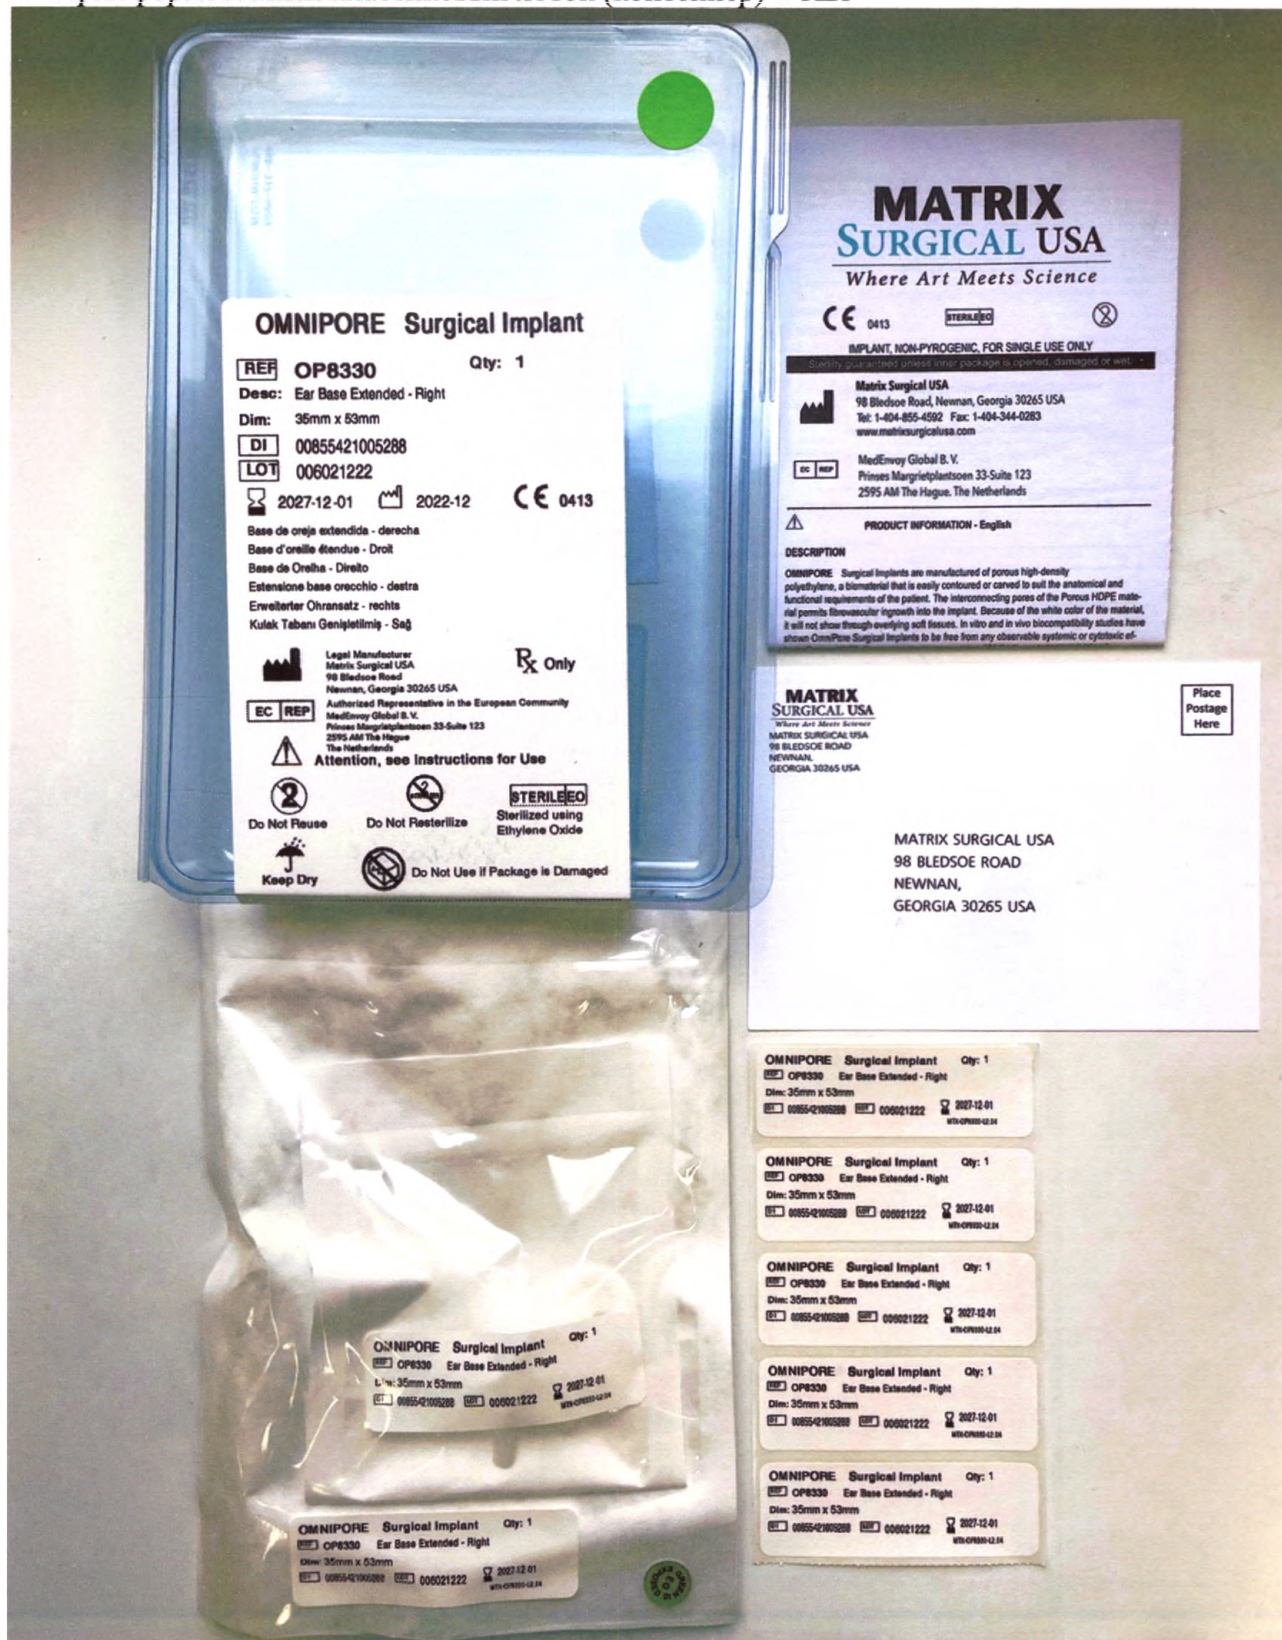

MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



"OP8330"

LOT



006021222

Qty



"0001"



(01)00855421005288(400)06021222(17)202712-01

MTX-OP8330-L1.06

Made in the USA

Имплантаты Ompipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Форма основания уха/Ear Base Shapes

Артикул: OP8330 Правая - 35мм x 53мм

Размер: Правая - 35мм x 53мм

Материал: полистирол высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал

Холдинг, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдинг, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛОВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр. 1, пом. I,


эт. 5, ком. I; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные вариант исполнения: Спиральный обод/Helical Rim, в составе:

- 1 Спиральный обод/Helical Rim, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт, вариант исполнения:
- OP8328 Правый - 50 мм x 61мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

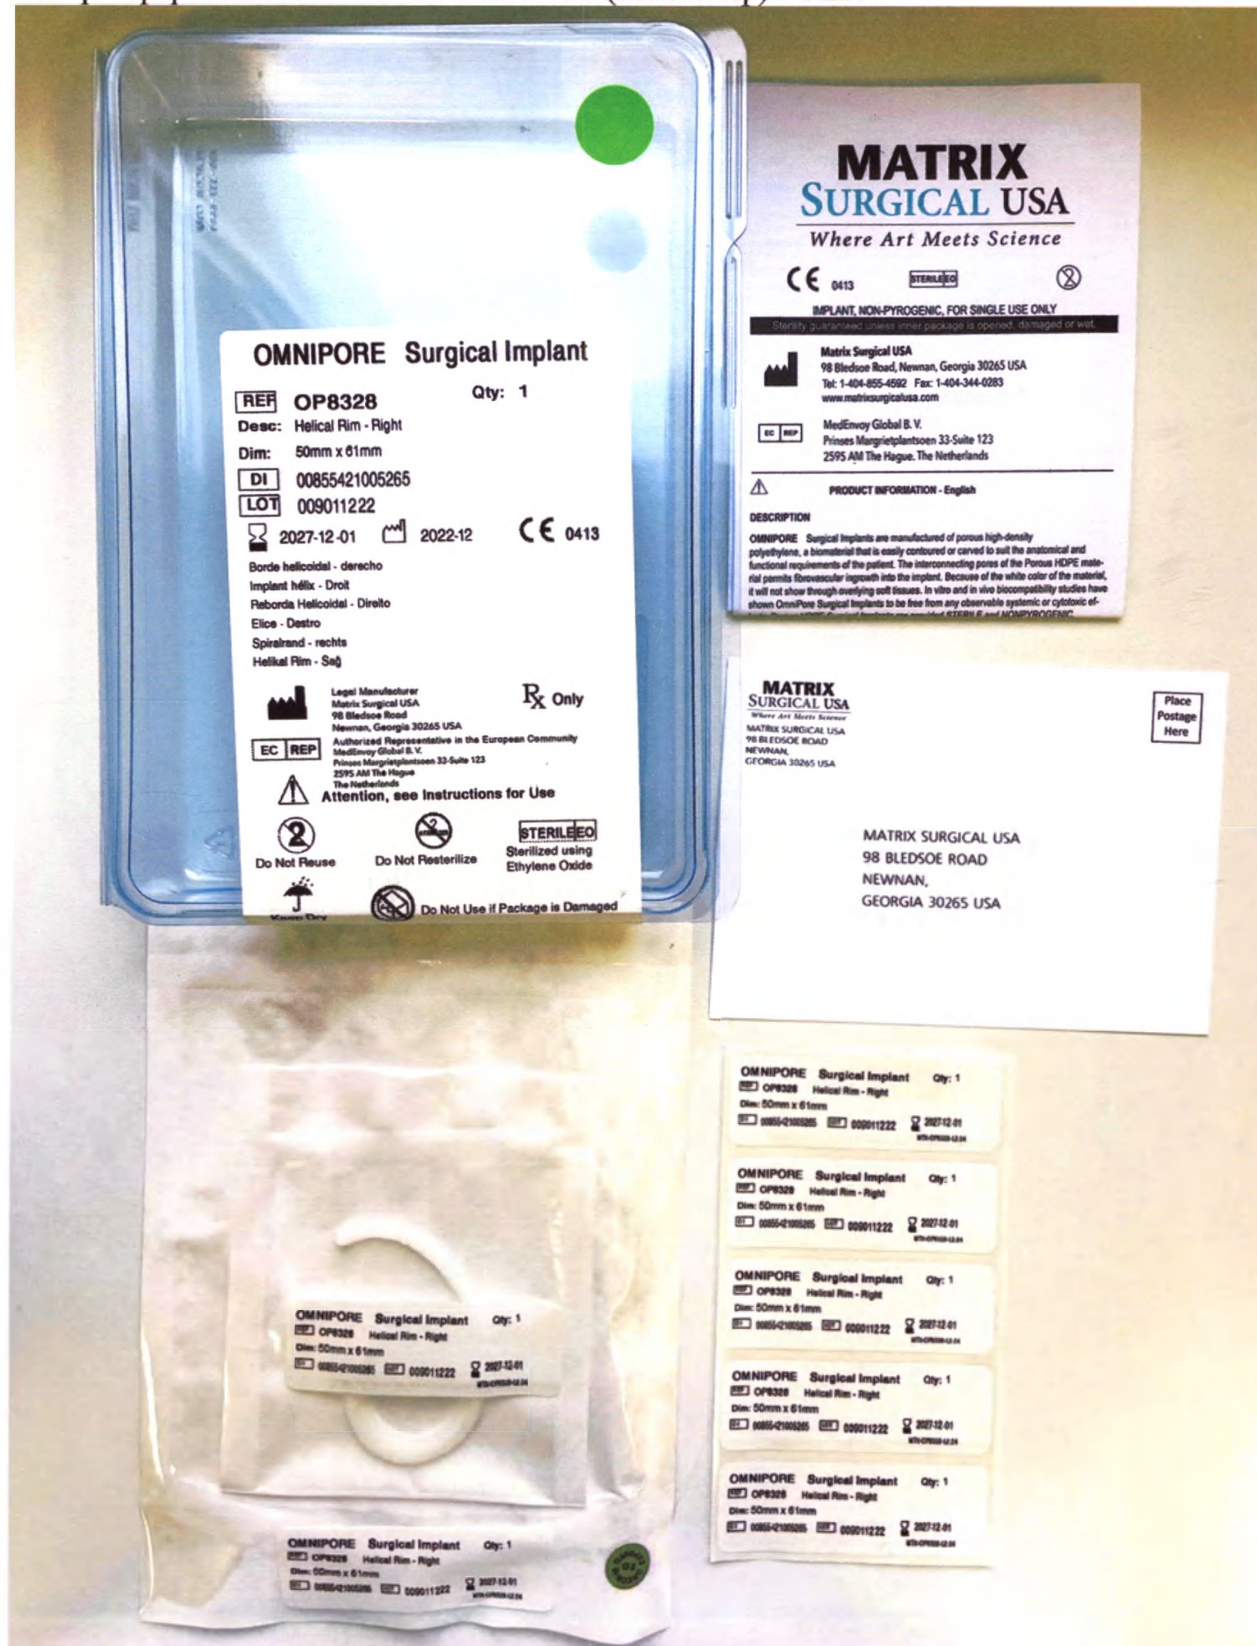



MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF

LOT

Qty



OP8328



009011222



0001



(01)00855421005265(00)0090112225(17)202712-01

MTX-OP8328-L1.07

Made in the USA

Имплантаты Otiptore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Спиральный обод/Helical Rim

Артикул: OP8328

Размер: Правый - 50 мм х 61 мм

Материал: полистилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал

Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛОВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр 1, пом.1,

эт. 5, ком. 1; Тел: 7 (495) 787-17-72, www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

вариант исполнения: БЛОК/Block, в составе:

1. БЛОК/Block, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт, вариант исполнения:
- OP6339 38мм x 63мм x 6мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт



MATRIX SURGICAL USA


Where Art Meets Science

REF



OP6339

LOT




004081122

Qty



0001



(01)00855421005345(90)004081122(17)202711-01

MTX-OP6339-L1.02

Made in the USA

Имплантаты Отпирог для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: БЛОК/Block

Артикул: OP6339

Размер: 38мм x 63мм x 6мм

Материал: полистилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал

Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106

кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО


«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,

эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Имплантаты для пластики угла нижней челюсти/ Design Y Mandible
Onlay, в составе:

1. Имплантат для пластики угла нижней челюсти/ Design Y Mandible Onlay, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1шт, вариант исполнения:
- OP7541 Малый левый 57мм x 39мм x 5мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт

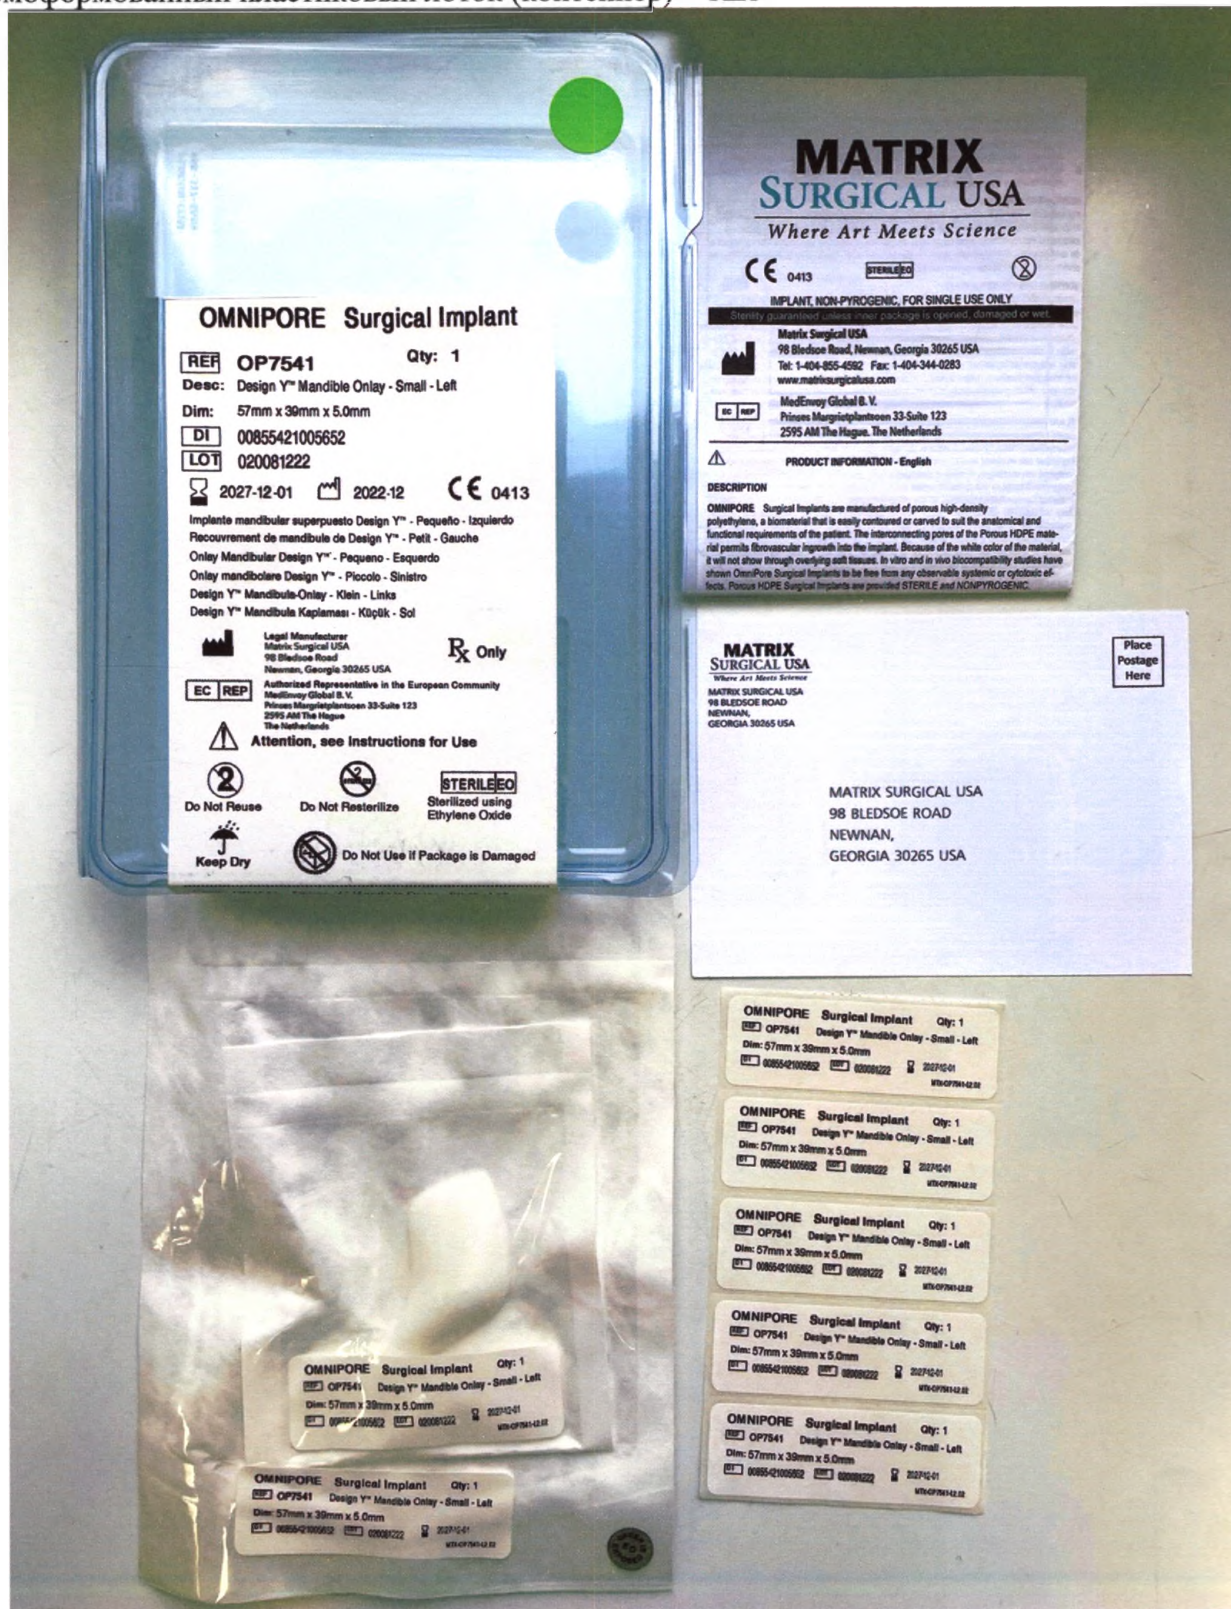

MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP7541

LOT



020081222

Qty



0001



(01)00855421005652(20)02(00)81222(17)202712-01

MTX-OP7541-L1.02

Made in the USA

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
Вариант исполнения: Имплантаты для пластики угла нижней челюсти/
Design Y Mandible Onlay

Артикул: OP7541

Размер: Малый левый 57мм x 39мм x 5мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru


Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

вариант исполнения: Увеличенные имплантаты для пластики подбородка/Design Y Chin, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт, вариант исполнения:

1. Увеличенный имплантат для пластики подбородка/Design Y Chin, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт, вариант исполнения:
- OP8314 Средний с круглой проекцией 37 мм x 32мм x 6мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

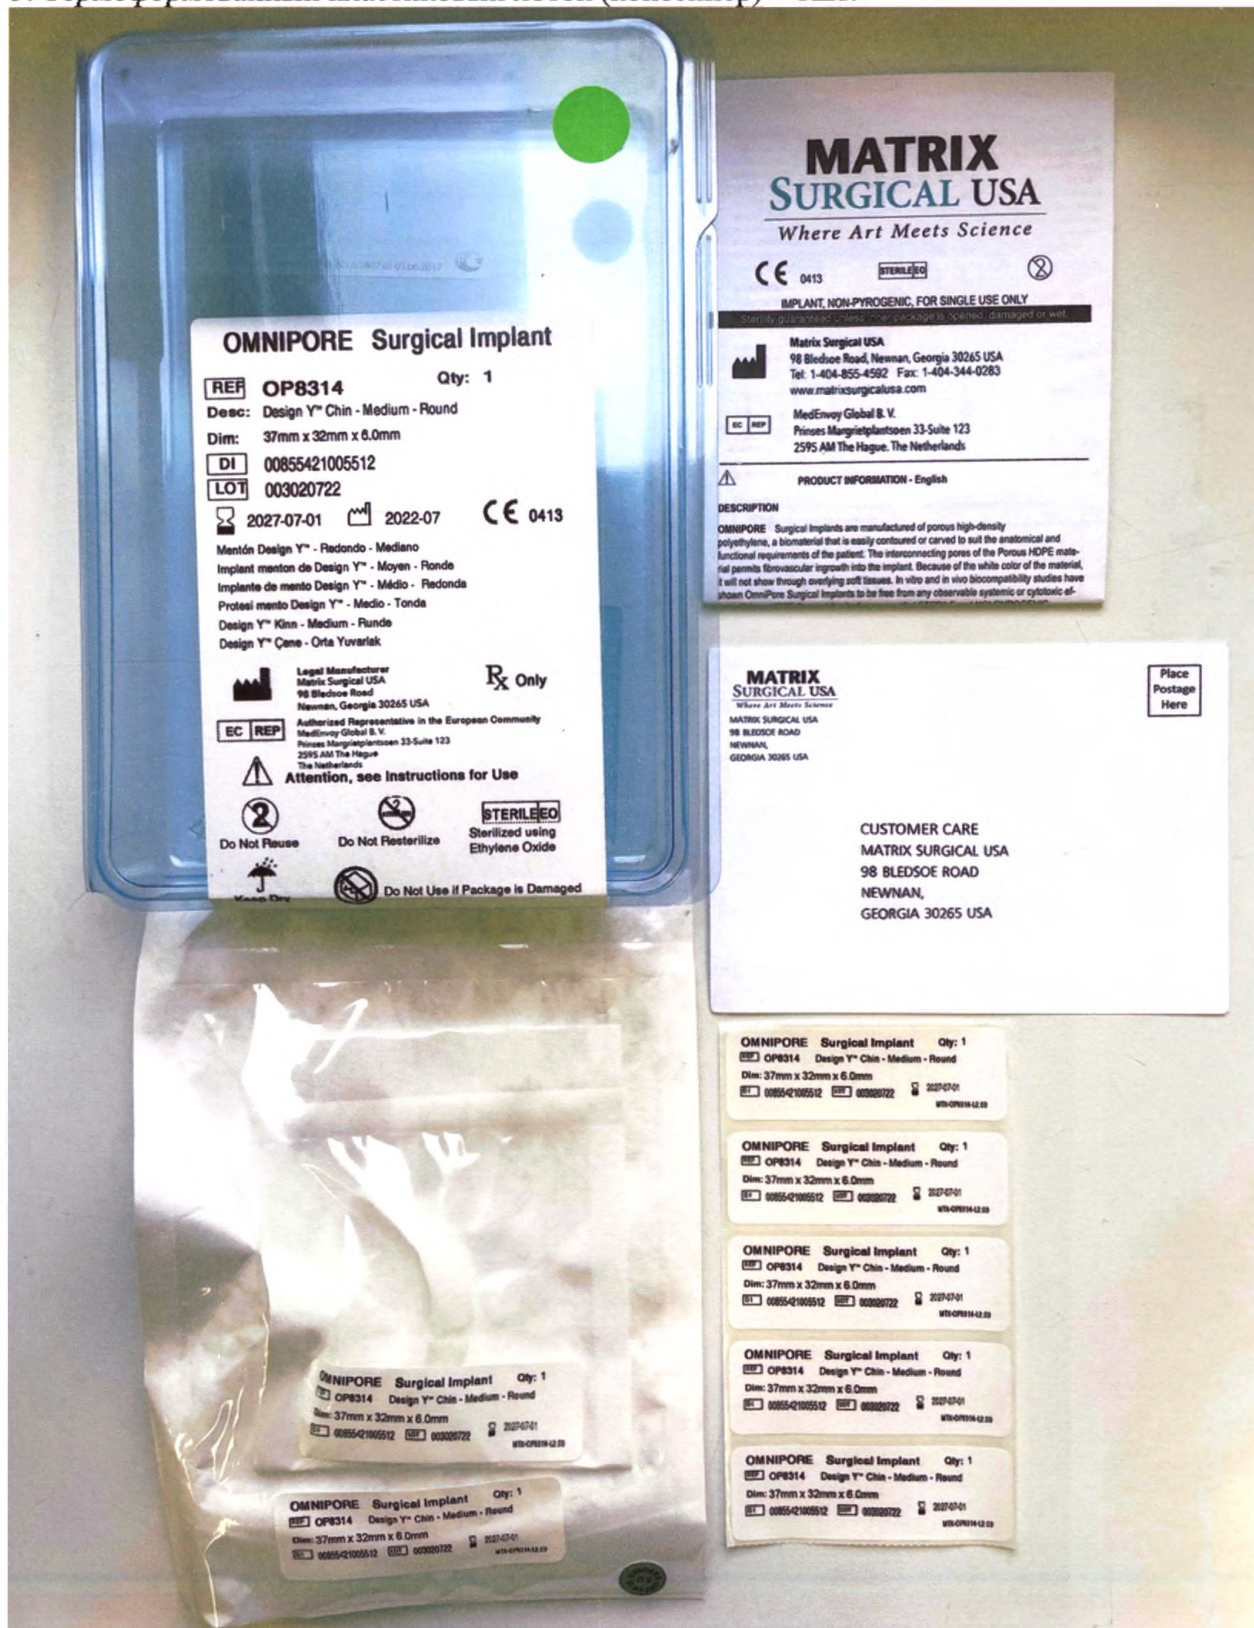



MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP8314

LOT



003020722

Qty



0001



(01)00855421005512(20)00(30)20722(17)202707-01

MTX-OP8314-L1.06

Made in the USA

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Увеличенные имплантаты для пластики

подбородка/Design Y Chin

Артикул: OP8314

Размер: Средний с круглой просечкой 37 мм x 32 мм x 6 мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал

Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106

кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛОВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,


эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72, www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



**Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Пластины с гладкой поверхностью/3S Sheets, в составе:**

1. Пластина с гладкой поверхностью/3S Sheet, помещенная в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1шт, вариант исполнения:
- OP9312 38мм x 50мм x 1.7мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

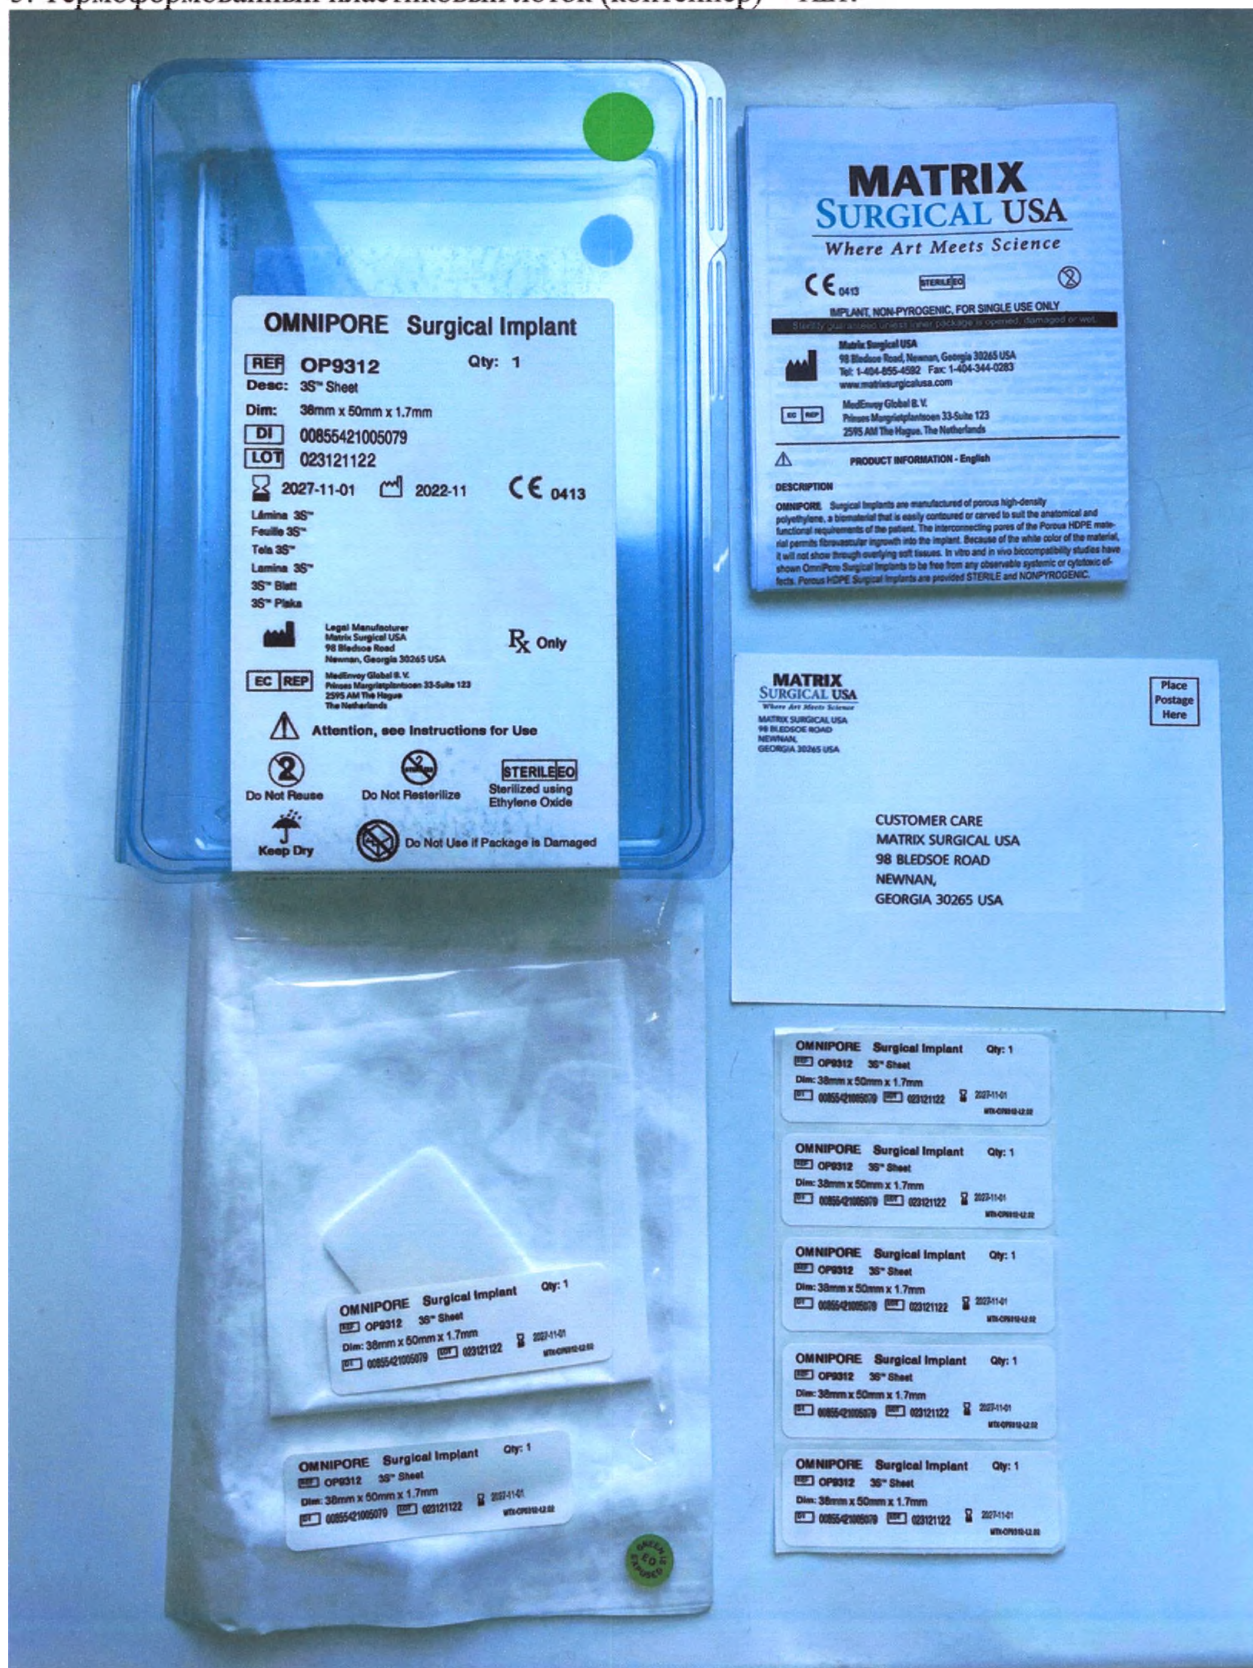

MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF

LOT

Qty



OP9312



023121122



0001



(01)00855421005079(90)023121122(17)202711-01

MTX-OP9312-L1.02

Made in the USA

Имплантаты Ompiroge для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Пластины с гладкой поверхностью/3S Sheets

Артикул: OP9312

Размер: 38мм x 50мм x 1.7мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, ЛЛС, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,

эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

вариант исполнения: Имплантат краниальный/Bendblock Cranial Grid implant, в составе:

15.1. Имплантат краниальный/Bendblock Cranial Grid implant OP9524 110мм x 97.5мм x 5.25мм, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт.

15.2. Инструкция по применению – 1шт.

15.3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.

15.4. Идентификационная карта пациента – 1шт.

OMNIPORE Surgical Implant

REF OP9524 Qty: 1

Desc: BENDBLOCK™ Cranial Grid Implant

Dim: 110mm x 97.5mm x 5.25mm

DI 00855421008750

LOT 012020922

2027-09-01 2022-09 CE 0413

Pajilla craneal BENDBLOCK™
Grille crânienne BENDBLOCK™
Grille crânienne BENDBLOCK™
Griglia cranica BENDBLOCK™
BENDBLOCK™ kraniales Gitter
BENDBLOCK™ Kranial Kafes Implant

Legal Manufacturer
Matrix Surgical USA
98 Bledsoe Road
Newnan, Georgia 30265 USA
MedEnergy Global B.V.
Prinses Margrietlaan 33-Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Rx Only

EC REP



Attention, see instructions for use



Do Not Reuse



Do Not Sterilize

STERILE

Sterilized using
Ethylene Oxide



Keep Dry



Do Not Use if Package is Damaged

MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

CE 0413

IMPLANT, NON-PYROGENIC, FOR SINGLE USE ONLY

Matrix Surgical USA

98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia 30265 USA

Tel: 1-404-855-4562 Fax: 1-404-344-0263

www.matrixsurgicalusa.com

MedEnergy Global B.V.

Prinses Margrietlaan 33-Suite 123

2595 AM The Hague, The Netherlands

PRODUCT INFORMATION - English

Surgical implants are manufactured of porous high-density

polyethylene that is easily contoured or carved to suit the anatomical and

requirements of the patient. The interconnecting pores of the porous HDPE en-

able to support biological tissue growth. Because of the white color of the material,

it is difficult to distinguish soft tissue. In vivo and in vitro biocompatibility studies have

shown that Matrix Surgical implants are free from any observable systemic or systemic ef-

fects. Matrix Surgical implants are provided STERILE and NON-PYROGENIC.

MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

Matrix Surgical USA

98 Bledsoe Road

Newnan,

Georgia 30265 USA

CUSTOMER CARE
MATRIX SURGICAL USA
98 BLEDSOE ROAD
NEWNAN,
GEORGIA 30265 USA

Place
Postage
Here

OMNIPORE Surgical Implant Qty: 1
REF OP9524 BENDBLOCK™ Cranial Grid Implant
Dim: 110mm x 97.5mm x 5.25mm
DI 00855421008750 LOT 012020922

OMNIPORE Surgical Implant Qty: 1
REF OP9524 BENDBLOCK™ Cranial Grid Implant
Dim: 110mm x 97.5mm x 5.25mm
DI 00855421008750 LOT 012020922


OMNIPORE Surgical Implant Qty: 1
REF OP9524 BENDBLOCK™ Cranial Grid Implant
Dim: 110mm x 97.5mm x 5.25mm
DI 00855421008750 LOT 012020922

OMNIPORE Surgical Implant Qty: 1
REF OP9524 BENDBLOCK™ Cranial Grid Implant
Dim: 110mm x 97.5mm x 5.25mm
DI 00855421008750 LOT 012020922

OMNIPORE Surgical Implant Qty: 1
REF OP9524 BENDBLOCK™ Cranial Grid Implant
Dim: 110mm x 97.5mm x 5.25mm
DI 00855421008750 LOT 012020922


OMNIPORE Surgical Implant Qty: 1
REF OP9524 BENDBLOCK™ Cranial Grid Implant
Dim: 110mm x 97.5mm x 5.25mm
DI 00855421008750 LOT 012020922

OMNIPORE Surgical Implant Qty: 1
REF OP9524 BENDBLOCK™ Cranial Grid Implant
Dim: 110mm x 97.5mm x 5.25mm
DI 00855421008750 LOT 012020922

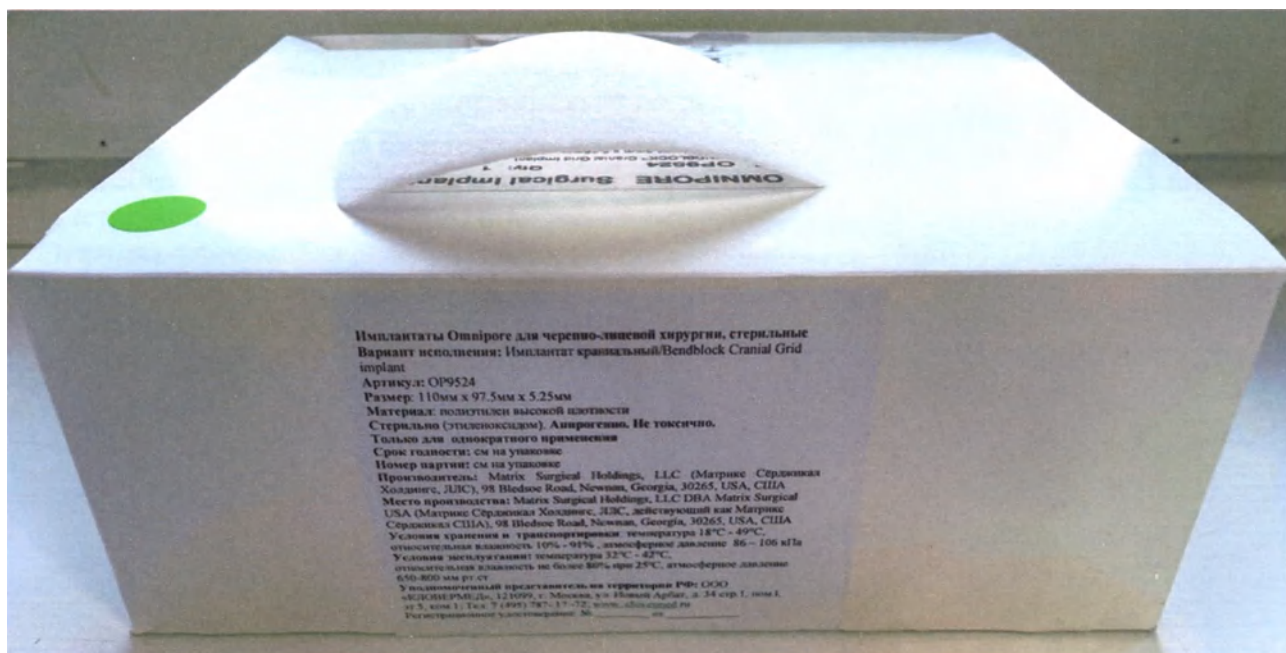

**Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Пластина канальная для пластики дна и стенок
глазницы/Channel Sheet Implant, в составе:**

1. Пластина канальная для пластики дна и стенок глазницы/Channel Sheet Implant OP9530 50мм x 50мм x 2мм, помещенная в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

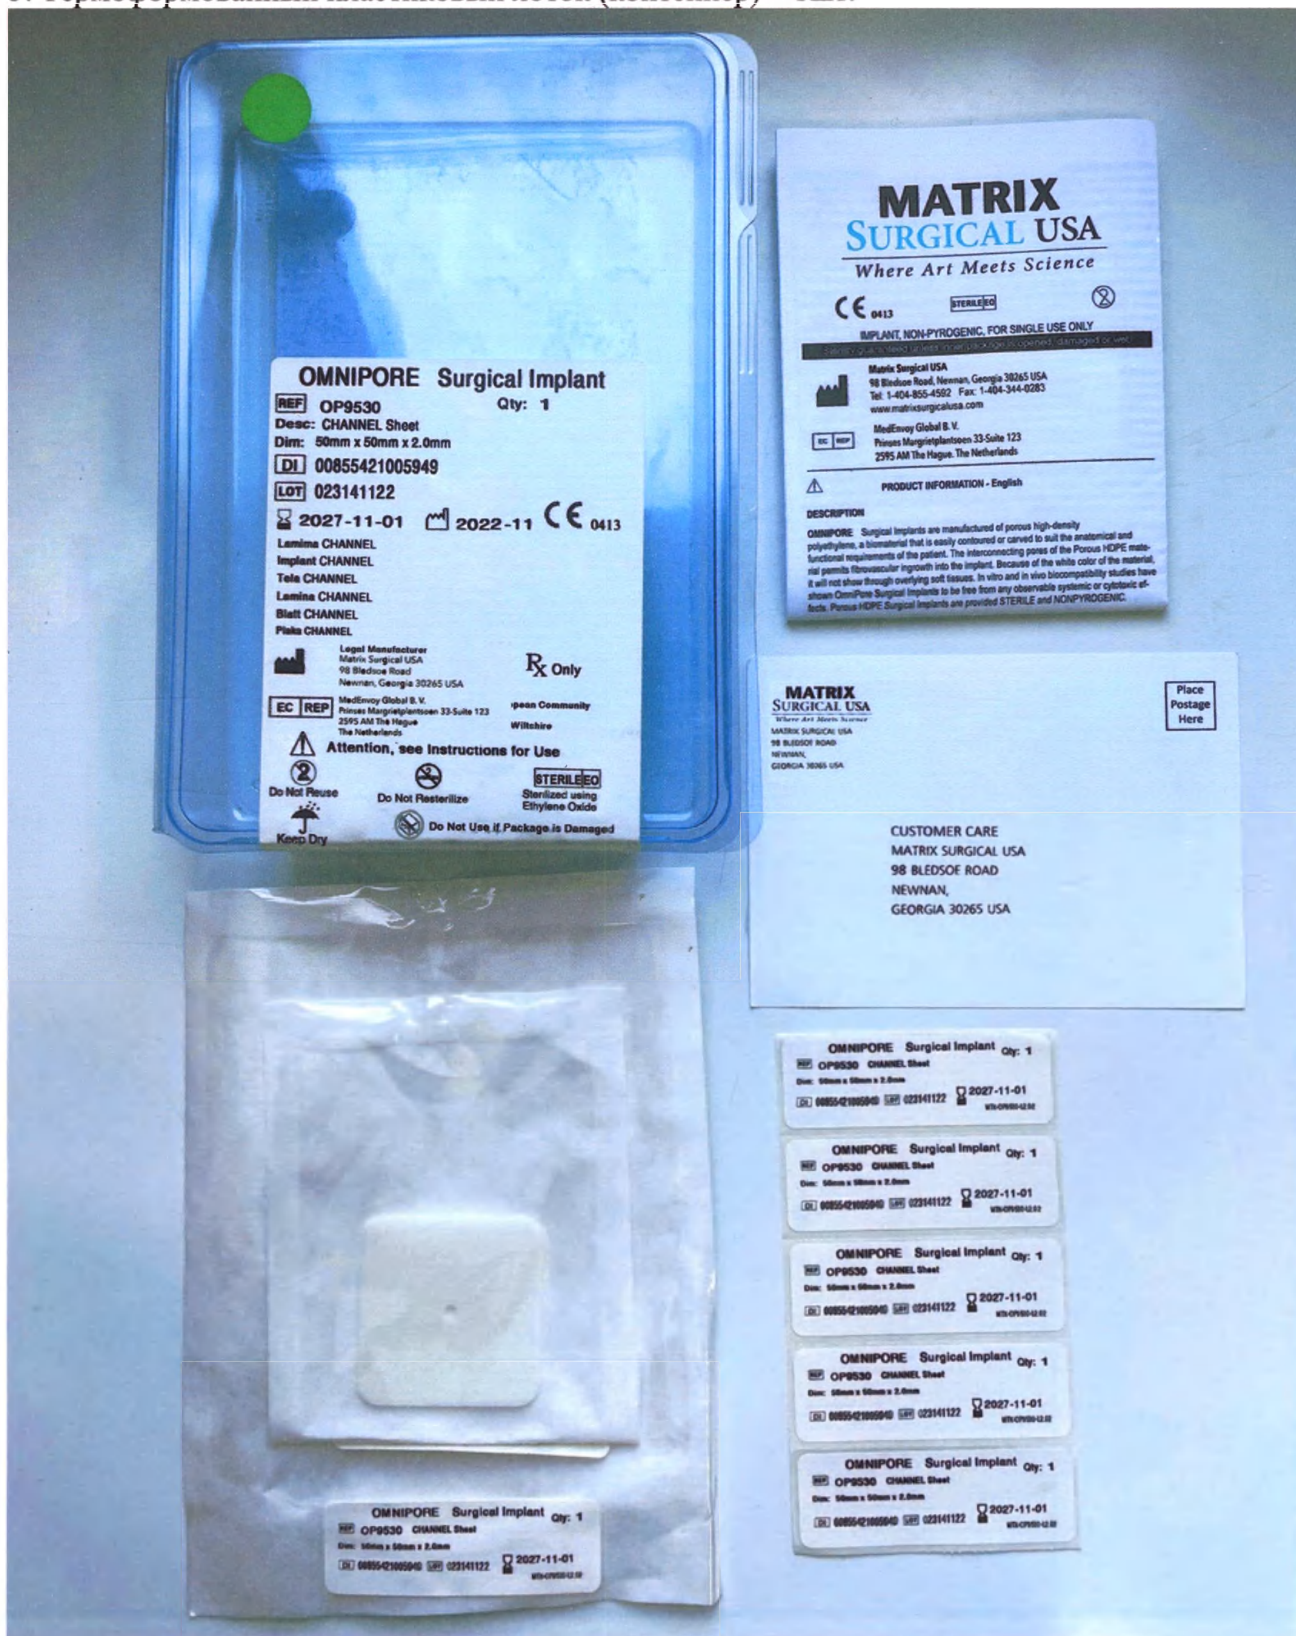

MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF

LOT

Qty



OP9530



023141122



0001



(01)00855421005949(90)023141122(17)202711-01

MTX-OP9530-L1.02

Made in the USA

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные

Вариант исполнения: Пластина канальная для пластики дна и стенок
глазницы/Channel Sheet Implant

Артикул: OP9530

Размер: 50мм x 50мм x 2мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал

Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, ЛЛС, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106

кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление


650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр. 1, пом. 1,


эт. 5, ком. 1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovemed.ru


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

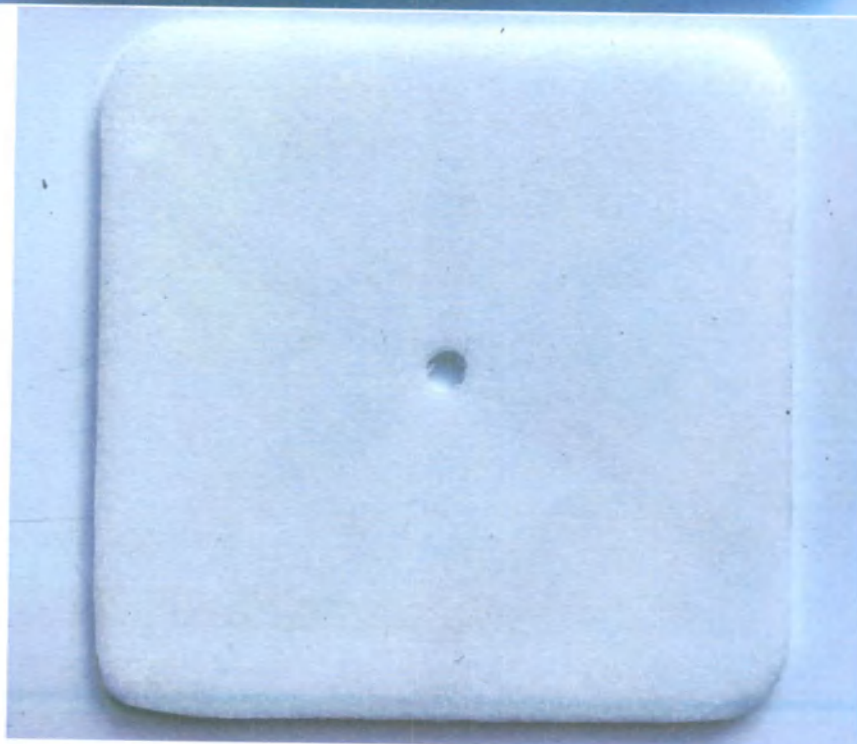

**Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Имплантаты краниальные гемисферические/Cranial Hemisphere, в составе:**


1. Имплантат краниальный гемисферический/Cranial Hemisphere, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1 шт, вариант исполнения:
- OP82001 Левый 174мм x 133мм x 5мм.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.

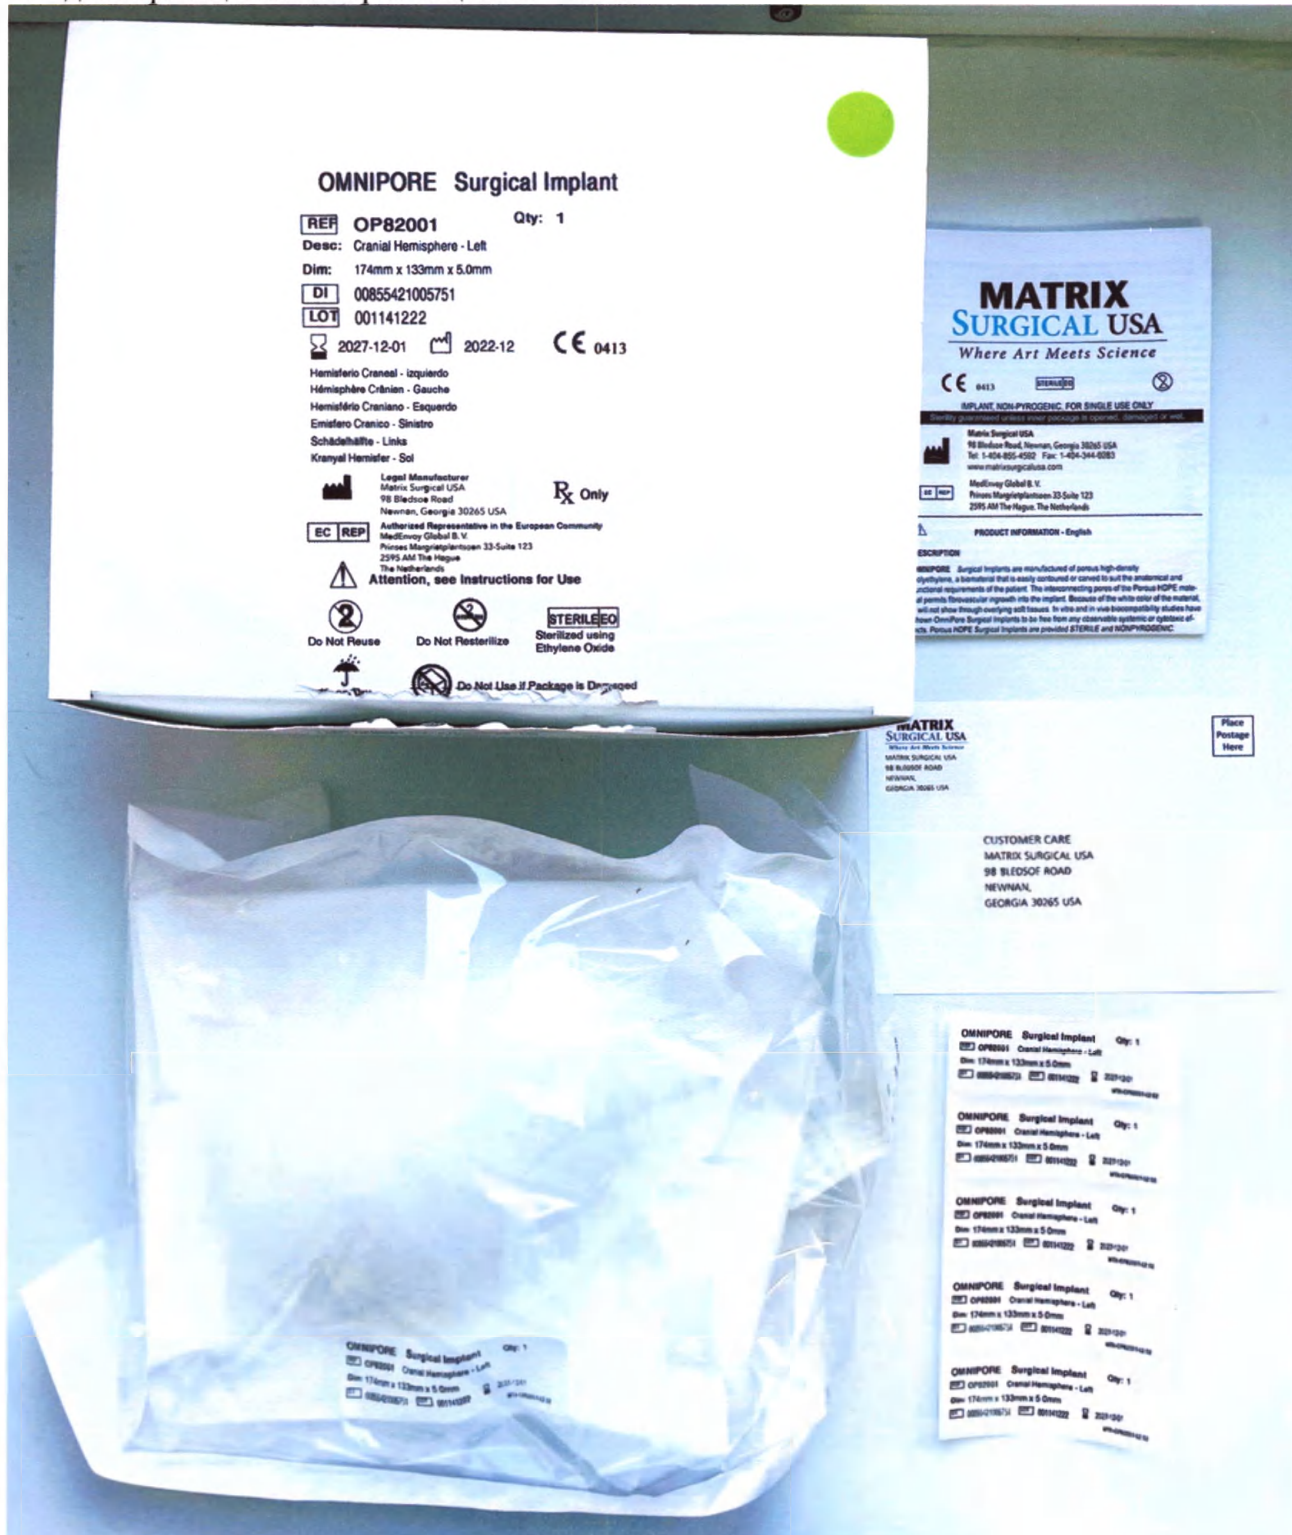

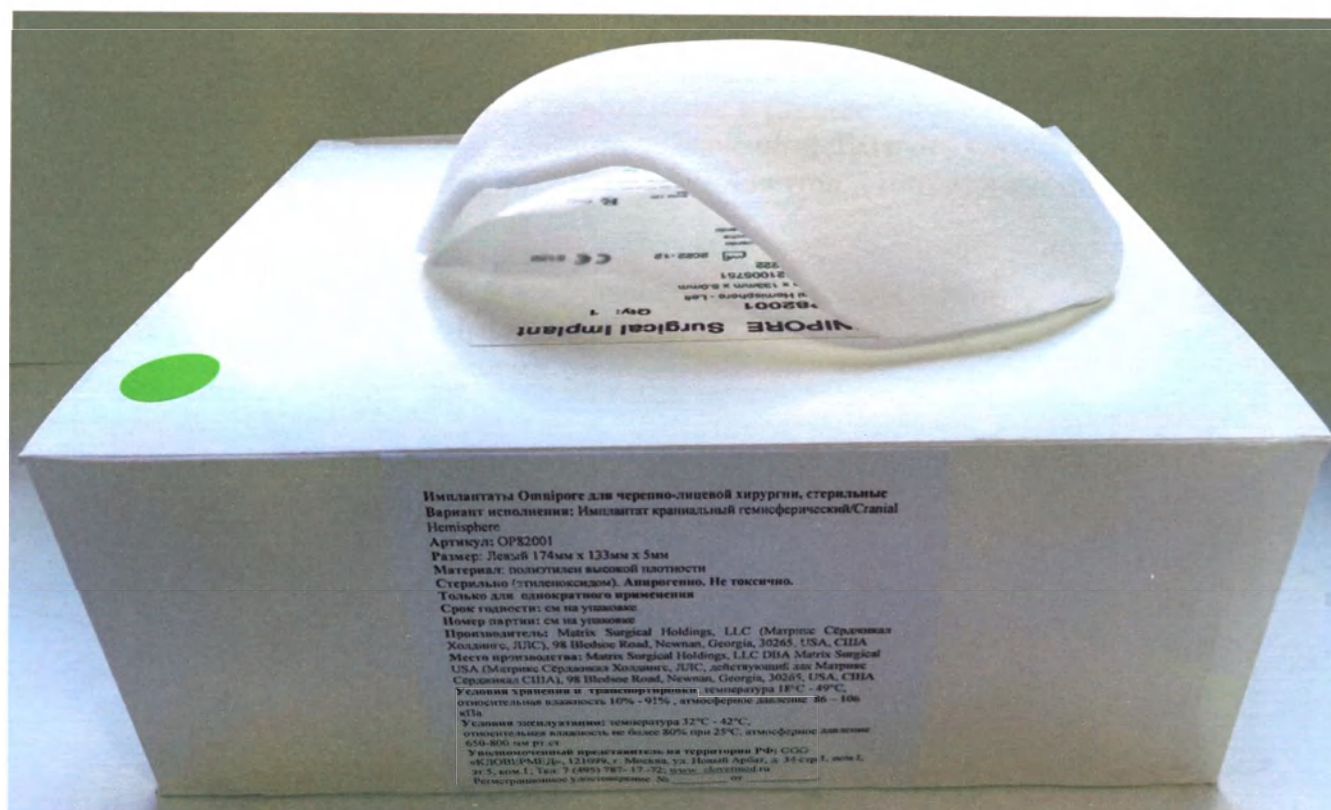

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Имплантаты для пластики края глазницы увеличенные
/Extended Orbital Rims, в составе:

- 17.1. Имплантат для пластики края глазницы увеличенный /Extended Orbital Rim, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevrone – 1шт, вариант исполнения: - OP9540 Правый 53мм x 31мм.
- 17.2. Инструкция по применению – 1шт.
- 17.3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
- 17.4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
- 17.5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

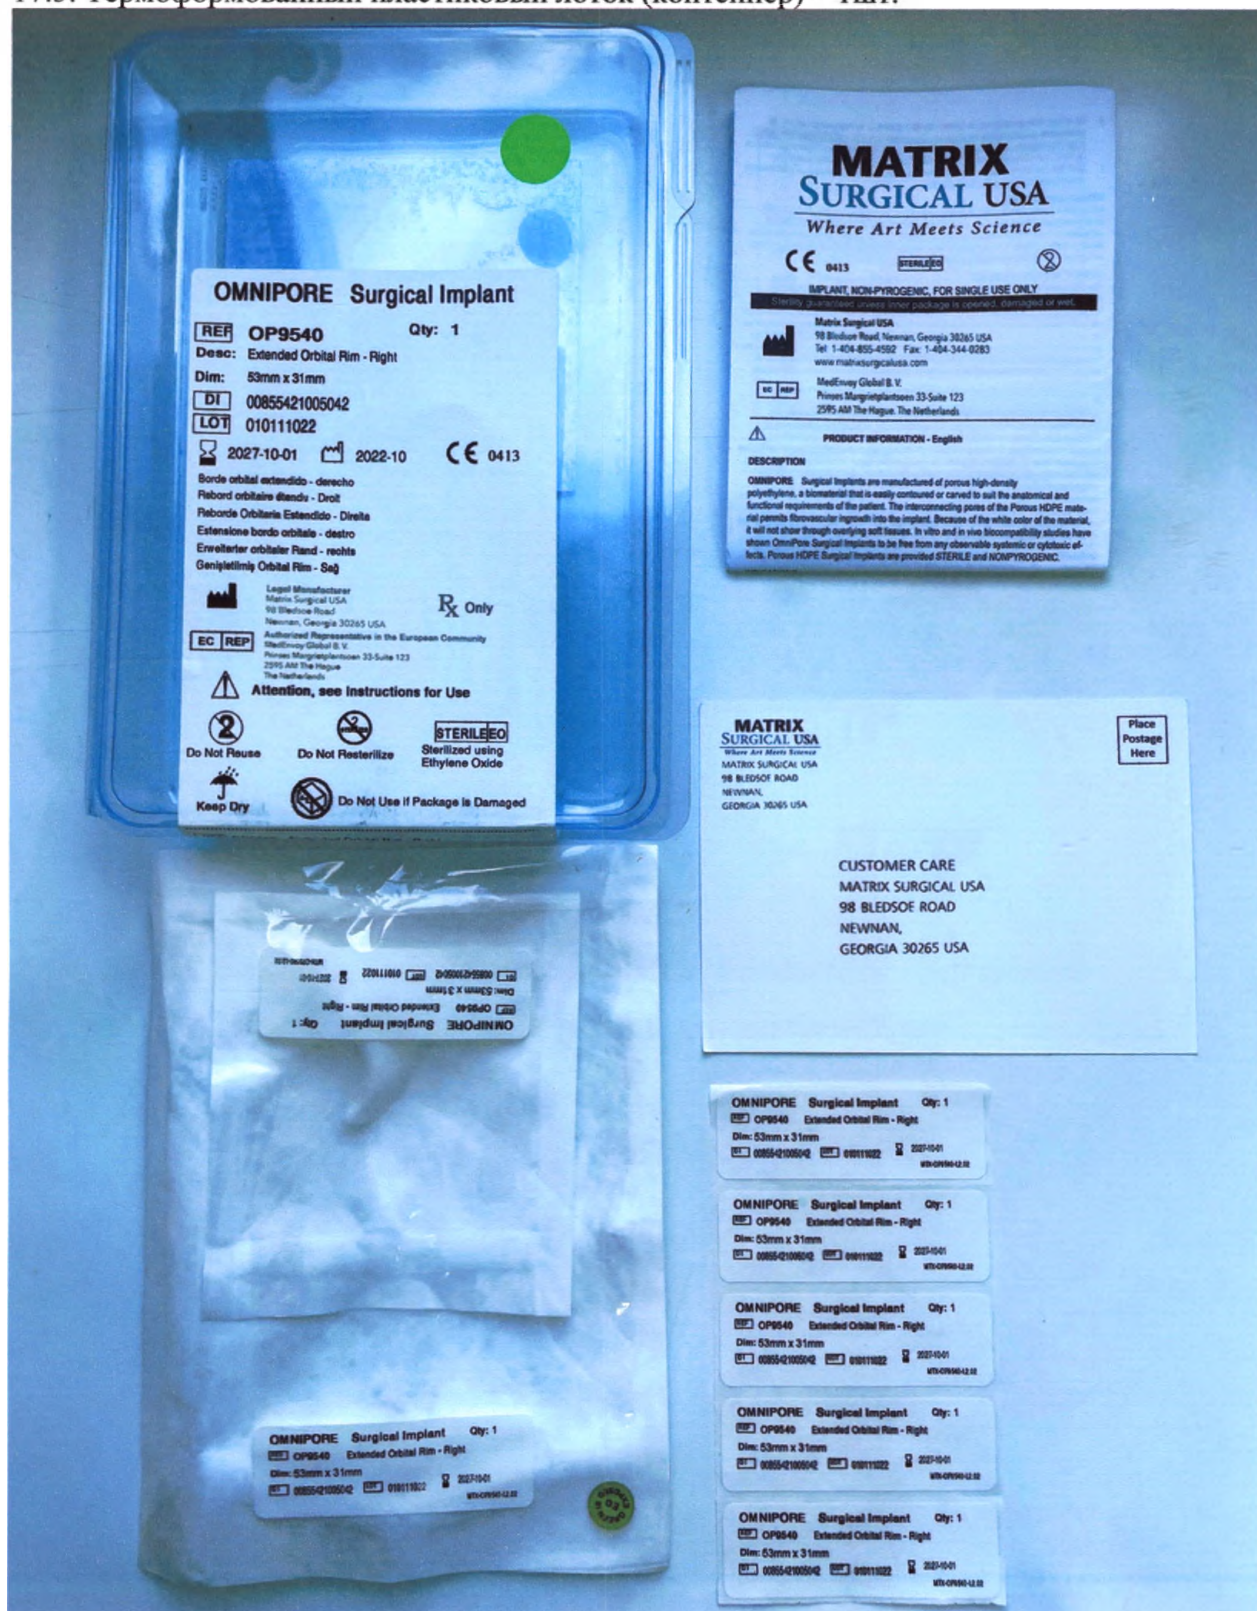

MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP9540

LOT



010111022

Qty



0001



(01)00855421005042(30)010111022(17)202710-01

MTX-OP9540-L1.02

Made in the USA

Имплантаты Ompirog для черепно-лицевой хирургии, стерильные
Вариант исполнения: Имплантаты для пластики края глазницы
увеличенные /Extended Orbital Rims

Артикул: OP9540

Размер: Правый 53мм x 31мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал
Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical
USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛОВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,


эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Имплантаты для пластики дна турецкого седла/Sellar Buttress
Implants (SBI), в составе:

1. Имплантат для пластики дна турецкого седла/Sellar Buttress Implant (SBI) , помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 1шт, вариант исполнения:
- OP82008 Большой 40мм x 40мм x 2.7мм x 0.7мм.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.

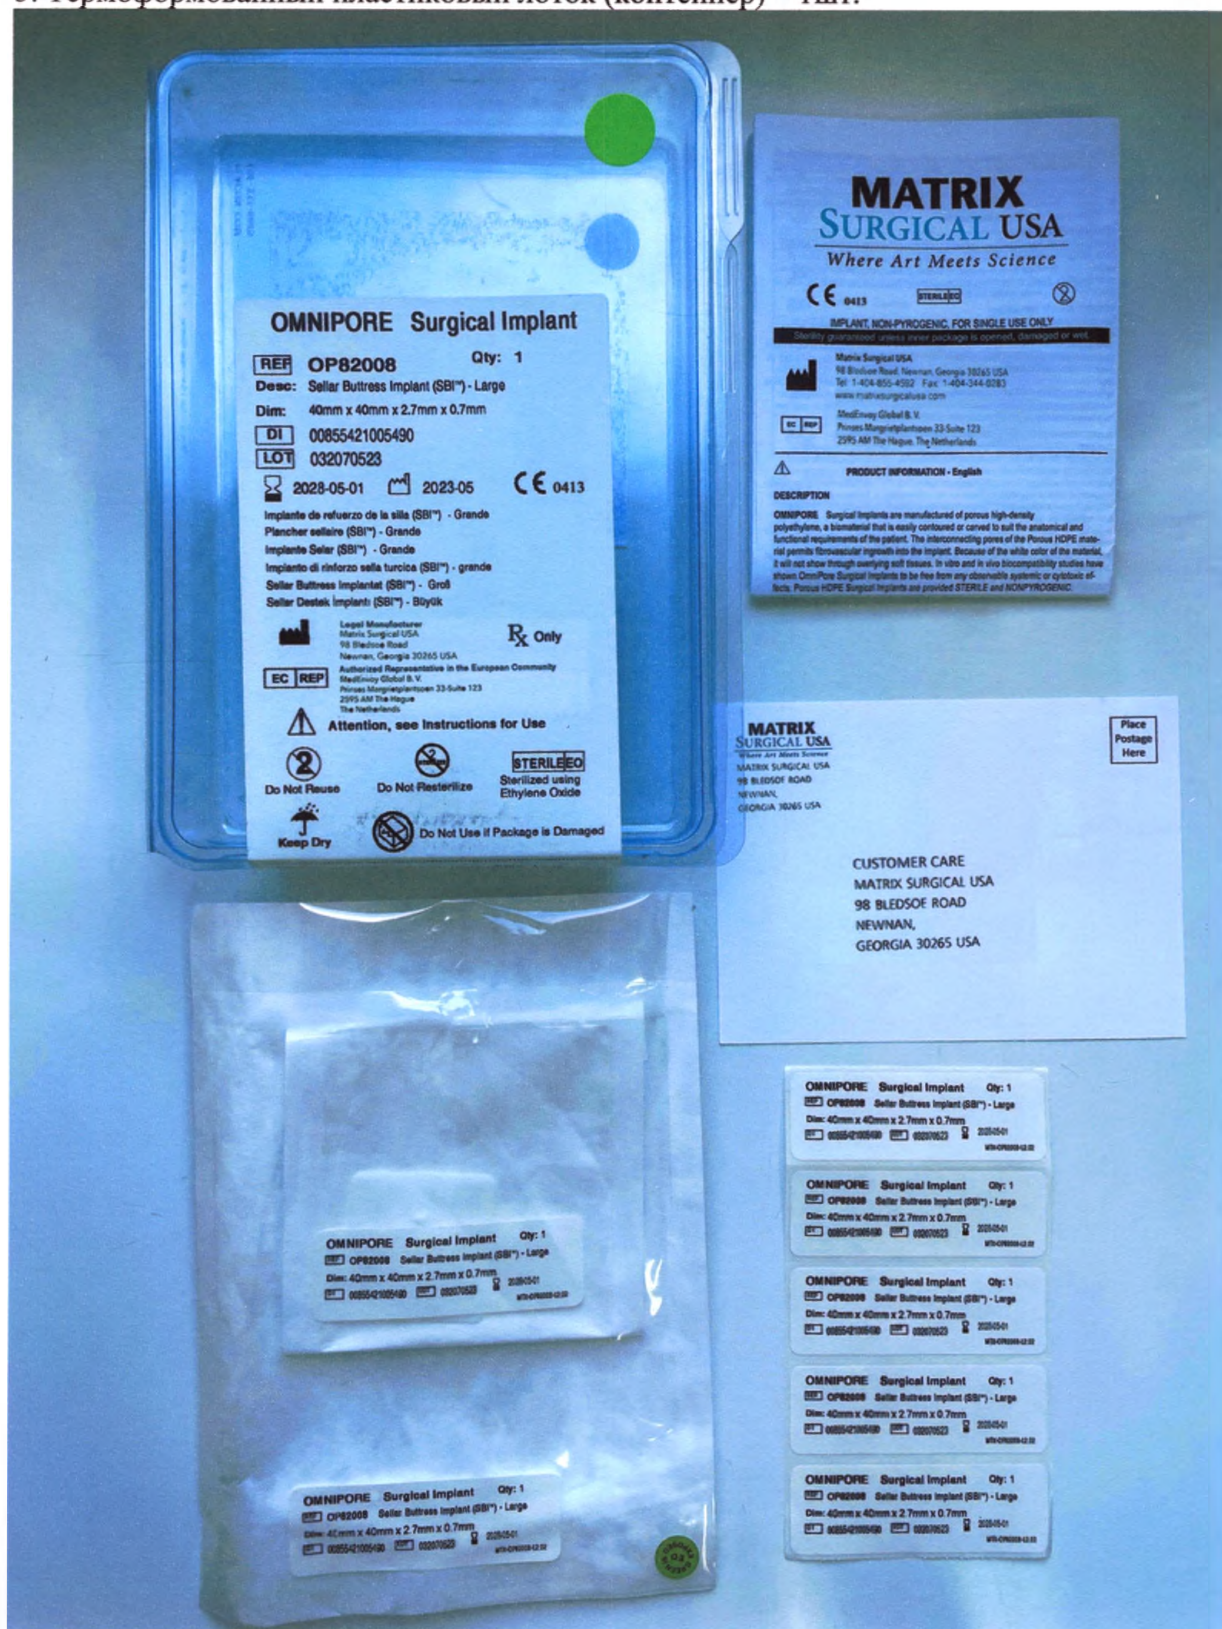

MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF

LOT

Qty



OP82008



032070523



0001



(01)00855421005390(00)0320705237(17)202805-01

MTX-OP82008-L1.02

Made in the USA

Имплантаты Otipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
Вариант исполнения: Имплантат для пластики дна турецкого седла/Sellar
Buttress Implant (SBI)

Артикул: OP82008

Размер: Большой 40мм x 40мм x 2.7мм x 0.7мм

Материал: полиэтилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиогенно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал
Холдингс, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдингс, LLC, действующий как Матрикс
Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106 кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,


относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление
650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,

эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

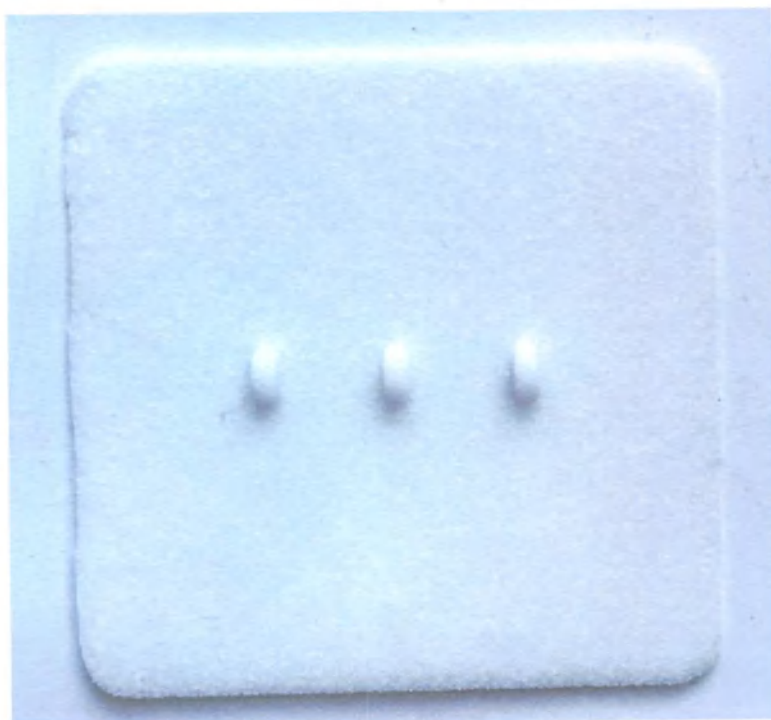

**Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
вариант исполнения: Имплантат краниальный клиновидный/Craniotomy Gap
Wedge, в составе:**


1. Имплантат краниальный клиновидный/Craniotomy Gap Wedge OP82011 102мм x 10мм x 4.70мм x 0.6мм, помещенный в двухслойный пакет из пленки Tyvek Chevron – 2шт.
2. Инструкция по применению – 1шт.
3. Этикетка-памятка для вклейки в историю болезни пациента – 5шт.
4. Идентификационная карта пациента – 1шт.
5. Термоформованный пластиковый лоток (контейнер) – 1шт.



MATRIX SURGICAL USA

Where Art Meets Science

REF



OP82011

LOT



012020151

Qty



0001



(01)00855421005747(7001)2020151(17)202712-01

MTX-OP82011-L1.03

Made in the USA

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные
Вариант исполнения: Имплантат краниальный клиновидный/Craniotomy
Gap Wedge

Артикул: OP82011

Размер: 102мм x 10мм x 4.70мм x 0.6мм

Материал: полистилен высокой плотности

Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично.

Только для однократного применения

Срок годности: см на упаковке

Номер партии: см на упаковке

Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Серджиал
Холдинг, LLC), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC DBA Matrix Surgical

USA (Матрикс Серджиал Холдинг, LLC, действующий как Матрикс

Серджиал США), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США

Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C,

относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 - 106

кПа

Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C,

относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление

650-800 мм рт.ст

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО

«КЛЮВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1,

эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787-17-72; www.clovermed.ru

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Прошито и заверено печатью
41 (сорок один)) листа(ов).
Генеральный директор ООО «КЛОВЕРМЕД»
Засеева О.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «КЛОВЕРМЕД»

О.В.Засеева



« 13 » октября 2023 г.

Общий макет этикеток индивидуальных упаковок с информацией на русском языке для изделия «Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные»

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Артикул: Размер: Материал: Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Образцы этикеток индивидуальных упаковок для изделия «Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные»

1. Микротонкая пластина/ Micro Thin Sheet:

-OP8438 30мм x 50мм x 0.45мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Микротонкая пластина/ Micro Thin Sheet Артикул: OP8438 Размер: 30мм x 50мм x 0.45мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛЮВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.І, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

2. Ультратонкие пластины/ Ultra Thin Sheets:

- OP7210 38мм x 50мм x 0.85мм

- OP7212 50мм x 76мм x 0.85мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Ультратонкая пластина/ Ultra Thin Sheet Артикул: OP7210 Размер: 38мм x 50мм x 0.85мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛЮВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.І, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

3. Пластины/Sheets:

- OP6330 38мм x 50мм x 1.5мм
- OP6331 50мм x 76мм x 1.5мм
- OP9562 38мм x 50мм x 3мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Пластина/Sheet Артикул: OP6330 Размер: 38мм x 50мм x 1.5мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

4. Орбитальные сферы/ Orbital Spheres:

- OP6316 – 14мм
- OP6326 – 16мм
- OP6327 – 18мм
- OP6317 – 20мм
- OP6322 – 22мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Орбитальная сфера/ Orbital Sphere Артикул: OP6316 Размер: 14мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

5. Составные имплантаты для пластики подбородка/Two-Piece Chin:

- OP8320 - Малый 62мм x 27мм x 5мм
- OP8321 - Средний 64мм x 32мм x 7мм
- OP8322 - Большой 64мм x36мм x 9мм

Имплантаты Omnigore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Составной имплантат для пластики подбородка/Two-Piece Chin Артикул: OP8320 Размер: Малый 62мм x 27мм x 5мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

6. Клиновидные имплантаты для коррекции энтофтальма/Enophthalmos Wedge:

- OP9541 Стандартный левый 31мм x 22мм x 6.5мм
- OP9542 Стандартный правый 31мм x 22мм x 6.5мм
- OP9543 Большой левый 39мм x 28мм x 7.5мм
- OP9544 Большой правый 39мм x 28мм x 7.5мм

Имплантаты Omnigore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Клиновидный имплантат для коррекции энтофтальма/Enophthalmos Wedge Артикул: OP9541 Размер: Стандартный левый 31мм x 22мм x 6.5мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

7. Скуловые имплантаты /Design Y Malar:

- OP9513 Малый правый 52мм x 26мм x 3мм
- OP9514 Малый левый 52мм x 26мм x 3мм
- OP9515 Средний правый 52мм x 27мм x 4мм
- OP9516 Средний левый 52мм x 27мм x 4мм
- OP9517 Большой правый 52мм x 28мм x 5мм
- OP9518 Большой левый 52мм x 28мм x 5мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Скуловой имплантат /Design Y Malar Артикул: OP9513 Размер: Малый правый 52мм x 26мм x 3мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛЮВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

8. Пластина для ринопластики/Nasal Sheet:

- OP9536 40мм x 9мм x 1.1мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Пластина для ринопластики/Nasal Sheet Артикул: OP9536 Размер: 40мм x 9мм x 1.1мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛЮВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

9. Форма основания уха/Ear Base Shapes:

- OP8330 Правая – 35мм x 53мм
- OP8331 Левая – 35мм x 53мм

Имплантаты Ompiroge для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Форма основания уха/Ear Base Shapes Артикул: OP8330 Размер: Правая – 35мм x 53мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

10. Спиральный обод/Helical Rim:

- OP8328 Правый - 50 мм x 61мм
- OP8329 Левый - 50 мм x 61мм

Имплантаты Ompiroge для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Спиральный обод/Helical Rim Артикул: OP8328 Размер: Правый - 50 мм x 61мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

11. БЛОК/Block:

- OP6332 13мм x 38мм x 3мм
- OP6333 13мм x 38мм x 6мм
- OP6335 25мм x 50мм x 3 мм
- OP6336 25мм x 50мм x 60мм
- OP6338 38мм x 63мм x 3мм
- OP6339 38мм x 63мм x 6мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: БЛОК/Block Артикул: OP6332 Размер: 13мм x 38мм x 3мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛЮВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

12. Имплантаты для пластики угла нижней челюсти/ Design Y Mandible Onlay:

- OP7541 Малый левый 57мм x 39мм x 5мм
- OP7542 Малый правый 57мм x 39мм x 5мм
- OP 7543 Средний левый 57мм x 39мм x 7.5мм
- OP7544 Средний правый 57мм x 39мм x 7.5мм
- OP7545 Большой левый 57мм x 39мм x 10мм
- OP7546 Большой правый 57мм x 39мм x 10мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Имплантат для пластики угла нижней челюсти/ Design Y Mandible Onlay Артикул: OP7541 Размер: Малый левый 57мм x 39мм x 5мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

13. Увеличенные имплантаты для пластики подбородка/Design Y Chin:

- OP8313 Малый с круглой проекцией 35 мм x 32мм x 4мм
- OP8314 Средний с круглой проекцией 37 мм x 32мм x 6мм
- OP8315 Большой с круглой проекцией 40мм x 32мм x 9мм
- OP8316 Малый с квадратной проекцией 35мм x 32мм x 4мм
- OP8317 Средний с квадратной проекцией 37мм x 32мм x 6мм
- OP8318 Большой с квадратной проекцией 40мм x 32мм x 9мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Увеличенный имплантат для пластики подбородка/Design Y Chin Артикул: OP8313 Размер: Малый с круглой проекцией 35 мм x 32мм x 4мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

14. Пластины с гладкой поверхностью/3S Sheets:

- OP8312 38мм x 50мм x 1мм
- OP9312 38мм x 50мм x 1.7мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Пластина с гладкой поверхностью/3S Sheet Артикул: OP8312 Размер: 38мм x 50мм x 1мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru

clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

15. Имплантат краниальный/Bendblock Cranial Grid implant:
- OP9524 110мм x 97.5мм x 5.25мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Имплантат краниальный/Bendblock Cranial Grid implant Артикул: OP9524 Размер: 110мм x 97.5мм x 5.25мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

16. Пластина канальная для пластики дна и стенок глазницы/Channel Sheet Implant:
- OP9530 50мм x 50мм x 2мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Пластина канальная для пластики дна и стенок глазницы/Channel Sheet Implant Артикул: OP9530 Размер: 50мм x 50мм x 2мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____

17. Имплантаты для пластики края глазницы увеличенные /Extended Orbital Rims:

- OP9539 Левый 53мм x 31мм

- OP9540 Правый 53мм x 31мм

Имплантаты Ompiroge для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Имплантат для пластики края глазницы увеличенный /Extended Orbital Rim Артикул: OP9539 Размер: Левый 53мм x 31мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.І, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

18. Имплантаты краниальные гемисферические/Cranial Hemisphere:

- OP82000 Правый 174мм x 133мм x 5мм

- OP82001 Левый 174мм x 133мм x 5мм

Имплантаты Ompiroge для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Имплантат краниальный гемисферический/Cranial Hemisphere Артикул: OP82000 Размер: Правый 174мм x 133мм x 5мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апиrogenно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.І, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

19. Имплантаты для пластики дна турецкого седла/Sellar Buttress Implants (SBI):

- OP82007 20мм x 20мм x 2.45мм x 0.45мм
- OP82008 Большой 40мм x 40мм x 2.7мм x 0.7мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Имплантат для пластики дна турецкого седла/Sellar Buttress Implant (SBI) Артикул: OP82007 Размер: 20мм x 20мм x 2.45мм x 0.45мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛЮВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

20. Имплантат краниальный клиновидный/Craniotomy Gap Wedge:

- OP82011 102мм x 10мм x 4.70мм x 0.6мм

Имплантаты Omnipore для черепно-лицевой хирургии, стерильные Модель: Имплантат краниальный клиновидный/Craniotomy Gap Wedge Артикул: OP82011 Размер: 102мм x 10мм x 4.70мм x 0.6мм Материал: полиэтилен высокой плотности Стерильно (этиленоксидом). Апирогенно. Не токсично. Только для однократного применения Срок годности: см на упаковке Номер партии: см на упаковке
Производитель: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Место производства: Matrix Surgical Holdings, LLC (Матрикс Сёрджикал Холдингс, ЛЛС), 98 Bledsoe Road, Newnan, Georgia, 30265, USA, США
Условия хранения и транспортировки: температура 18°C - 49°C, относительная влажность 10% - 91%, атмосферное давление 86 – 106 кПа
Условия эксплуатации: температура 32°C - 42°C, относительная влажность не более 80% при 25°C, атмосферное давление 650-800 мм рт.ст
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛЮВЕРМЕД», 121099 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34 стр.1, пом.1, эт.5, ком.1; Тел: 7 (495) 787- 17 -72; www.clovermed.ru
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Прошито и заверено печатью

12 (*ДВЕНАДЦАТЬ*) листа(ов).

Генеральный директор ООО «КЛОВЕРМЕД»

Засеева О.В.

