


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора)

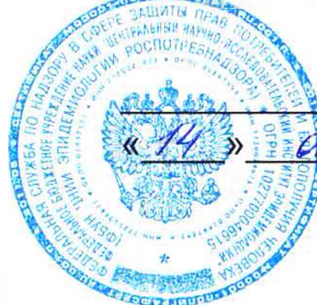


В.Г. Акимкин

2010 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов

АмплиСенс® *Human enterovirus-FL*



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® Human enterovirus-FL

ТУ 21.20.23-277-01897593-2017



Σ 55

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FEP/FRT-50-0,2

Состав комплекта:

ПЦР-смесь-FL Enterovirus	0,01 мл x 55
ПЦР-буфер-К	1,1 мл x 1
ПЦР-буфер-А-Фон	0,6 мл x 1
К+ Enterovirus	0,2 мл x 1
К-	0,2 мл x 1
ВКО-FL	0,5 мл x 1
ОКО	1,2 мл x 1

2 °C 8 °C

-24 °C -16 °C
ПЦР-буфер-К



ПЦР-смесь-FL Enterovirus

При получении разукomплектовать в соответствии с указанными температурами хранения

REF H-2771-3-2

LOT ДД.ММ.ГГ

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

Регистрационный номер:

Фотография набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL
формы 1 до вскрытия внешней упаковки (коробка)



Фотография набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL
формы 1 после вскрытия внешней упаковки (коробка)

AmpliSens® ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

ВКЛАДЫШ
к набору реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Форма 1 REF H-2771-3-2

Форма 2 REF H-2772-3

Форма 3 REF H-2773-1-4

LOT ДД.ММ.ГГ

Детекция по «конечной точке»
Настройки теста «Enterovirus» для флуоресцентных детекторов
ALA-1/4 «Дельта», «Дельта-4»

Канал	Назначение	Порог отрицательного результата	Порог положительного результата	Порог
HEX	Enterovirus	2.5	3.0	—
RAM	ВКО	—	—	3.0

Детекция в режиме «реального времени»
Настройки для приборов второго типа
Rotor-Gene 3000, Rotor-Gene 6000, Rotor-Gene Q

Канал	Сайтраты/Калиб. Optimization... Opt. уравнил. крив.	Threshold Порог	Dynamic tube/ Динамич. фон	Slope Correct/ Коррект. уклона	More Settings/Other Removal/Устранение выбросов
-------	---	--------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL



AmpliSens®

Форма 1
REF H-2771-3-2
LOT ДД.ММ.ГГ

Наименование	Содержимое	Срок годности	Условия хранения	Срок хранения
1. Набор реагентов	0,01 мл x 55 1,1 мл x 1 0,6 мл x 1 0,2 мл x 1 0,2 мл x 1 0,5 мл x 1 1,2 мл x 1	12 месяцев	2-8 °C	12 месяцев

AmpliSens®

Краткое руководство
набор реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Форма 1: REF H-2771-3-2

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новомосковская, 34
Тел: (495) 374-5042
e-mail: info@fbsn.ru



АмплиСенс® Human enterovirus-FL
ТУ 21.20.23-277-01897593-2017

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FEP/FRT-50-0-2

Состав комплекта:

- ПЦР-смесь-FL Enterovirus
- ПЦР-буфер-К
- ПЦР-буфер-А-Фон
- К- Enterovirus
- ВКО-FL
- ВКО

При получении реагентов в соответствии с условиями поставки проверить

Состояние и целостность упаковки

REF H-2771-3-2 LOT ДД.ММ.ГГ





ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



V55

Набор реагентов

АмплиСенс® Human enterovirus-FL

ТУ 21.20.23-277-01897593-2017

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FEP/FRT-50-0,2

Состав комплекта:

ПЦР-смесь-FL Enterovirus

ПЦР-буфер-К

ПЦР-буфер-А-Фон

К- Enterovirus

К-

ВКО-FL

ОК

0,01 мл x 55

1,1 мл x 1

0,6 мл x 1

0,2 мл x 1

0,2 мл x 1

0,5 мл x 1

1,2 мл x 1

2 °C

8 °C

-24 °C

16 °C

ПЦР-буфер-К

ПЦР-смесь-FL Enterovirus

При получении результатов в соответствии с указанными температурами хранения

REF H-2771-3-2

LOT ДД ММ ГГ

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 712724, № 321480 Регистрационный номер:



АмплиСенс®

ӘКПАДЫШ

АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Dopis 1 REF 4-2771-3-2

FORM 2 REF H-2772-3

REF H-2773-14

07 ДД.ММ.ГГ

отёдки по «конечной точке»
эстройки твист «Ельзовица» р
LA-1/4, «Дрон», «Дрон-4»

Комплекс	Наименование	Порог отрицательного результата	Порог положительного результата	Порог
HEX	<i>Enterovirus</i>	2,5	3,0	—
FAM				1,0
RKO				1,0

отекли в ранние аркадные времена
защиты для приборов оптического типа

Model	Calibration Optimization / OT	Throughput Persec	Dynamic table dimension / format	Storage Capacity Kbytes, address width, bits	More Settings & Output Parameters / Programme suboptions
Router-Gate 5000, Router-Gate Q	OT 10T 20 10T	0.05	интервал	встроенная	12%

AmpliSens®

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Формы:	☐ ГГ ☐ ММ	☐ ГГГ-ММ-ДД ☐ ГГГ-ММ-ДД
--------	---	--

Serial Number	Project Name	Project Description	Project Status	Project Location	Project Period	Project Budget	Project Outcome
1	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	Completed	Project A	2018-2020	\$1,000,000	20 classrooms and a library built.
2	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	In Progress	Project B	2020-2022	\$1,000,000	10 classrooms and a library built.
3	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	Not Started	Project C	2022-2024	\$1,000,000	0 classrooms and a library built.
4	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	Completed	Project D	2018-2020	\$1,000,000	20 classrooms and a library built.
5	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	In Progress	Project E	2020-2022	\$1,000,000	10 classrooms and a library built.
6	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	Not Started	Project F	2022-2024	\$1,000,000	0 classrooms and a library built.
7	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	Completed	Project G	2018-2020	\$1,000,000	20 classrooms and a library built.
8	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	In Progress	Project H	2020-2022	\$1,000,000	10 classrooms and a library built.
9	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	Not Started	Project I	2022-2024	\$1,000,000	0 classrooms and a library built.
10	Construction of a new school building	Construction of a new school building with 20 classrooms and a library.	Completed	Project J	2018-2020	\$1,000,000	20 classrooms and a library built.

[illegible]

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

ӘКІЛДІК

АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Dopis 1 REF 4-2771-3-2

FORM 2 REF H-2772-3

REF H-2773-14

07 ДД.ММ.ГГ

отёдки по «конечной точке»
эстройки твист «Ельзовица» р
LA-1/4, «Дрон», «Дрон-4»

Комплекс	Наименование	Порог отрицательного результата	Порог положительного результата	Порог
HEX	<i>Enterovirus</i>	2,5	3,0	—
FAM				1,0
RKO				1,0

отекли в ранние аркадные времена
защиты для приборов оптического типа

Model	Calibration Optimization / OT	Throughput Persec	Dynamic table dimension / format	Storage Capacity Kbytes, address width, bits	More Settings & Output Parameters / Programme suboptions
Router-Gate 5000, Router-Gate Q	OT 10T 20 10T	0.05	интервал	встроенная	12%



AmpliSens®

Советское руководство

набор реагентов

REF H-2771-2-2

**«ЮНИТАС» Инвестиционная
Реконструкция**

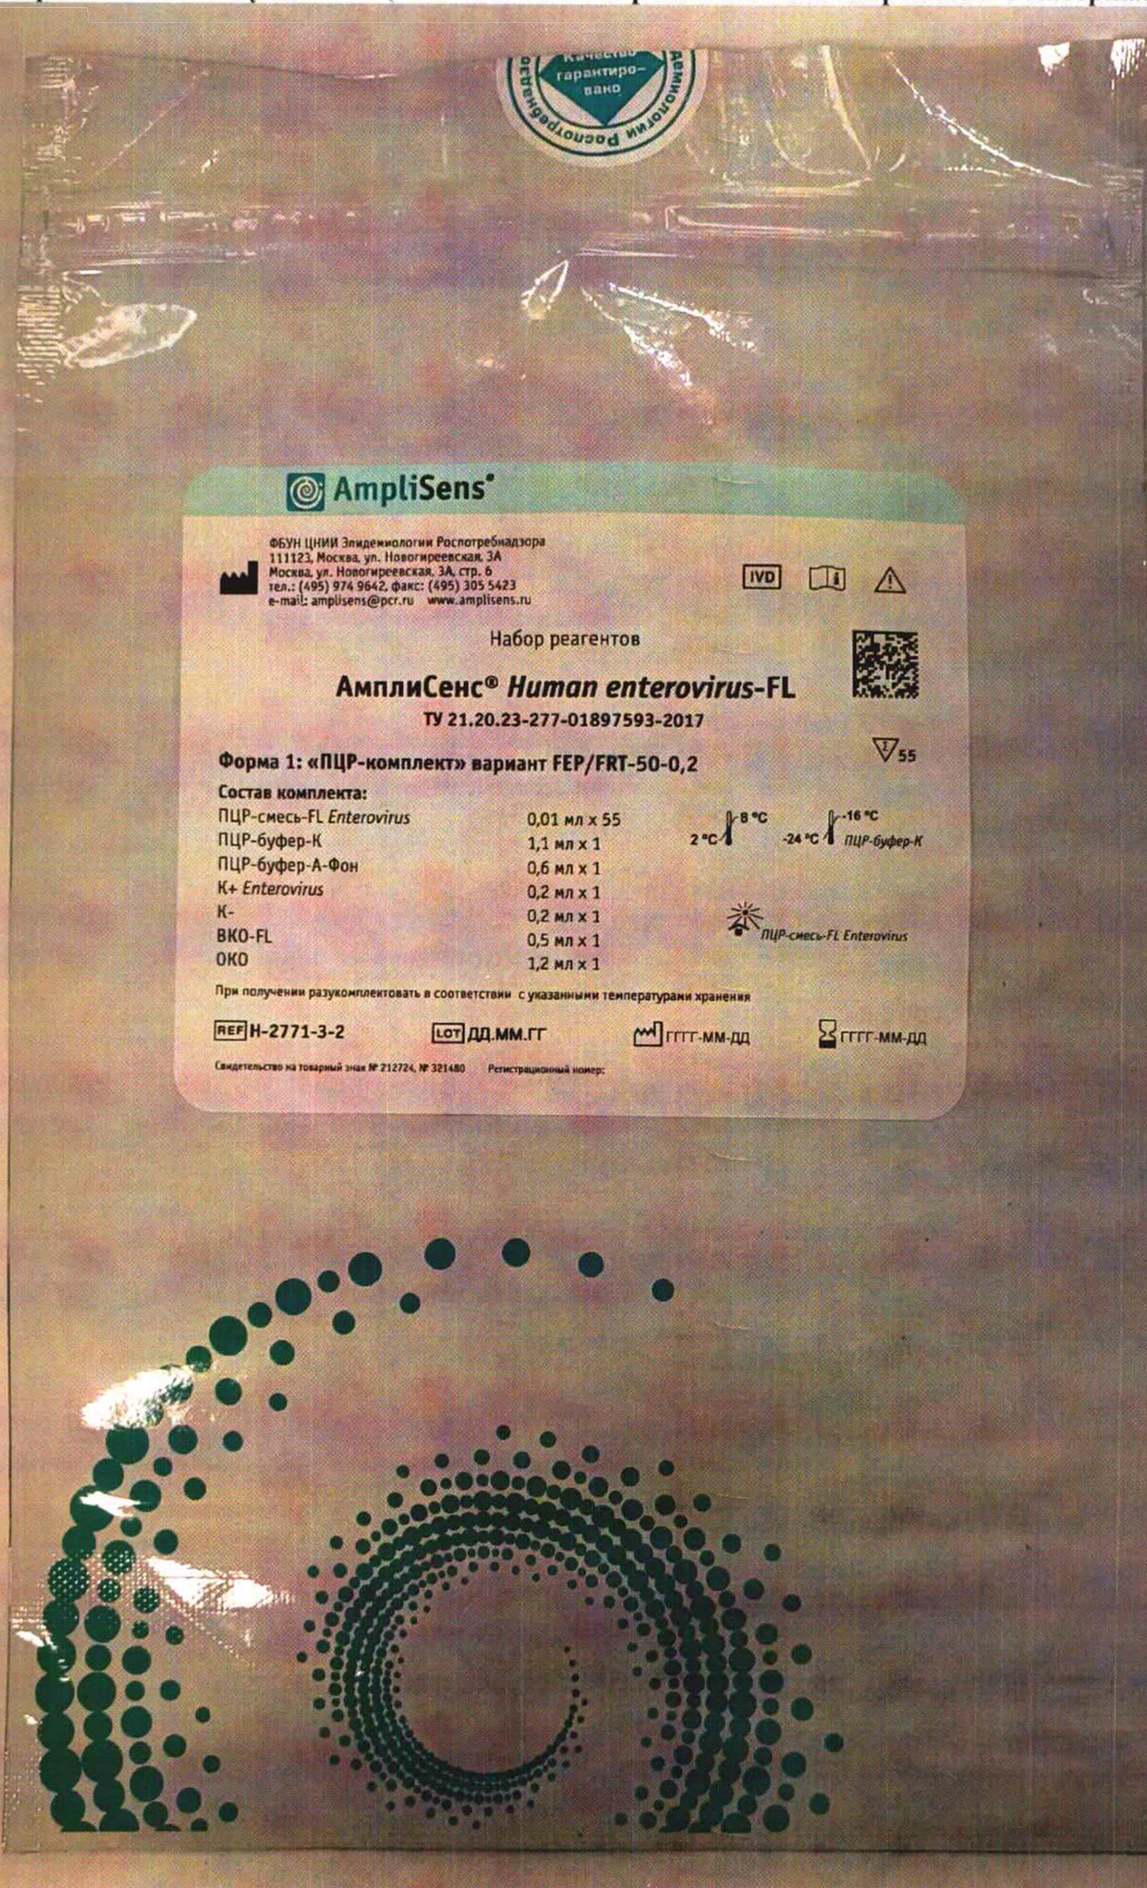

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 5
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® Human enterovirus-FL

ТУ 21.20.23-277-01897593-2017



Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FEP/FRT-50-0,2

55

Состав комплекта:

ПЦР-смесь-FL Enterovirus	0,01 мл x 55	2 °C	8 °C	-24 °C	-16 °C
ПЦР-буфер-К	1,1 мл x 1				
ПЦР-буфер-А-Фон	0,6 мл x 1				
К+ Enterovirus	0,2 мл x 1				
К-	0,2 мл x 1				
ВКО-FL	0,5 мл x 1				
ОКО	1,2 мл x 1				



ПЦР-смесь-FL Enterovirus

При получении разупаковать в соответствии с указанными температурами хранения


REF H-2771-3-2

LOT ДД.ММ.ГГ


ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480 Регистрационный номер:

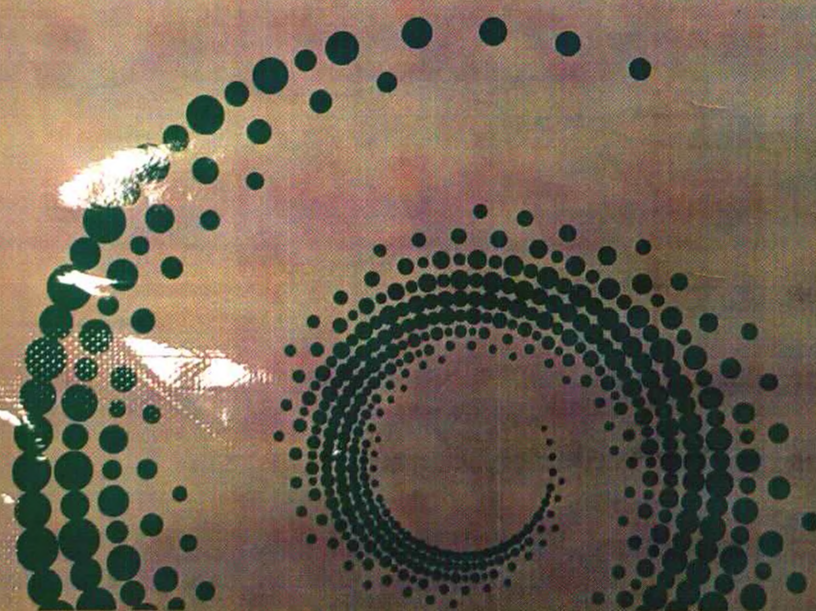





ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® Human enterovirus-FL

ТУ 21.20.23-277-01897593-2017



V55

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FEP/FRT-50 F

Состоит из 2 частей

Часть 1 из 2. Состав:

K+ Enterovirus	0,2 мл x 1
K-	0,2 мл x 1
Минеральное масло для ПЦР	2,0 мл x 1
ВКО-FL	0,5 мл x 1
ОКО	1,2 мл x 1

2 °C - 8 °C

REF H-2772-3

LOT ДД.ММ.ГГ

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

Регистрационный номер:



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® Human enterovirus-FL

ТУ 21.20.23-277-01897593-2017

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FEP/FRT-50 F

Состоит из 2 частей

Часть 2 из 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL Enterovirus	0,6 мл x 1
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1
ТМ-Репертажа (MMb)	0,015 мл x 1
RT-G-mix-2	0,015 мл x 1

-24 °C



REF H-2772-3

LOT ДД.ММ.ГГ

ГГГГ-ММ-ДД


ГГГГ-ММ-ДД



Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
Регистрационный номер:

Фотография набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL
формы 2 до вскрытия внешней упаковки (коробка)

Фотография набора реагентов АмплиСенс® *Human enterovirus-FL* формы 2 до вскрытия внешней упаковки (коробка) – с наклейкой контроля вскрытия



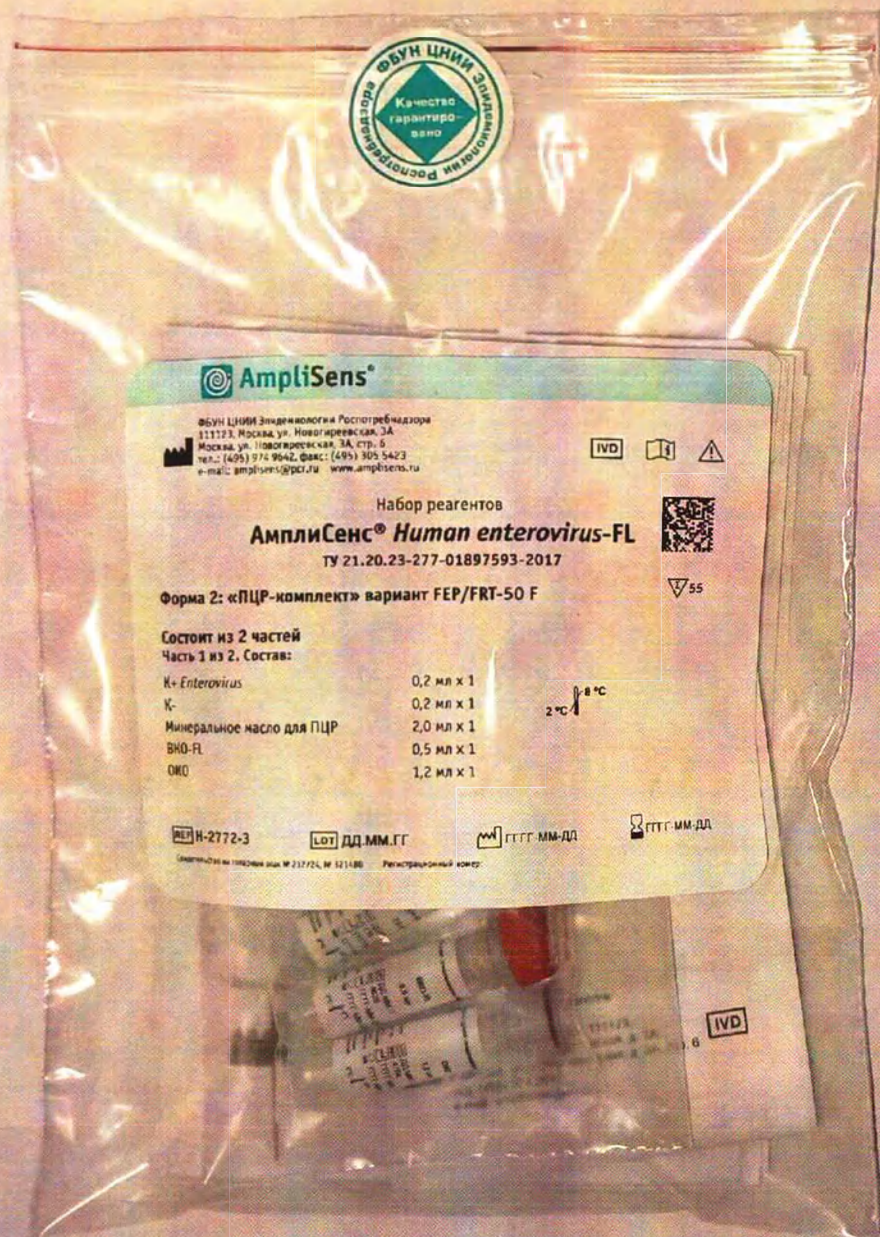

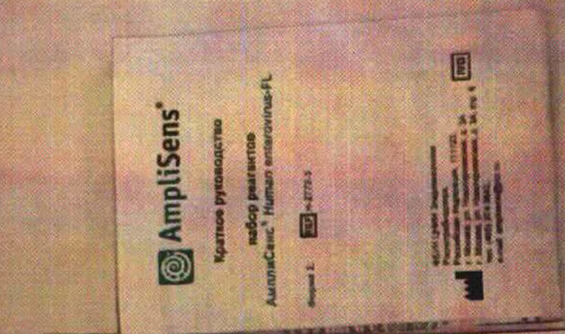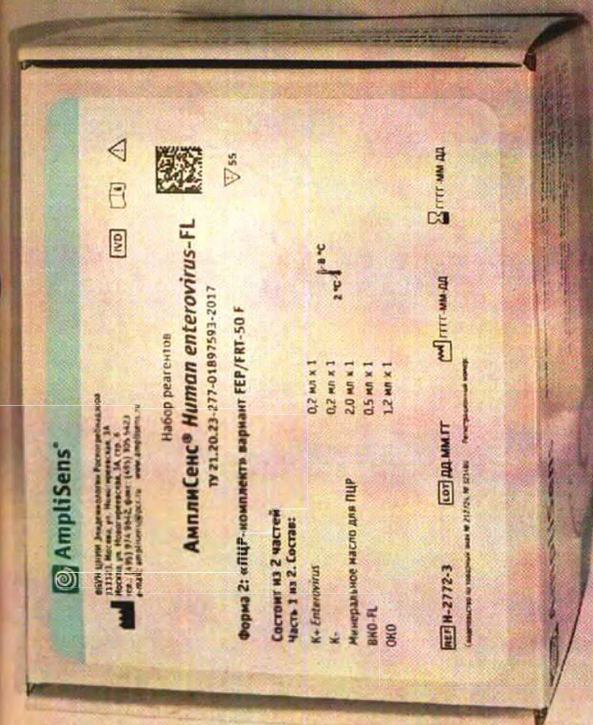

АмплиСенс®
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
и Роспотребнадзора
ВКЛАДЫШ
к набору реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Форма 1 REF H-2771-3-2
Форма 2 REF H-2772-3
Форма 3 REF H-2773-1-4
LOT 100 MM GT

Детекция по элюционной точке
Настраивая тест «Ентеровирус» для флуоресцентных детекторов
ALA-114, «Дельта», «Дельта-4»

Канал	Настройка	Порог	Порог	Порог
HEX	Ентеровирус	2.5	3.0	3.0
FAM	BHO	-	-	-

Детекция в реальном времени
Настраивая тест «Ентеровирус» для флуоресцентных детекторов
Rotor-Gene 5000, Rotor-Gene 6000, Rotor-Gene Q

Канал	Настройка	Порог	Порог	Порог
FAM/Green	Ентеровирус	0.05	0.05	0.05
HEX	Ентеровирус	2.5	3.0	3.0
FAM	BHO	-	-	-

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
и Роспотребнадзора
ВКЛАДЫШ
к набору реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Форма 1 REF H-2771-3-2
Форма 2 REF H-2772-3
Форма 3 REF H-2773-1-4
LOT 100 MM GT

Детекция по элюционной точке
Настраивая тест «Ентеровирус» для флуоресцентных детекторов
ALA-114, «Дельта», «Дельта-4»

Канал	Настройка	Порог	Порог	Порог
HEX	Ентеровирус	2.5	3.0	3.0
FAM	BHO	-	-	-

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
и Роспотребнадзора
ВКЛАДЫШ
к набору реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Форма 1 REF H-2771-3-2
Форма 2 REF H-2772-3
Форма 3 REF H-2773-1-4
LOT 100 MM GT

AmpliSens®

Набор реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL
Тр 21.26.23-271-0187593-2017

Формы 2: в ПЦР-амплификаторе (10/100/500) T

Система из 2 частей
Часть 1 из 2. Сортик

№: 02.04.01
02.04.01
02.04.01
02.04.01

Информация о наборе реагентов

ВНИМАНИЕ! При использовании набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL необходимо соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции по применению.

АмплиСенс®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

набор реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Формы 2: в ПЦР-амплификаторе (10/100/500) T


Система из 2 частей
Часть 1 из 2. Сортик

№: 02.04.01
02.04.01
02.04.01
02.04.01

Информация о наборе реагентов

ВНИМАНИЕ! При использовании набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL необходимо соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции по применению.

АмплиСенс®

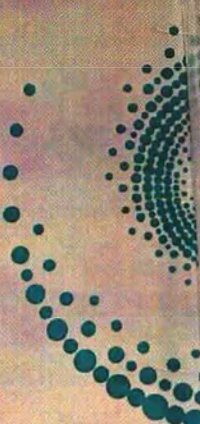

AmpliSens®

ФЕУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

ВКЛАДЫШ
к набору реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Формы 1: REF H-2771-3-2
Формы 2: REF H-2772-3
Формы 3: REF H-2773-1-4

ЛОТ ДД, ММ, ГГ

Детекция по основной точке
настройка теста в элюате для детекции

Капан	Наименование	Порядок размещения	Порядок результата	Порядок результата	Порядок результата
HEX	Элюат	2,5	3,0	3,0	3,0
FAM	ВК	0,05	0,05	0,05	0,05

Детекция в режиме реального времени

Настройка теста в элюате для детекции

Капан	Наименование	Порядок размещения	Порядок результата	Порядок результата	Порядок результата
HEX	Элюат	2,5	3,0	3,0	3,0
FAM	ВК	0,05	0,05	0,05	0,05

Детекция в режиме реального времени

Настройка теста в элюате для детекции

AmpliSens®

Краткое руководство
набор реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Формы 2: в ПЦР-амплификаторе (10/100/500) T

Система из 2 частей
Часть 1 из 2. Сортик

№: 02.04.01
02.04.01
02.04.01
02.04.01

Информация о наборе реагентов

ВНИМАНИЕ! При использовании набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL необходимо соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции по применению.

АмплиСенс®

AmpliSens®

Краткое руководство
набор реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL

Формы 2: в ПЦР-амплификаторе (10/100/500) T

Система из 2 частей
Часть 1 из 2. Сортик

№: 02.04.01
02.04.01
02.04.01
02.04.01


Информация о наборе реагентов

ВНИМАНИЕ! При использовании набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL необходимо соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции по применению.

АмплиСенс®



Фотография набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL
формы 2, часть 2 из 2, после вскрытия внешней упаковки (коробка)

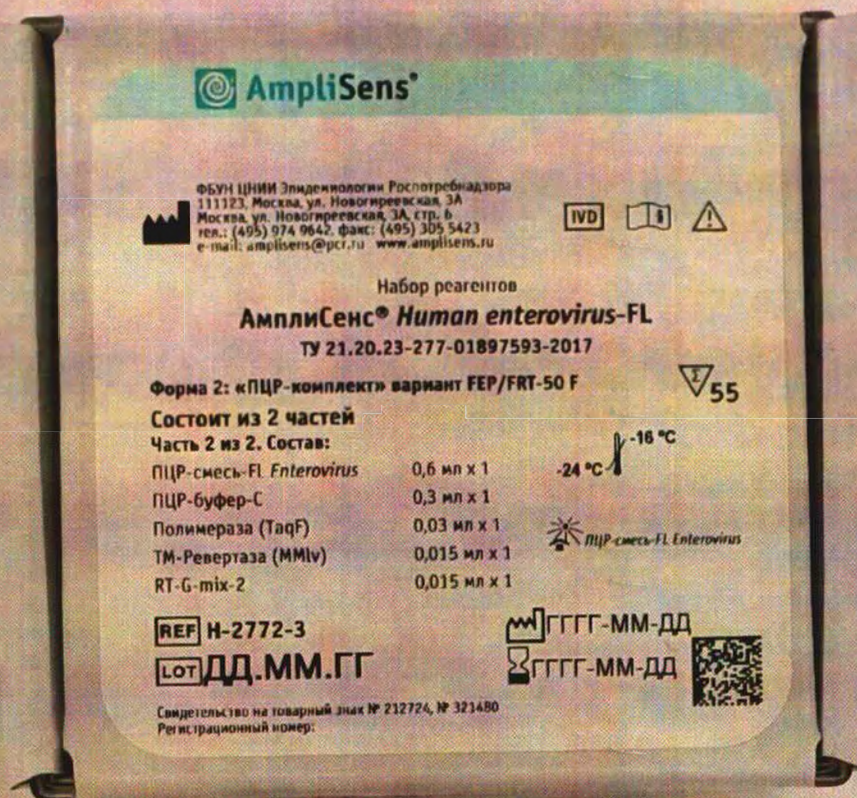

Фотография набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL формы 2, часть 2 из 2, после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock из полиэтилена)



AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111173, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@fsc.ru, www.amplisens.ru



Набор реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL
ТУ 21.20.23-277-01897593-2017

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FEP/FRT-50 F

55

Состоит из 2 частей

Часть 2 из 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL Enterovirus	0,6 мл x 1
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1
ТМ-Реввертаза (MMiv)	0,015 мл x 1
RT-G-mix-2	0,015 мл x 1

-24 °C
-16 °C

ПЦР-смесь-FL Enterovirus

REF H-2772-3

LOT ДД.ММ.ГГ

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД



Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
Регистрационный номер:



AmpliSens®

ФГУП ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
121123, Москва, ул. Новогорская, 3А
Москва, ул. Новогорская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 874 0642, факс: (495) 359 5423
e-mail: amplisens@yandex.ru, www.amplisens.ru

Набор реагентов
АмплиСенс® Human enterovirus-FL
ТУ 21.20.23-277-01В97593-2017

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FEP/FRT-50 F

Состоит из 2 частей
Часть 2 из 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL Enterovirus	0,6 мл x 1
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1
ТМ-Реквертаза (MMiv)	0,015 мл x 1
RT-G mix-2	0,015 мл x 1

REF H-2772-3
LOT DD.MM.GG

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321490
Регистрационный номер:


IVD I I A

55


-24 °C -16 °C

ПЦР-смесь-FL Enterovirus

МГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД

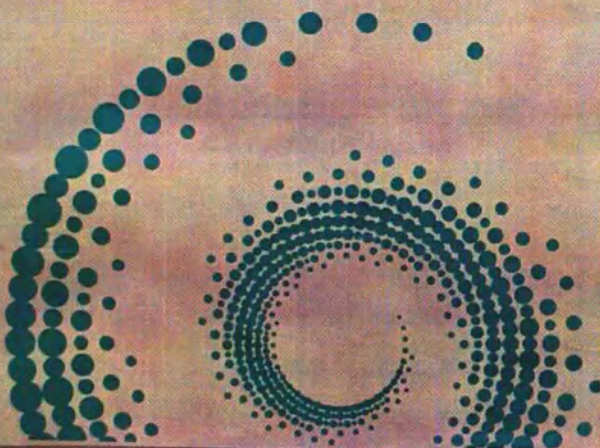





ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® Human enterovirus-FL

ТУ 21.20.23-277-01897593-2017



96

Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-L

Состав комплекта:

ПЦР-смесь *Enterovirus-Lyo*

--- x 96

К+ *Enterovirus*

0,5 мл x 1

К-

0,5 мл x 1

ВКО-FL



1,0 мл x 1

ОКО

1,2 мл x 1

Буфер для элюции А

1,2 мл x 4



REF Н-2773-1-4

LOT ДД.ММ.ГГ



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД


Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

Регистрационный номер:

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
тел.: (495) 974 9642
факс: (495) 305 5423

Federal Budget Institute of Science
"Central Research Institute for Epidemiology"
3A Novogireevskaya Street, Moscow, 111123, Russia
Tel: +7 (495) 974 9642
Fax: +7 (495) 305 5423


 **AmpliSens®**

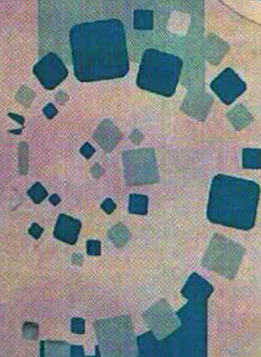



AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9042, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@psr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов

АмплиСенс® Human enterovirus-FL

ТУ 21.20.23-277-01897593-2017



96

Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-L

Состав комплекта:

ПЦР-смесь Enterovirus-Lyo

К+ Enterovirus

К-

ВКО-FL

ОКО

Буфер для элюции А

— x 96

0,5 мл x 1

0,5 мл x 1

1,0 мл x 1

1,2 мл x 1

1,2 мл x 4

2 °C 8 °C

ПЦР-смесь Enterovirus-Lyo

ПЦР-смесь Enterovirus-Lyo

REF H-2773-1-4


LOT ДД.ММ.ГГ

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Свидетельство на товарный знак № 232724, № 321480



Регистрационный номер:

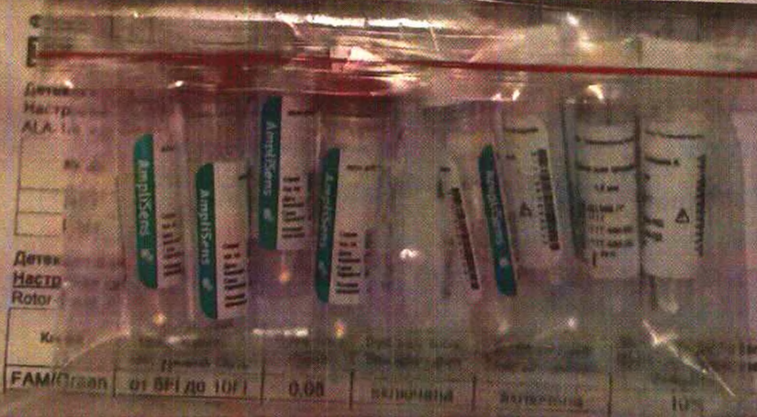

Фотография набора реагентов АмплиСенс® Human enterovirus-FL формы 3 после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock из полиэтилена)






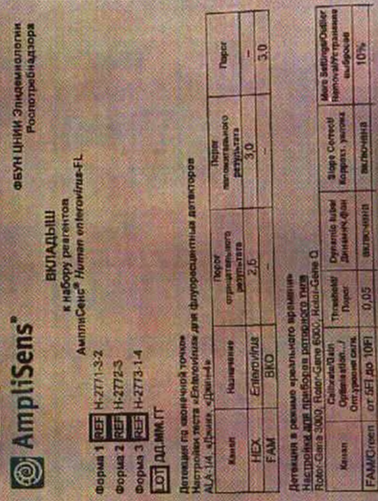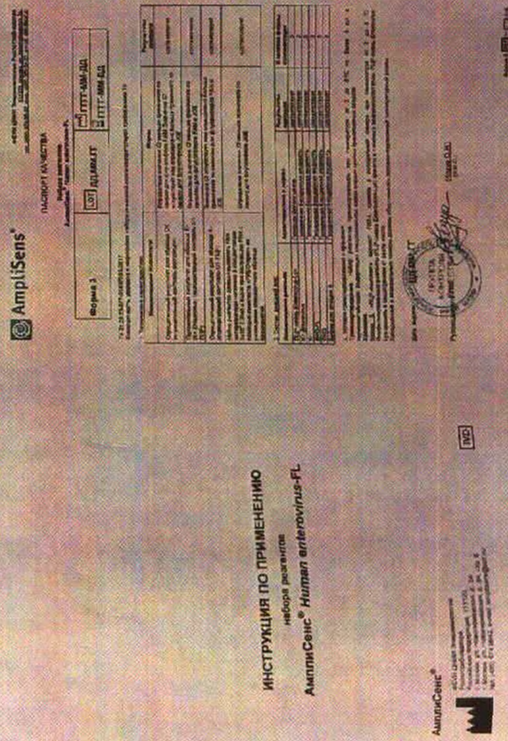



Фотография реагента «ПЦР-смесь *Enterovirus-Лю*» (96 пробирок), входящего в набор реагентов АмплиСенс® *Human enterovirus-FL* формы 3, после вскрытия внешней упаковки (цефленовый пакет)

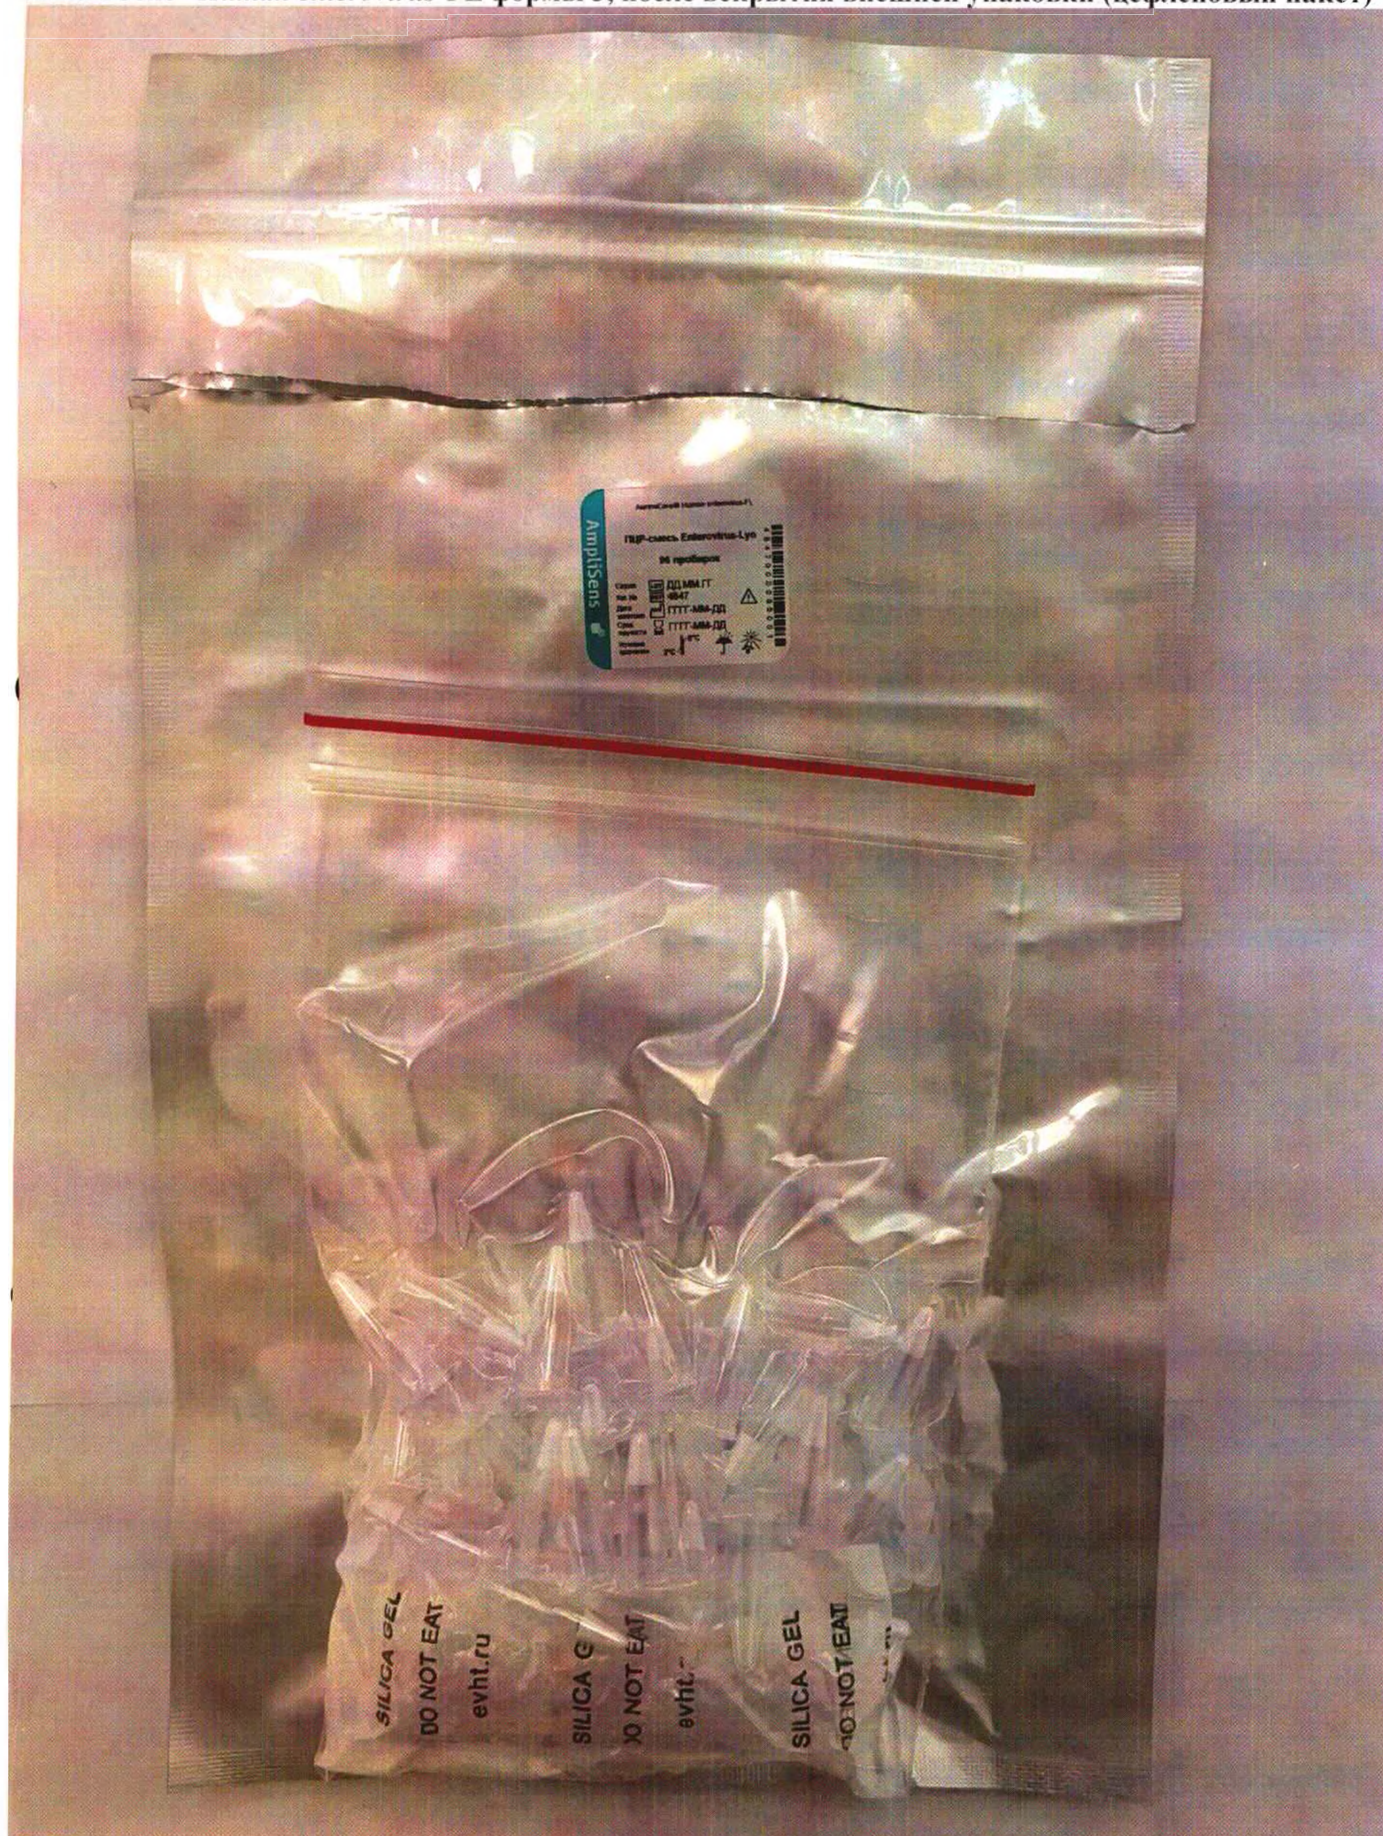

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 30
тридцать лист 08

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 169/22 от 16.11.2022 г.)



А.О.Лисицына

20 23 г.

М.П.