





Аппарат рентгеновский цифровой для исследования грудной клетки ФЦ - "ЭКСПЕРТ" по ТУ 9442-023-11150760-2007 в составе:







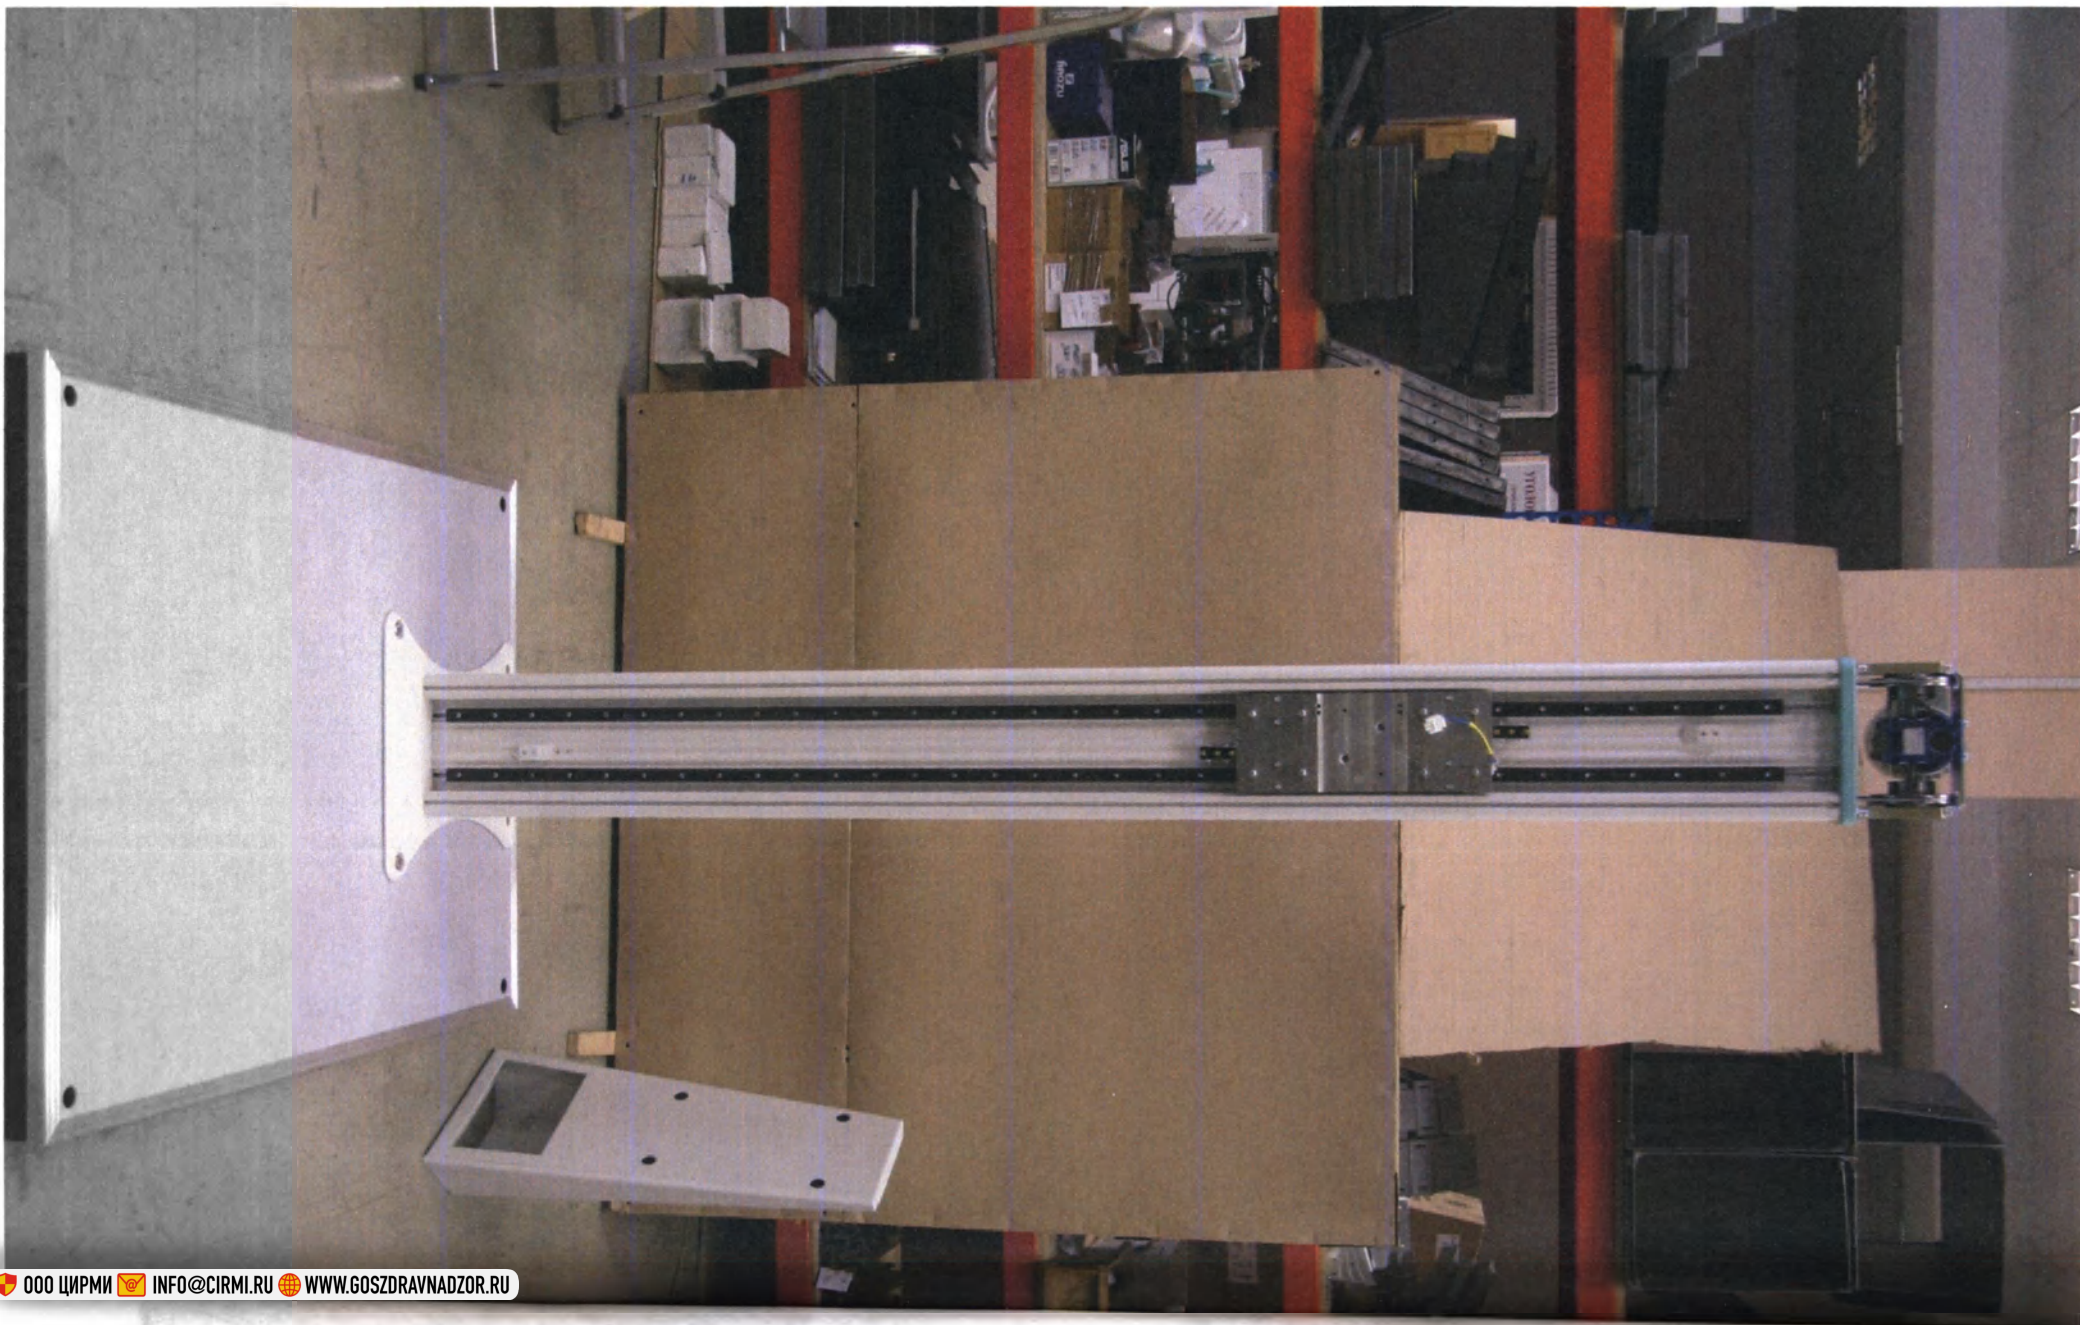


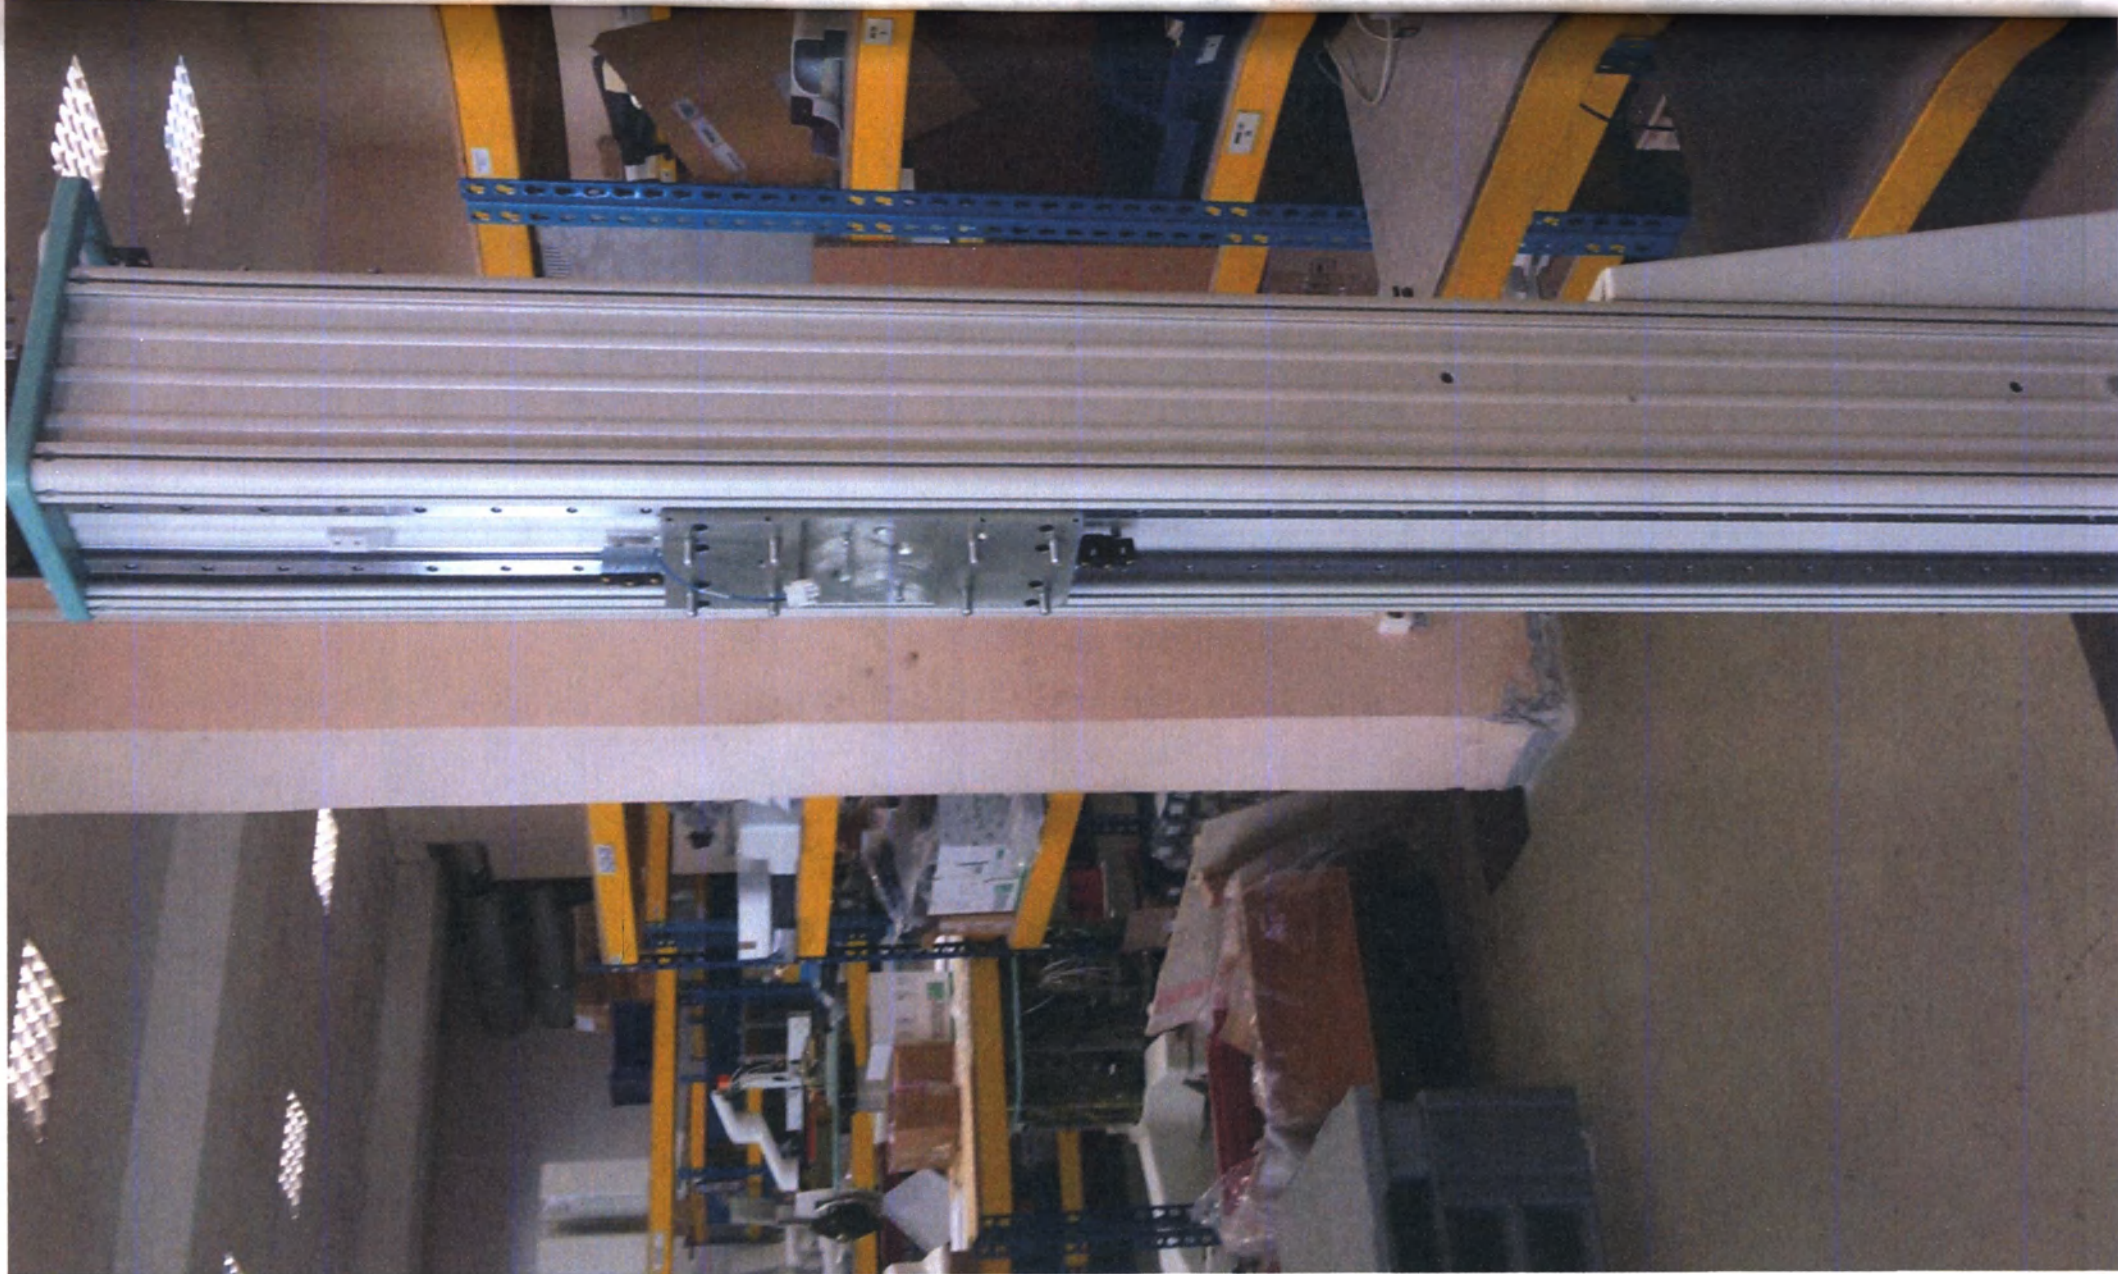



4. Система позиционирования рентгеновская

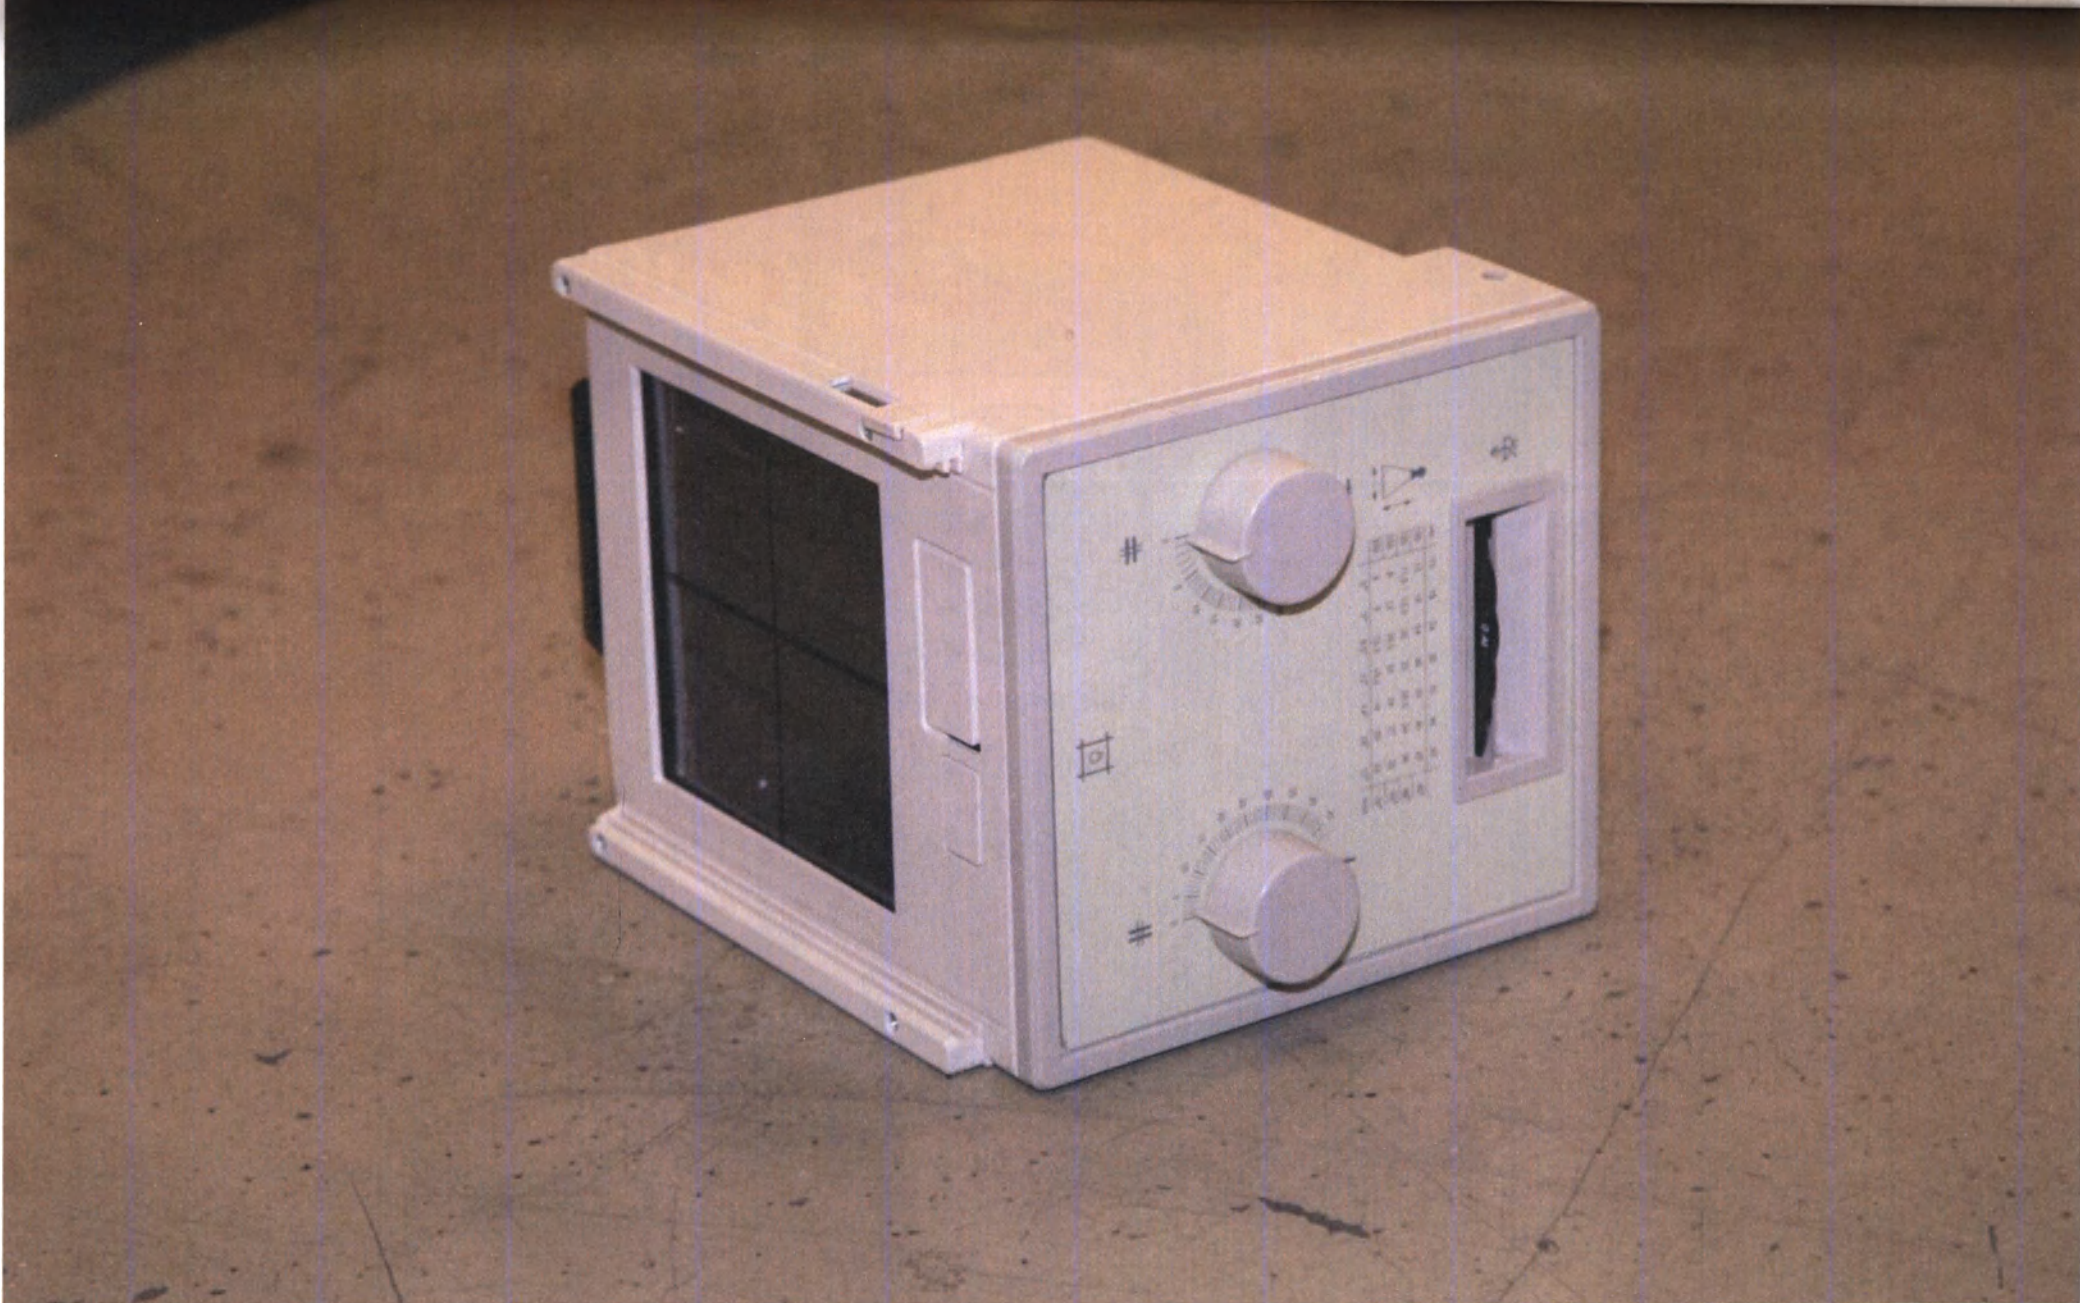

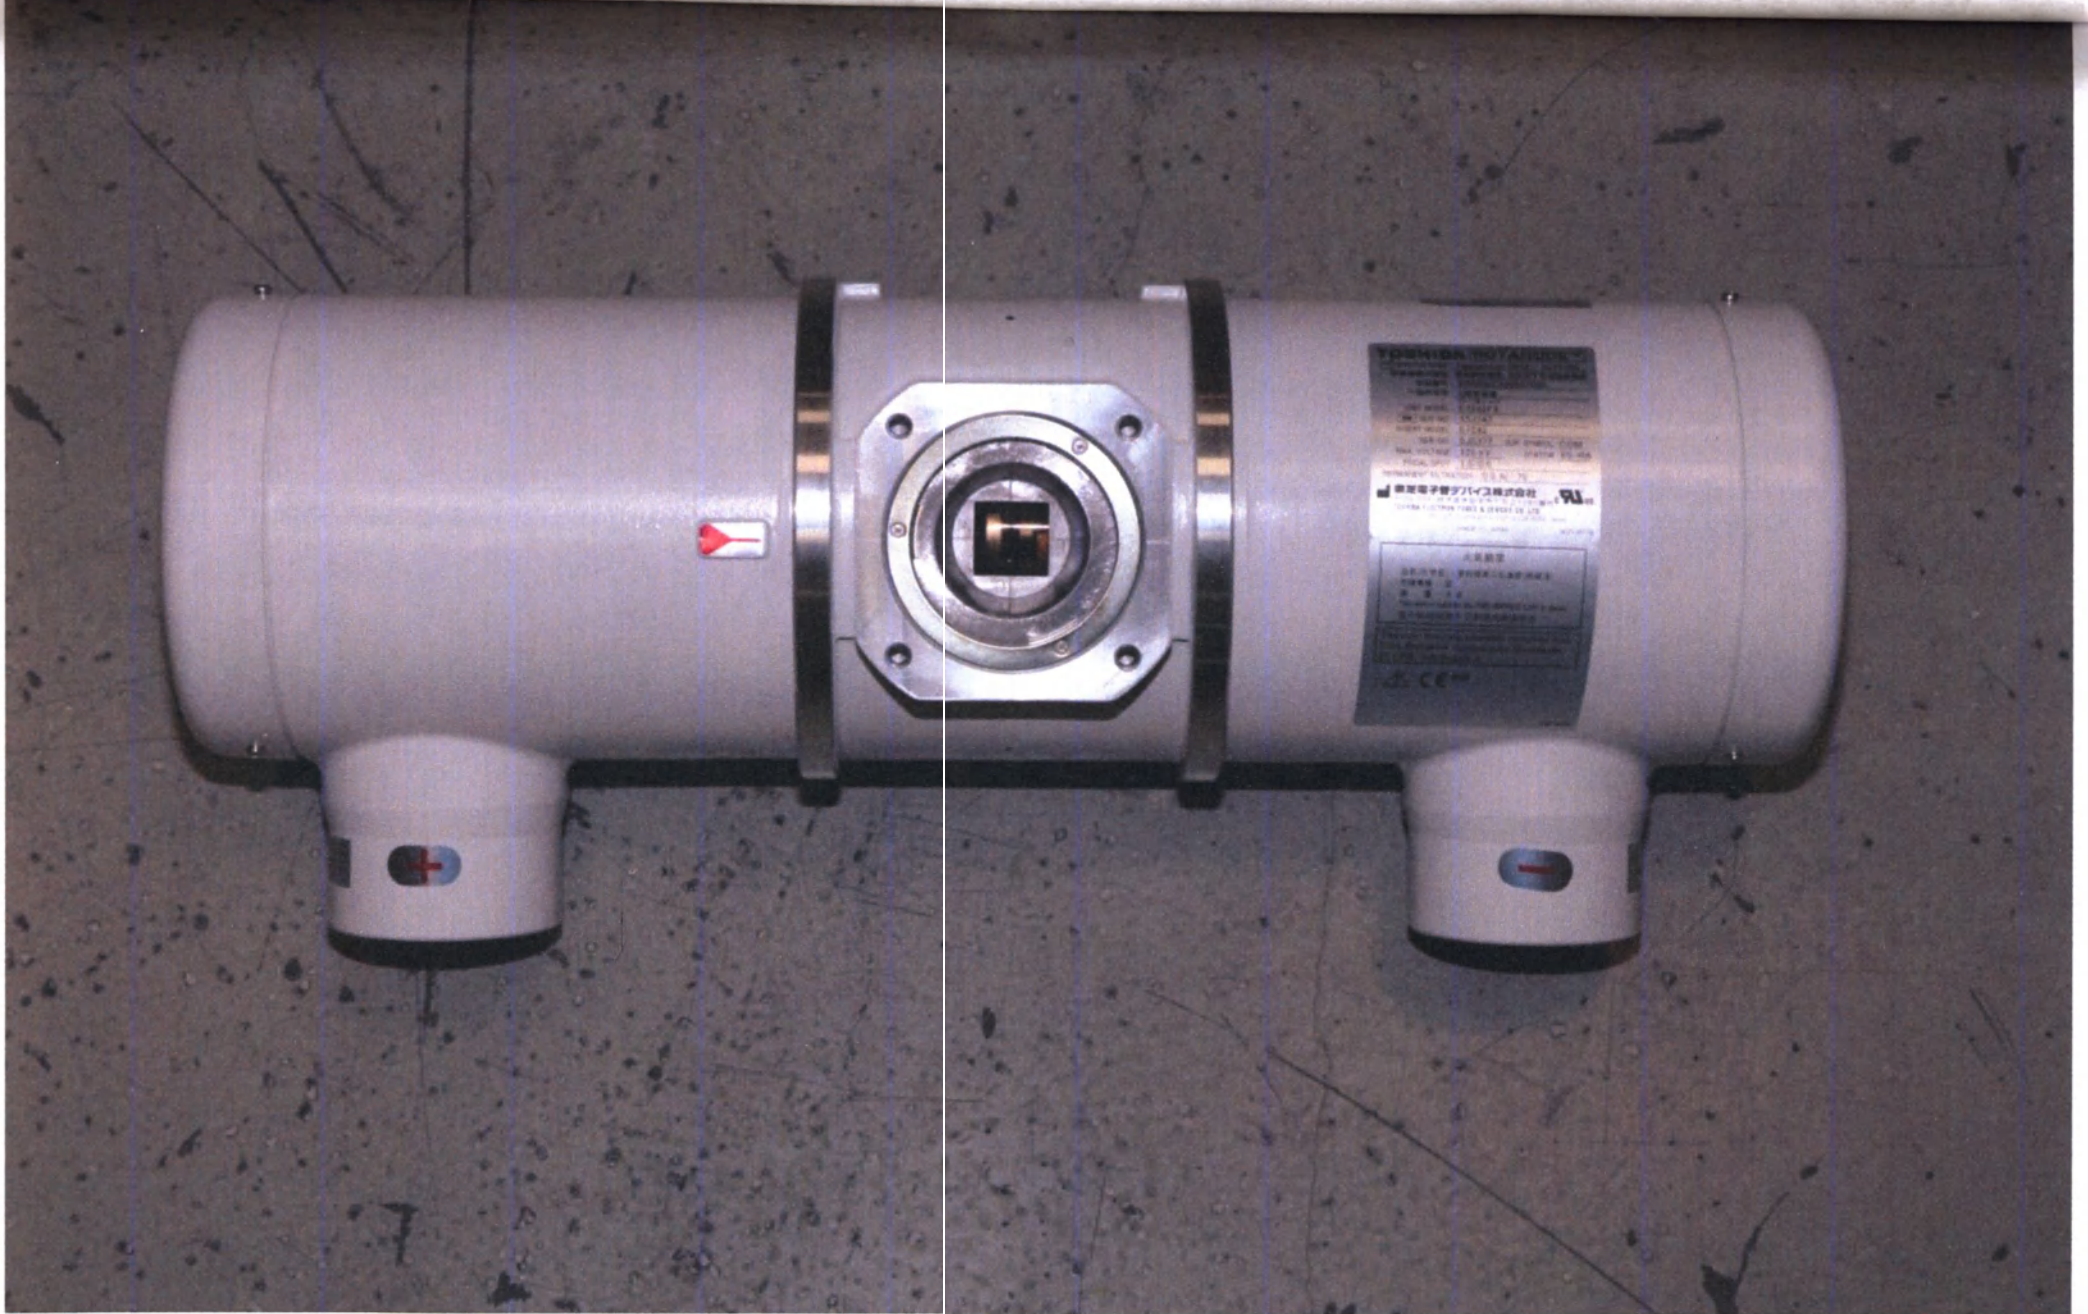

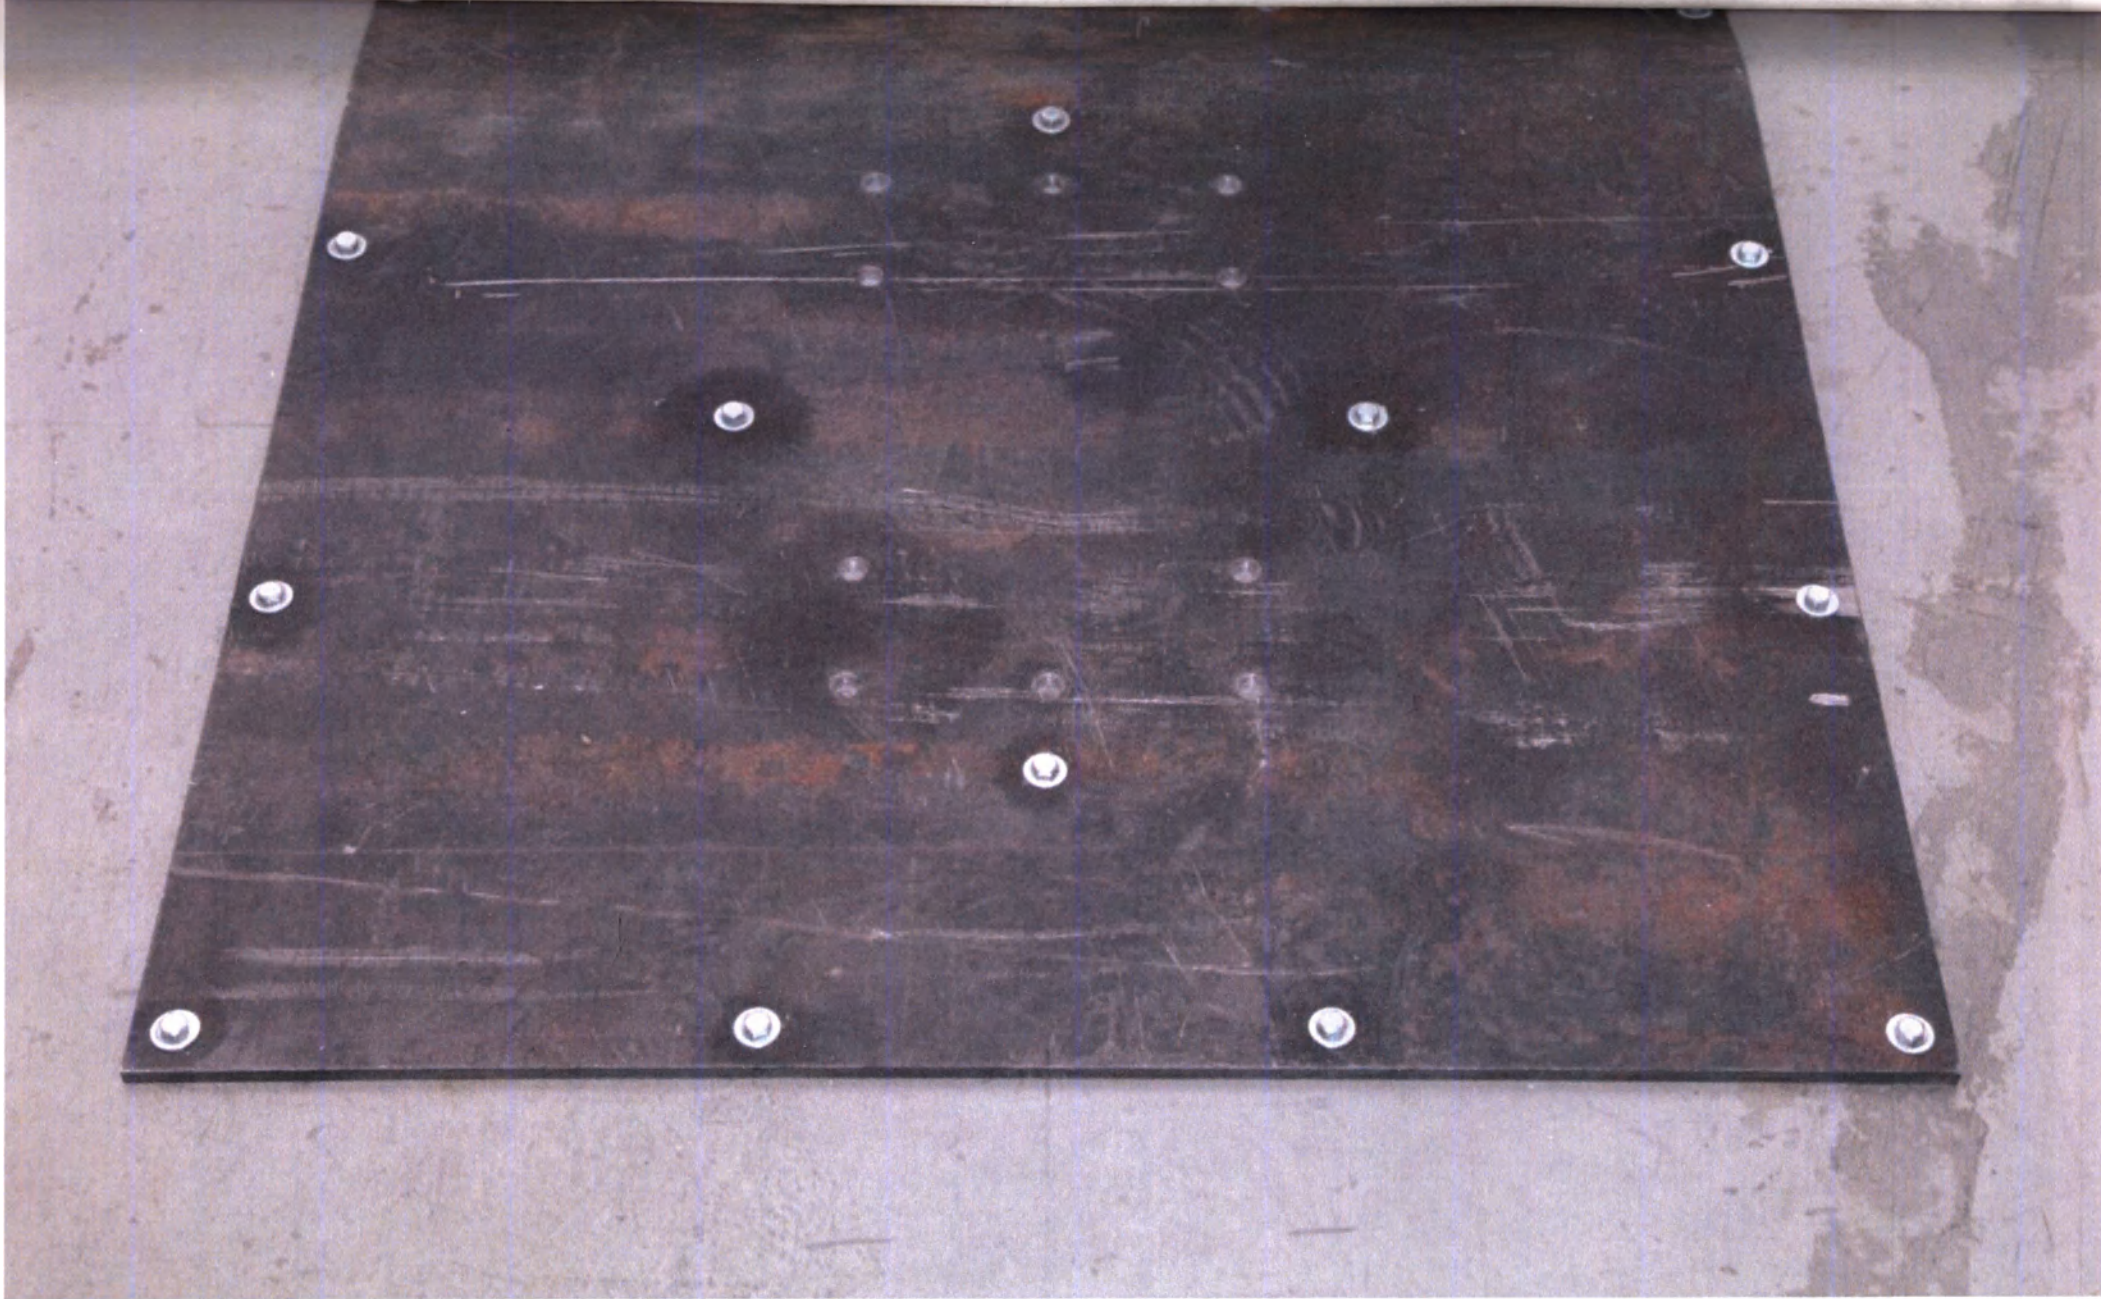


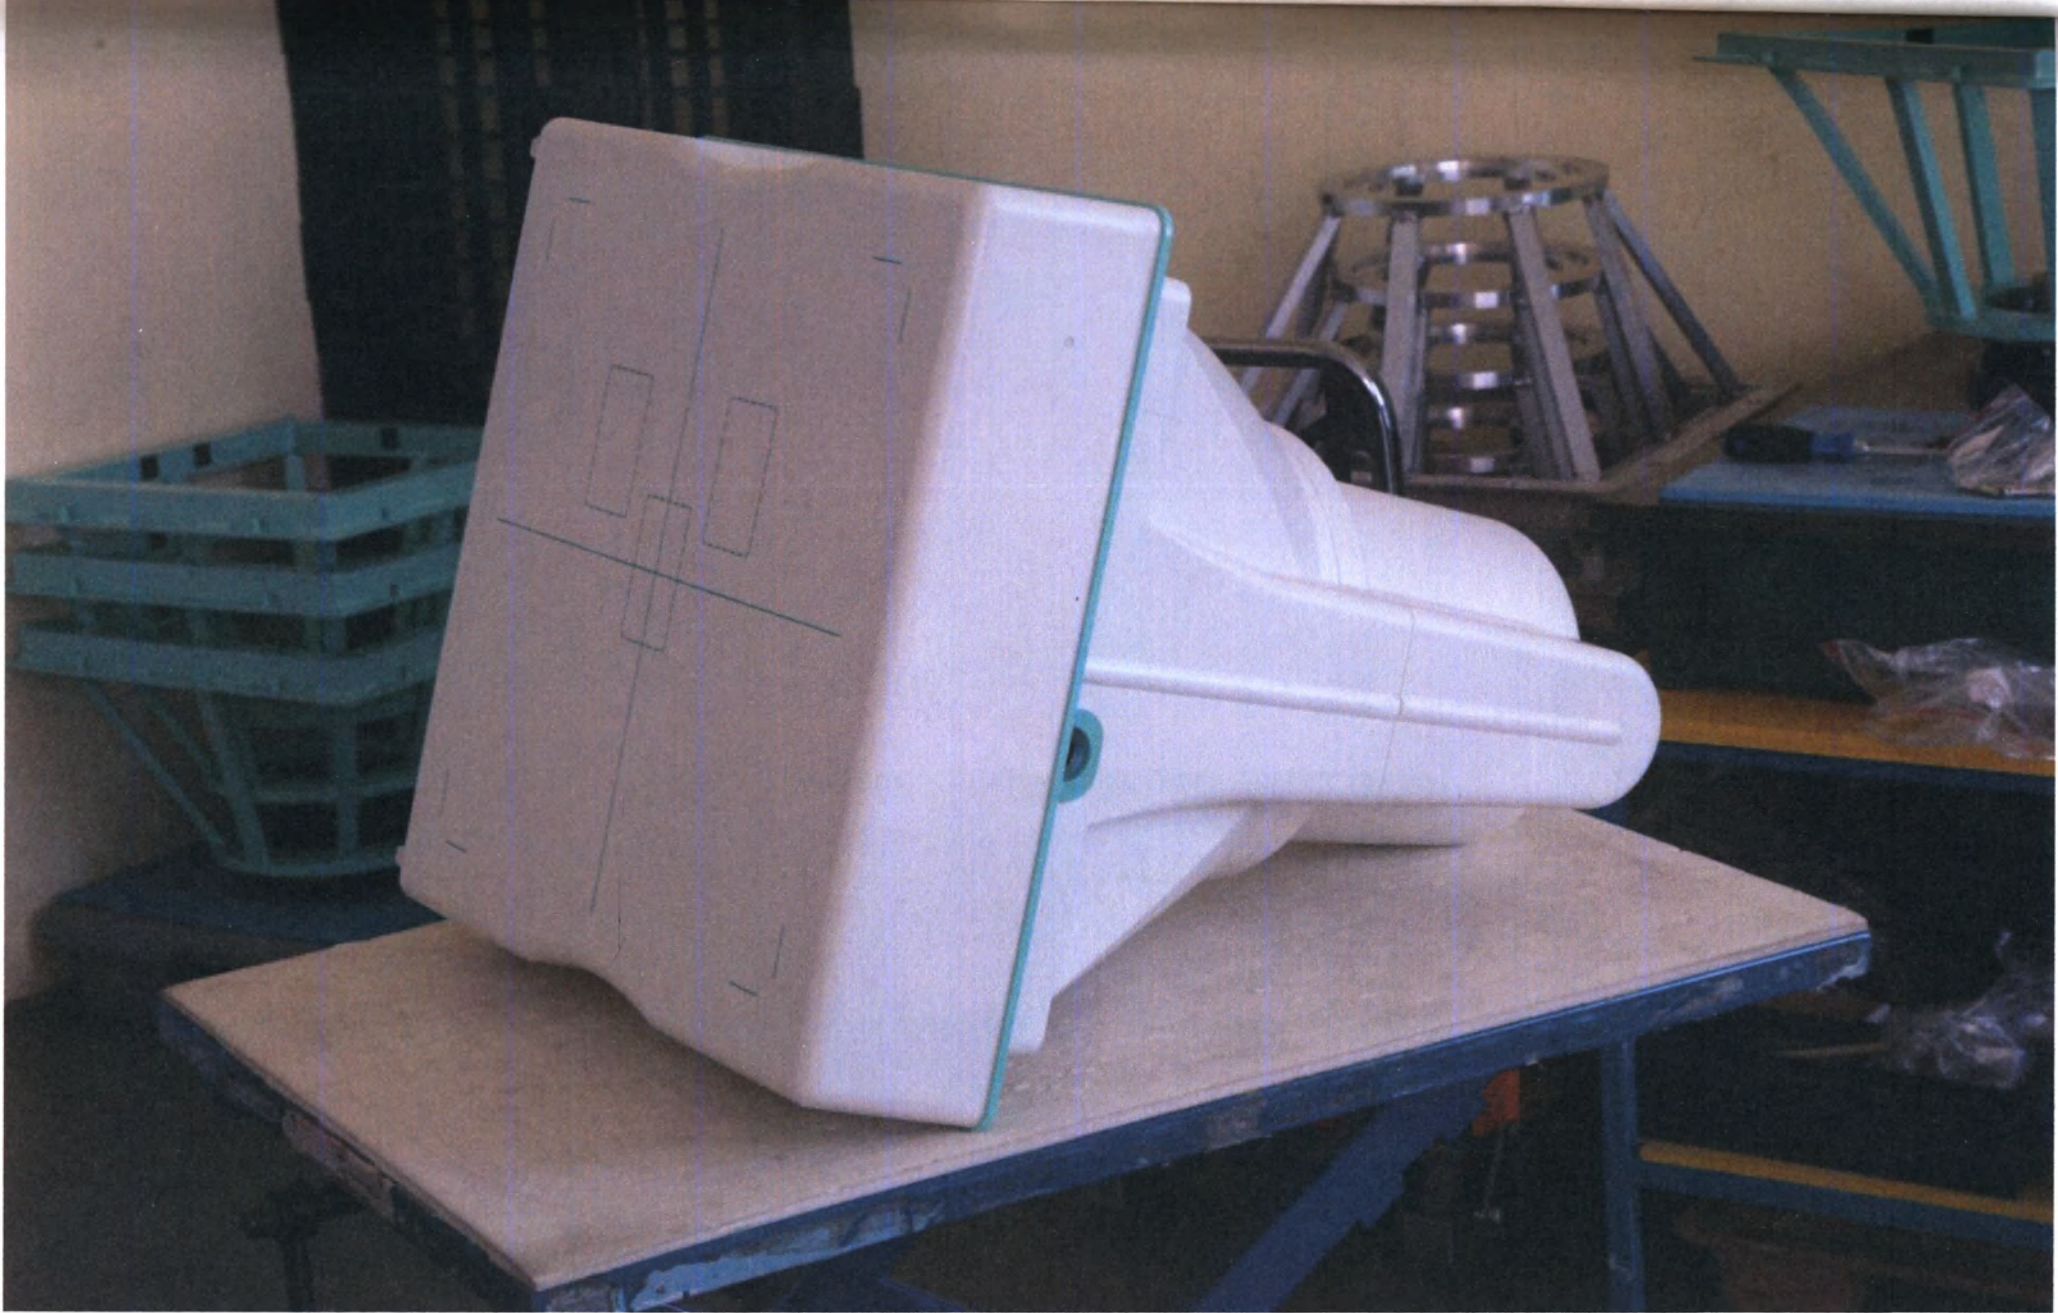

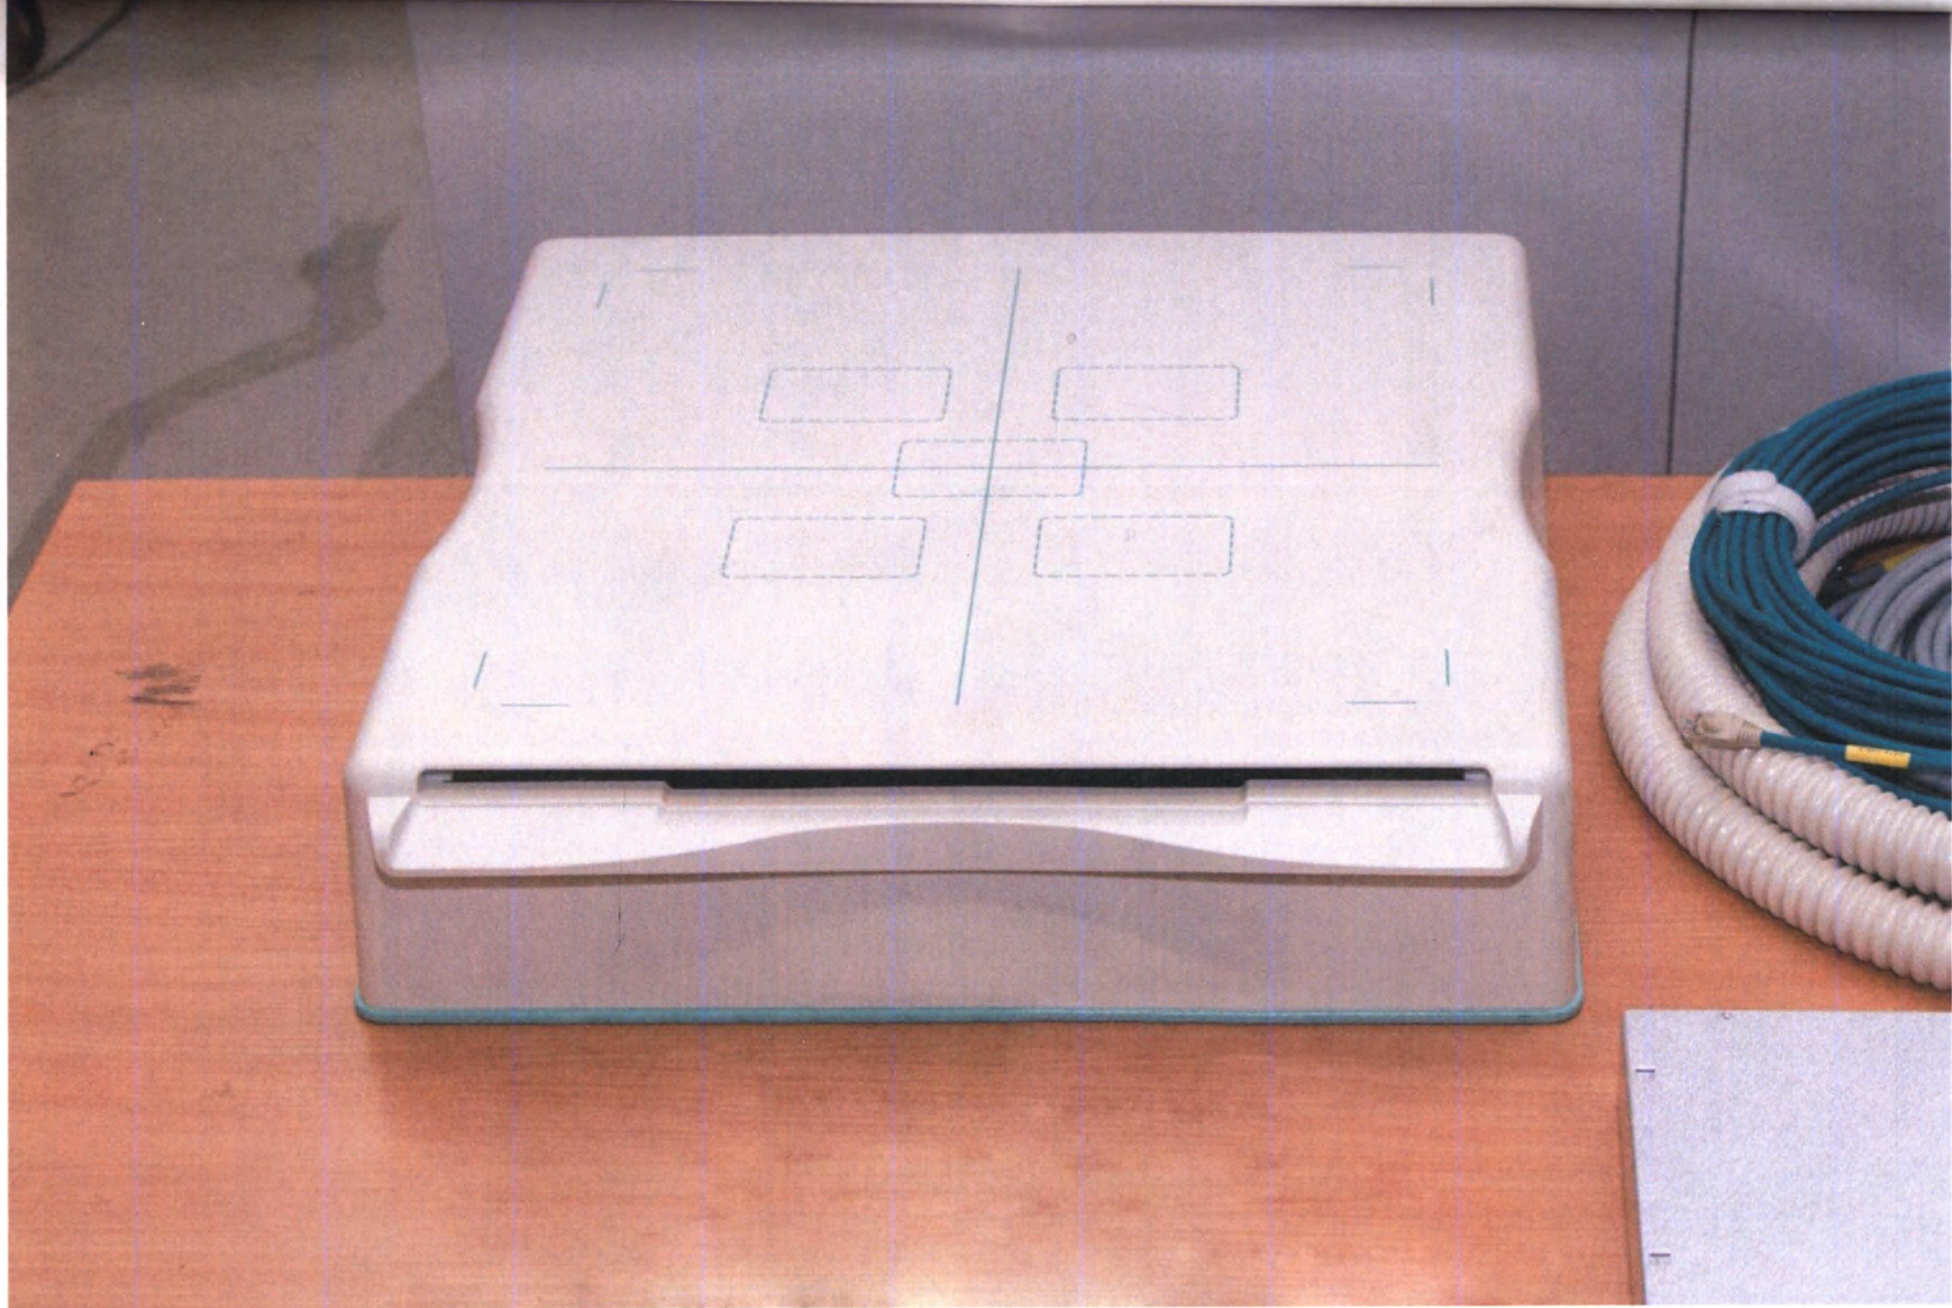

Детектор плоскостельный


Комплект кабелей

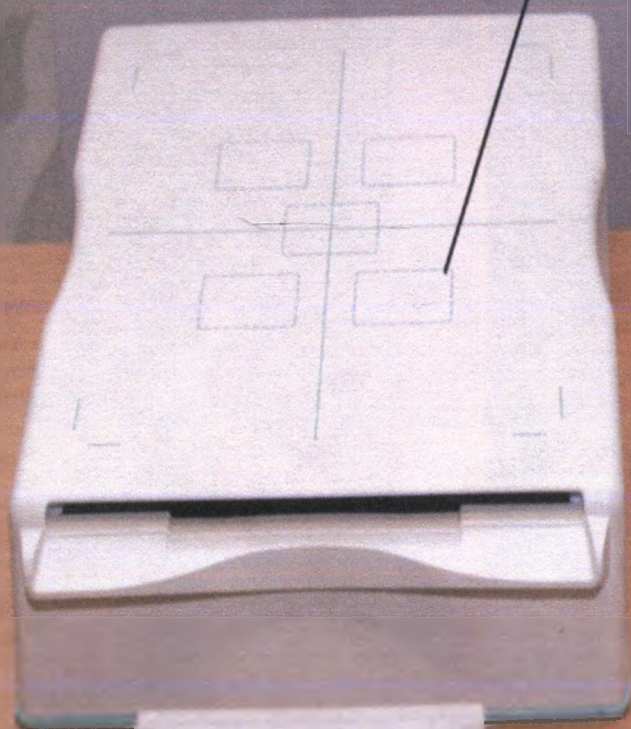

Блок питания

Блок сопряжения




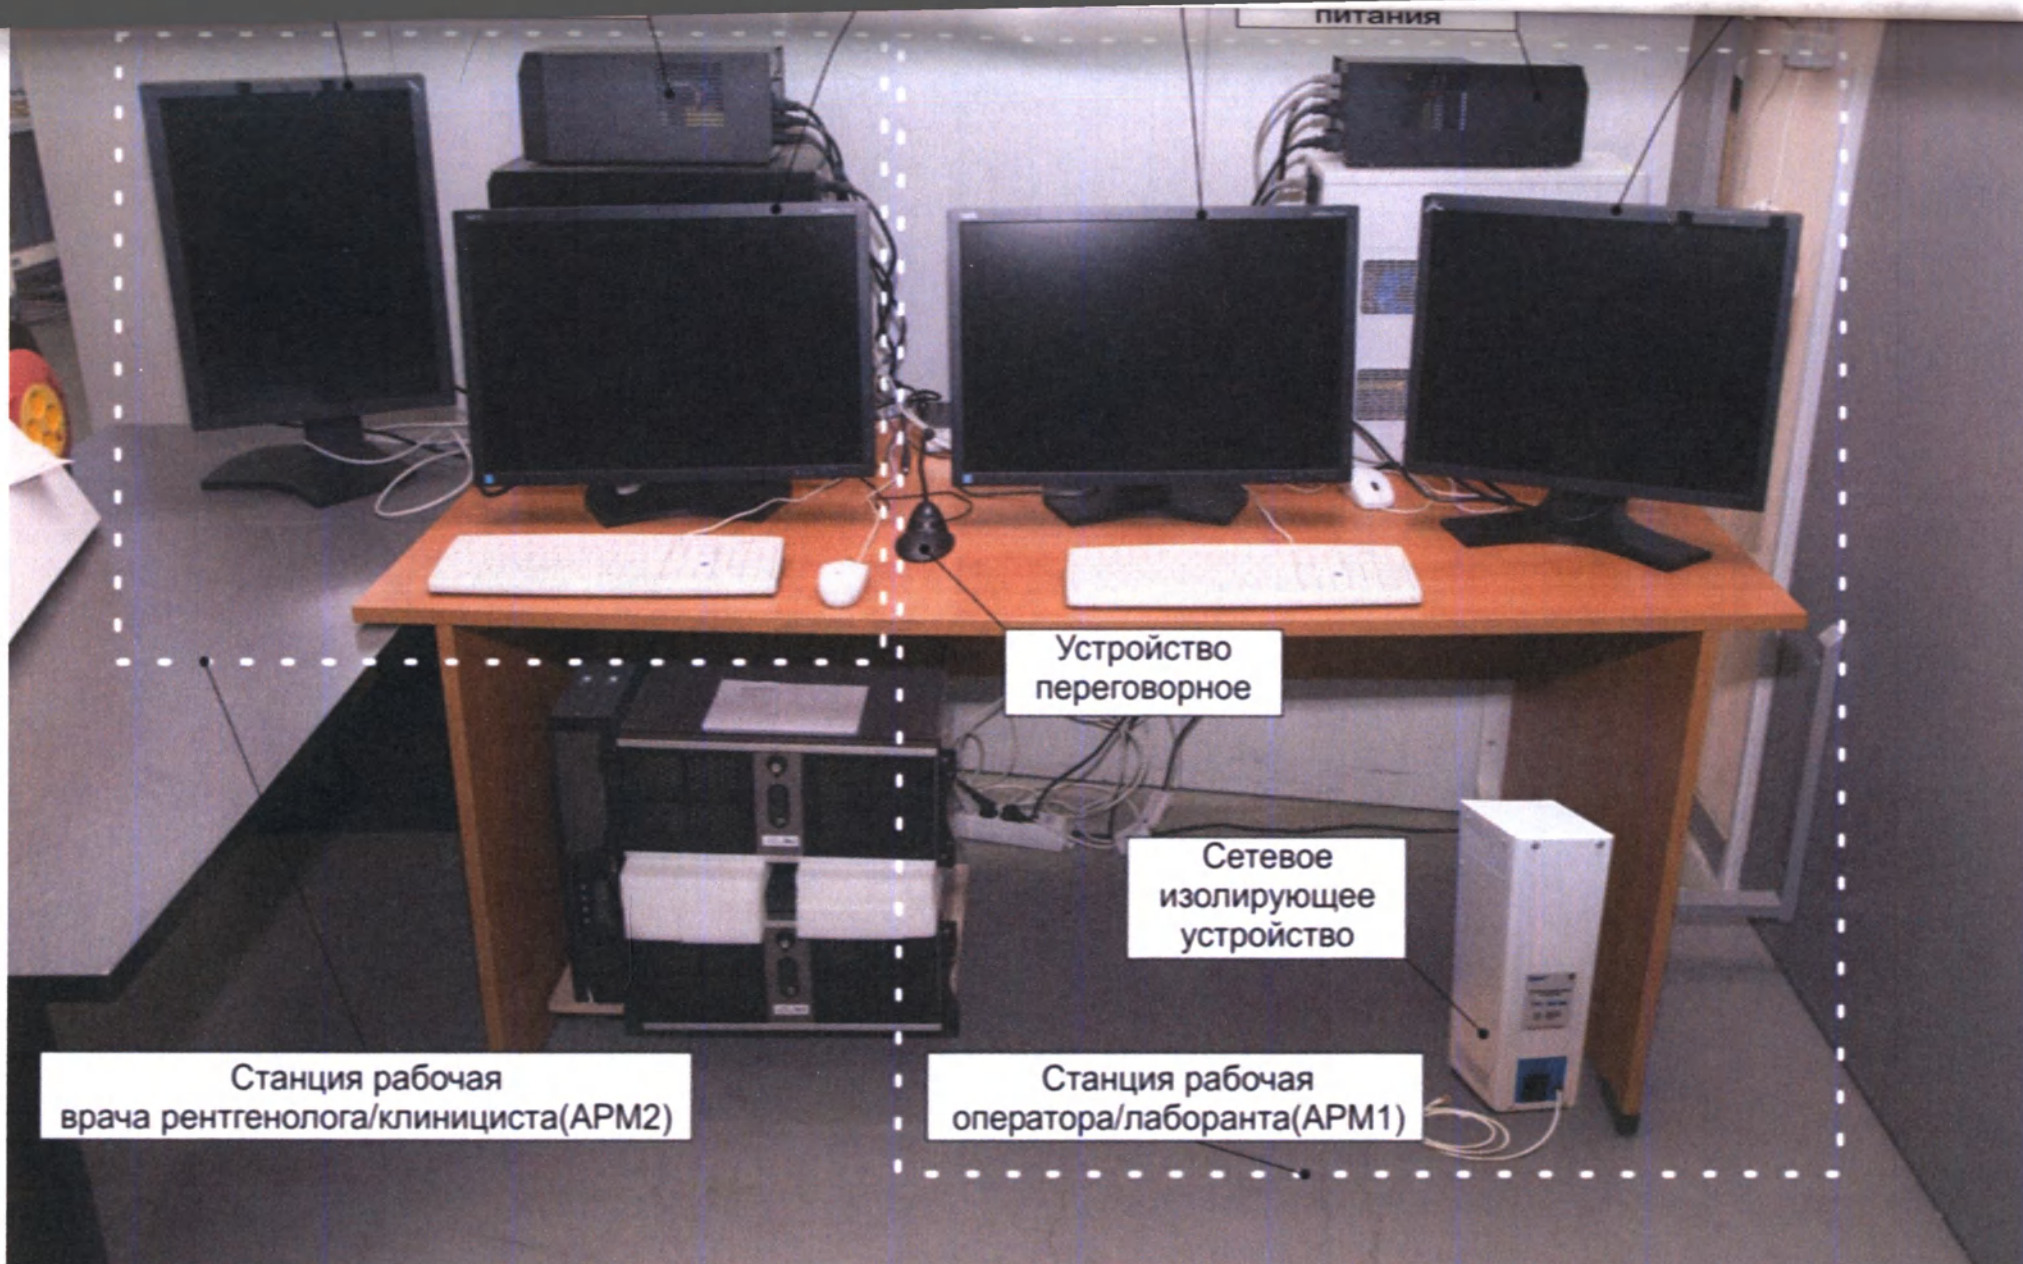

11. РПАК (рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс)- Станция рабочая оператора/лаборанта (APM1) Станция рабочая врача/рентгенолога/клинициста (APM2)





11. РПАК (рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс)- Станция рабочая регистратора/Web-доступа (АРМ3)

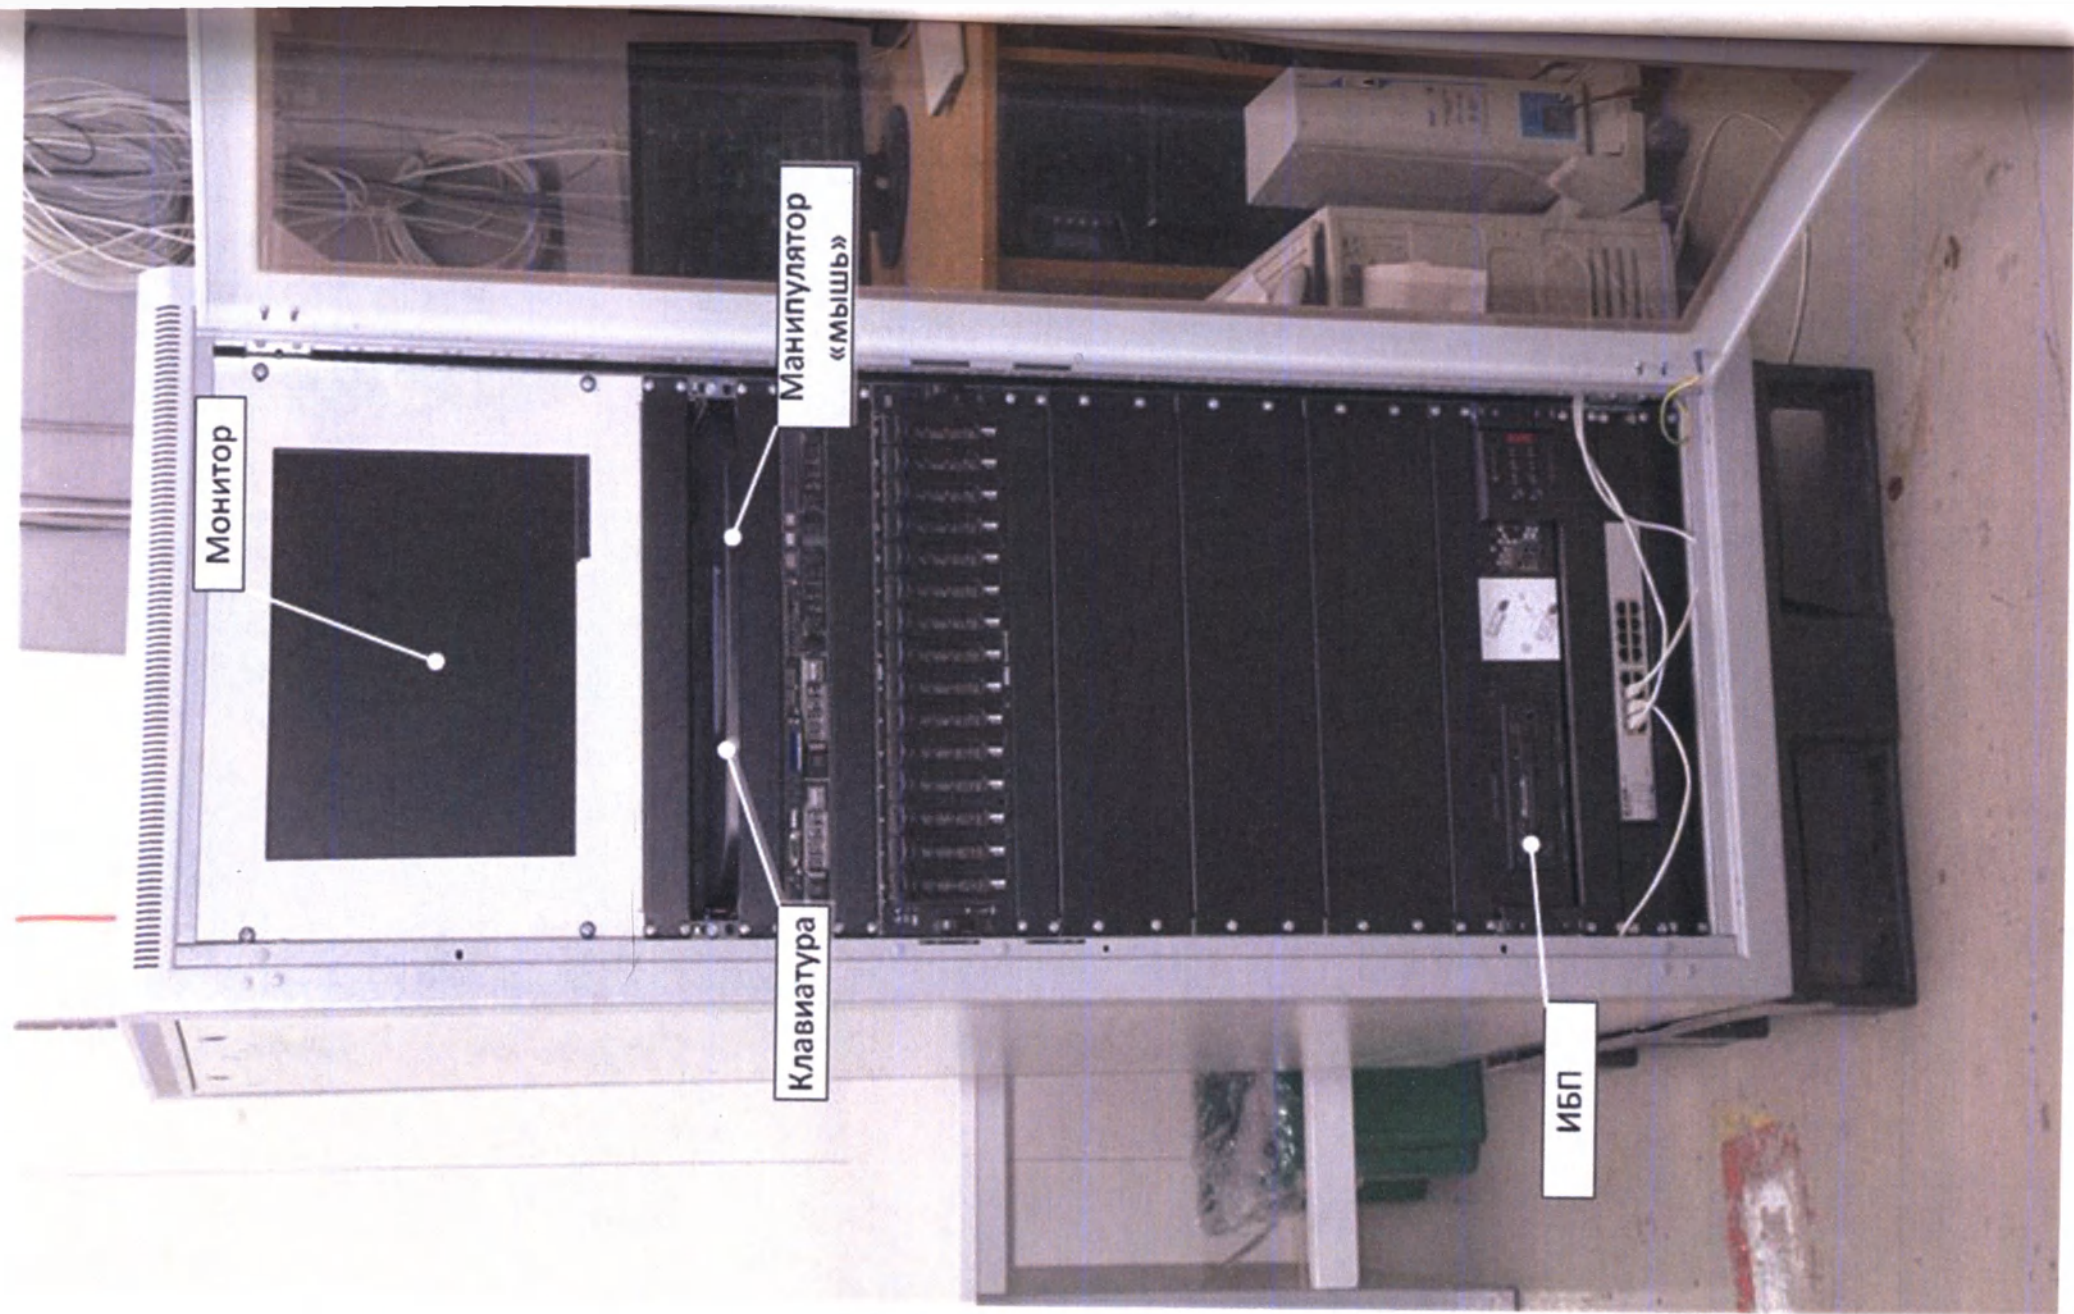

12. Комплекс программно-аппаратный ПАК – сервер



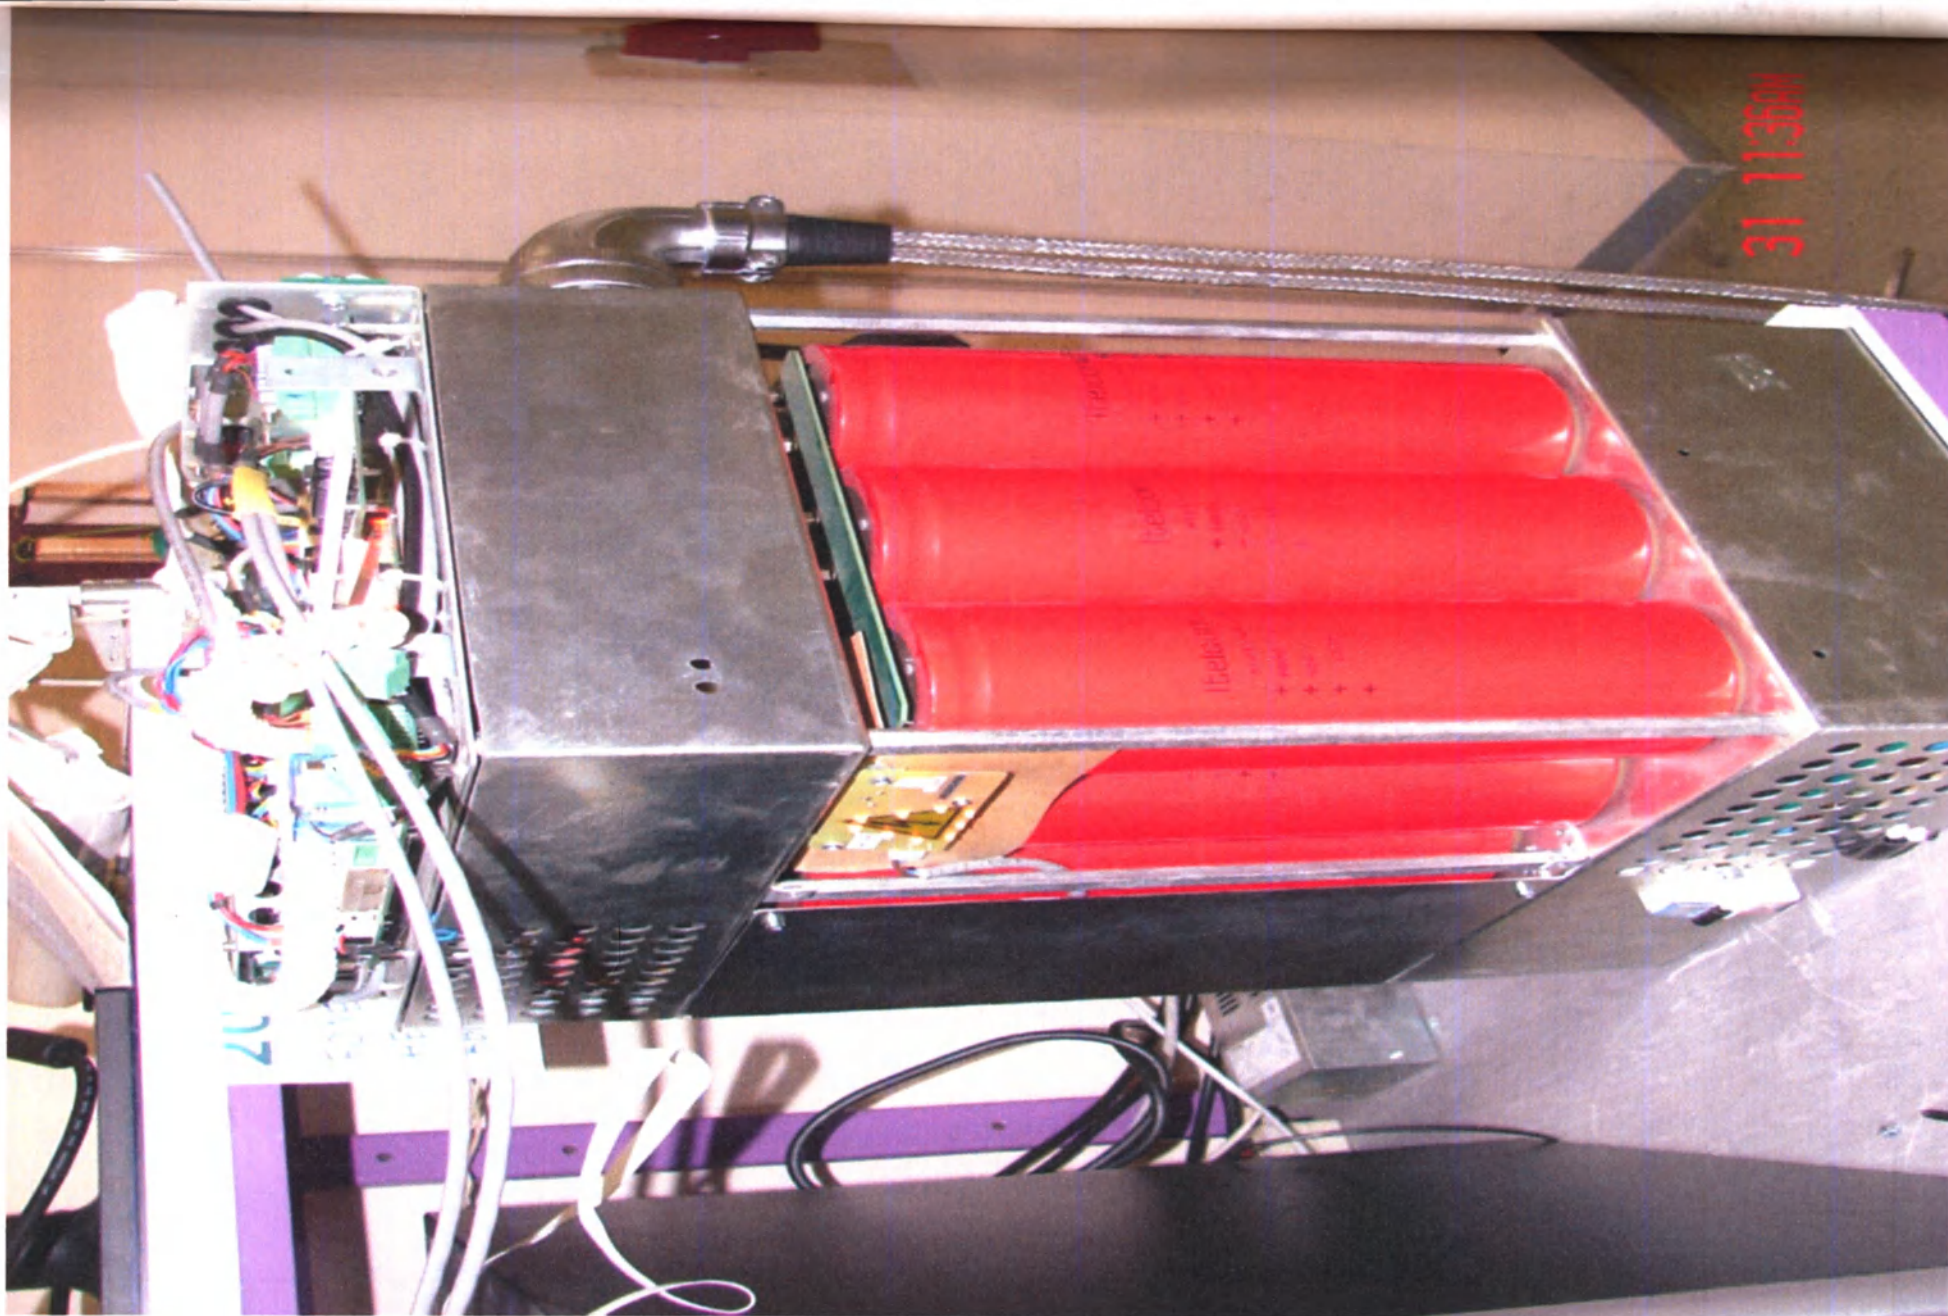


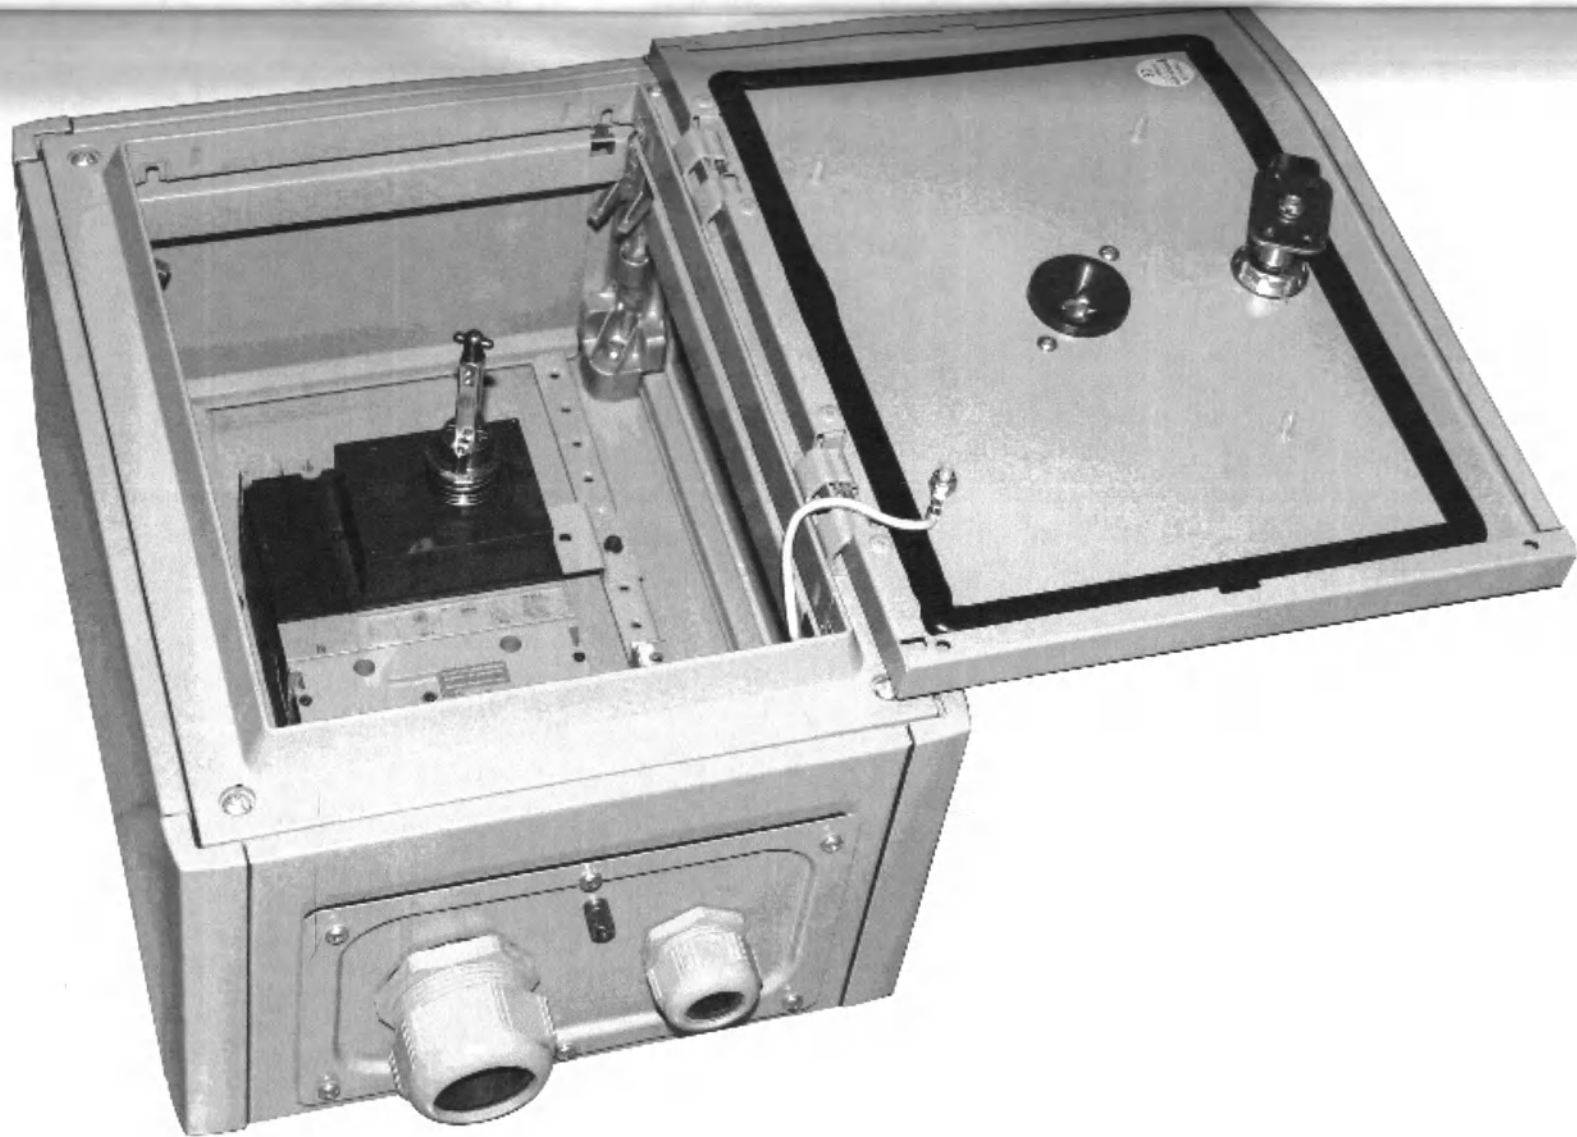

14. Шкаф питания и защиты



18. Дополнительное оборудование: 18.1. Окно рентгенозащитное серии MACO

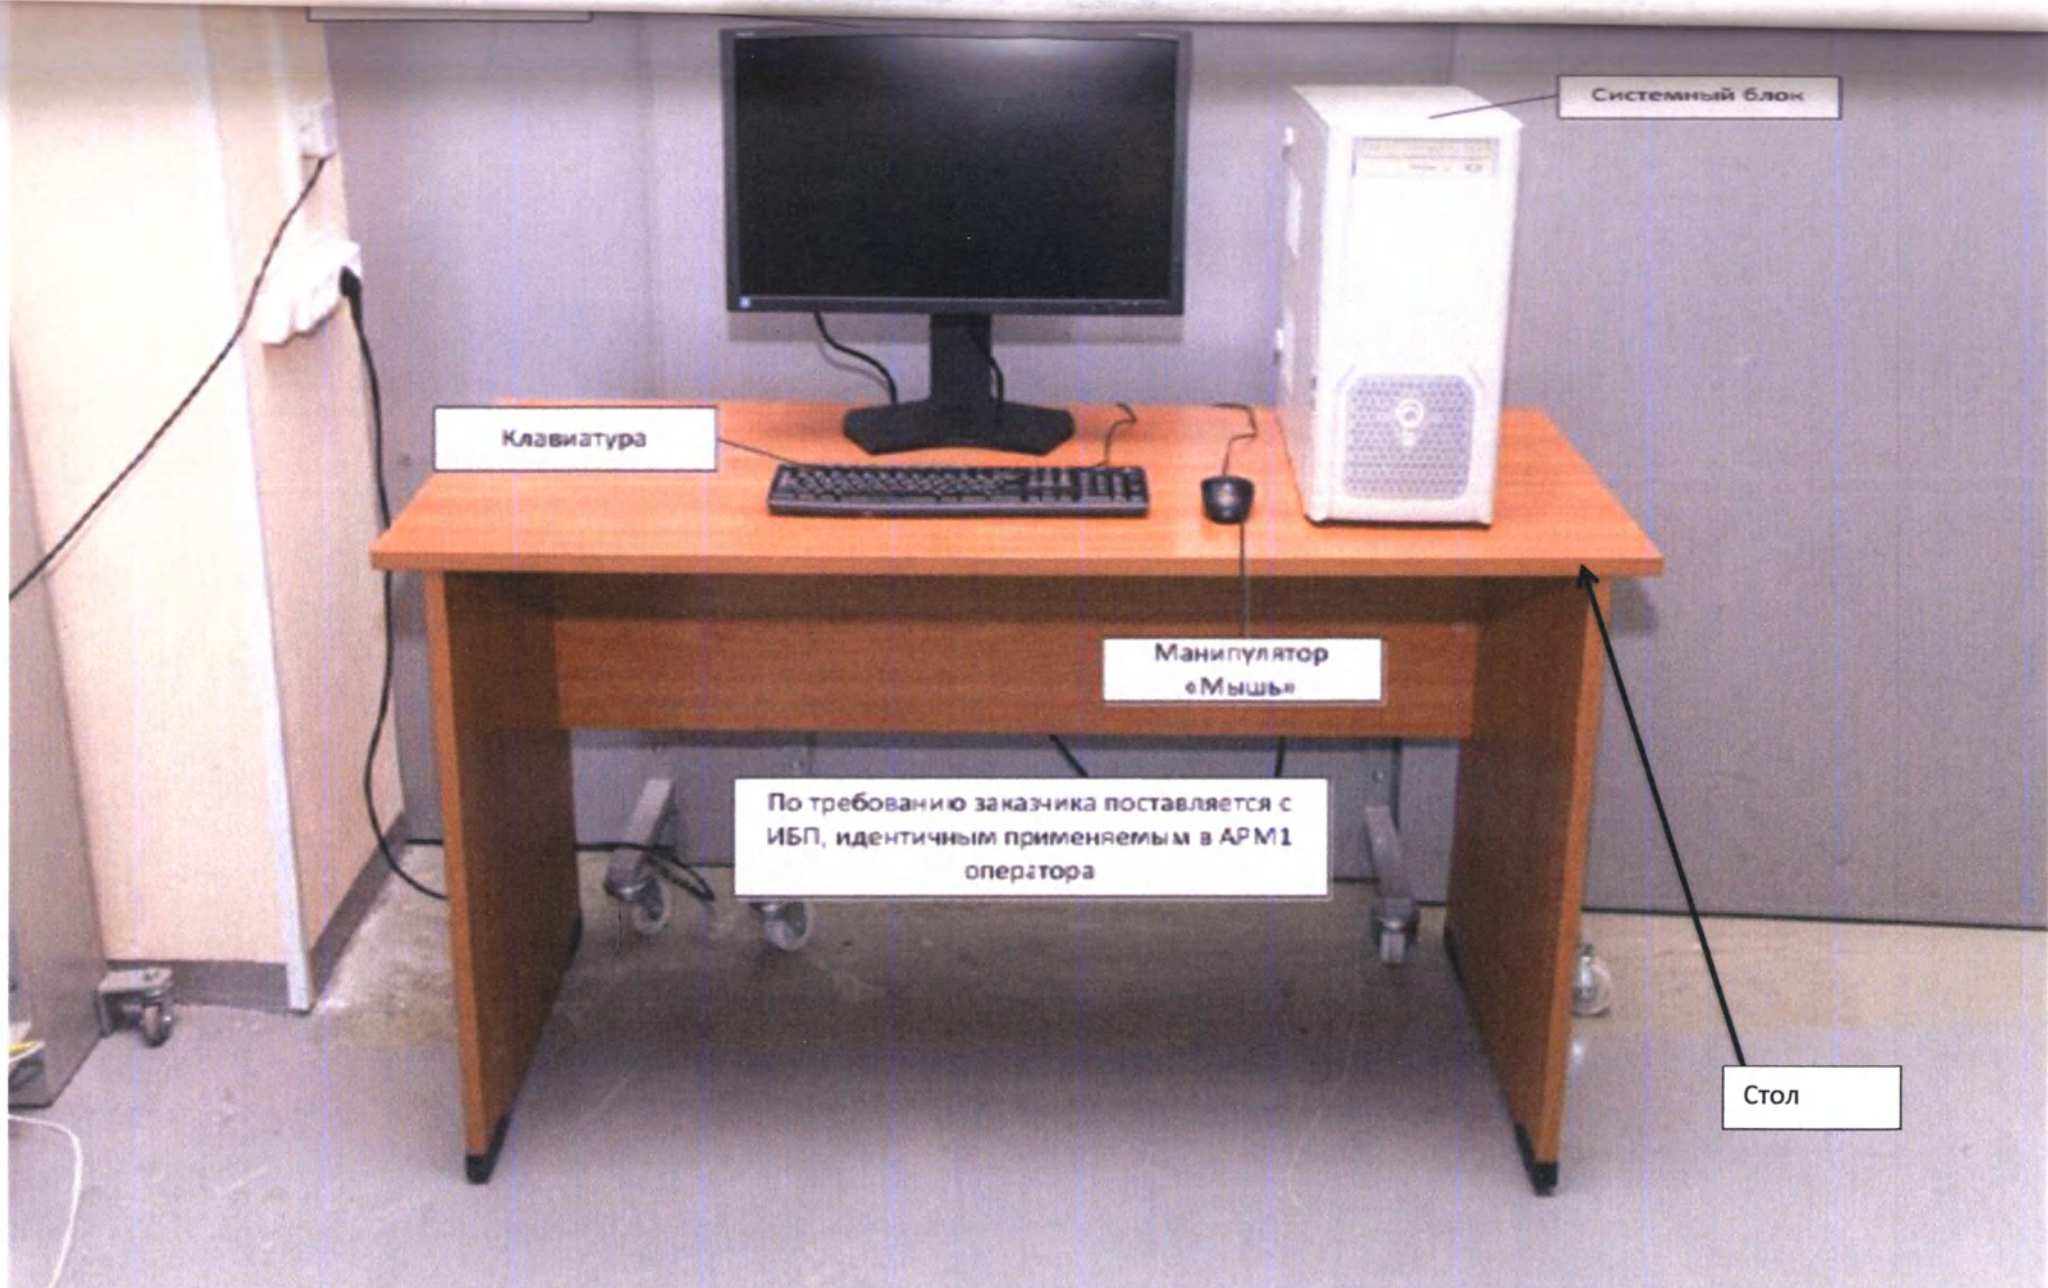




18.2. Комплект мебели: стул



18.2. Комплект мебели: кресло



18.2. Комплект мебели: тумба

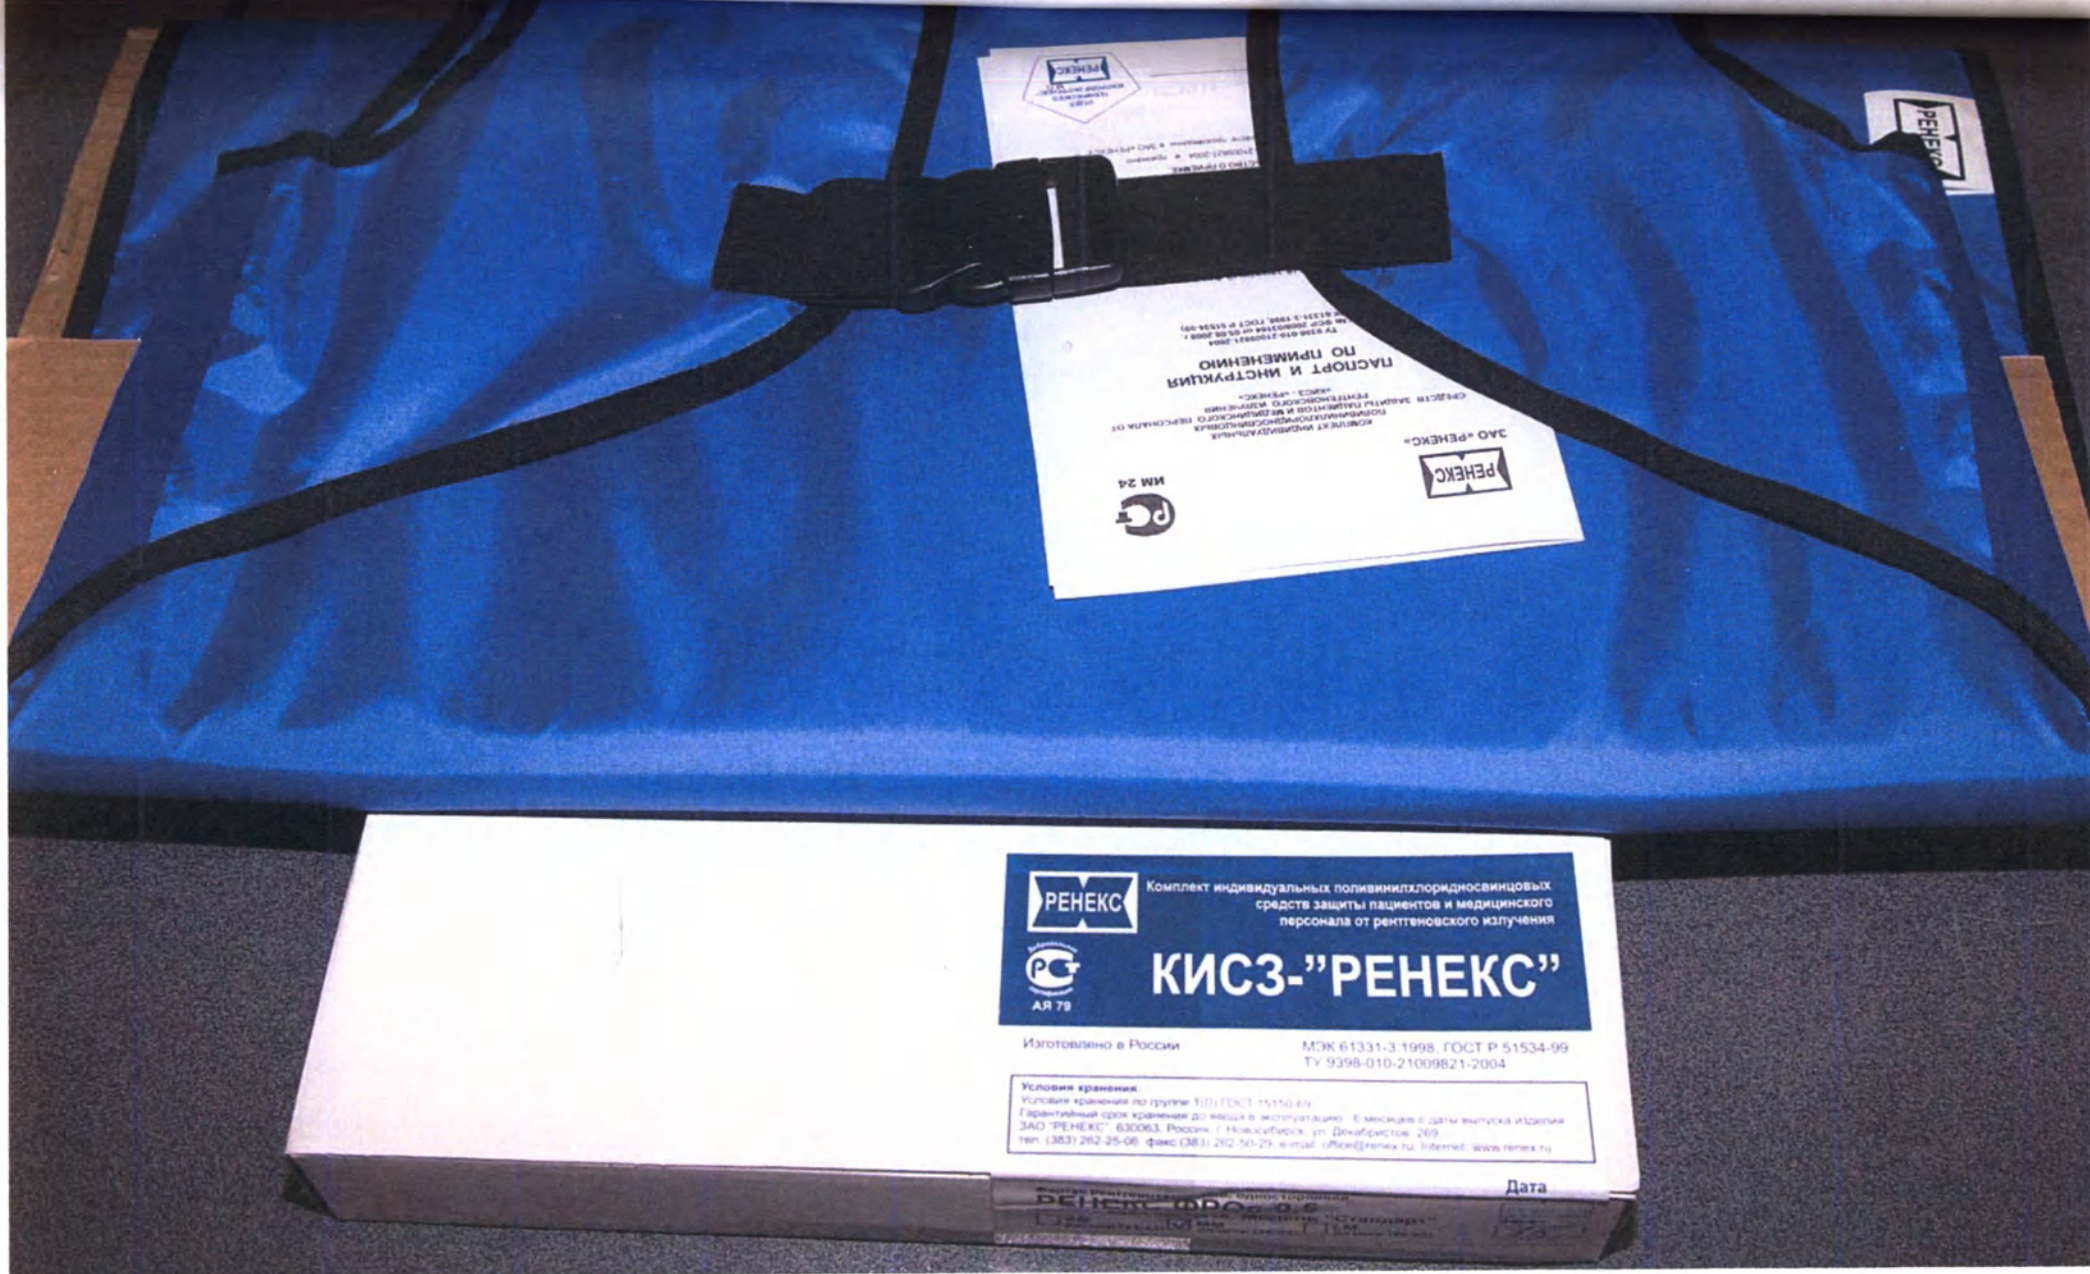

18.3. Комплект индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения: - жилет




- фартук



- воротник





Комплект индивидуальных поливинилхлоридных
средств защиты пациентов и медицин-
ского персонала от рентгеновского излучения

КИСЗ-"РЕНЕКС"

Изготовлено в России

МЭК 61331-3 1998, ГОСТ Р
ТУ 9398-010-21(00821-200)

Условия хранения:

Условия хранения по группе 1 по ГОСТ 15150-80

Гарантийный срок хранения до конца эксплуатации - 6 месяцев с даты выпуска

ЗАО "РЕНЕКС", 630083, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 203,

тел. (383) 262-25-06, факс (383) 262-60-28, e-mail: info@reneks.ru, Internet: www.reneks.ru



Комплект индивидуальных поливинилхлоридно-свинцовых
средств защиты пациентов и медицинского
персонала от рентгеновского излучения

КИСЗ-"РЕНЕКС"

Изготовлено в России

МЭК 61331-3-1998, ГОСТ Р 51534-99
ТУ 9398-010-21009821-2004

Условия хранения

Условия хранения по группе 1(3) ГОСТ 15150-09.
Гарантийный срок хранения до ввода в эксплуатацию - 6 месяцев с даты выпуска изделия.
ЗАО "РЕНЕКС", 630063, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269.
тел. (383) 262-25-06, факс (383) 262-50-29, e-mail: office@renex.ru, Internet: www.renex.ru

Дата

- набор рентгенозащитных пластин

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



18.4 Дозиметр серии ДРК



18.5. Монтажный комплект

Прошито, пронум.
скреплено печатью.

