





Генеральный директор
ООО «ГРУППА АЛЪЯНС»
Маханова Е.А.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


**Устройство для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов под
торговой маркой Centron
Производства «Центрон Корпорейшн» (Centron Corporation), Корея**

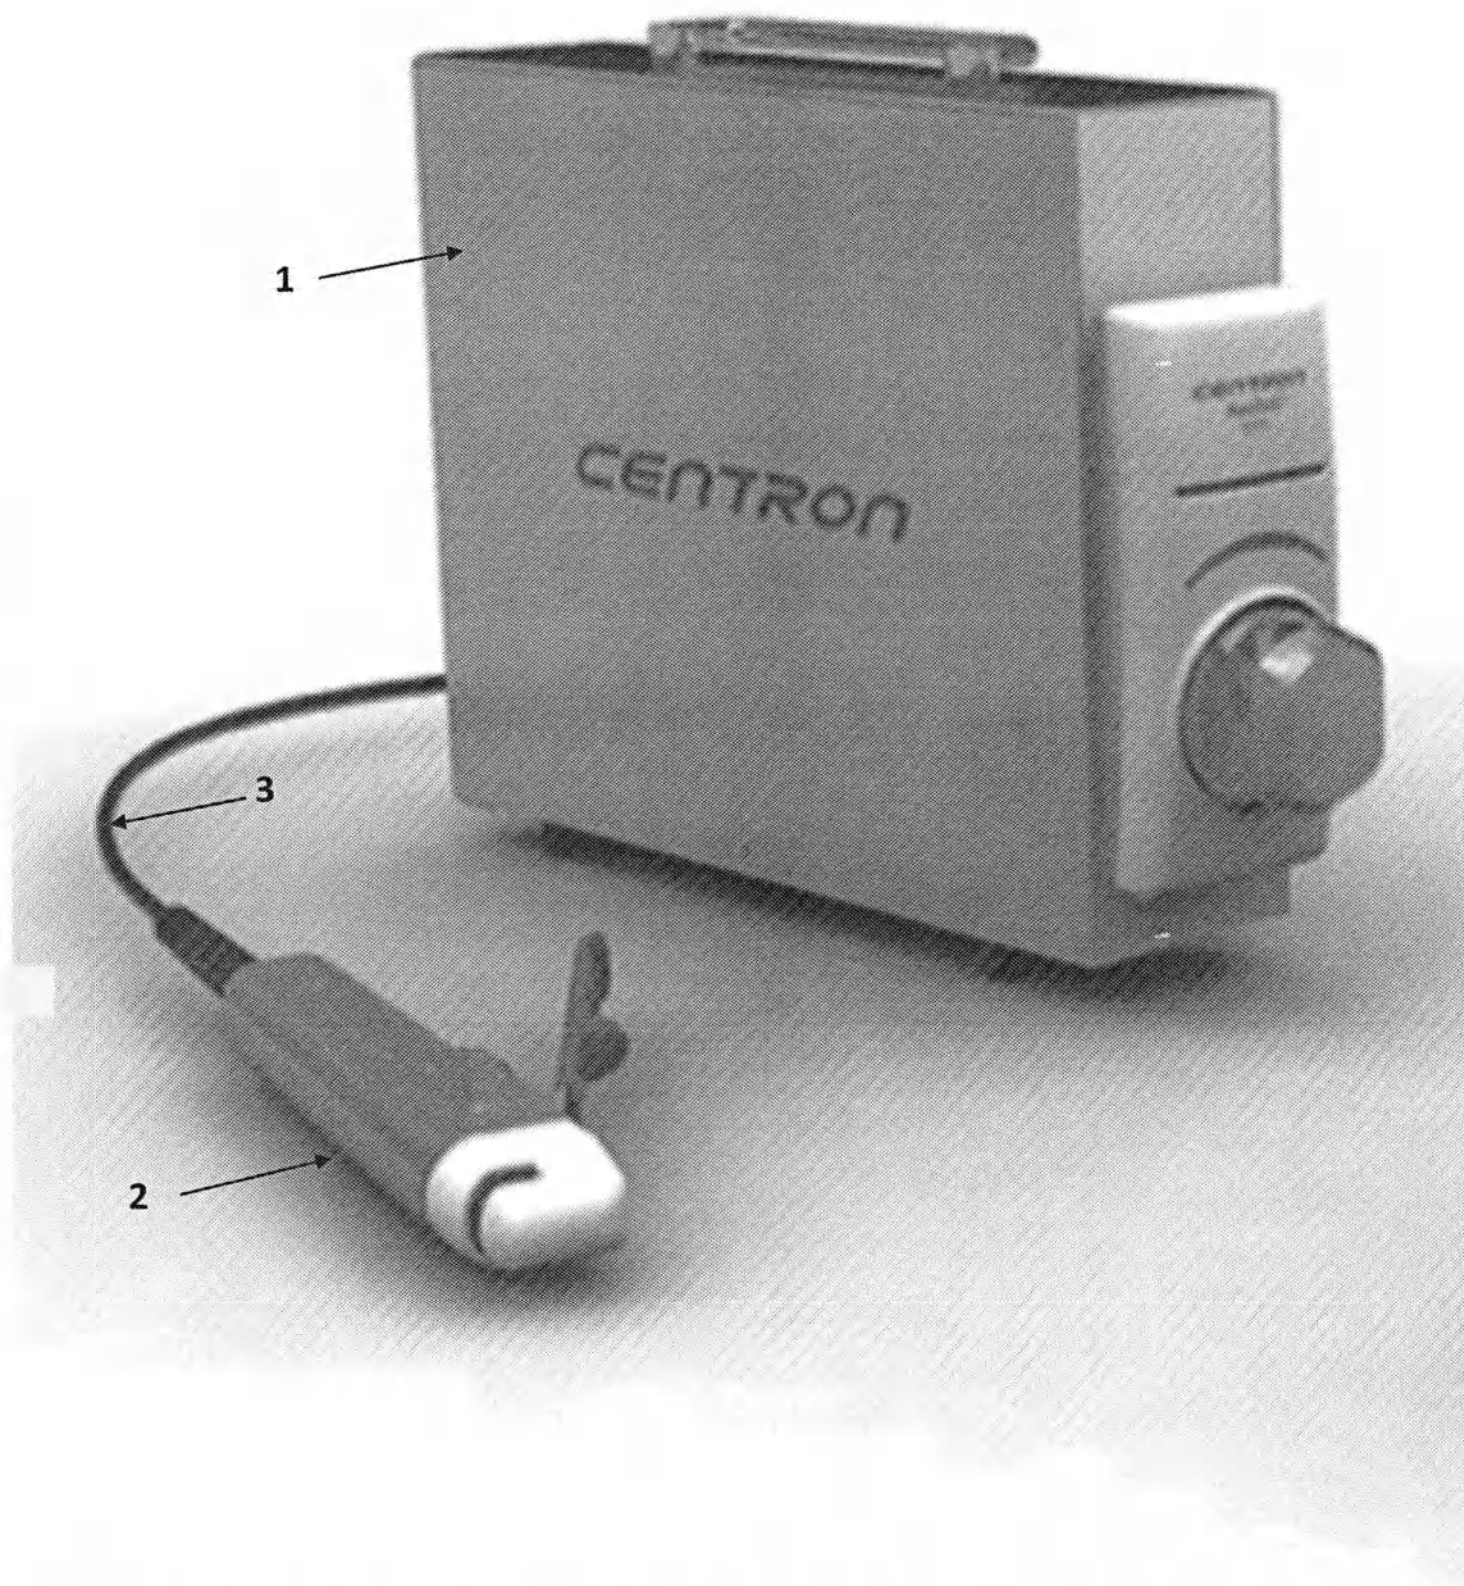


Устройство для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE160
(1 – основной блок модель SE160, 2 – выносное запаивающее устройство модель 200-038A, 3 – коаксиальный кабель
высокочастотный модель 8219 rg-58a/u, производитель Belden CDT Inc, США)

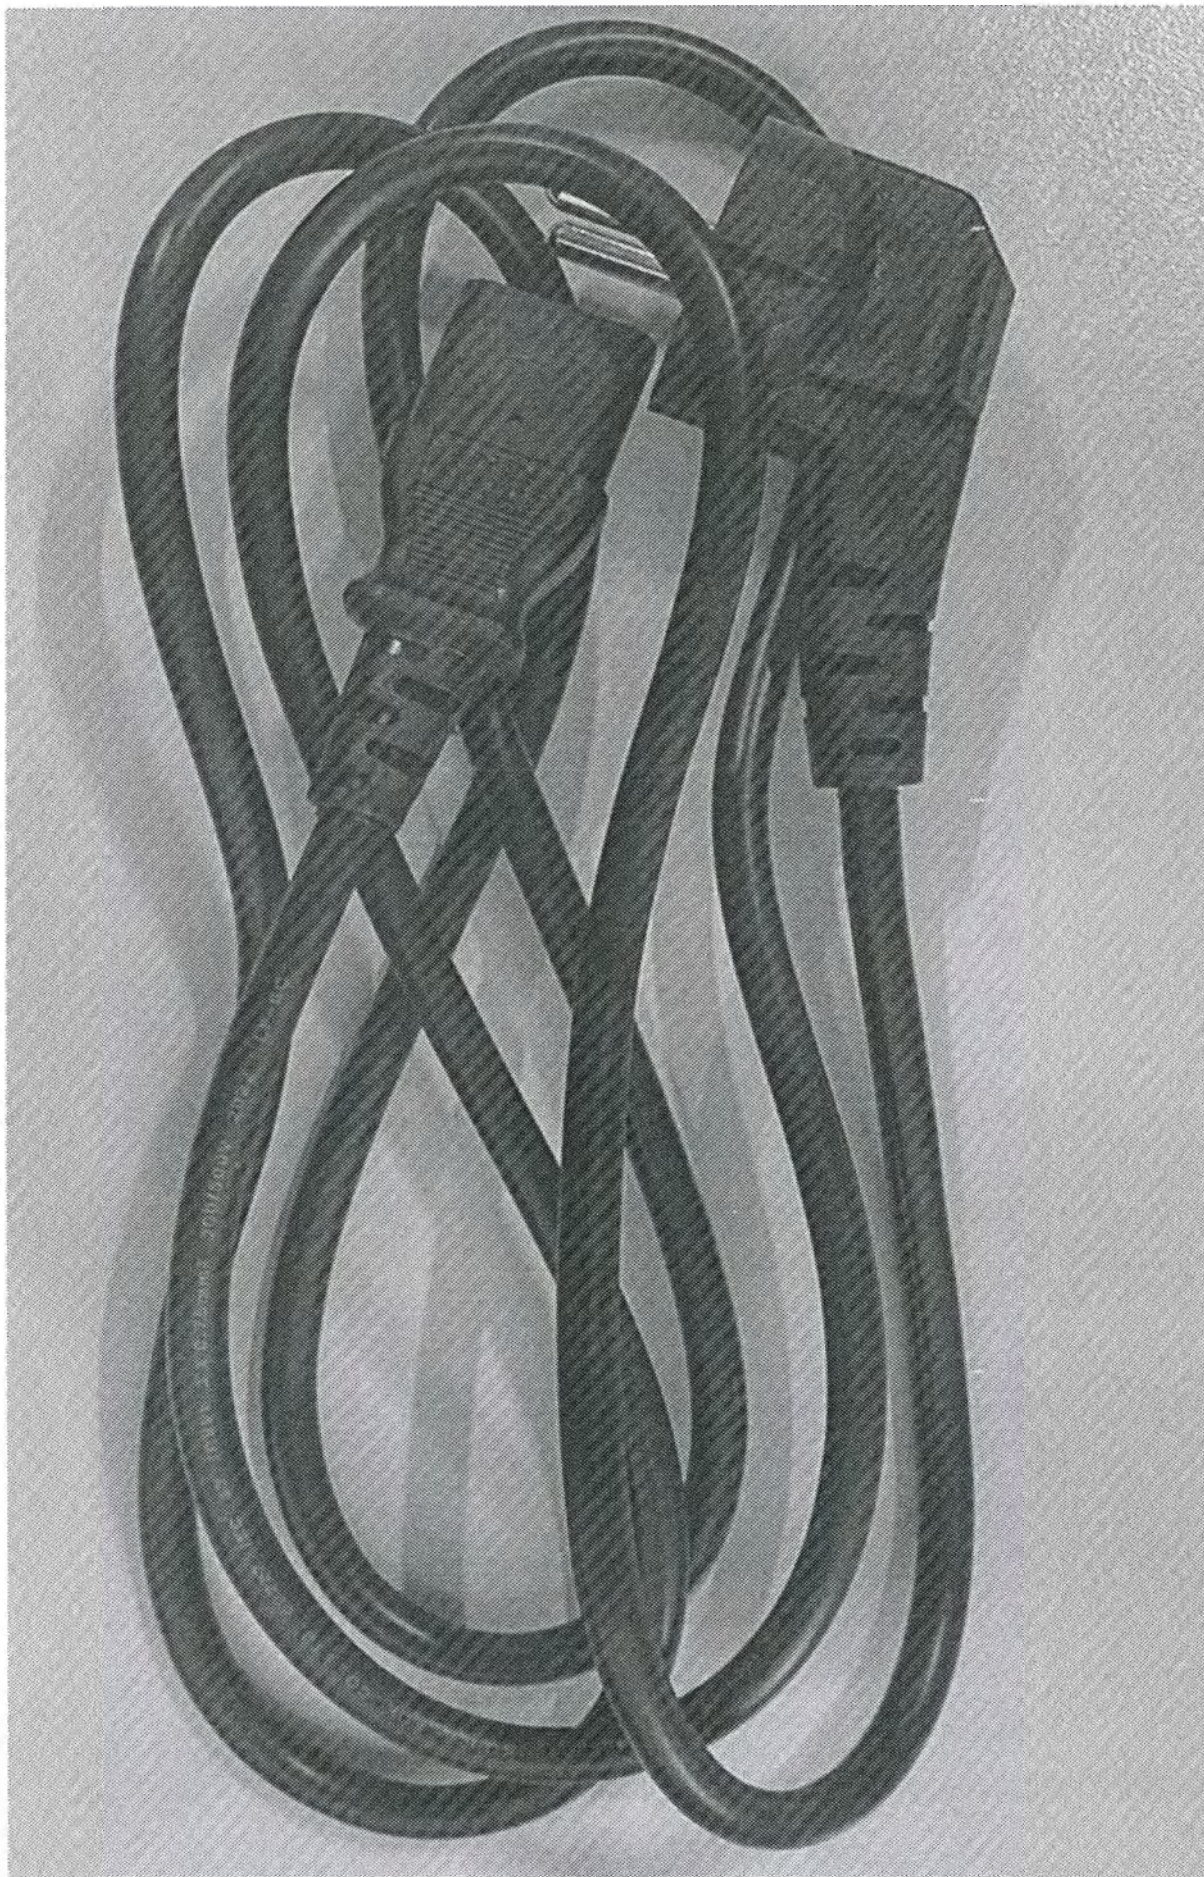


Шнур питания переменного тока 220-240 В модель КОСЕ-3 Н05VV-F 3x0,75 мм² 300/500 В, производства Korea KDK Co. Ltd., Корея

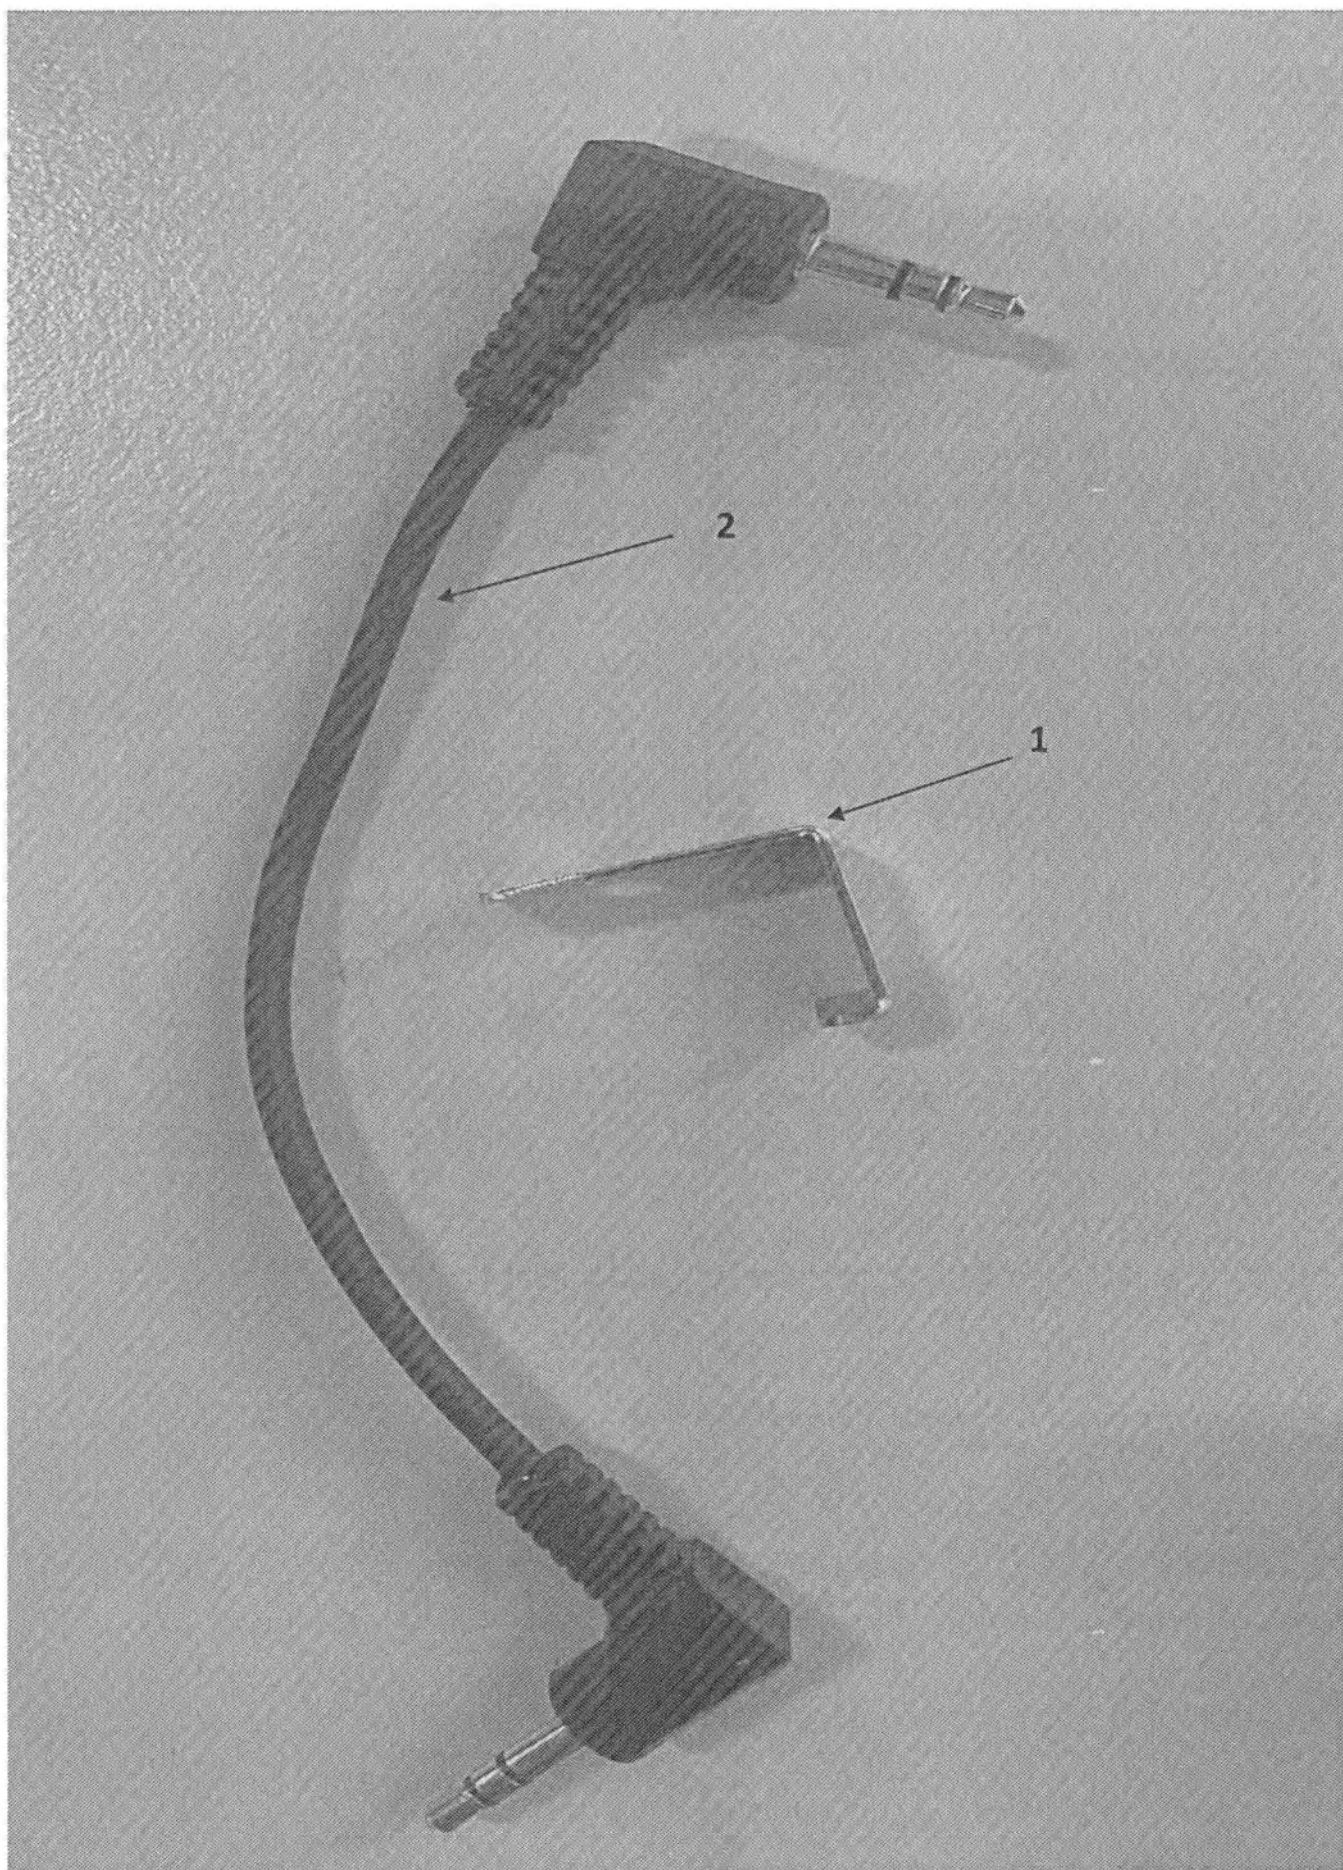


Комплект подключения (1- кронштейн спускового рычага, 2 – кабель сигнальный)

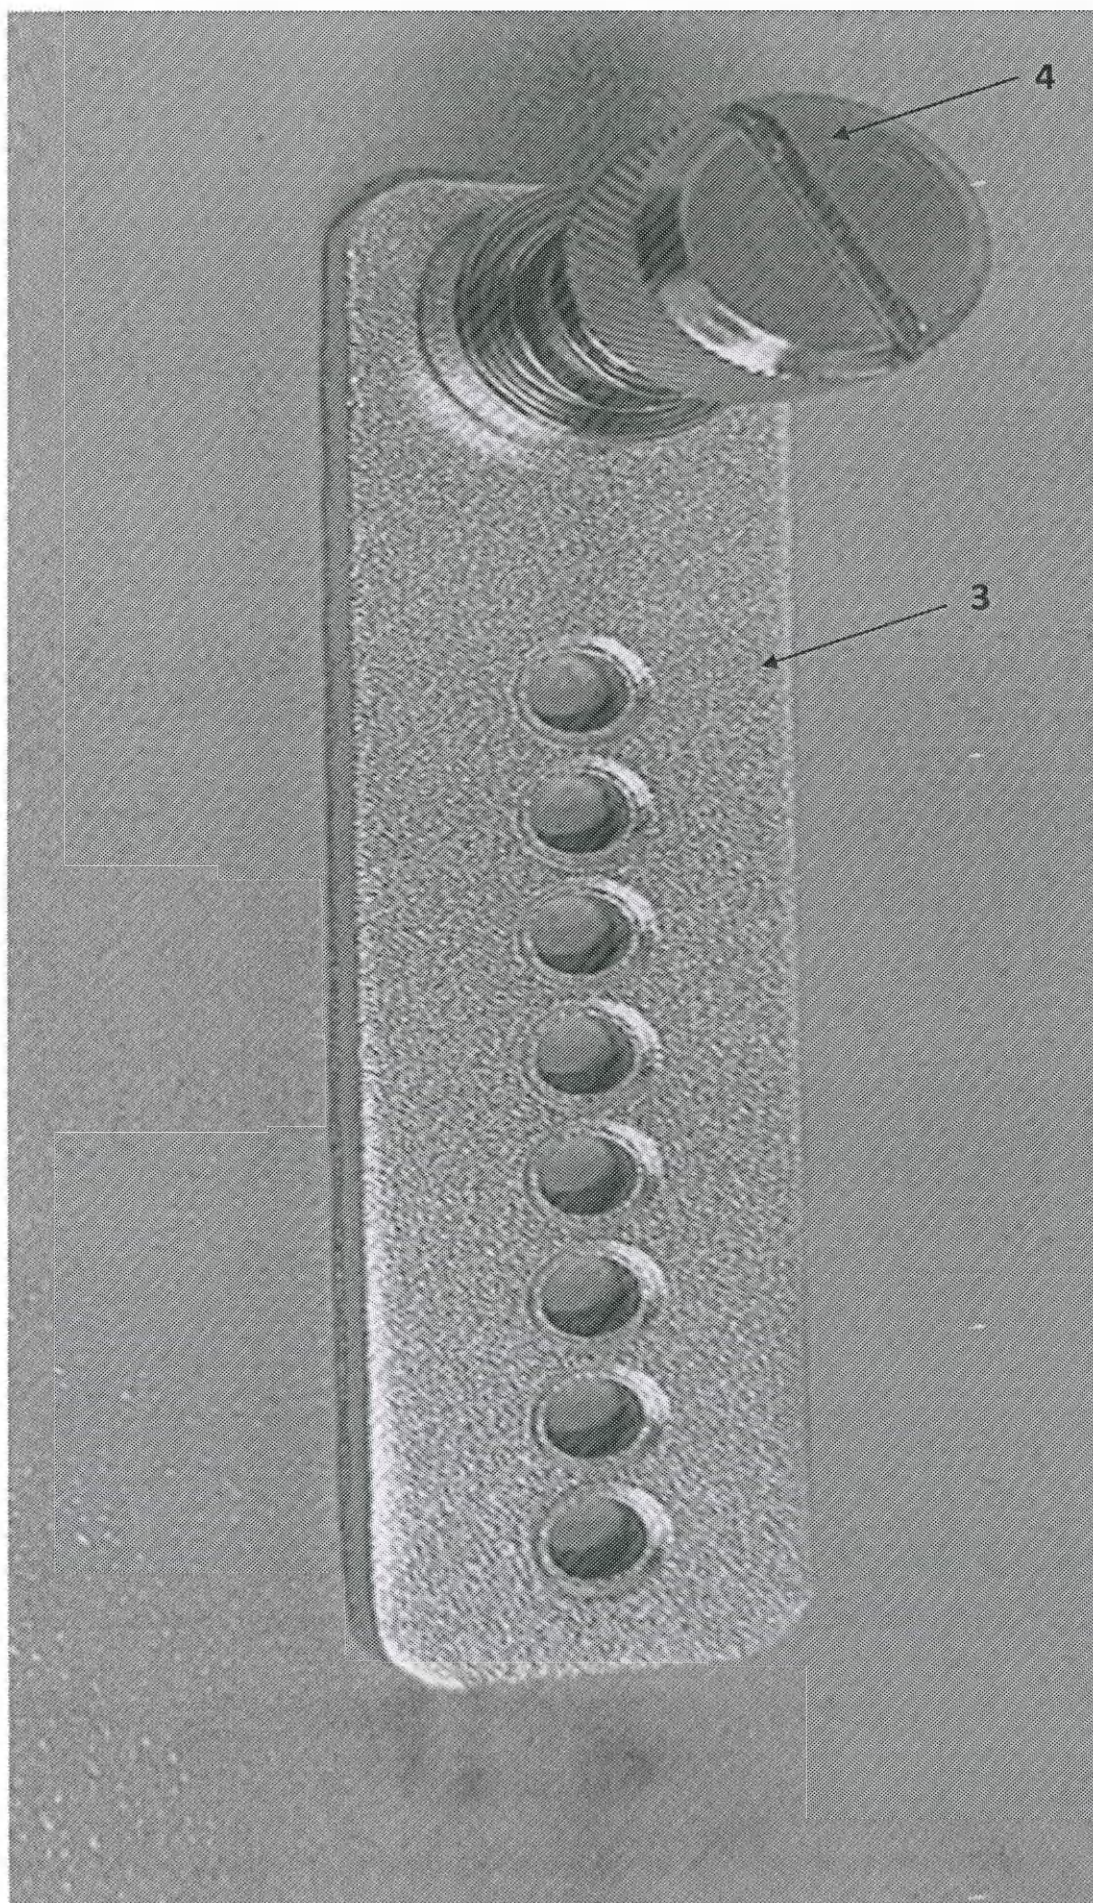



Комплект подключения (3 – соединительная планка, 4 – винт)

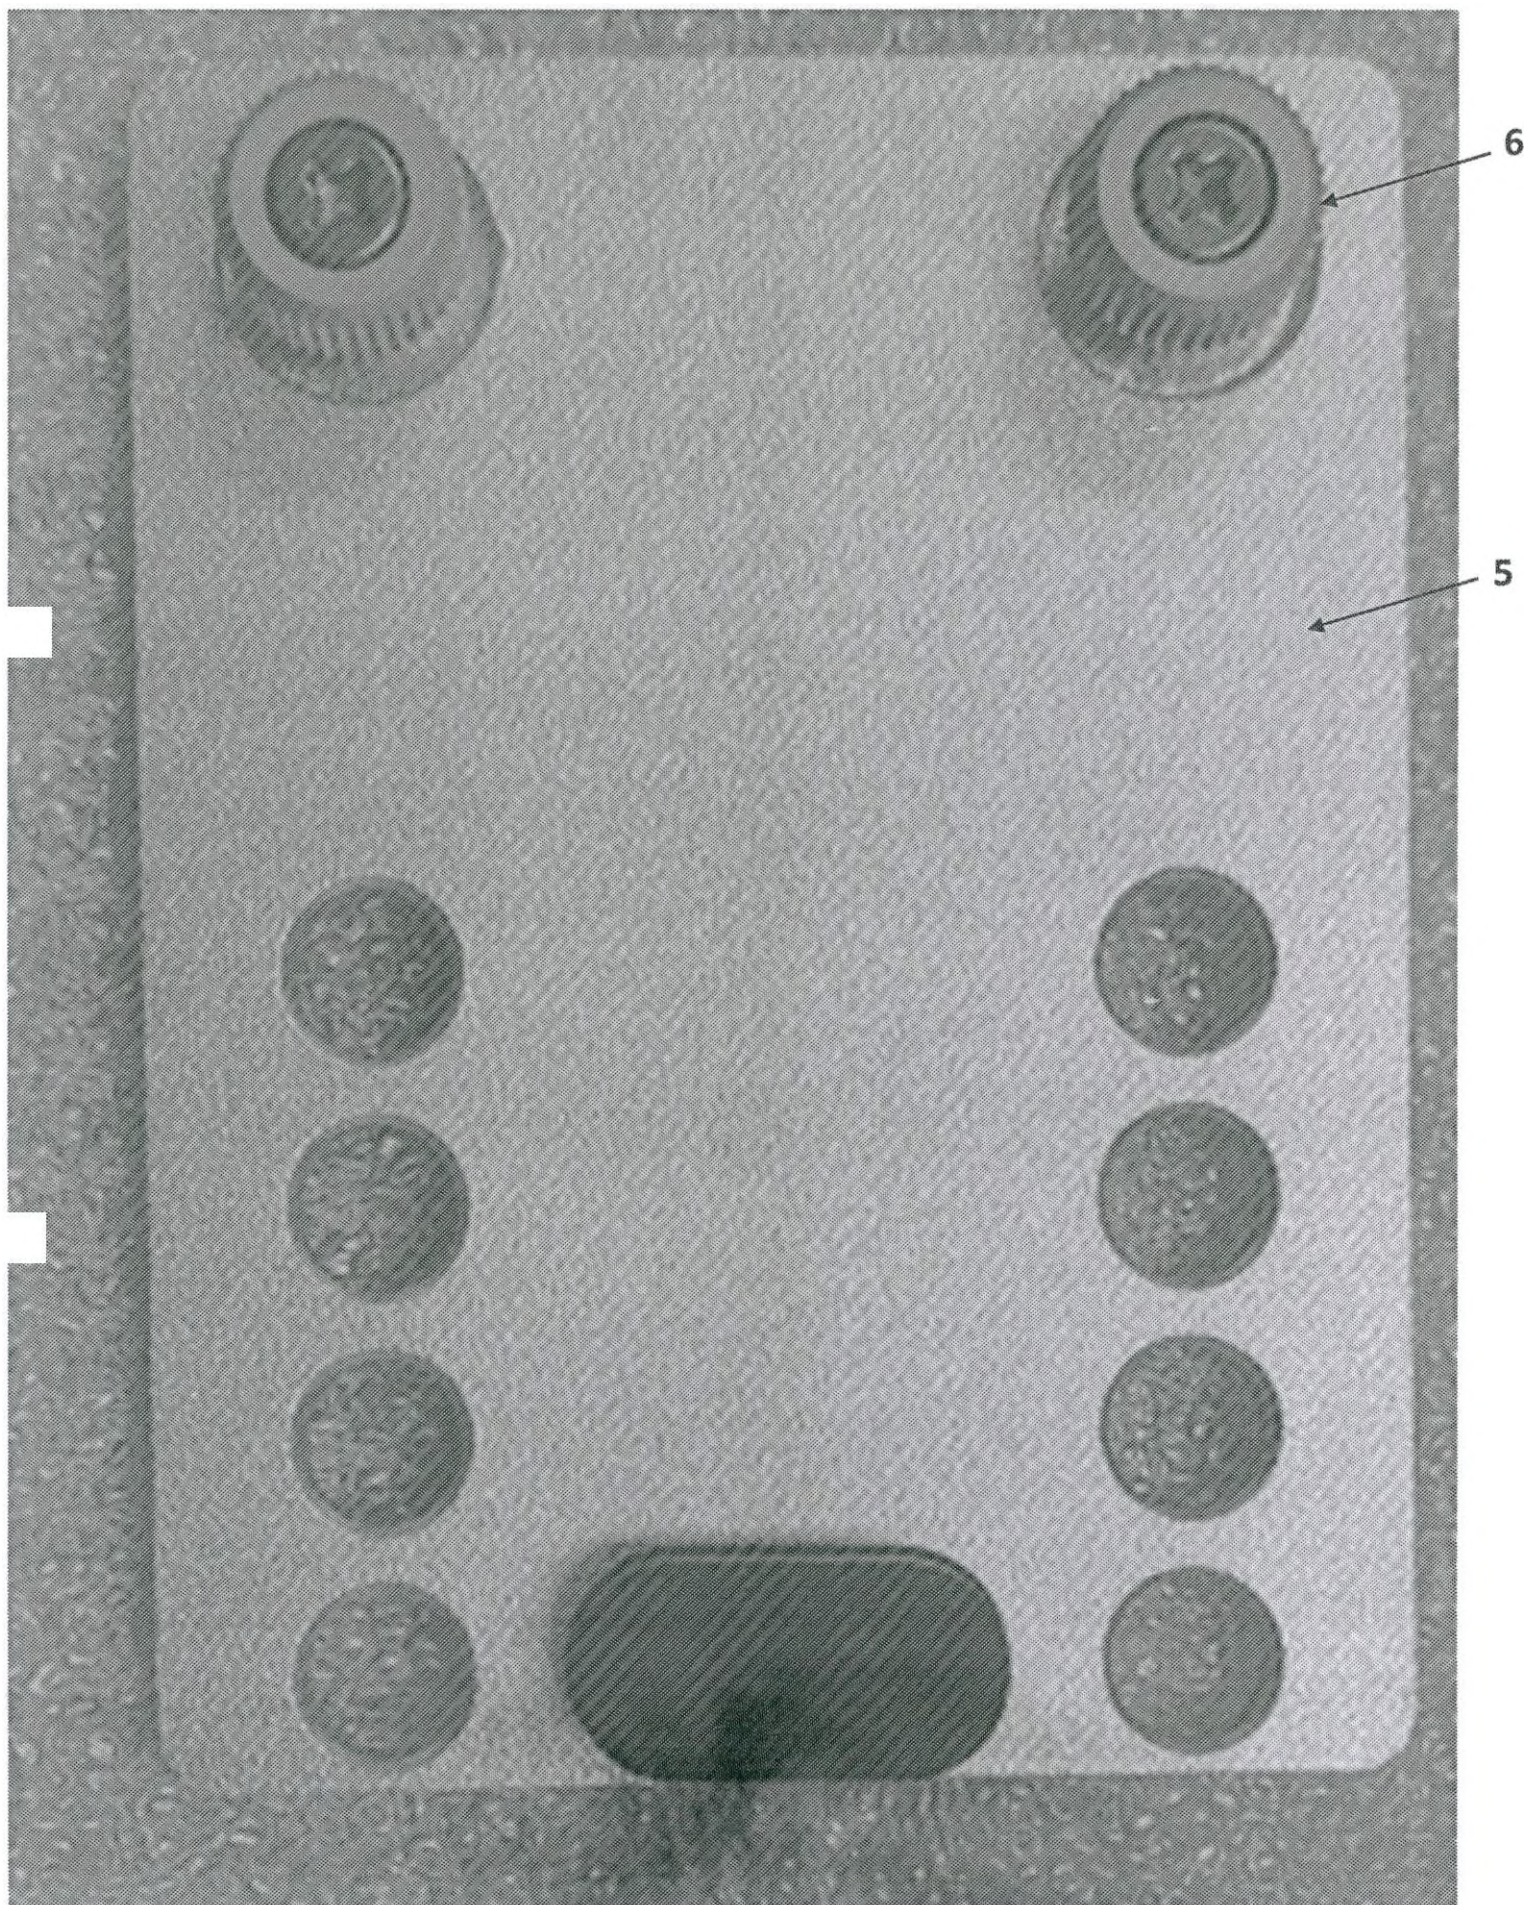


Комплект подключения (5 – соединительная пластина, 6 – винты)

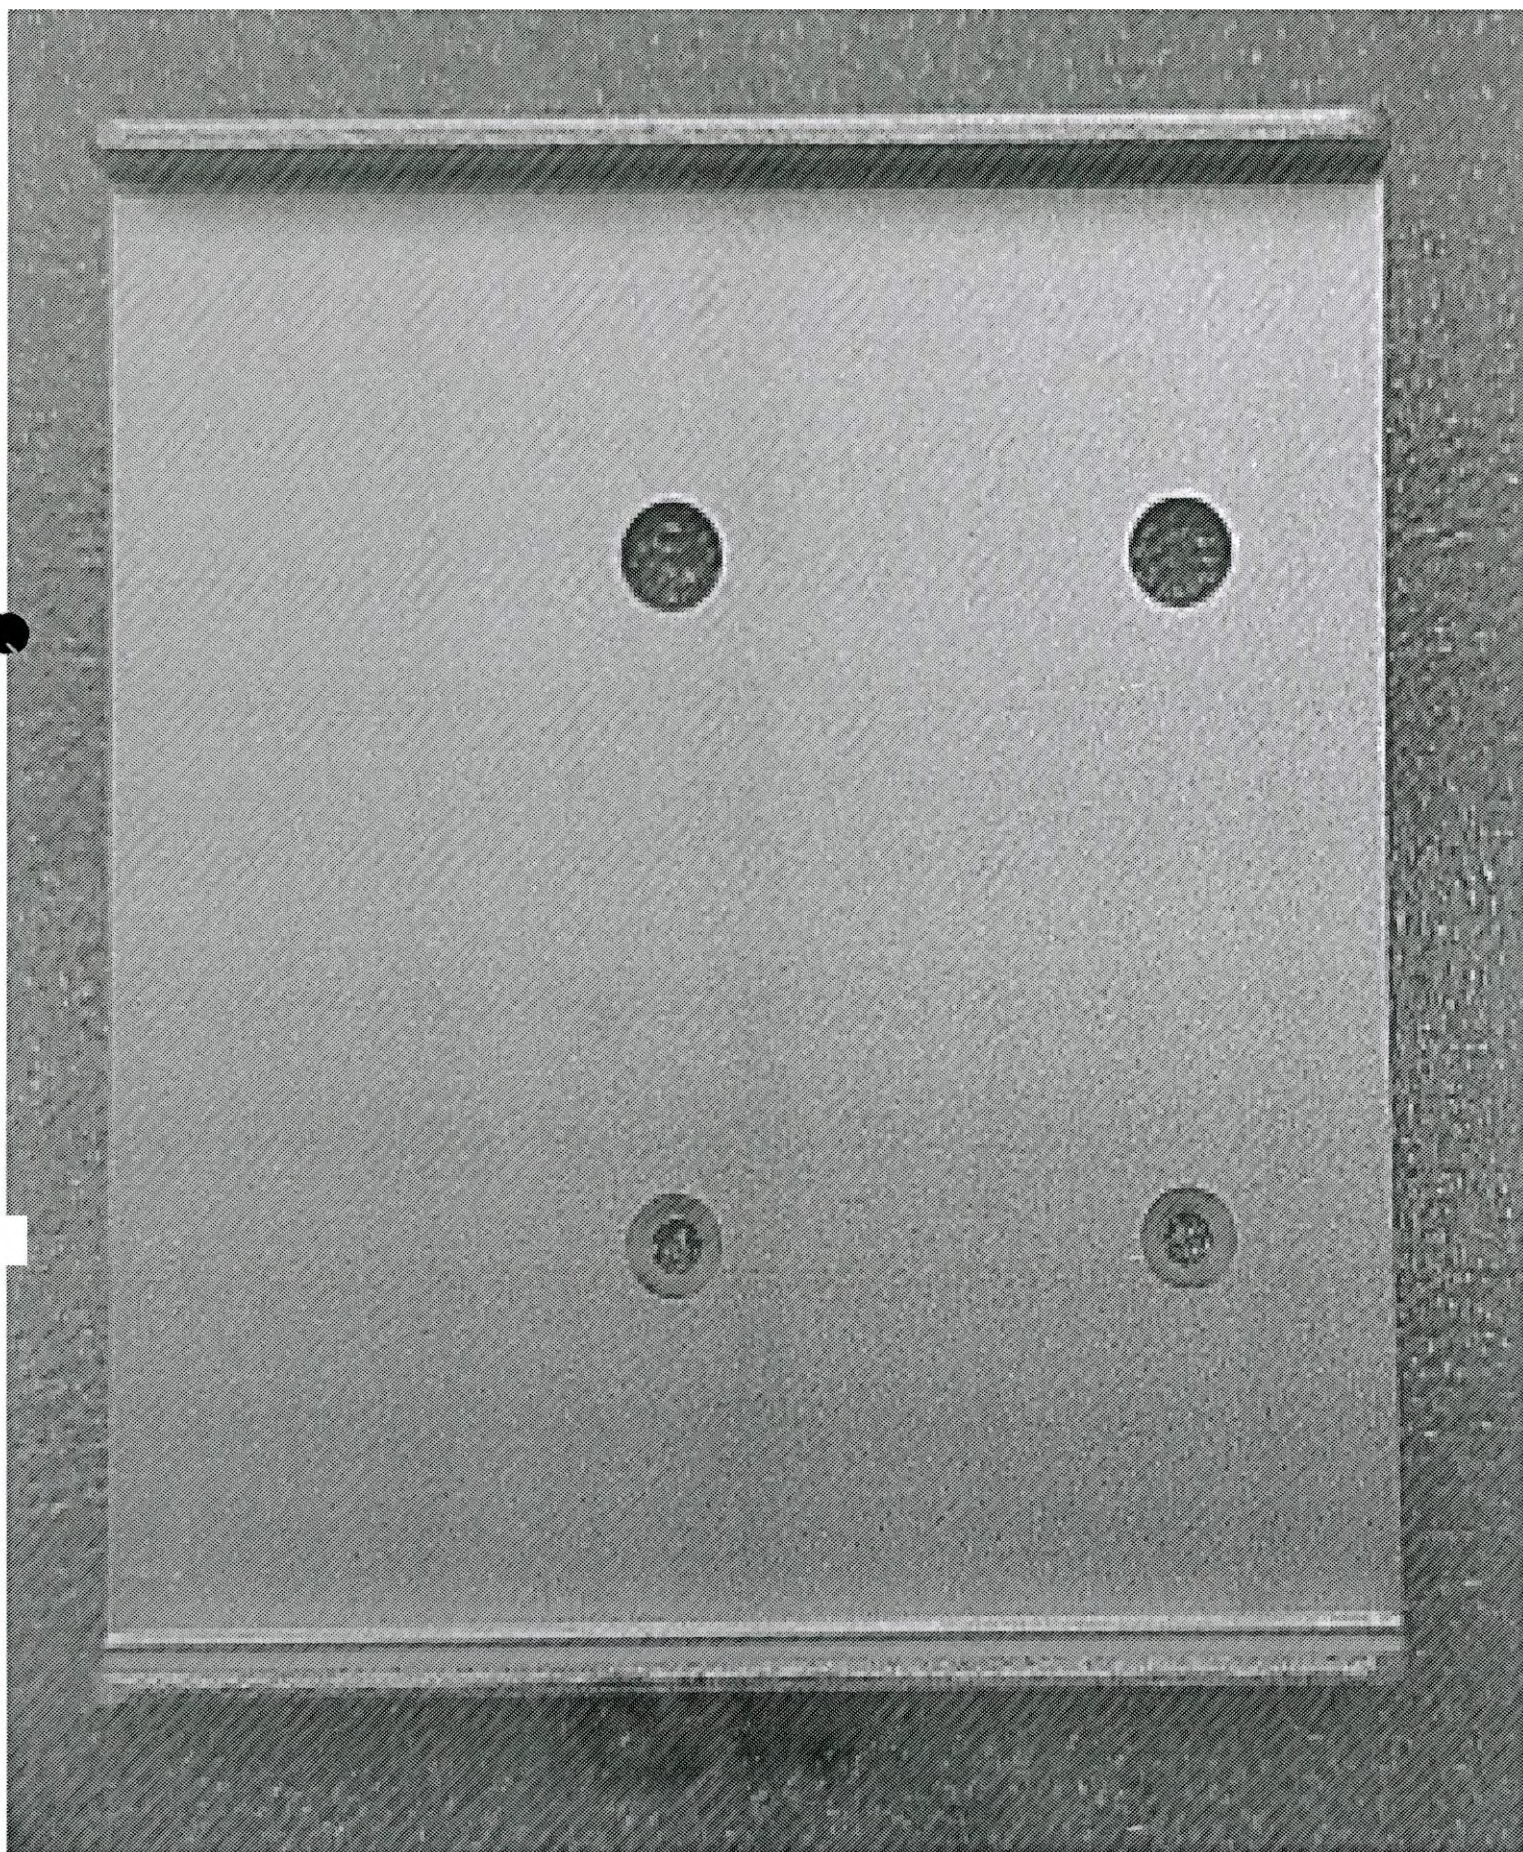


Комплект подключения (подставка)

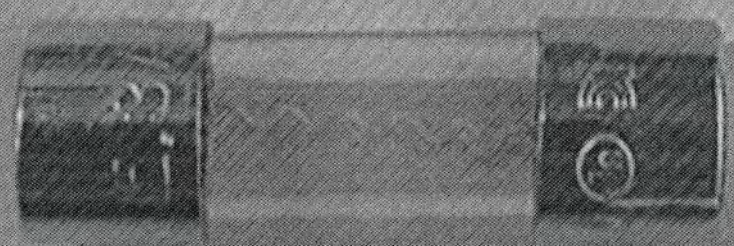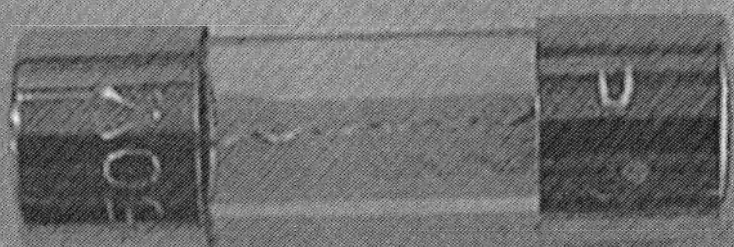


Запасной предохранитель 3А/250 В, производитель Littlefuse Inc., США (2 шт.)

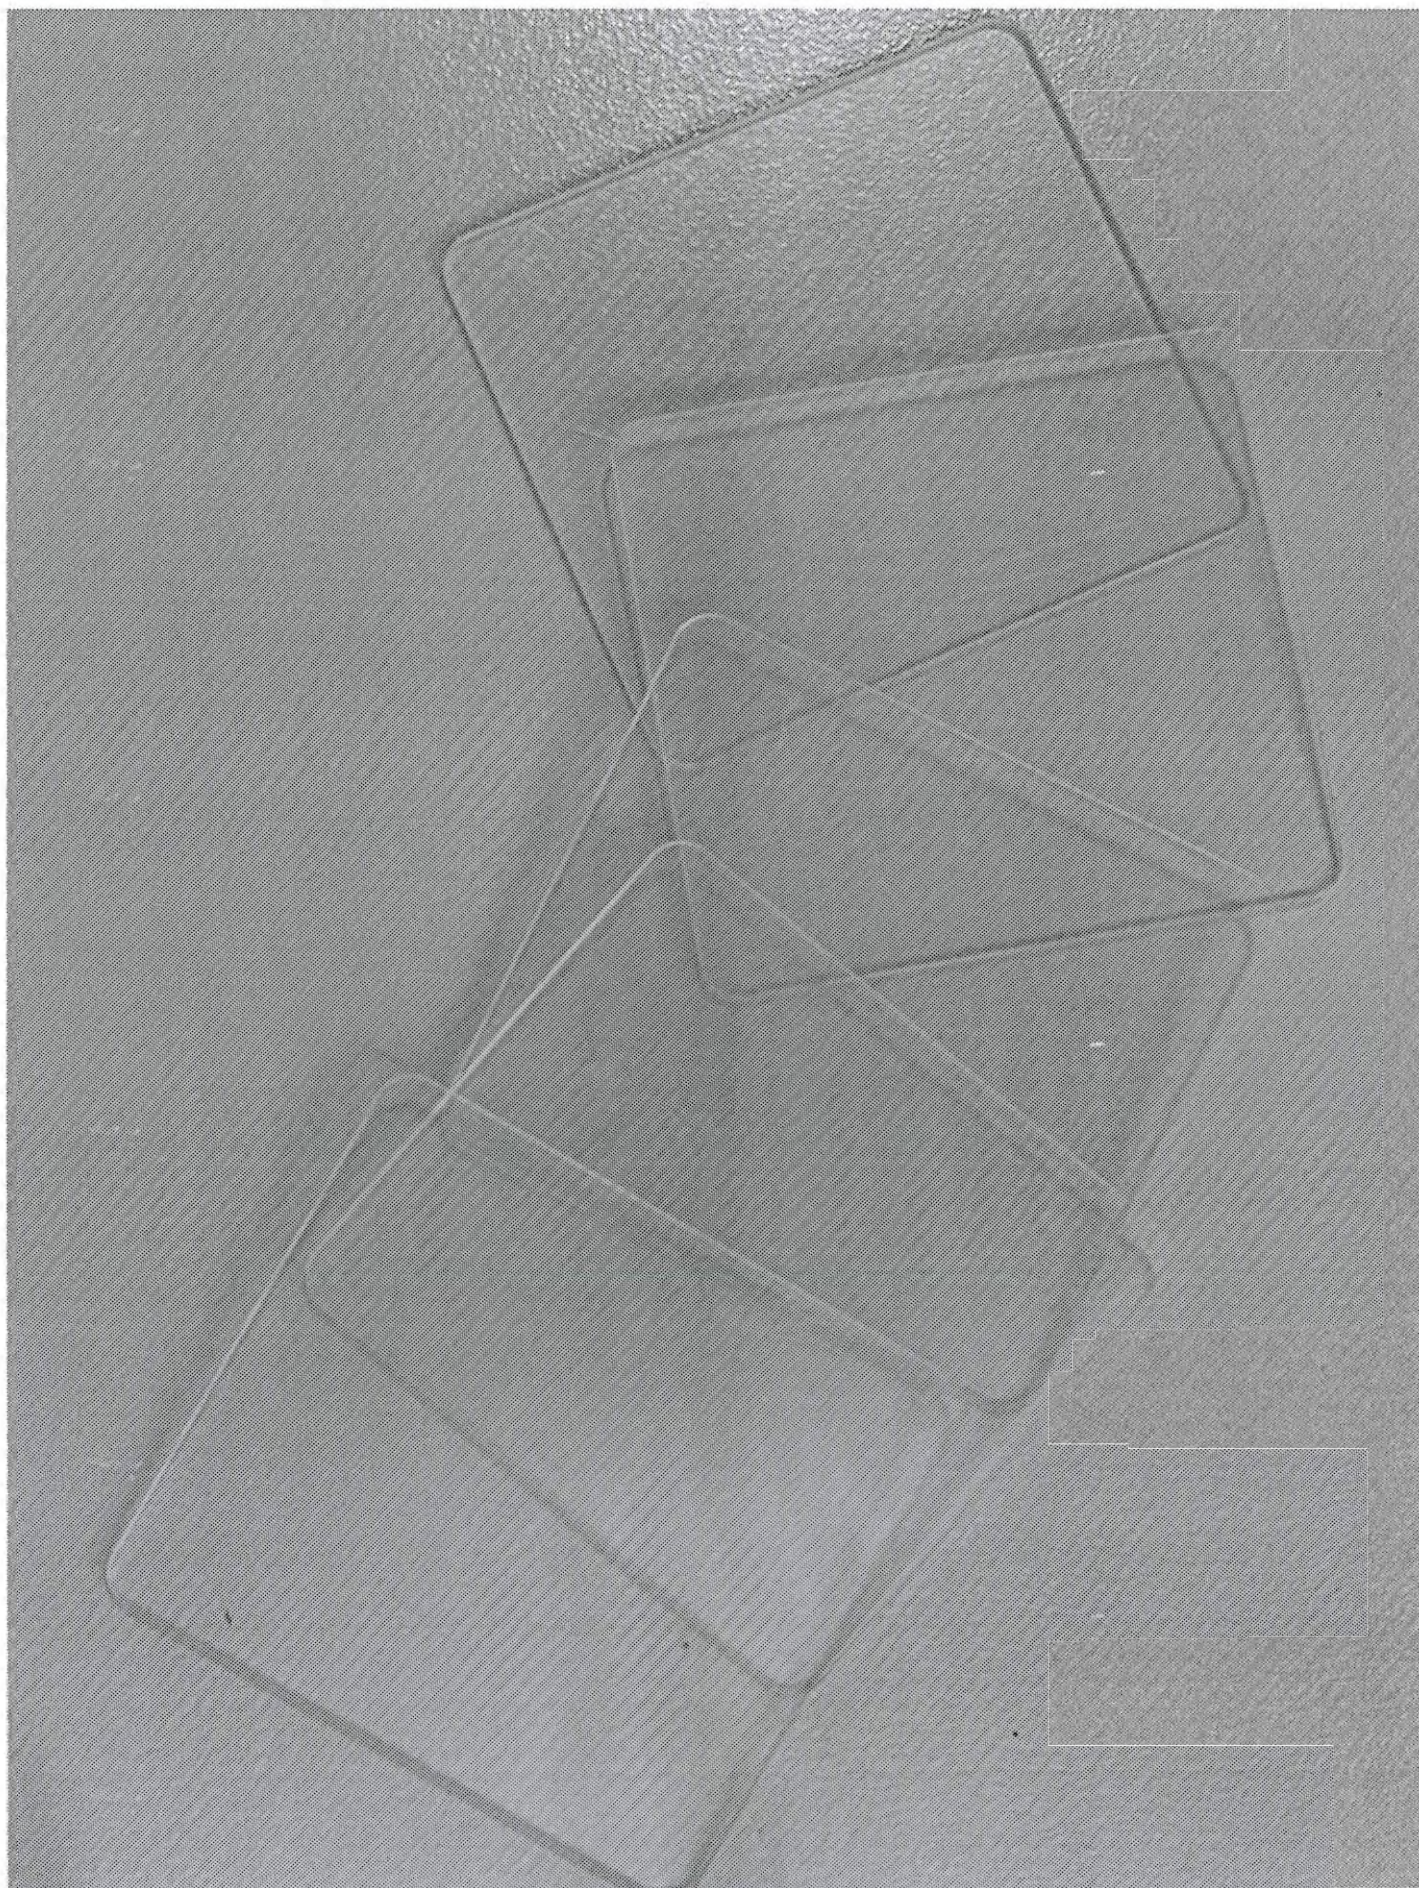


Запасной защитный экран

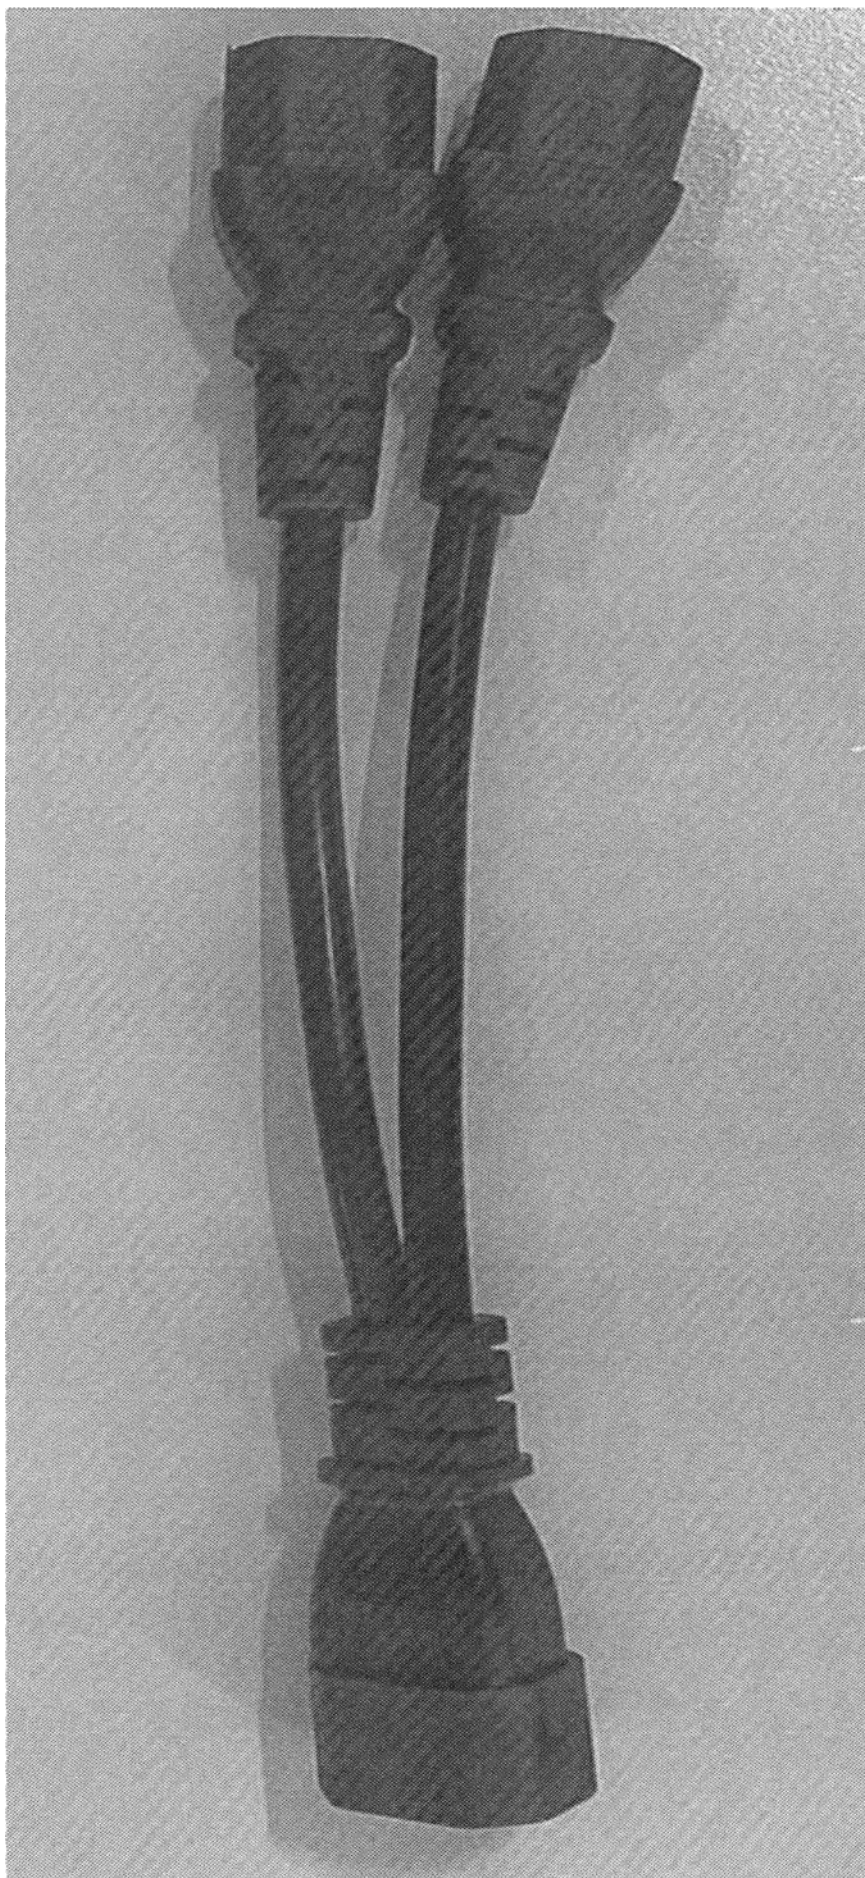


Разветвитель подачи питания модель h05VV-F 3x0.75 мм² 300/500 В, производитель Korea KDK Co. Ltd., Корея

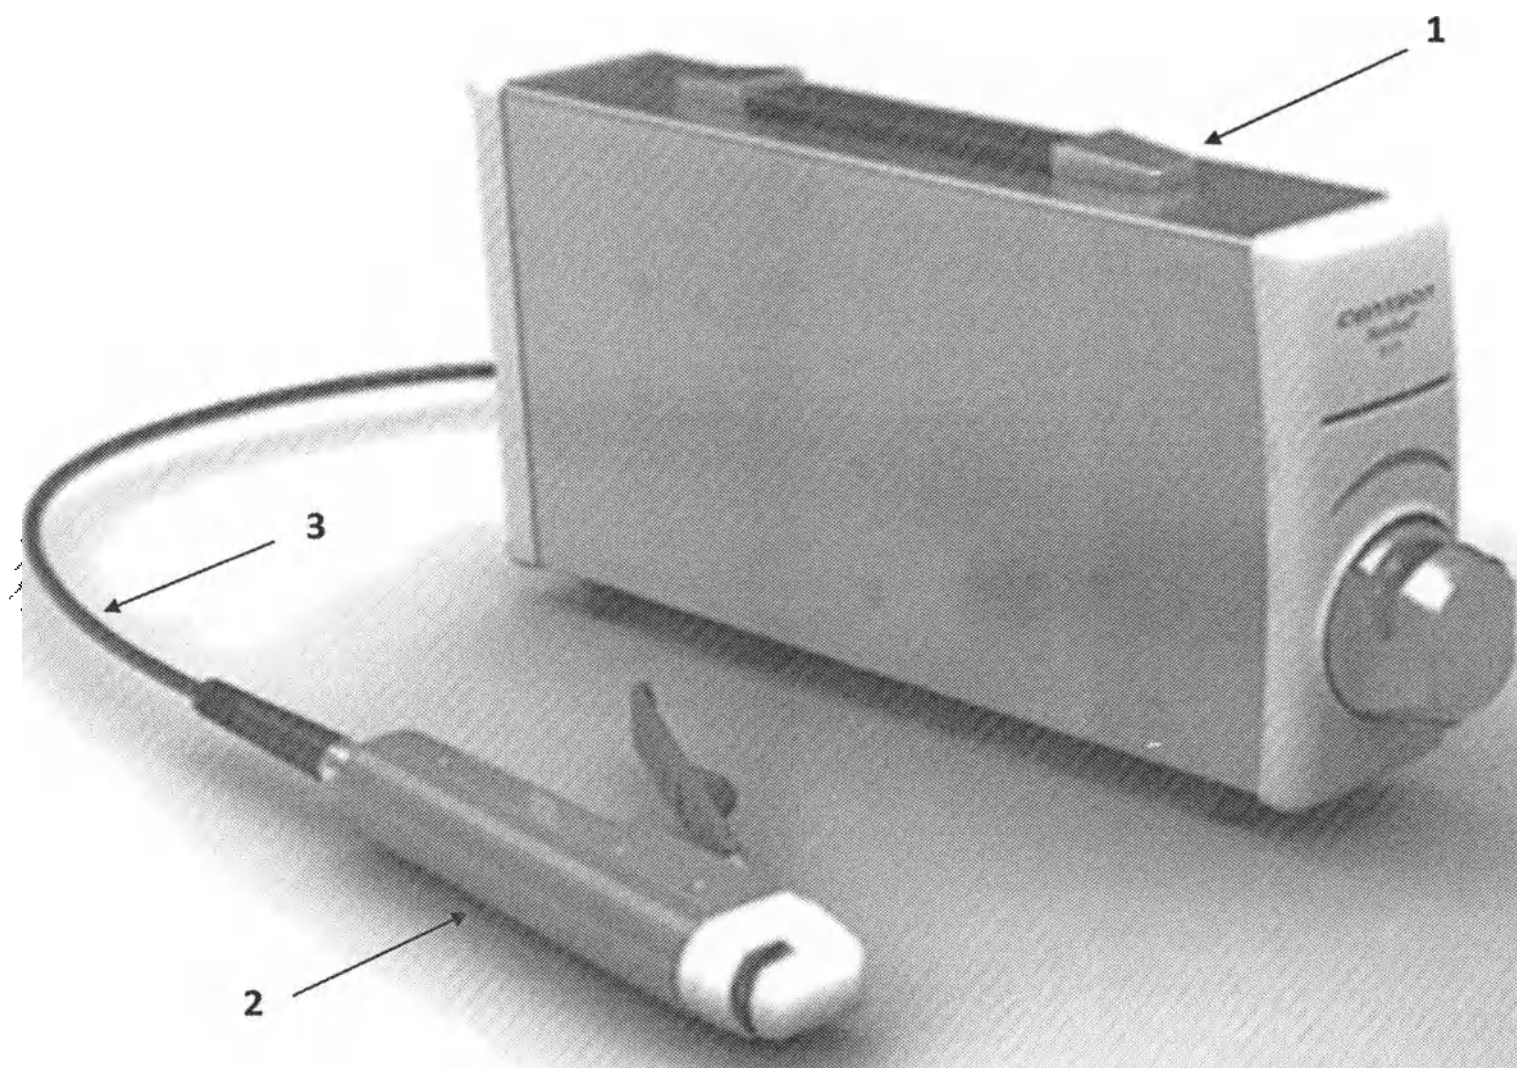


**Устройство для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE170
(1 – основной блок модель SE170, 2 – выносное запаивающее устройство модель 200-038A, 3 – коаксиальный кабель
высокочастотный модель 8219 rg-58a/u, производитель Belden CDT Inc, США)**

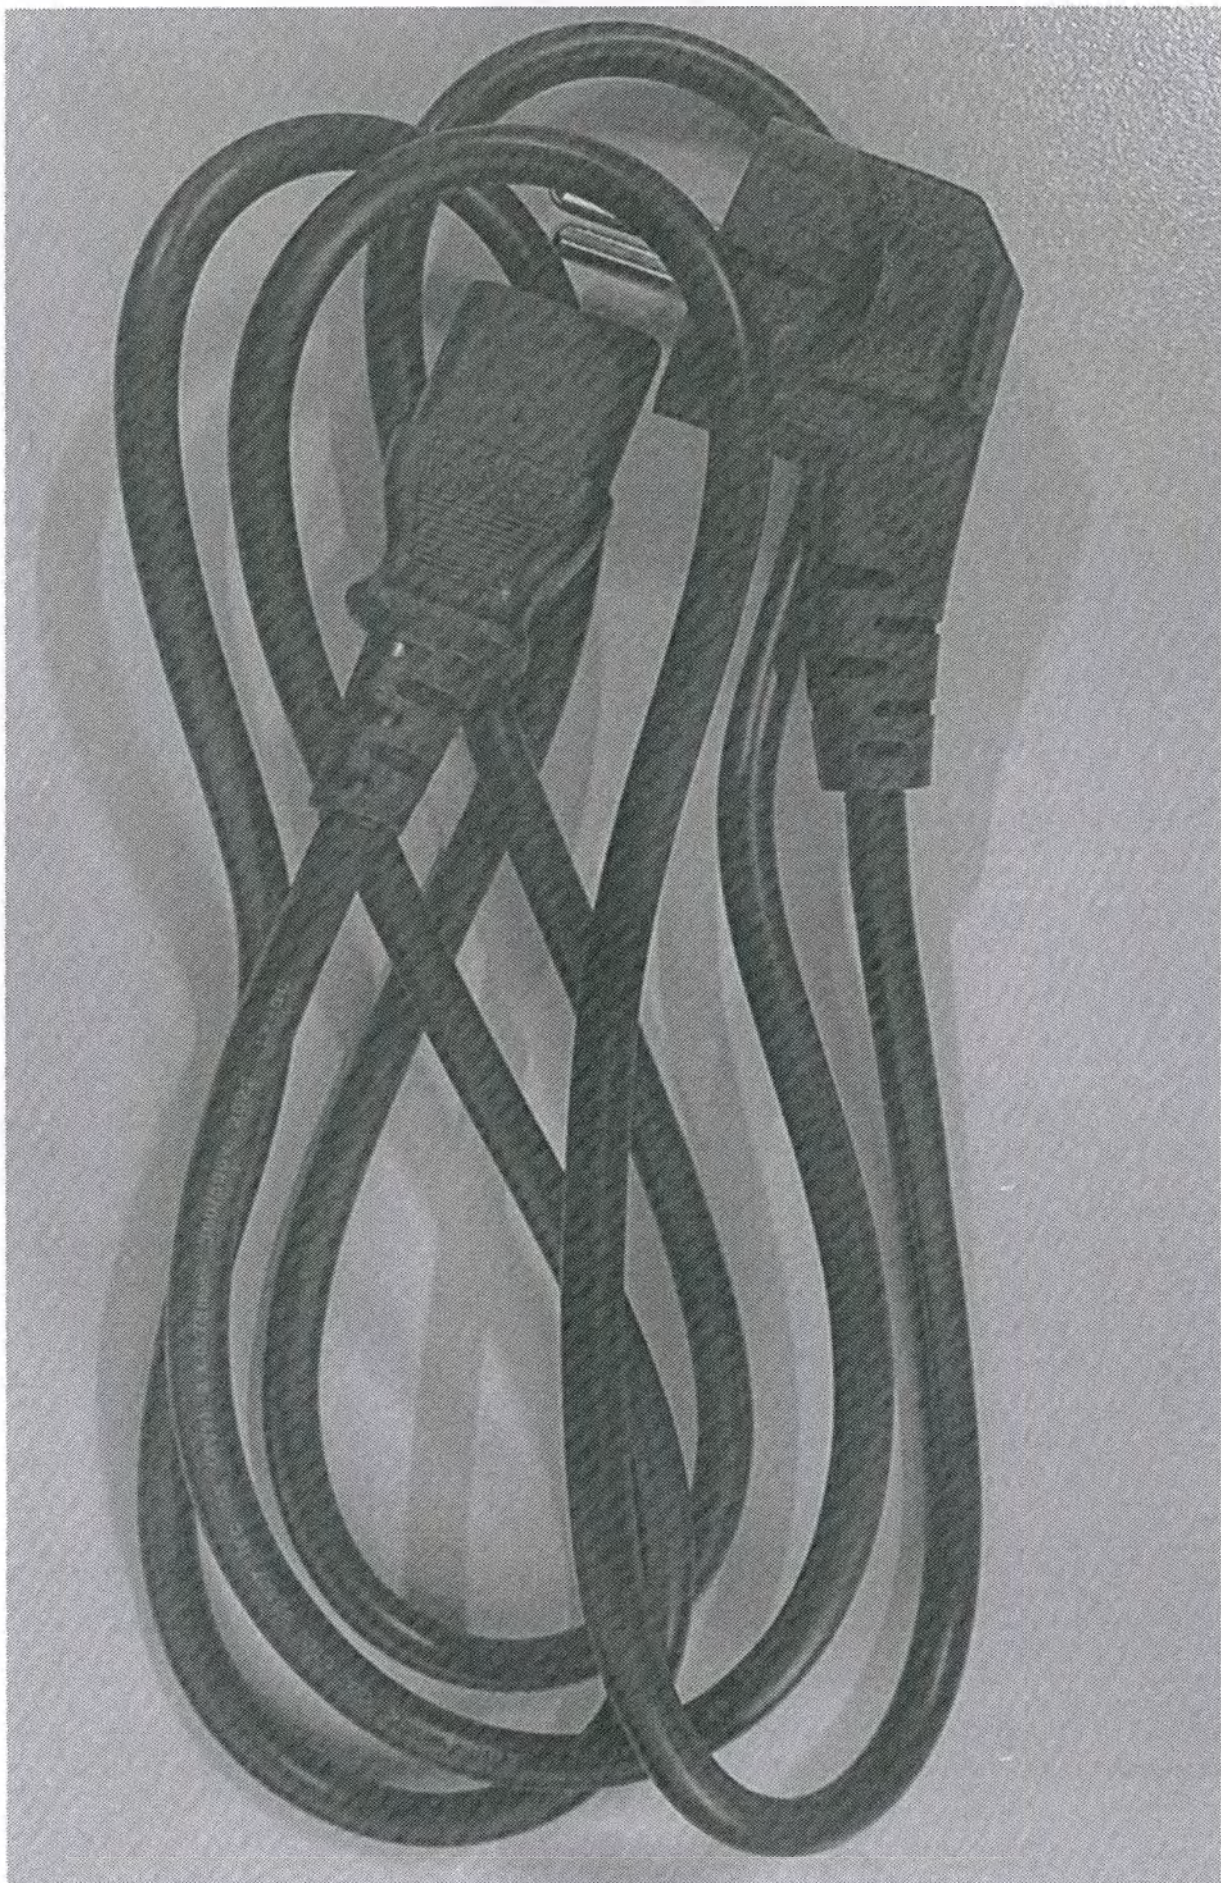


Шнур питания переменного тока, модель КОСЕ-3 Н05VV-F 3x0,75 мм² 300/500 В, производства Korea KDK Co. Ltd., Корея

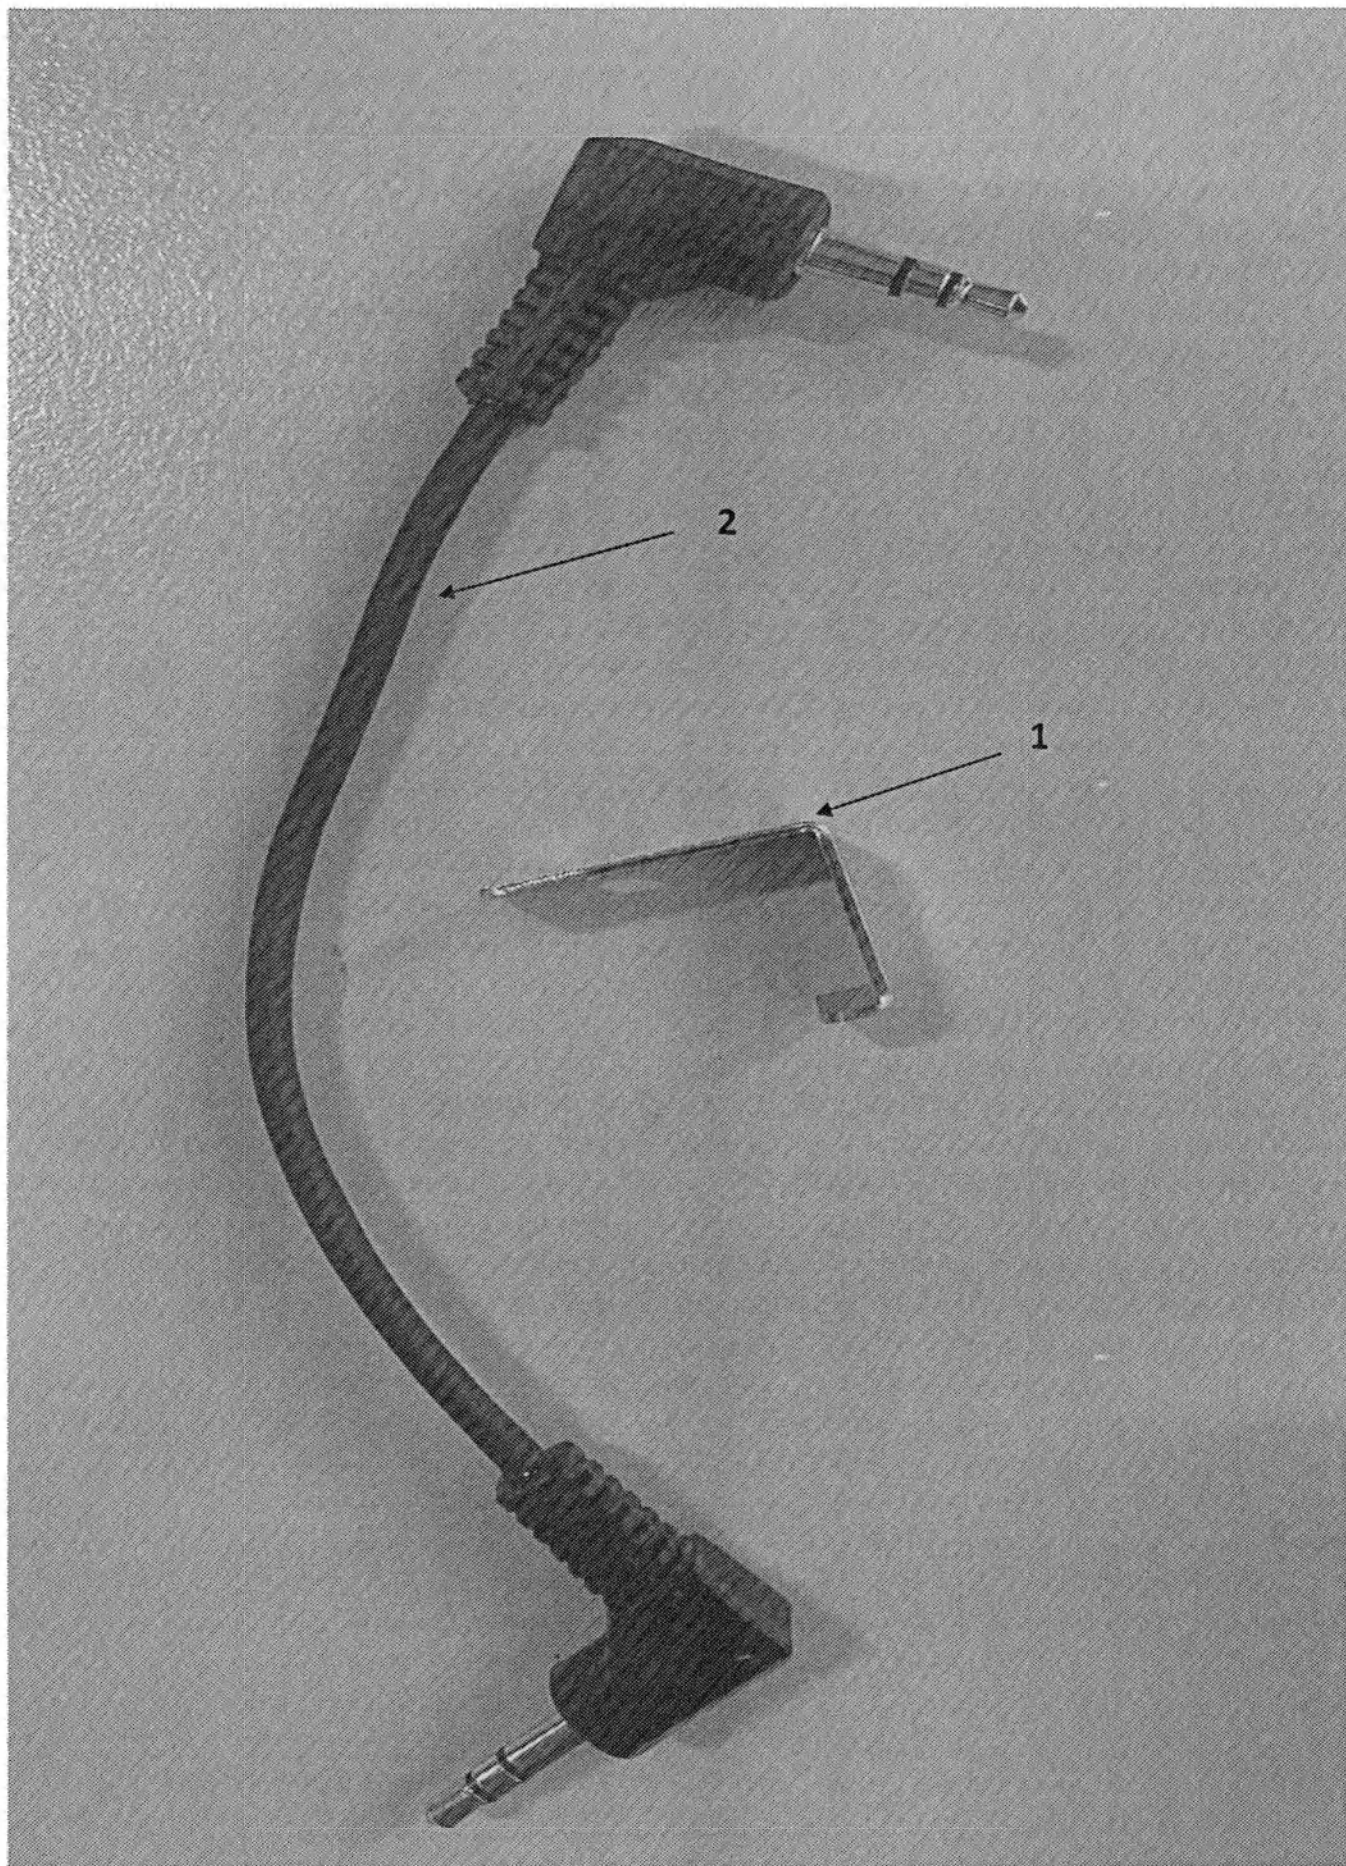


Комплект подключения (1- кронштейн спускового рычага, 2 – кабель сигнальный)

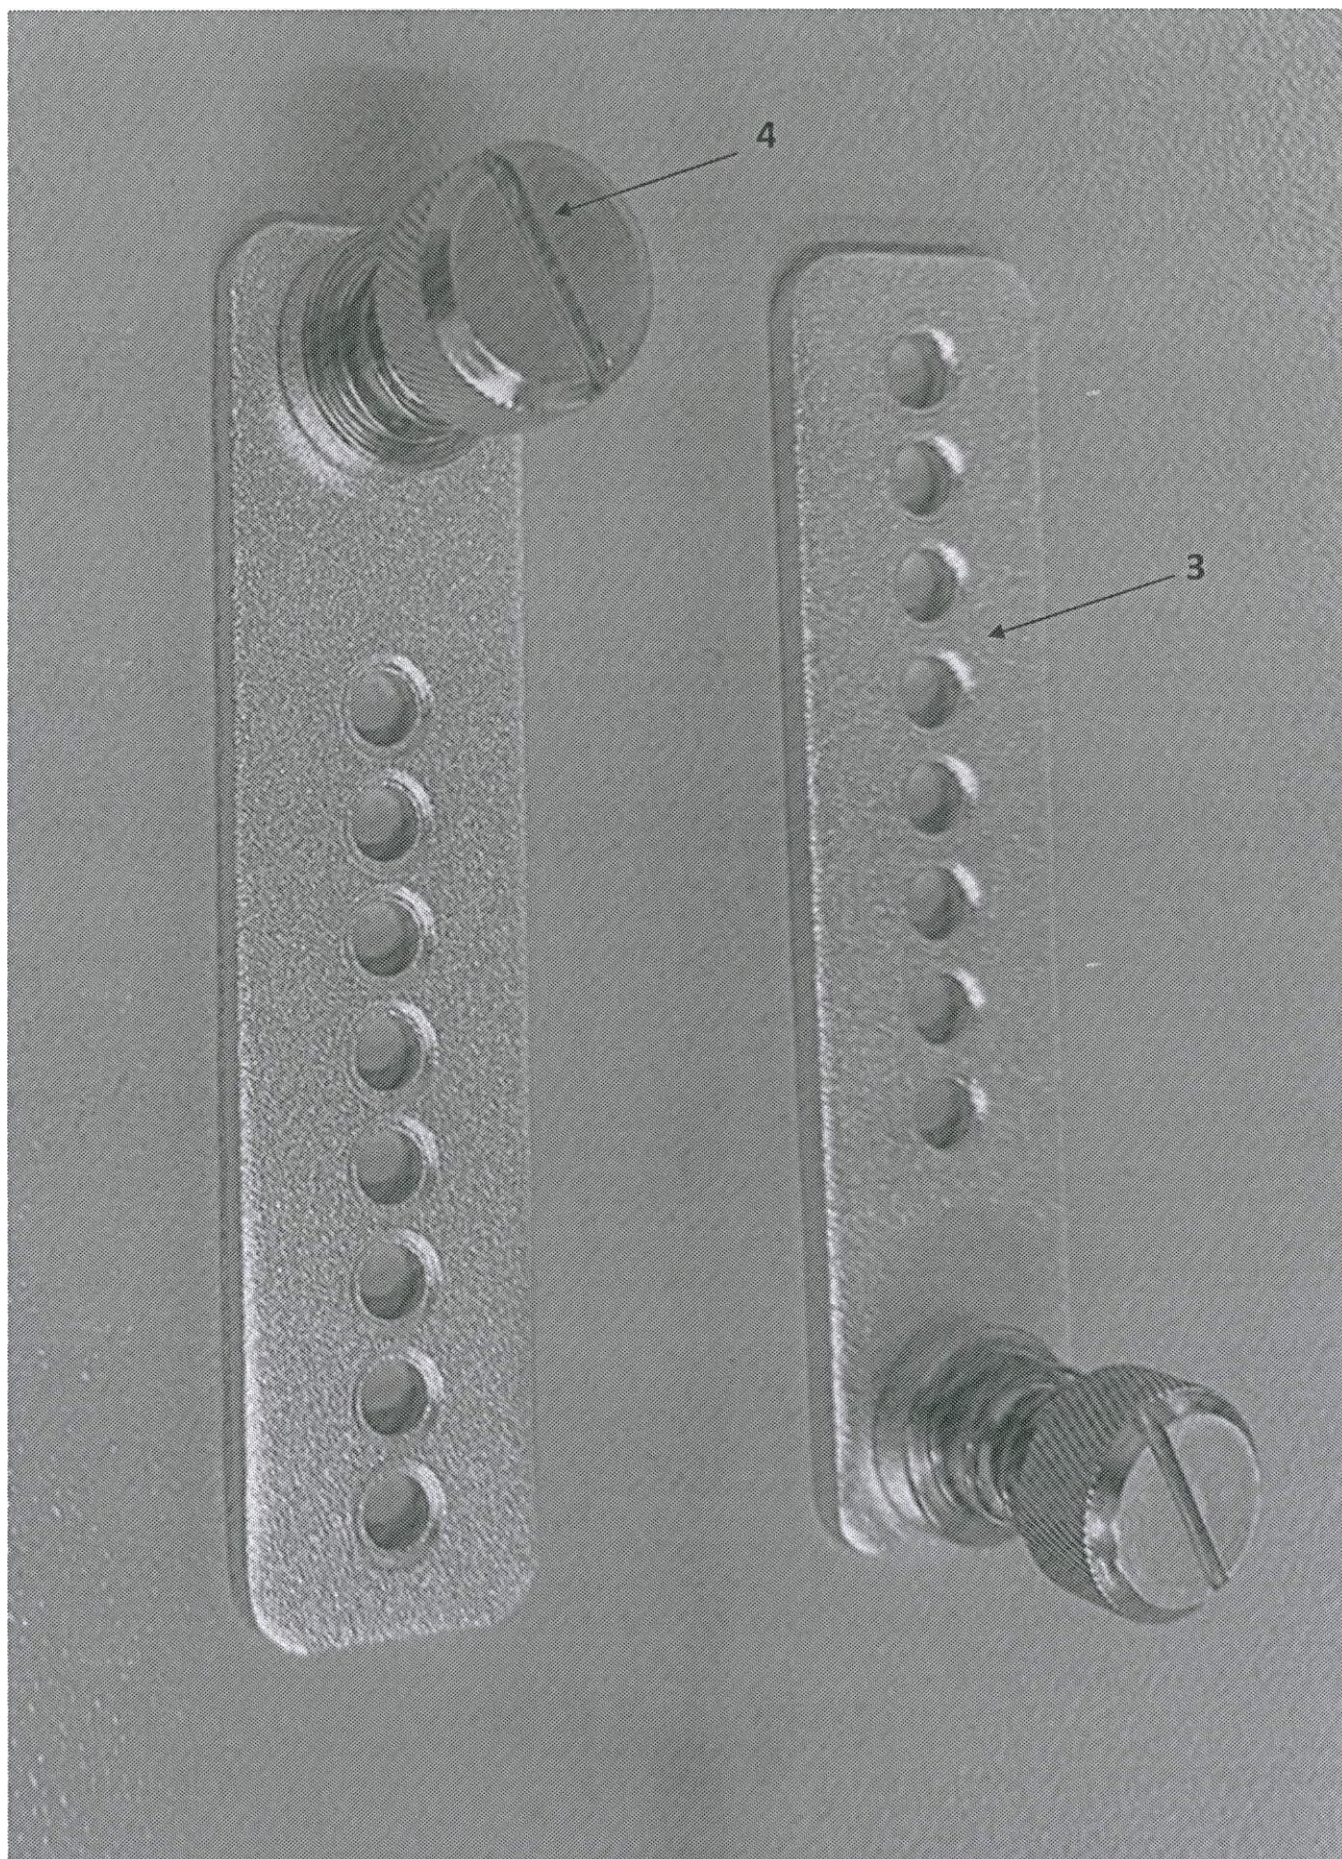

Комплект подключения (3 – соединительная планка (2 шт.), 4 – винт (2 шт.))

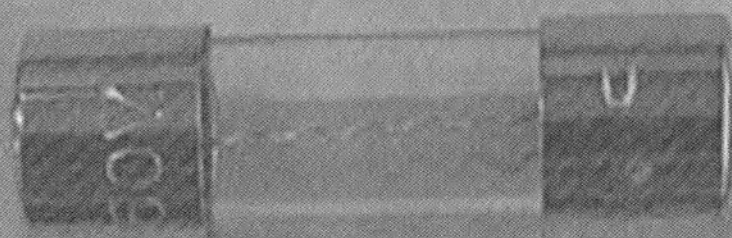


Запасной предохранитель 3А/250 В, производитель Littlefuse Inc., США (2 шт.)

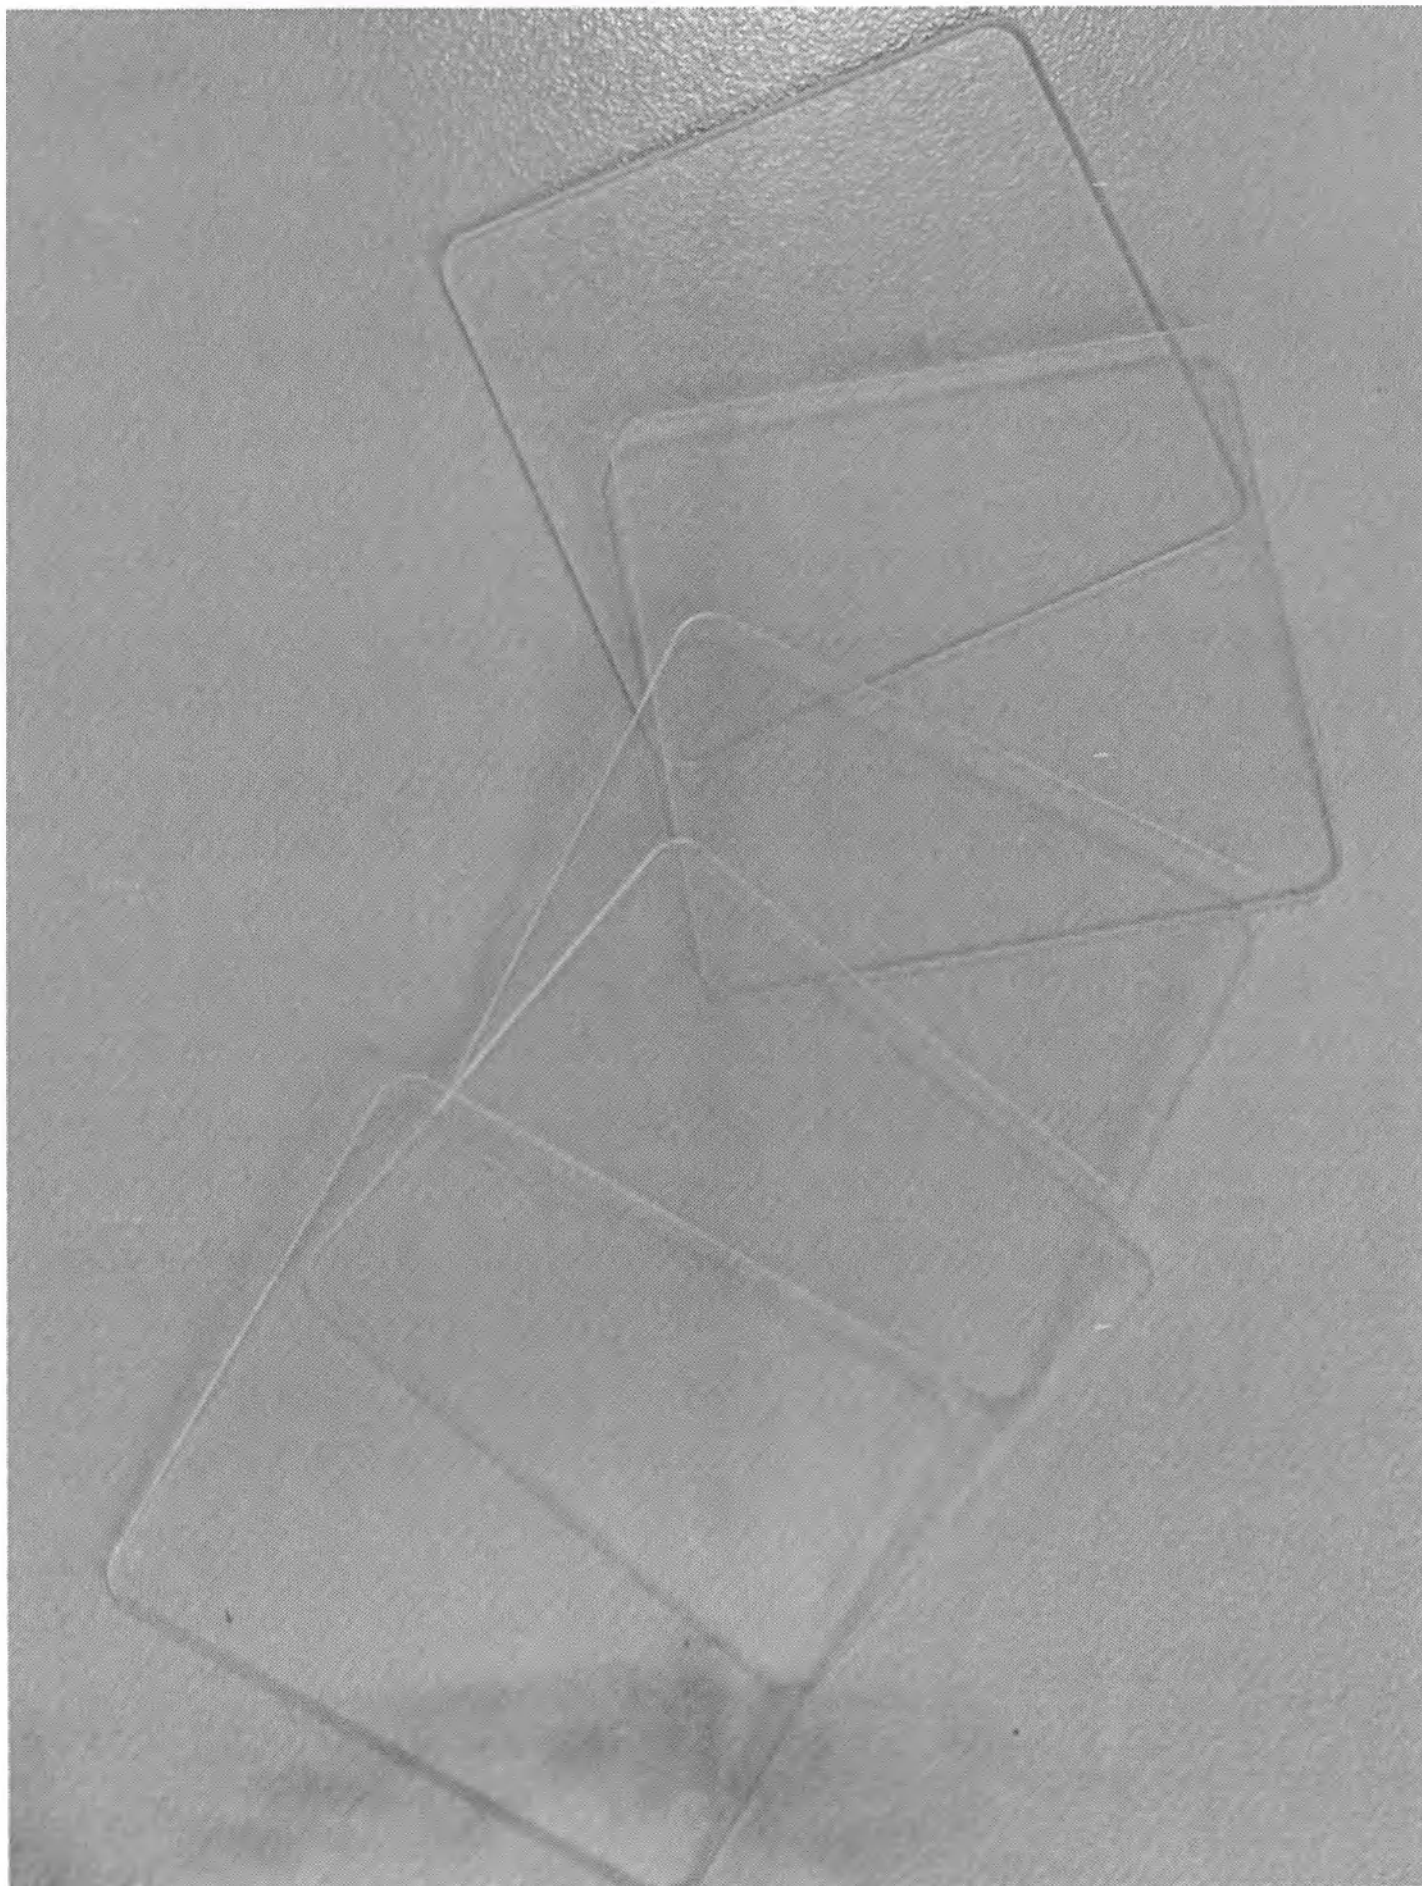


Запасной защитный экран




Разветвитель подачи питания, модель h05VV-F 3x0.75 мм² 300/500 В, производитель Korea KDK Co. Ltd., Корея

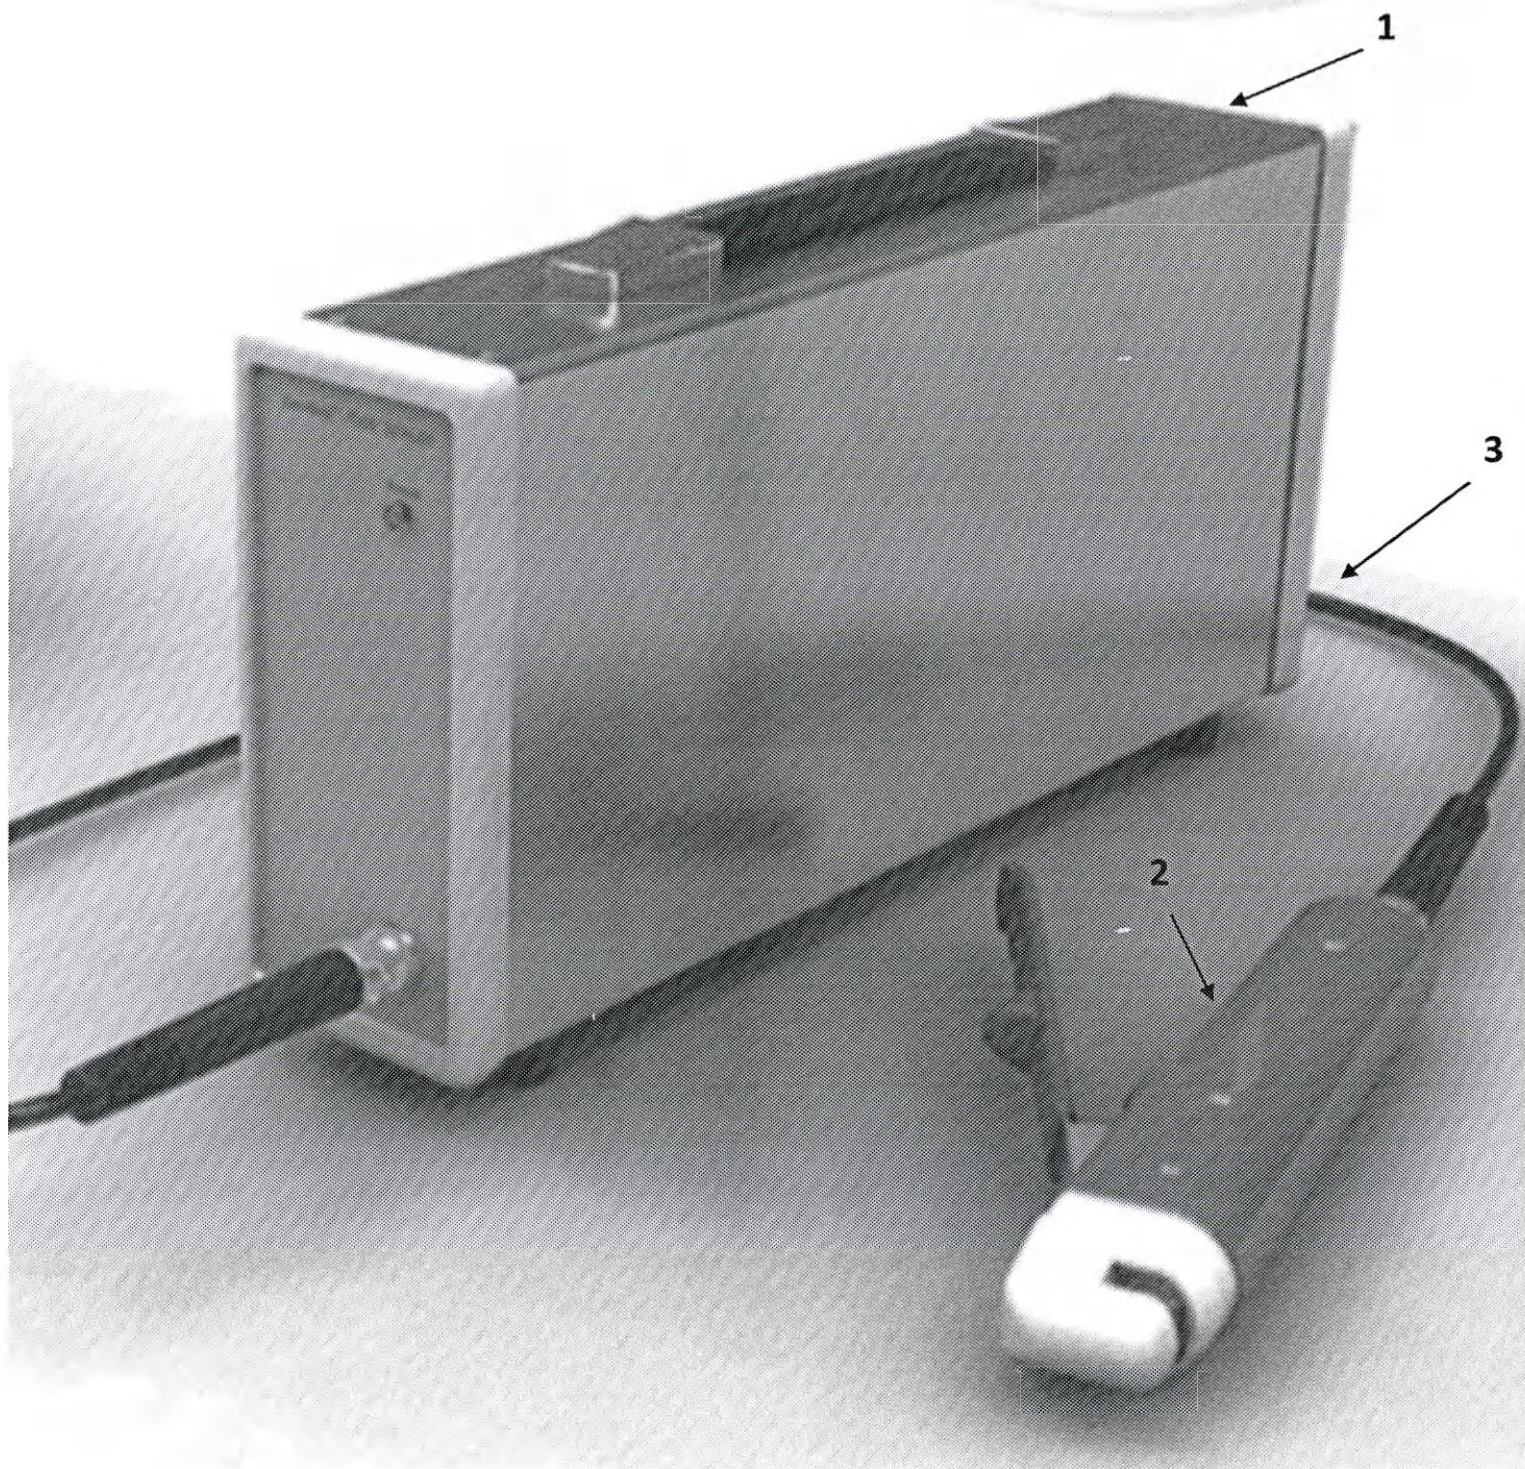


Устройство для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE175 (1 – основной блок модель SE175, 2 - Выносное запаивающее устройство модель 200-038A, 3 - Коаксиальный кабель высокочастотный модель 8219 rg-58a/u, производитель Belden CDT Inc, США)

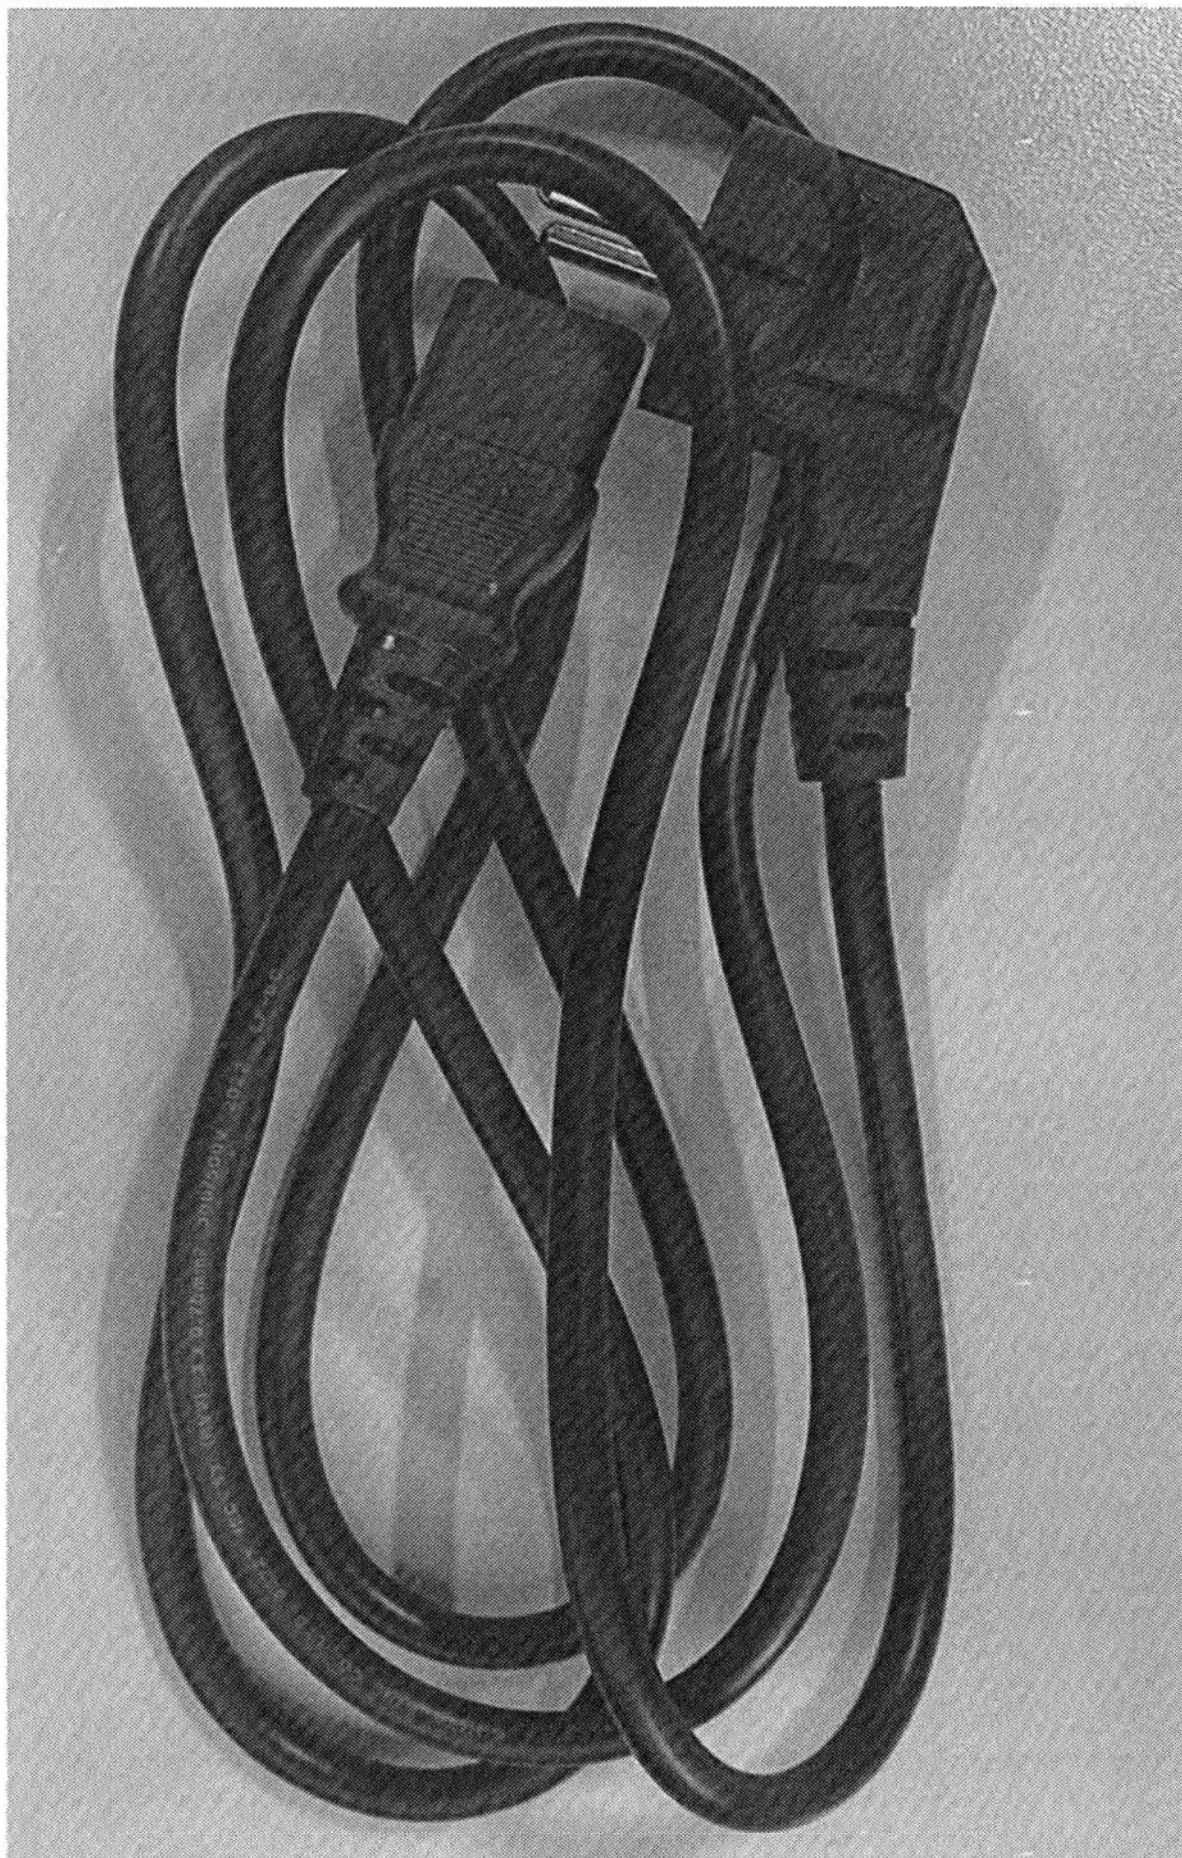


Шнур питания переменного тока 220-240 В, модель КОСЕ-3 H05VV-F 3x0,75 мм² 300/500 В, производства Korea KDK Co. Ltd., Корея

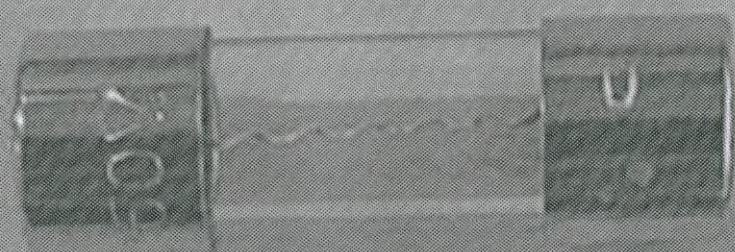


Запасной предохранитель, 3А/250 В, производитель Littlefuse Inc., США (2 шт.)

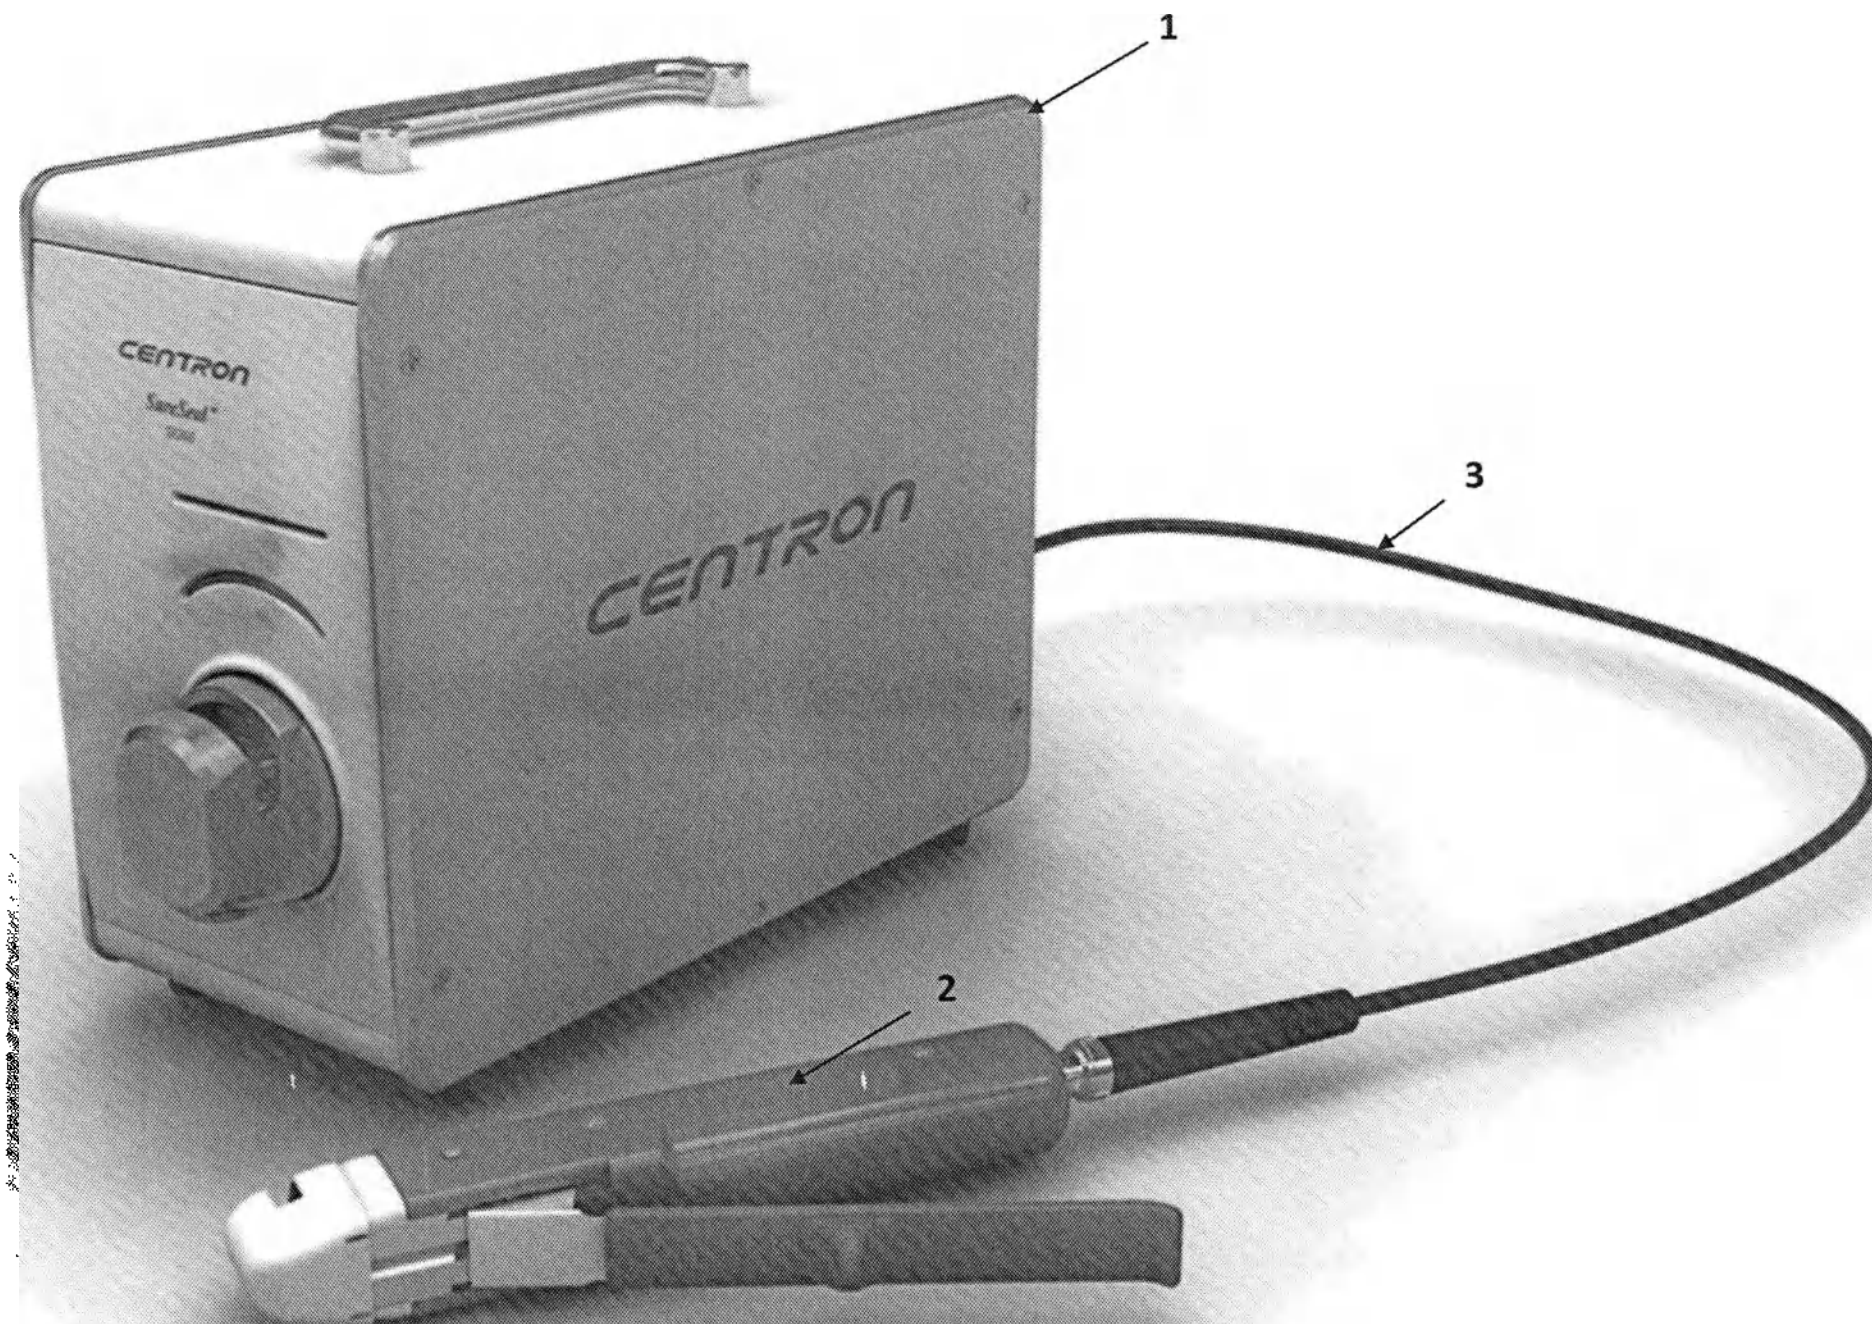


Устройство для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE260 (1 – основной блок модель SE260, 2 - Выносное запаивающее устройство модель 200-038A, 3 - Коаксиальный кабель высокочастотный модель 8219 rg-58a/ц, производитель Belden CDT Inc, США)

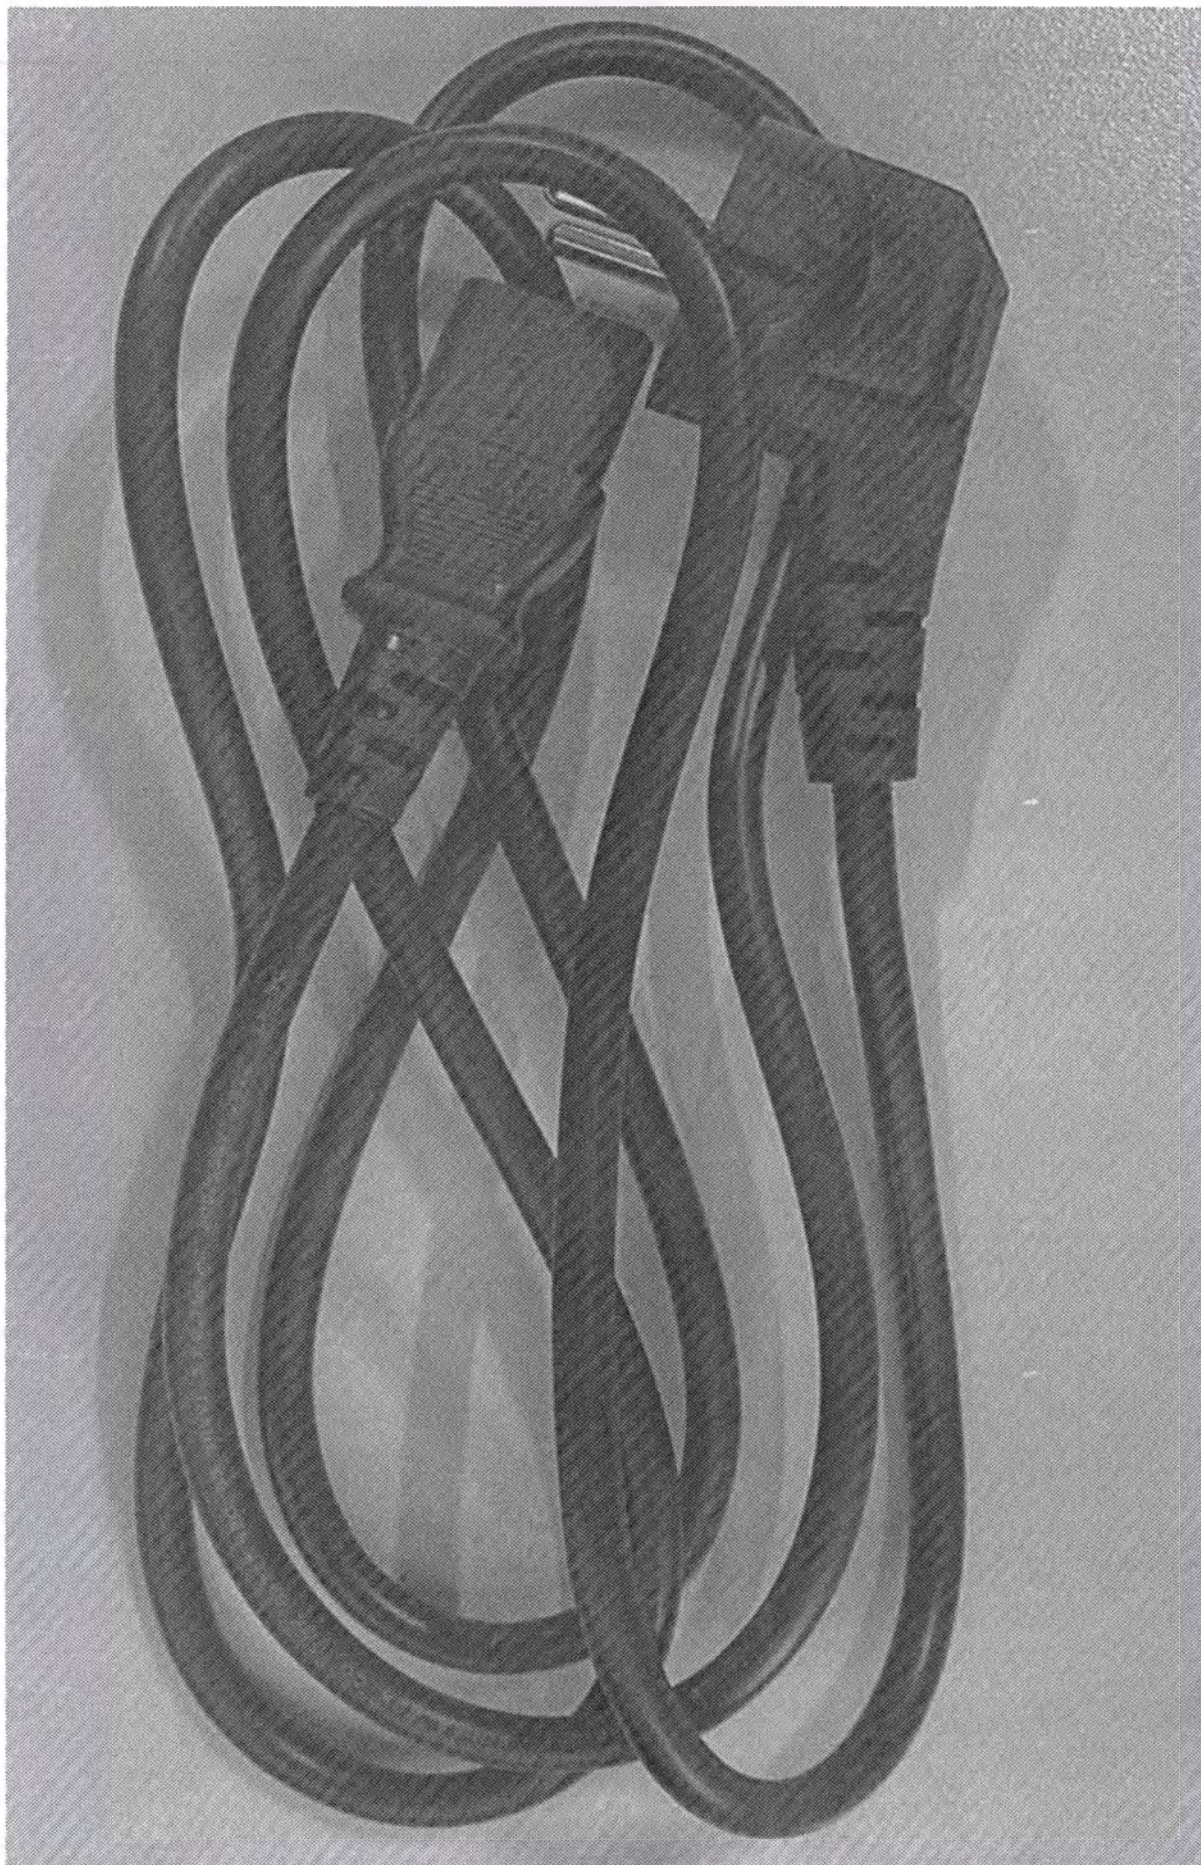


Шнур питания переменного тока 220-240 В, модель КОСЕ-3 Н05VV-F 3х0,75 мм² 300/500 В, производства Korea KDK Co. Ltd., Корея

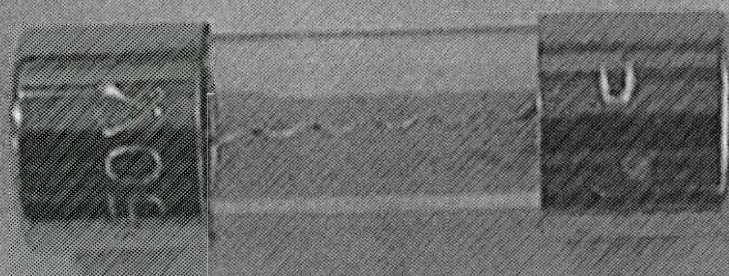


Запасной предохранитель, 3А/250 В, производитель Littlefuse Inc., США (2 шт.)

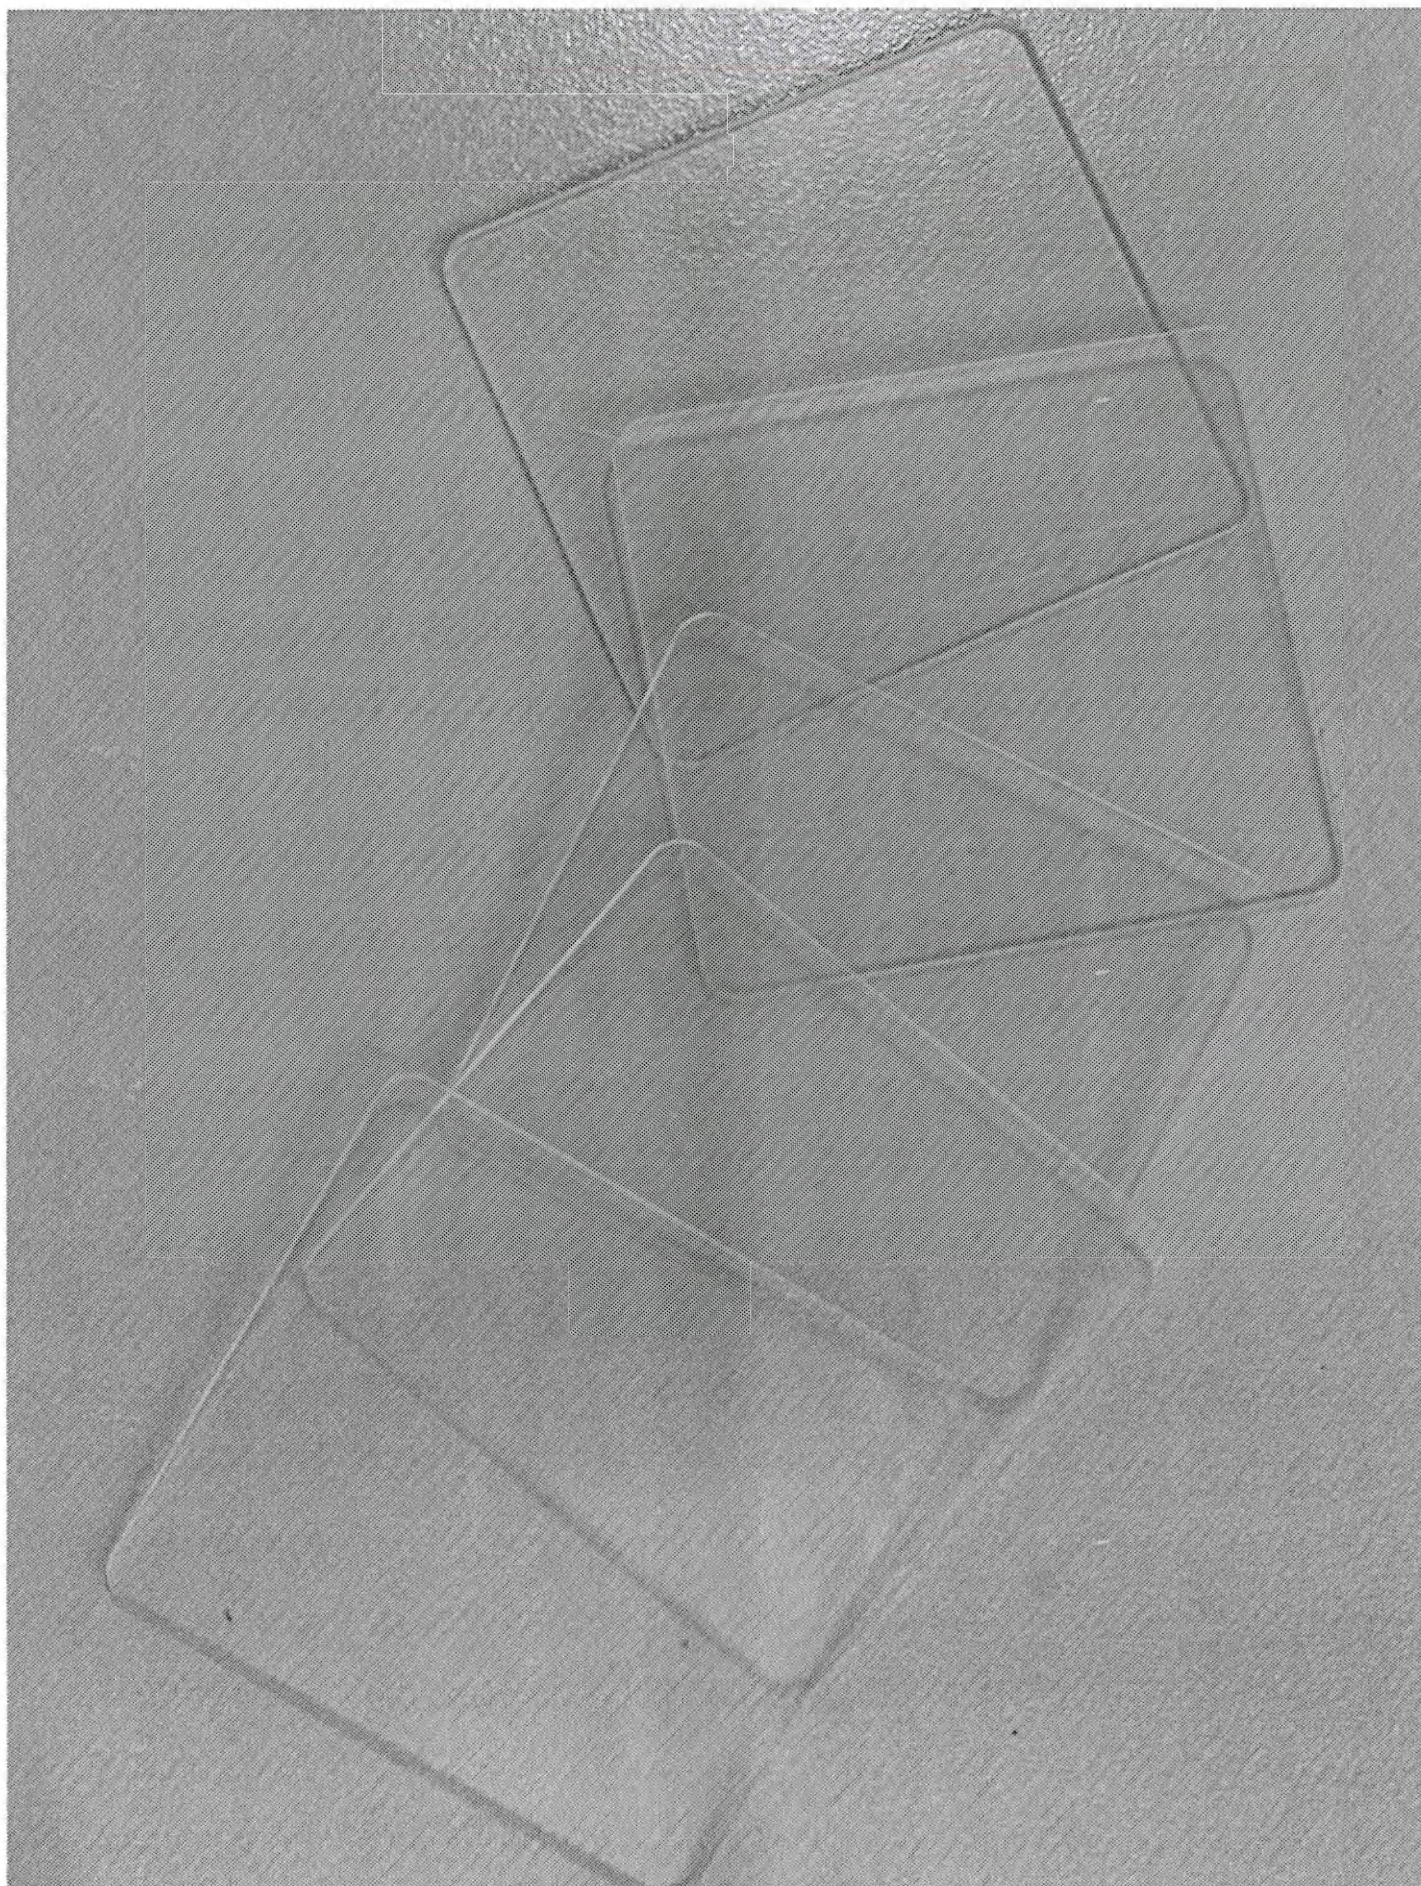


Запасной защитный экран

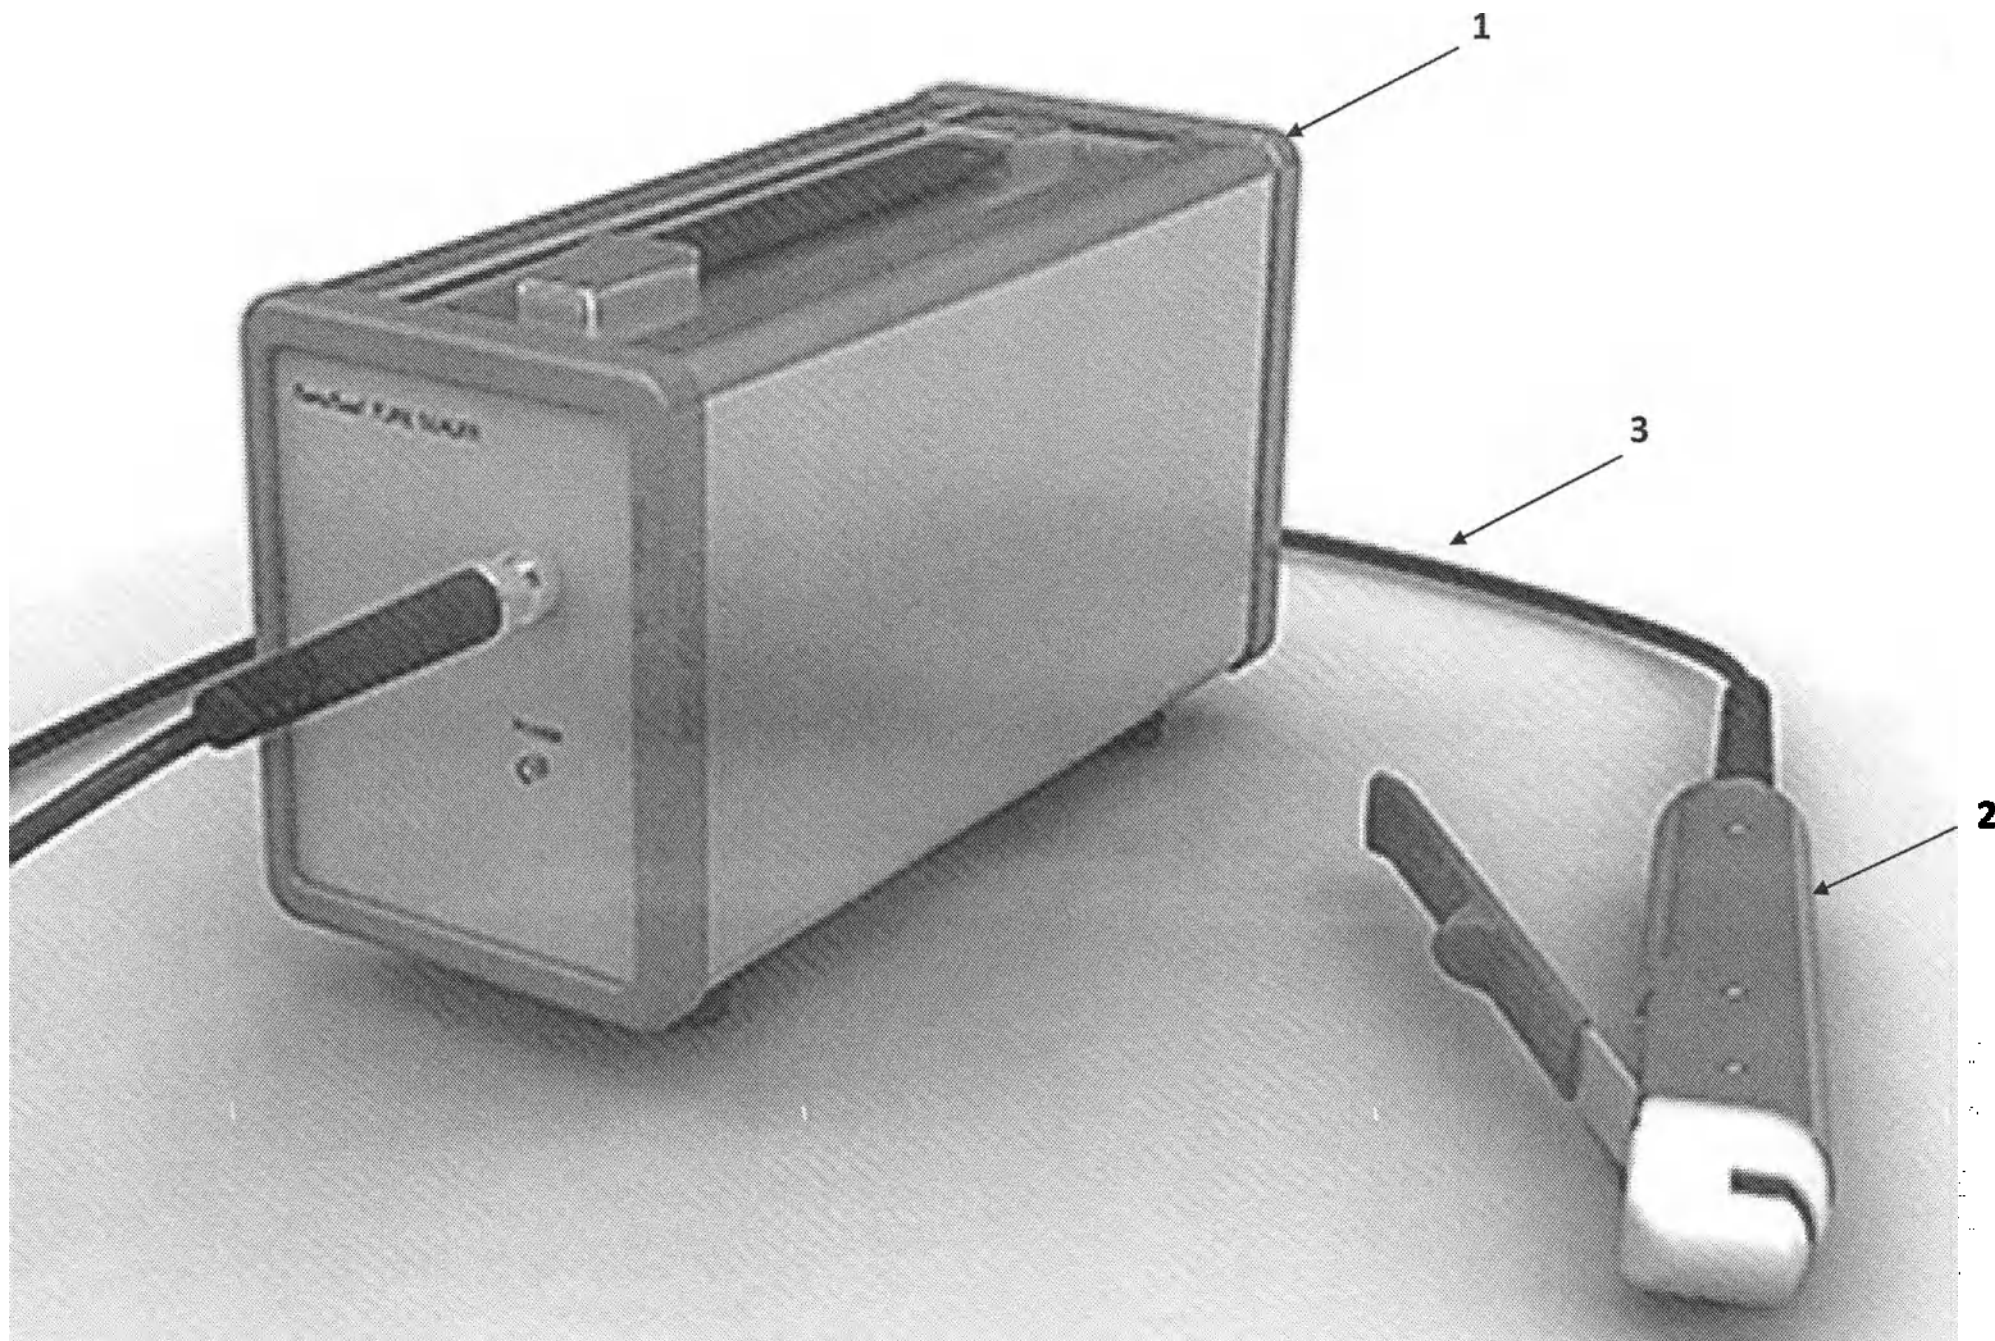


Устройство для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE450 (1 – основной блок модель SE450, 2 - Выносное запаивающее устройство модель 200-038A, 3 - Коаксиальный кабель высокочастотный модель 8219 rg-58a/u, производитель Belden CDT Inc, США)

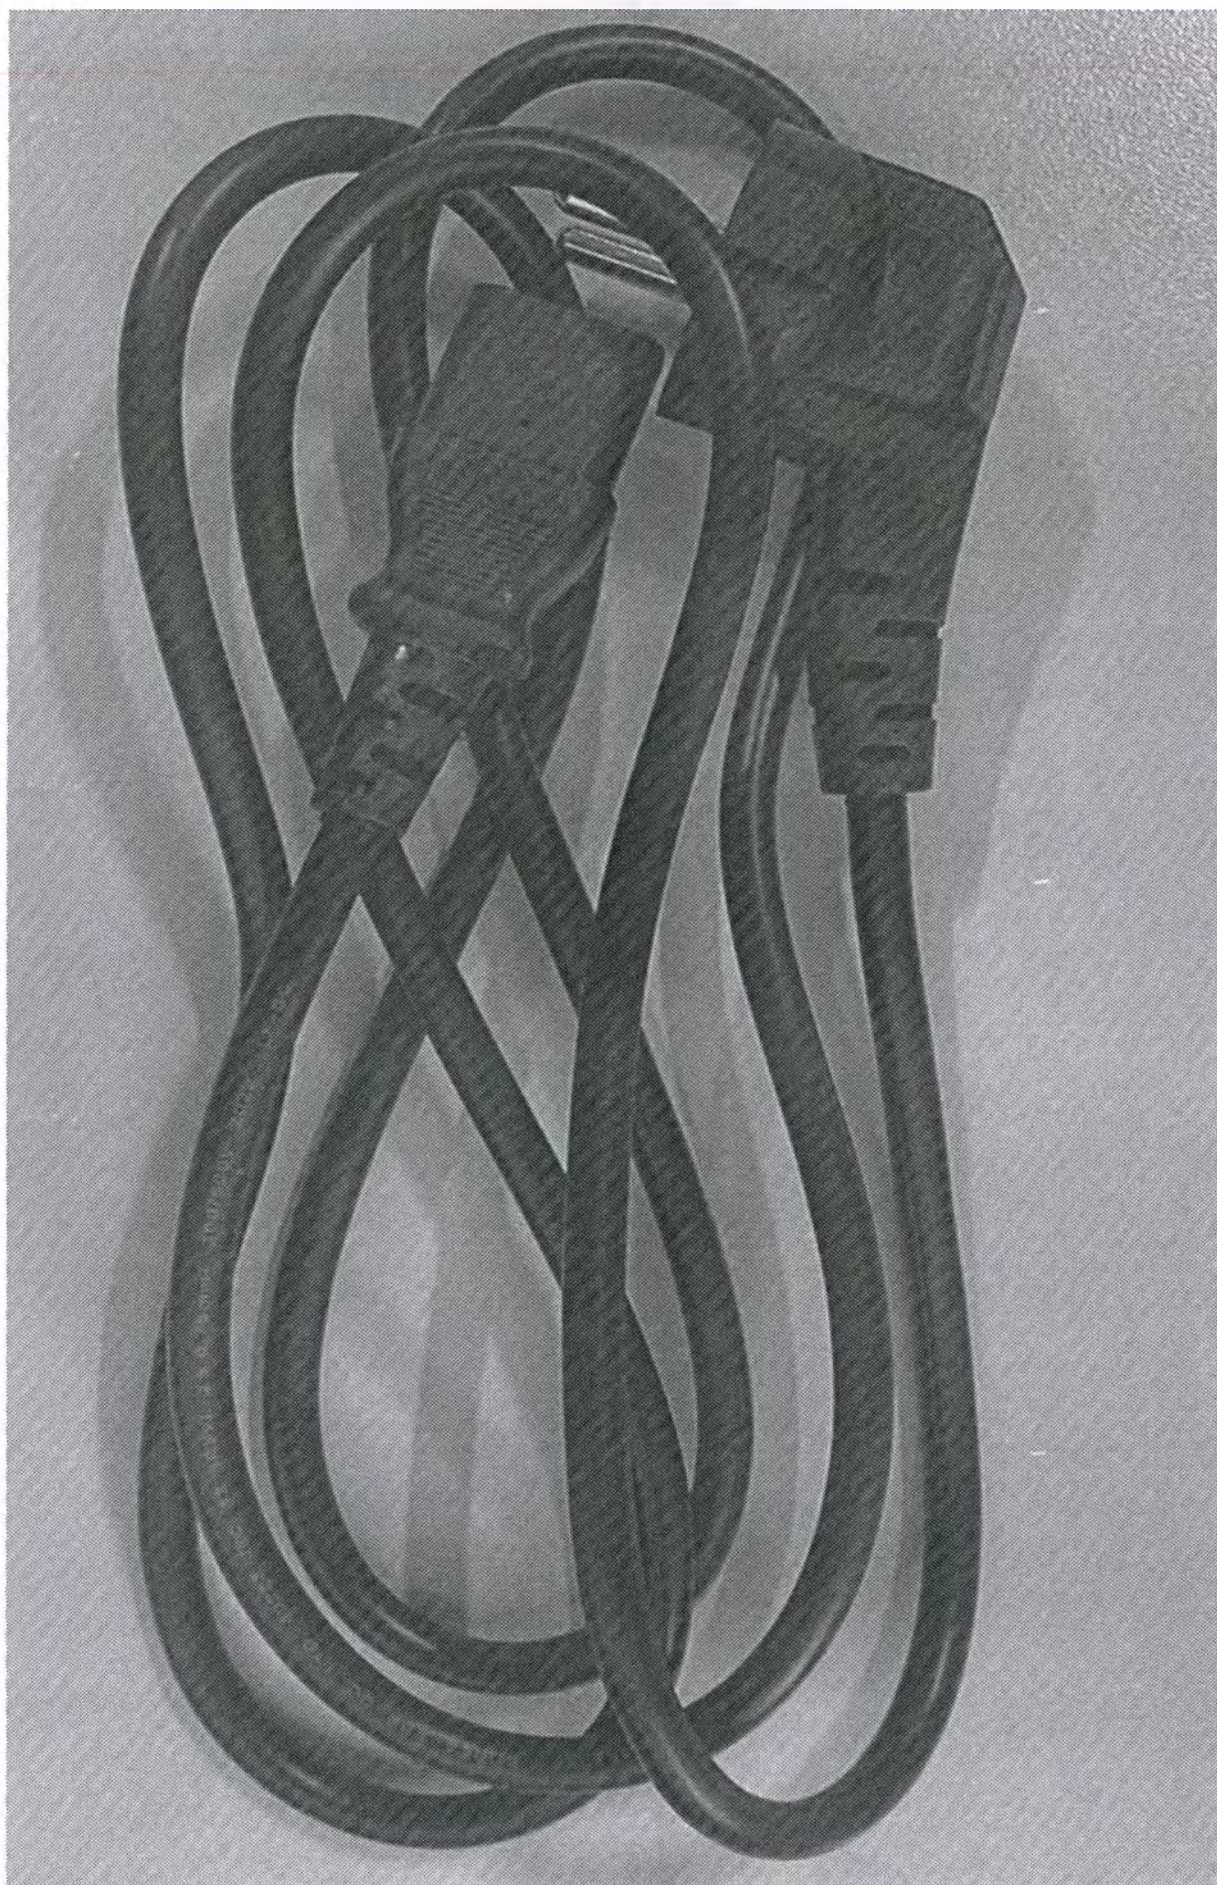


Шнур питания переменного тока модель КОСЕ-3 Н05VV-F 3x0,75 мм² 300/500 В, производства Korea KDK Co. Ltd., Корея

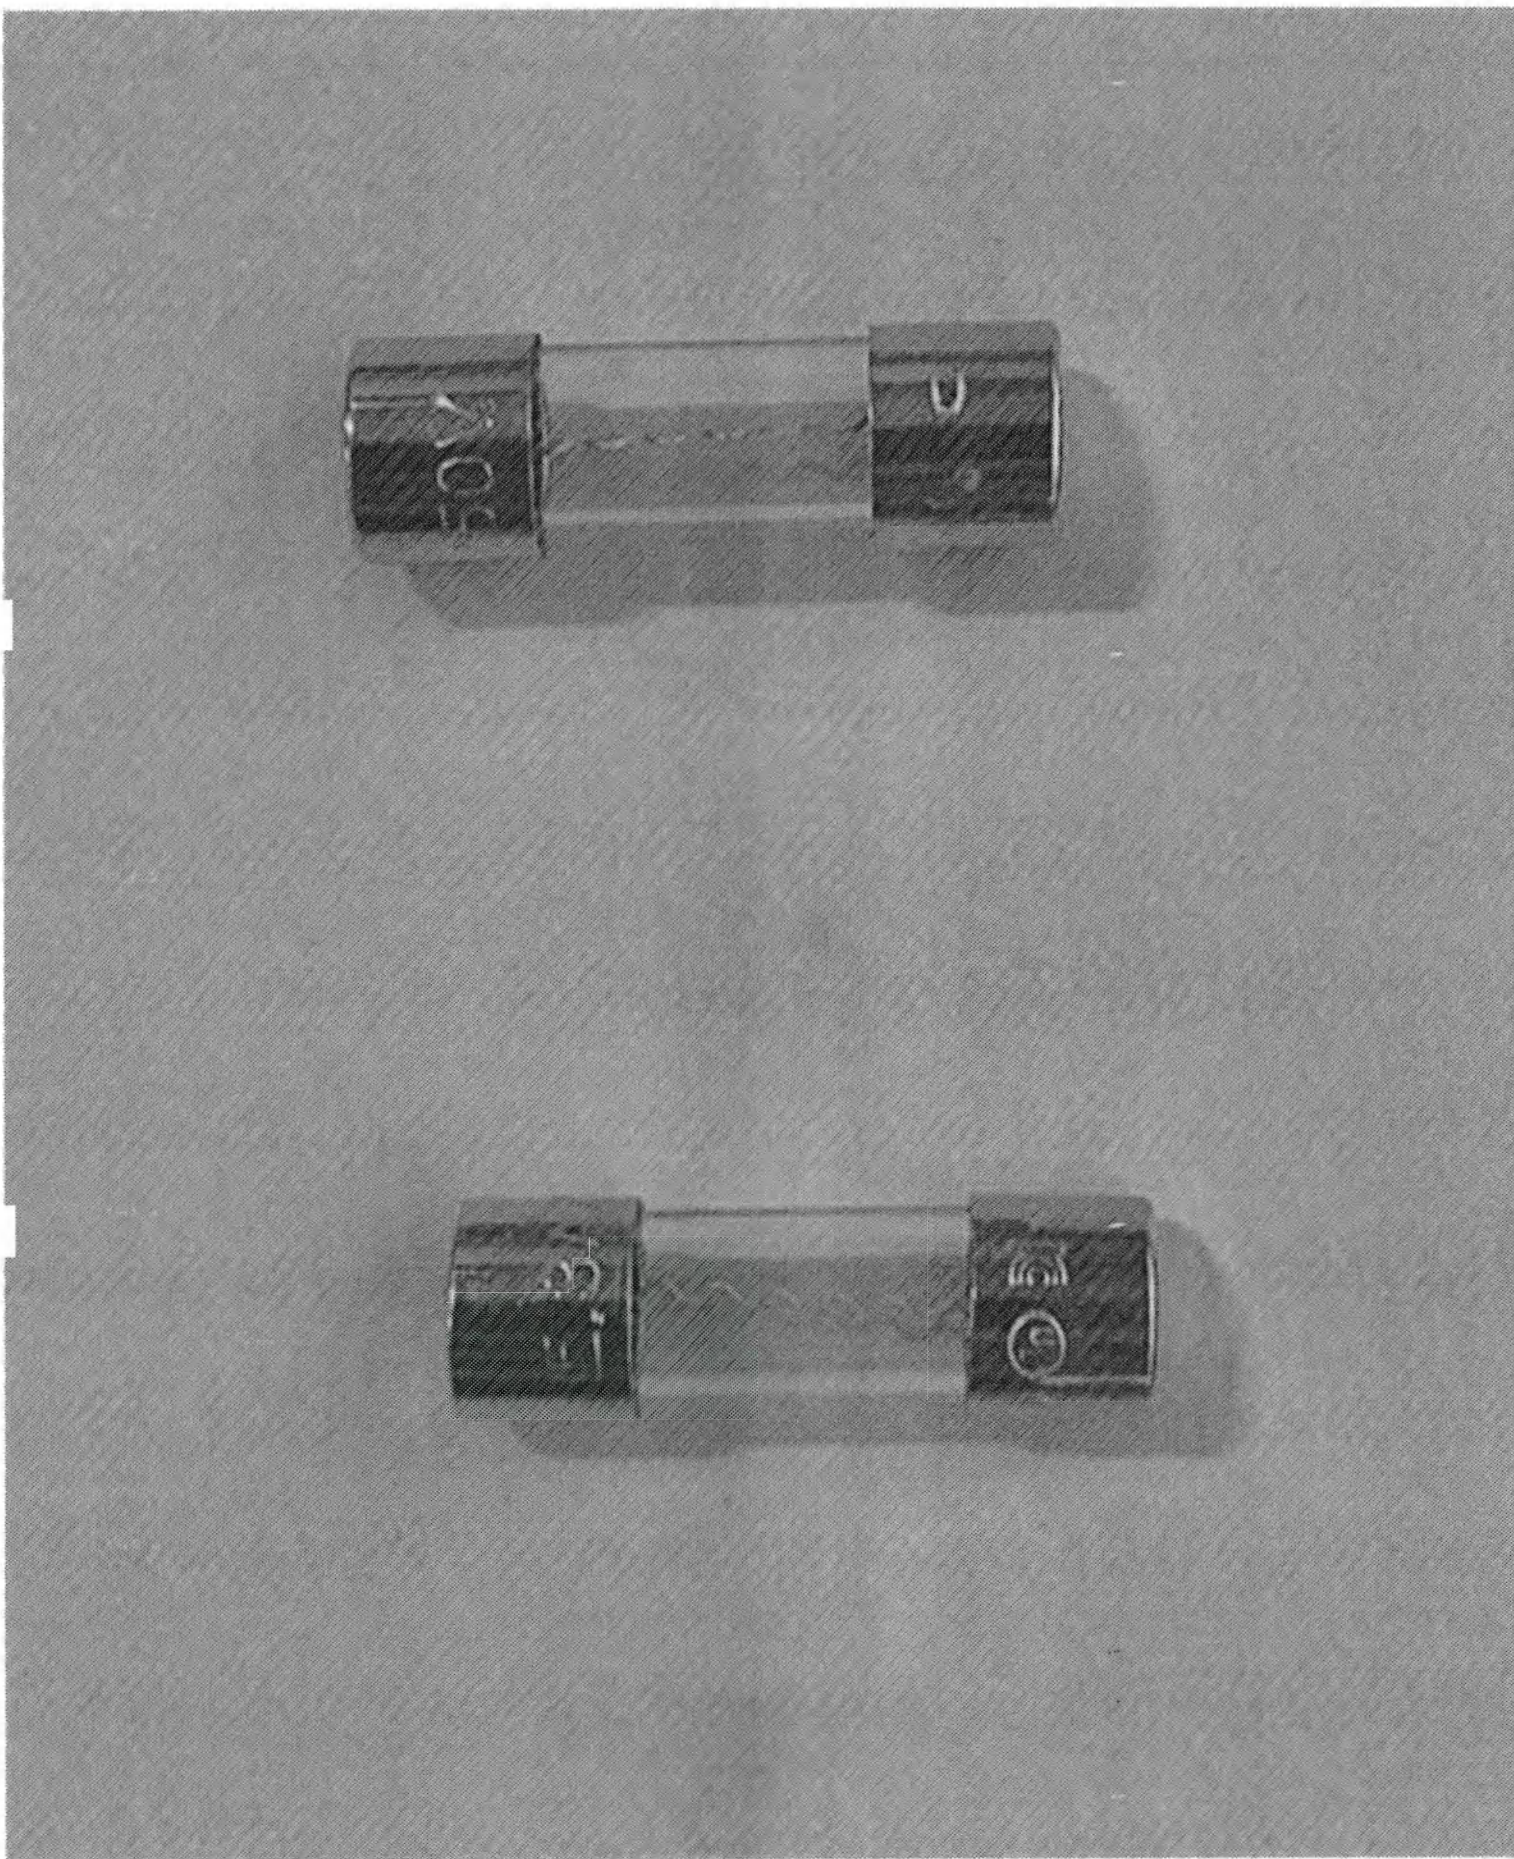

Запасной предохранитель 3А/250 В, производитель Littlefuse Inc., США (2 шт.)

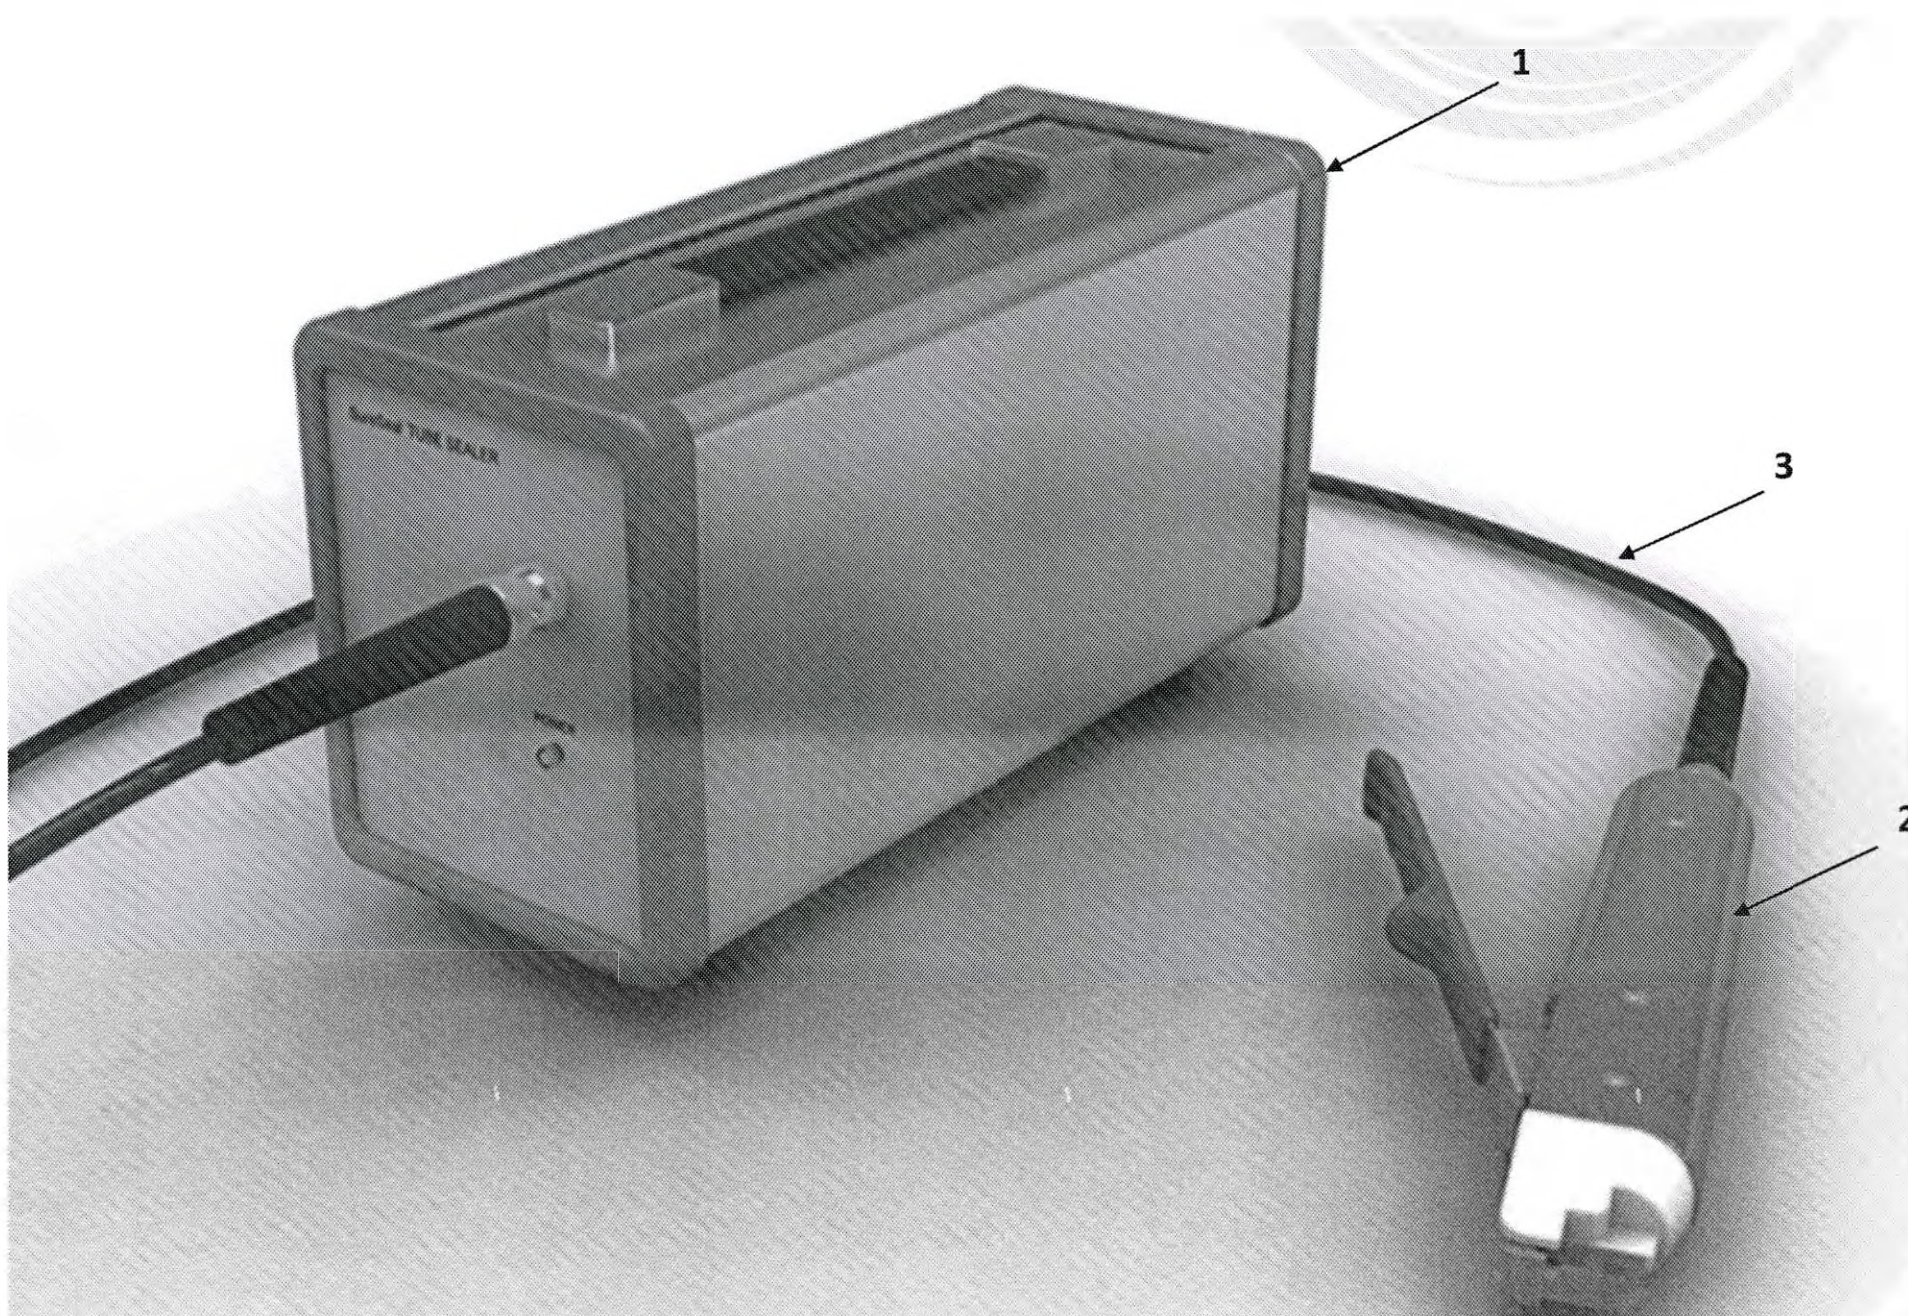


Устройство для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE470 (1 – основной блок модель SE470, 2 - Выносное запаивающее устройство модель 200-038A, 3 - Коаксиальный кабель высокочастотный модель 8219 rg-58a/u, производитель Belden CDT Inc, США)

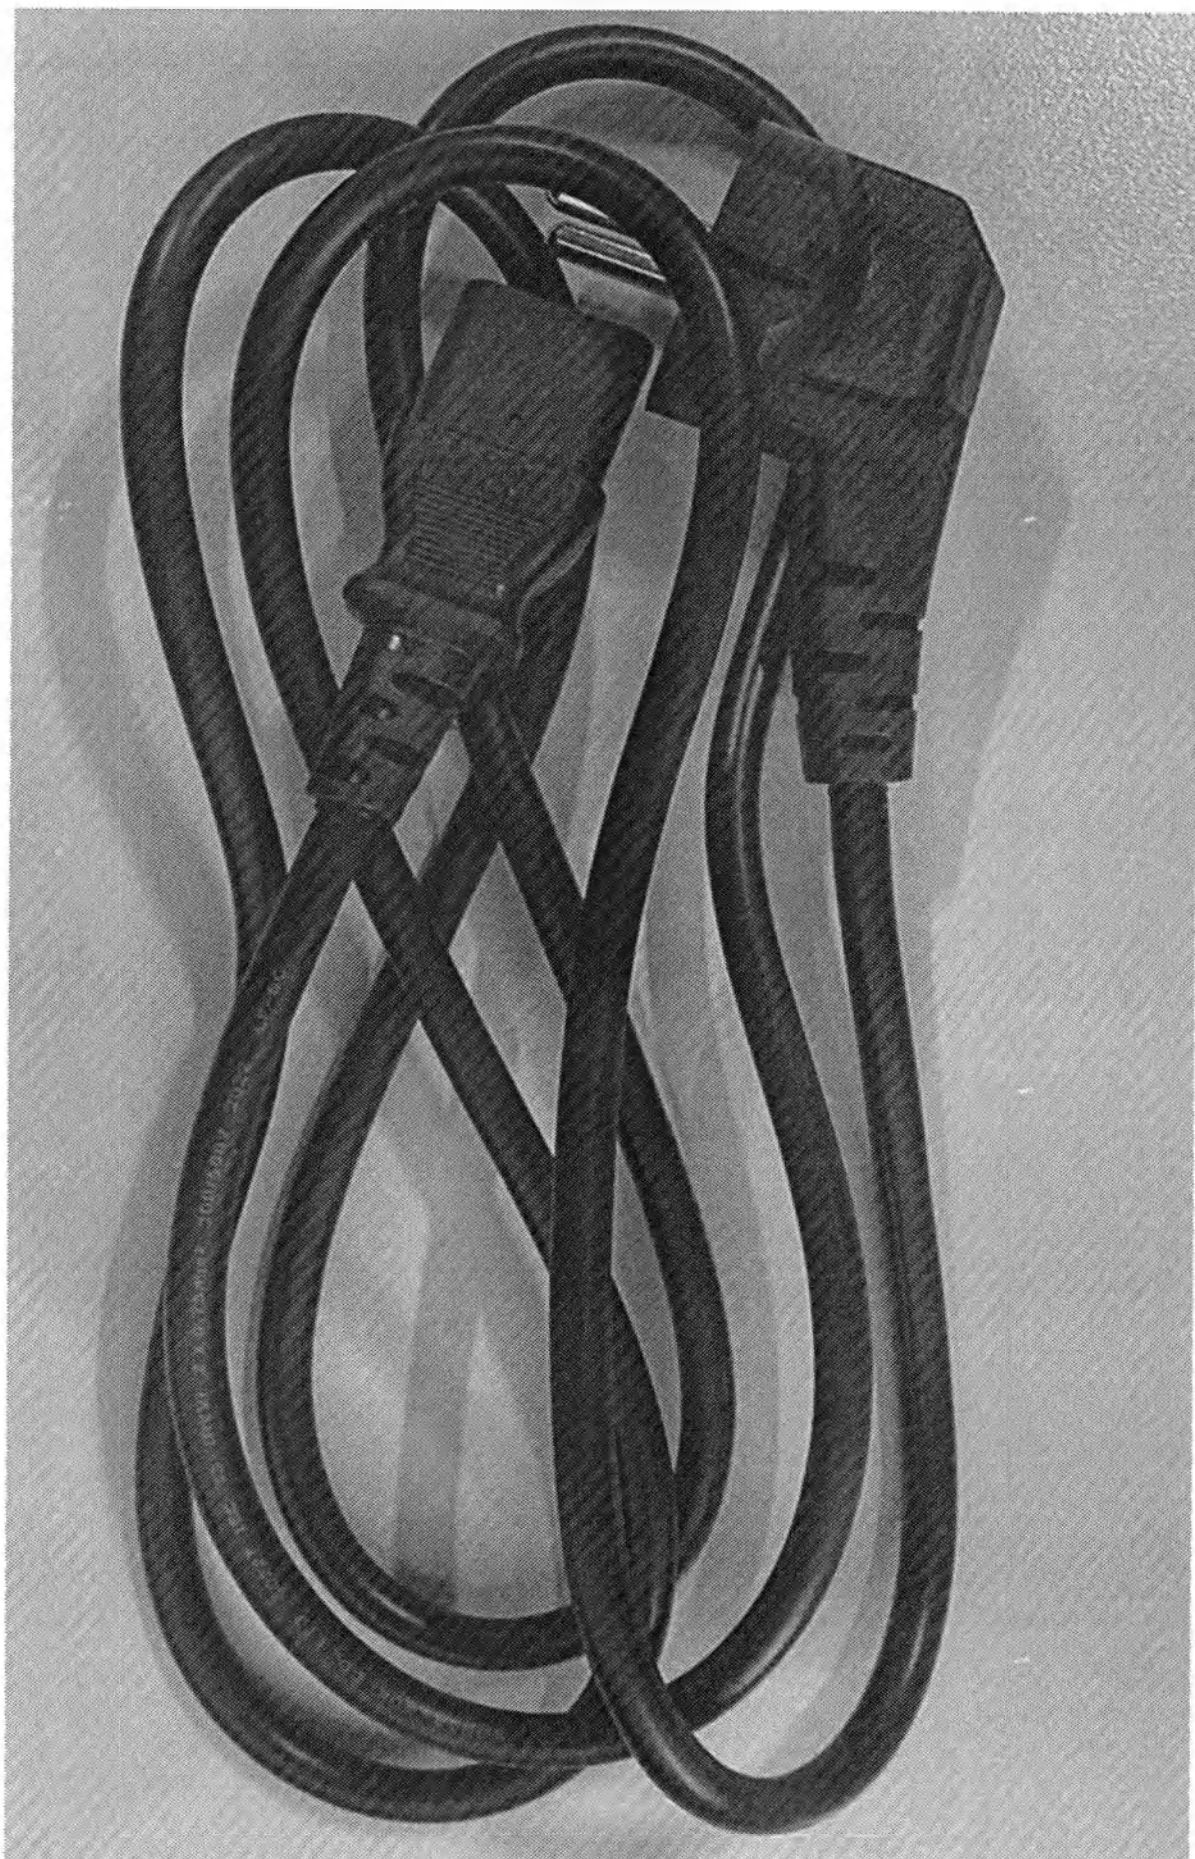


Шнур питания переменного тока 220-240 В, модель KOCE-3 H05VV-F 3x0,75 мм² 300/500 В, производства Korea KDK Co. Ltd., Корея




Запасной предохранитель 3А/250 В, производитель Littlefuse Inc., США (2 шт.)

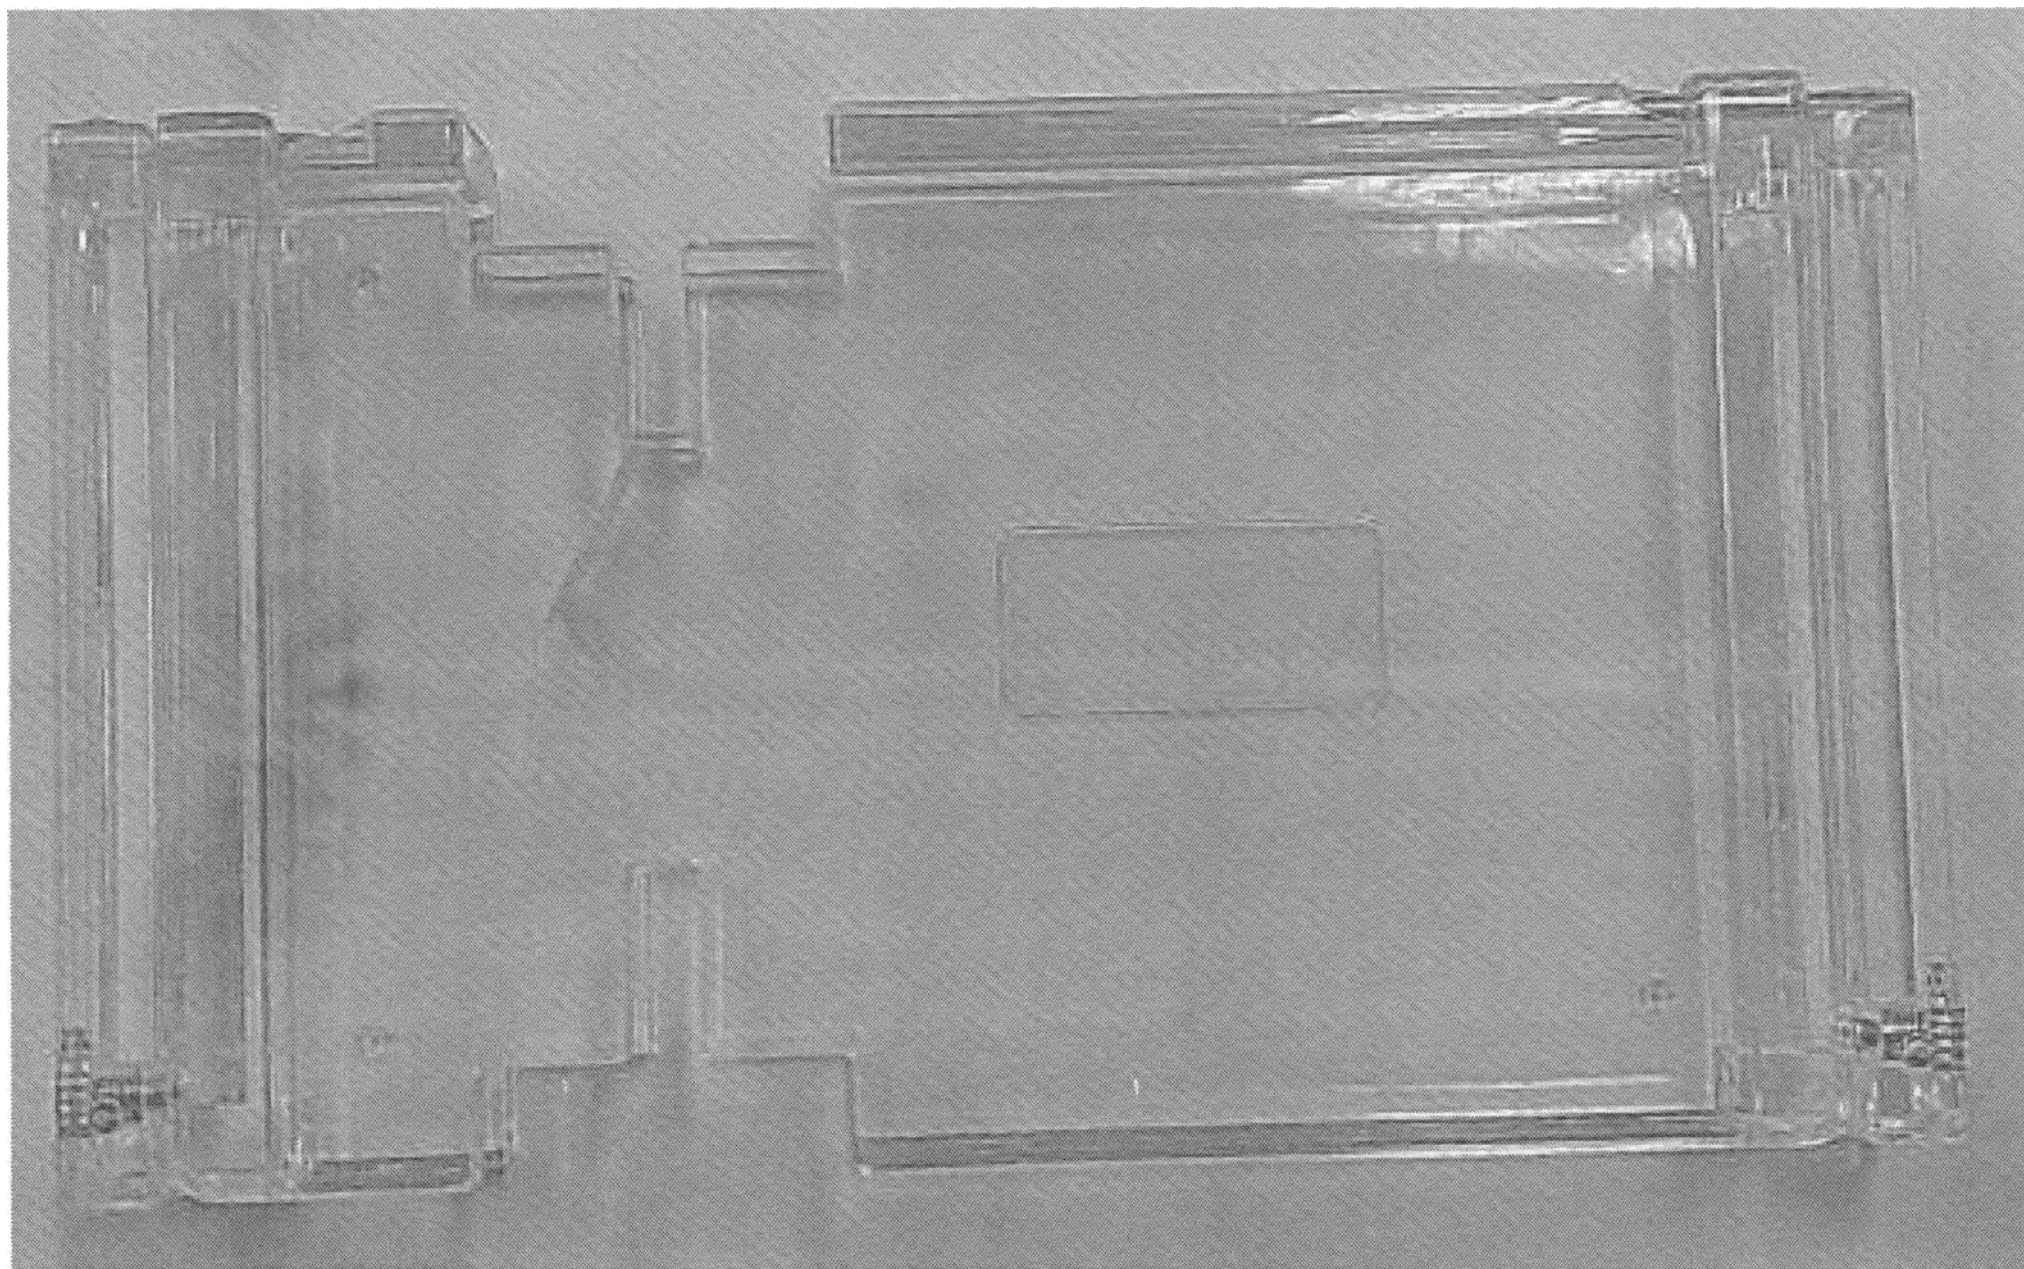


Запалвающее приспособление

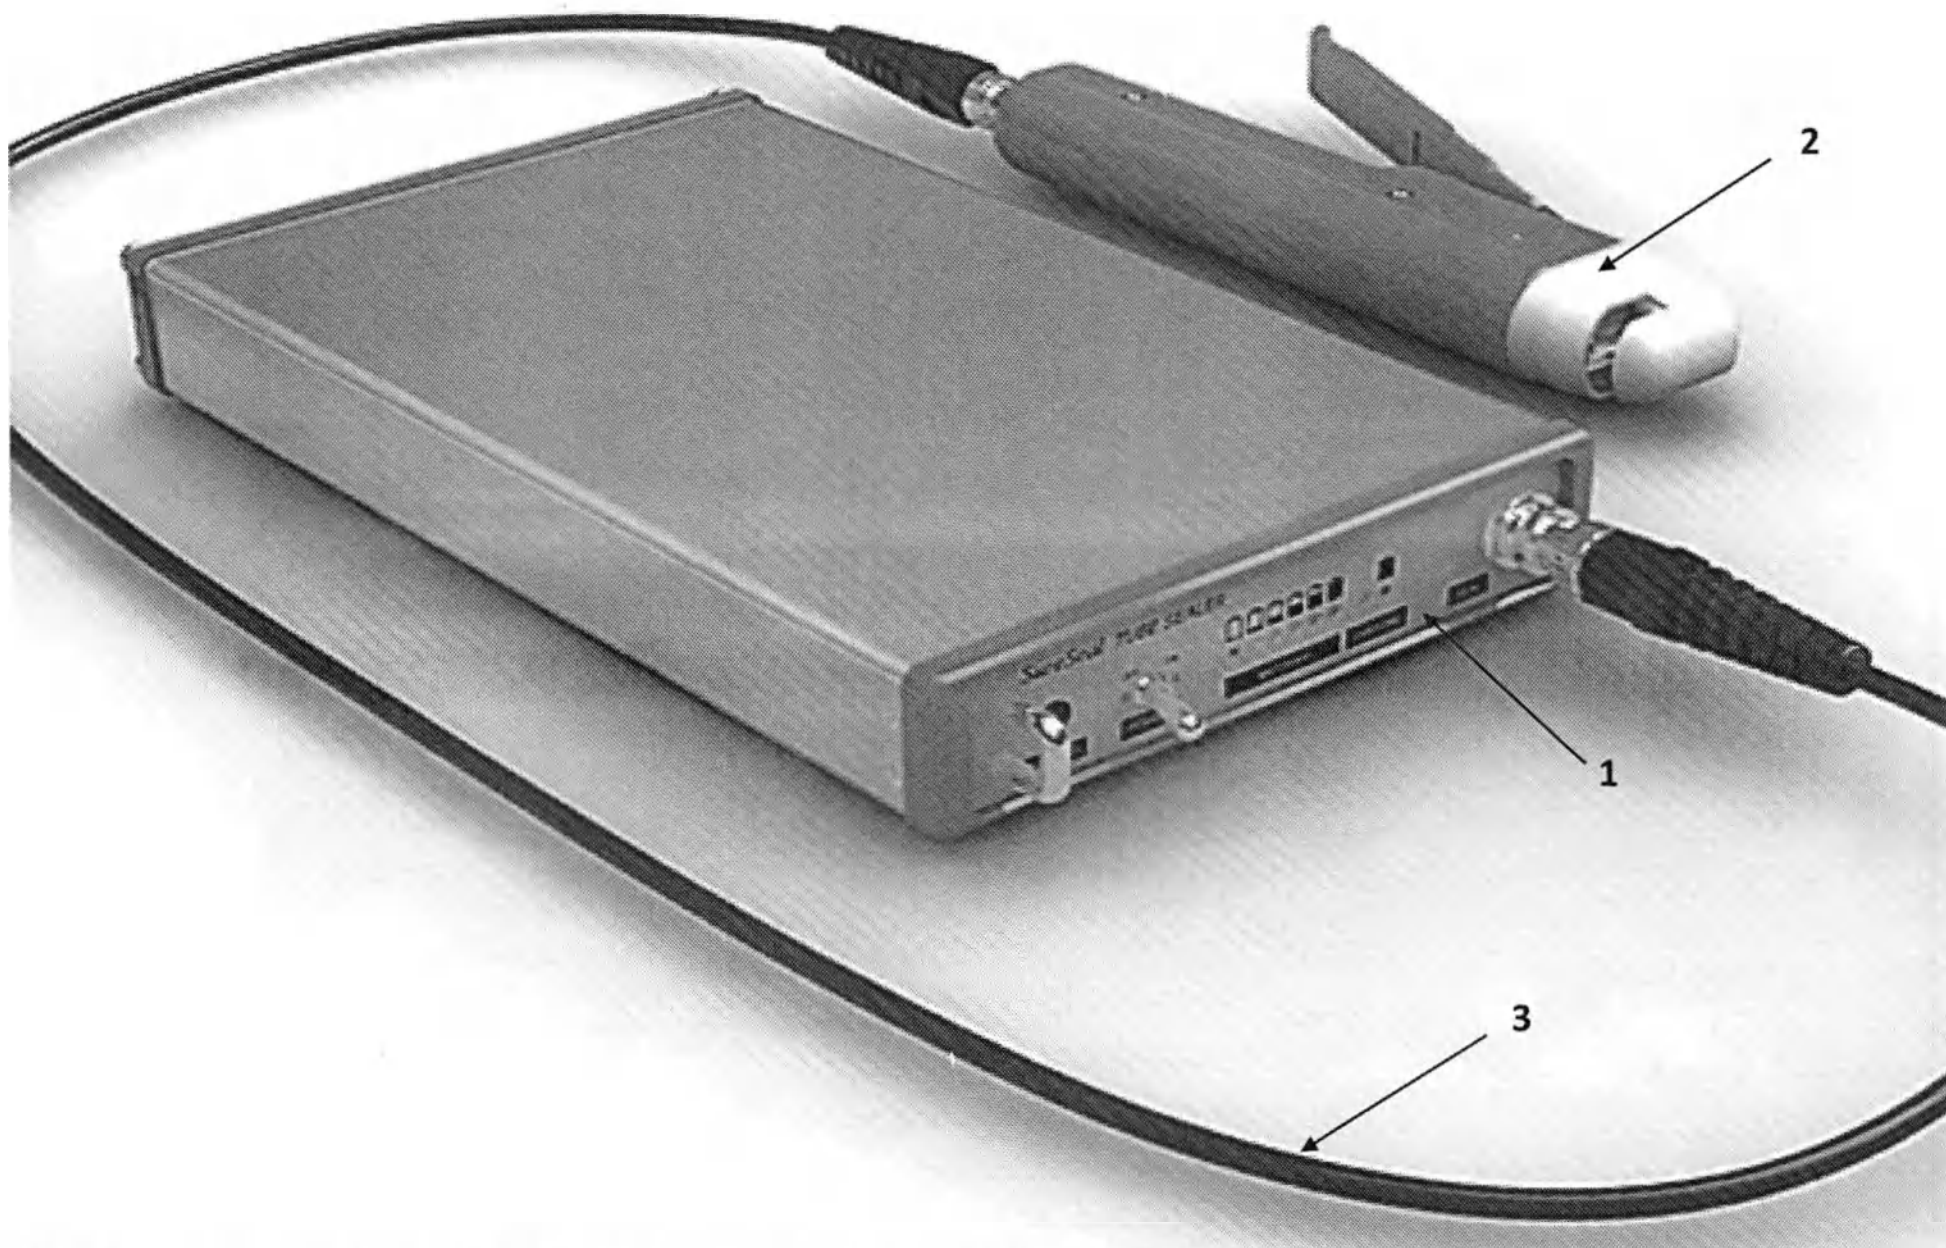


Устройство для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE700 (1 – основной блок модель SE700, 2 - Выносное запаивающее устройство модель 200-038A, 3 - Коаксиальный кабель высокочастотный модель 8219 rg-58a/u, производитель Belden CDT Inc, США)

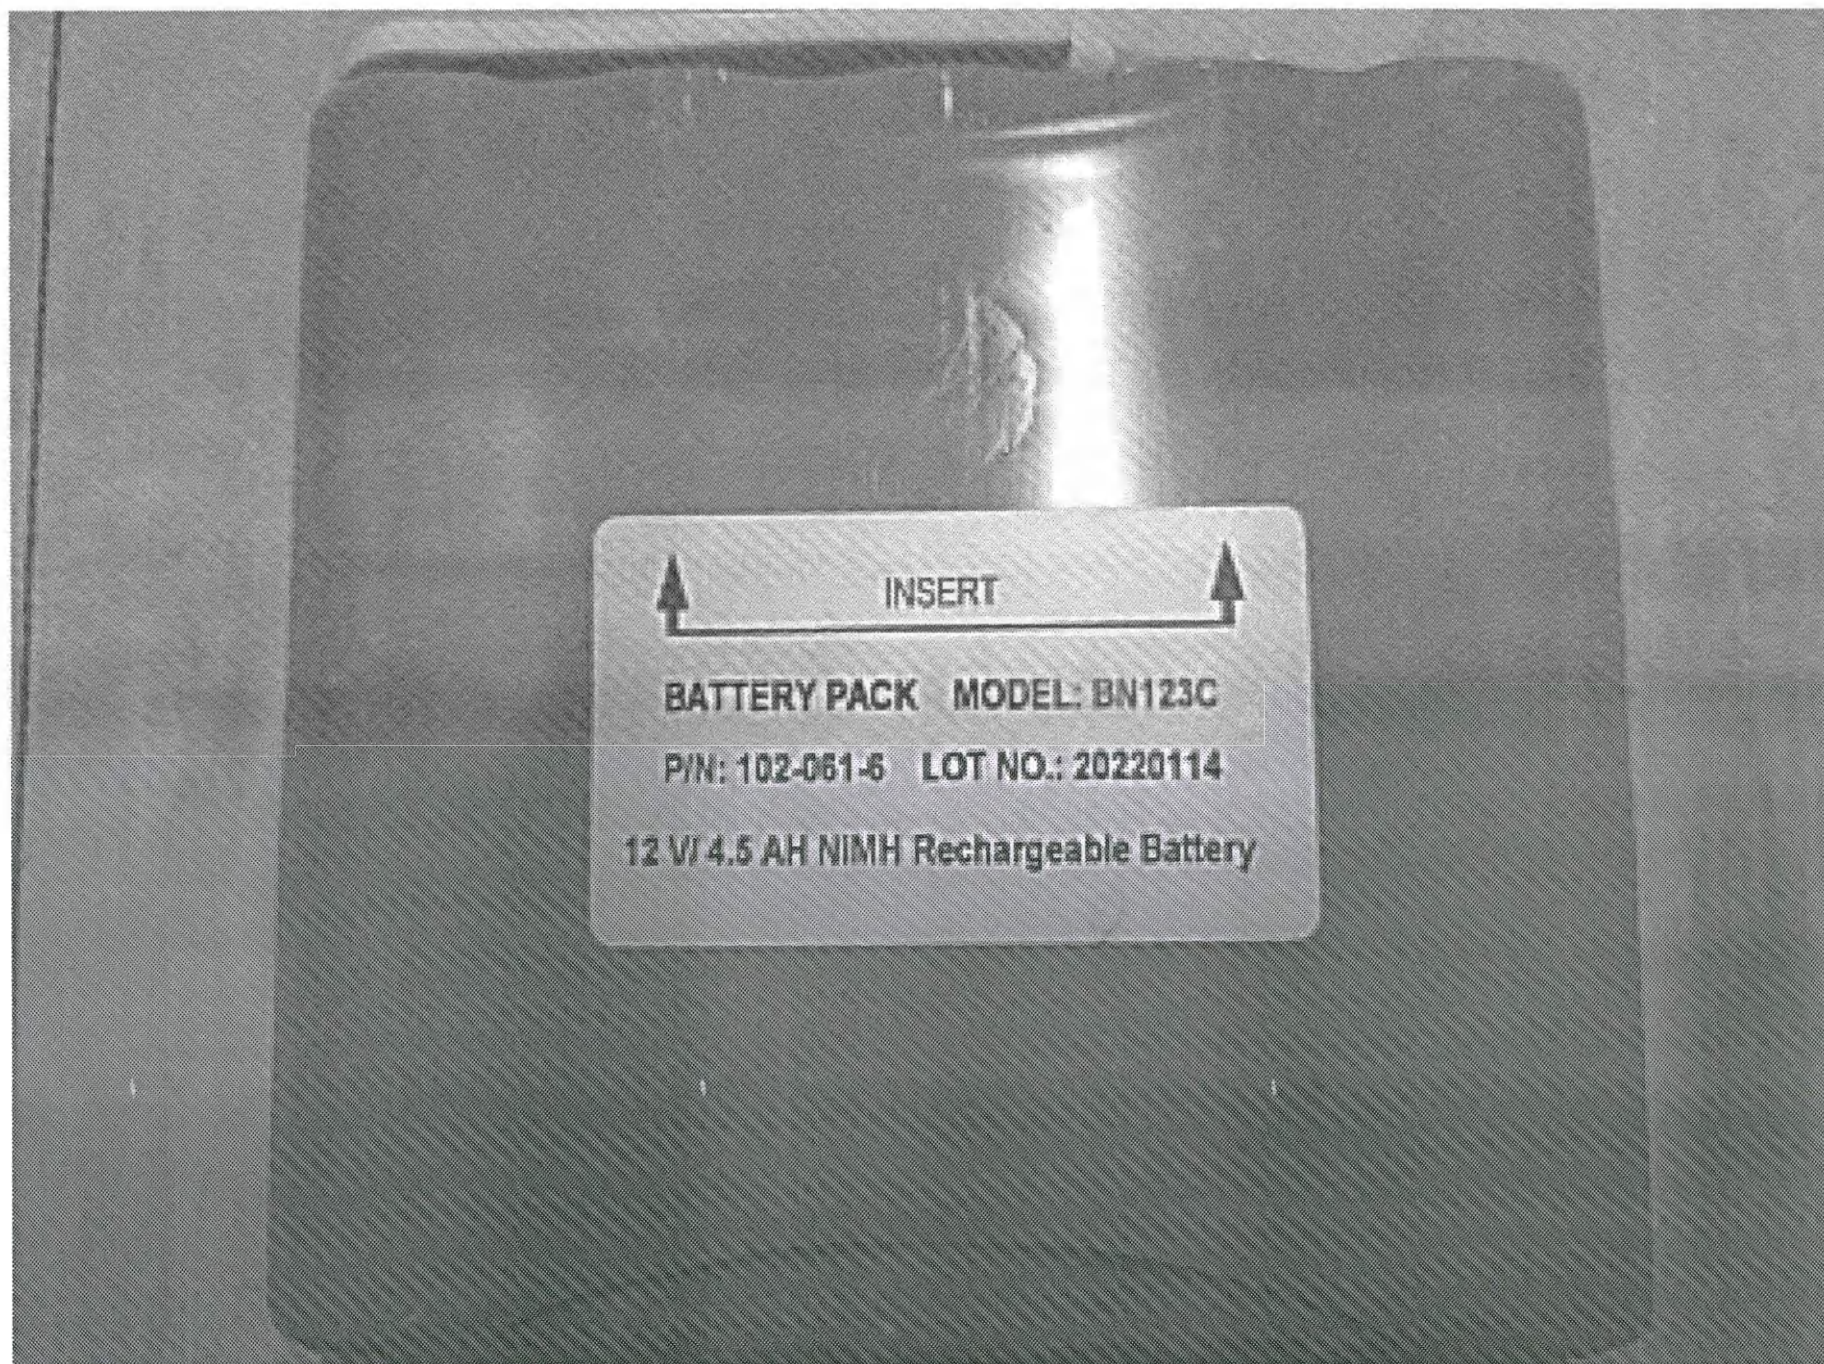


Аккумулятор Ni-MH перезаряжаемый сменный модель BN123C (12 В, 4.5 А*ч)

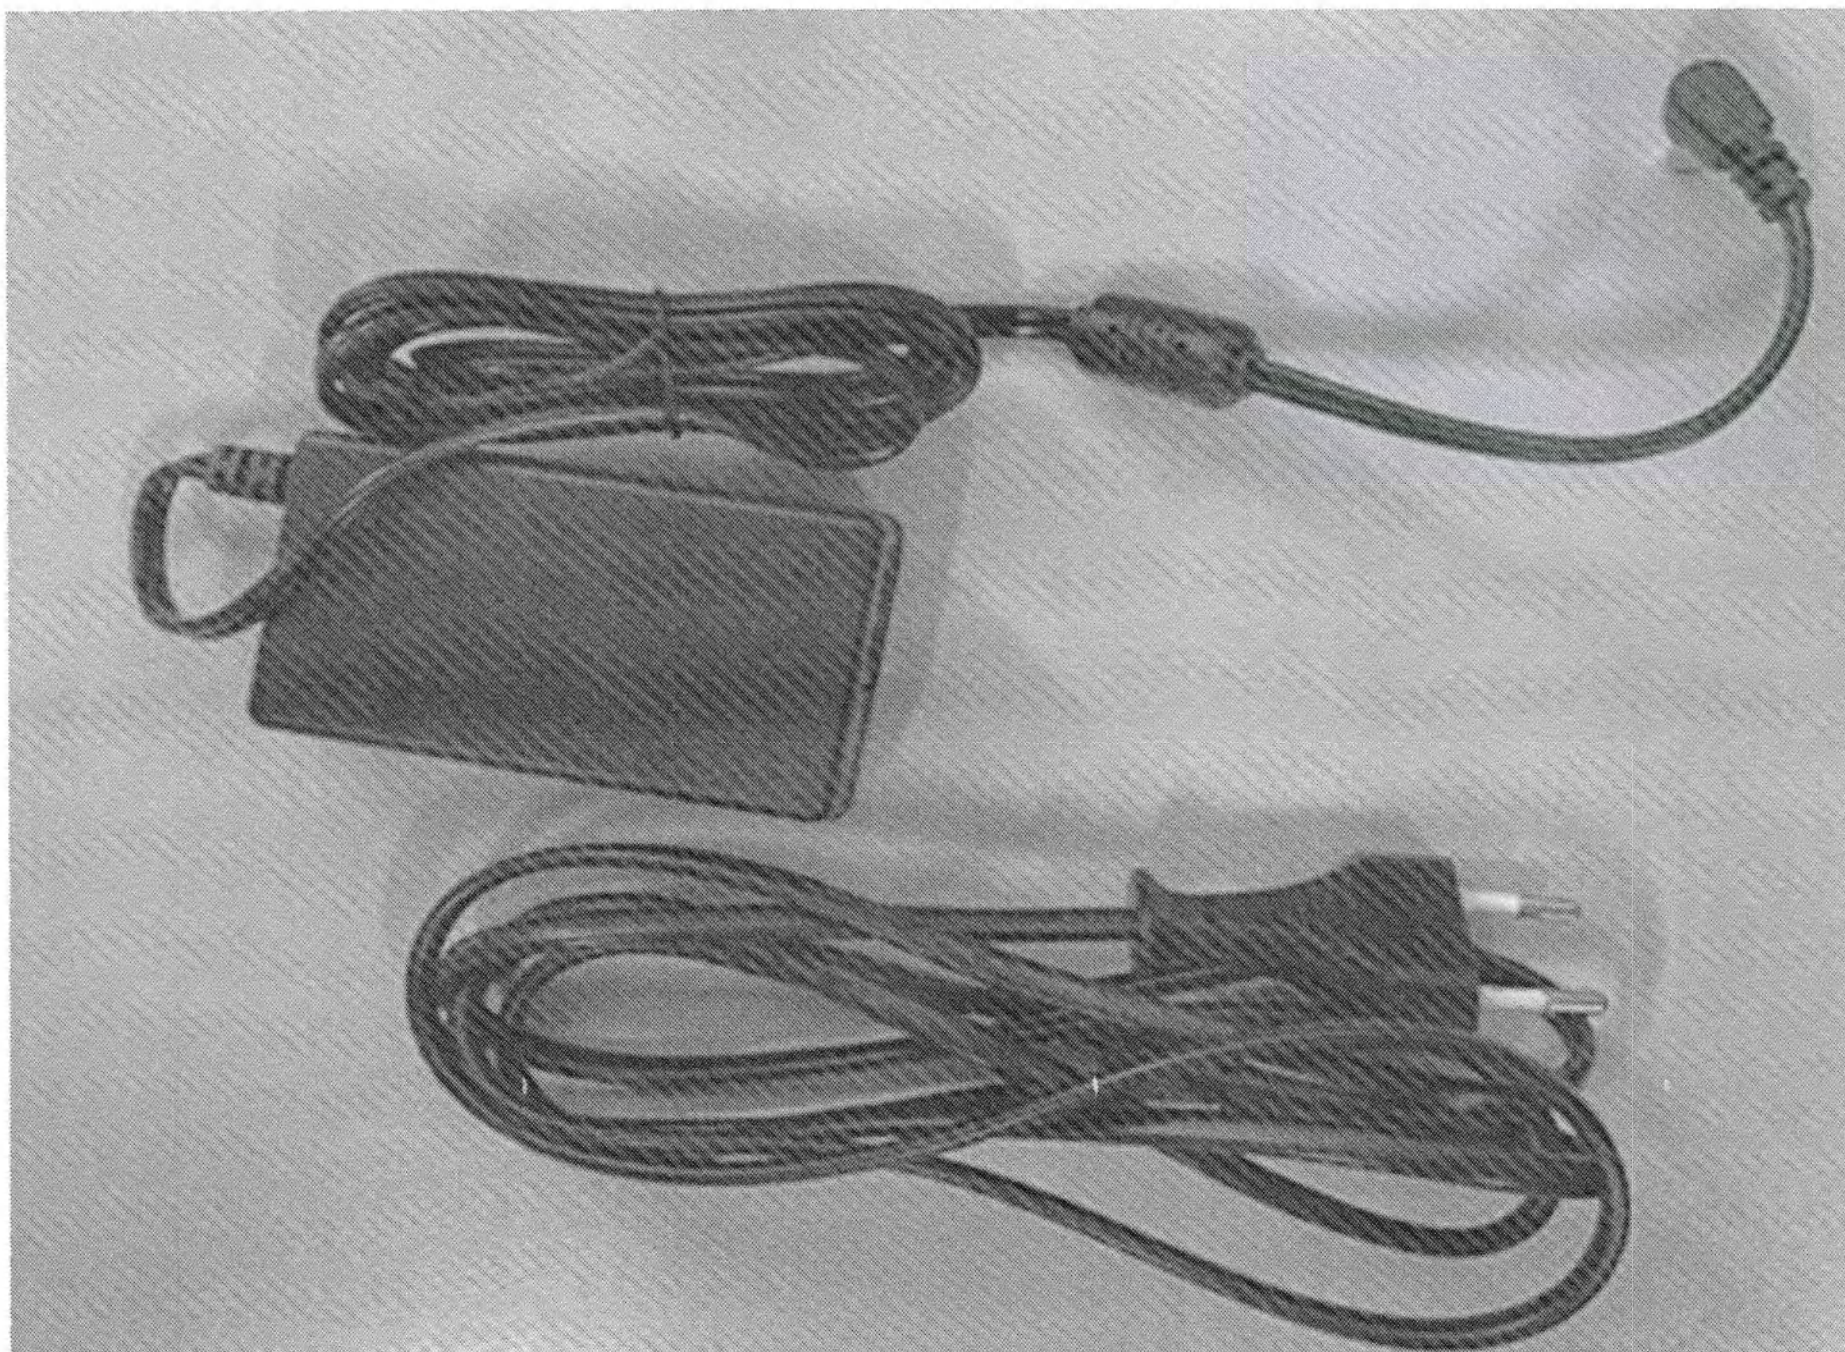

Зарядное устройство, модель SW-00180100-S10, производитель Shenzhen Starwell Technology Co., Ltd.. Китай

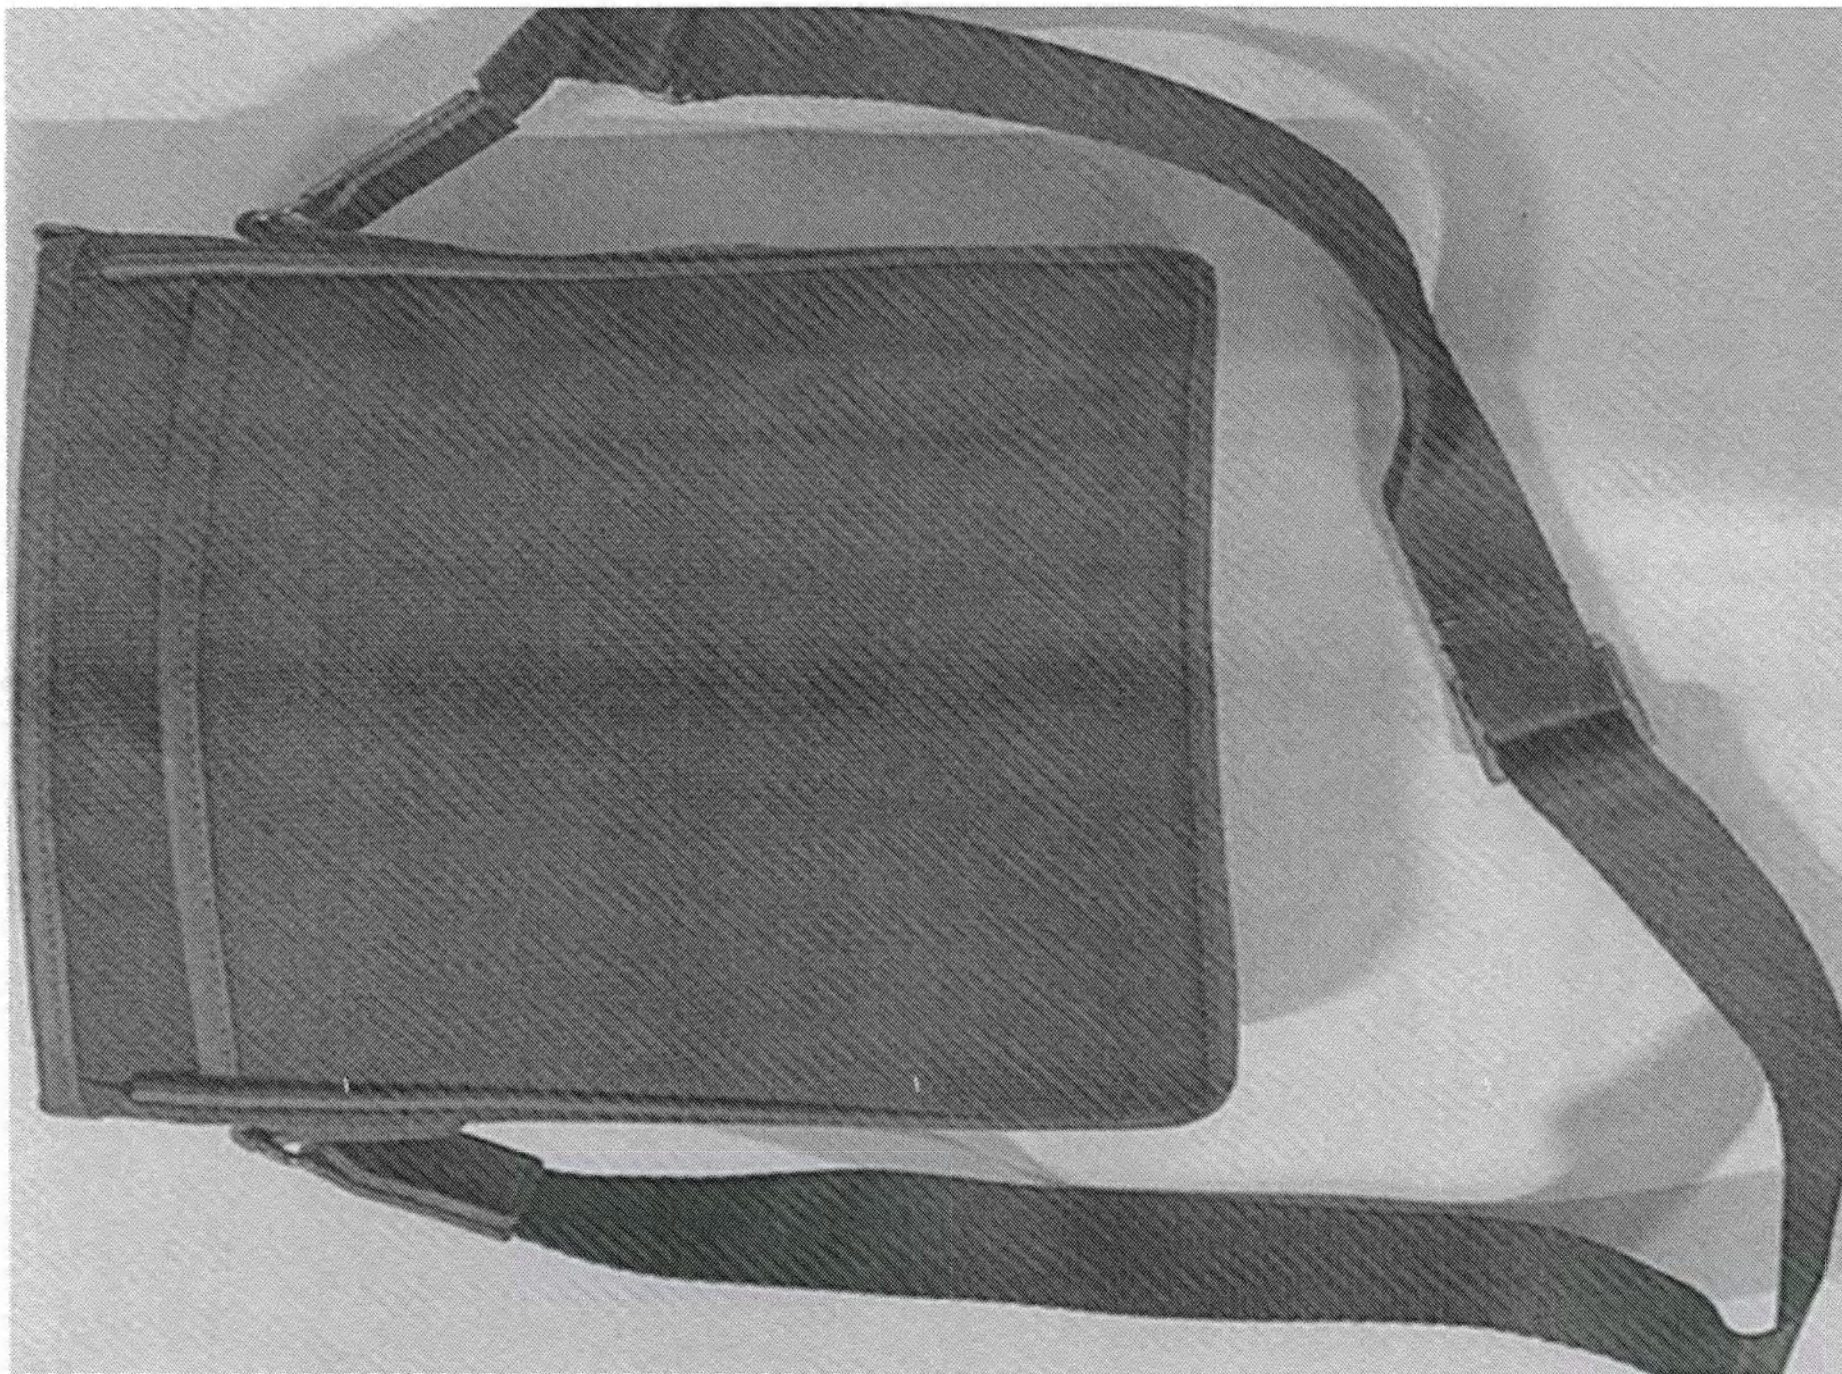


Сумка для переноски

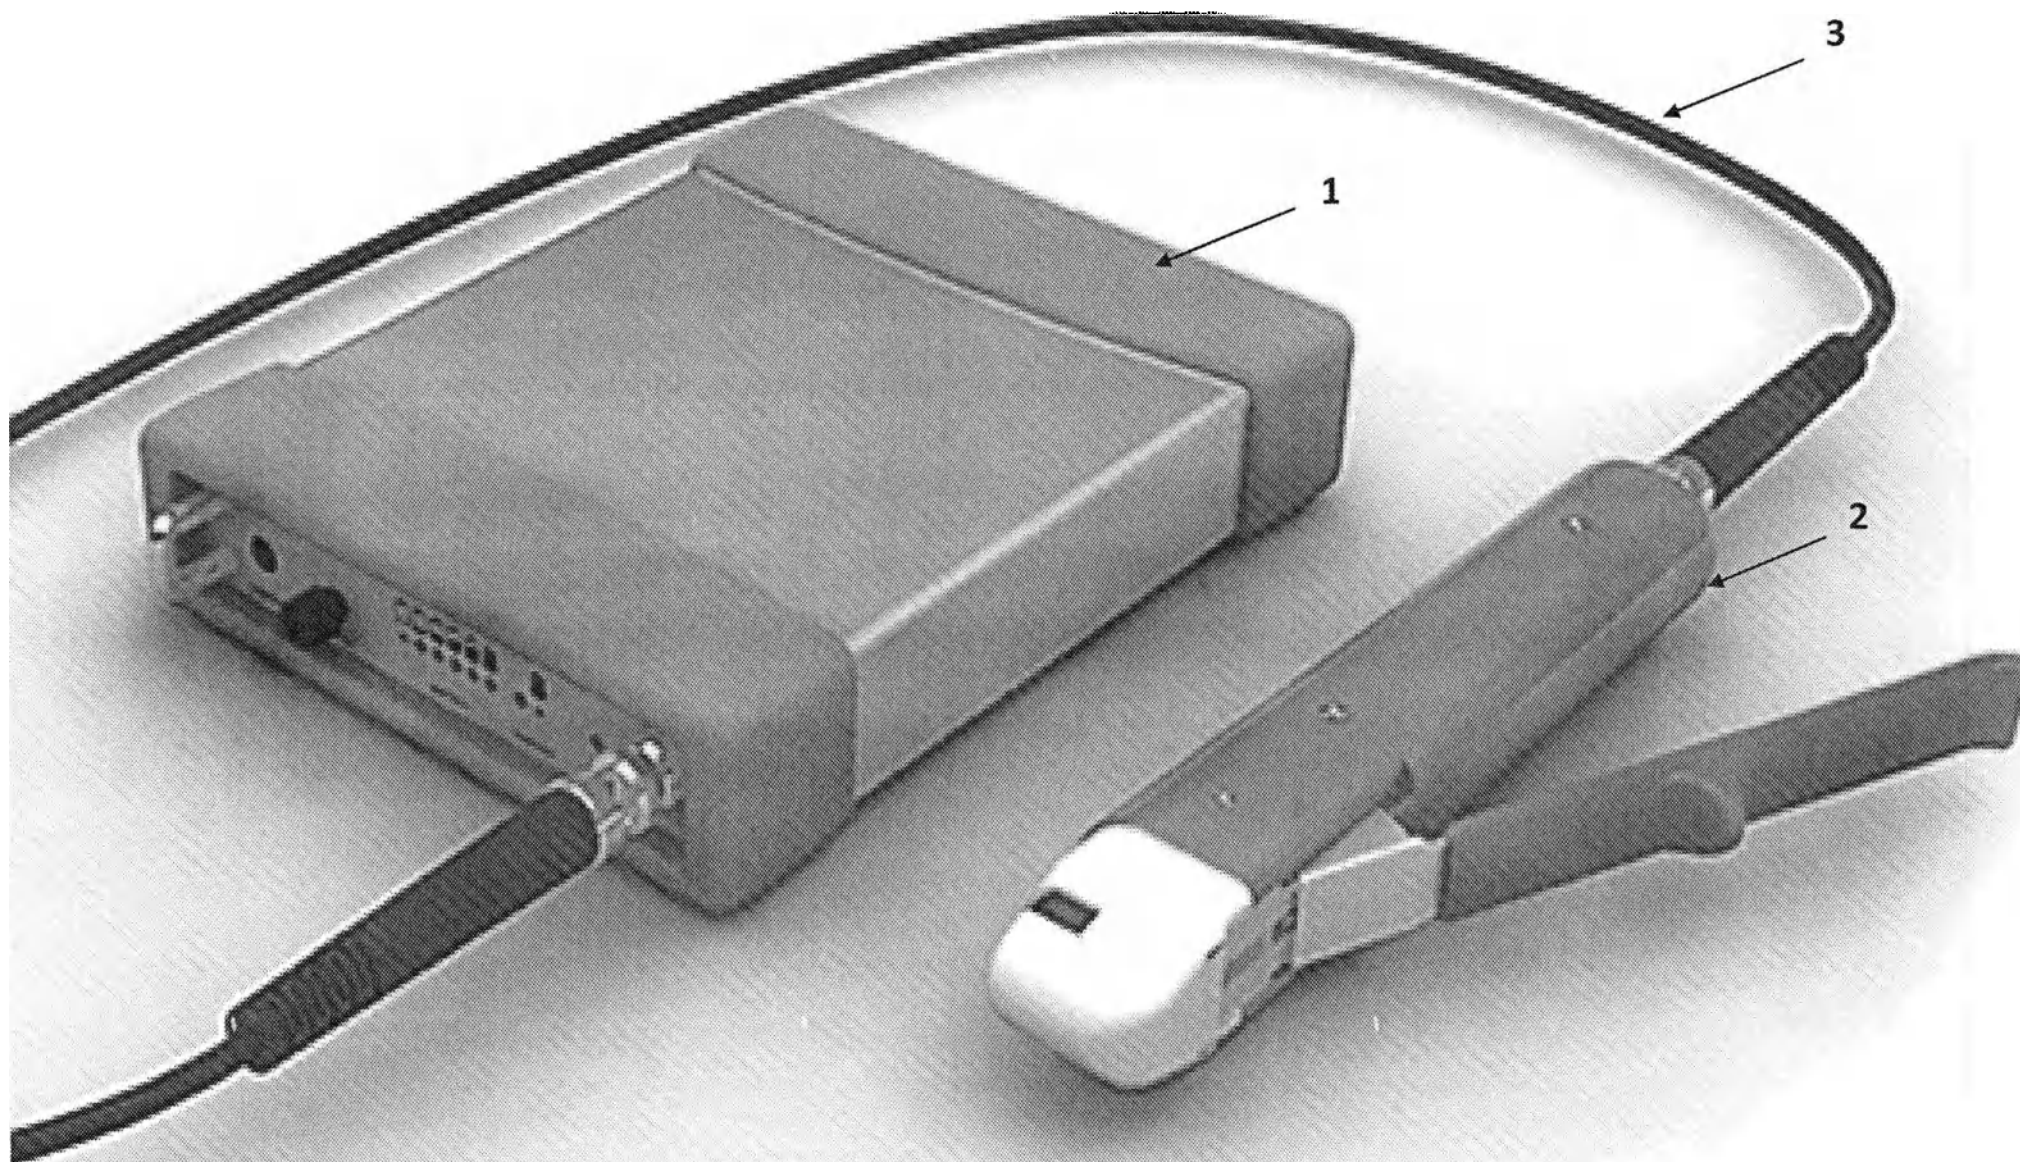


Устройство для заправки магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE730 (1 – основной блок модель SE730, 2 - Выносное питающее устройство модель 200-038A, 3 - Коаксиальный кабель высокочастотный модель 8219 rg-58a/u, производитель Belden CDT Inc, США)




Аккумулятор Li-Ion перезаряжаемый сменный модель BL141 (14.4 В, 2.5 А*ч)

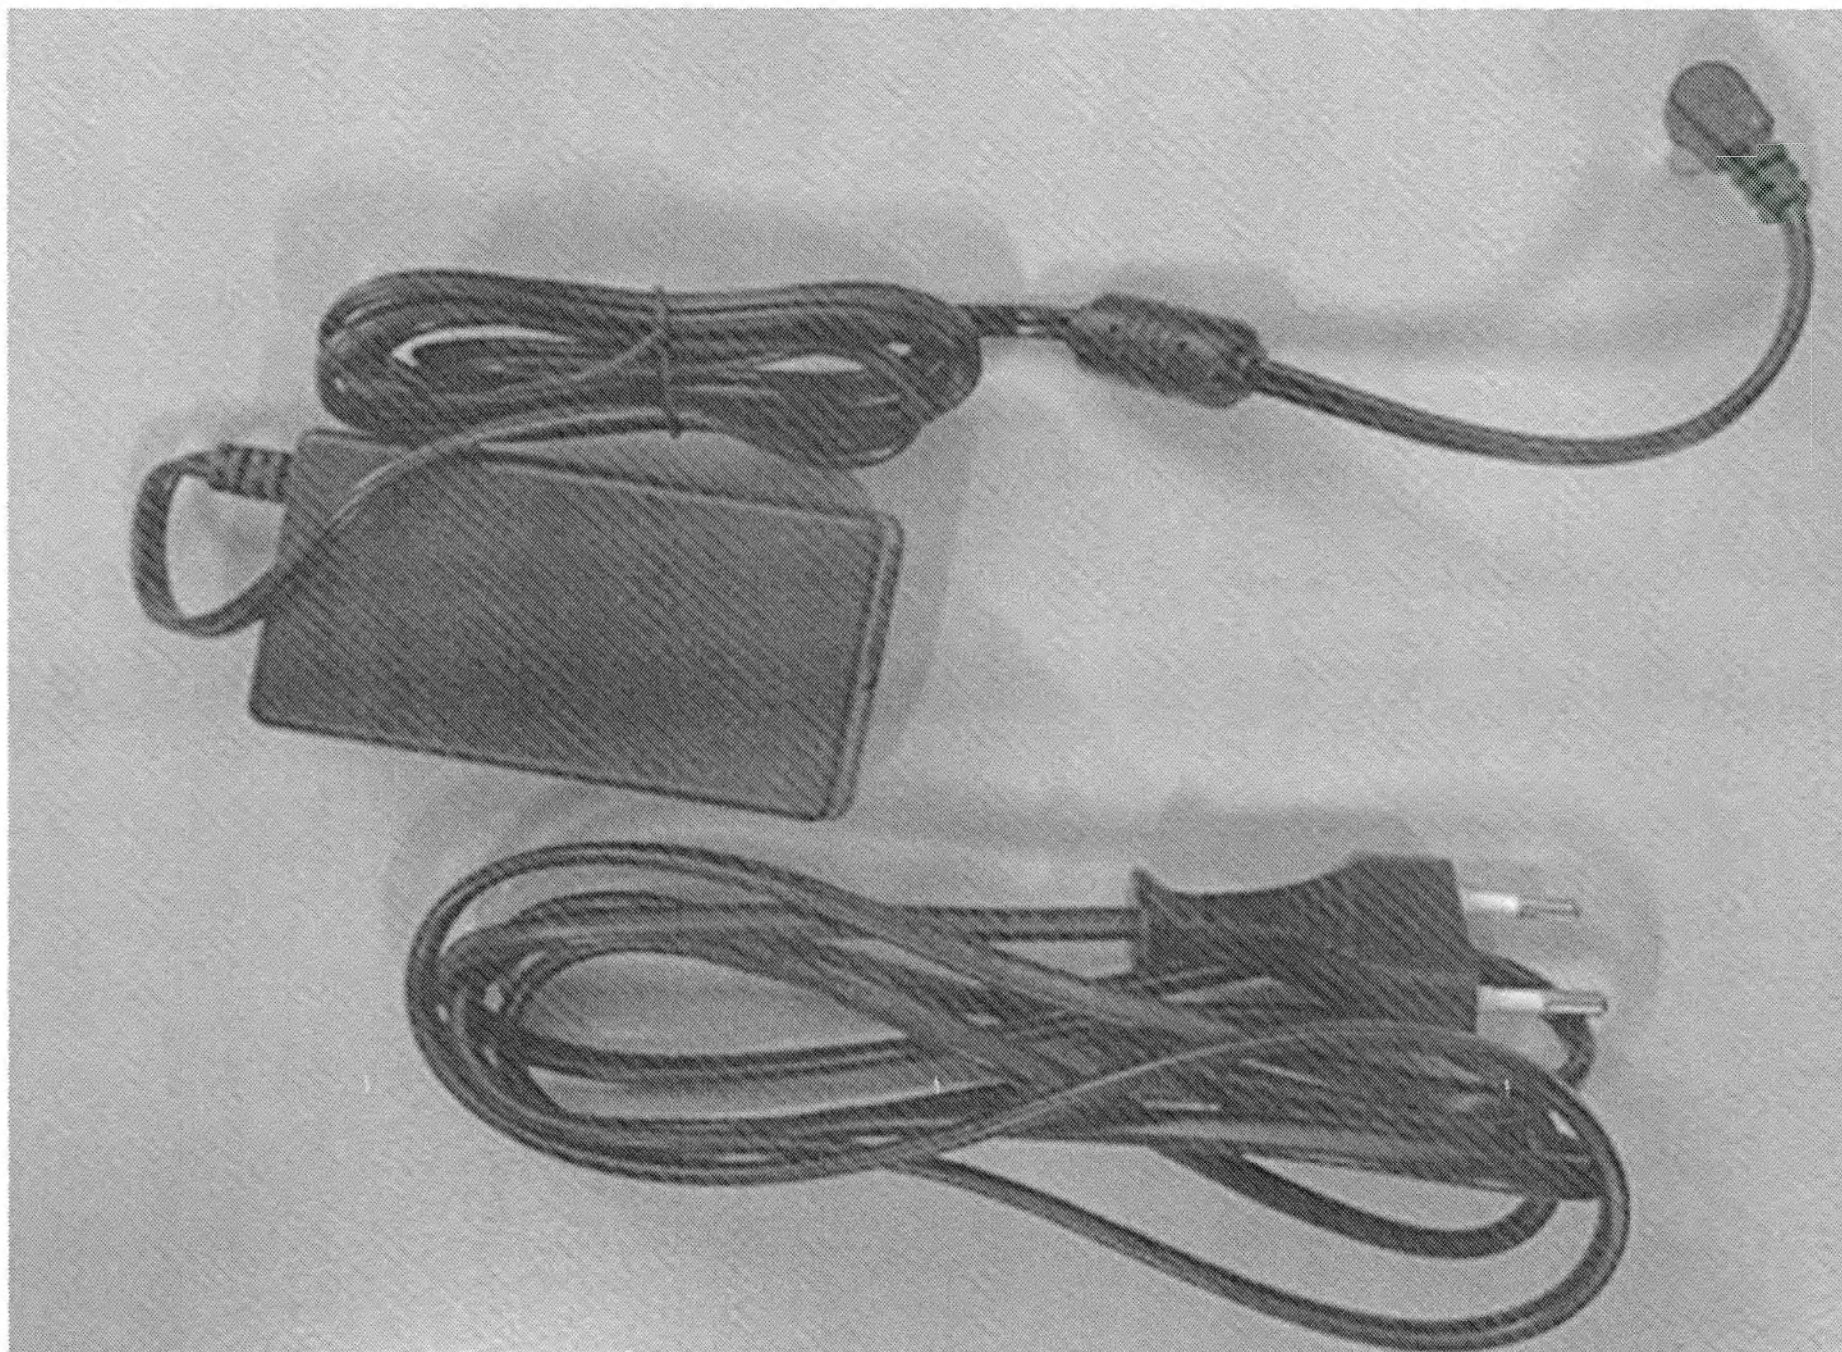


Зарядное устройство, модель SW-00180100-S10, производитель Shenzhen Starwell Technology Co., Ltd.. Китай

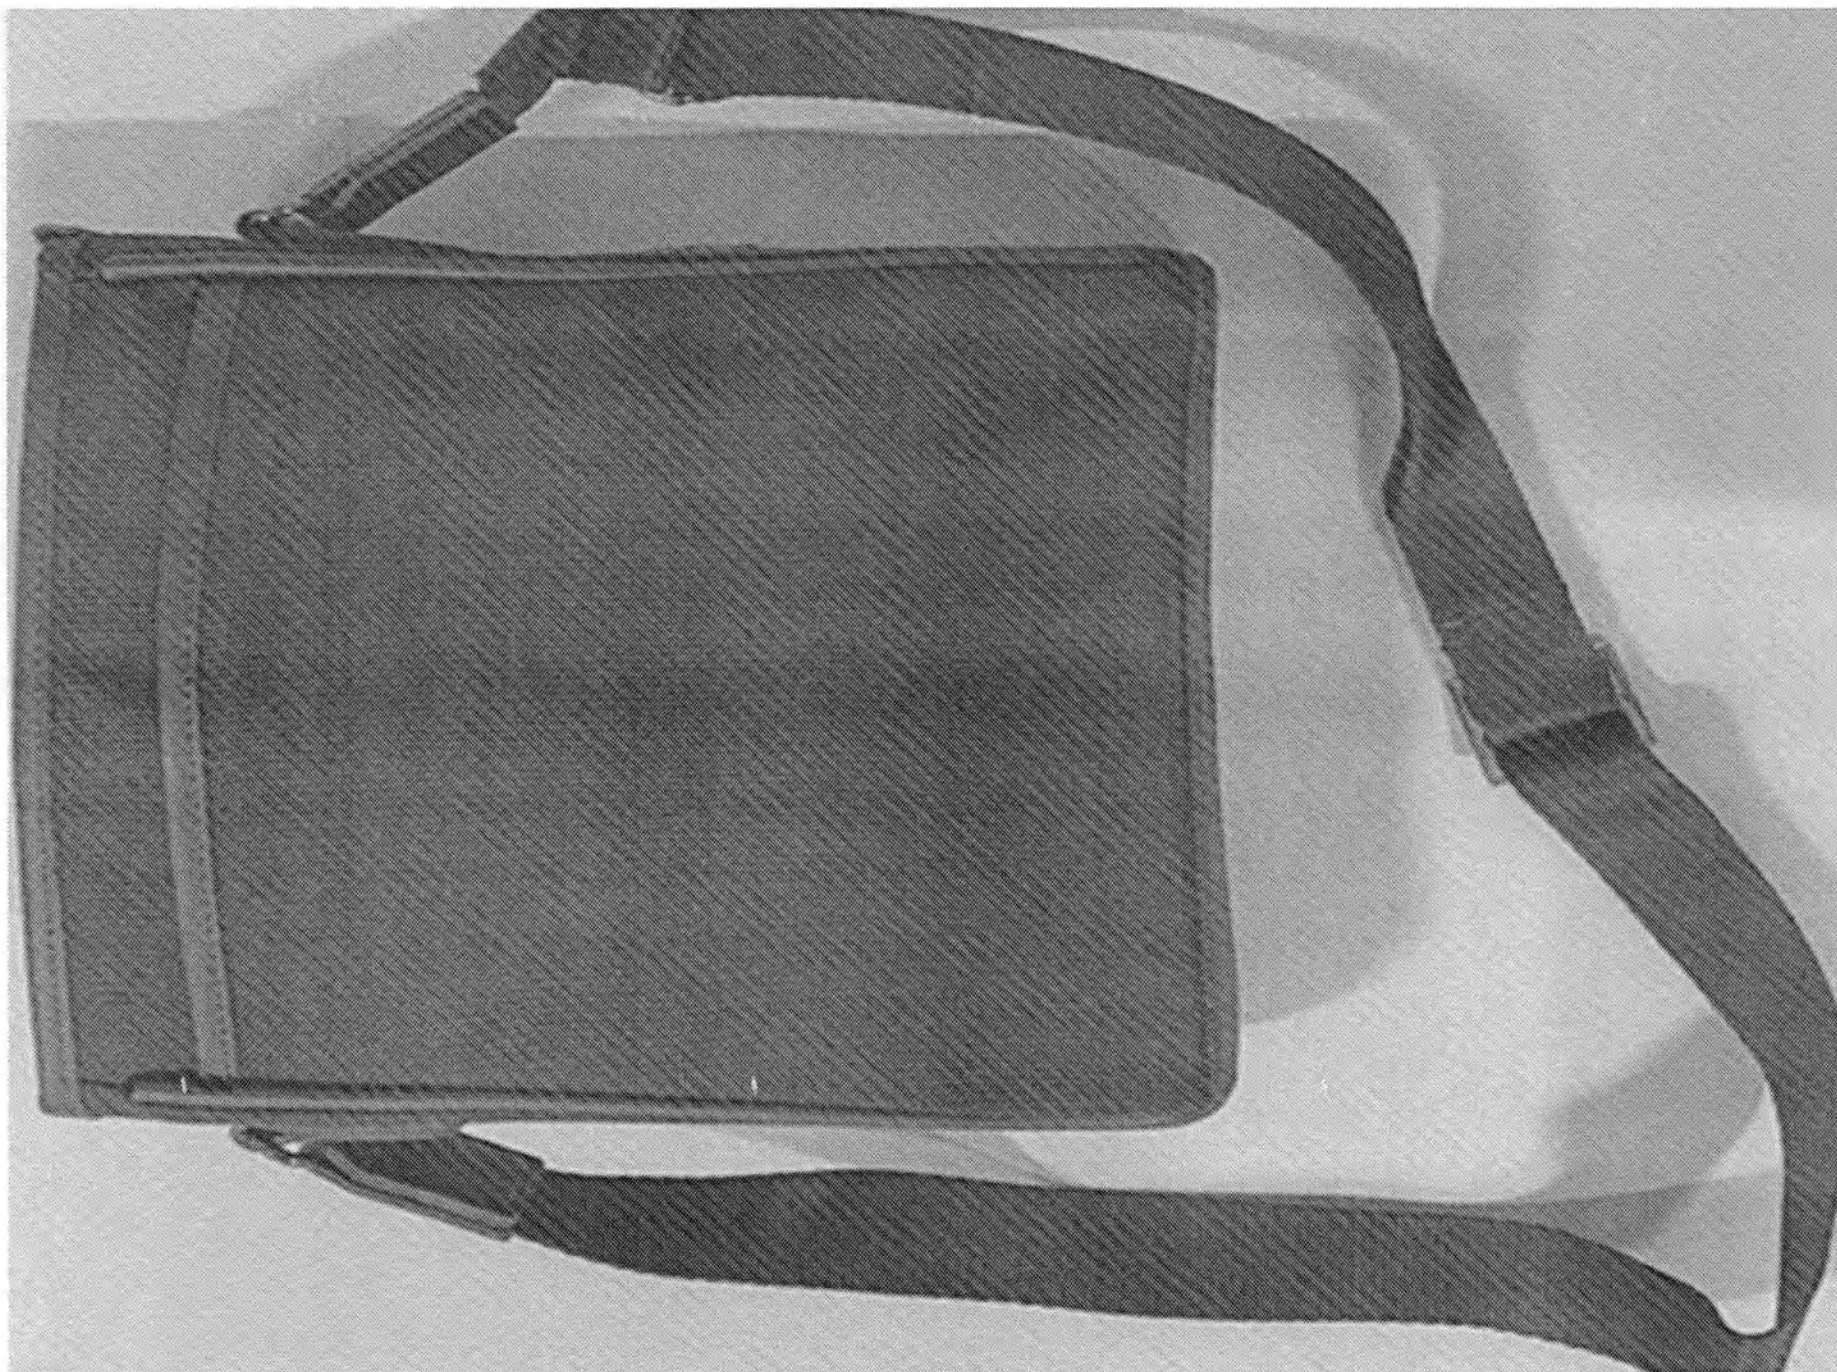

Сумка для переноски

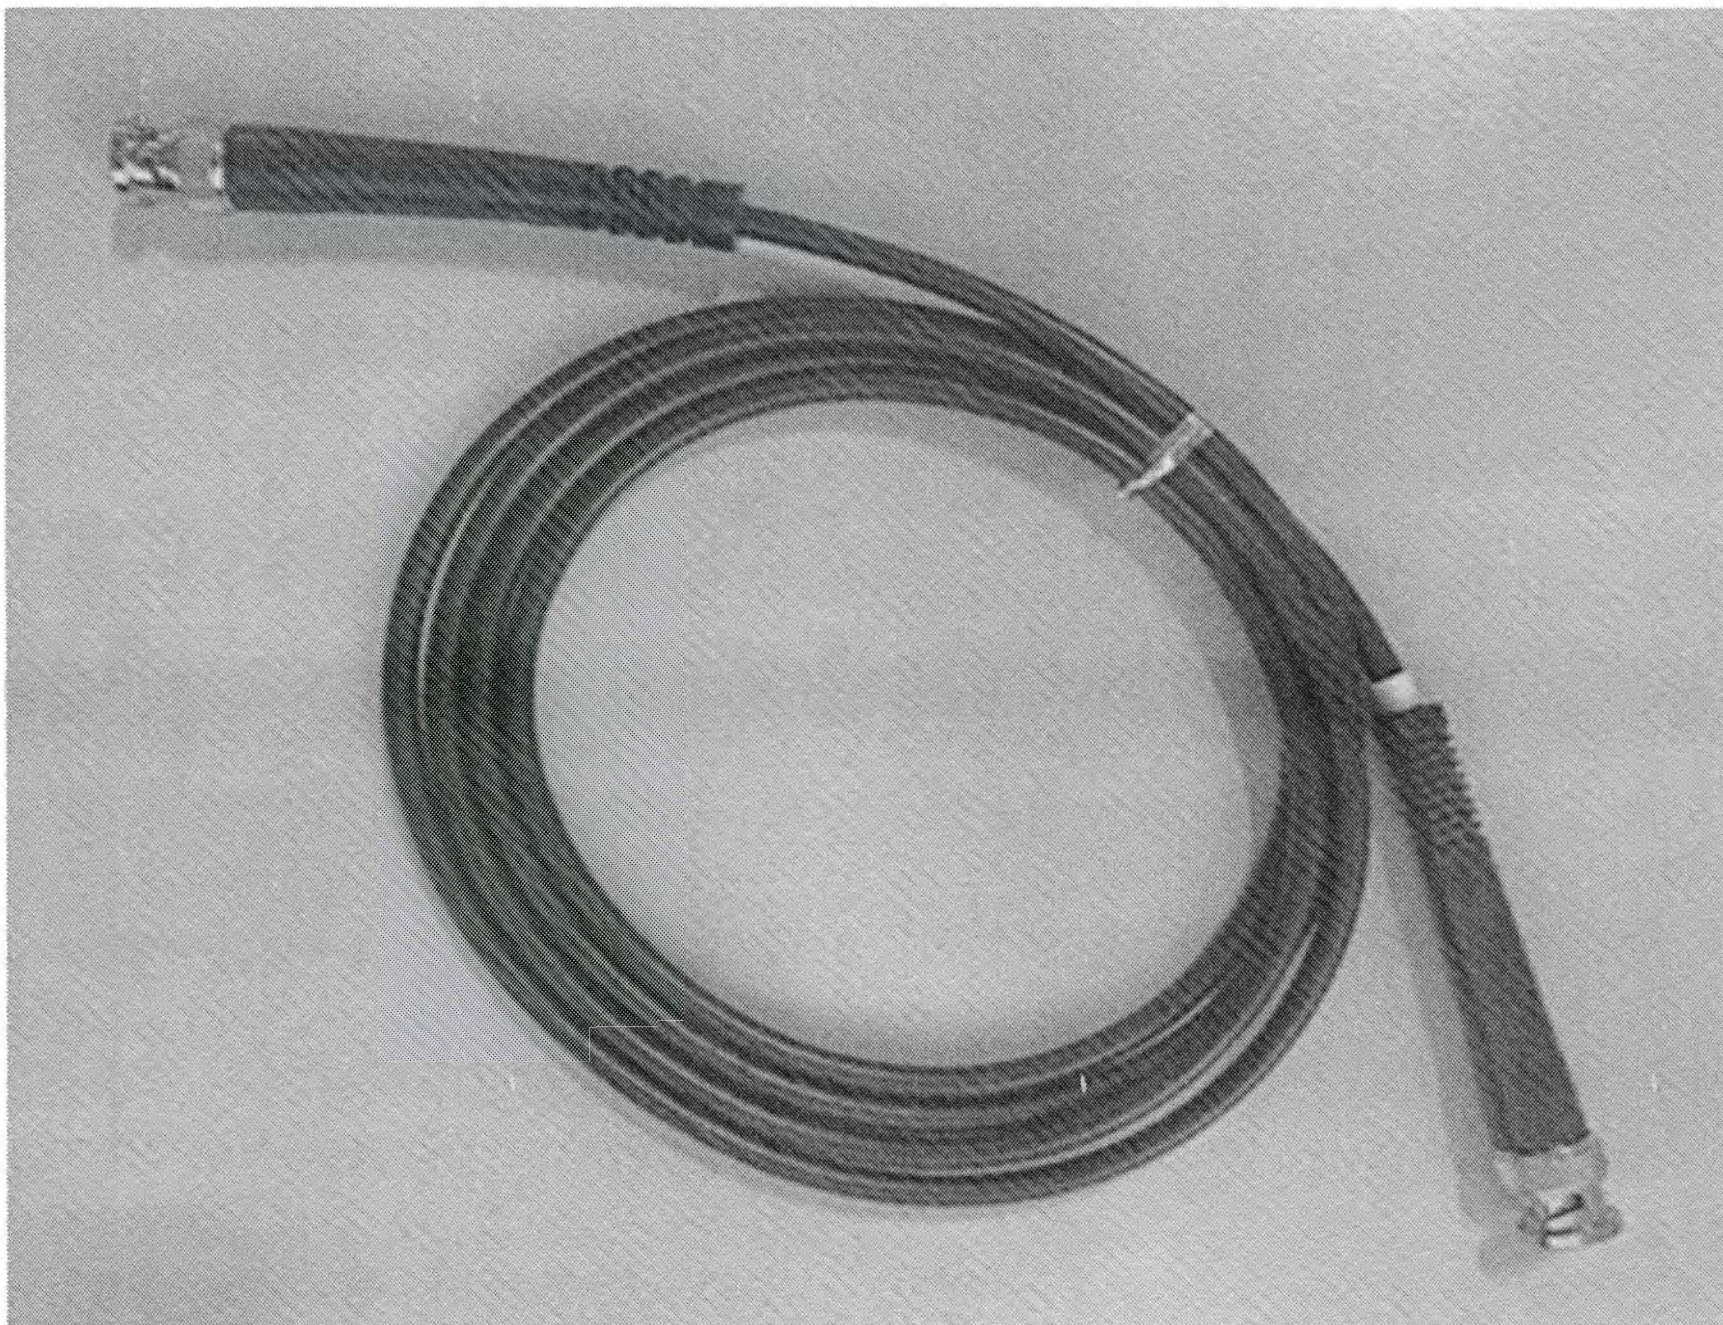

Коаксиальный кабель высокочастотный, модель 8219 rg-58a/u, производитель Belden CDT Inc, США

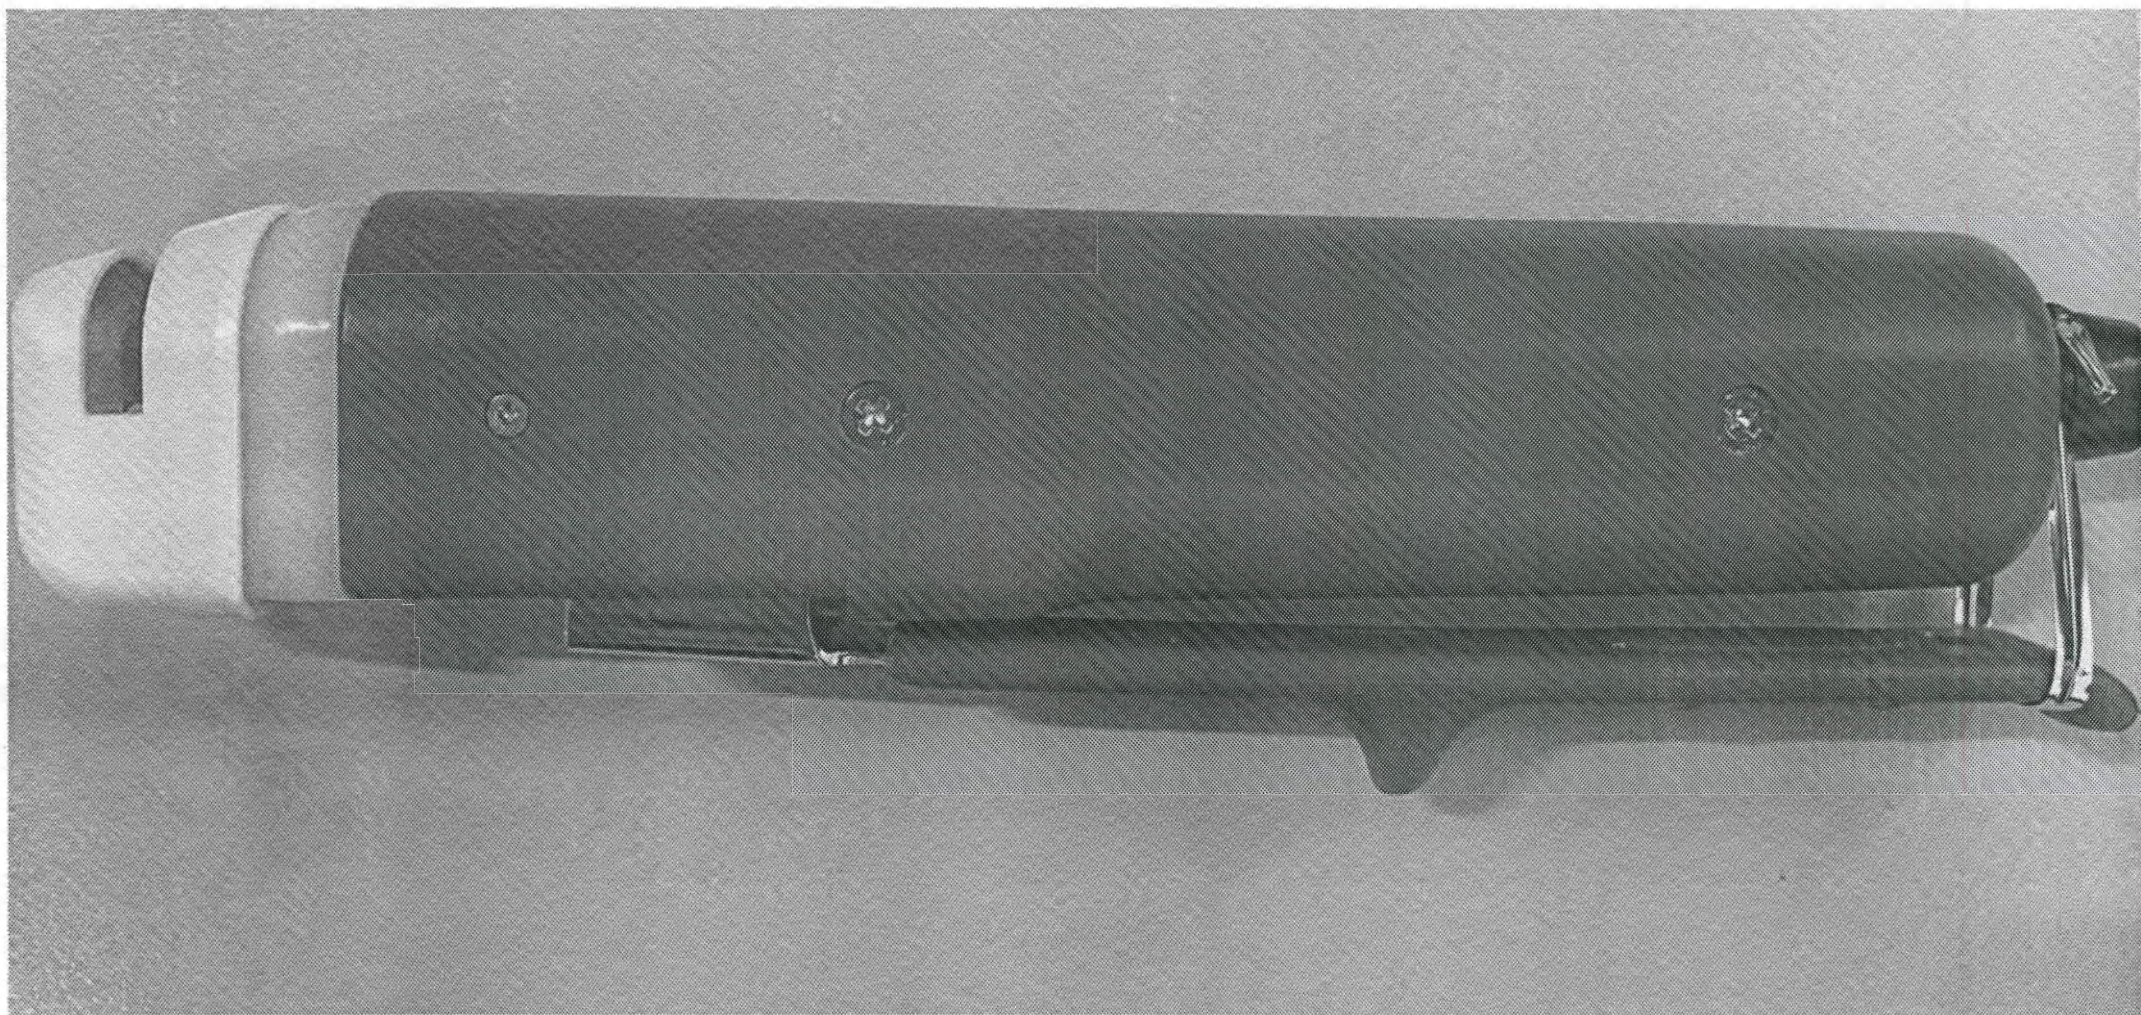

Выносное запаивающее устройство, модель 200-038А

Маркировка изделия

МОДЕЛЬ:	Устройство для заправки магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE170	 CENTRON KOREA
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	XXXXXXX	
ПИТАНИЕ:	100-120 В 50/60Гц 250Вт 220- 250 В 50/60 Гц 250 Вт	
ЗАЩИТА:	3А/250В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКИ	

ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ АННУЛИРОВАНА, ЕСЛИ ОТКРЫТЬ


Маркировка на русском языке на примере SE170 (аналогично для всех моделей, кроме SE700 и SE730)

МОДЕЛЬ:	Устройство для заправки магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов модель SE730
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	XXXXXXX
ПИТАНИЕ:	18В  1А 
АДАПТЕР:	100-240 В 50/60Гц 0.6А
CE	CENTRON СДЕЛАНО В КОРЕЕ


	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ	

ОТКРОЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ АККУМУЛЯТОР

Маркировка на русском языке на примере SE730 (аналогично для модели SE700)

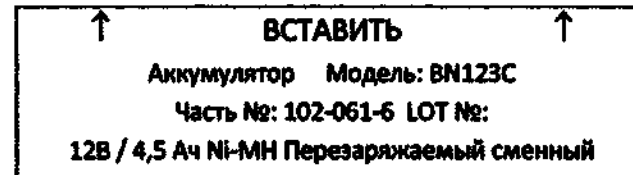

Маркировка на русском языке Аккумулятора Ni-MH перезаряжаемого сменного модель BN123C (12 В, 4.5 А*ч) - для модели SE700

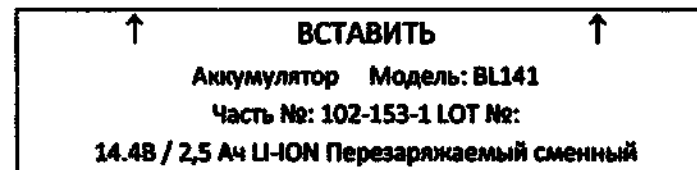

Маркировка на русском языке Аккумулятора Li-Ion перезаряжаемого модель BL141 (14.4 В, 2.5 А*ч) – для модели SE730

**Устройство для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее
компонентов под торговой маркой Centron модель SEXXX**



Производитель

«Центрон Корпорейшн» (Centron Corporation)

44 Beolmal-Ro, Dongan-Gu, Anyang,

Gyeonggi-Do, 14059, Корея

SN

XXXXXX



XX.XXXX

**Уполномоченный представитель
производителя в РФ:**

ООО «ГРУППА АЛЪЯНС»

**196191, город Санкт-Петербург, проспект
Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А,
помещение 4-Н, ком. 13**

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____



Маркировка транспортной упаковки на русском языке

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 44 листа(-ов)

Генеральный директор
ООО «Группа Альянс»
Маханова Е.А.

