

Medtronic

ООО «Медтроник»

Вн. тер. г., м.о. Пресненский
Пресненская наб., д.10
Башня С
9 эт., пом. III, ком.41
г. Москва, 123112
Россия

Tel: +7(495) 580 73 77

Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Е. В. Плясунова

«26» января 2023 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**«Электрод для стимуляции в кардиальной вене
Attain Performa»**


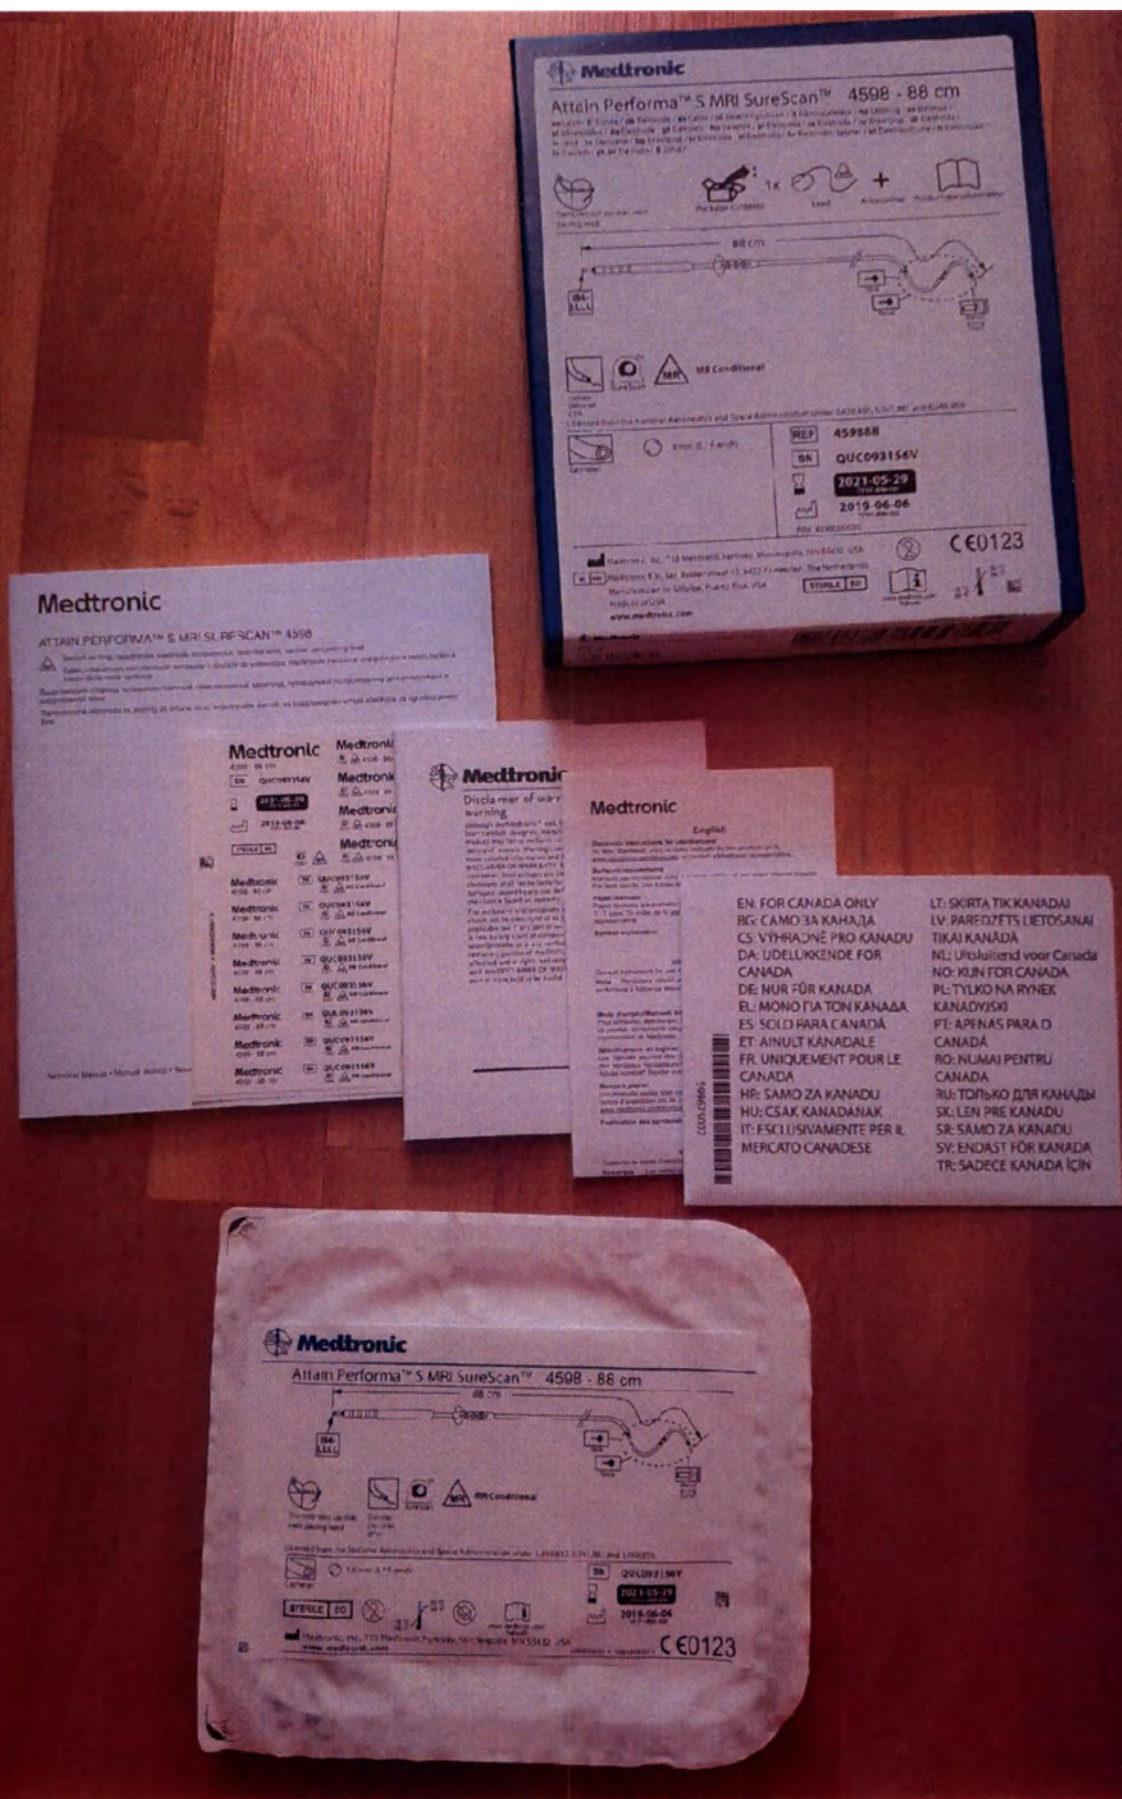


Рисунок 1. Общий вид Электрода для стимуляции в кардиальной вене Attain Performa (содержимое упаковки) на примере варианта исполнения: Электрод для стимуляции в кардиальной вене ATAIN PERFORMA S MRI SURESCAN 4598 размер 88 см



Attain Performa™ S MRI SureScan™ 4598 - 88 cm


en Lead / fr Sonde / de Elektrode / es Cable / nl Geleidingdraad / it Elettrocatteter / no Ledning / sv Elektrod /
el Ηλεκτρόδιο / da Elektrode / pt Eléctrodo / hu Vezeték / pl Elektroda / cs Elektroda / ru Электрод / sk Elektroda /
tr Lead / ro Derivație / bg Електрод / sr Elektroda / sl Elektroda / hr Elektrodni kateter / et Elektrodijuhe / lt Elektrodas /
lv Pievads / pt-br Eletrodo / fi Johdin



Transvenous cardiac vein
pacing lead



Package contents:



1x


Lead



Accessories



Product documentation

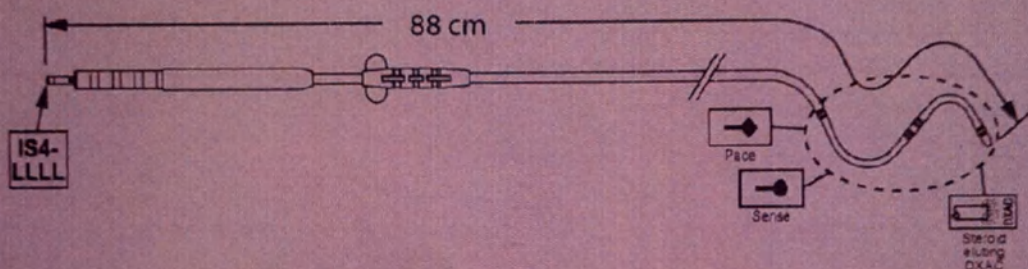

Catheter
Delivered
OTW



MR Conditional

Licensed from the National Aeronautics and Space Administration under 5,639,850, 5,741,883 and 6,048,959.



Catheter

1.9 mm (5.7 French)

REF 459888

SN QUC093156V

2021-05-29
YYYY-MM-DD

2019-06-06
YYYY-MM-DD

PIN: 4598000030



Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432 USA



Medtronic B.V., Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands

Manufactured In: Villalba, Puerto Rico, USA

Product of USA

www.medtronic.com

STERILE EO



[www.medtronic.com/
manuals](http://www.medtronic.com/manuals)



CE0123




15 °C
59 °F

30 °C
86 °F


Рисунок 2. Маркировка упаковки Electroда для стимуляции в кардиальной вене ATTAIN PERFORMA (содержимое упаковки) на примере варианта исполнения: Electroд для стимуляции в кардиальной вене ATTAIN PERFORMA S MRI SURESCAN 4598 размер 88 cm



Рисунок 3. Маркировка упаковки (боковая часть) Электрода для стимуляции в кардиальной вене АТТАИН PERFORMA (содержимое упаковки) на примере варианта исполнения: Электрод для стимуляции в кардиальной вене АТТАИН PERFORMA S MRI SURESCAN 4598 размер 88 см



Attain Performa™ S MRI SureScan™ 4598 - 88 cm

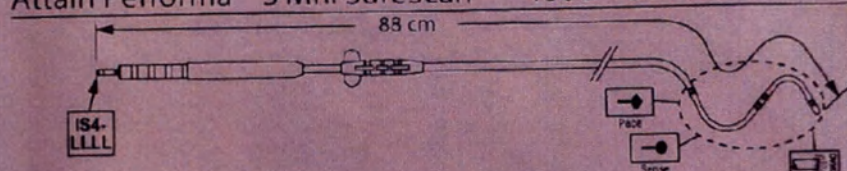

Transvenous cardiac
vein pacing lead



Catheter
Delivered
OTV



MR Conditional

Licensed from the National Aeronautics and Space Administration under 5 639.850, 5,741,883 and 6 048 959



Catheter

1.9 mm (5.7 French)

SN QUC093156V

2021-05-29
YYYY-MM-DD

2019-06-06
YYYY-MM-DD

STERILE EO



15°C
59°F



20°C
66°F



www.medtronic.com/
manuals

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432 USA
www.medtronic.com

5188333AC01 A - 11883330A001 A

C E0123

Рисунок 4. Стерильная упаковка (внешний лоток с крышкой), маркировка Electroда для стимуляции в кардиальной вене ATTAIN PERFORMA на примере варианта исполнения: Electroд для стимуляции в кардиальной вене ATTAIN PERFORMA S MRI SURESCAN 4598 размер 88 см

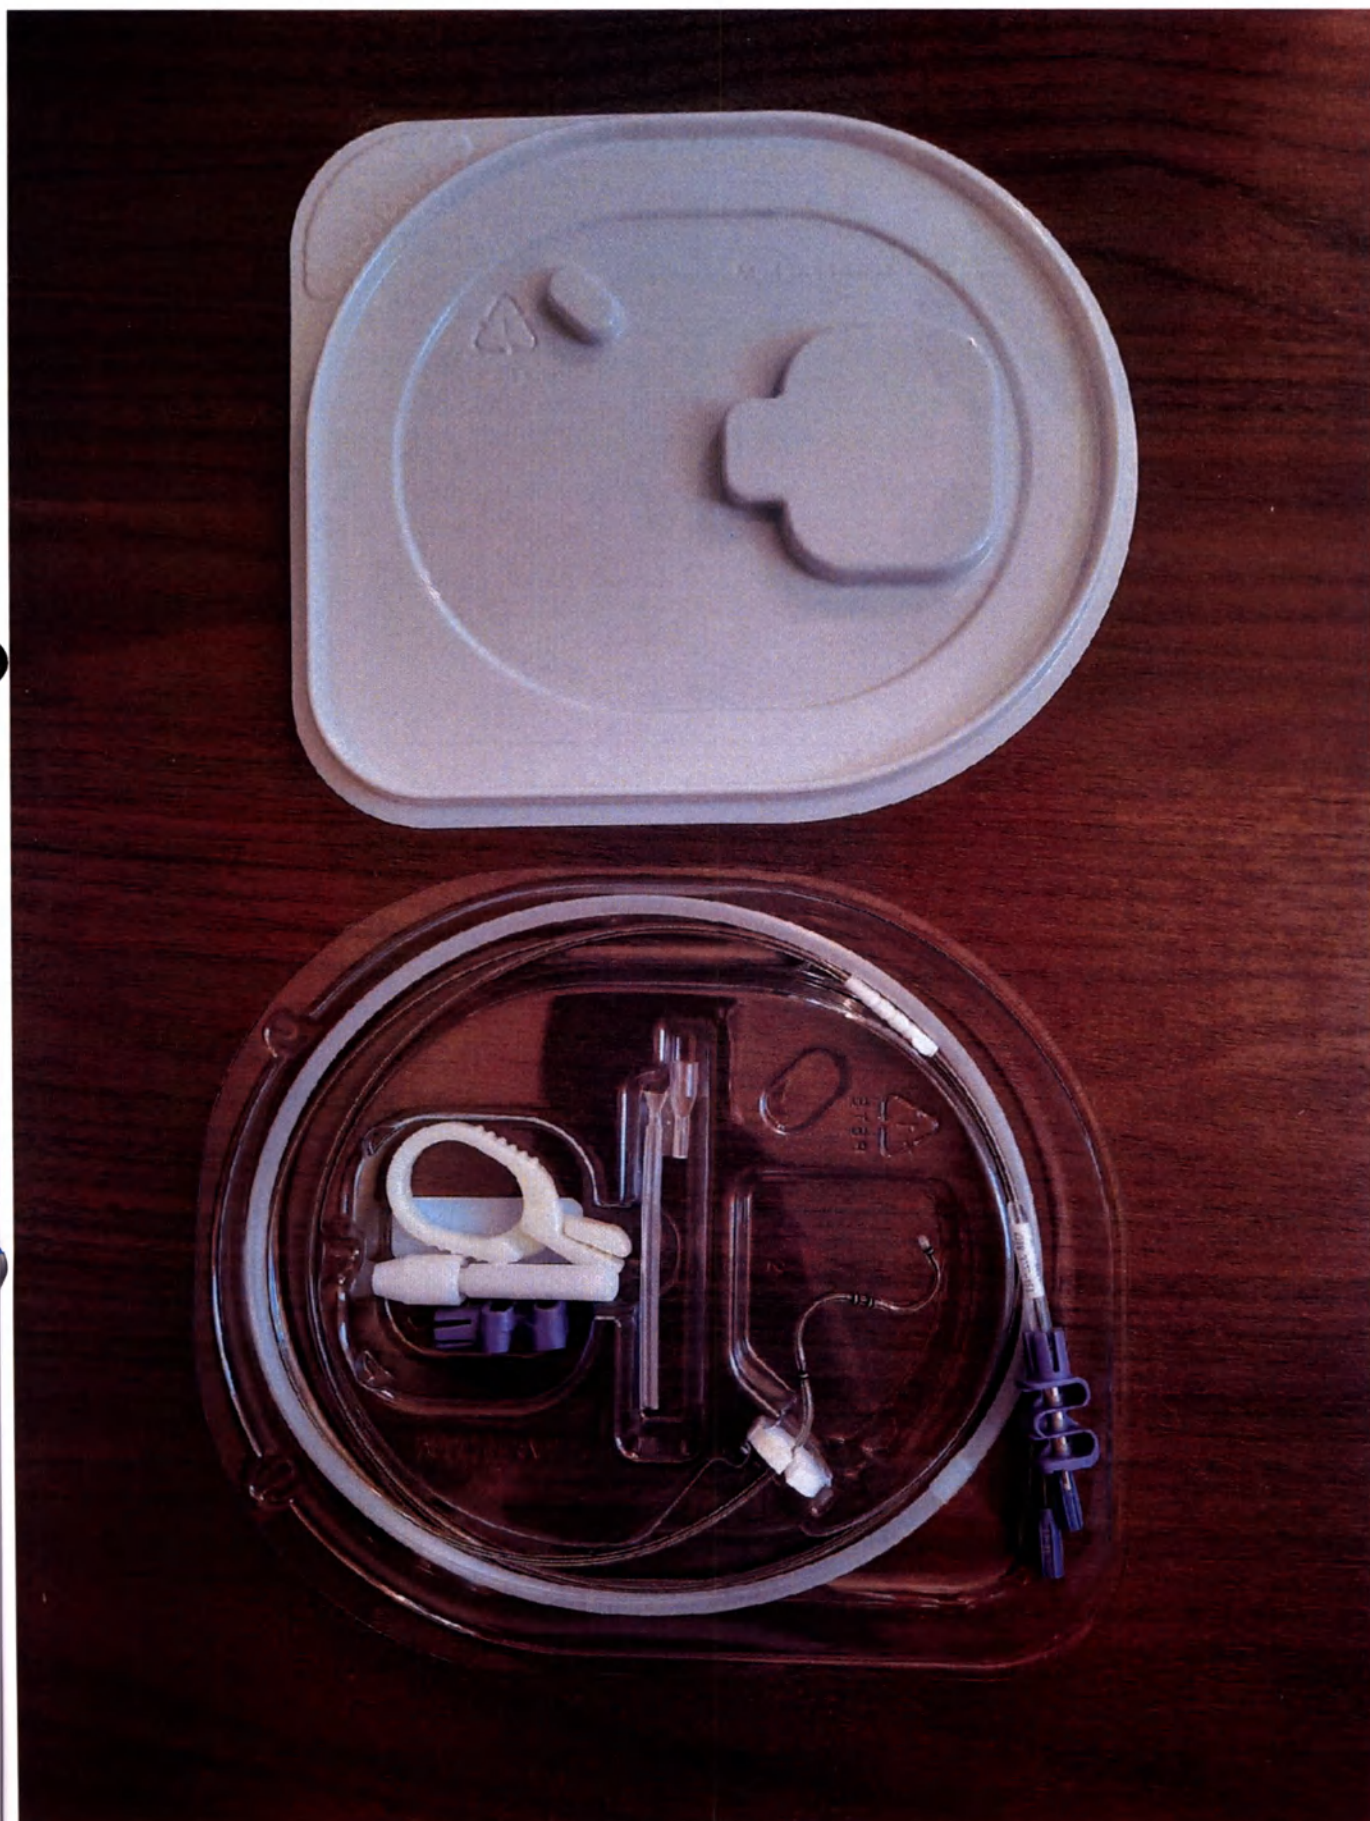


Рисунок 5. Стерильная упаковка (внутренний лоток с крышкой) Electroда для стимуляции в кардиальной вене ATTAİN PERFORMA (содержимое упаковки) на примере варианта исполнения: Electroд для стимуляции в кардиальной вене ATTAİN PERFORMA S MRI SURESCAN 4598 размер 88 см

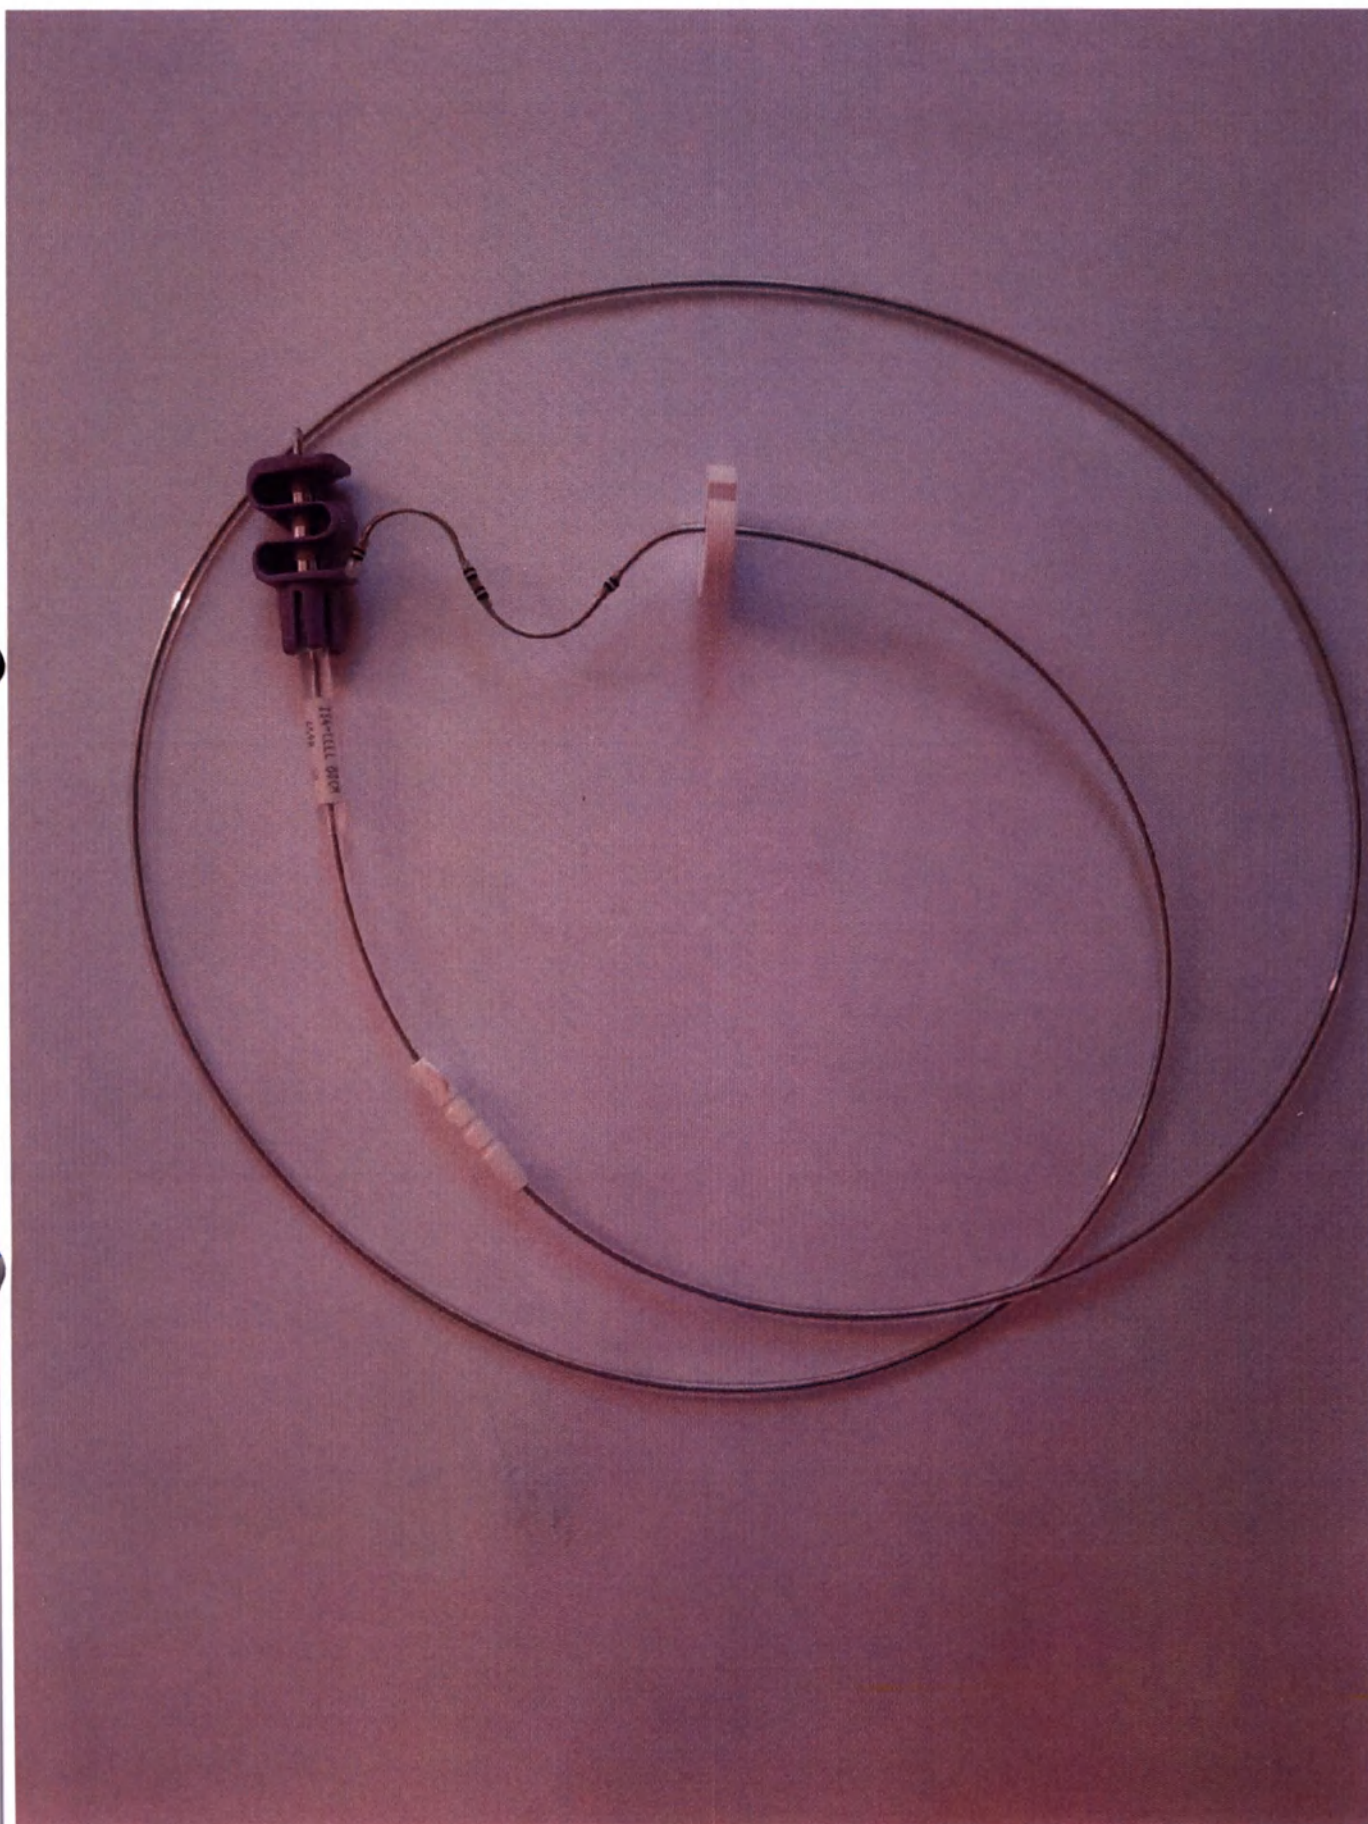


Рисунок 6. Электрод с фиксирующей муфтой с инструментом анализатора кабельного интерфейса AccuRead 2.0

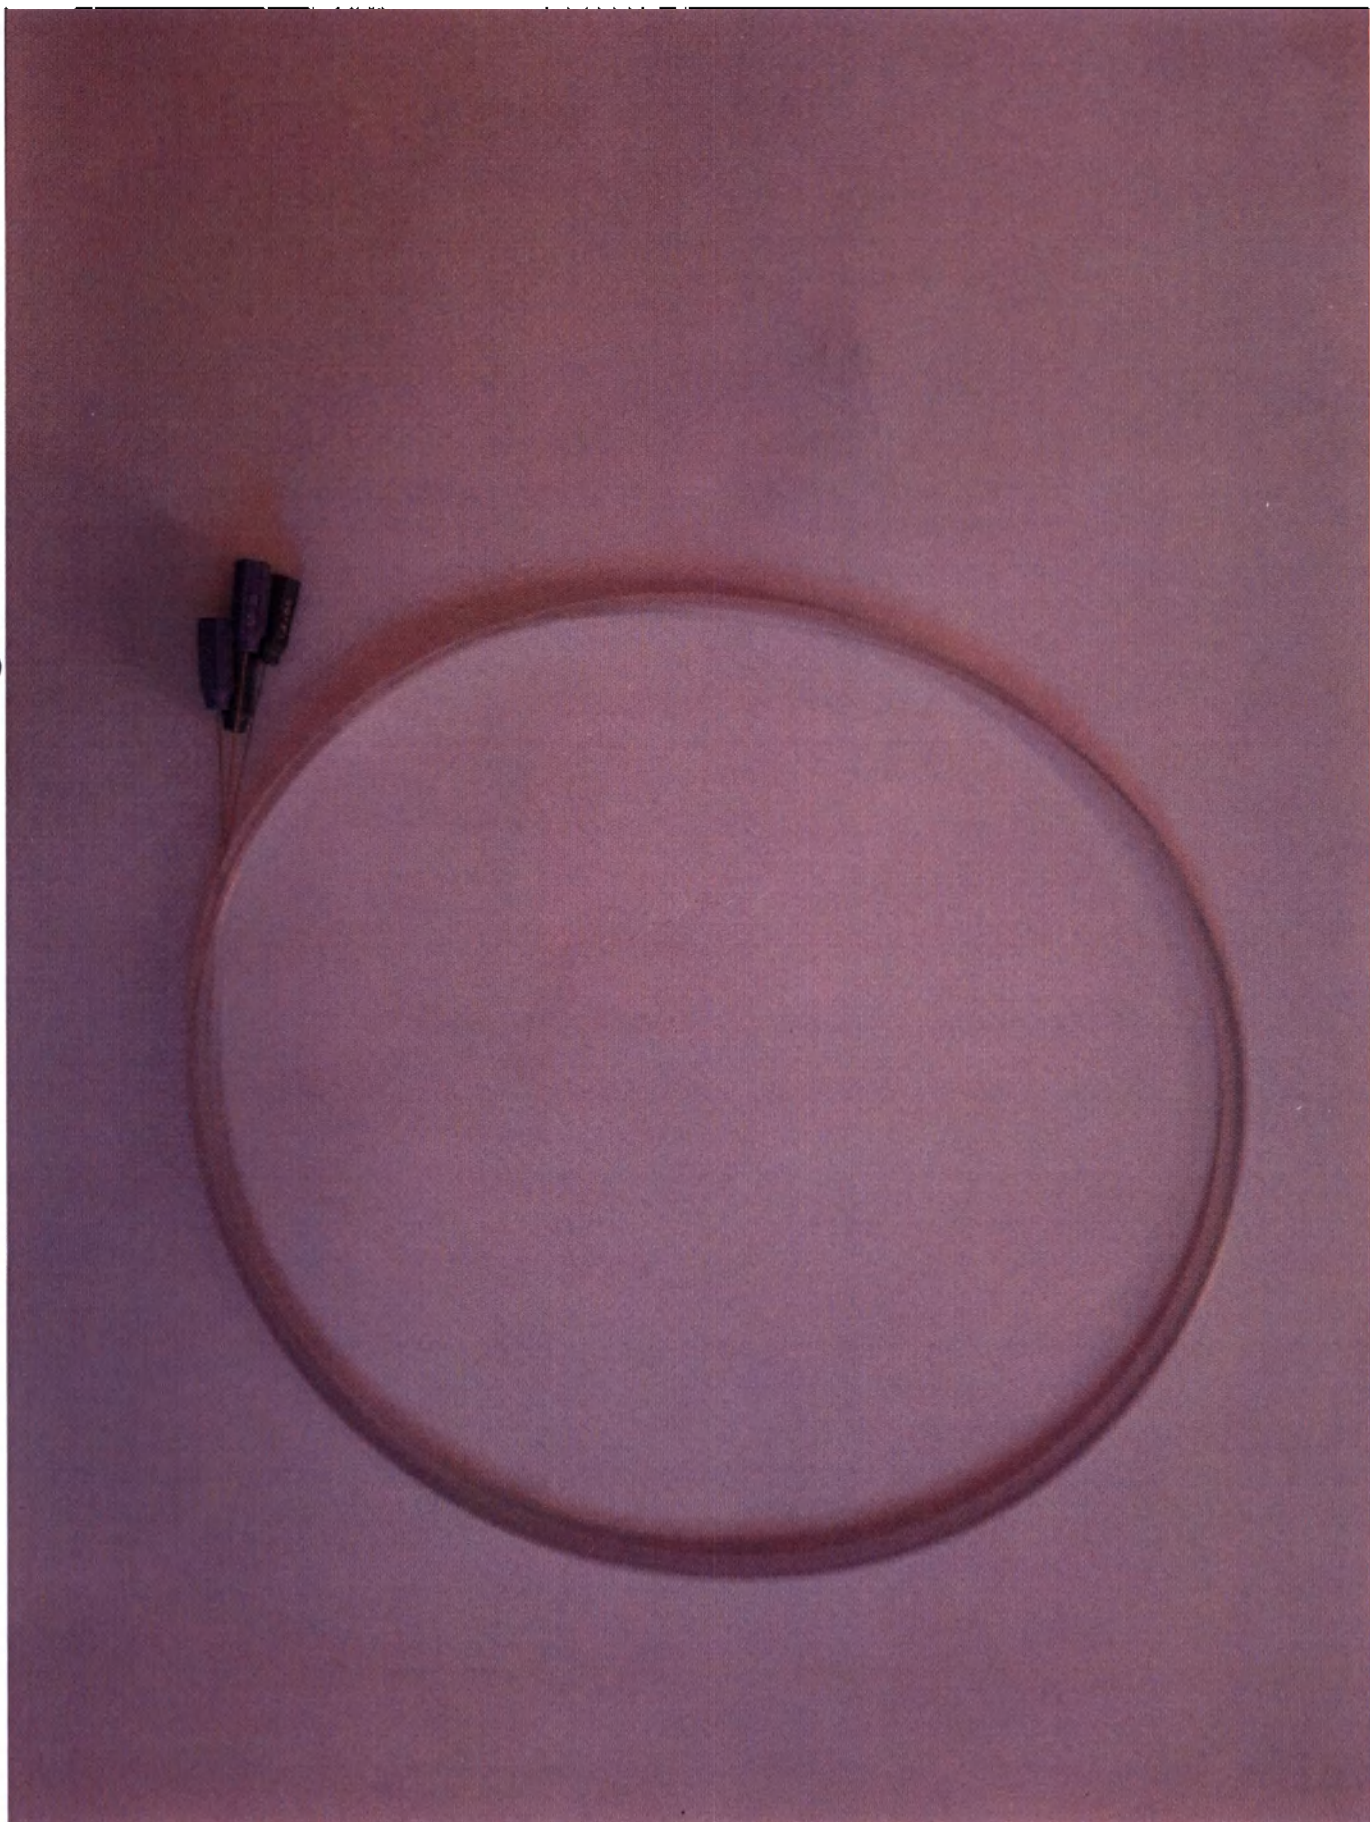


Рисунок 7. Стиллет – не более 4 шт.

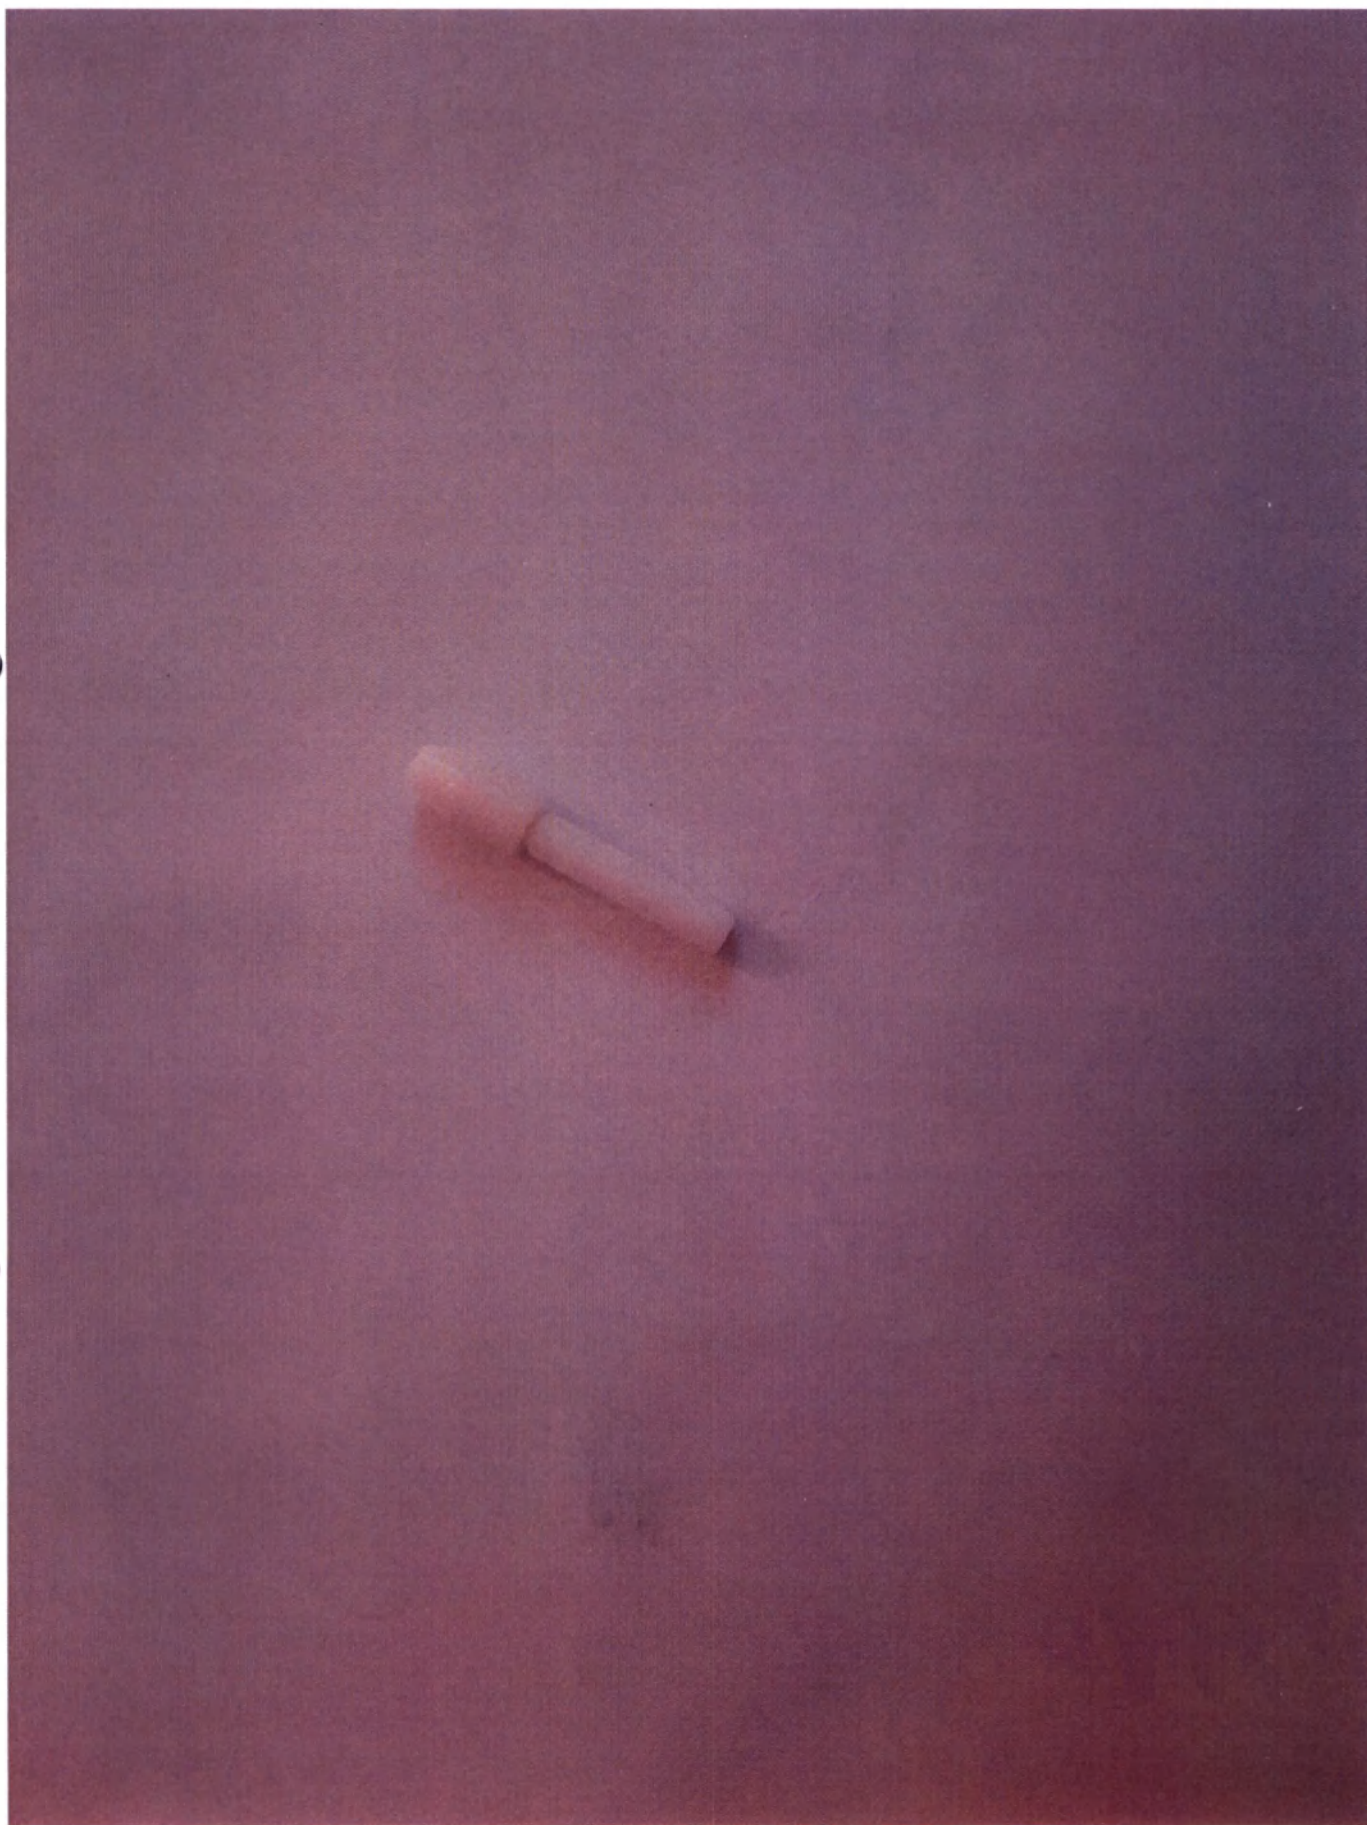


Рисунок 8. Рукоятка управления проводником

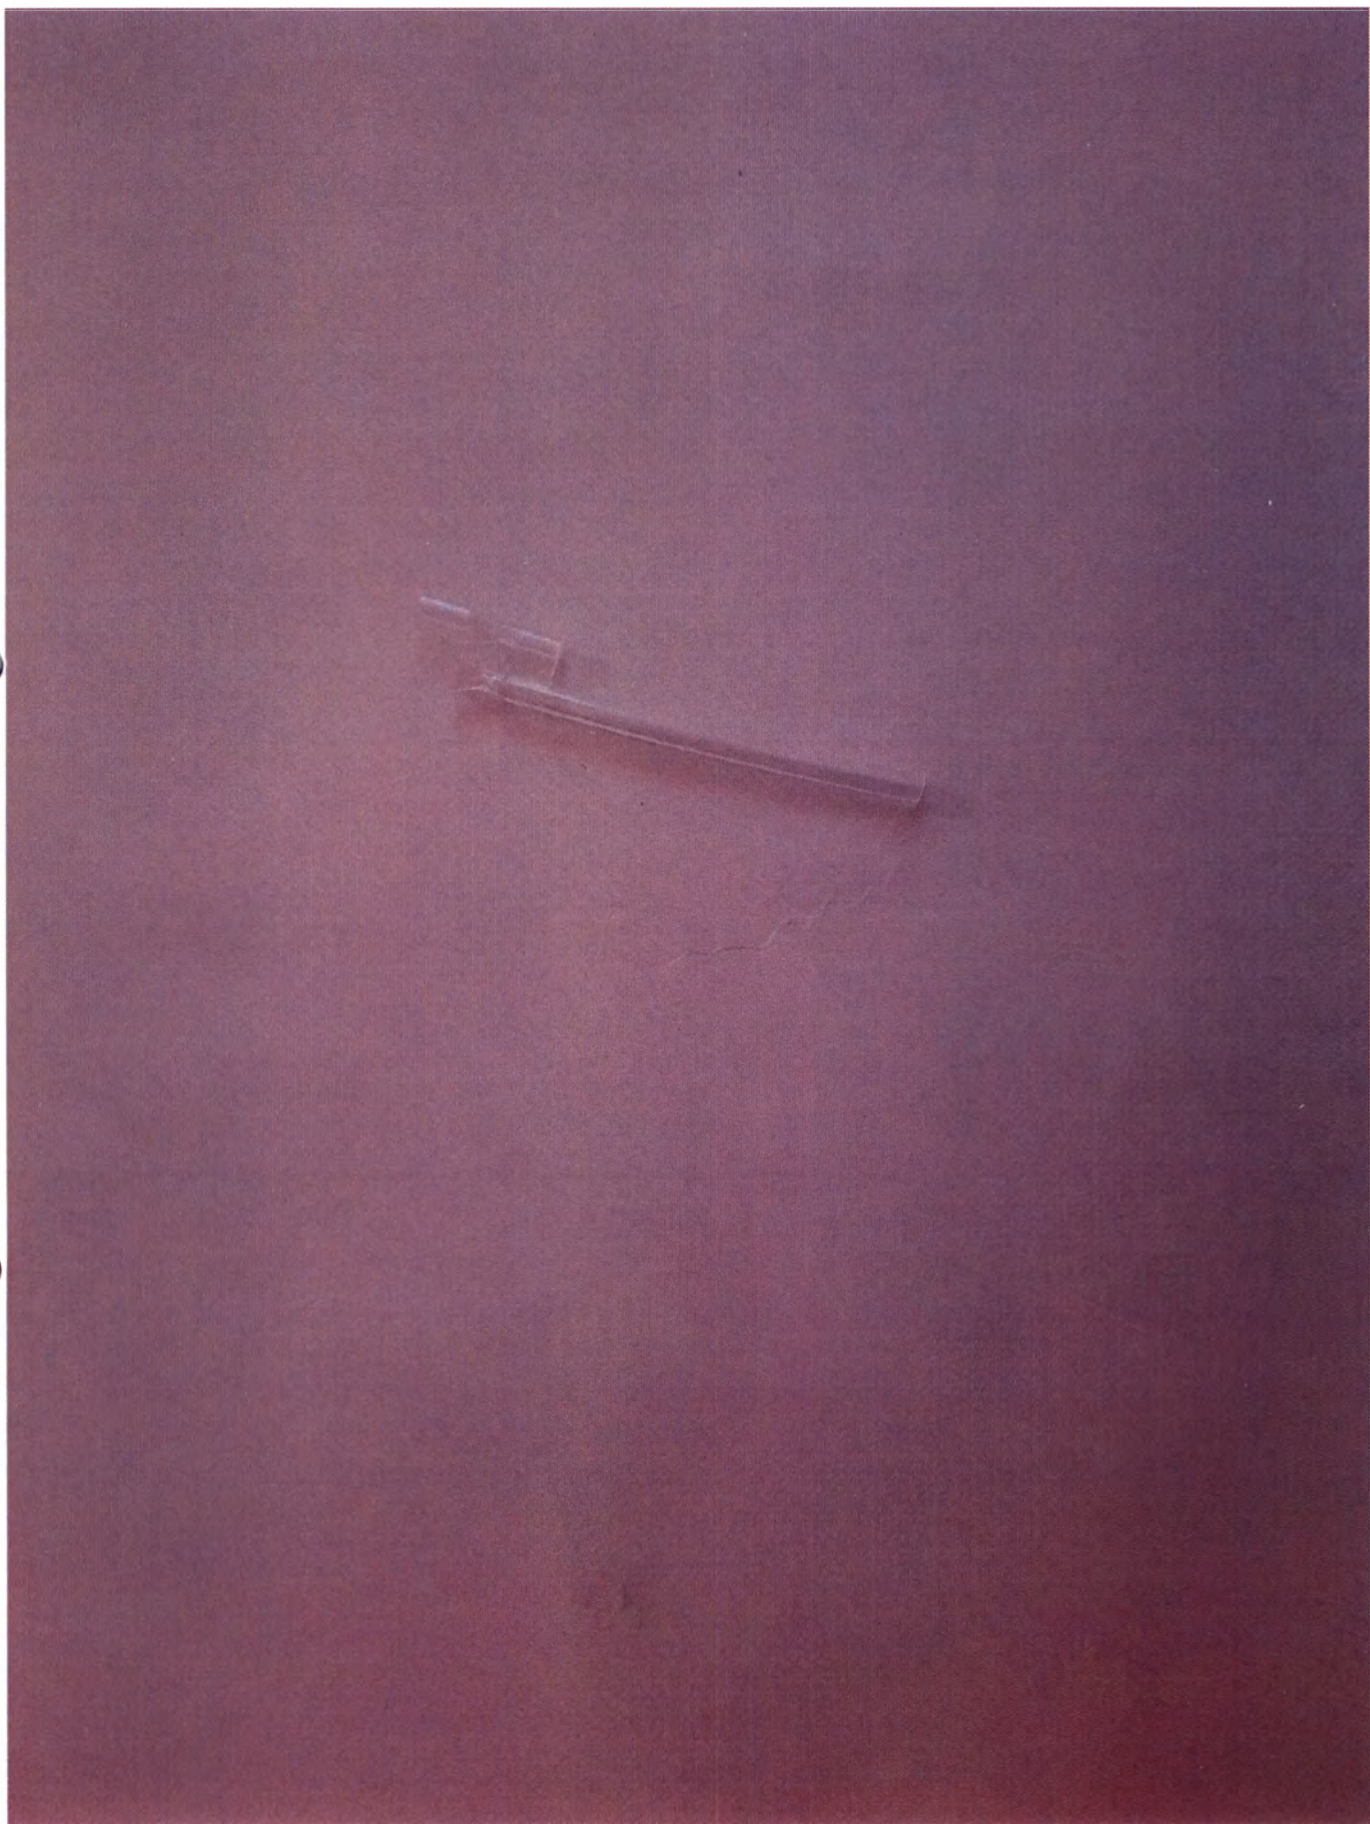


Рисунок 9. Инструмент для введения проводника

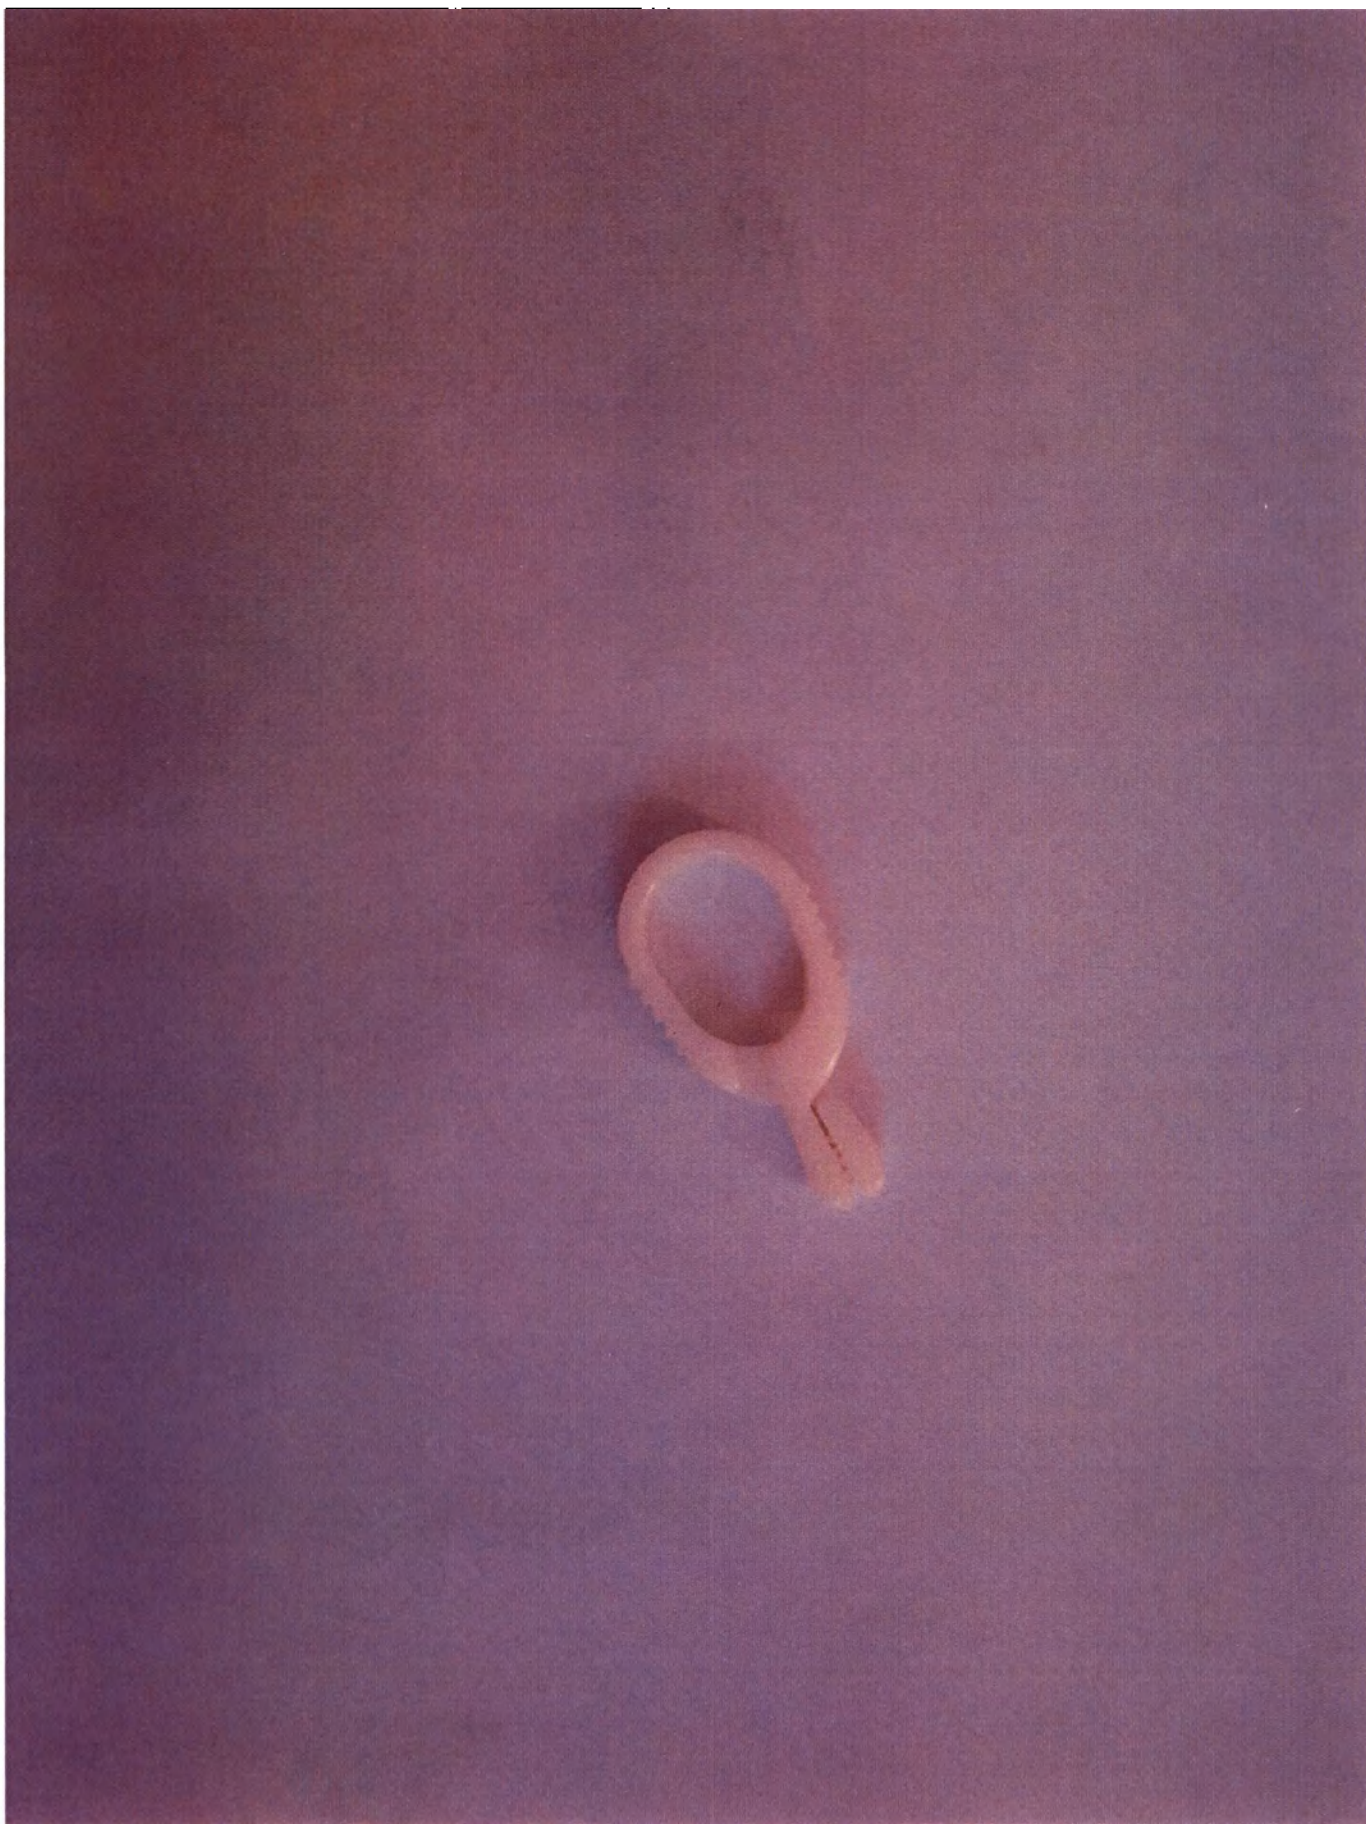



Рисунок 10. Зажим проводника



Рисунок 11. Инструмент анализатора кабельного интерфейса AccuRead 2.0

Образец локальной маркировки медицинского изделия на примере варианта исполнения:
«Электрод для стимуляции в кардиальной вене ATTAIN PERFORMA S MRI SURESCAN
4598, размер 88 см»

	Электрод для стимуляции в кардиальной вене ATTAIN PERFORMA MRI SURESCAN 4298 размер: 78 см	
	Производитель: Medtronic Inc.	Код UPN
	Страна производства: USA	Код CFN
	Представитель производителя в РФ: 123112, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, эт. 9, пом. III, комн. 41	
	Регистрационное удостоверение № 2017/6630 от	
	Дата произв./Серия/ Годен до: см. на упаковке	См. инструкции См. символы на упаковке
	Не токсично Апирогенно	





Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
13 листа(ов)

