

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И. Камнева

2023 г.




## **Фотографические изображения**


**«Инструменты хирургические для установки эндопротеза тазобедренного сустава G7 в вариантах исполнения»**

**Производства:**


**«Биомет Ортопедикс», США (Biomet Orthopedics), 56 East Bell Drive, P.O. Box 587, Warsaw, Indiana, 46581, USA**

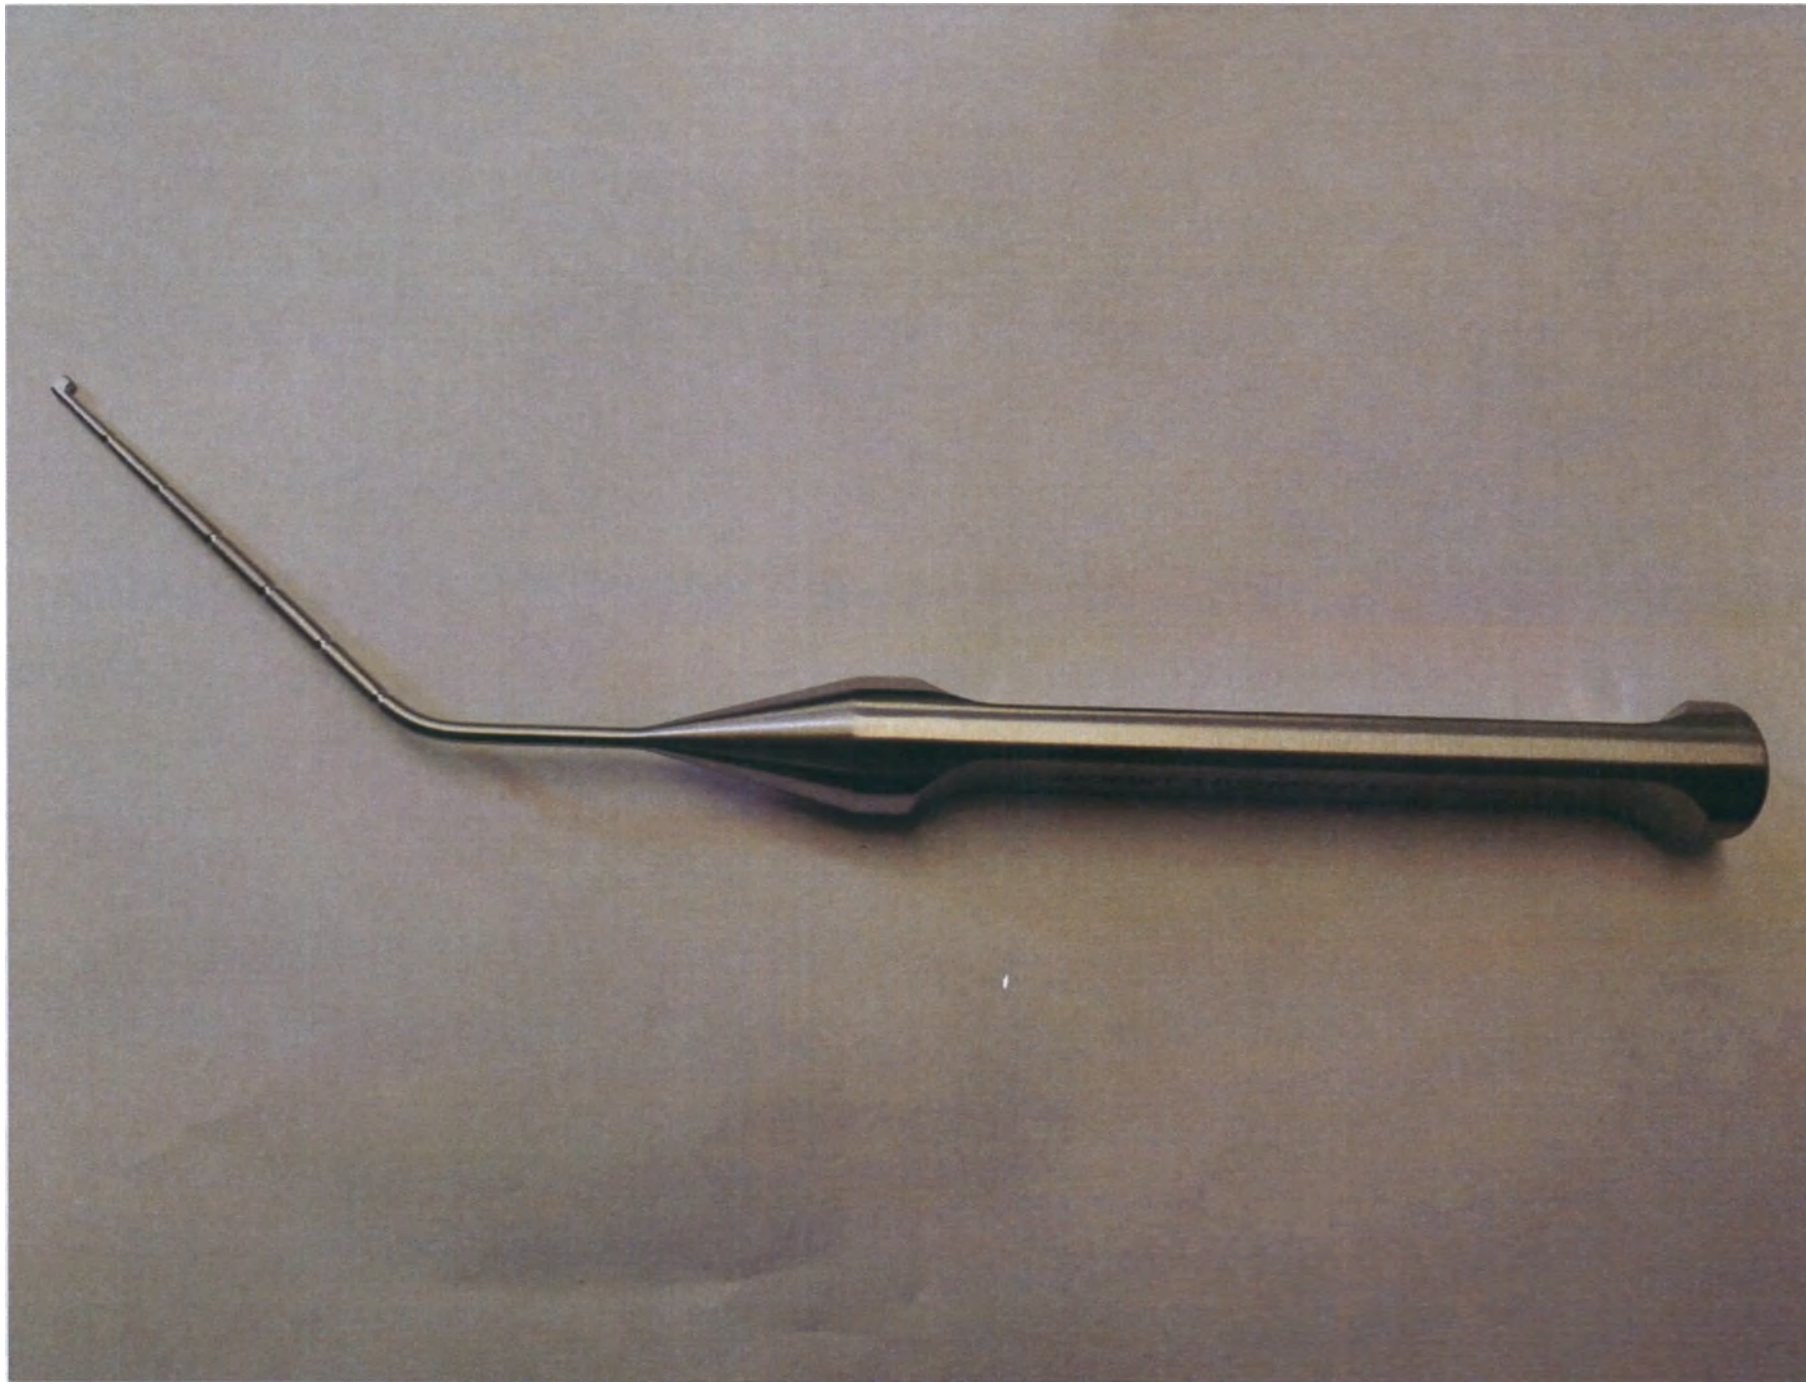

**Рис. 1. Глубиномер G7.**

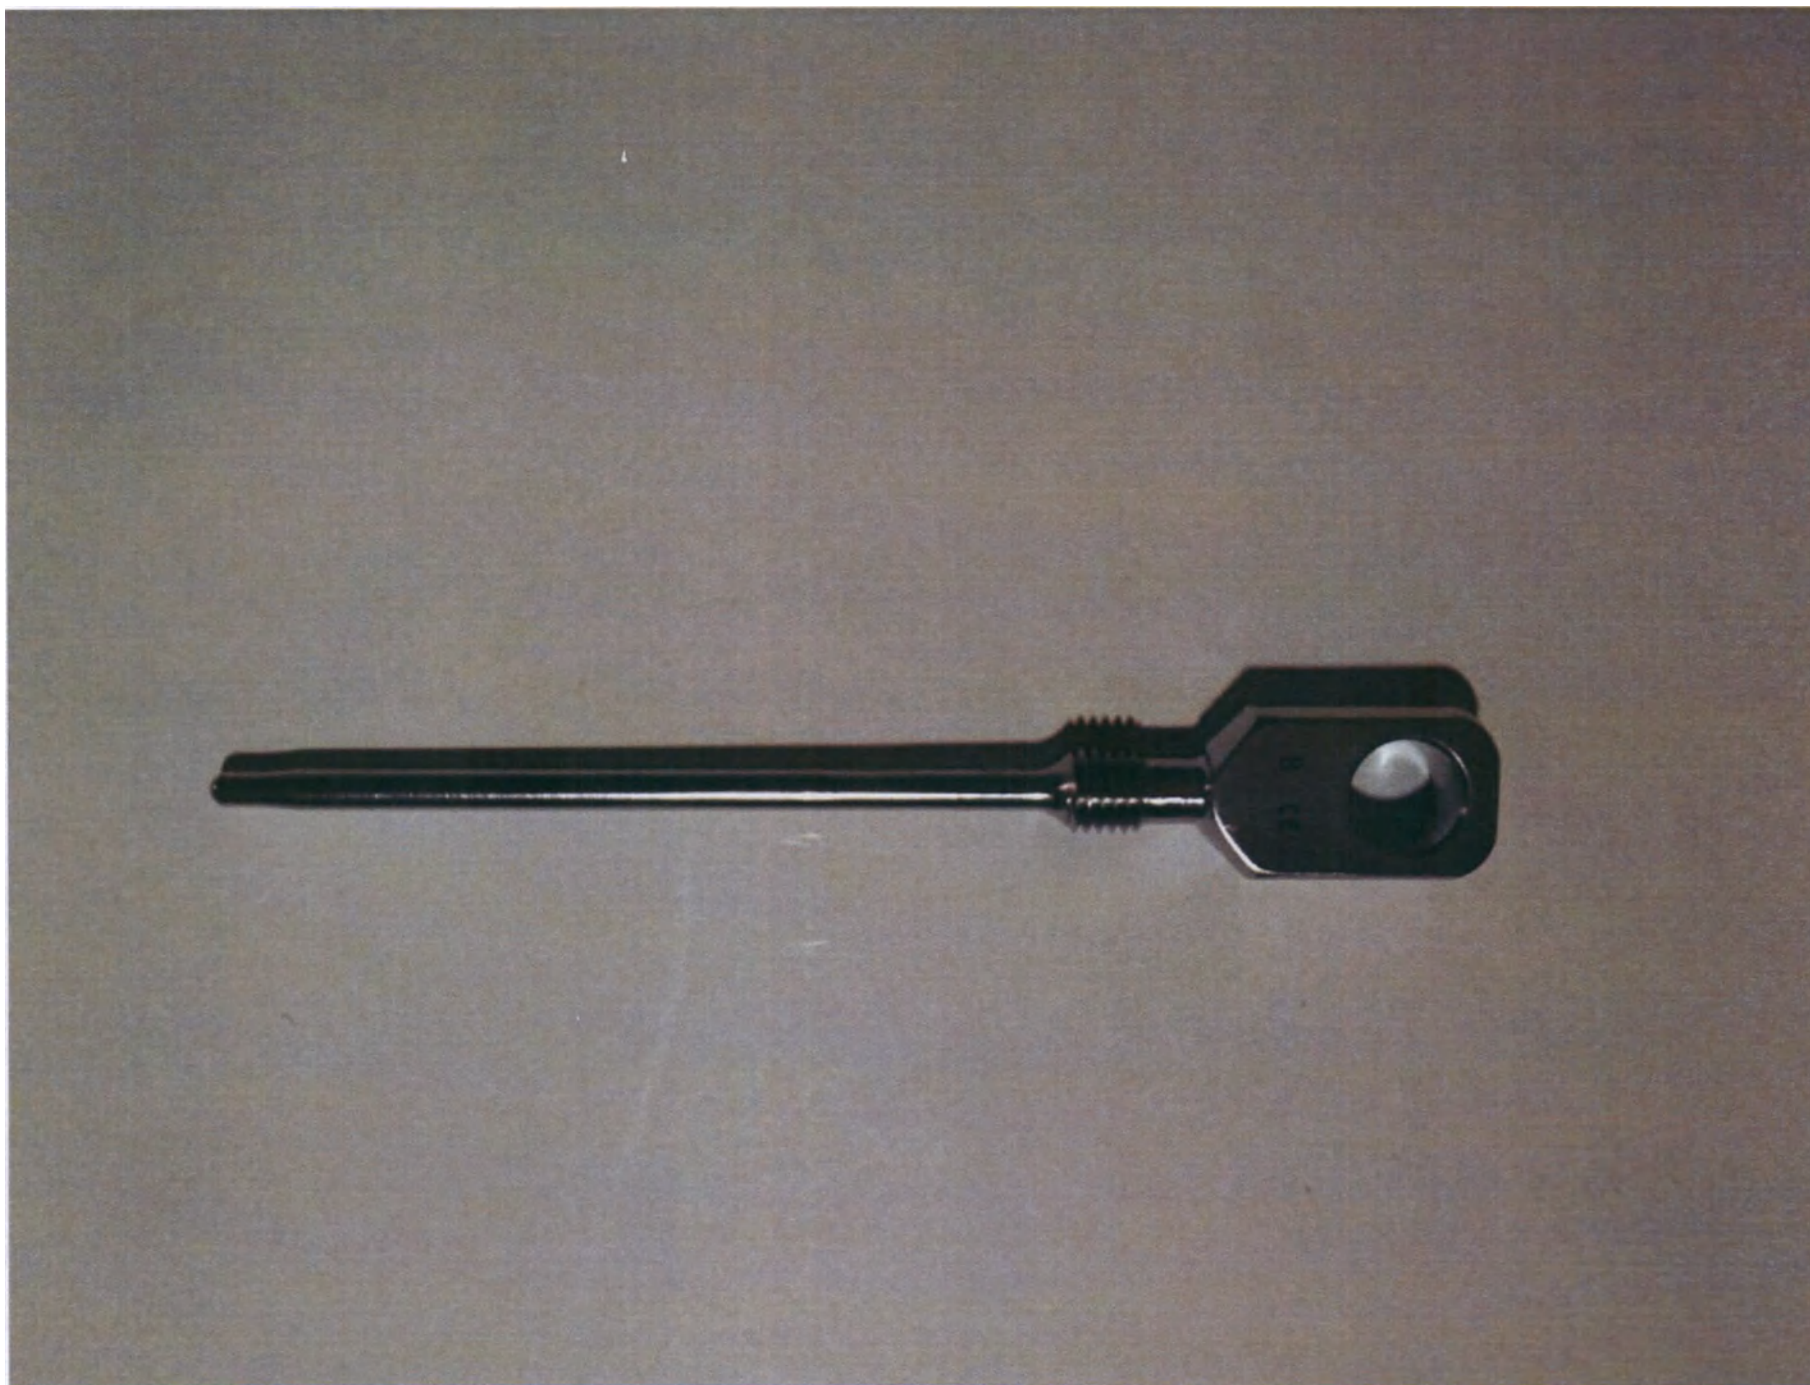

**Рис. 2. Направитель G7.**

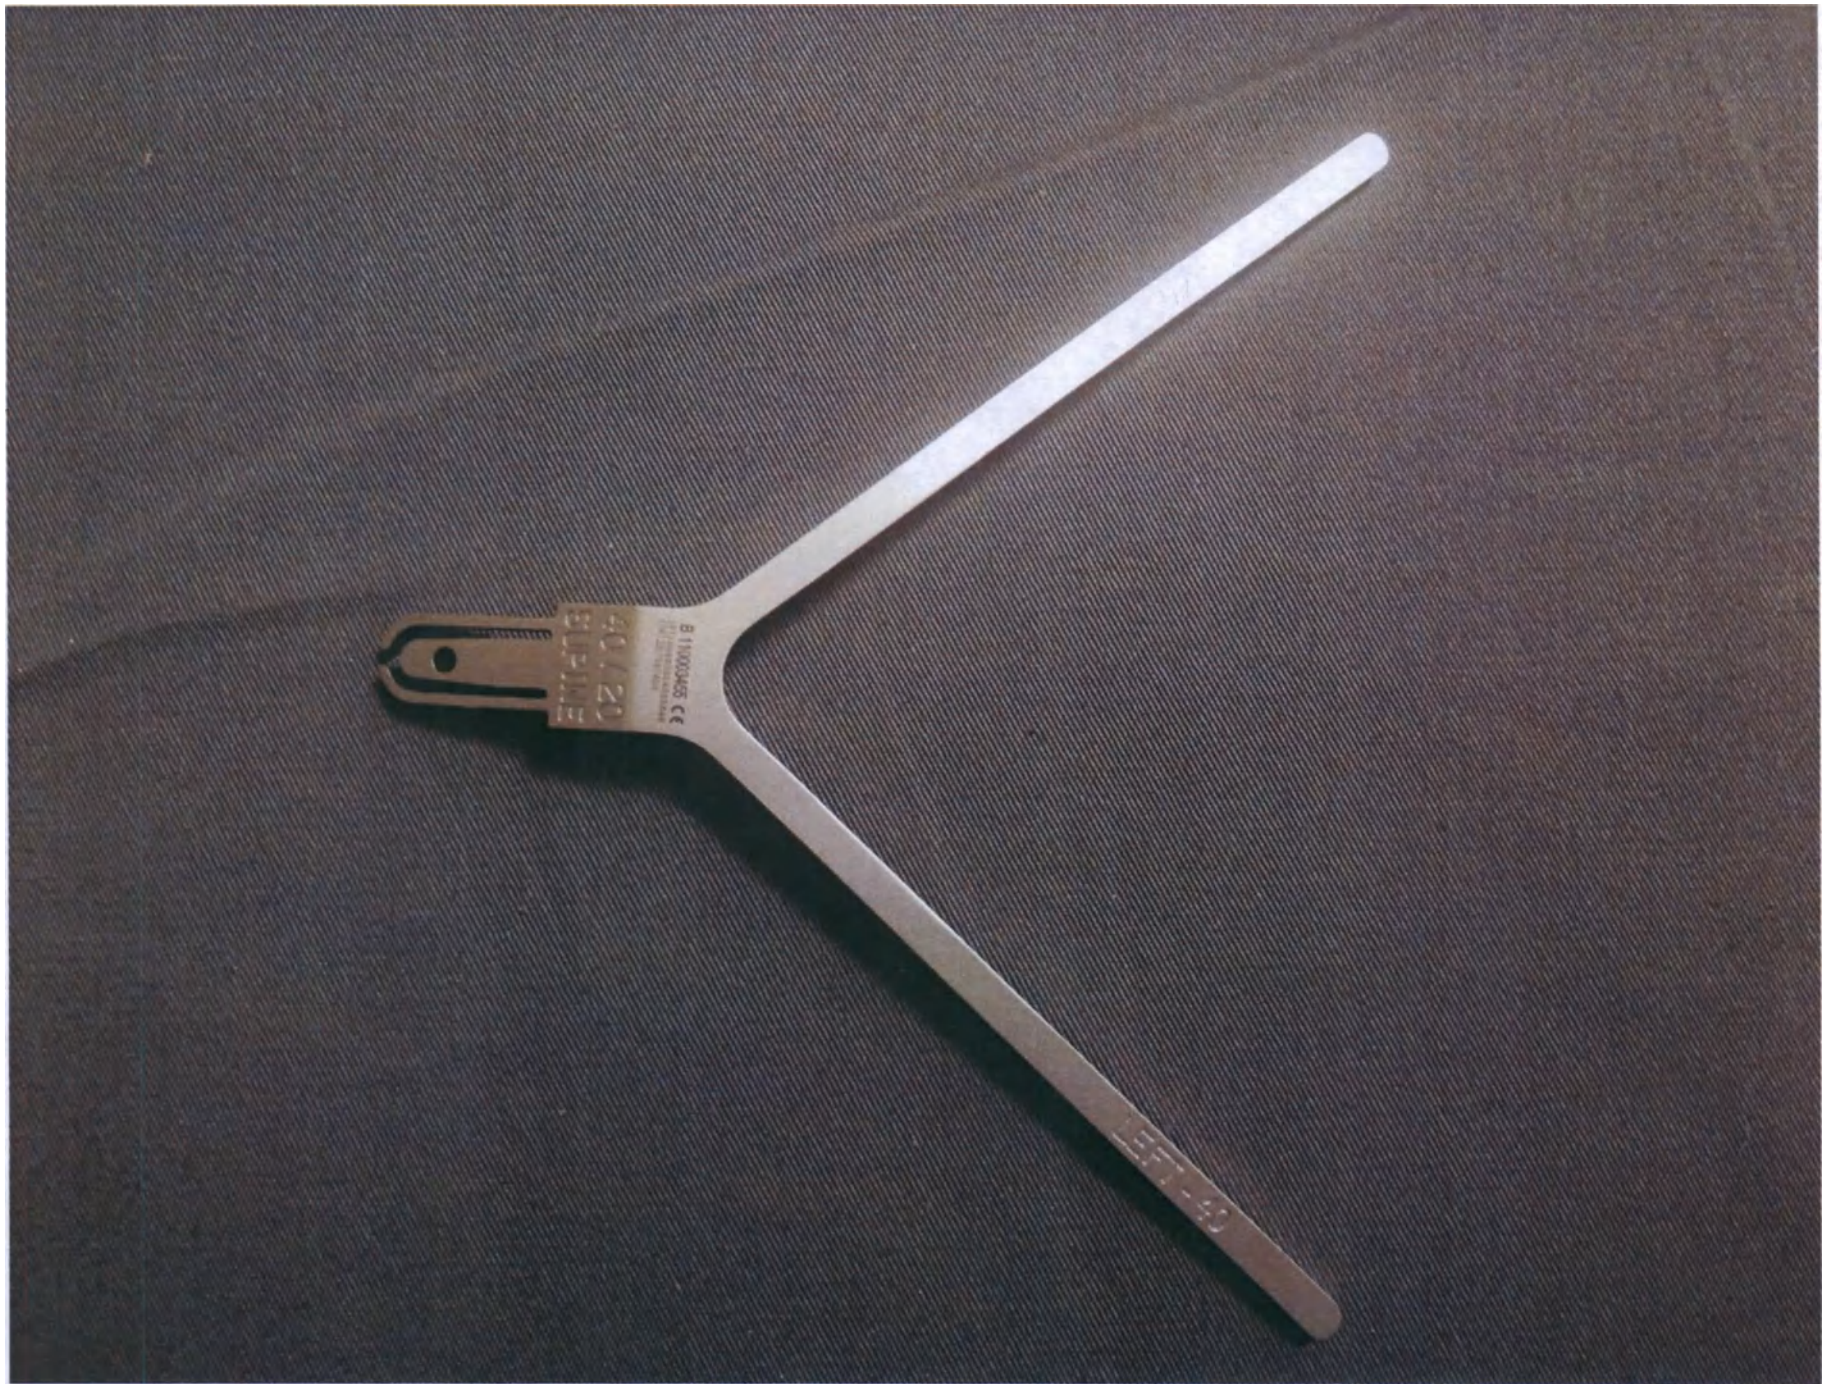

**Рис. 3. Направитель для положения на спине G7.**


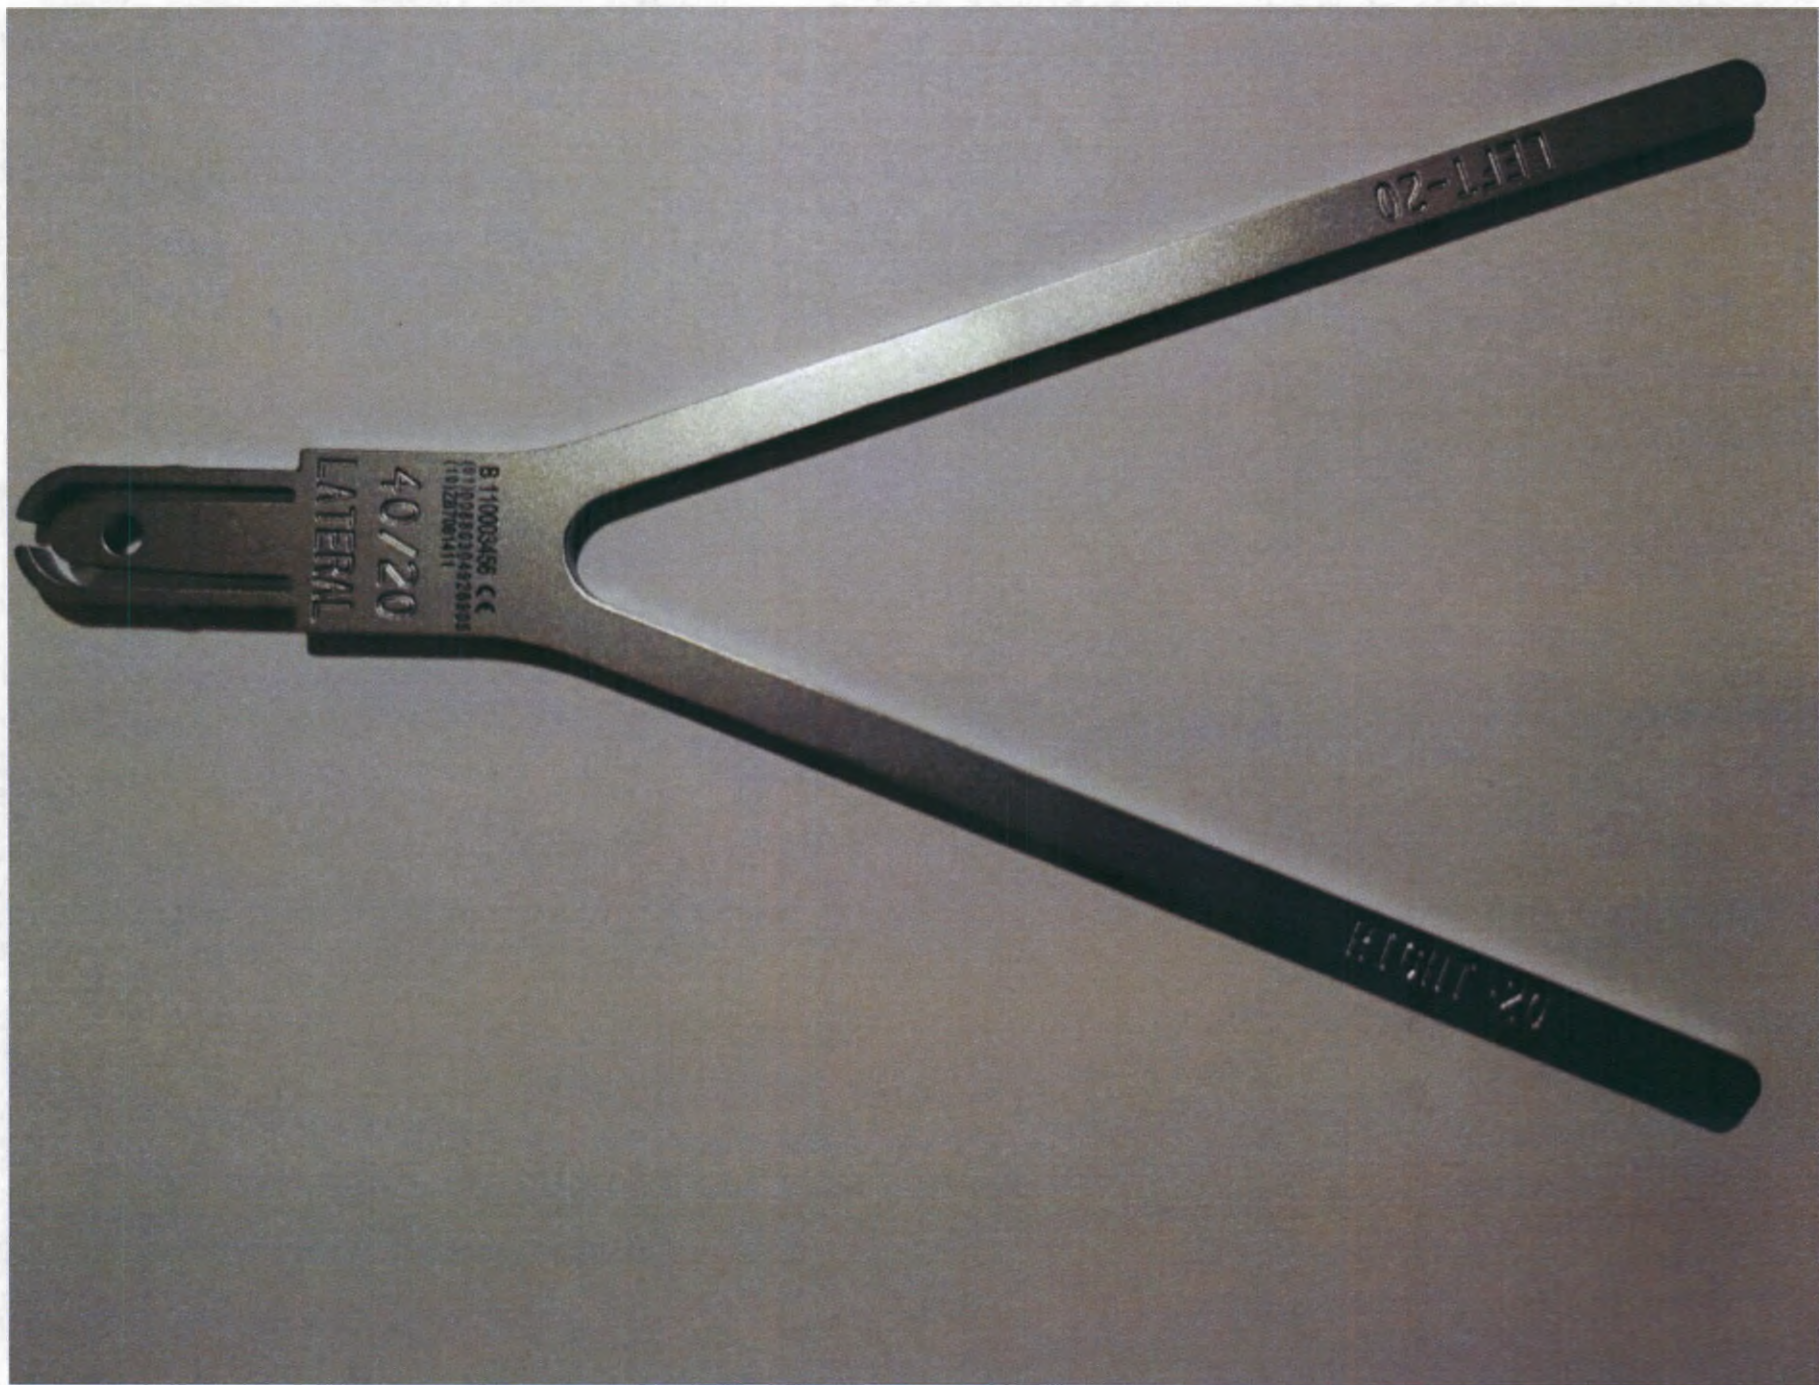


Рис. 4. Направитель латеральный G7.



**Рис. 5. Направитель сверла G7.**

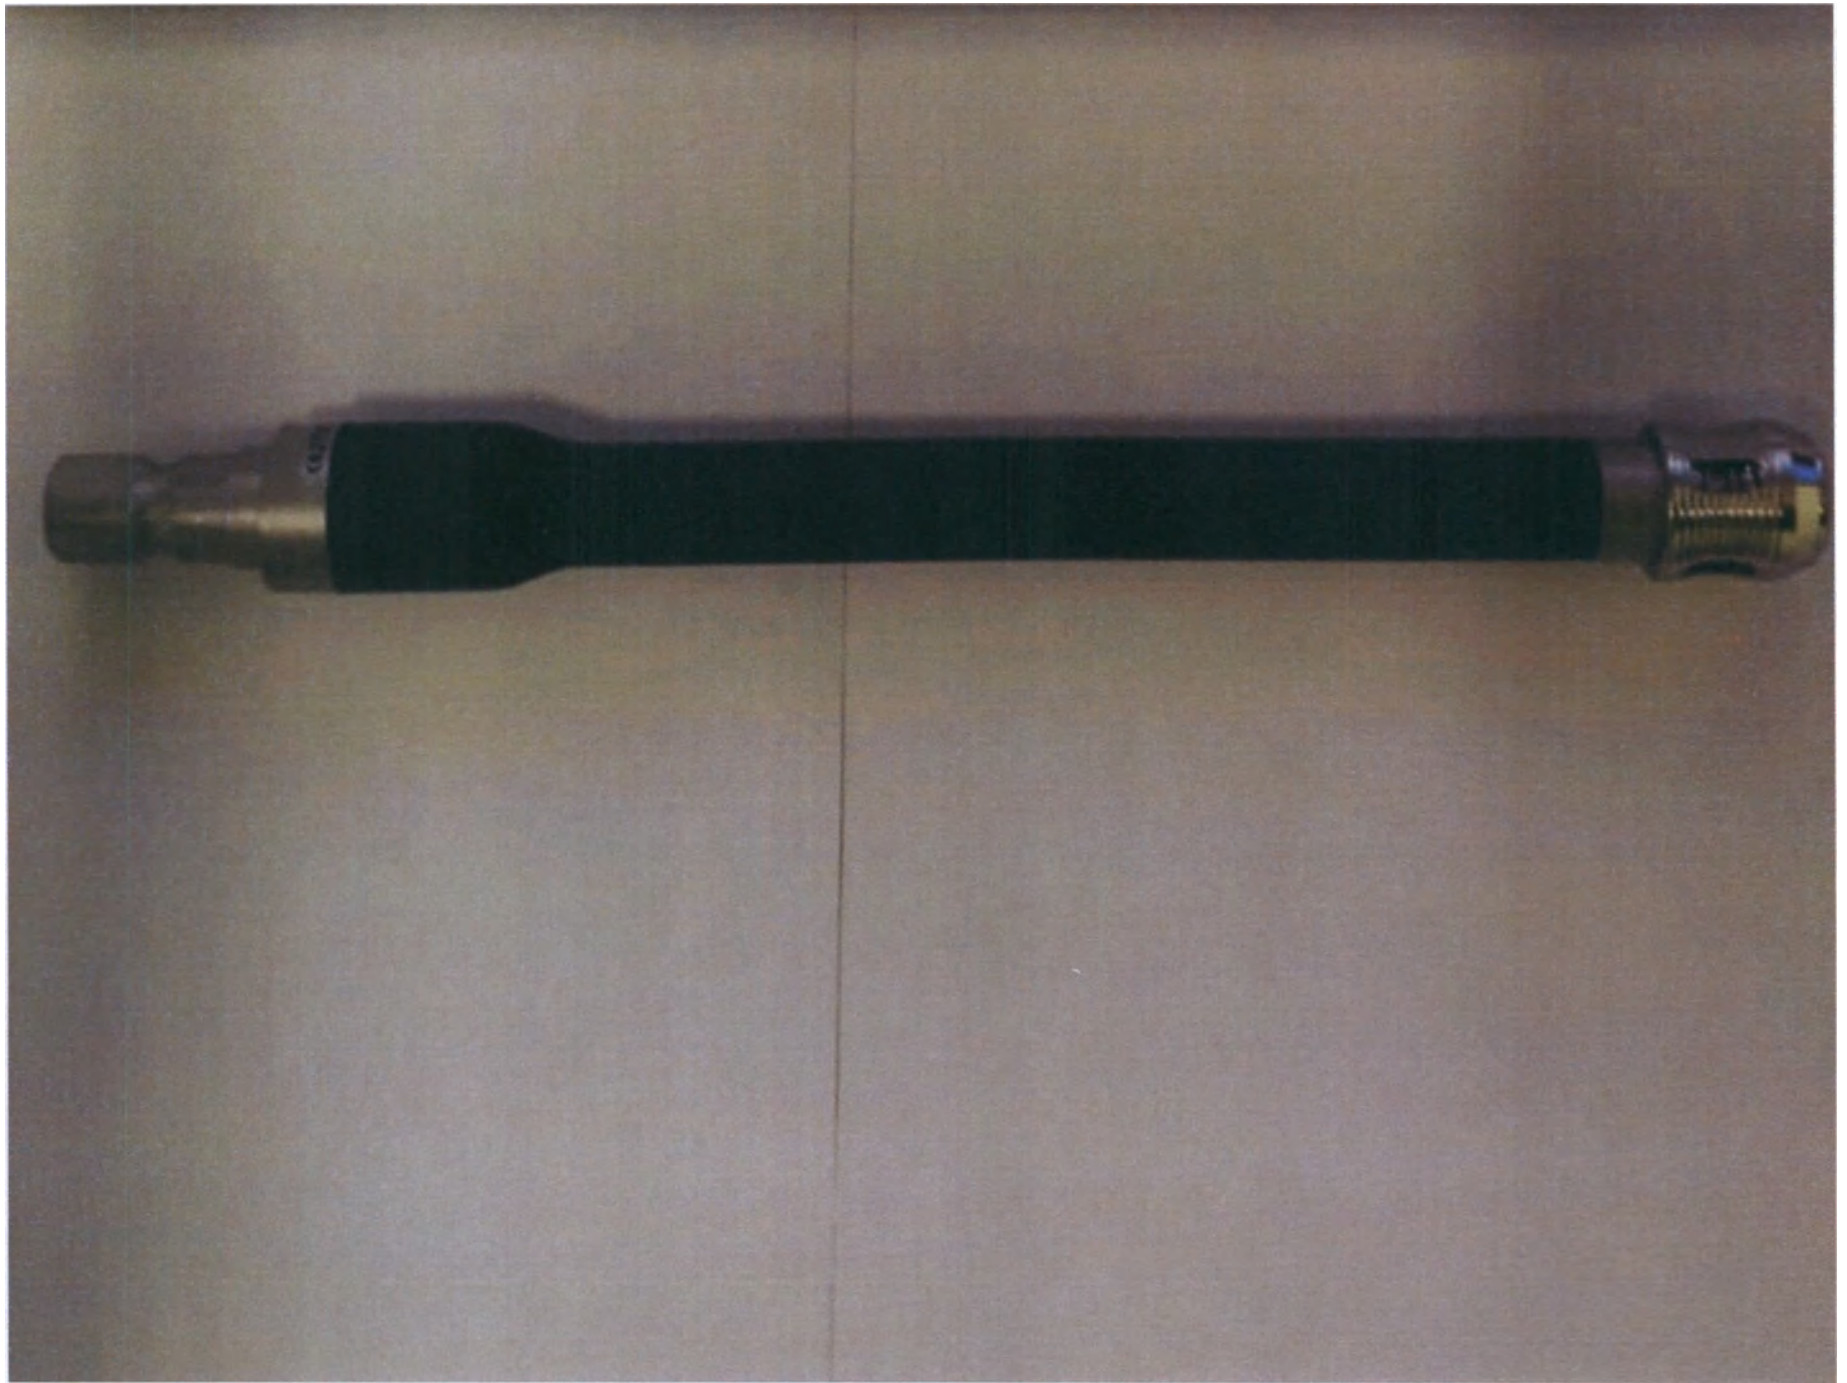

**Рис. 6. Направитель сверла гибкий.**



**Рис. 7. Отвертка гексагональная G7 с шаровым наконечником**


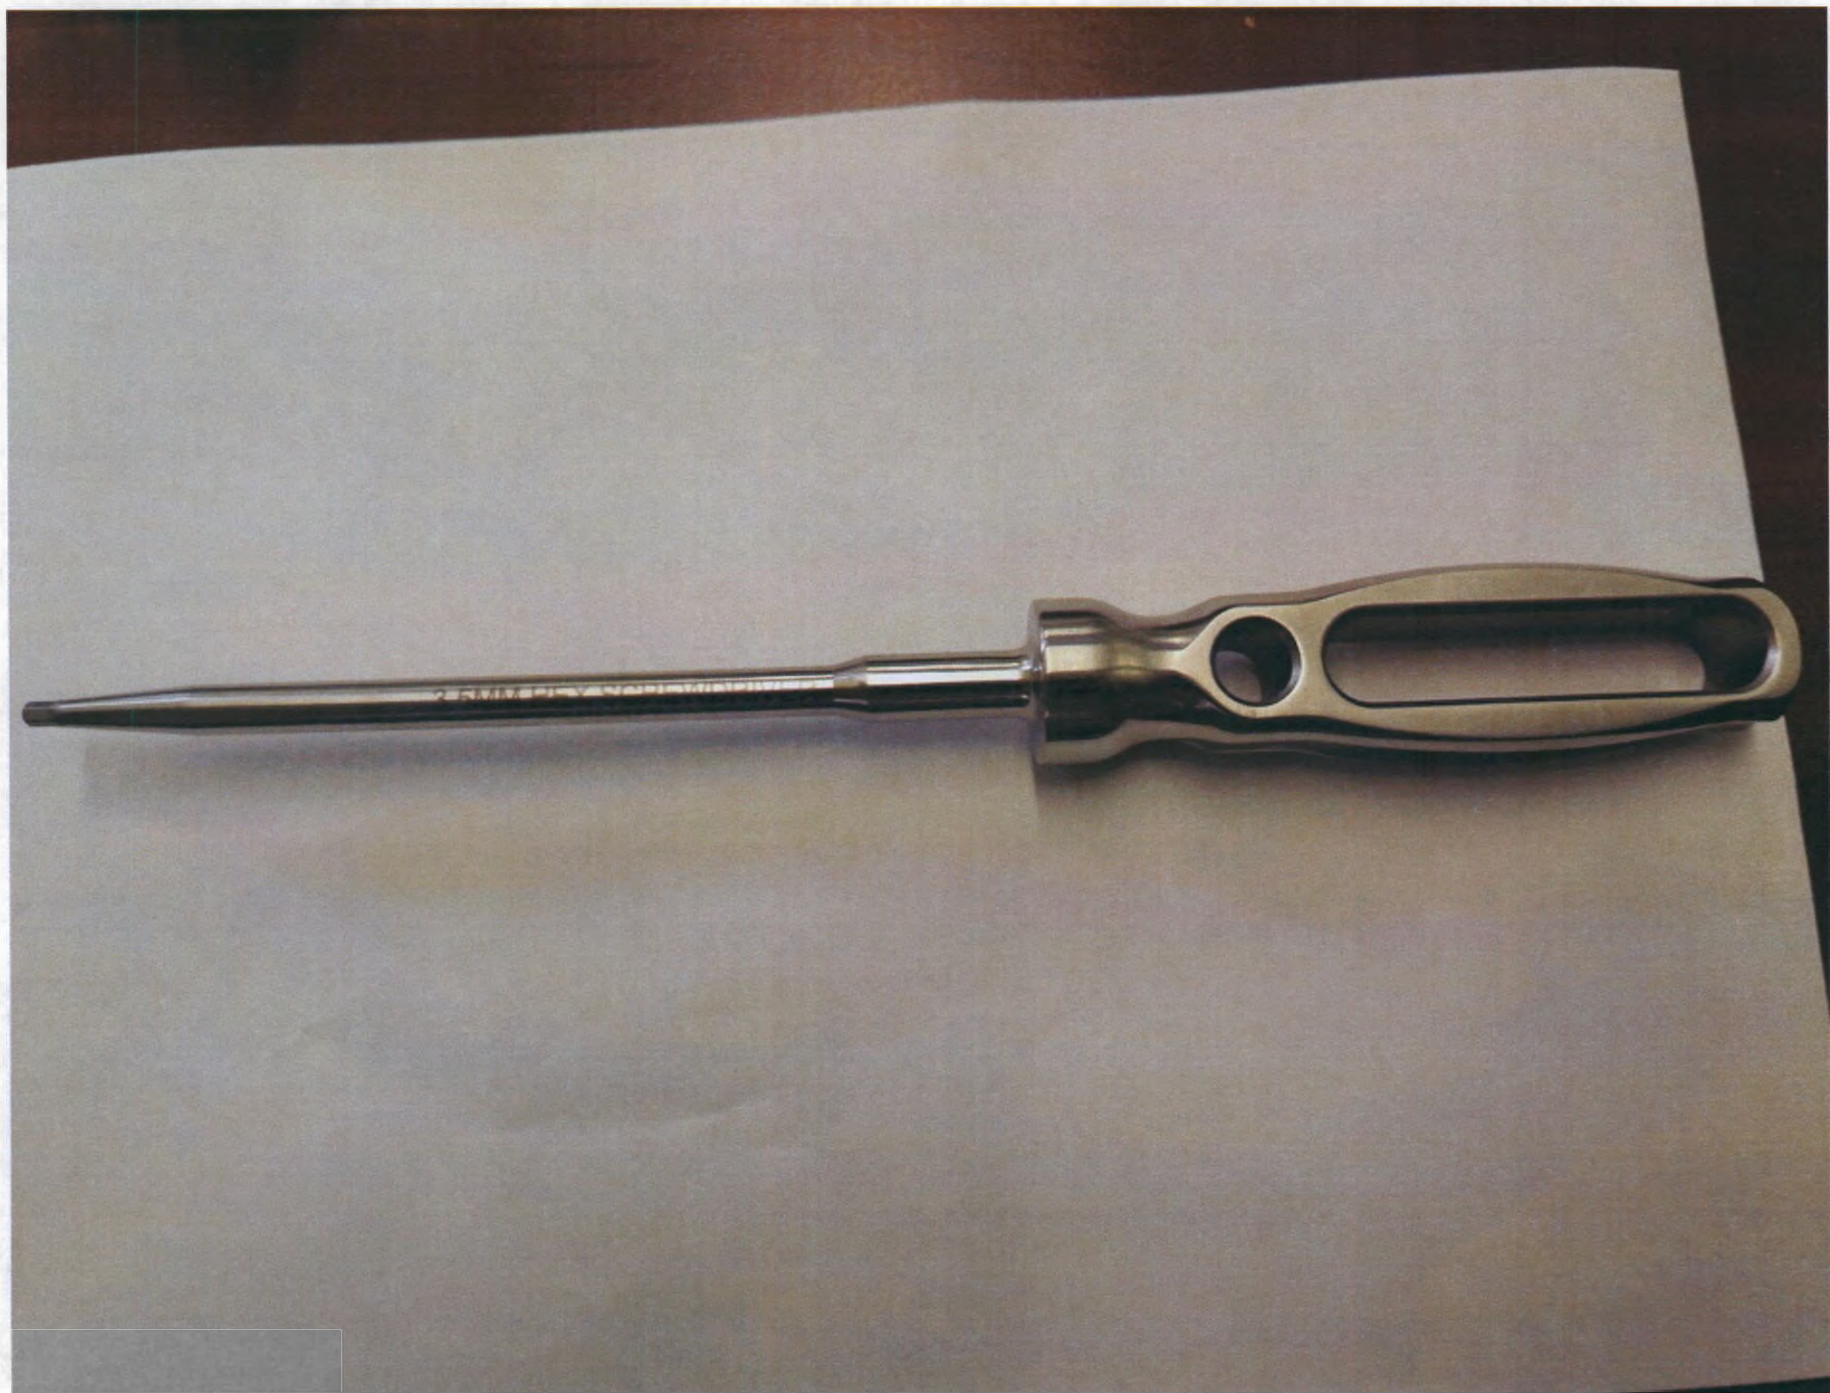


Рис. 8. Отвертка гексагональная 3,5 мм



**Рис. 9. Отвертка модульная G7 прямая 3,5 мм**

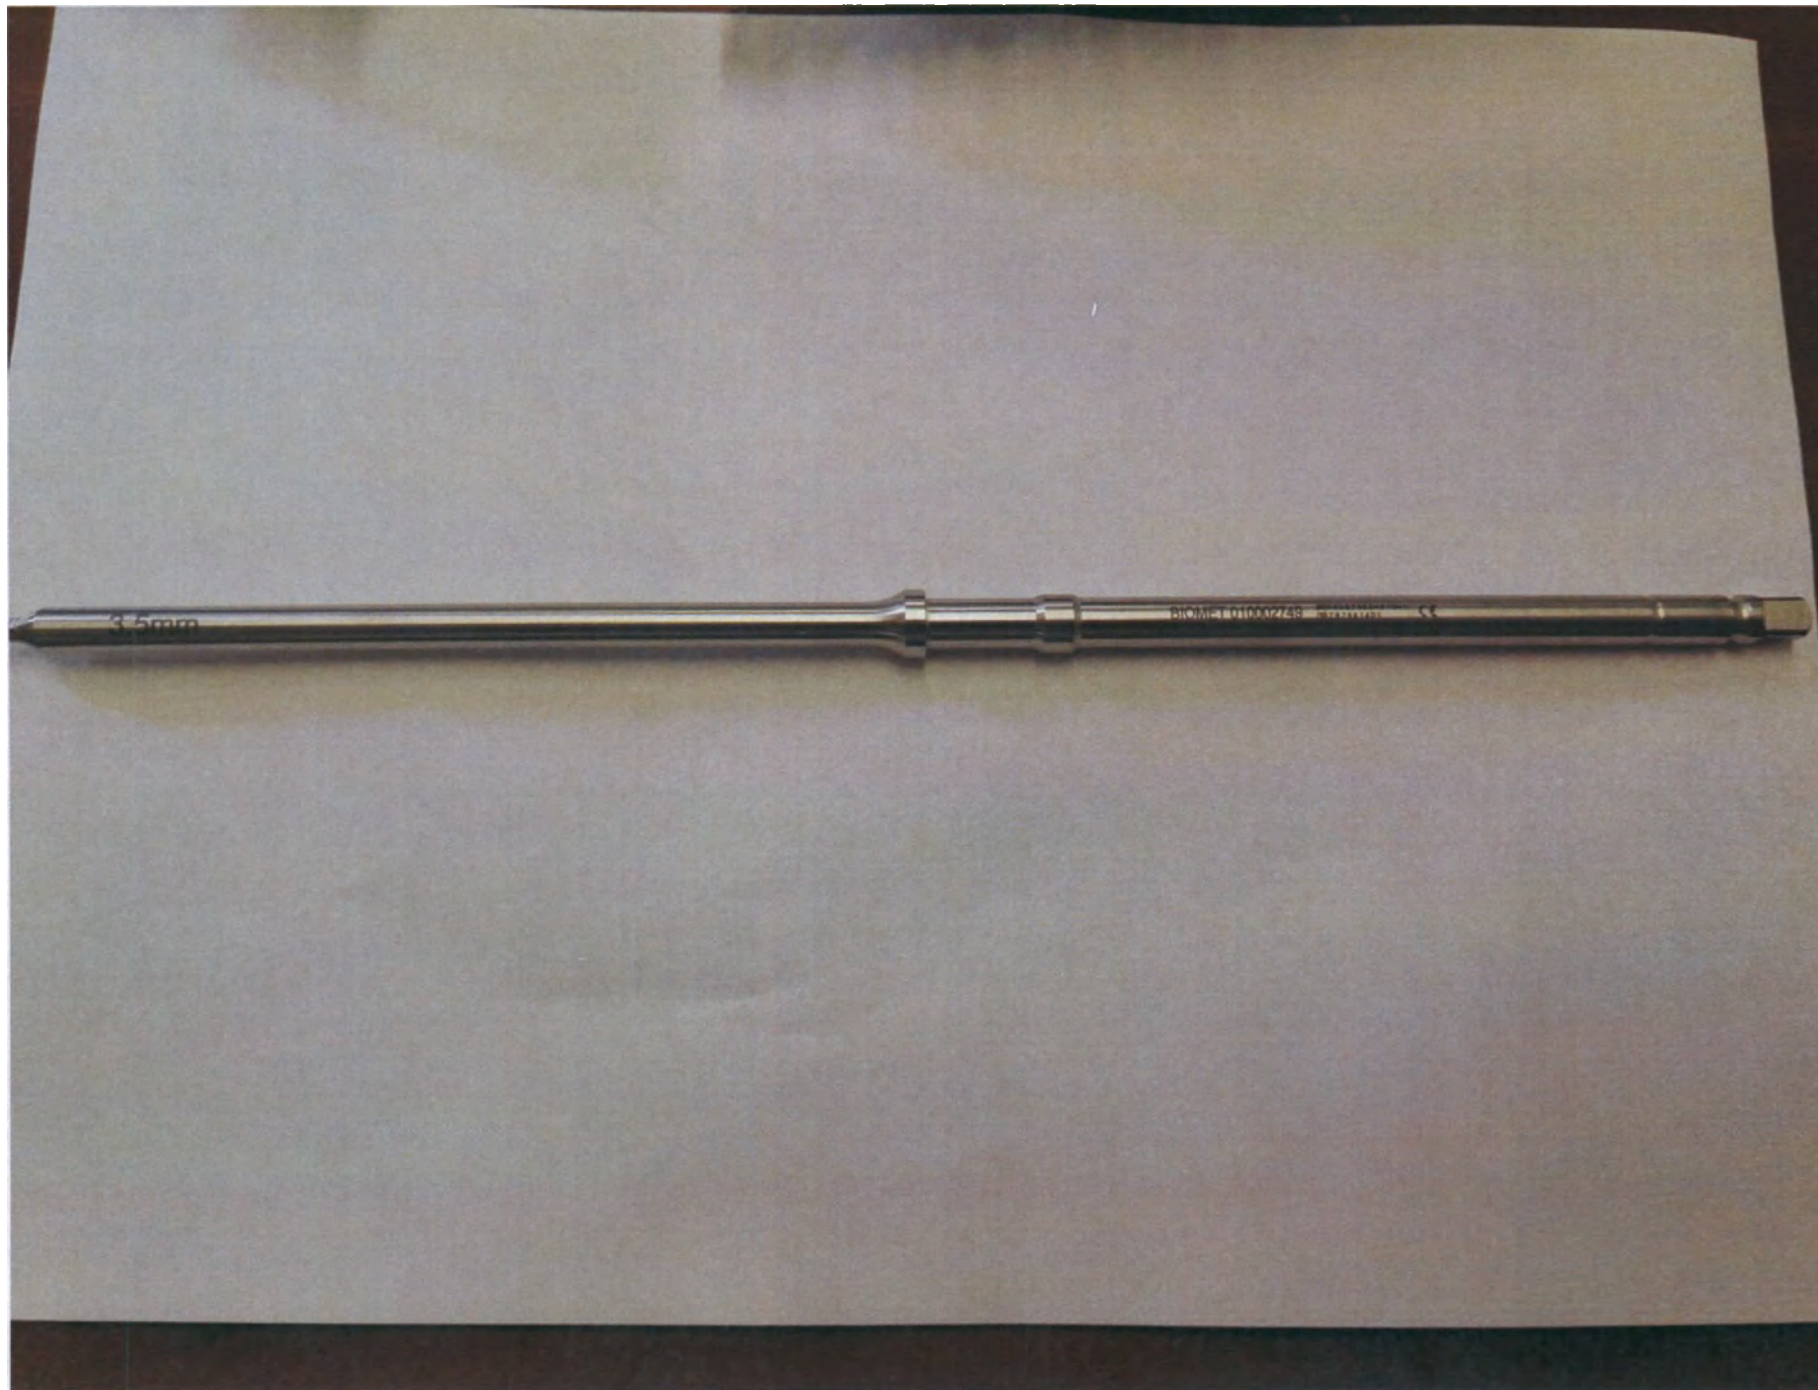

**Рис. 10. Отвертка модульная G7 с U-соединением 3,5 мм**


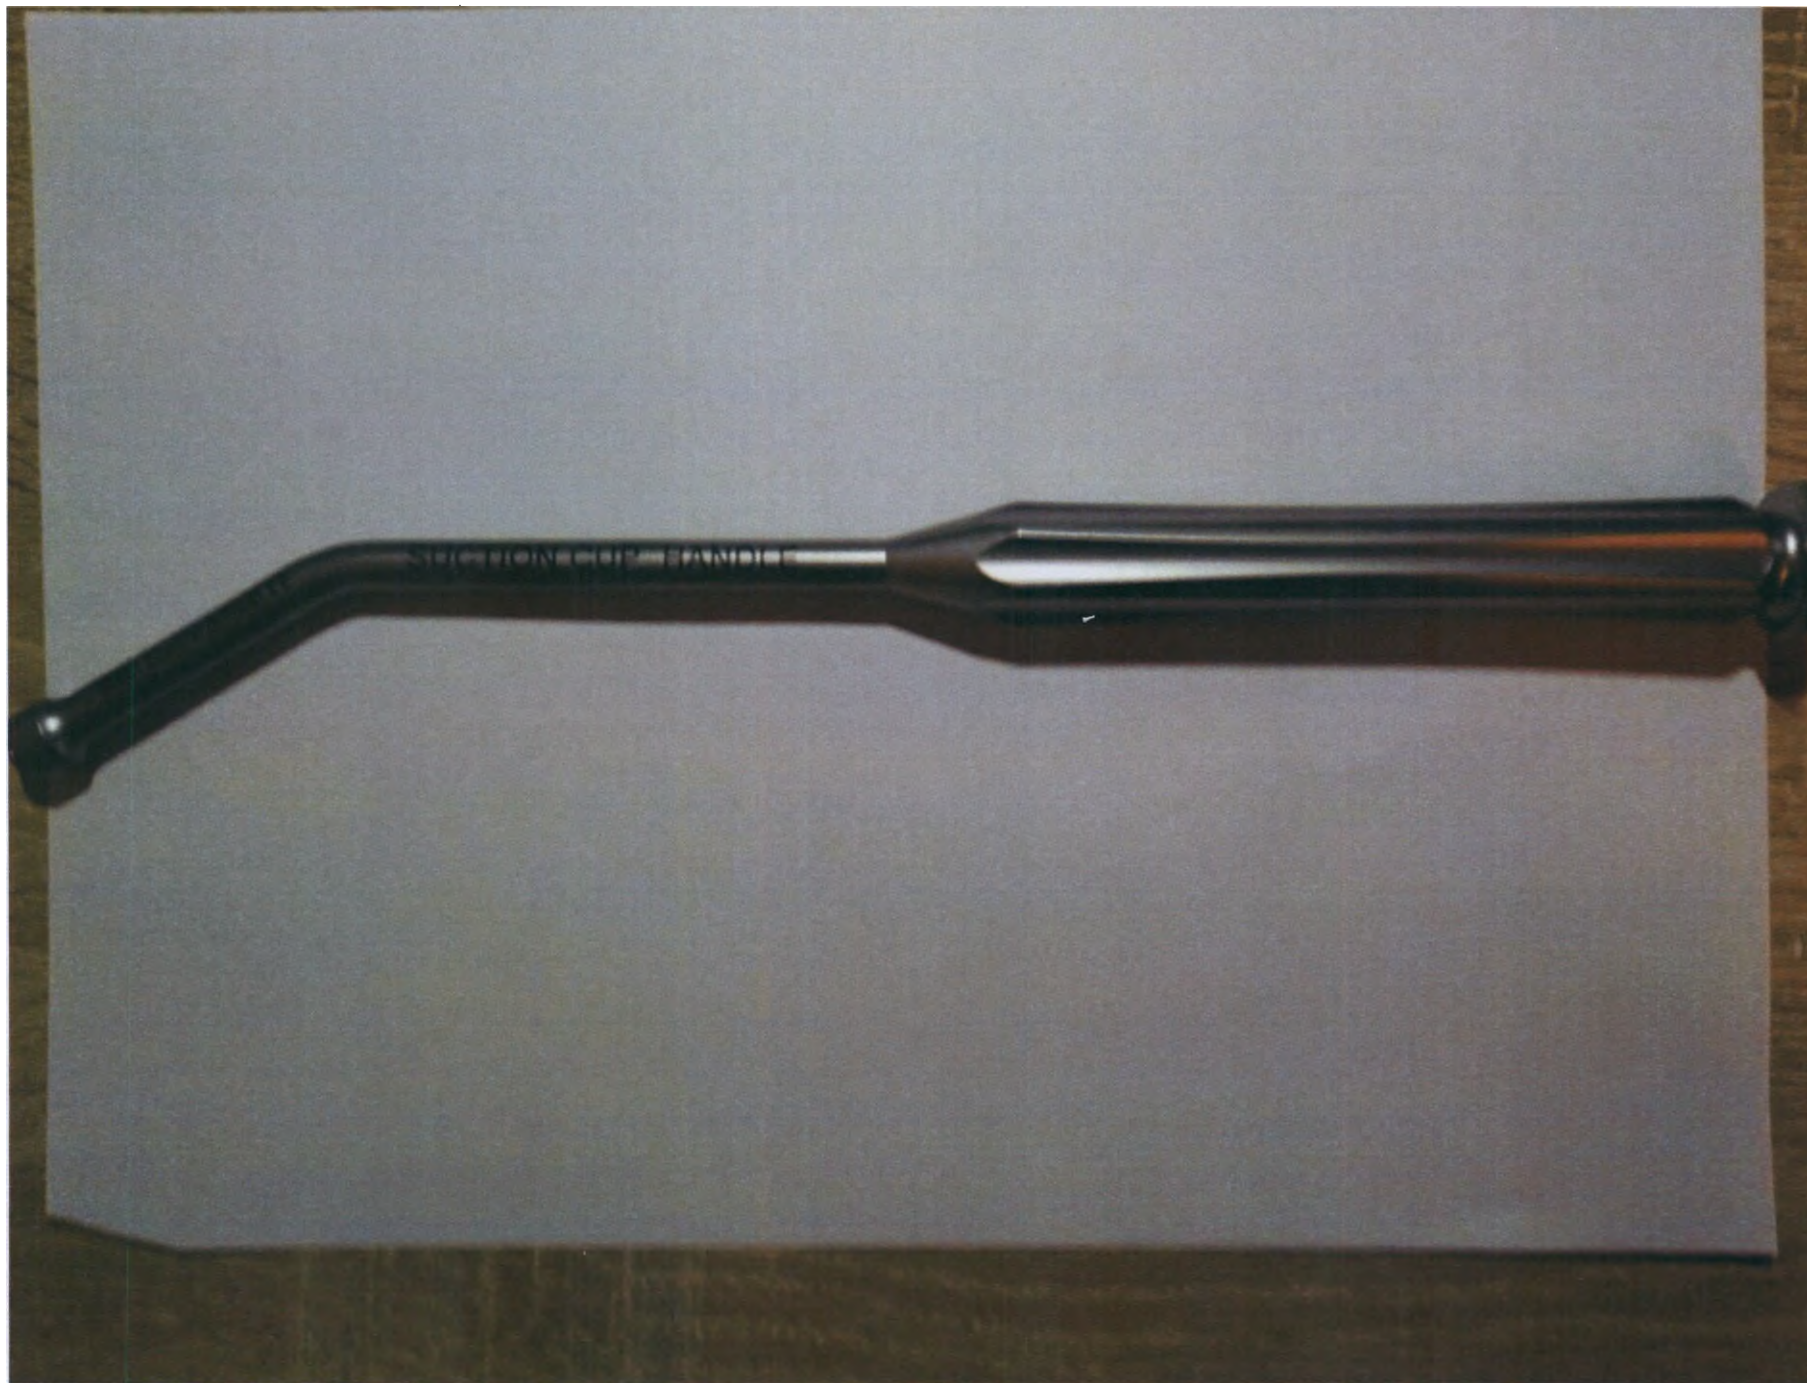


Рис. 11. Изгибатель / рукоятка присоски G7.

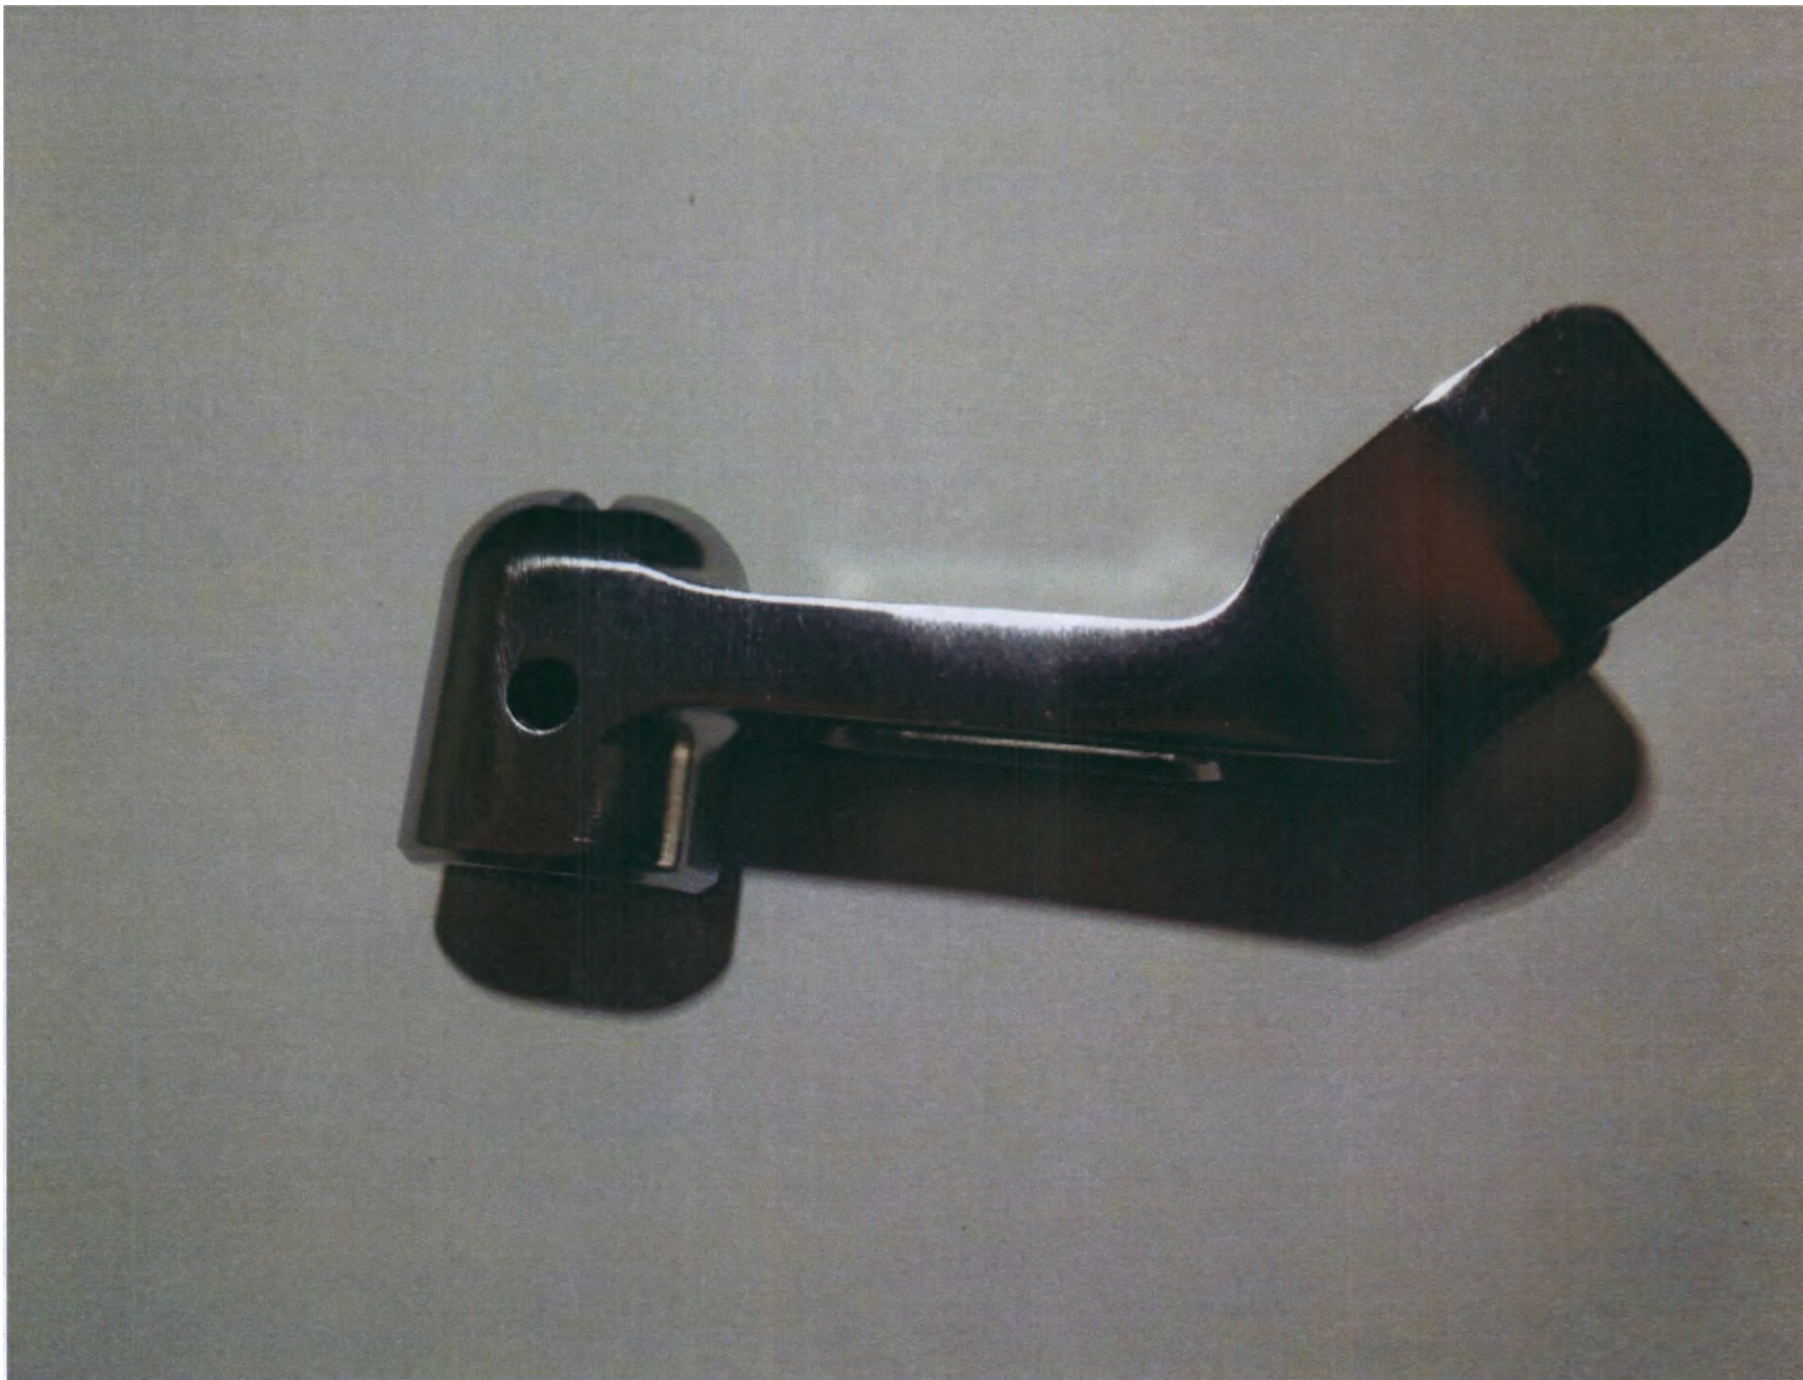

**Рис. 12. Позиционер сверла G7.**

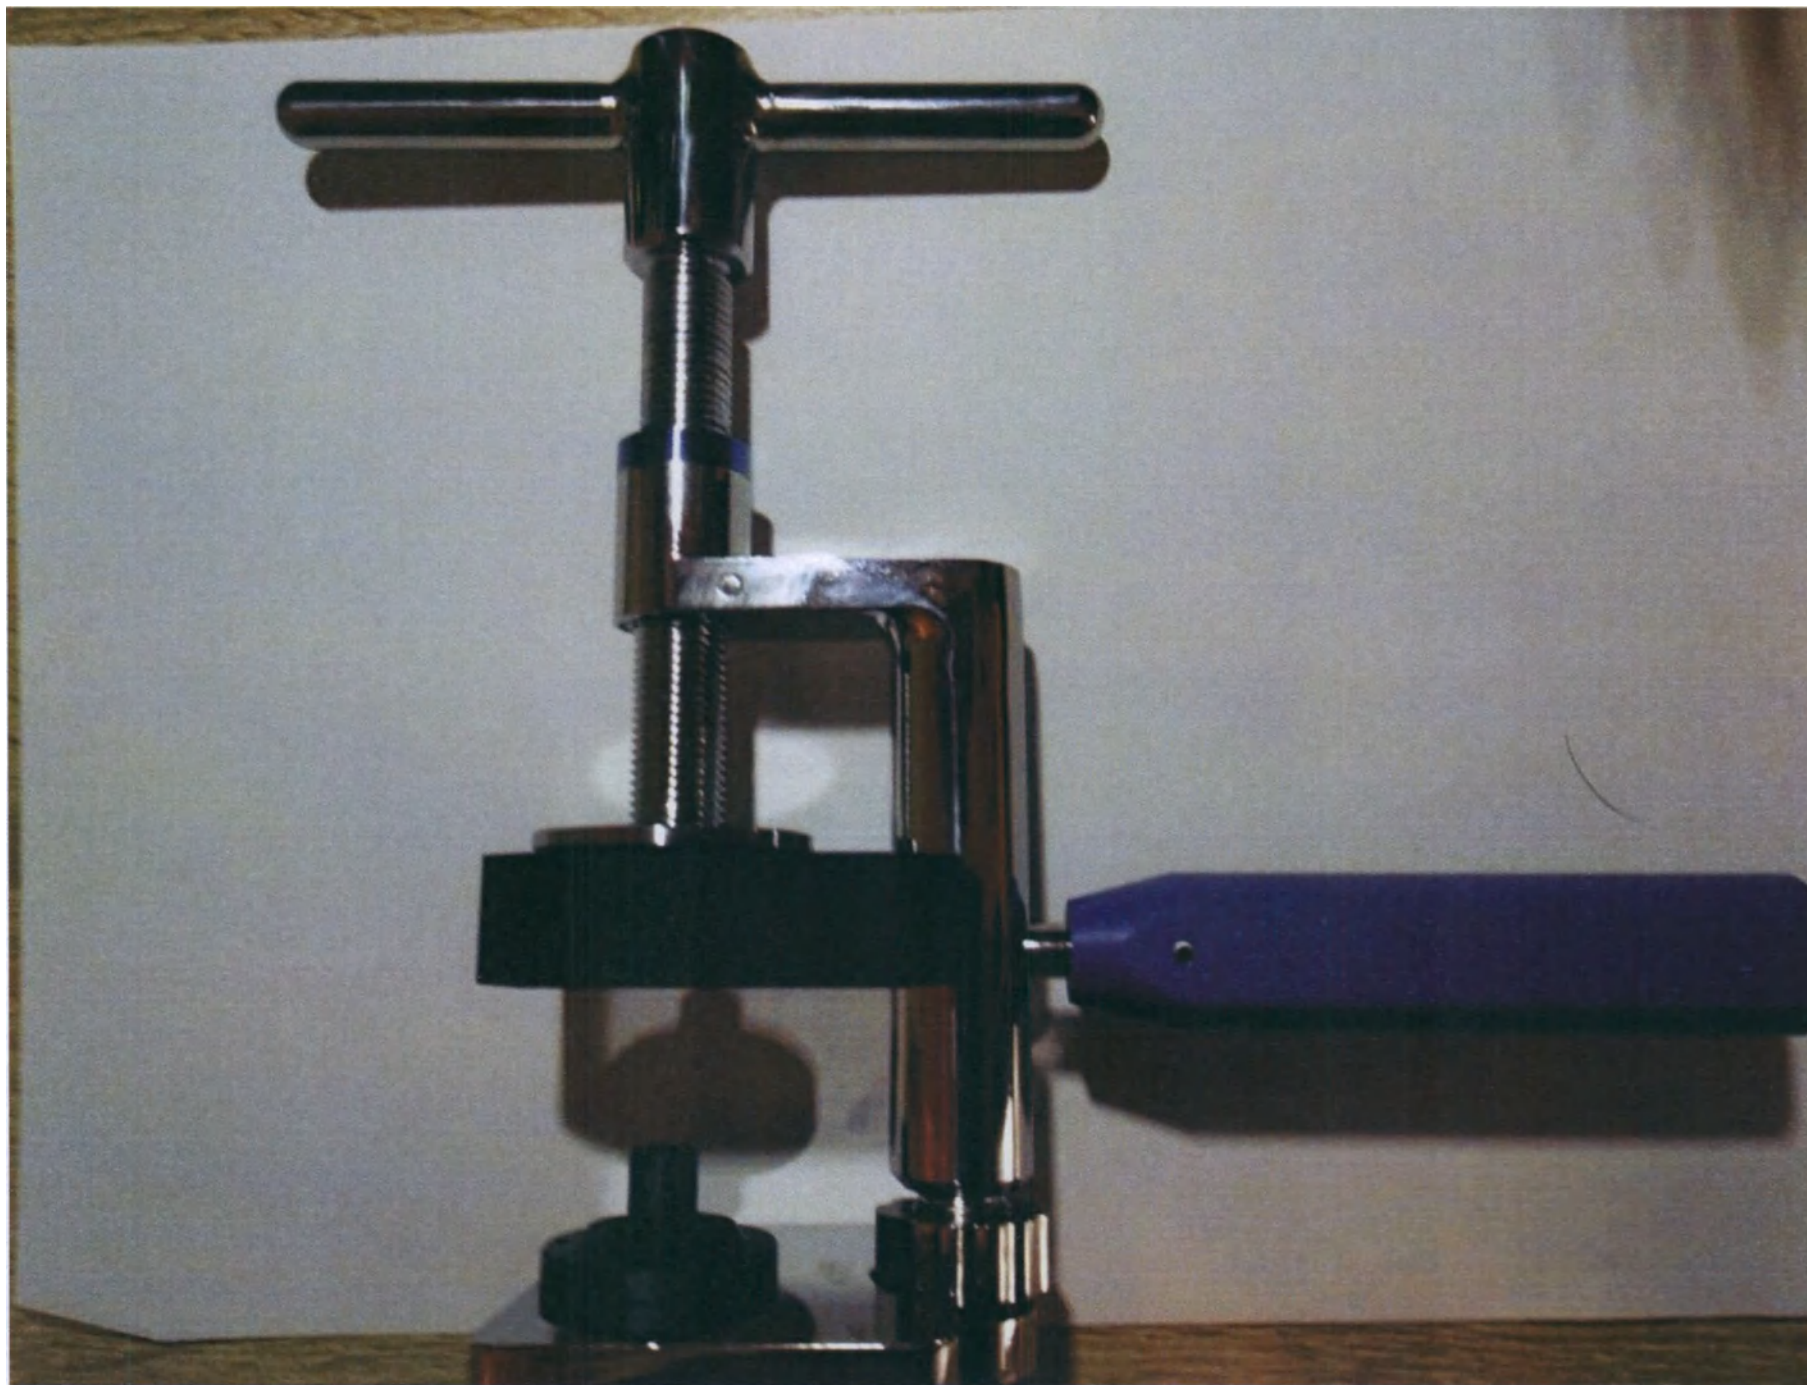


Рис. 13. Пресс для головки.



Рис. 14. Пресс для головки в разобранном виде

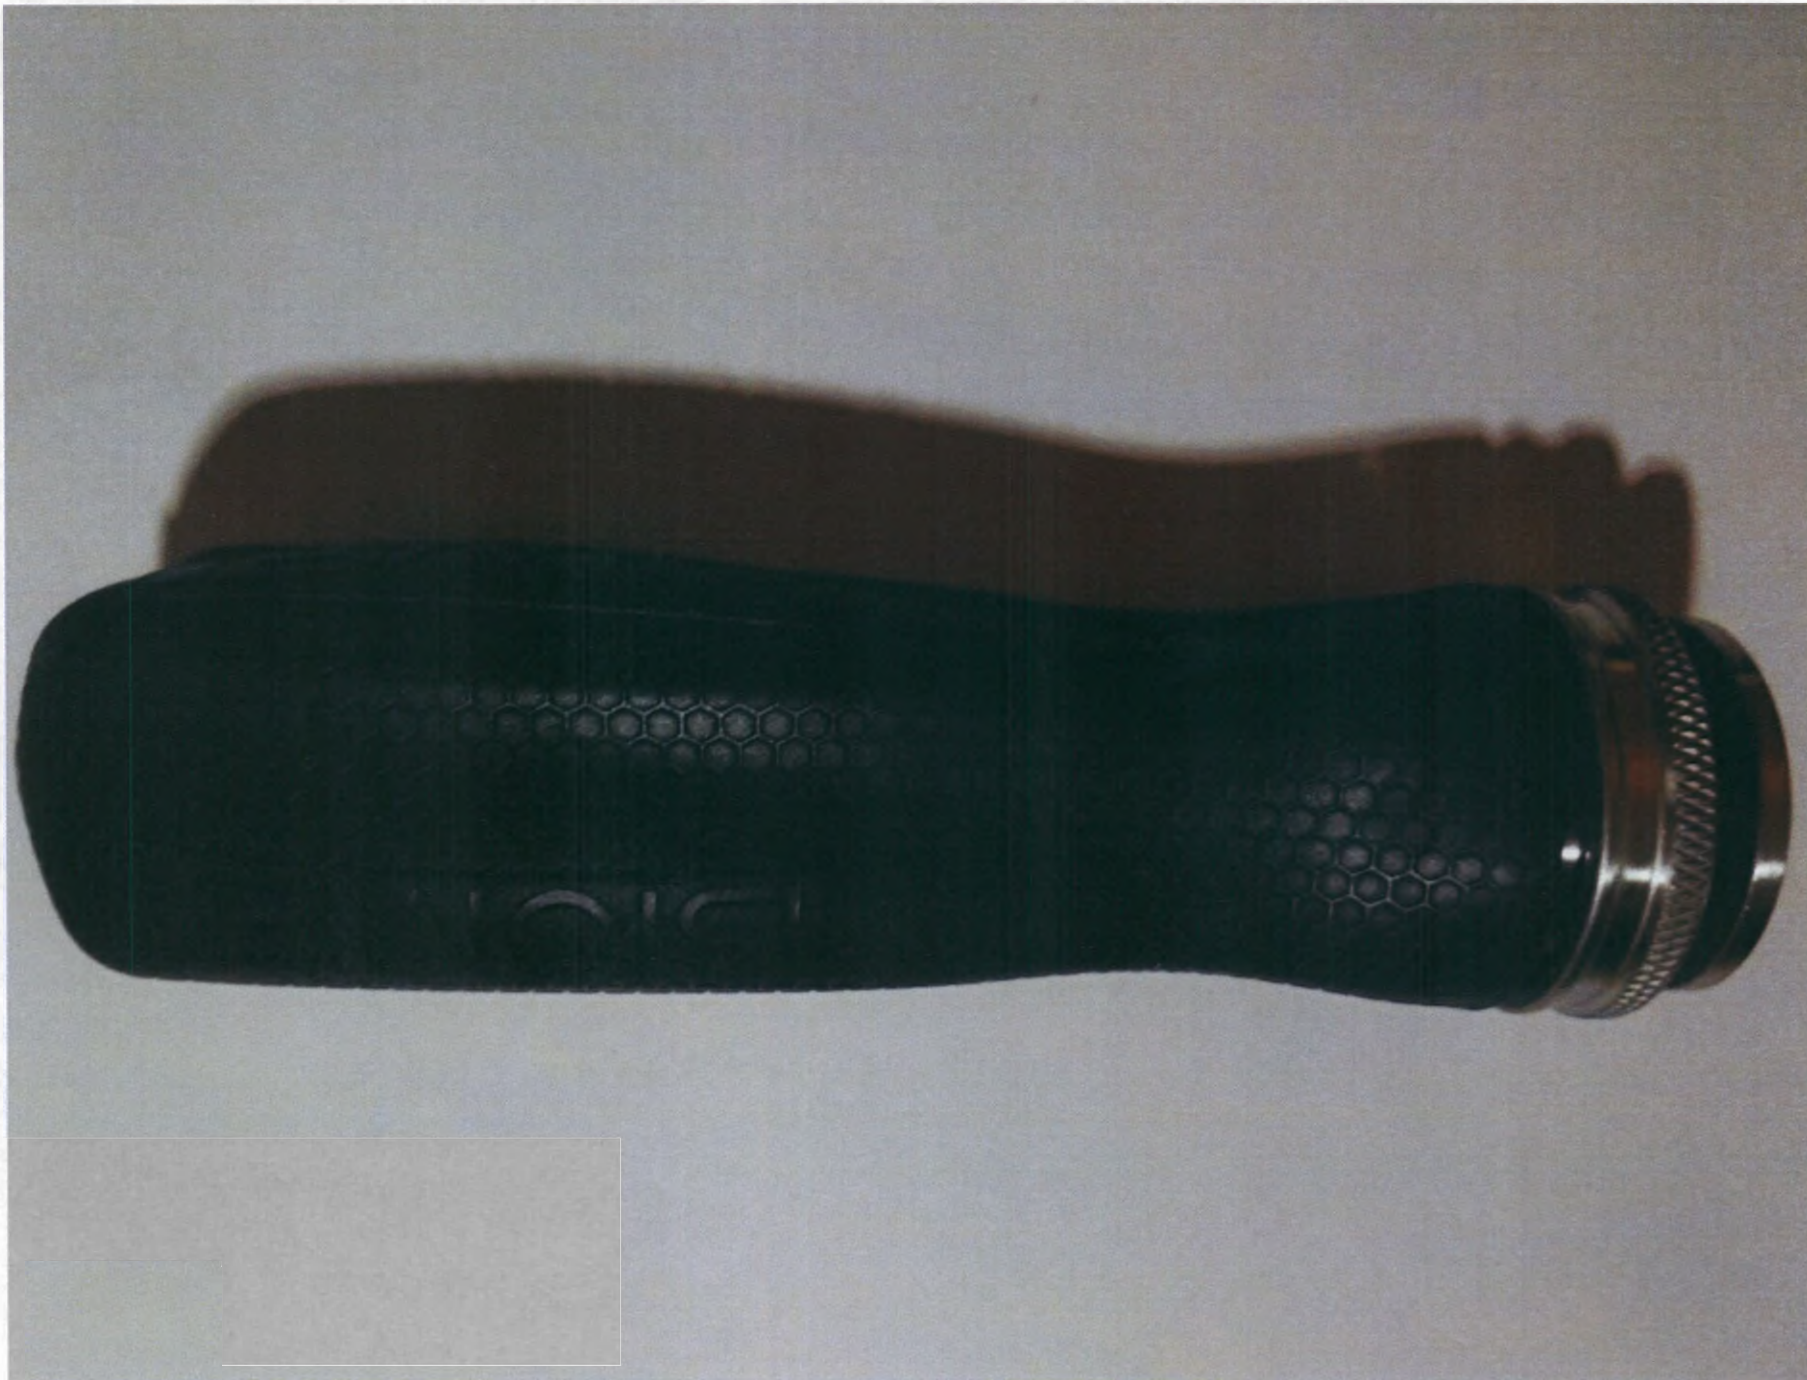


Рис. 15. Рукоятка отвертки с храповым механизмом.



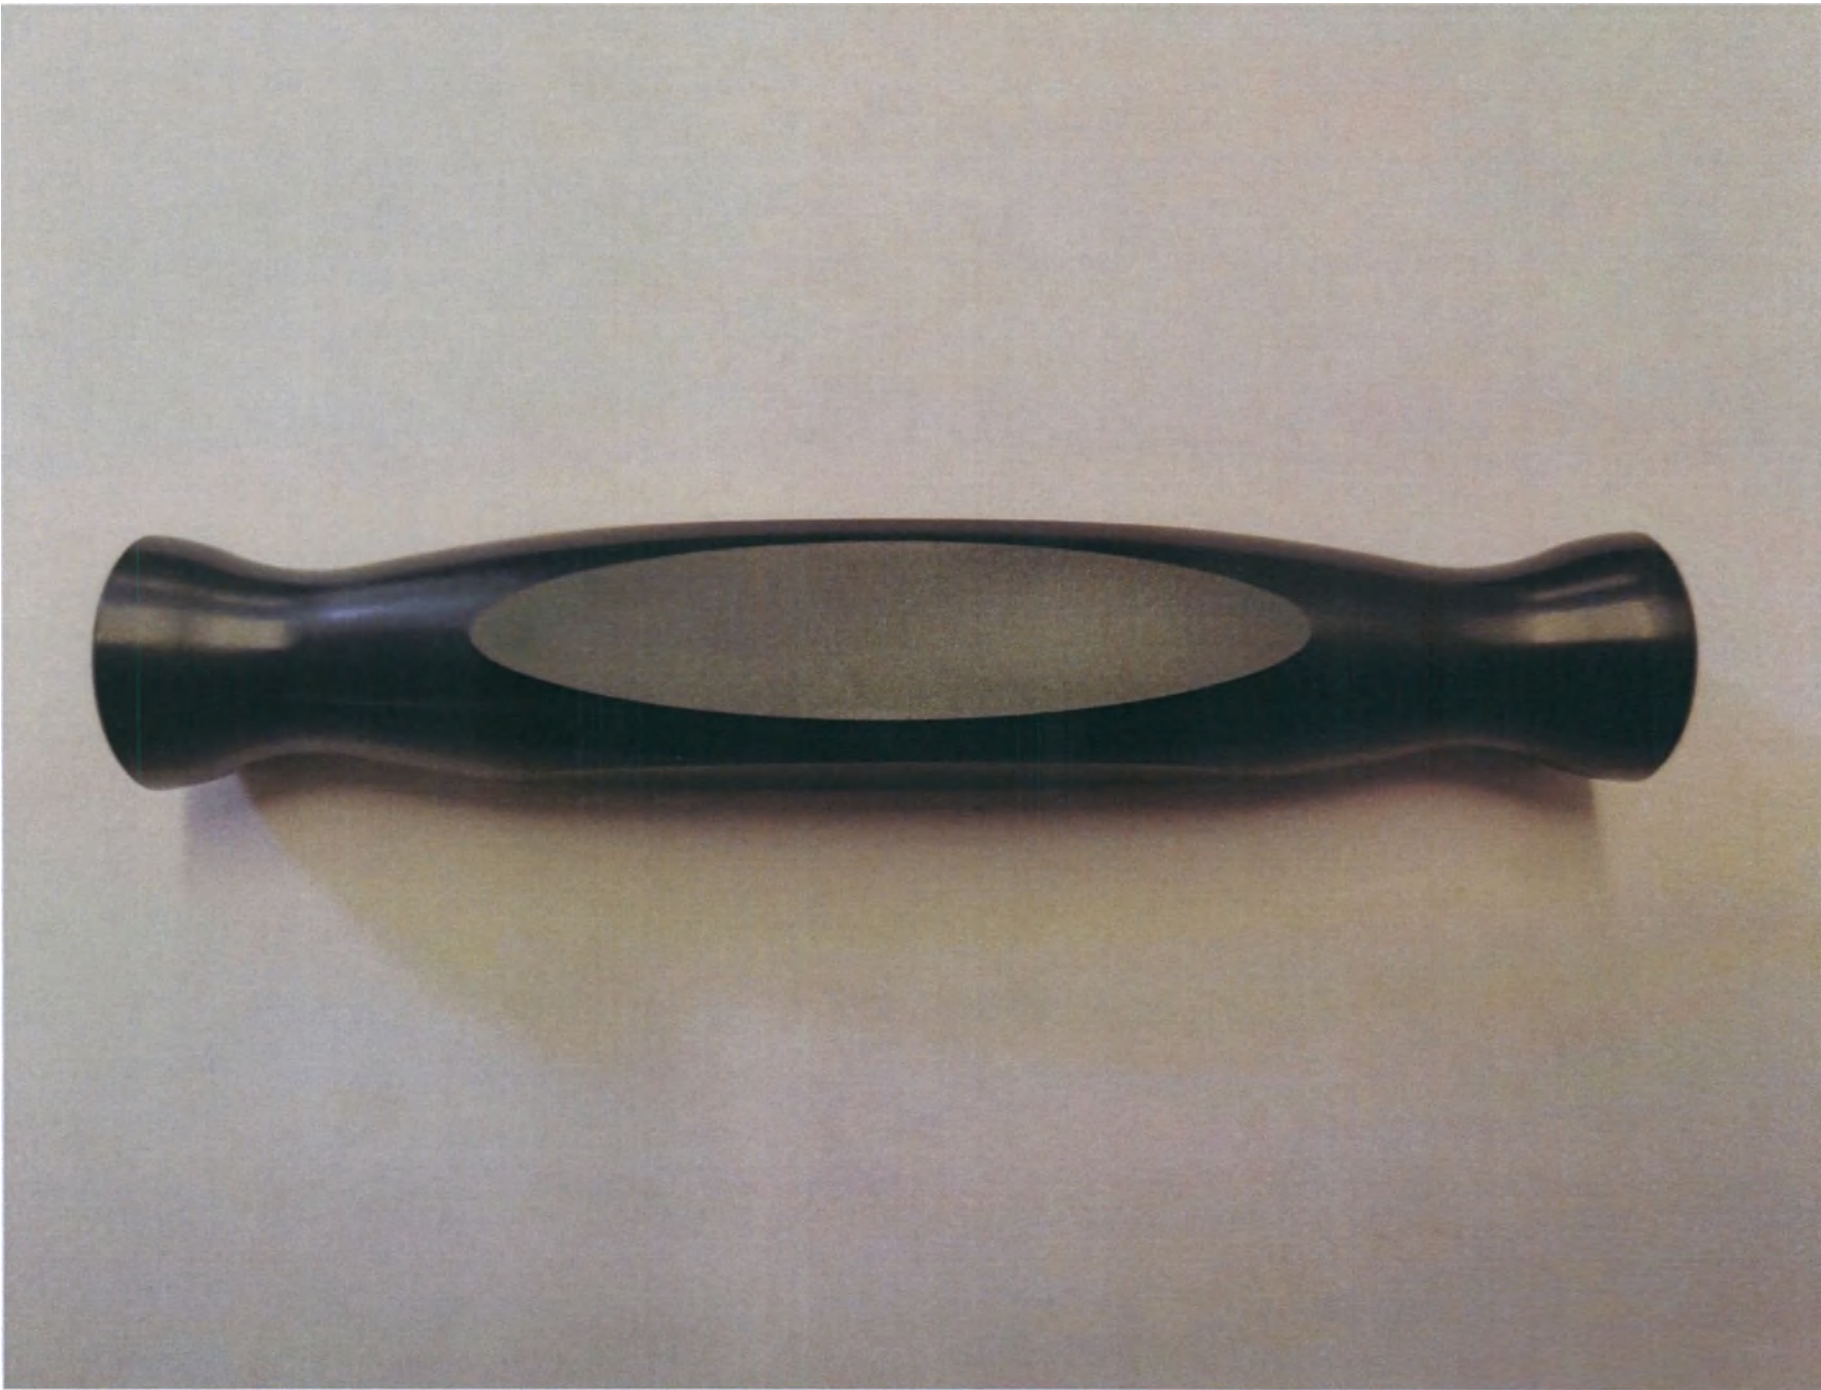



Рис. 16. Муфта отвертки G7

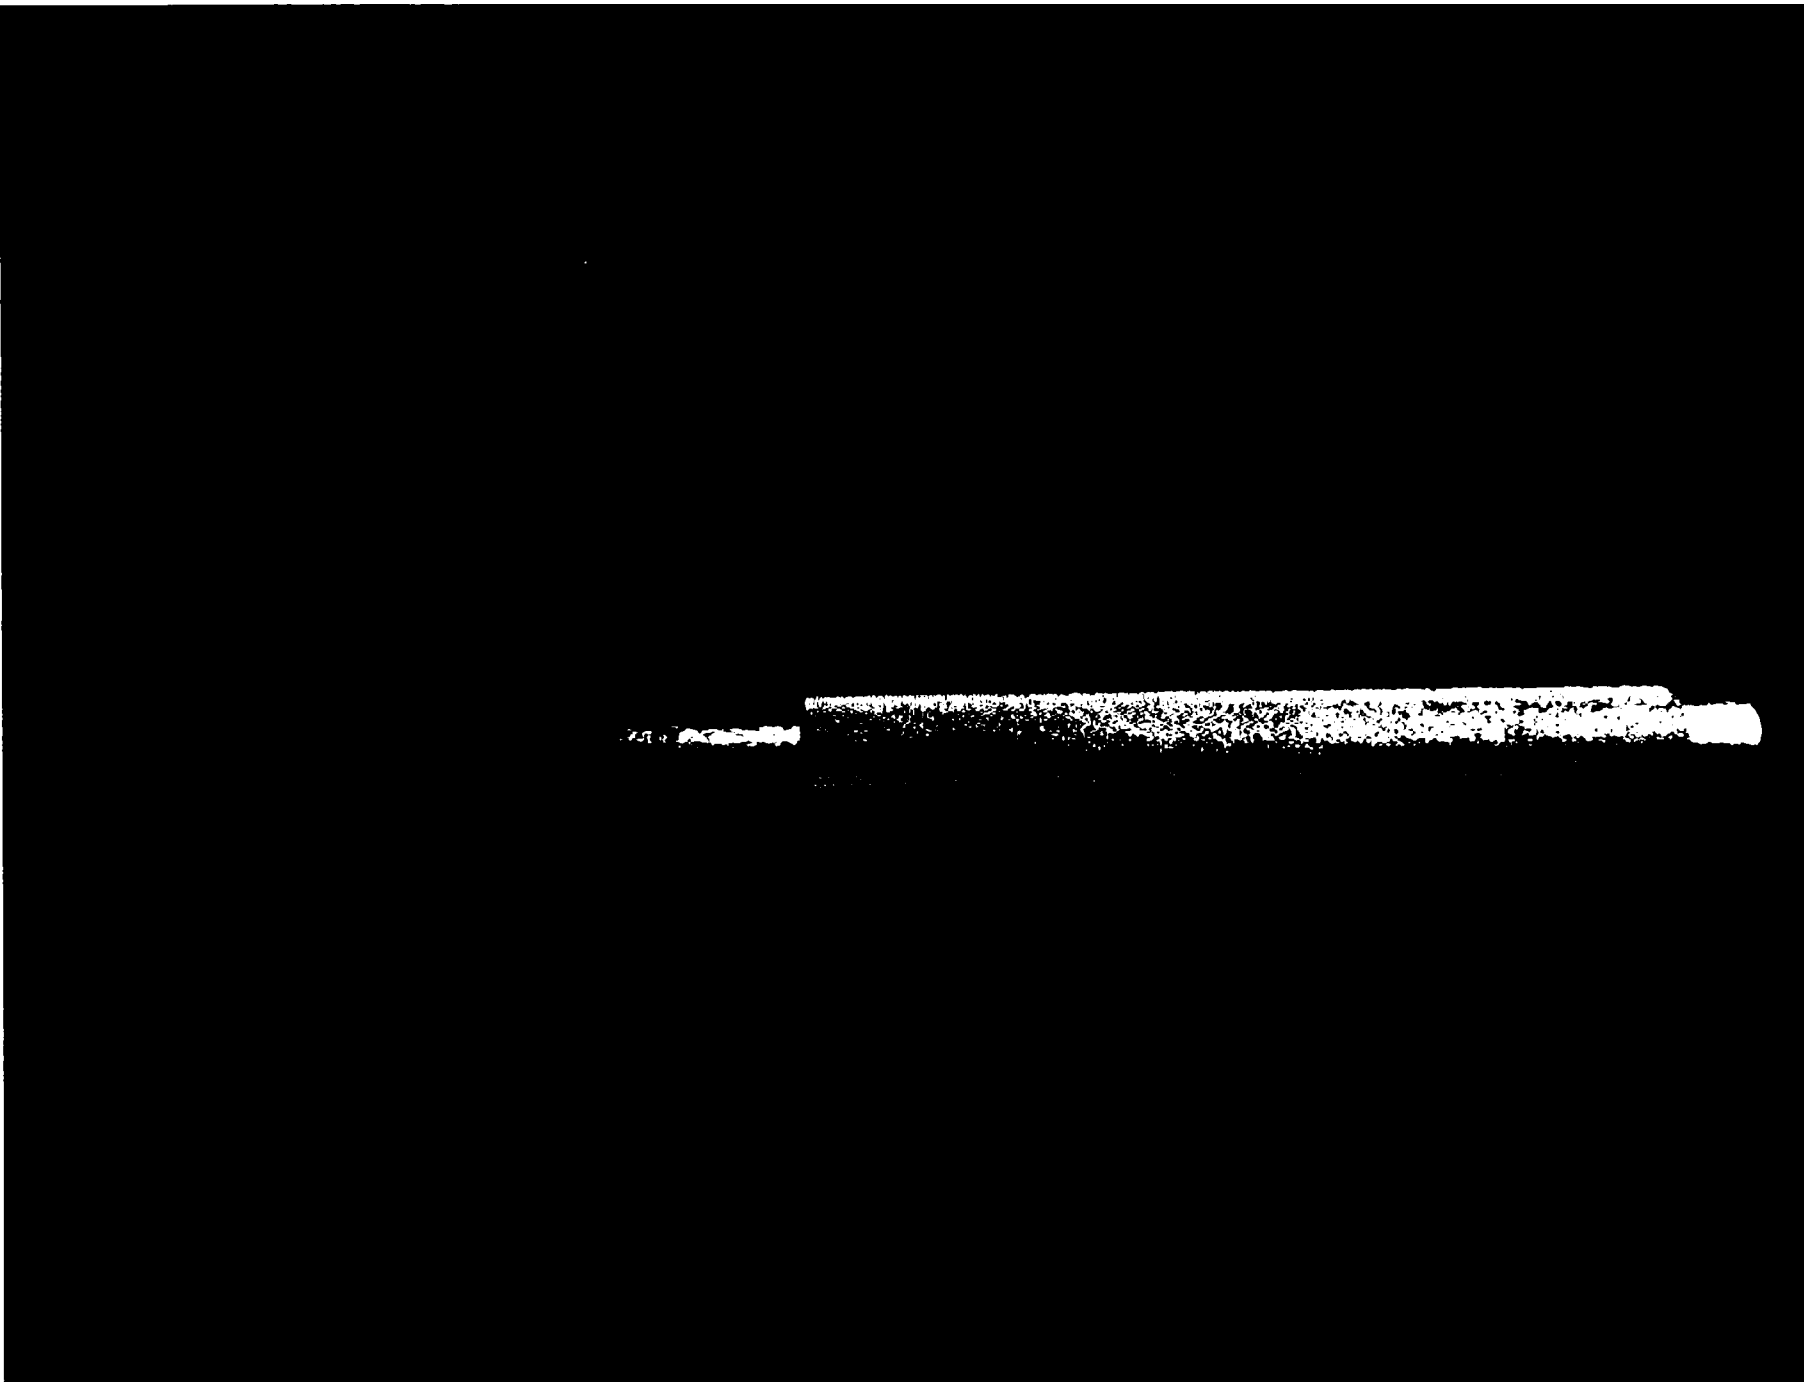


**Рис. 17. Уплотнитель G7.**

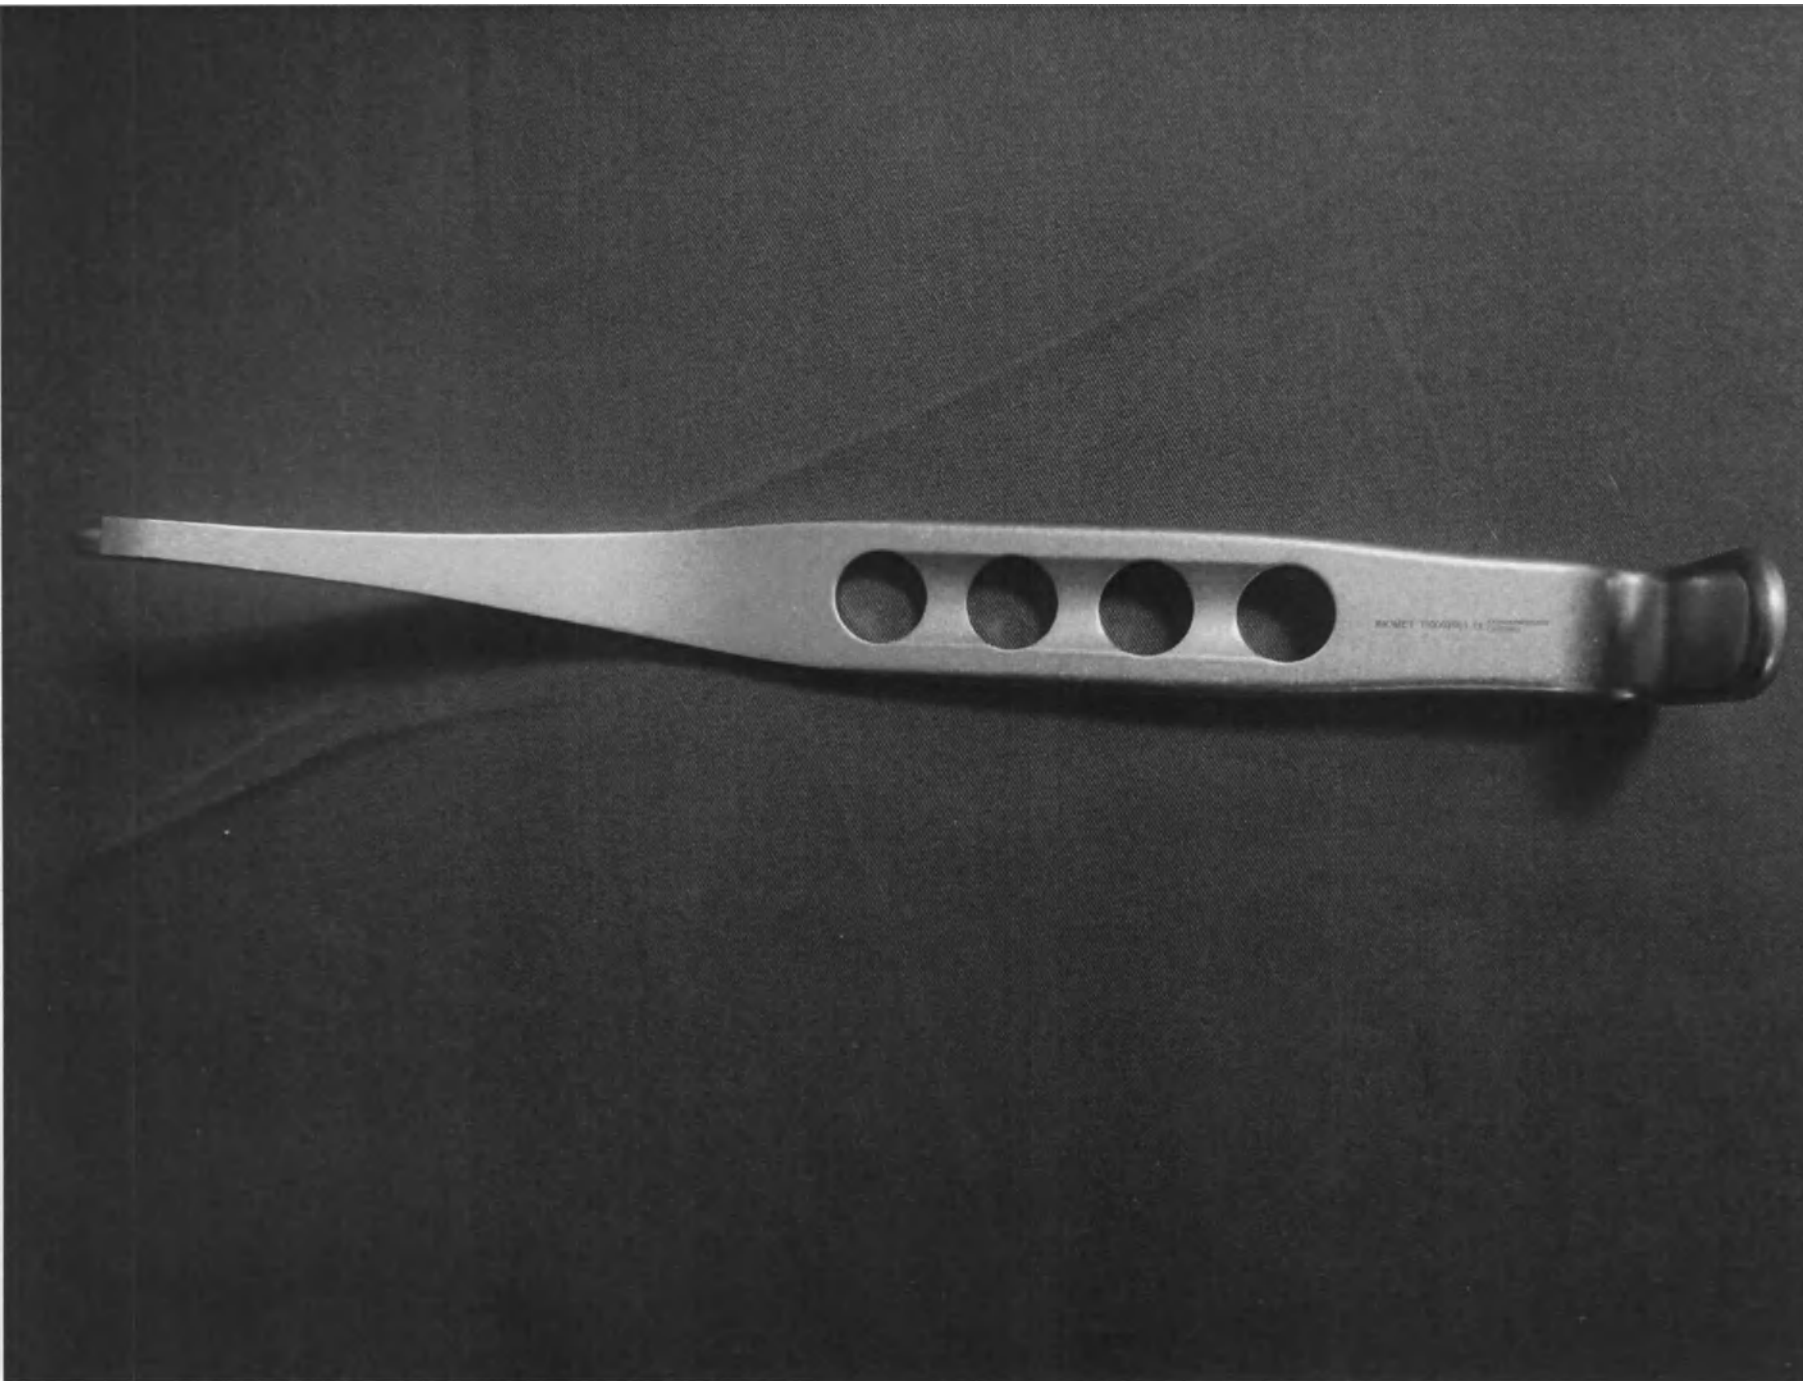

**Рис. 18. Инструмент для удаления вкладыша G7.**

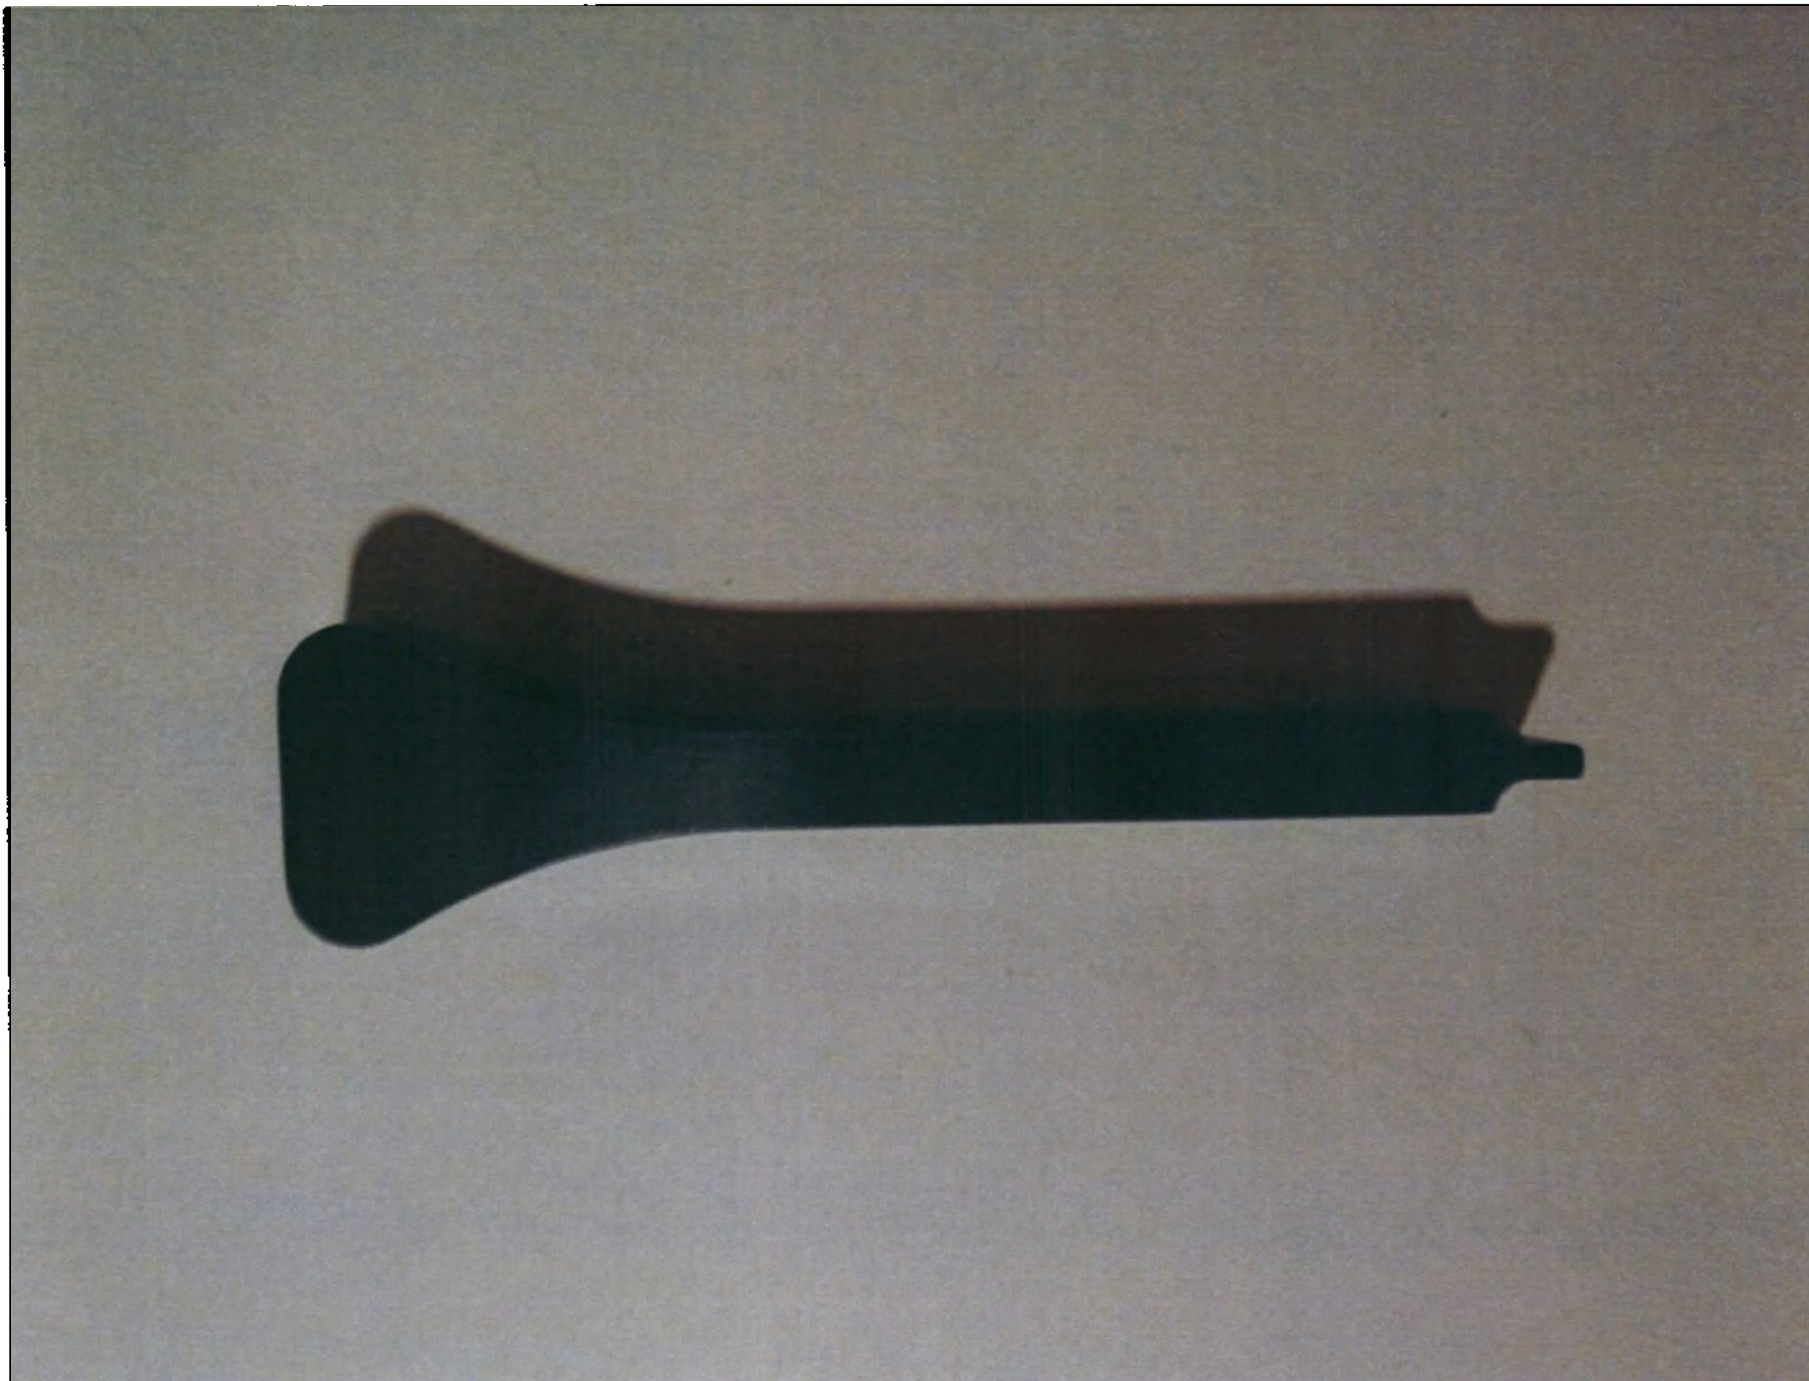

**Рис. 19. Инструмент для удаления заглушки.**

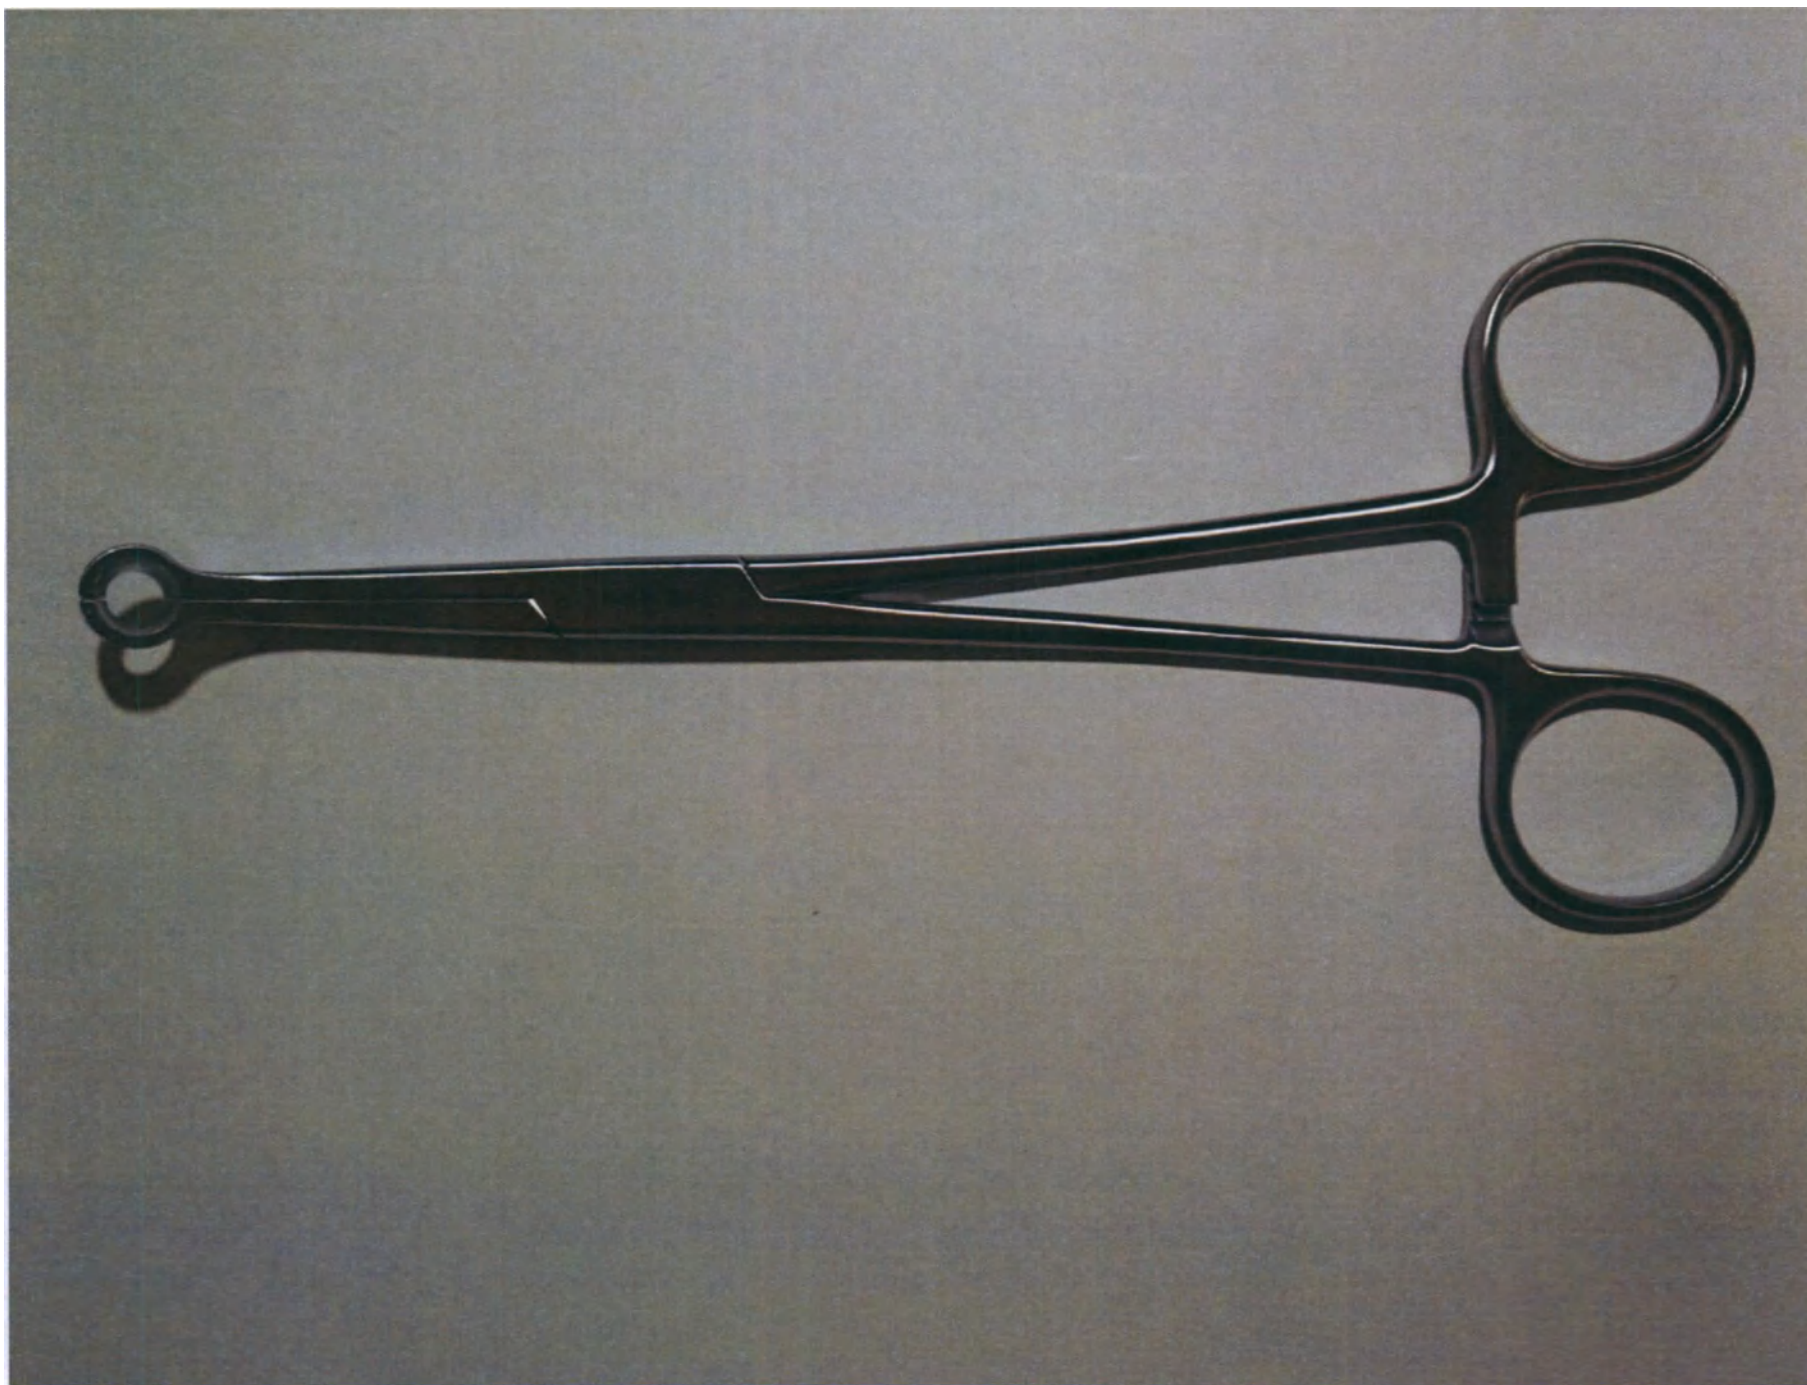

**Рис. 20. Щипцы для винтов.**

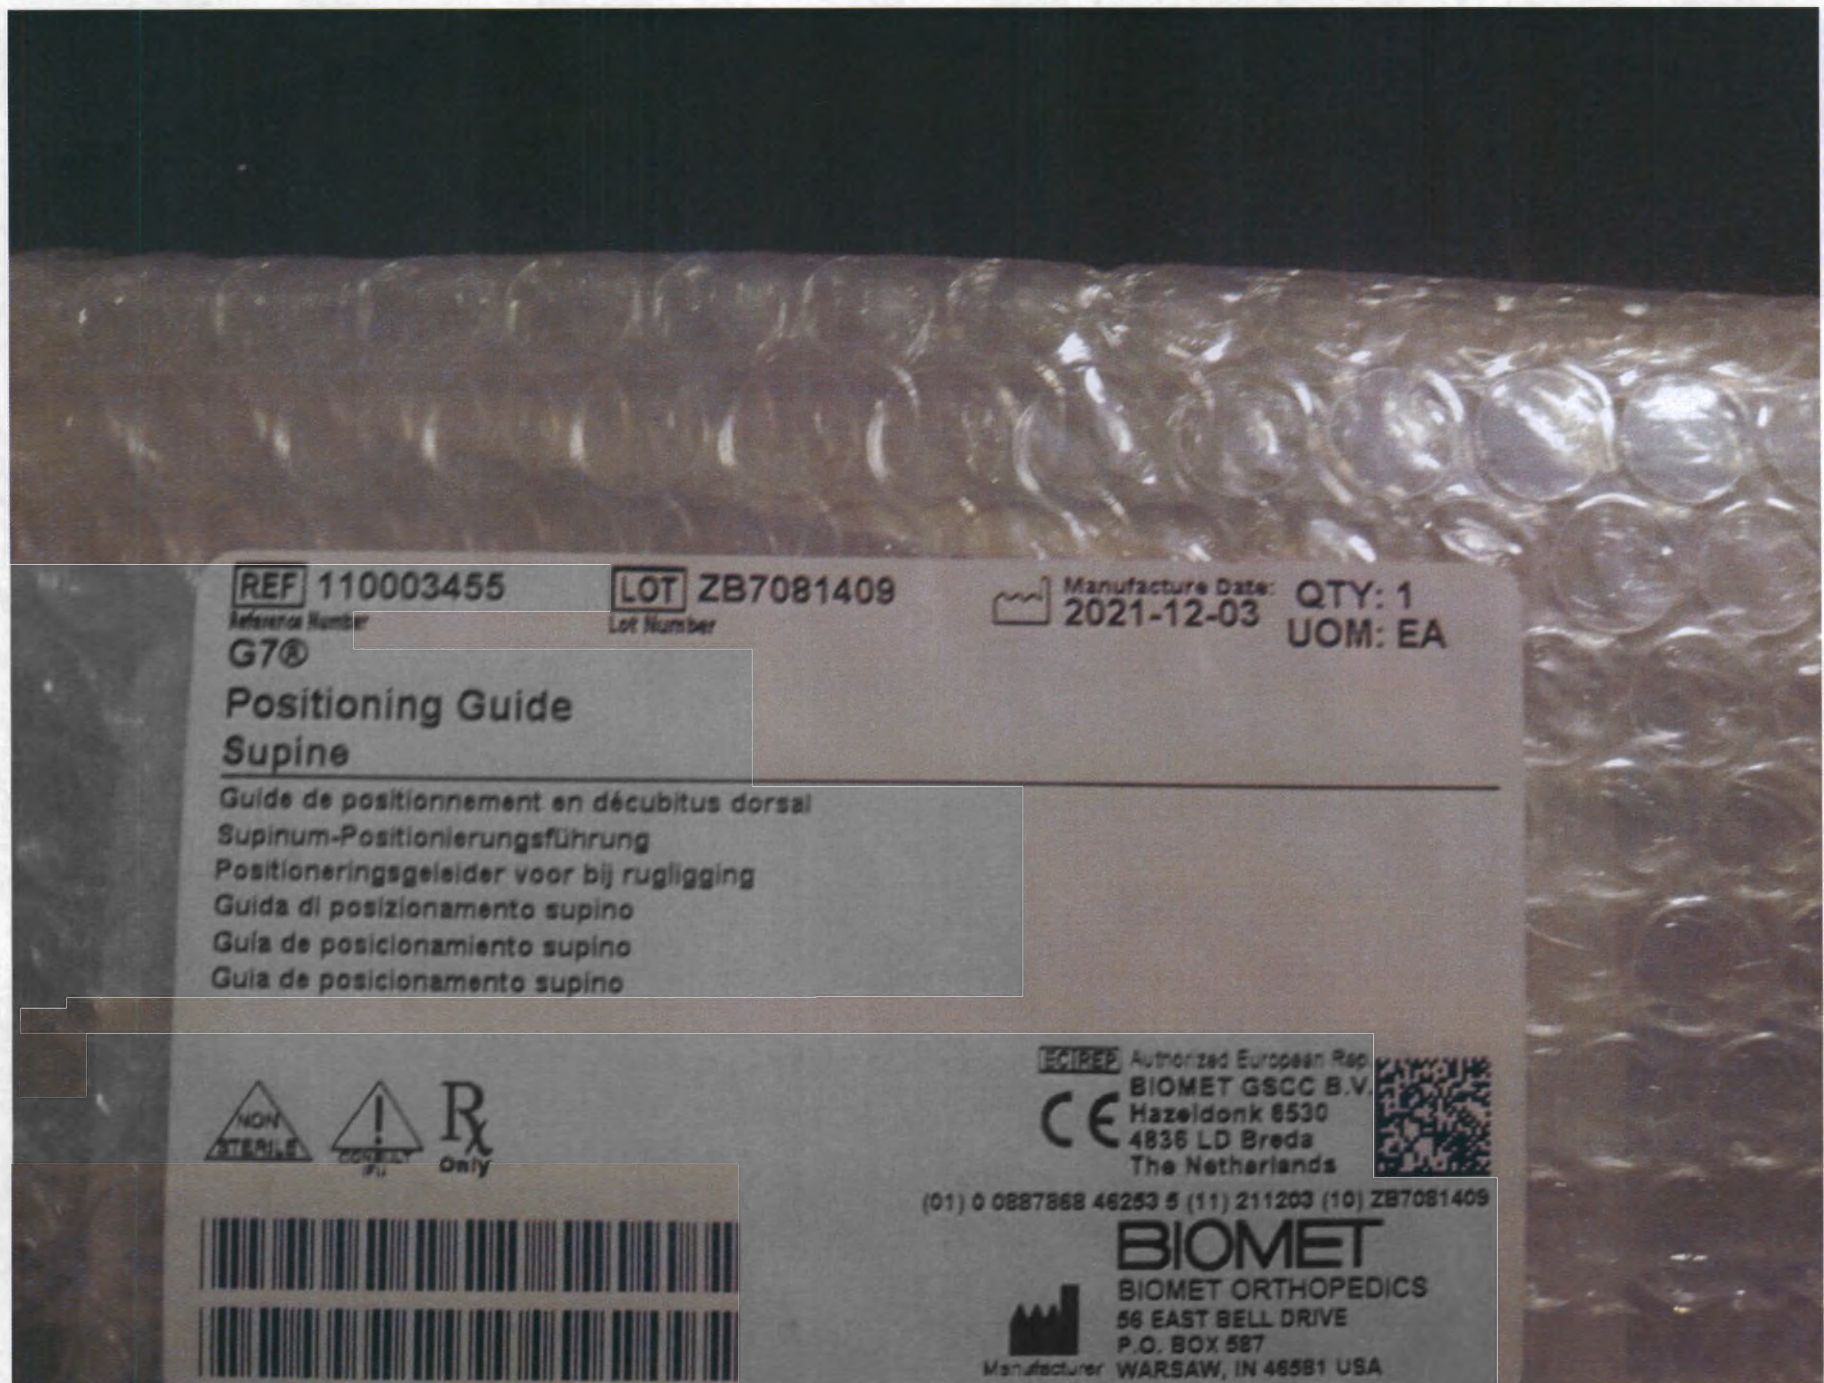


Рис. 21. Пример маркировки потребительской упаковки.

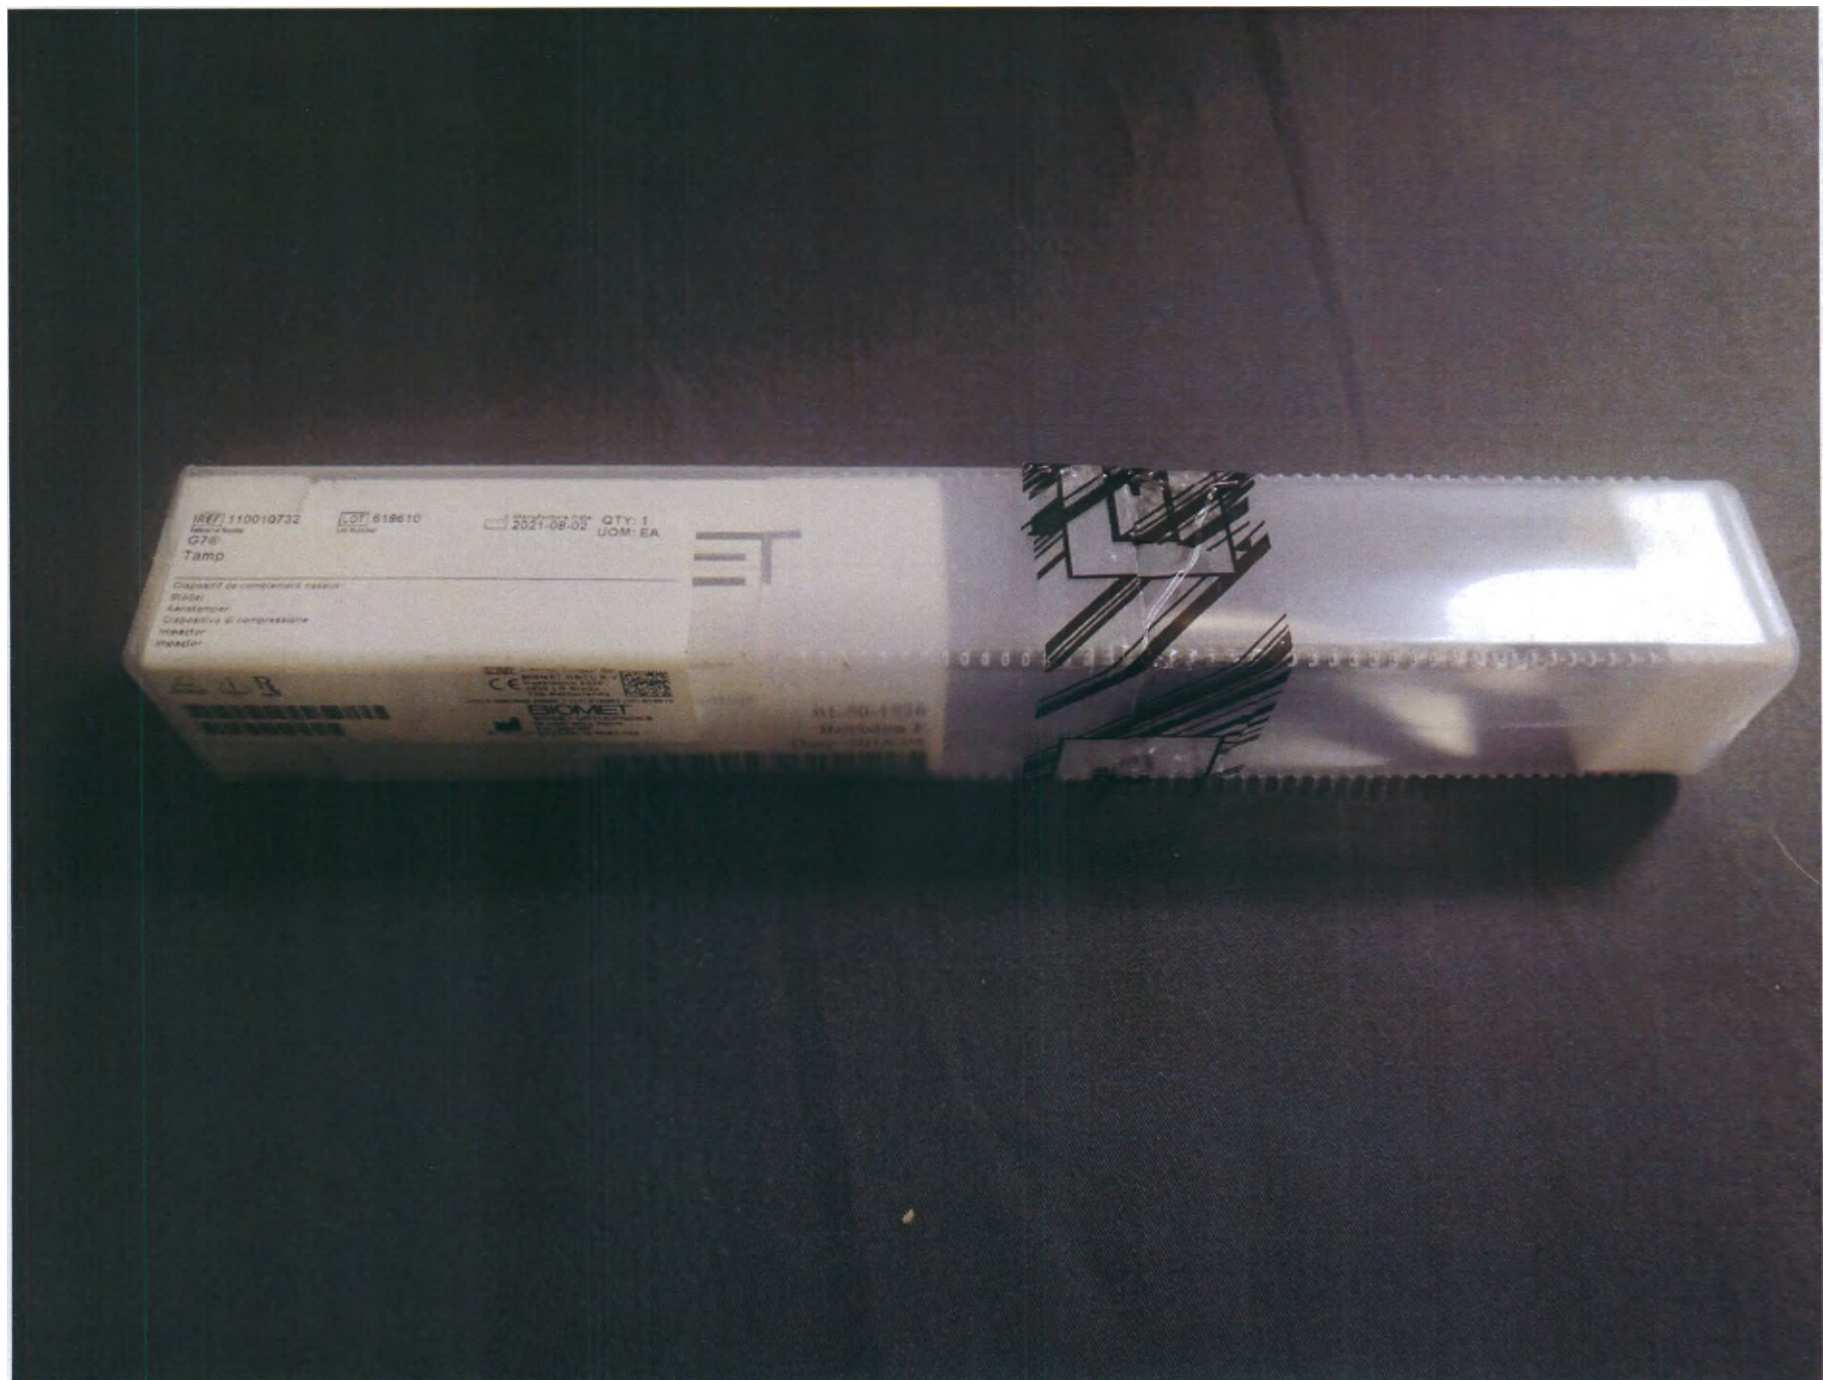


Рис. 22. Пример маркировки потребительской упаковки.

|                                                               |                     |                         |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| <b>Муфта отвертки G7</b>                                      |                     |                         |            |
| <b>Производитель:</b>                                         | «Биомет Ортопедикс» | США                     | XXXXXX     |
| <b>Представитель производителя в РФ:</b>                      | ООО «Зиммер СНГ»    |                         |            |
| 119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15; |                     |                         |            |
| Тел: (495) 980 08 95                                          |                     |                         |            |
| <b>Регистрационное удостоверение №</b>                        | XXX                 | <b>от</b>               | ДД.ММ.ГГГГ |
| <b>Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до:</b>     |                     | см. упаковку            |            |
|                                                               |                     | см. инструкцию          |            |
|                                                               |                     | см. символы на упаковке |            |
| <b>Описание:</b>                                              | Муфта отвертки G7   |                         |            |

Рис. 23. Макет маркировки на русском языке на примере муфты отвёртки G7.

|                                                               |                            |                                |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Глубиномер G7</b>                                          |                            |                                |                      |
| <b>Производитель:</b>                                         | <b>«Биомет Ортопедикс»</b> | <b>США</b>                     | <b>XXXXXX</b>        |
| <b>Представитель производителя в РФ:</b>                      |                            | <b>ООО «Зиммер СНГ»</b>        |                      |
| 119048, Москва, улица Усачева, дом 29, корп. 9, помещение 15; |                            |                                |                      |
| Тел: (495) 980 08 95                                          |                            |                                |                      |
| <b>Регистрационное удостоверение №</b>                        |                            | <b>XXX</b>                     | <b>от ЧЧ.ММ.ГГГГ</b> |
| <b>Дата изготовления / Назначение / Серия / Годен до:</b>     |                            | <b>см. упаковку</b>            |                      |
| <b>Н</b>                                                      |                            | <b>см. инструкцию</b>          |                      |
|                                                               |                            | <b>см. символы на упаковке</b> |                      |
| <b>Описание:</b>                                              | <b>Глубиномер G7</b>       |                                |                      |

Рис. 24. Макет маркировки на русском языке для вариантов исполнения из нержавеющей стали на примере глубиномера G7

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 25 листа (ов)

Руководитель отдела регистрации и  
качества Камнева А.И.

