

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Включая МАРКИРОВКУ
медицинского изделия

**Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями,
варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160**


1. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT-3020.
Внешний вид.




2. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT-3020.
Шильдик.



3. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160.
Внешний вид.

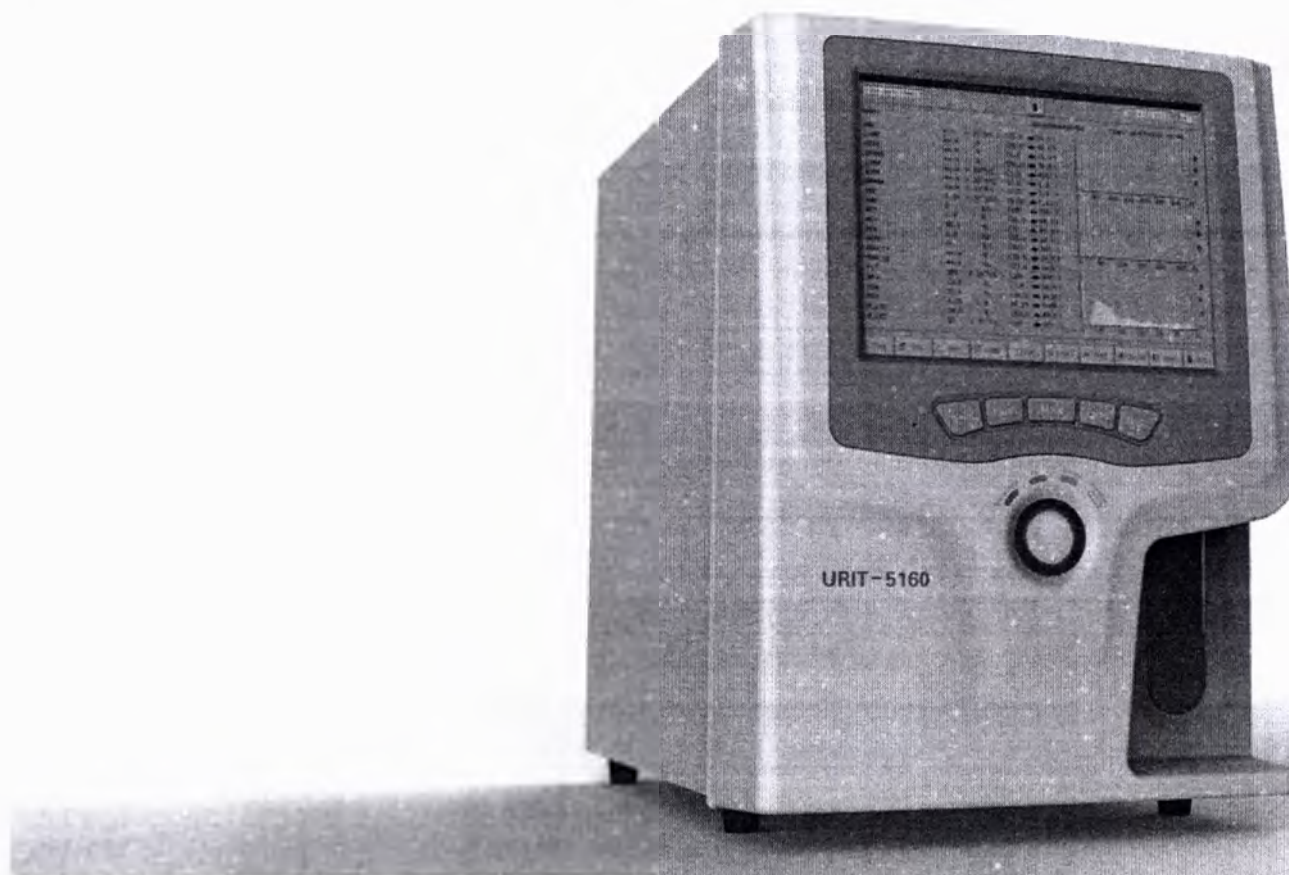

4. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160. Шильдик.

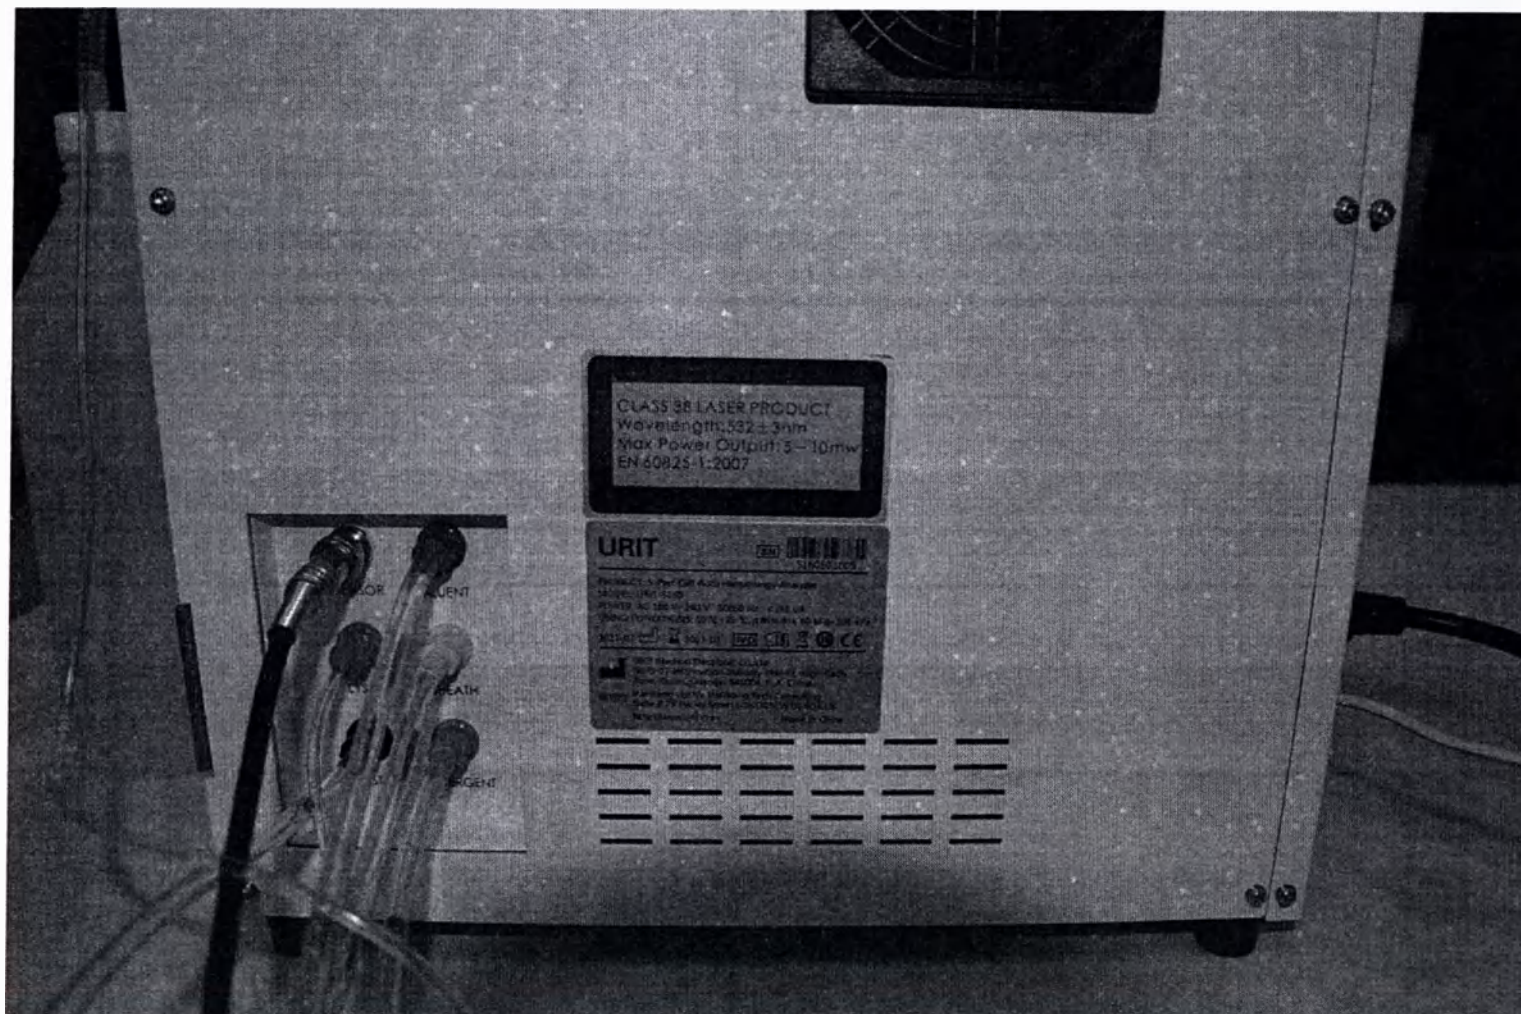

5. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.
Кабель питания для анализатора автоматического гематологического URIT (Power Cord For URIT Auto Hematology Analyzer) – 1 шт.




6. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160.
Кабель питания для анализатора автоматического гематологического URIT (Power Cord For URIT Auto Hematology Analyzer) – 1 шт.



Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020
Кабель питания для анализатора автоматического гематологического URIT Кат.
Использовать до
Серия
Хр. при темп. -10 + + 40 °C
Рег. уд.
Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»
РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а
Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79


Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160
Кабель питания для анализатора автоматического гематологического URIT Кат.
Использовать до
Серия
Хр. при темп. -10 + + 40 °C
Рег. уд.
Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»
РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а
Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

7. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.
Руководство пользователя (Operation Manual) – 1 шт.

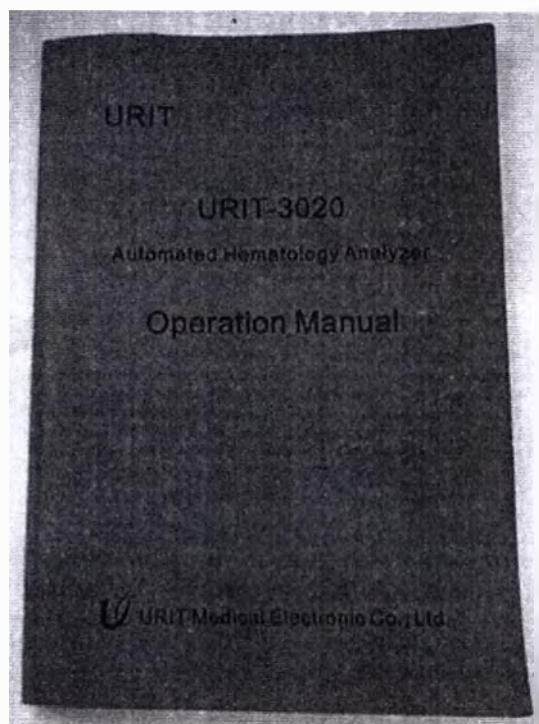

8. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160.

Руководство пользователя (Operation Manual) – 1 шт.

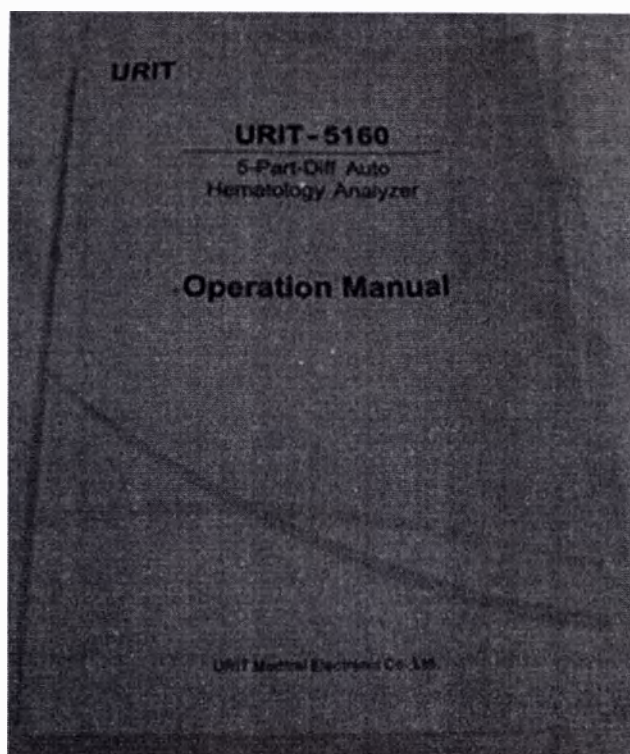

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.

Руководство пользователя (Operation Manual)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160.

Руководство пользователя (Operation Manual)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»


РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

9. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020. Инструкция пошаговая URIT (URIT, Operation Steps) – 1 шт.

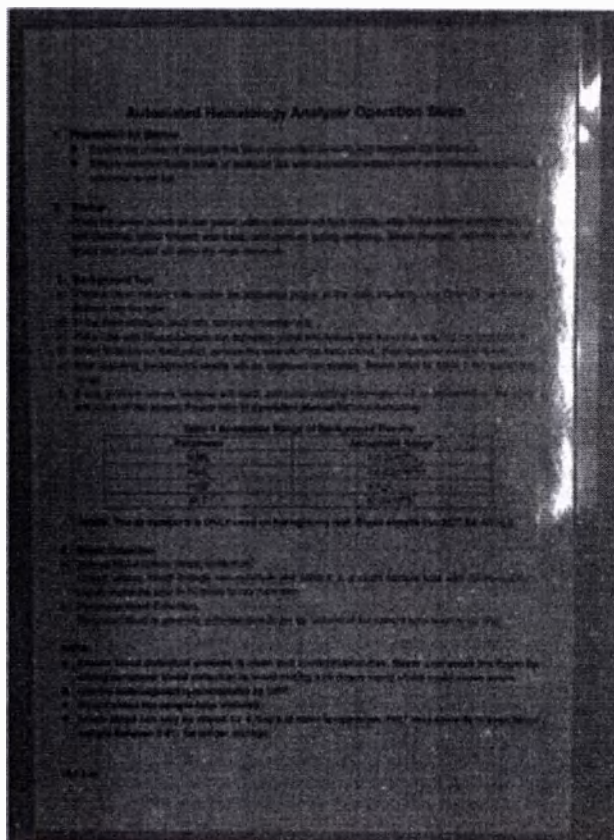

10. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160. Инструкция пошаговая URIT (URIT, Operation Steps) – 1 шт.



Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.

Инструкция пошаговая URIT (URIT, Operation Steps)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd Уполномоченный

представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160.

Инструкция пошаговая URIT (URIT, Operation Steps)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а


Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

11. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Провод заземления (Grounding Wire) – 1 шт.

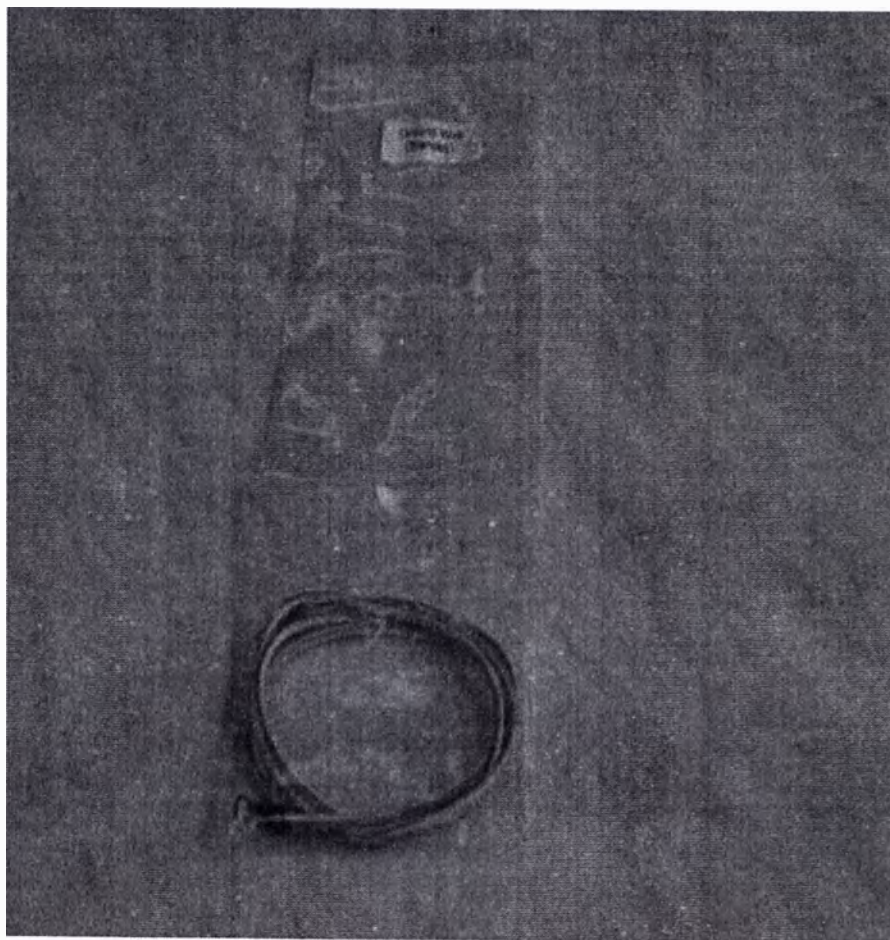


Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160
Провод заземления (Grounding Wire)
Кат.
Использовать до
Серия
Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$
Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»
РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а
Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

12. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020.
Кабель последовательного порта (Serial Port Line) – 1 шт.

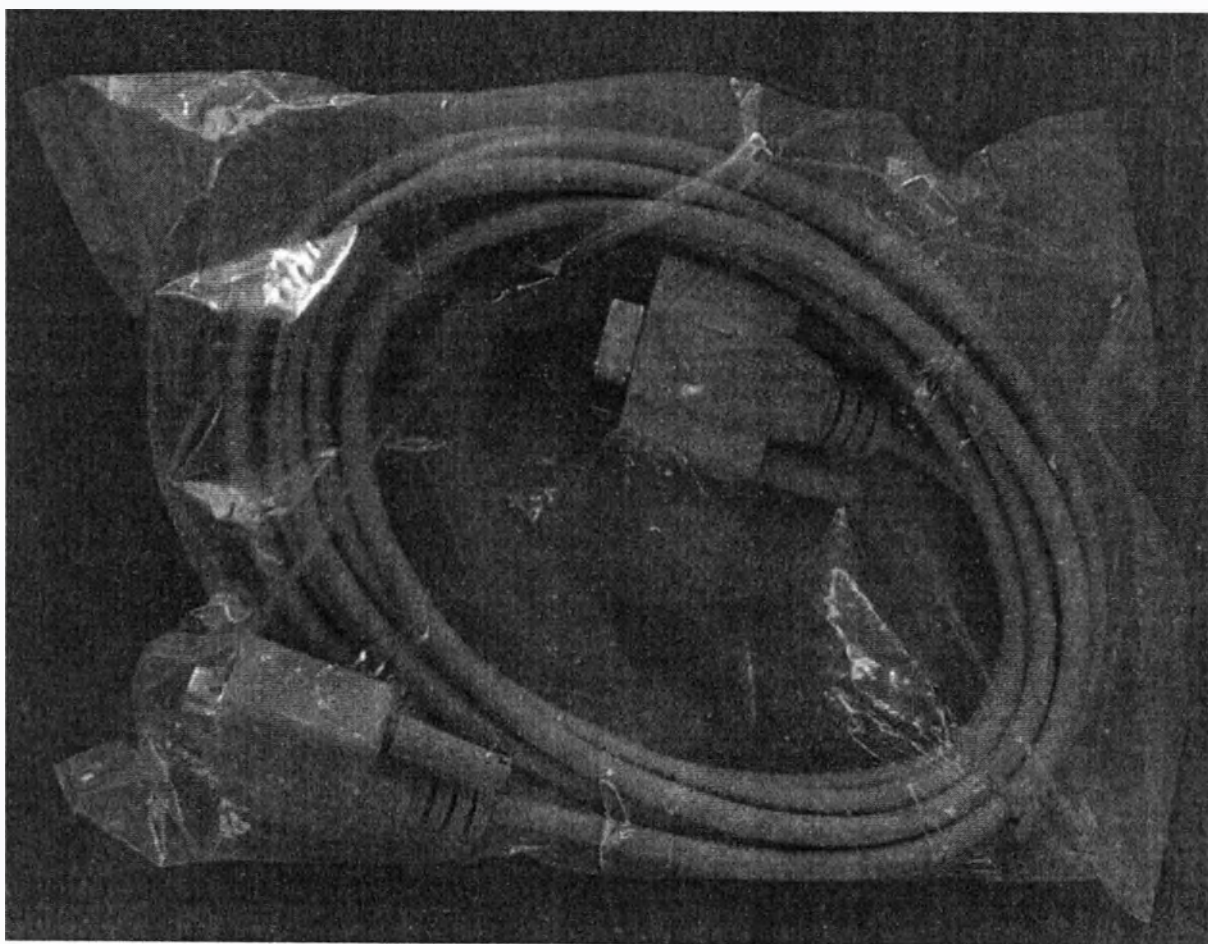

13. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 5160.
Кабель последовательного порта (Serial Port Line) – 1 шт.

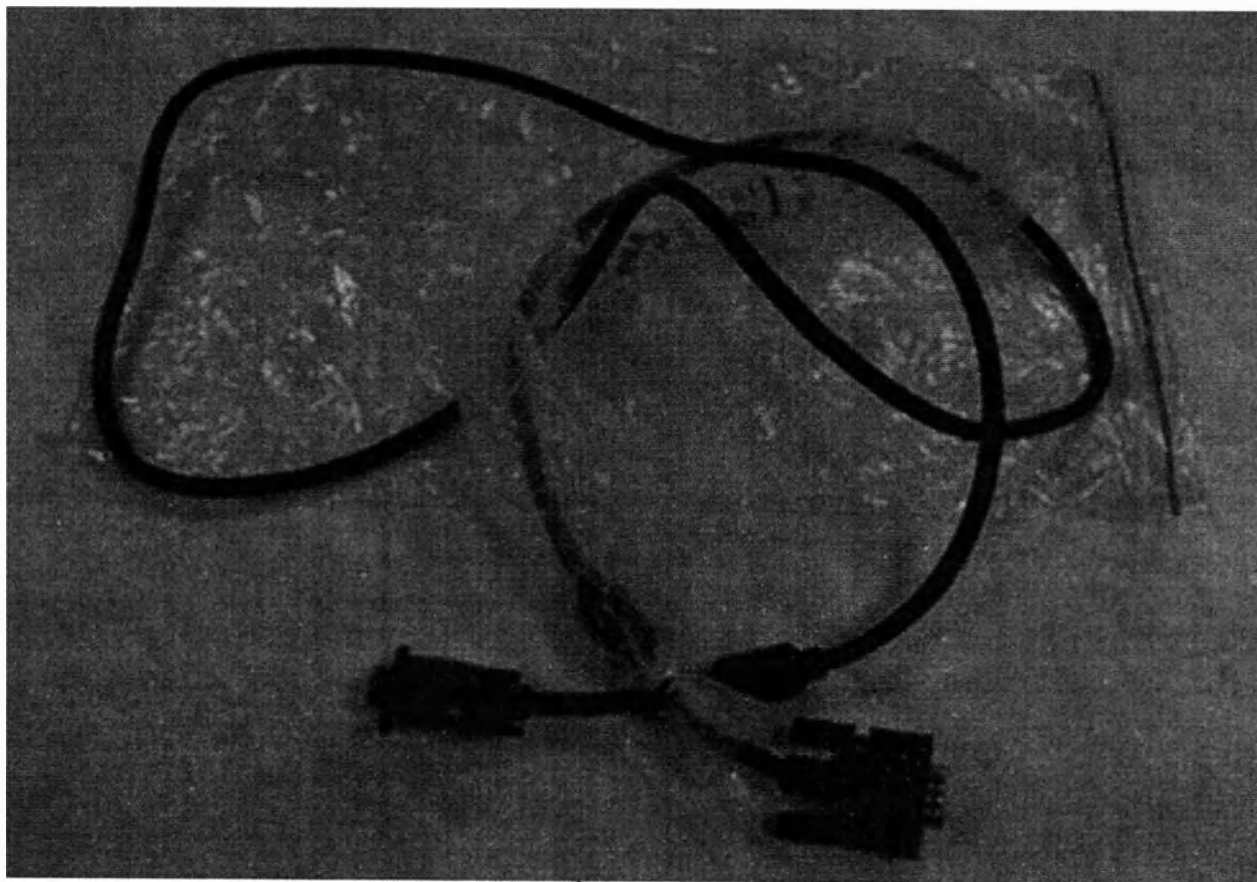

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.

Кабель последовательного порта (Serial Port Line)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. -10 + + 40 °C

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160.

Кабель последовательного порта (Serial Port Line)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. -10 + + 40 °C


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

14. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Предохранители 15A (Fuse T3.15AL 250V) – 2 шт.

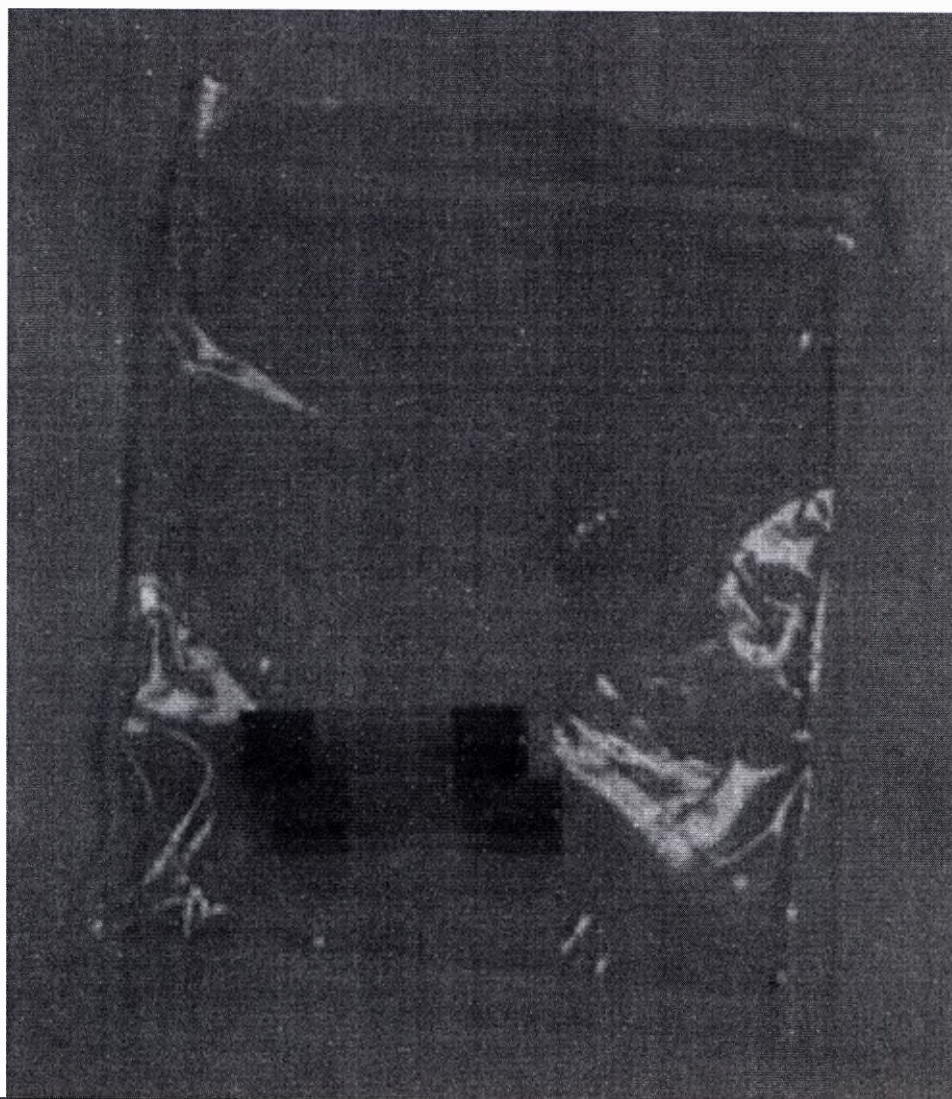

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Предохранители 15A (Fuse T3.15AL 250V)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. -10 + + 40 °C


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39. Факс: +7 495-980-66-79

15. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Трубка для подачи разбавителя с крышкой (Diluent Inlet Tube With Cap) – 1 шт.

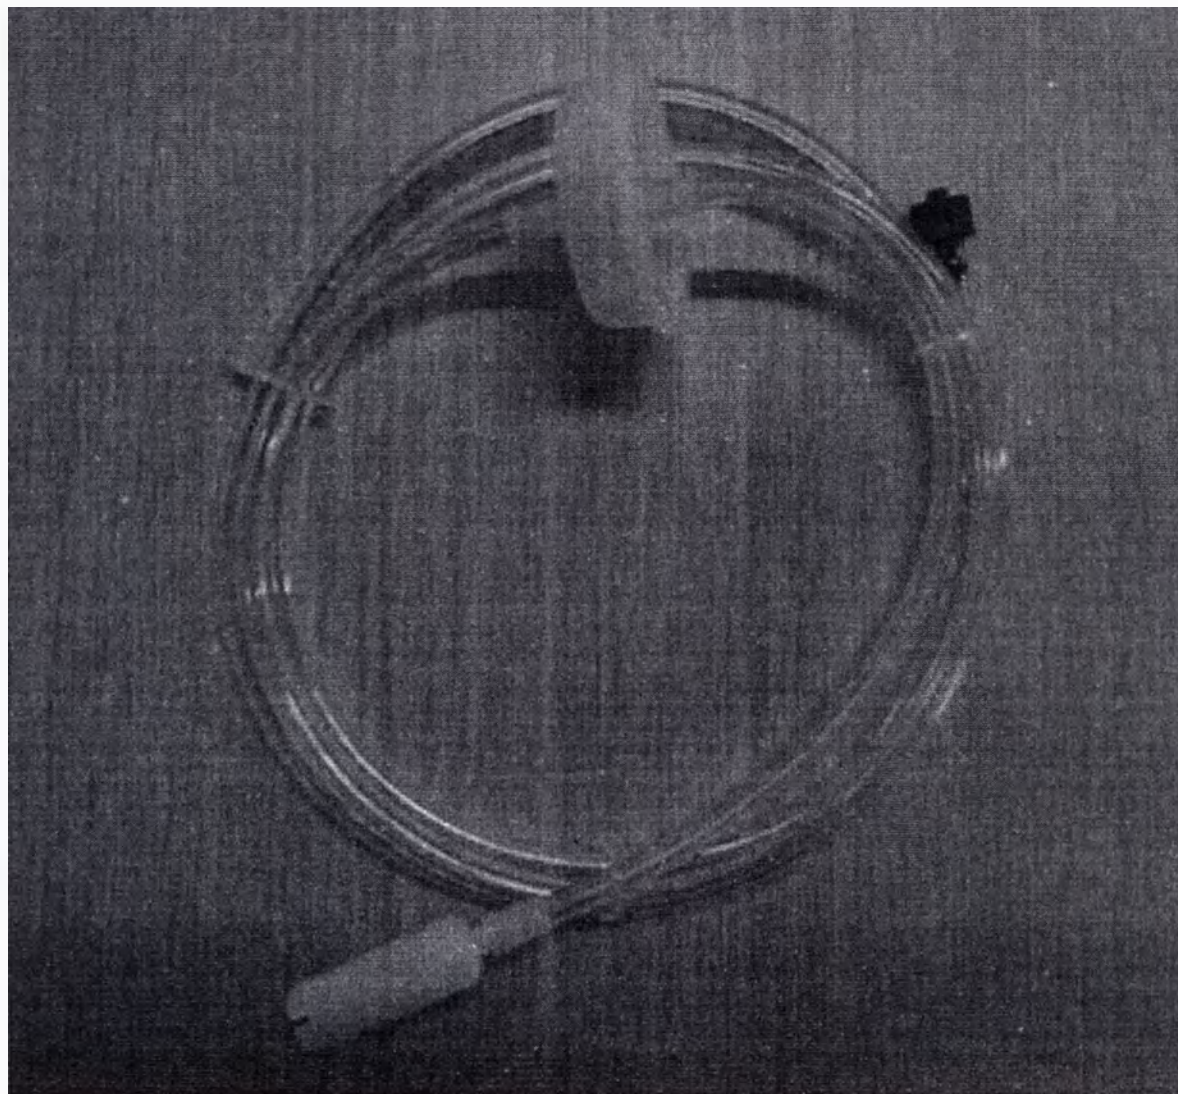

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.

Трубка для подачи разбавителя с крышкой (Diluent Inlet Tube With Cap)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39. Факс: +7 495-980-66-79

16. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Трубка для подачи гемолизирующего раствора с крышкой (Lyse Inlet Tube With Cap) – 1 шт.

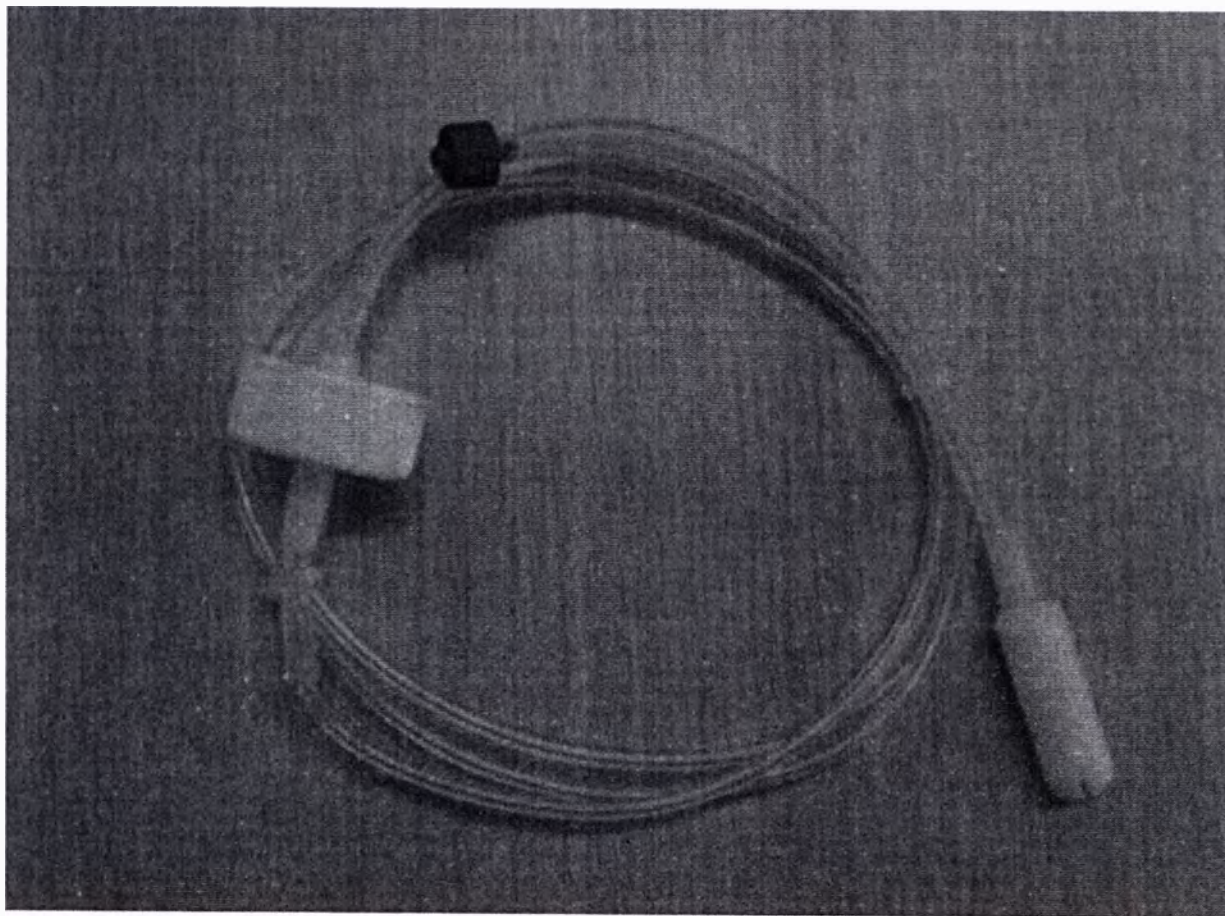

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Трубка для подачи гемолизирующего раствора с крышкой (Lyse Inlet Tube With Cap)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. -10 + + 40 °C


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

17. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Трубка для подачи детергента с крышкой (Detergent Inlet Tube With Cap) – 1 шт.

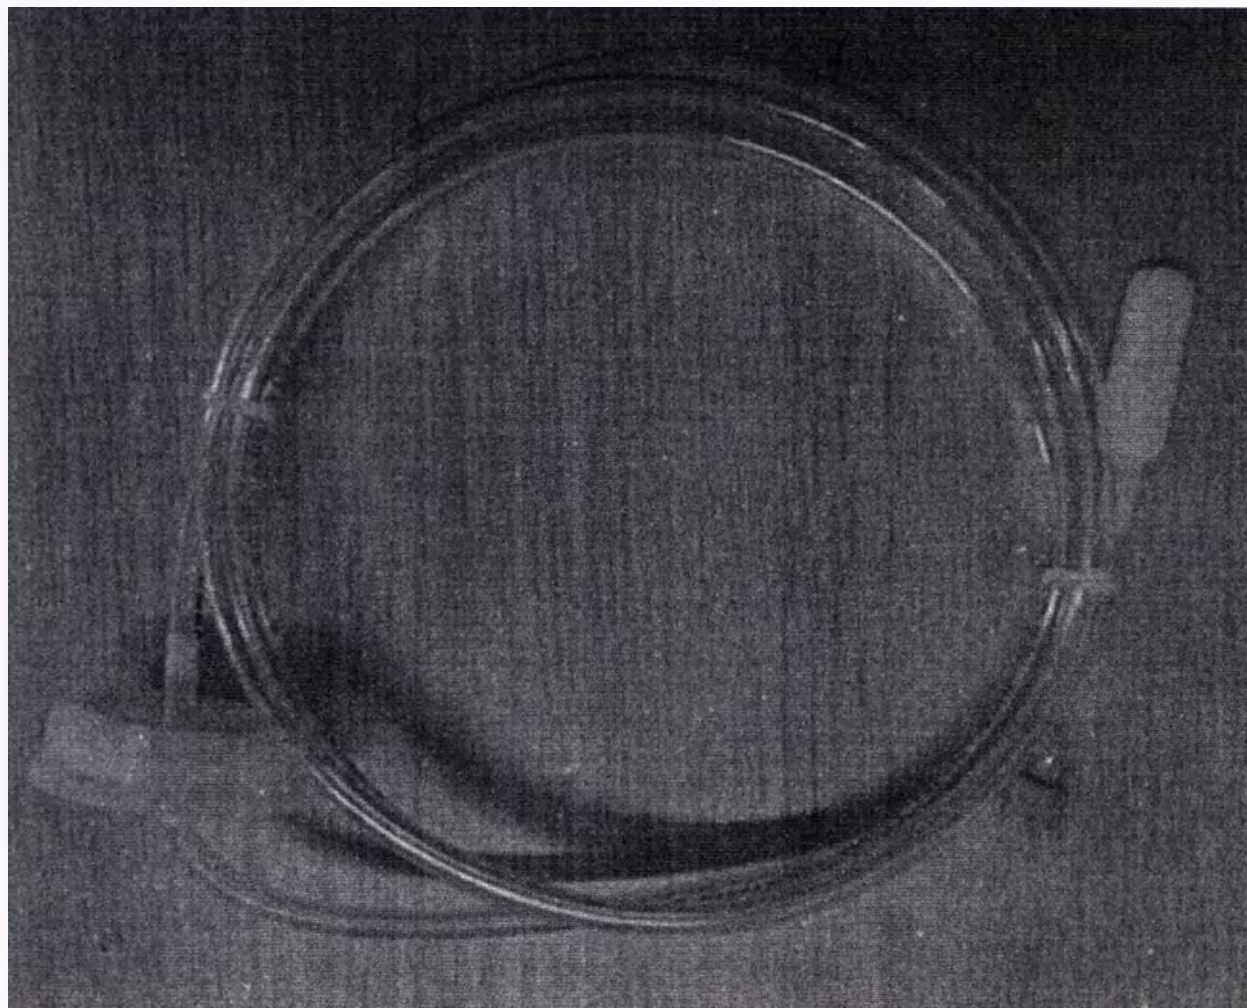

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Трубка для подачи детергента с крышкой (Detergent Inlet Tube With Cap)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

18. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Трубка слива отходов с датчиком уровня (Waste Outlet Tubing With Cap and Sensor Cable) – 1 шт.

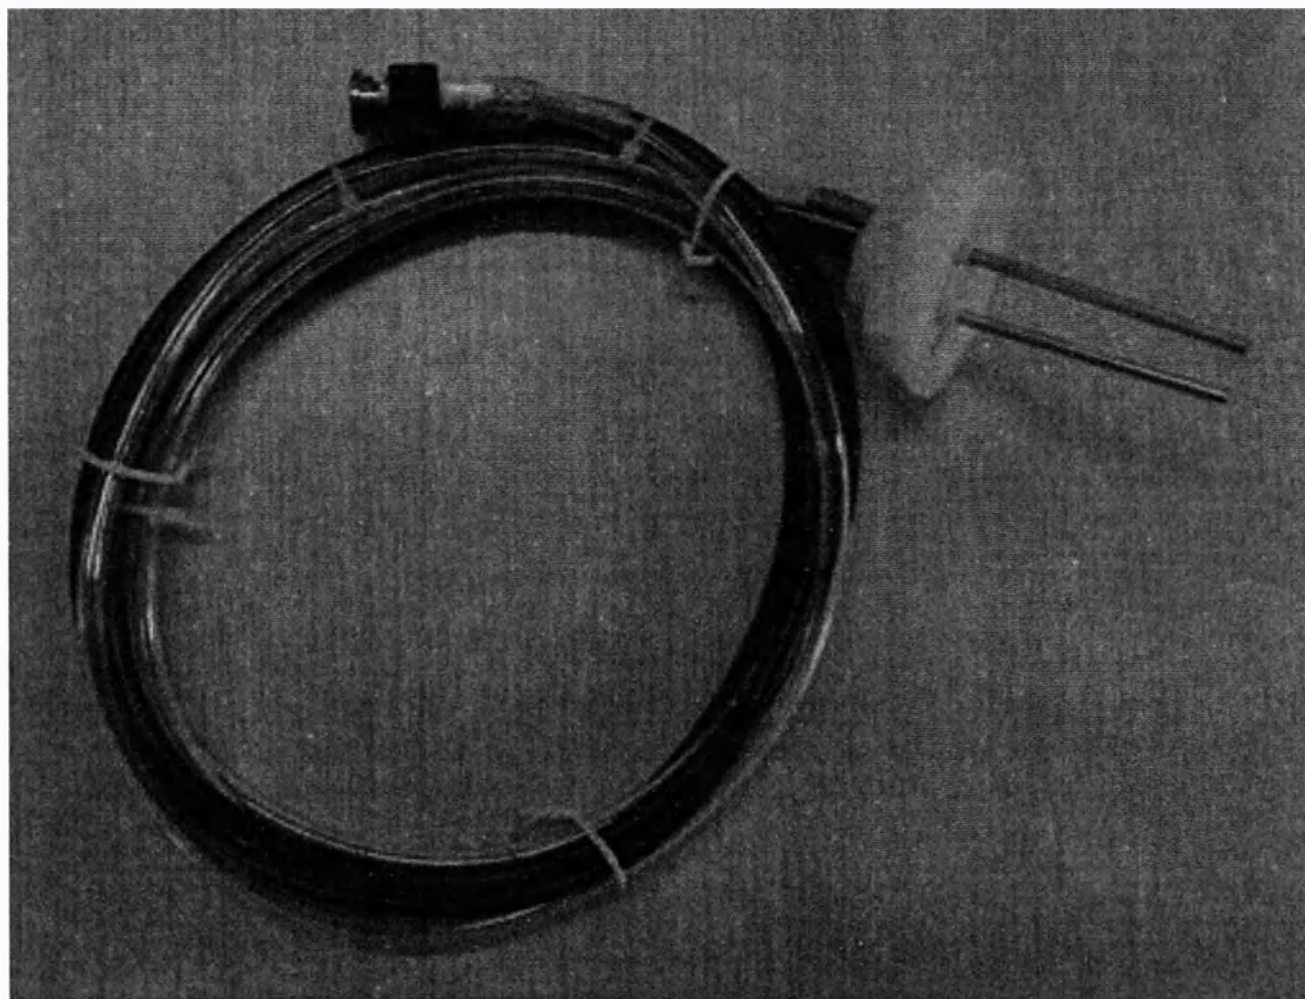

Анализатор автоматический гематологический URIT, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160, с принадлежностями
Трубка слива отходов с датчиком уровня (Waste Outlet Tubing With Cap and Sensor Cable)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

19. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Детергент для пробоотборника (100 мл) (Probe Cleaner (100mL)) – 1 флакон.

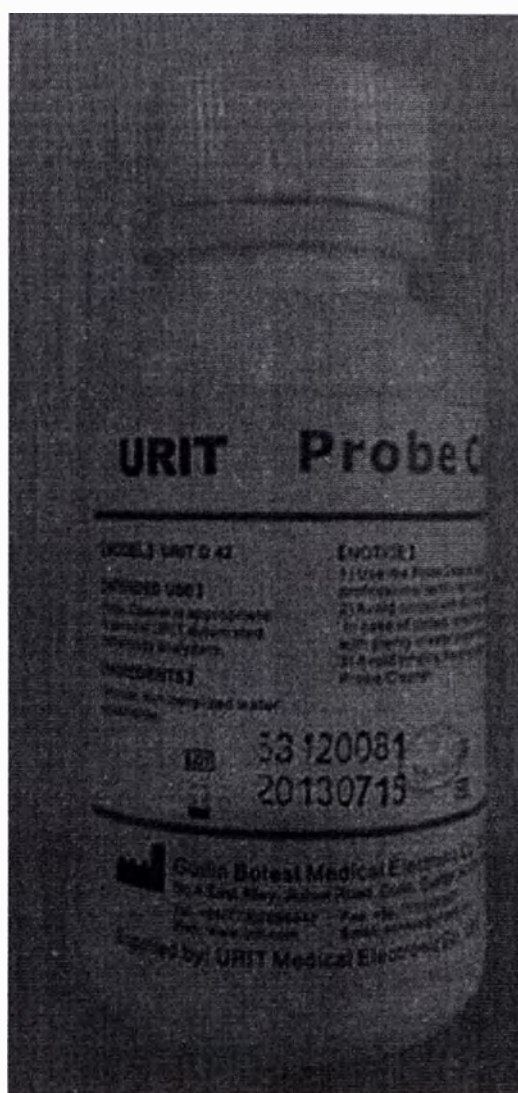

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Детергент для пробоотборника (100 мл) (Probe Cleaner (100mL))

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. -10 + + 40 °C


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

20. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Смазка (Grease) – 1 шт.

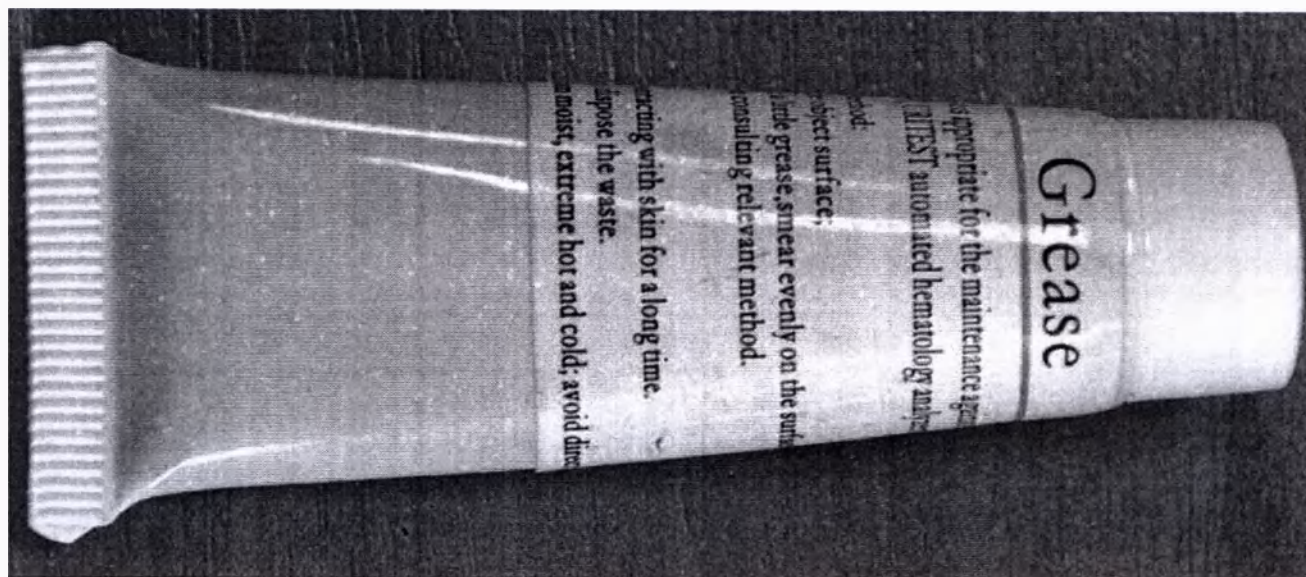

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.

Смазка (Grease)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 \div +40^{\circ}\text{C}$

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

21. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Фильтр (Filter) – 2 шт.

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Фильтр (Filter)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. -10 + + 40 °C

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd


Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

22. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.

Кольцо уплотнительное для шприца дозирования гемолизирующего раствора (малое) (Lyse Syringe Seal Ring (small)) – 1 шт.

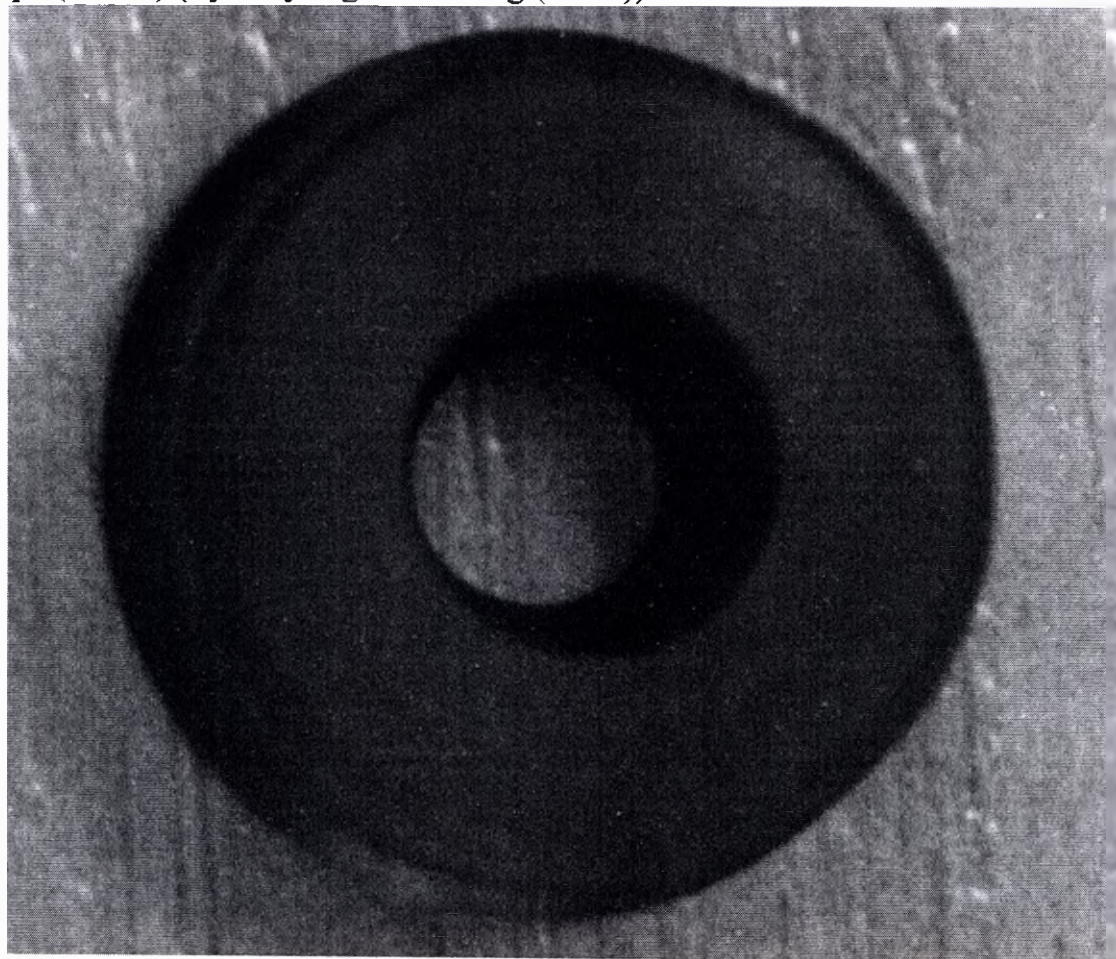

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Кольцо уплотнительное для шприца дозирования гемолизирующего раствора (малое) (Lyse Syringe Seal Ring (small))

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. -10 + + 40 °C


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а


Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

23. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Кольцо уплотнительное для шприца дозирования разбавителя (большое) (Diluent Syringe Seal Ring (big)) – 1 шт.

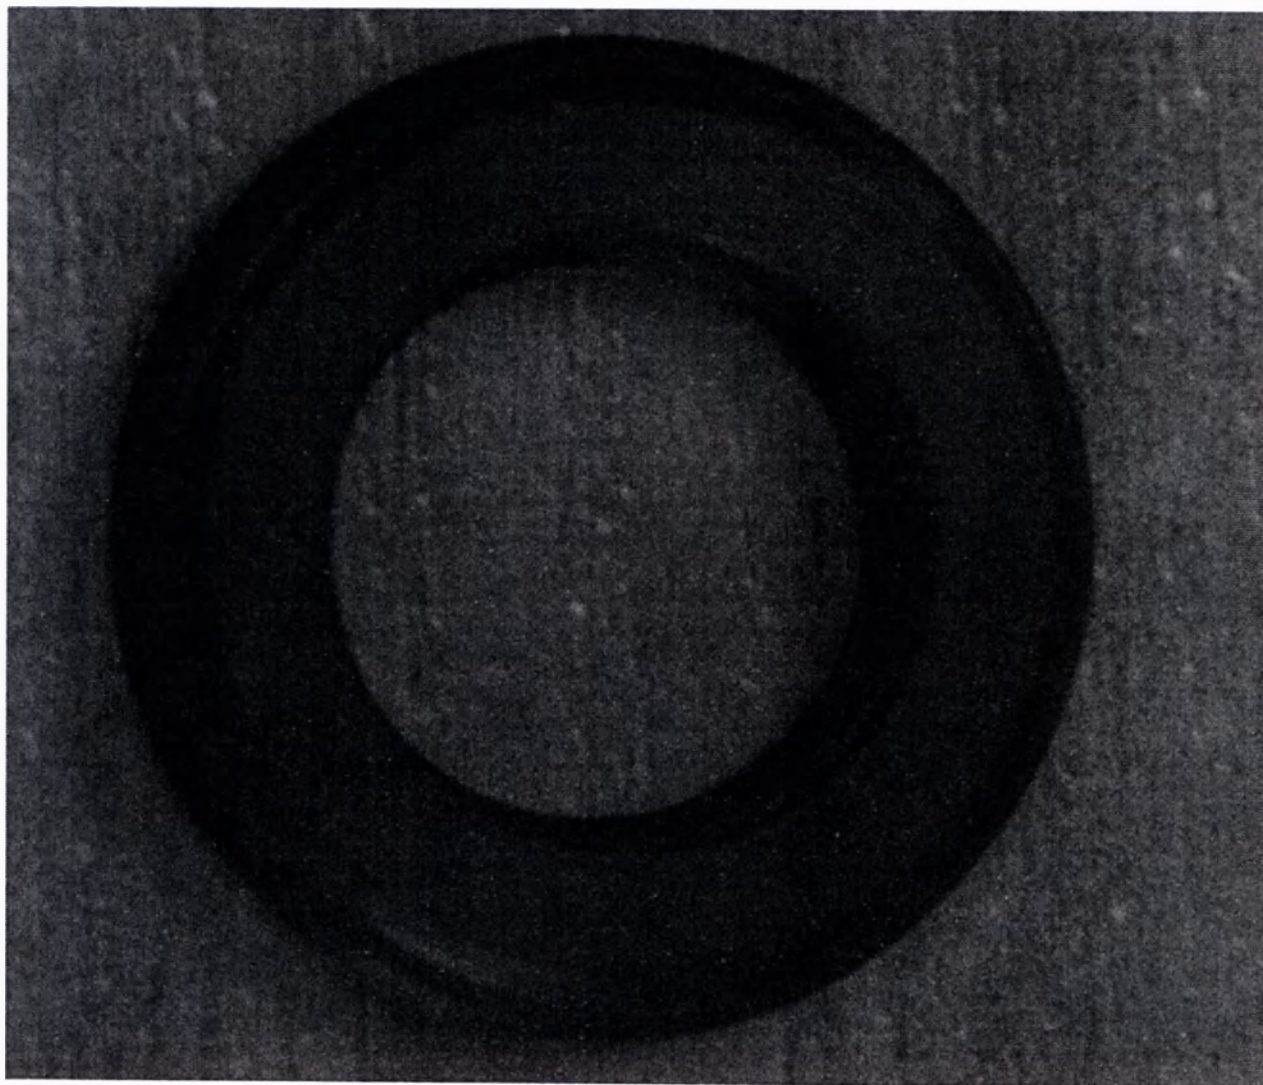

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Кольцо уплотнительное для шприца дозирования разбавителя (большое) (Diluent Syringe Seal Ring (big)) Кат.
Использовать до
Серия
Хранить при темп. $-10 \pm + 40^{\circ}\text{C}$
Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»
РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а
Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

24. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Пробирка пластиковая одноразовая (200 шт.) (Disposable Plastic Test Tube) – 1 уп.

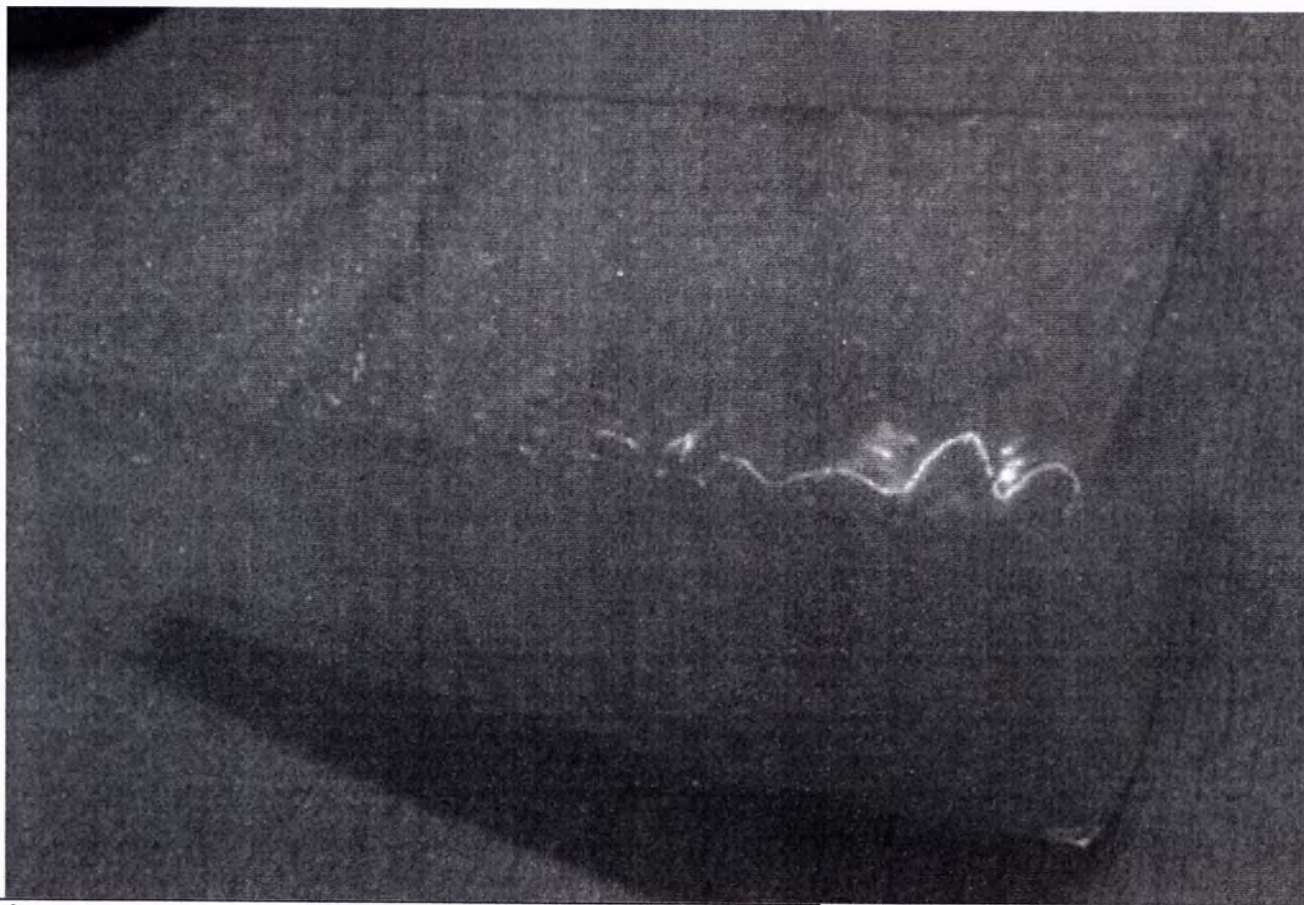

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, варианты исполнения URIT 3020, URIT 5160.
Пробирка пластиковая одноразовая (200 шт.) (Disposable Plastic Test Tube)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. -10 + + 40 °C


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

25. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.
Клавиатура (Keyboard) – 1 шт.

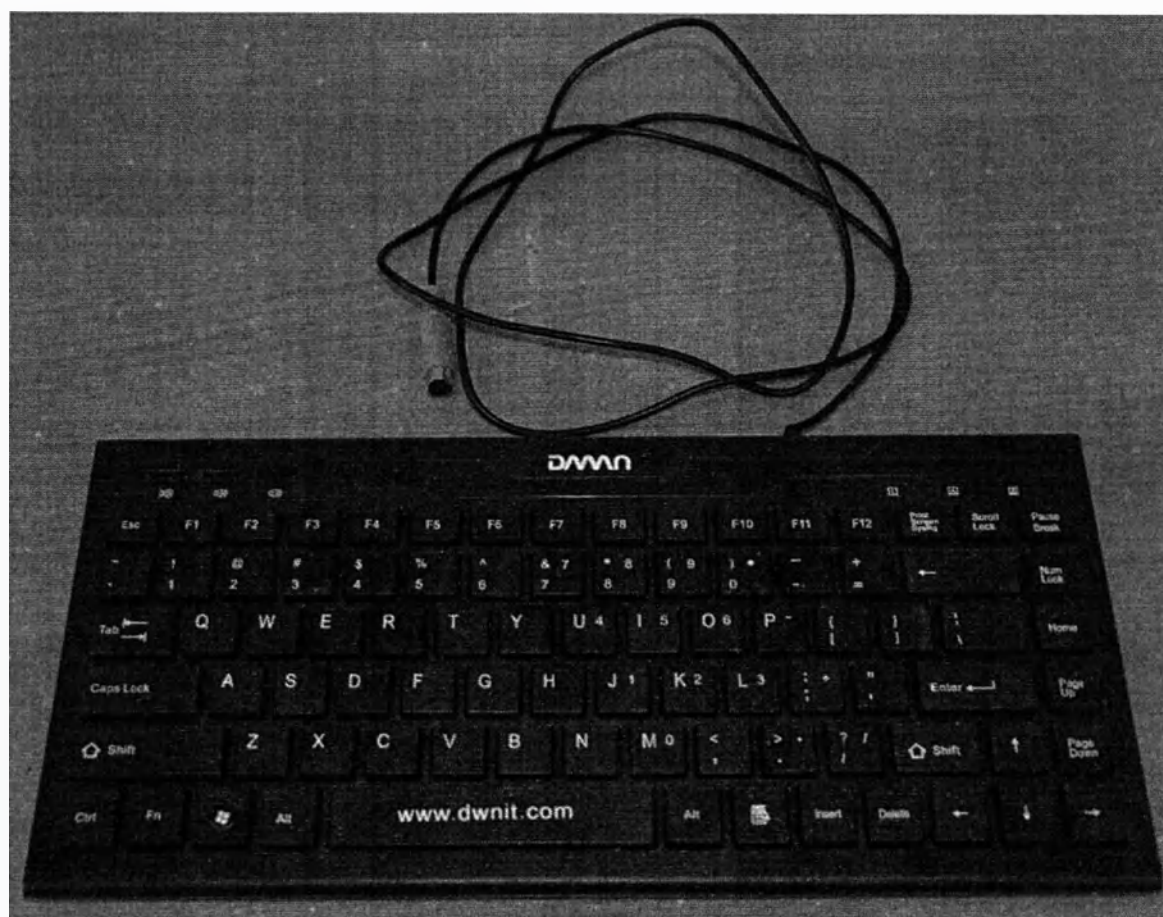

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.
Клавиатура (Keyboard)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. -10 + + 40 °C

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

26. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.

Компьютерная мышь (Computer Mouse) – 1 шт.



Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020

Компьютерная мышь (Computer Mouse)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

27. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.
Груша для всасывания (Suction Bulb) – 1 шт.

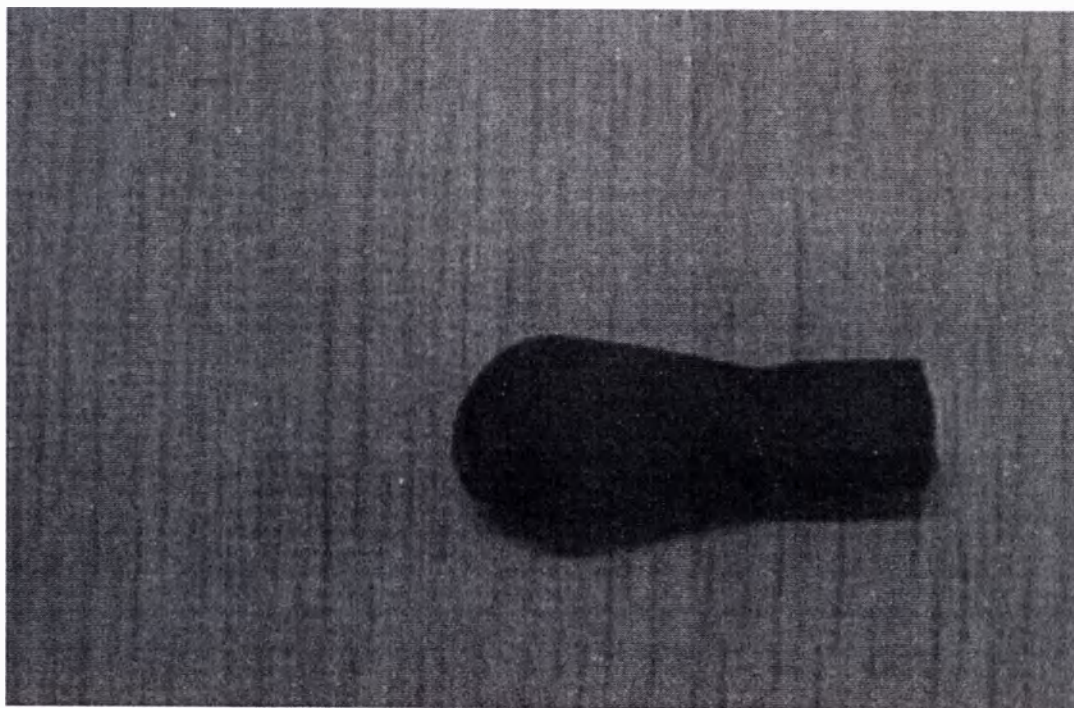

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями,
вариант исполнения URIT 3020

Груша для всасывания (Suction Bulb)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd


Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

28. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160.

Трубка для подачи фокусирующего раствора (Sheath Inlet Tubing) – 1 шт.

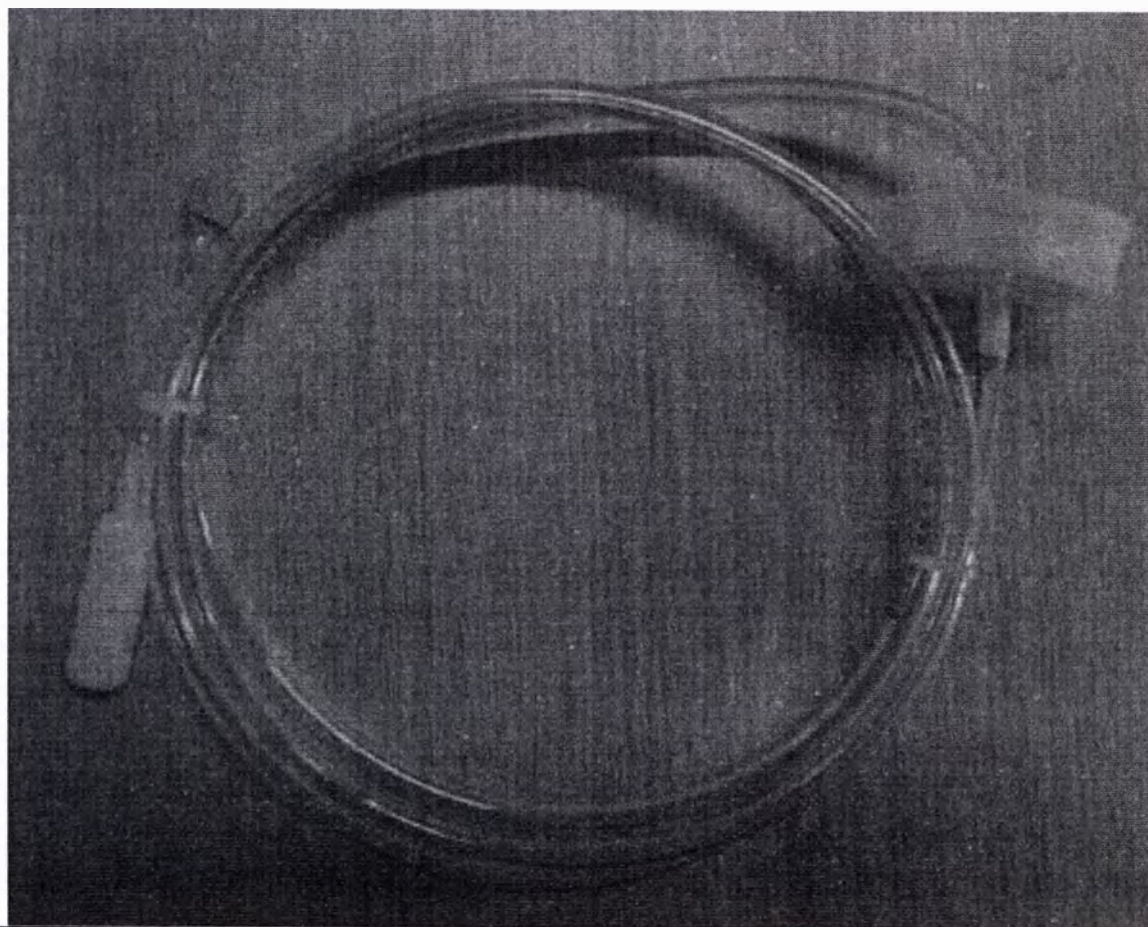

Анализатор автоматический гематологический URIT, вариант исполнения URIT 5160, с принадлежностями
Трубка для подачи фокусирующего раствора (Sheath Inlet Tubing)
Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd Уполномоченный

представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

29. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.
Канистра для отходов (Waste Container) – 1 шт.

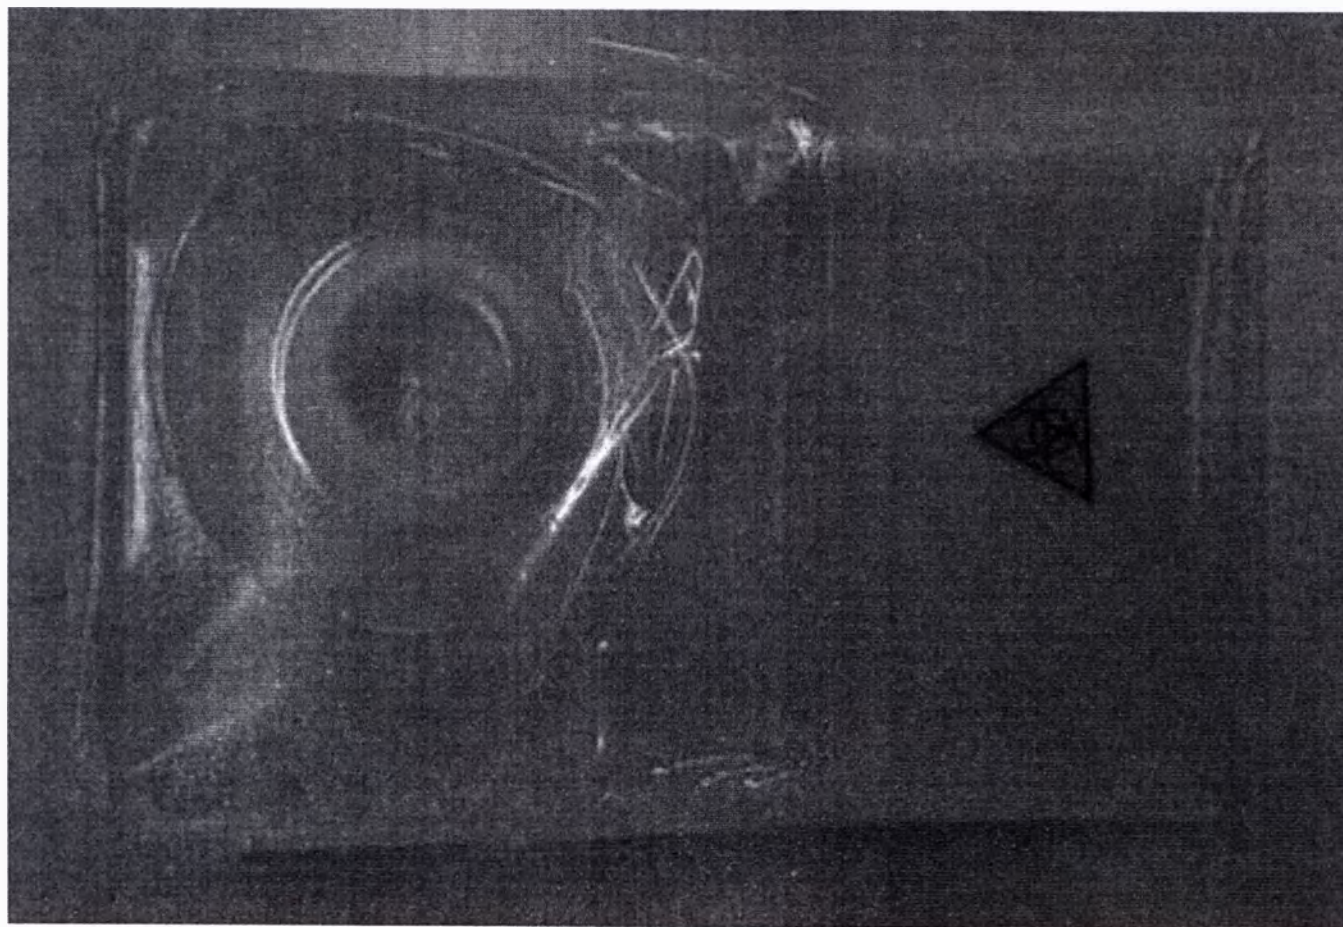

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020
Канистра для отходов (Waste Container)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39. Факс: +7 495-980-66-79

30. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.

Бумага для термопринтера (Thermal Recorder Paper) – 2 рулона.



Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020

Бумага для термопринтера (Thermal Recorder Paper)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd


Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

31. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.

Крышка к 20 л канистре разбавителя (20 L Diluent Cap) – 1 шт.

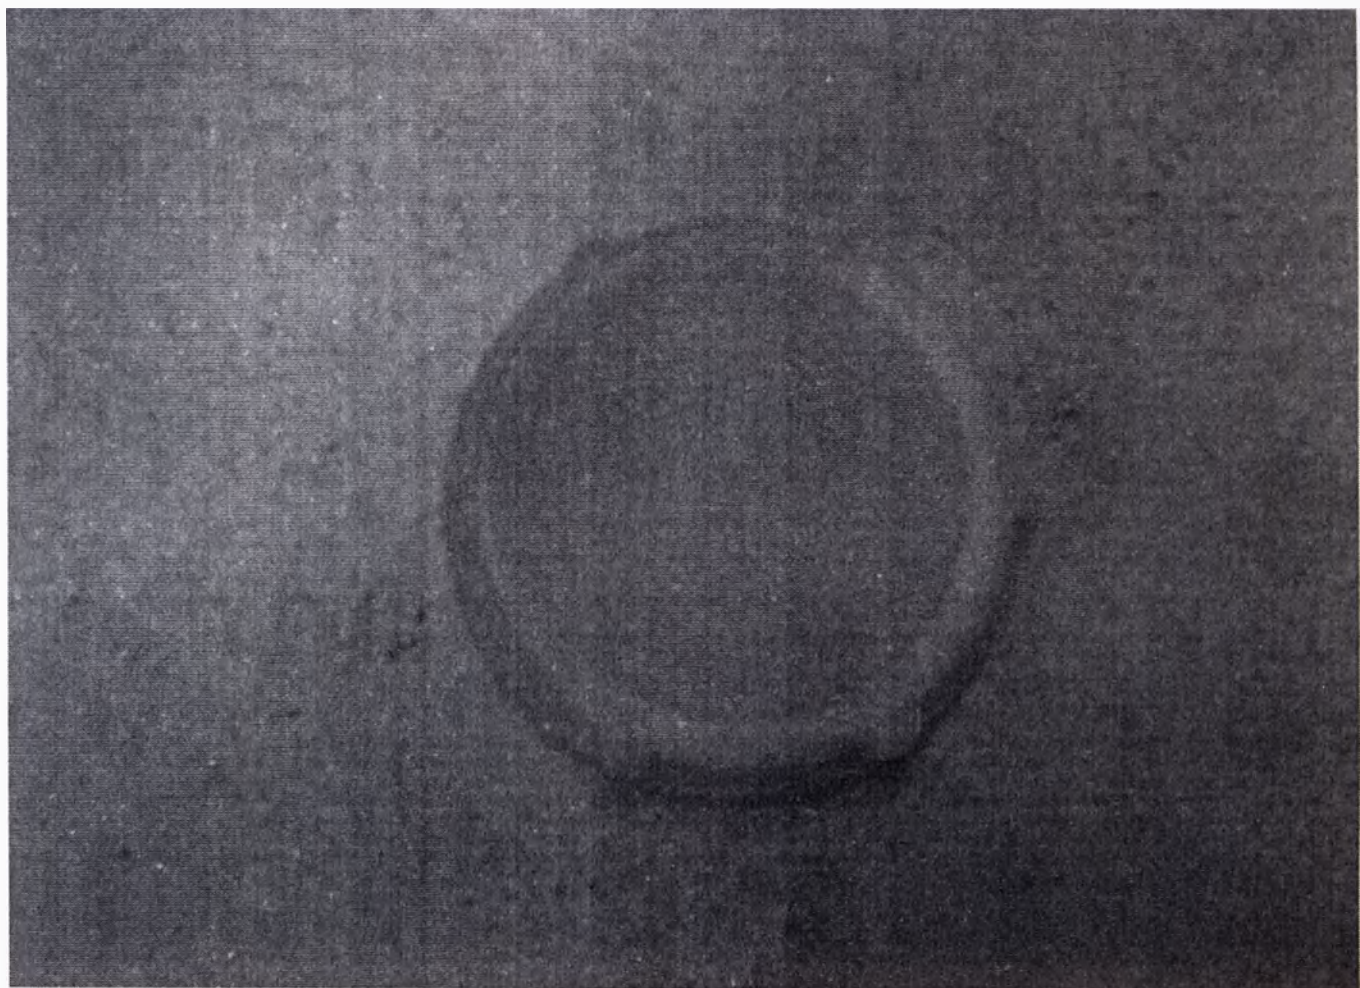

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020
Крышка к 20 л канистре разбавителя (20 L Diluent Cap)
Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$


Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а


Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

32. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.
Крышка к 5 л канистре разбавителя (20 5 Diluent Cap) – 1 шт.

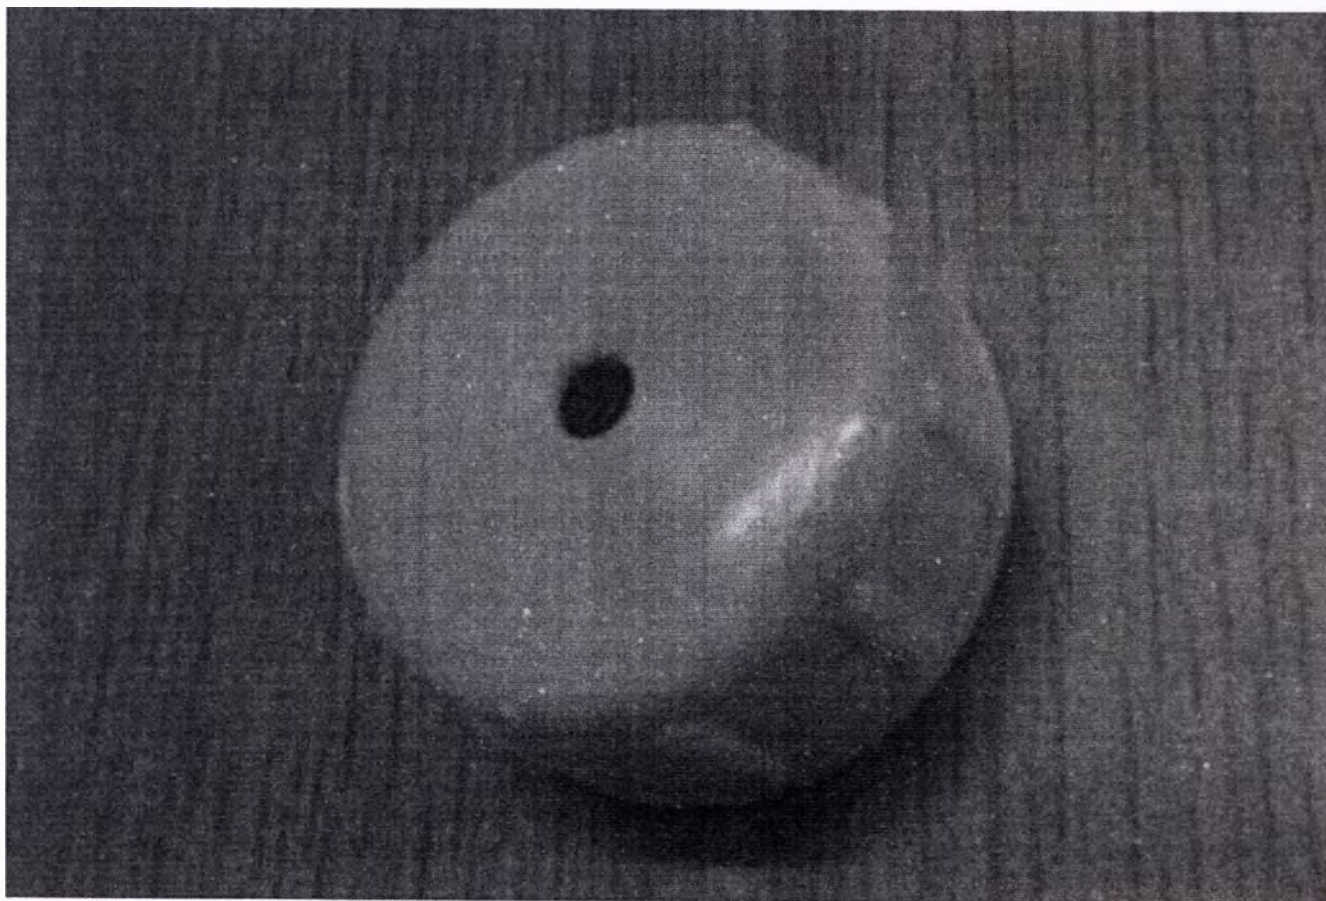

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020
Крышка к 5 л канистре разбавителя (20 5 Diluent Cap)
Кат.
Использовать до
Серия
Хранить при темп. $-10 + + 40^{\circ}\text{C}$
Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»
РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а
Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

33. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160.
Разъем (Socket) – 1 шт.

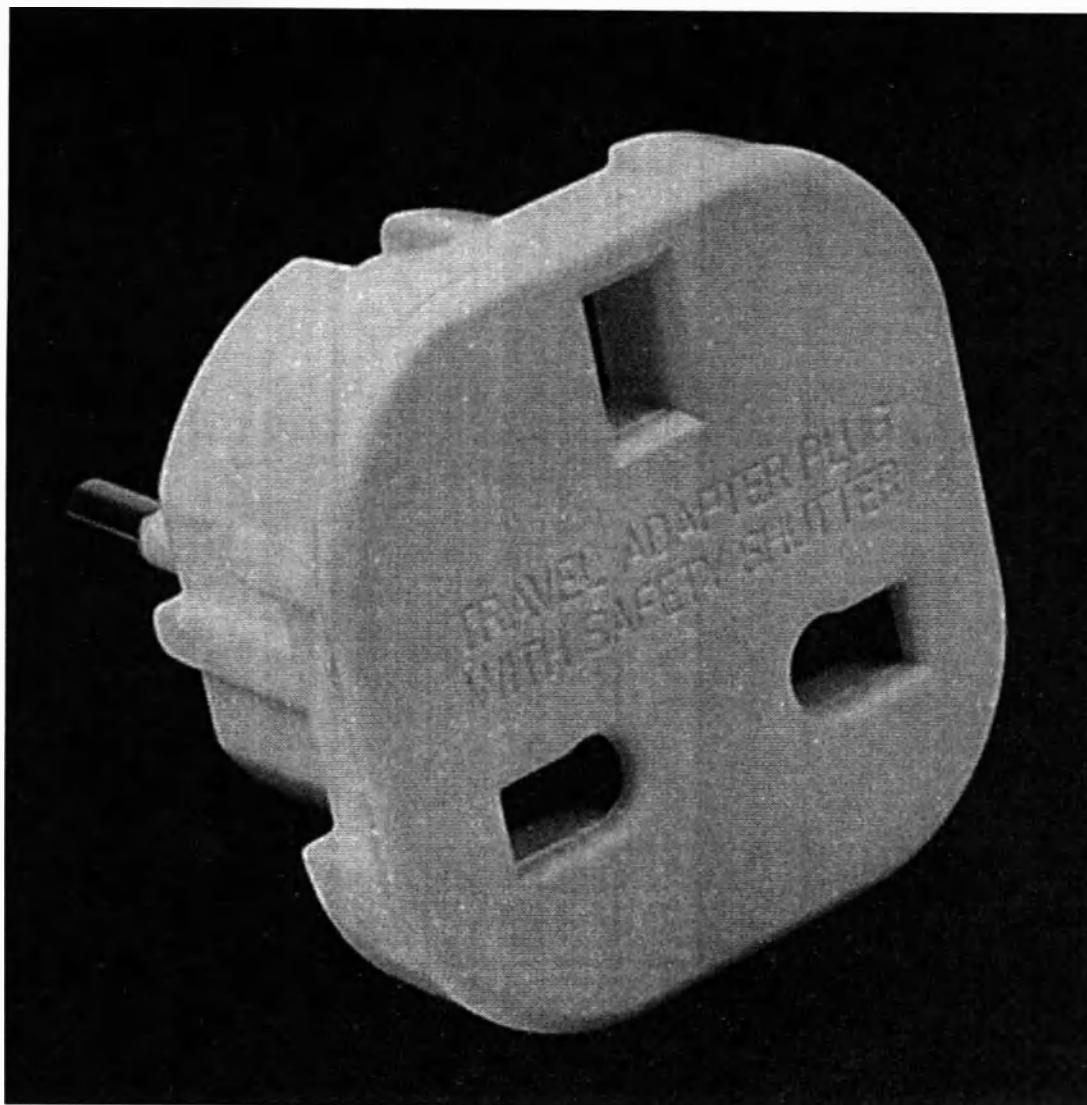

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160
Разъем (Socket)
Кат.
Использовать до
Серия
Хранить при темп. -10 + + 40 °C
Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»
РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а
Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

34. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160.
Набор карточек идентификационных (Cards set of product maintenance records) – 1 шт.



Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5160
Набор карточек идентификационных (Cards set of product maintenance records)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 \pm + 40^{\circ}\text{C}$

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

35. Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020.
Сертификат квалифицированного продукта (Qualified Product Certificate) – 1 шт.



Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 3020
Сертификат квалифицированного продукта (Qualified Product Certificate)

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп. $-10 \div +40^{\circ}\text{C}$

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39. Факс: +7 495-980-66-79

Генеральный директор
АО «ДИАКОН»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Иванов".

34 лист