

Medtronic

ООО «Медтроник»

Вн. тер. г., м.о. Пресненский

Пресненская наб., д.10

Башня С

9 эт., пом. III, ком.41

г. Москва, 123112

Россия

Tel: +7(495) 580 73 77

Fax: +7(495) 580 73 78

www.medtronic.com

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Плещунова Е.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello



Индивидуальная упаковка

(на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)

Остальные варианты исполнения имеют индивидуальную упаковку идентичного внешнего вида.



Индивидуальная упаковка (оборотная сторона)

(на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)

Остальные варианты исполнения имеют индивидуальную упаковку идентичного внешнего вида.

Balloon Occlude Catheter
Intrascapular Catheter with Cath

- [illegible]

1X Balloon Grasp Catheter
1X Dilator



The diagram shows two components: a balloon grasp catheter and a dilator. The catheter has a circular balloon at one end and a handle with a trigger mechanism. The dilator is a long, thin tube with a handle at one end. The catheter is shown inserted into the dilator. Labels include 'L' for length, 'OD' for outer diameter, and 'ID' for inner diameter.

OD = 6" (2.0mm) L = 30mm ID = 4.50" (2.1mm) N = 2.0"

Maximum Gallons per CO	0.035"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
2mm	0.04ml
4mm	0.07ml
5mm	0.12ml
6mm	0.18ml
7mm	0.24ml
8mm	0.34ml
Maximum Balloon Volume	1.0ml

1610590
6200002
2022-01
2024-12-01

Ⓢ Distributed by:
MicroTherapeutics, Inc.
4014 S. Hawthorne
Irvine, CA 92618
USA
Phone: 949-337-3700
Fax: 949-837-2044
www.micrortho.com

CE 2750

CALL NUMBER: 1610500 6200002



(01:14544050120703(17)2012011101120000



01 14544050130742 117 1241201 1191 5200000



(01)14544050120743(17)241201(10)5200002

UDI

[illegible]

Authorized Representative in EU

EC	REP	MedDevConsult GmbH
----	-----	--------------------

Airport Center (Building C),
Flughafenstrasse 52a 22335 Hamburg
Germany
Fax -No +49 40 53299-100

(на примере варианта исполнения *Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с*

материал Cellon, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)



9F


920
mmL

CELLO™

Balloon Guide Catheter Intravascular Catheter with Cuff

- Cathéter-guide à ballonnet
- Ballon-Führungskatheter
- Catetere guida a palloncino
- Catéter guía con globo
- Ballongguidekatheter
- Ballon Gids Katheter
- Cateter-guia com Balão
- Ballonki-katetri
- Ballonguidekatheter
- Οδηγός Καθετήρας με Μπαλόνι
- Balónkový vodič katéter
- Ballonos vezető katéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balonowy cewnik prowadzący
- Balon Kilavuz Kateter
- Ballongledekatheter
- Balónkový vodič katéter
- Cateter cu ghidaj cu balon
- Водещ балонен катетър
- Ballooniga juhtekateeter
- Balonski uvodni kateter
- Balioninis kreipiamasis kateteris
- Vadišanai paredzēts balonkatetrs
- Balonski vodilni kateter
- Cateter-guia com Balão
- Ống thông can thiệp đầu gắn bóng
- Балонски уводни катетер
- Шарлы бағыттағыш катетер
- Балон катетер за жица водич
- Kateter Pemandu Balon

CONT 1 × Balloon Guide Catheter
1 × Dilator

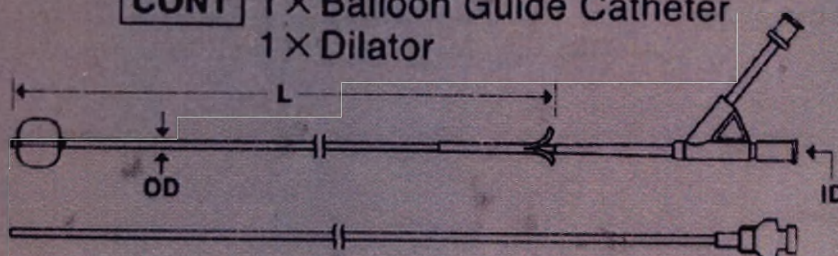



OD= 9F (3.0mm) L= 920mm ID=0.085" (2.15mm) (6.5F)

Maximum Guidewire OD	0.038"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.04mL
4mm	0.07mL
5mm	0.12mL
6mm	0.18mL
7mm	0.26mL
8mm	0.36mL
Maximum Balloon Volume	1.0mL


Маркировка на индивидуальной упаковке (увеличено)

(на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с




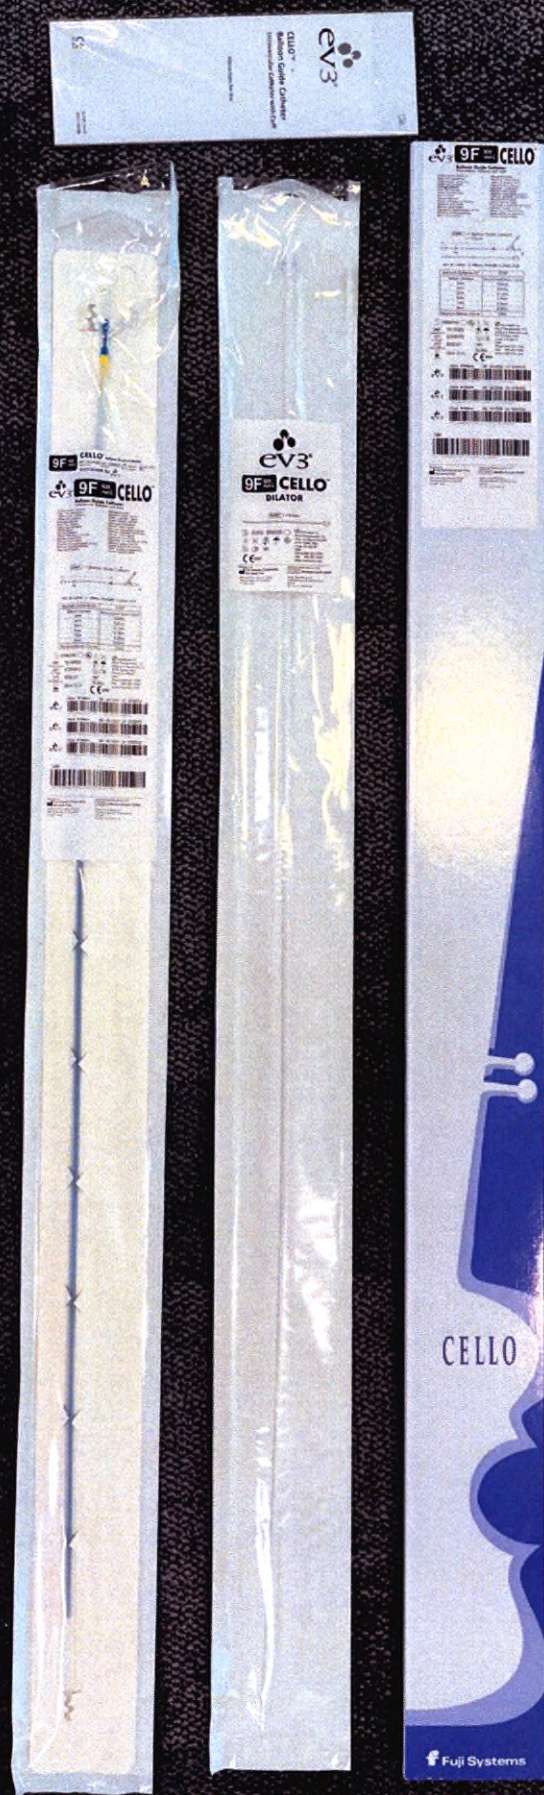

Содержимое индивидуальной упаковки: внутрисосудистый катетер (справа) и расширитель (по центру) (на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)

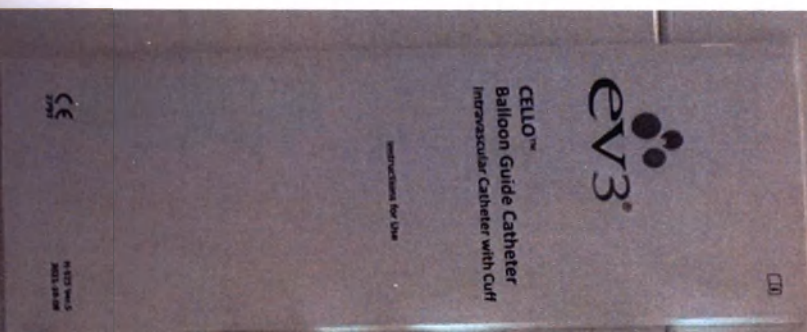

Содержимое индивидуальной упаковки: внутрисосудистый катетер (справа) и расширитель (по центру) (увеличенно) (на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый

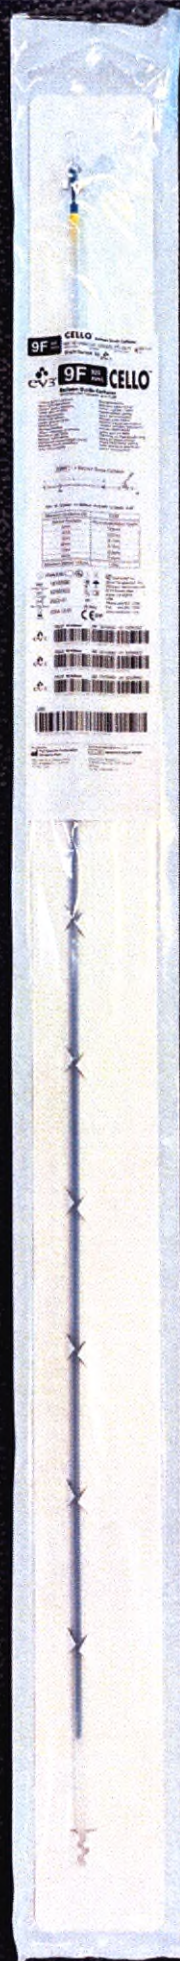

Катетер внутрисосудистый, стерильная упаковка (на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)

ev3[®] 9F 920 mm L CELLO[™]

- Katheter guide a ballonnet
- Balloon-Führungskatheter
- Katheter guide a palloncino
- Katheter guía con globo
- Balloon-idealkatheter
- Balloon-Gids Katheter
- Katheter guide com Balão
- Balónli-kateter
- Balloon-idealkatheter
- Одноразовый катетер с баллоном
- Balloonový vodič katéru
- Balloonos vezetel katéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balloonový český průvodič
- Balón Kérelv Katéter

- Balón gde katešeter
- Balónkoví volací katešeter
- Katešeter cu ghidaj cu balón
- Balónu salónu katešeter
- Balónu ghidaj katešeter
- Balónu uvdni katešeter
- Balónu krepimaj katešeter
- Valilatan paracšeter balónu katešeter
- Balónu vodilni katešeter
- Katešeter-gula cu balón
- Ōng thōng cu thiē dōi sūn bōng
- Balónu salónu katešeter
- Шарни балонувни катешетер
- Balón katešeter cu mōi cu vodni
- Katešeter paracšeter balón

[illegible]

Maximum Guidewire OD	0.036"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.04mL
4mm	0.07mL
5mm	0.12mL
6mm	0.18mL
7mm	0.26mL
8mm	0.36mL
Maximum Balloon Volume	1.0mL

 Distributed by:
MicroTherapeutics, Inc.
d/b/a av3 Neurovascular
9775 Toledo Way
Irvine, CA 92618
USA
Phone: 949-837-3700
Fax: 949-837-2044
www.medtronic.com

CELLO 9F/920mm **REP** 1610590 **LOT** 5200002

 **ev3**

1031104544050120740

1031104544050120740 1031104544050120740 1031104544050120740

UDI



(01) 044400170 1111110 520602

Manufacturers
Fuji Systems Corporation
Shirakawa Plant
203-2 Aza-Oniya, Odashira, Nishigo
Niigata Shirakawa District, Fukushima
961-8601 Japan

Authorized Representative in EU
EC REF MedDevConsult GmbH
Airport Center Building C1
Flughafenstrasse 57a 22339 Hamburg
Germany
Fax: No. +49 40 53295-100

Катетер внутрисосудистый, маркировка стерильной упаковки (на примере варианта исполнения *Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello*, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)

9F 920 mmL

CELLO™

Balloon Guide Catheter

REF 1610590
Catalog Number

LOT 5200002
Lot Number

2022-01
Date of manufacture

2024-12-01
Use by

Distributed by **ev3**




9F 920 mmL

CELLO™

Balloon Guide Catheter
Intravascular Catheter with Cuff

- Cathéter-guide à ballonnet
- Ballon-Führungskatheter
- Catetere guida a palloncino
- Catéter guía con globo
- Ballonguidekatheter
- Ballon Gids Katheter
- Cateter-guia com Balão
- Ballonki-katetri
- Ballonguidekatheter
- Οδηγός Καθετήρας με Μπαλόνι
- Balónkový vodič katétr
- Ballonos vezetô katéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balonowy cewnik prowadzący
- Balon Kilavuz Kateter

- Ballongledekatheter
- Balónkový vodič katétr
- Cateter cu ghidaj cu balon
- Водещ балонен катетър
- Ballooniga juhtekateeter
- Balonski uvodni kateter
- Balioninis kreipiamasis kateteris
- Vadišanai paredzēts balonkatetrs
- Balonski vodilni kateter
- Cateter-guia com Balão
- Ống thông can thiệp đầu gần bóng
- Балонски уводни катетер
- Шарлы бағыттағыш катетер
- Balon kateter za žižca vodič
- Kateter Pemandu Balon

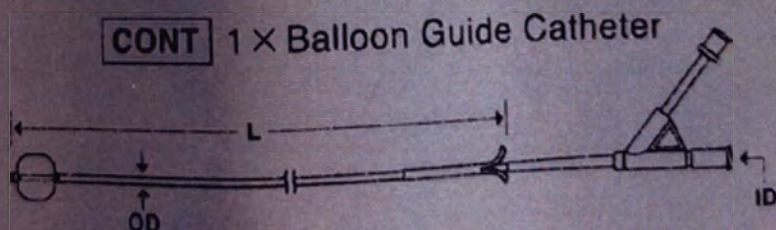

OD= 9F (3.0mm) L= 920mm ID=0.085" (2.15mm) (6.5F)

Maximum Guidewire OD	0.038"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.04mL
4mm	0.07mL
5mm	0.12mL
6mm	0.18mL
7mm	0.26mL
8mm	0.36mL
Maximum Balloon Volume	1.0mL

Катетер внутрисосудистый, маркировка стерильной упаковки (увеличенно) (на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)

8mm	0.26mL
	0.36mL
Maximum Balloon Volume	1.0mL

 **STERILE**        

REF 1610590
Catalog Number
LOT 5200002
Lot Number
 2022-01
Date of manufacture
 2024-12-01
Use by

MD
Rx.Only
CE 2797


Distributed by:
 MicroTherapeutics, Inc.
 d/b/a ev3 Neurovascular
 9775 Toledo Way
 Irvine, CA 92618
 USA
 Phone: 949-837-3700
 Fax: 949-837-2044
 www.medtronic.com

 **CELLO 9F/920mm** **REF** 1610590 **LOT** 5200002

 (01) 04544050120746 (17) 241201 (10) 5200002

 **CELLO 9F/920mm** **REF** 1610590 **LOT** 5200002

 (01) 04544050120746 (17) 241201 (10) 5200002

 **CELLO 9F/920mm** **REF** 1610590 **LOT** 5200002

 (01) 04544050120746 (17) 241201 (10) 5200002


UDI

 (01) 04544050120746 (17) 241201 (10) 5200002

Manufacturer
 **Fuji Systems Corporation**
Shirakawa Plant
 200-2 Aza-Ohira, Odakura, Nishigo,
 Nishi Shirakawa Gun, Fukushima
 961-8061 Japan

Authorized Representative in EU
EC REP MedDevConsult GmbH
 Airport Center (Building C),
 Flughafenstrasse 52a 22335 Hamburg
 Germany
 Fax -No. +49 40 53299-100

Катетер внутрисосудистый, маркировка стерильной упаковки (увеличенно, продолжение) (на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)

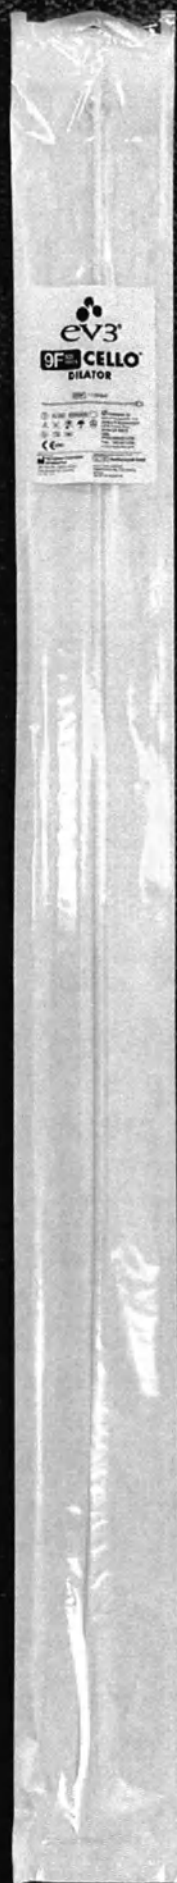


Расширитель, стерильная упаковка (на примере варианта исполнения *Катетер баллонный направляющий* (внутрисосудистый катетер с манжетой) *Cello*, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)



9F^{920 mm L} CELLOTM
DILATOR

CONT 1 × Dilator



Rx.Only

STERILE EO



Distributed by:
MicroTherapeutics, Inc.
d/b/a ev3 Neurovascular
9775 Toledo Way
Irvine, CA 92618
USA
Phone: 949-837-3700
Fax: 949-837-2044
www.medtronic.com



CE 2797

Manufacturer

Fuji Systems Corporation
Shirakawa Plant


200-2 Aza-Ohira, Odakura, Nishigo,
Nishi Shirakawa Gun, Fukushima
961-8061 Japan

Authorized Representative in EU


EC REP MedDevConsult GmbH

Airport Center (Building C),
Flughafenstrasse 52a 22335 Hamburg
Germany
Fax.-No. +49 40 53299-100


Расширитель, маркировка стерильной упаковки (на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)

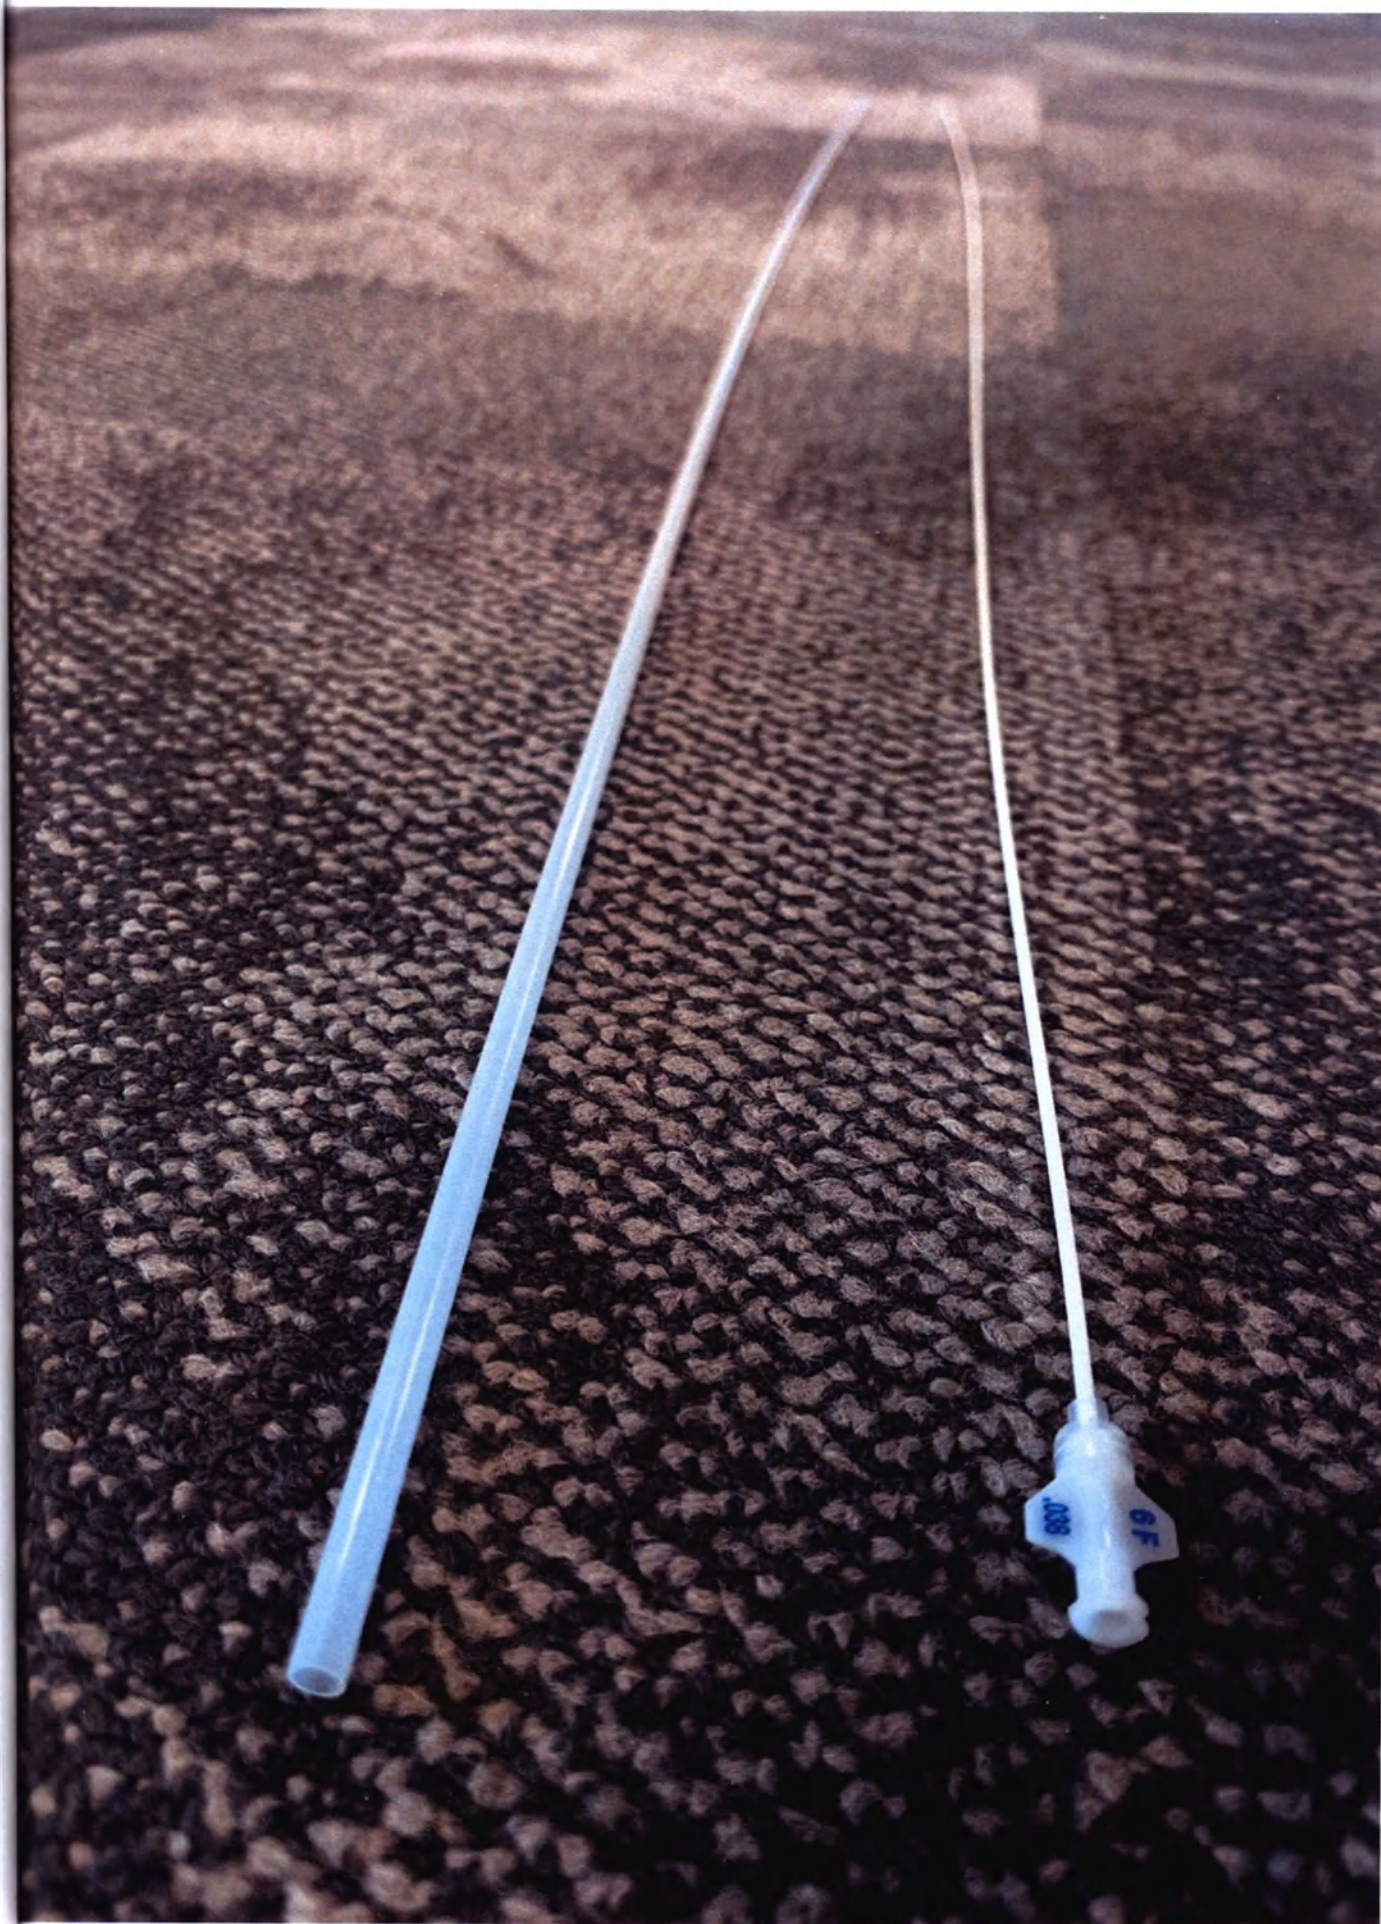


Расширитель с защитной трубкой

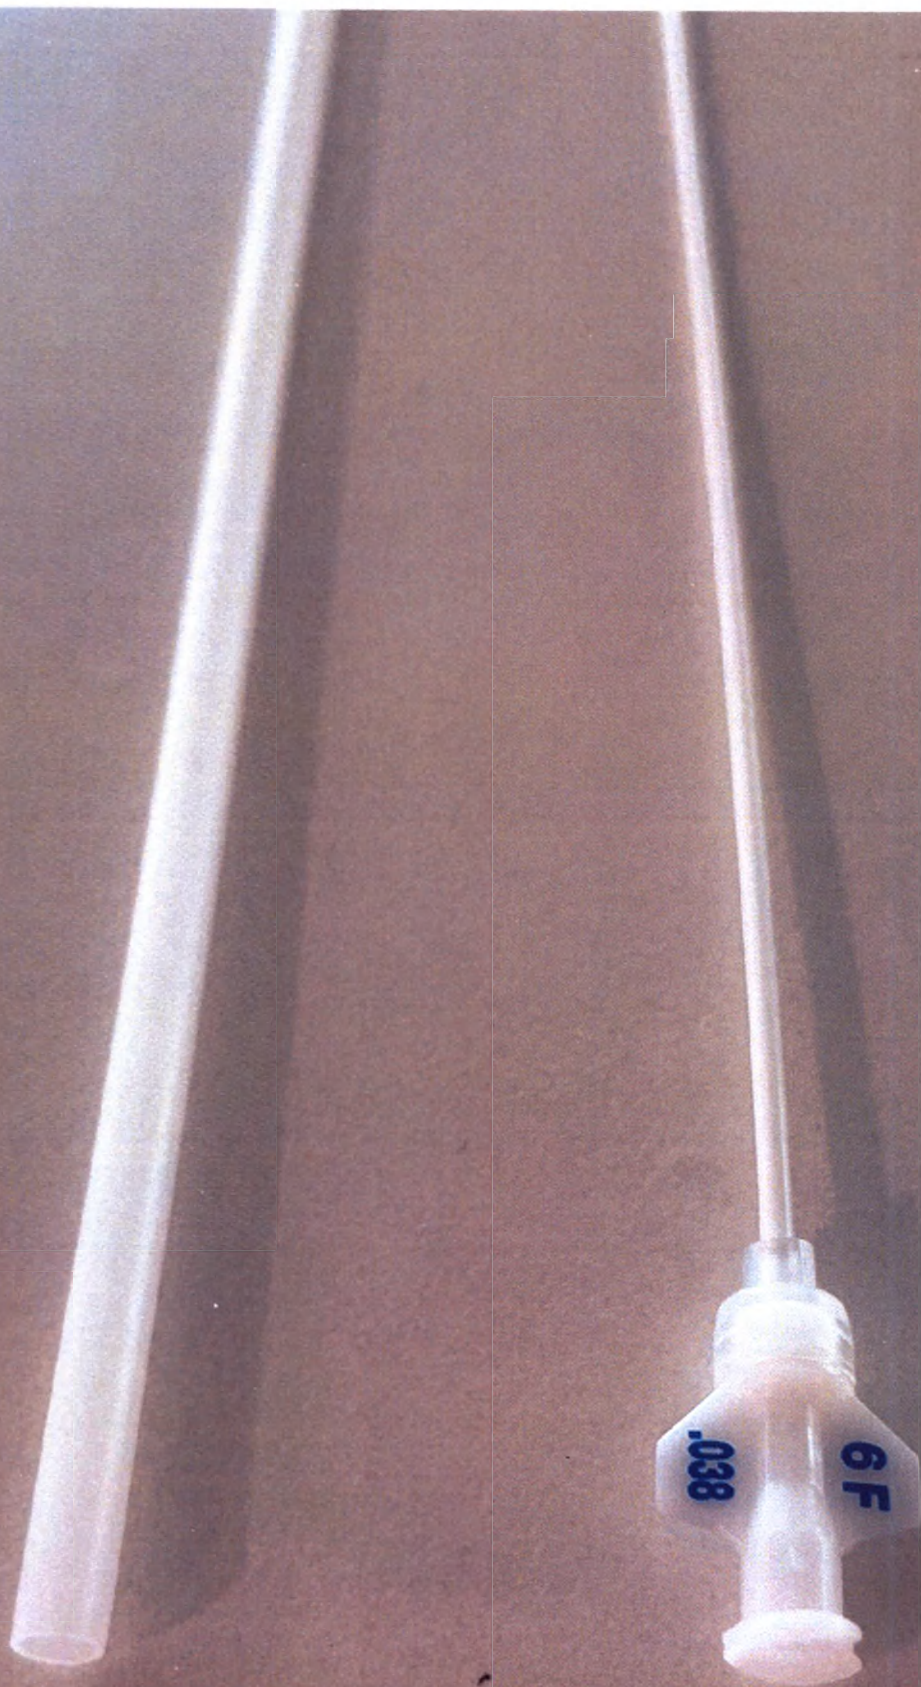

Расширитель с защитной трубкой

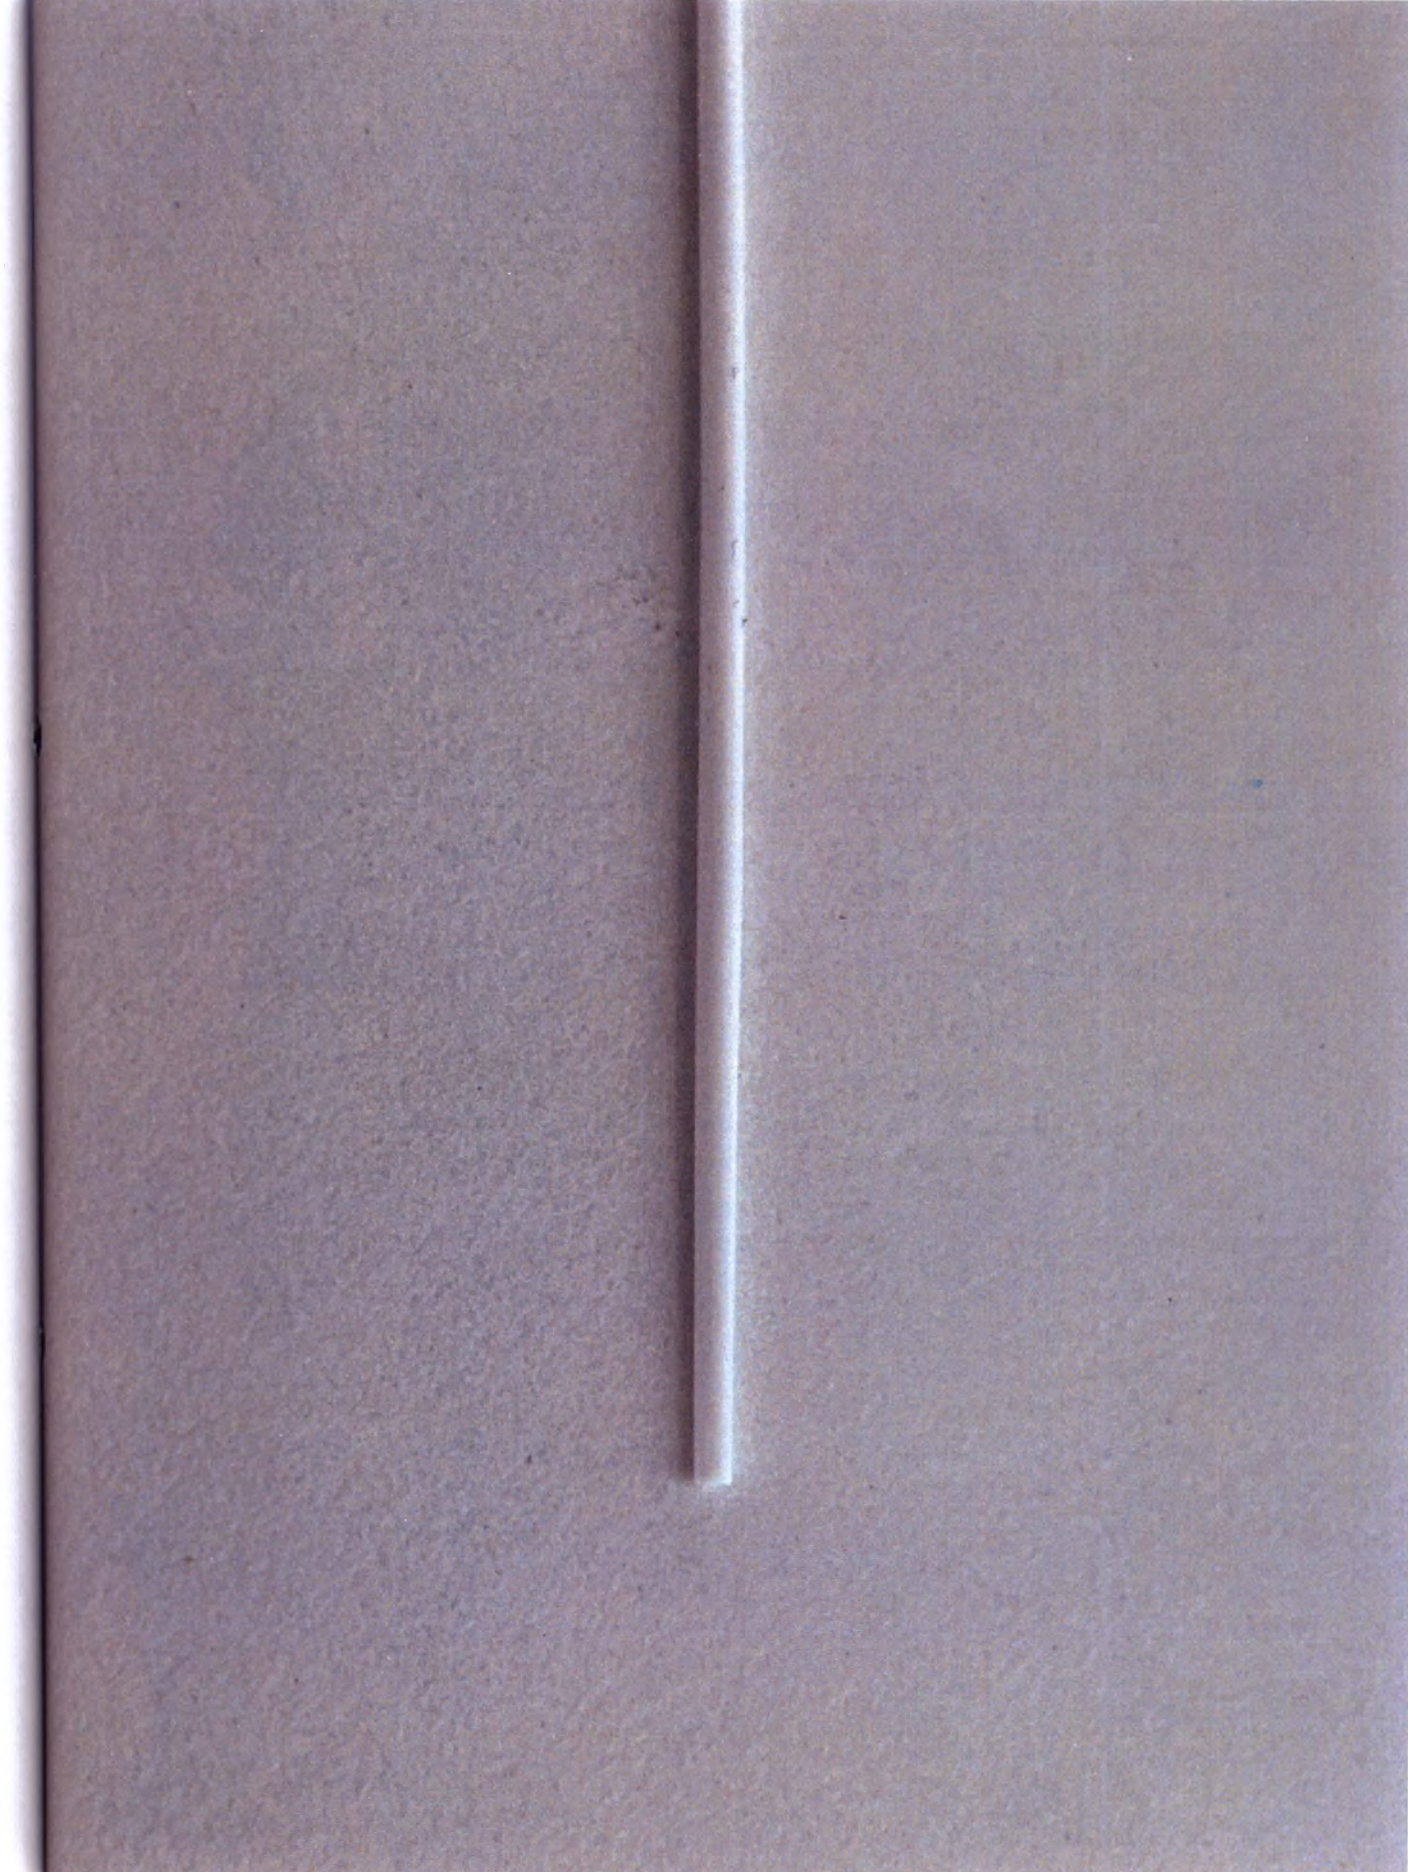

Расширитель с защитной трубкой, кончик

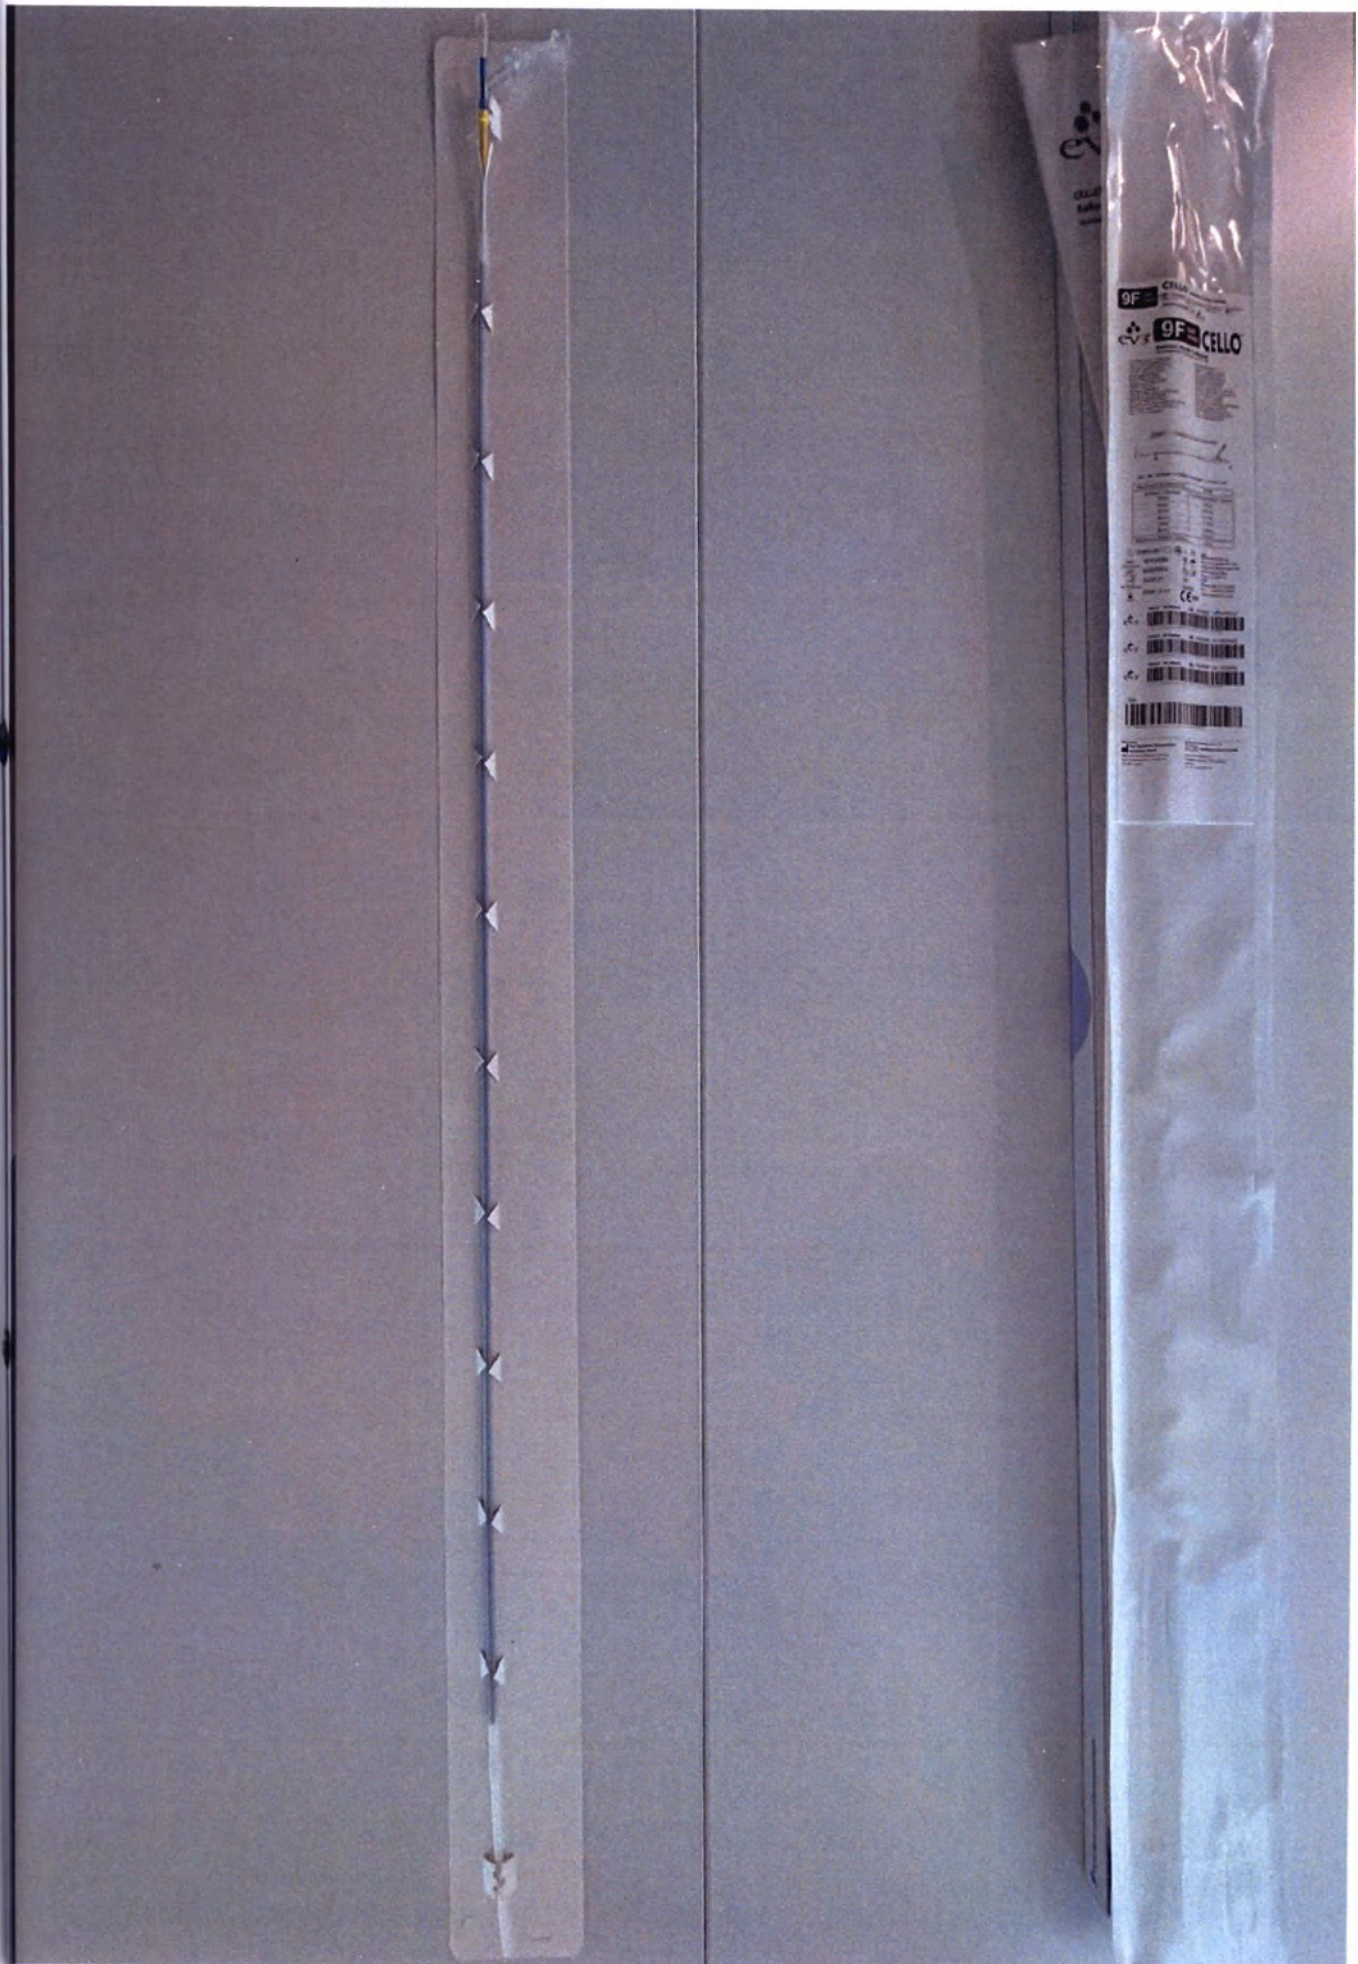


Катетер баллонный направляющий (в защитной трубке) (на примере варианта исполнения Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внутренний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)






Катетер баллонный проводниковый (соединительная втулка) рядом с защитной трубкой (на примере варианта исполнения *Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello*, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм)

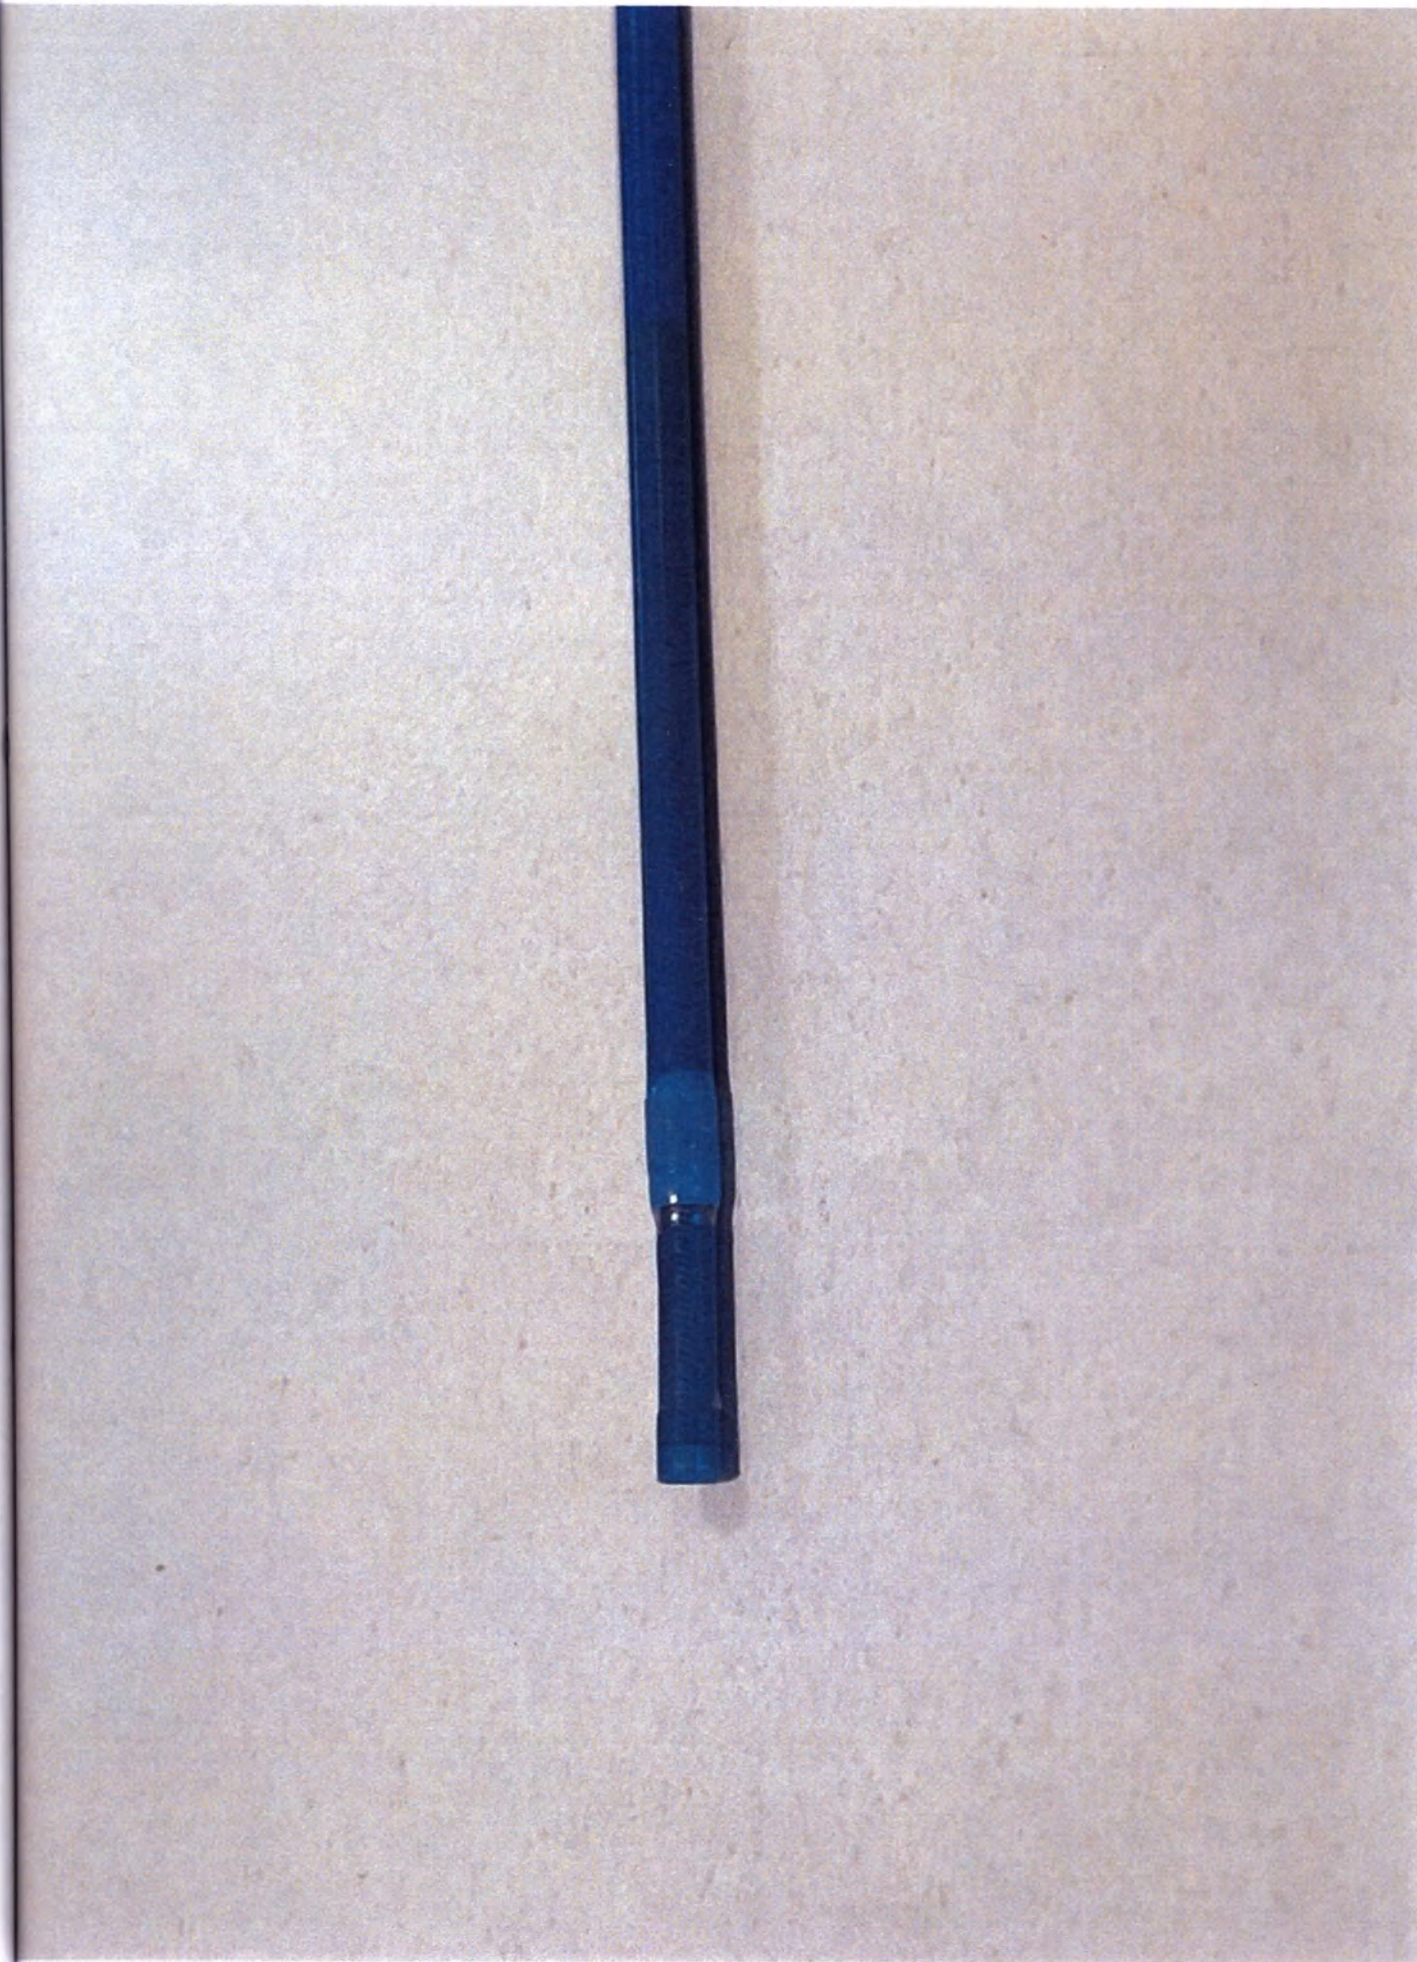


Кончик катетера с баллоном в нераскрытом состоянии



Кончик катетера с баллоном в раскрытом состоянии

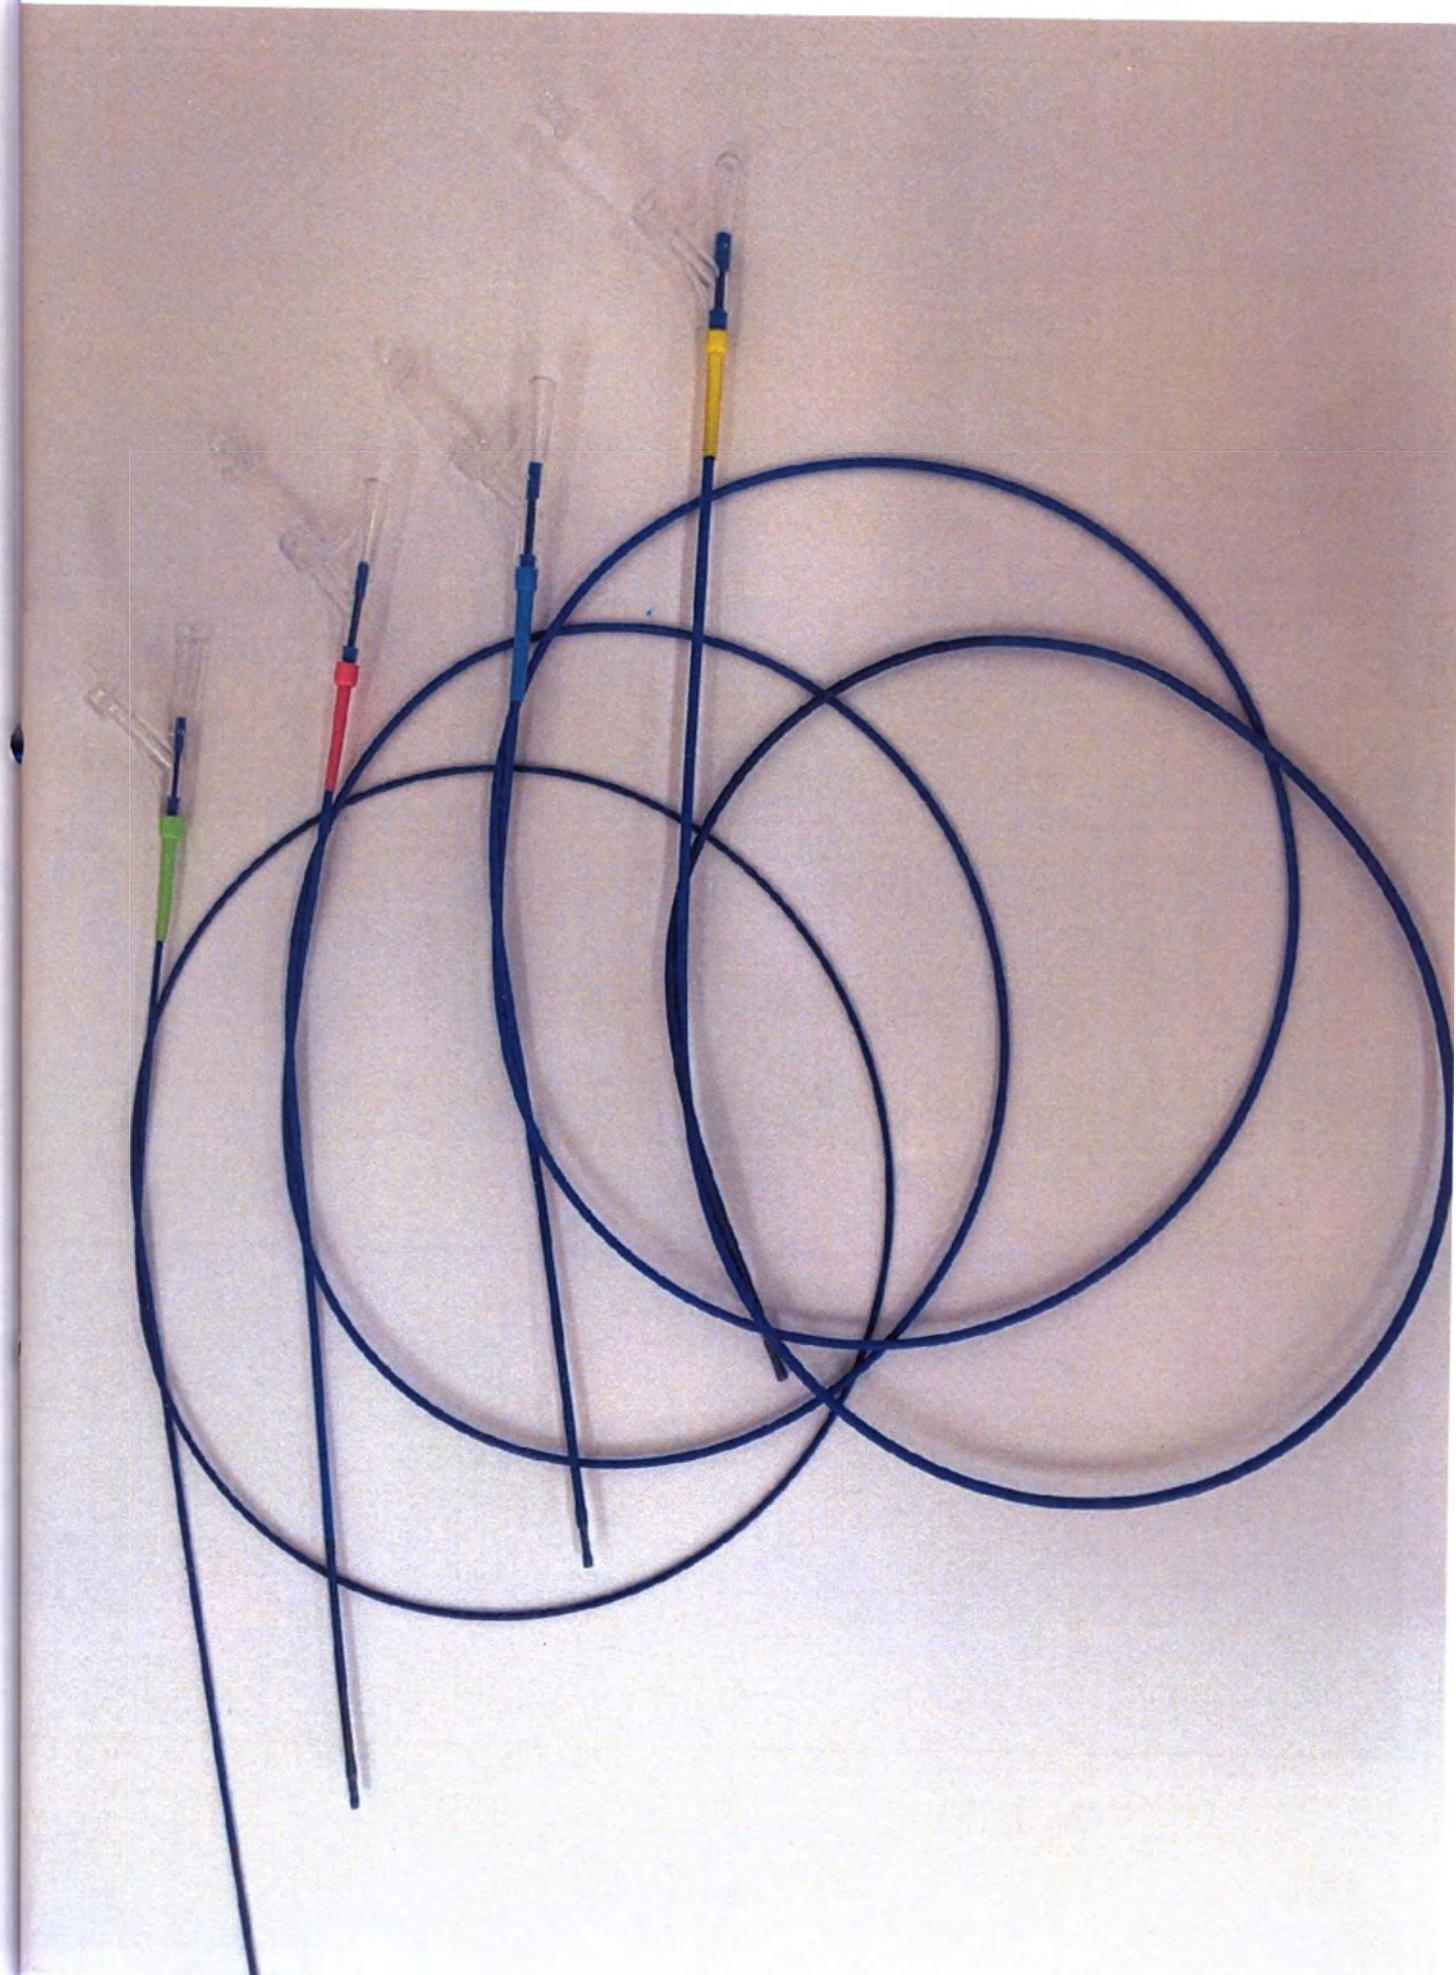

Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello:
Размер 6F+ (слева), размер 7F+ (второй слева), размер 8F (второй справа), размер 9F (справа)

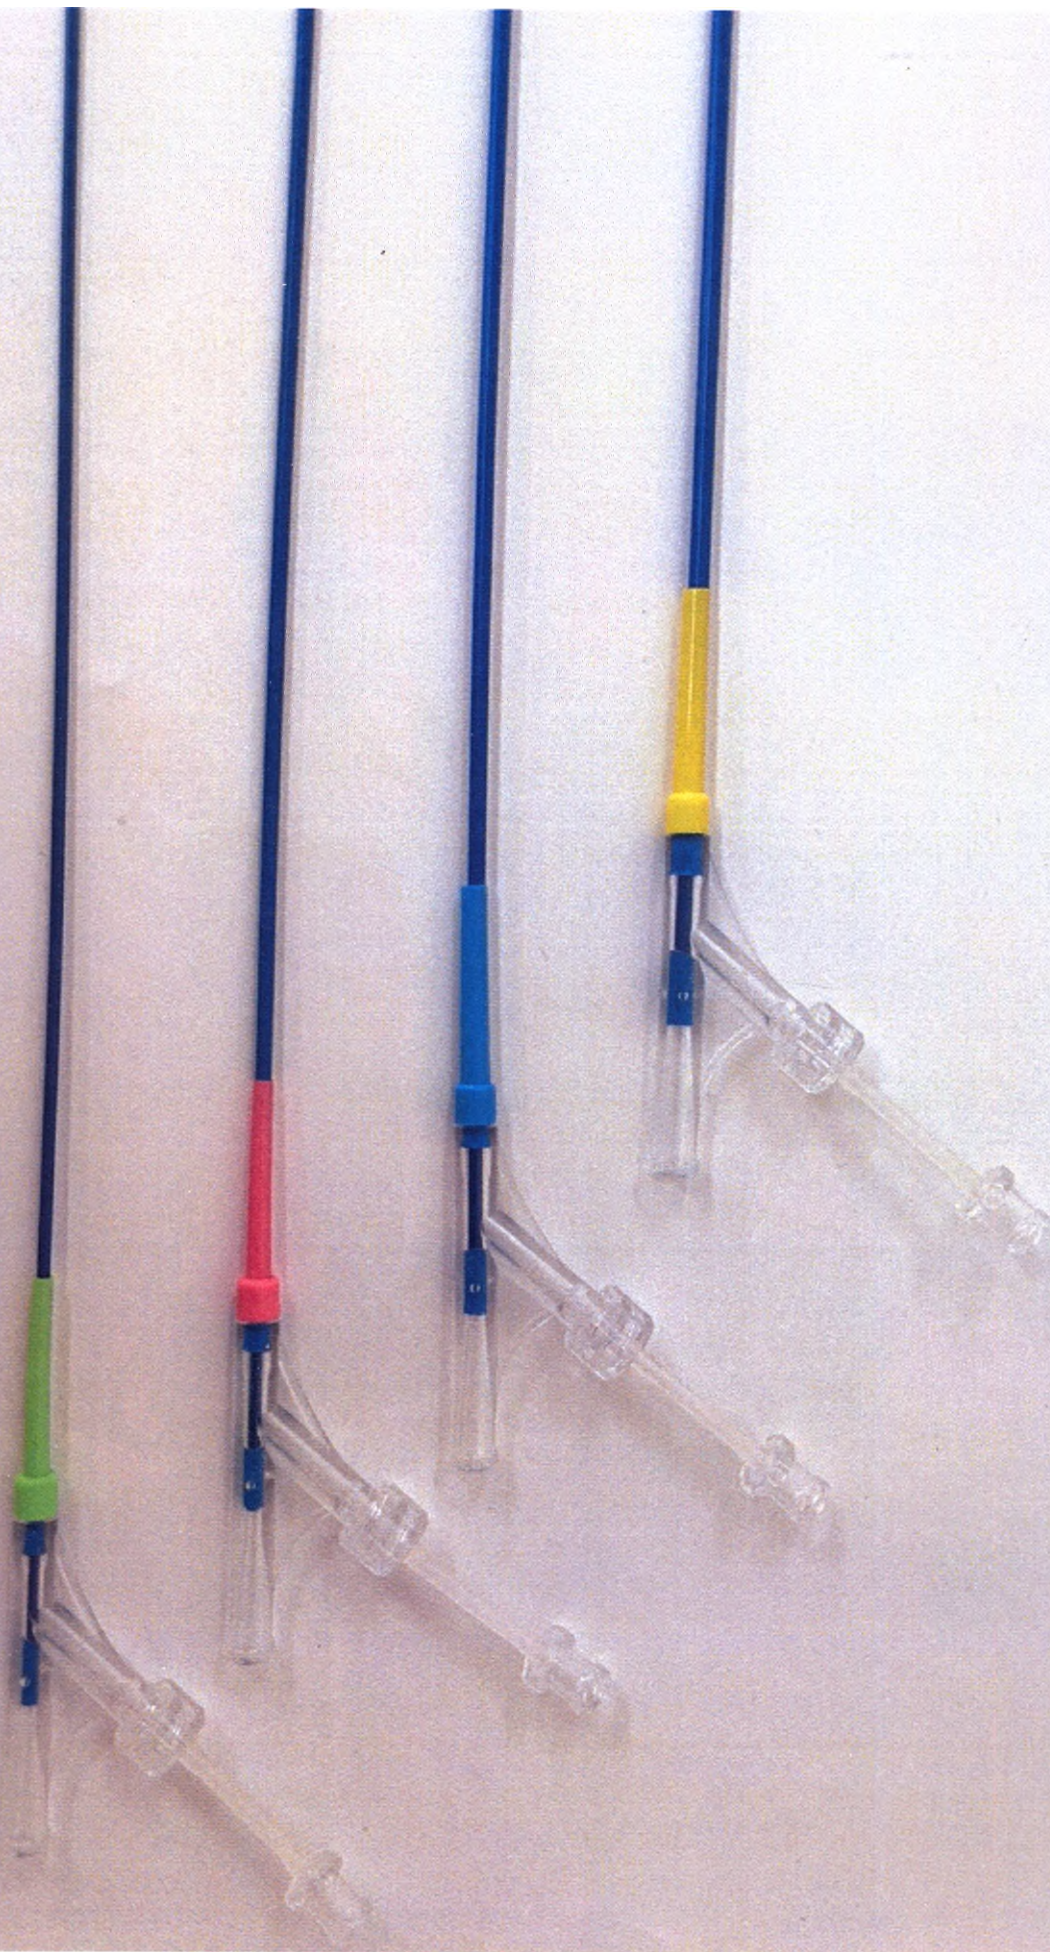

**Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello
(соединительная втулка):**

Размер 6F+ (слева), размер 7F+ (второй слева), размер 8F (второй справа), размер 9F (справа)



Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello (кончик катетера с баллоном в нераскрытом состоянии):


Размер 6F+ (слева), размер 7F+ (второй слева), размер 8F (второй справа), размер 9F (справа)

6F+ 950 mmL **CELLO™** Balloon Guide Catheter
 REF 1610560 LOT
 Catalog Number Lot Number Date of manufacture Use by
 Distributed by **ev3**

ev3 **6F+ 950 mmL** **CELLO™**

Balloon Guide Catheter
Intravascular Catheter with Cuff

- Cathéter-guide à ballonnet
- Ballon-Führungskatheter
- Catetere guida a pallonino
- Catéter guía con globo
- Ballonguidekatheter
- Ballon Gids Katheter
- Cateter-guia com Balão
- Ballonki-katetri
- Ballonguidekatheter
- Οδηγός Καθετήρας με Μπαλόνι
- Balónkový vodič katéter
- Ballonos vezető katéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balonowy cewnik prowadzący
- Balon Kilavuz Kateter
- Ballongidekatheter
- Balónkový vodič katéter
- Cateter cu ghidaj cu balon
- Бодец Балонен катетер
- Balloniga juhtekateeter
- Balsonki uvodni kateter
- Balioninis kreipiamasis kateteris
- Vadišanal paredrēts balonkatētrs
- Balonski vodilni kateter
- Cateter-guia com Balão
- Ống thông can thiệp đầu gần bóng
- Балонки уводни катетер
- Шарлы бағыттағыш катетер
- Балон катетер за жица водич
- Kateter Pemandu Balon

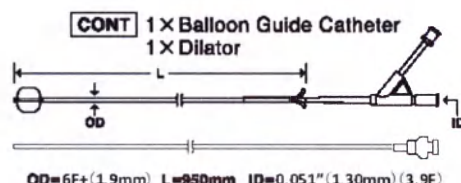

Maximum Guidewire OD	0.025"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.02mL
4mm	0.04mL
5mm	0.07mL
6mm	0.11mL
7mm	0.18mL
8mm	0.26mL
Maximum Balloon Volume	0.80mL

STERILE EO

REF 1610560
 Catalog Number
 LOT
 Lot Number
 Date of manufacture
 Use by

MD
Rx Only

CE 2787

Distributed by:
 MicroTherapeutics, Inc.
 d/b/a ev3 Neurovascular
 9775 Toledo Way
 Irvine, CA 92618
 USA
 Phone: 949-837-3700
 Fax: 949-837-2044
 www.medtronic.com

CELLO 6F+/950mm REF 1610560 LOT

ev3

CELLO 6F+/950mm REF 1610560 LOT

ev3

CELLO 6F+/950mm REF 1610560 LOT

ev3

UDI

Manufacturer
Fuji Systems Corporation
Shirakawa Plant
 200-2 Aza-Ohira, Oda-kura, Nishigo,
 Nishio Shirakawa Gun, Fukushima
 961-8061 Japan

Authorized Representative in EU
EC REP MedDevConsult GmbH
 Airport Center (Building C),
 Flughafenstrasse 52a 22335 Hamburg
 Germany
 Fax.-No. +49 40 53299-100

Макет маркировки: Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello,
 6F+ (внешний диаметр 1,9 мм), длина 950 мм

6F+ 950
mm L

CELLO™ Balloon Guide Catheter

REF 1610560 LOT
Catalog Number Lot Number

Date of manufacture Use by

Distributed by **ev3**




6F+ 950
mm L

CELLO™

Balloon Guide Catheter
Intravascular Catheter with Cuff


- Cathéter-guide à ballonnet
- Ballon-Führungskatheter
- Catetere guida a palloncino
- Catéter guía con globo
- Ballonguidekatheter
- Ballon Gids Katheter
- Cateter-guia com Balão
- Ballonki-katetri
- Ballonguidekatheter
- Οδηγός Καθετήρας με Μπαλόνι
- Balónkový vodící katéter
- Ballonos vezető katéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balonowy cewnik prowadzący
- Balon Kilavuz Kateter
- Ballongledekatheter
- Balónkový vodič katéter
- Cateter cu ghidaj cu balon
- Водещ балонен катетър
- Balloniga juhtekateeter
- Balonski uvodni kateter
- Baloninis kreipiamasis kateteris
- Vadišanai paredzēts balonkatetrs
- Balonski vodilni kateter
- Cateter-guia com Balão
- Ống thông can thiệp đầu gần bóng
- Балонски уводни катетер
- Шарлы бағыттағыш катетер
- Балон катетер за жица водич
- Kateter Pernandu Balon

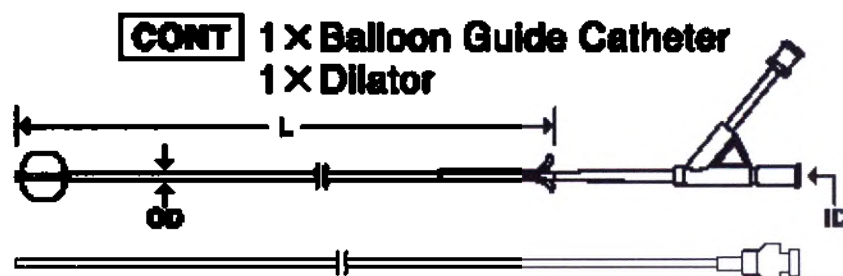


OD=6F+(1.9mm) L=950mm ID=0.051" (1.30mm) (3.9F)

Maximum Guidewire OD	0.025"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.02mL
4mm	0.04mL
5mm	0.07mL
6mm	0.11mL
7mm	0.18mL
8mm	0.26mL
Maximum Balloon Volume	0.80mL

Макет маркировки (увеличенно): Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello размер 6F+ (внешний диаметр 1,9 мм), длина 950 мм

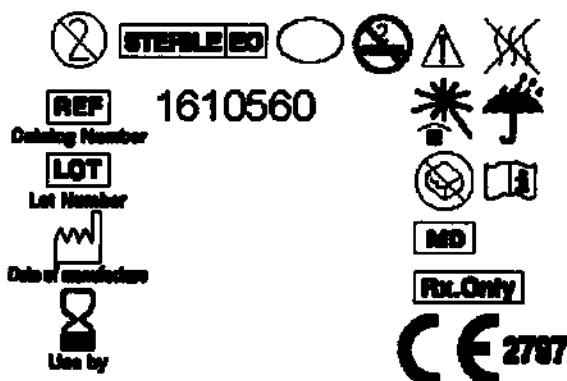

Distributed by:
 MicroTherapeutics, Inc.
 d/b/a ev3 Neurovascular
 8775 Toledo Way
 Irvine, CA 92618
 USA
 Phone: 949-837-3700
 Fax: 949-837-2044
 www.medtronic.com

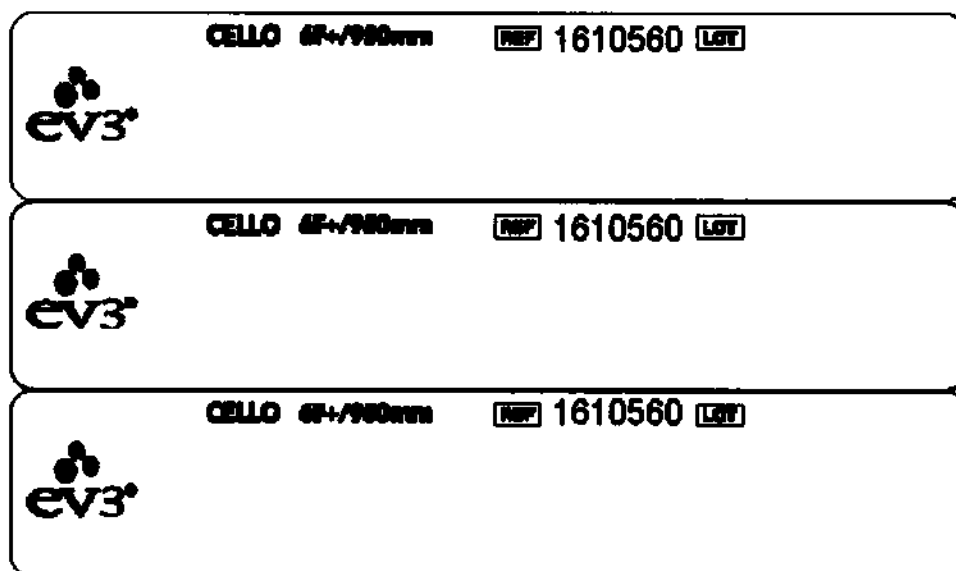

UDI

Manufacturer
Fuji Systems Corporation
 Shirakawa Plant

200-2 Aza-Onira, Odaikura, Nishigo,
 Nishi-Shirakawa Gun, Fukushima
 961-8061 Japan

Authorized Representative in EU


EC REP **MedDevConsult GmbH**

Airport Center (Building C),
 Flughafenstrasse 52a 22335 Hamburg
 Germany
 Fax.-No. +49 40 53277-100

Макет маркировки (увеличенно, продолжение): Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 6F+ (внешний диаметр 1,9 мм), длина 950 мм


Balloon Guide Catheter
Intravascular Catheter with Cuff

- Catheter-guide à ballonnet
- Ballon-Führungskatheter
- Catetere guida a palloncino
- Catheter guide con globo
- Ballonguidékatheter
- Ballon Guidé Katheter
- Catheter-guide com Balão
- Ballonki-kateter
- Ballonguidékatheter
- Ödnyűző Katétertipus ja Működés
- Ballonový vodič katéter
- Ballonos vezetőkathéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balonowy cewnik prowadzący
- Balon Működés Katéter
- Ballongledékatheter
- Ballonový vodič katéter
- Catheter cu ghidaj cu balon
- Balloon Sonneni kateterep
- Balloniga juhtkatheter
- Balloniki uradni kateter
- Balloninis krepšiamasis kateteris
- Vodičnatel paralizetna balonkateter
- Balloneti vodilni kateter
- Catheter-guide com Balão
- Ống thông dẫn bóng
- Balloonsonen kateterep
- Működés Balonnyalvezetőkathéter
- Balon kateterep sa sonneni
- Kateter Fernando Balon

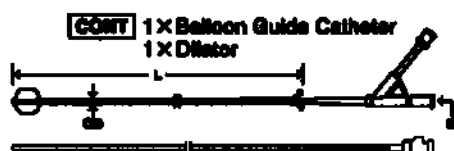

OD=7F+ (2.4mm) L=950mm ID=0.057" (1.70mm) (5.3F)

Maximum Guidewire OD	0.035"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.04mL
4mm	0.07mL
5mm	0.11mL
6mm	0.16mL
7mm	0.24mL
8mm	0.34mL
Maximum Balloon Volume	1.0mL

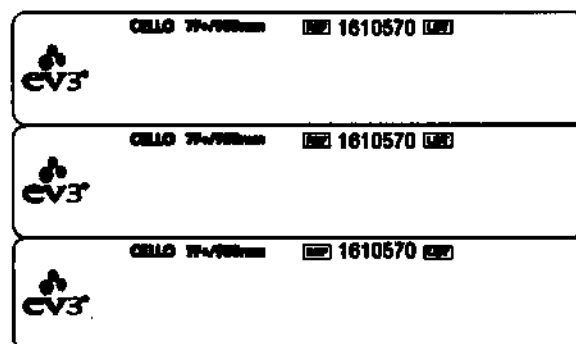

UDI

Manufacturer
Pfizer Systems Corporation
Minuteman Plant
 230-2 Ann Drive, Orléans, MA 01546
 1000 Minuteman Park, Andover
 01810-0001

Authorized Representative for EU
EC REF MicroTherapeutics GmbH
 Airport Center Building 11,
 Flughafenstrasse 51a 22089 Hamburg
 Germany
 Fax: +49 40 30299-105

Макет маркировки: Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 7F+ (внешний диаметр 2,4 мм), длина 950 мм

7F+ 950 mmL

CELLO™ Balloon Guide Catheter

REF 1610570 LDT
Ordering Number Lot Number

Date of manufacture Use by

Distributed by **ev3**

ev3

7F+ 950 mmL

CELLO™

Balloon Guide Catheter
Intravascular Catheter with Cuff

- Cathéter-guide à ballonnet
- Ballon-Führungskatheter
- Catetere guida a palloncino
- Catéter guia con globo
- Ballonguidekatheter
- Ballon Gids Katheter
- Cateter-guia com Balão
- Ballonki-kathetri
- Ballonguidekatheter
- Οδηγός Καθετήρας με Μπαλόνι
- Balónkový vodič katétr
- Ballonos vezető katéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balonowy cewnik prowadzący
- Balon Kilavuz Kateter
- Ballongidekatheter
- Balónkový vodič katéter
- Cateter cu ghidaj cu balon
- Водещ балонен катетър
- Balloniga juhtekateeter
- Balonski uvodni kateter
- Balloninis kreipiamasis kateteris
- Vadišanai paredzēts balonkatetrs
- Balonski vodilni kateter
- Cateter-guia com Balão
- Ống thông can thiệp đầu gần bóng
- Балонски уводни катетер
- Шарлы бағыттағыш катетер
- Балон катетер за жила водич
- Kateter Pernandu Balon


CONT 1 X Balloon Guide Catheter
1 X Dilator




OD=7F+(2.4mm) L=950mm ID=0.067" (1.70mm) (5.1F)

Maximum Guidewire OD	0.035"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.04mL
4mm	0.07mL
5mm	0.11mL
6mm	0.16mL
7mm	0.24mL
8mm	0.34mL
Maximum Balloon Volume	1.0mL

Макет маркировки (увеличено): Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 7F+ (внешний диаметр 2,4 мм), длина 950 мм

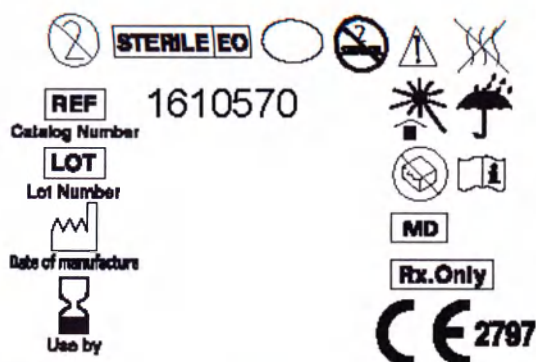


 Distributed by:
MicroTherapeutics, Inc.
d/b/a ev3 Neurovascular
9775 Toledo Way
Irvine, CA 92618
USA
Phone: 949-837-3700
Fax: 949-837-2044
www.medtronic.com

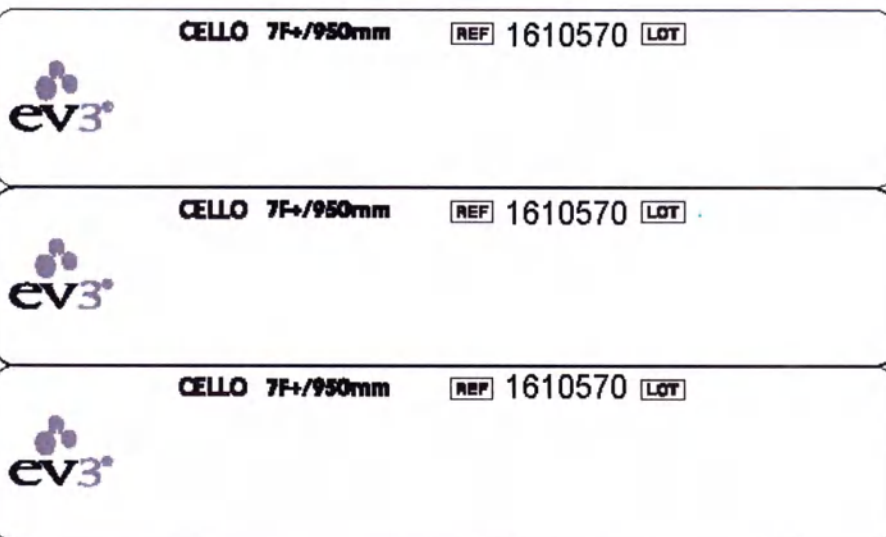

UDI

Manufacturer
 **Fuji Systems Corporation**
Shirakawa Plant
200-2 Aze-Ohira, Odakura, Nishigo,
Nishi Shirakawa Gun, Fukushima
961-8061 Japan

Authorized Representative in EU
 **MedDevConsult GmbH**
Airport Center (Building C),
Flughafenstrasse 52a 22335 Hamburg
Germany
Fax.-No. +49 40 53299-100

Макет маркировки (увеличенно, продолжение): Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 7F+ (внешний диаметр 2,4 мм), длина 950 мм

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8F 950
mmL

CELLO™ Balloon Guide Catheter

REF 1610580 LOT
Catalog Number Lot Number

DATE OF MANUFACTURE

USE BY

Distributed by **ev3**




8F 950
mmL

CELLO™

Balloon Guide Catheter
Intravascular Catheter with Cuff


- Cathéter-guide à ballonnet
- Ballon-Führungskatheter
- Catetere guida a palloncino
- Catéter guía con globo
- Ballonguidekatheter
- Ballon Gids Katheter
- Cateter-guia com Balão
- Ballonki-kathetri
- Ballonguidekatheter
- Οδηγός Καθετήρας με Μπαλόνι
- Balónkový vodič katétr
- Ballonos vezető katéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balonowy cewnik prowadzący
- Balon Kilavuz Kateter
- Ballongidekatheter
- Balónkový vodič katéter
- Cateter cu ghidaj cu balon
- Водещ балонен катетър
- Ballooniga juhtekateeter
- Balonski uvodni kateter
- Balioninis kreipiamasis kateteris
- Vadišanai paredzēts balonkatetrs
- Balonski vodilni kateter
- Cateter-guia com Balão
- Ống thông can thiệp đầu gần bóng
- Балонски уводни катетер
- Шарлы бағыттағыш катетер
- Балон катетер за жила водич
- Kateter Pernandu Balon

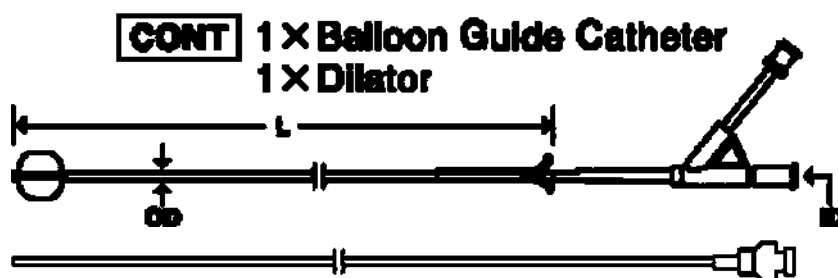


OD= 8F (2.6mm) L=950mm ID=0.075" (1.90mm) (5.7F)

Maximum Guidewire OD	0.036"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.04mL
4mm	0.08mL
5mm	0.12mL
6mm	0.17mL
7mm	0.25mL
8mm	0.35mL
Maximum Balloon Volume	1.0mL

Макет маркировки (увеличенно): Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 8F (внешний диаметр 2,6 мм), длина 950 мм

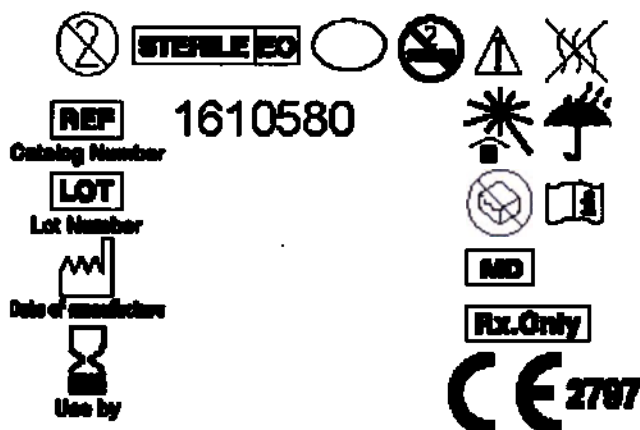

Distributed by:
MicroTherapeutics, Inc.
d/b/a ev3 Neurovascular
9775 Toledo Way
Irvine, CA 92618
USA
Phone: 949-837-3700
Fax: 949-837-2044
www.medtronic.com

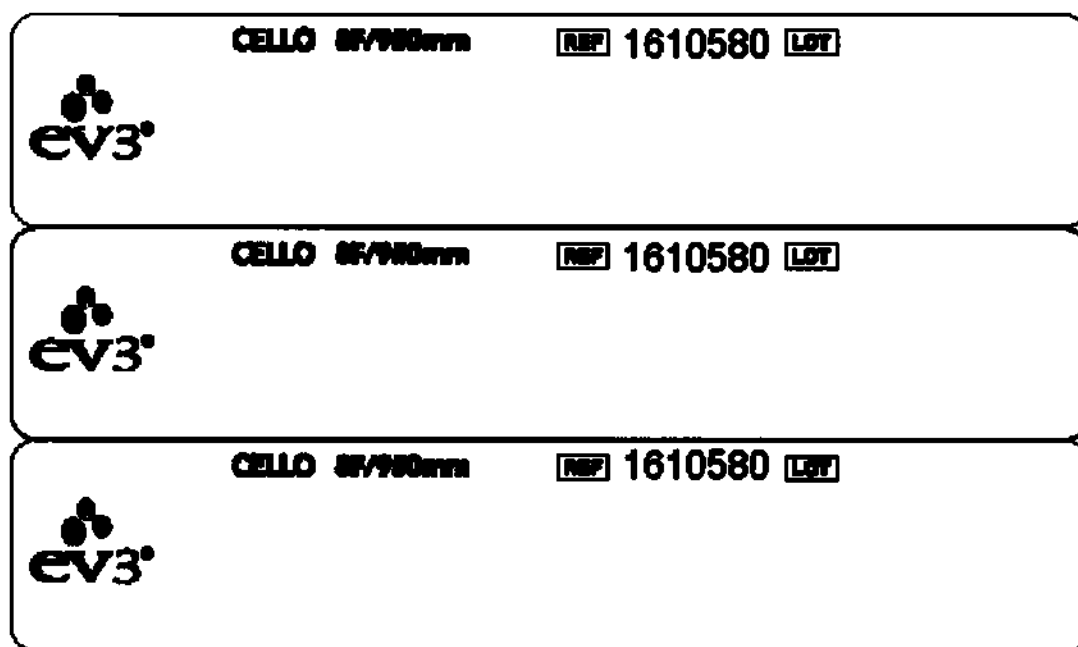

UDI

Manufacturer
Fuji Systems Corporation
Shirakawa Plant

200-2 Aza-Ohira, Odakura, Nishigo,
 Nishi-Shirakawa Gun, Fukushima
 961-8041 Japan

Authorized Representative in EU

EC REP MedDevConsult GmbH

Airport Center (Building C1,
 Flughafenstrasse 52a 22335 Hamburg
 Germany
 Fax-No. +49 40 53299-100


Макет маркировки (увеличенно, продолжение): Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый

000 ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Cello, размер 8F (внешний диаметр 2,6 мм), длина 950 мм



Balloon Guide Catheter
Intravascular Catheter with Cuff

- Cathéter-guide à ballonnet
- Balloon-Führungskatheter
- Cateteri guida a palloncino
- Cateter guía con globo
- Balloonguidekatheter
- Balloon Guide Catheter
- Cateter-guia com Balão
- Balloon-kateteri
- Balloonguidekatheter
- Объёмный направляющий катетер
- Balloonový vodící katétr
- Balloonos vezető katéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balloonowy cewnik prowadzący
- Balloon-Kilavuz Kateter
- Balloonguidekatheter
- Balloonový vodící katéter
- Cateter cu ghidaj cu balon
- Балонный направляющий катетер
- Balloonliga juhkekatheter
- Balloonki uvođni kateter
- Balloonis kreiðiamasís kateteris
- Vadikalai paredzēts balonkatērs
- Balloonki uvođni kateter
- Cateter-guia com Balão
- Ống thông cân thiệp đầu gần bóng
- Балонный уводни катетер
- Шлапунь балоннагоу катетер
- Balloon kateter za mluva vodni
- Kateter Fernando Balon

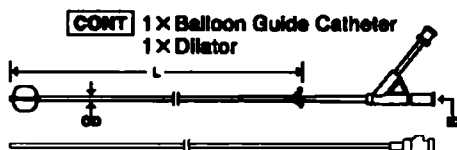


OD= 9F (3.0mm) L= 920mm ID=0.085" (2.15mm) (6.5F)

Maximum Guidewire OD	0.036"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.04mL
4mm	0.07mL
5mm	0.12mL
6mm	0.18mL
7mm	0.26mL
8mm	0.36mL
Maximum Balloon Volume	1.0mL



Distributed by:
 MicroTherapeutics, Inc.
 d/b/a ev3 Neurovascular
 9776 Toledo Way
 Irvine, CA 92618
 USA
 Phone: 949-837-3700
 Fax: 949-837-2044
 www.medtronic.com

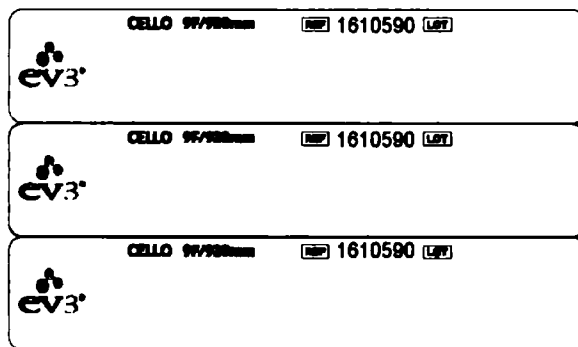

UDI

Manufactured by
Fuji Systems Corporation
 Shizuoka Plant
 326-7 Aoi-Ohira, Oshika, Shizuoka
 416-8502 Japan
 Phone: 81-54-852-1111

Authorized Representative in EU
MedDevConsult GmbH
 Airport Center Building C1
 Flughafenstrasse 52a 22329 Hamburg
 Germany
 Fax: +49 40 53279-100

Макет маркировки: Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм

9F 920
mmL

CELLO™ Balloon Guide Catheter

REF 1610590 LOT
Catalog Number Lot Number

Batch number

Use by

Distributed by **ev3**




9F 920
mmL

CELLO™

Balloon Guide Catheter
Intravascular Catheter with Cuff


- Cathéter-guide à ballonnet
- Ballon-Führungskatheter
- Catetere guida a palloncino
- Catéter guía con globo
- Ballonguldekater
- Ballon Gids Katheter
- Cateter-guia com Balão
- Ballonki-katetri
- Ballonguldekater
- Οδηγός Καθετήρας με Μπαλόνι
- Balónkový vodič katéter
- Balonos vezető katéter
- Баллонный направляющий катетер
- Balonowy cewnik prowadzący
- Balon Kilavuz Kateter
- Ballongledekater
- Balónkový vodič katéter
- Cateter cu ghidaj cu balon
- Водещ балонен катетер
- Balloniga juhtekateeter
- Balonski uvodni kateter
- Balioninis kreipiamasis kateteris
- Vadīšanai paredzēts balonkatetrs
- Balonski vodilni kateter
- Cateter-guia com Balão
- Ống thông can thiệp đầu gần bóng
- Балонски уводни катетер
- Шарлы бағыттағыш катетер
- Балон катетер за жила водич
- Kateter Pemandu Balon

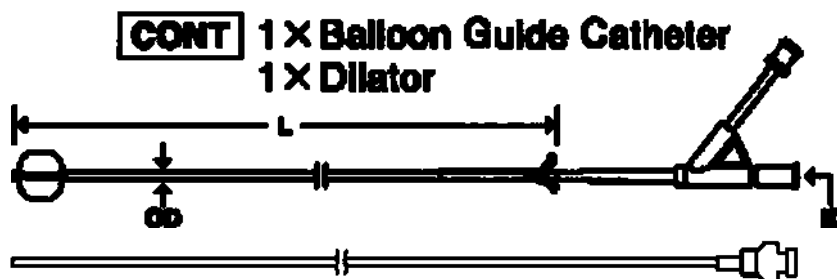

OD= 9F (3.0mm) L= 920mm ID=0.085" (2.15mm) (6.5F)

Maximum Guidewire OD	0.036"
Balloon Diameter	Recommended Balloon Volume
3mm	0.04mL
4mm	0.07mL
5mm	0.12mL
6mm	0.18mL
7mm	0.26mL
8mm	0.36mL
Maximum Balloon Volume	1.0mL

Макет маркировки (увеличенно): Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм

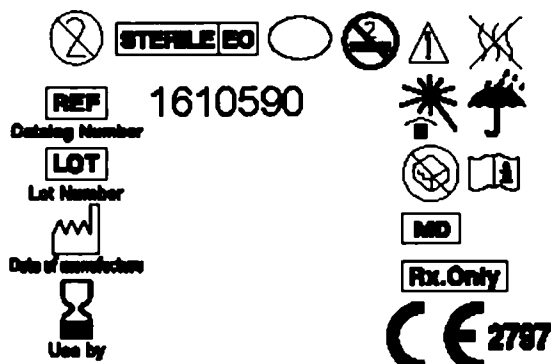

Distributed by:
MicroTherapeutics, Inc.
d/b/a ev3 Neurovascular
9775 Toledo Way
Irvine, CA 92618
USA
Phone: 949-837-3700
Fax: 949-837-2044
www.medtronic.com

CELLO 9F/920mm	REF 1610590	LOT
ev3		
CELLO 9F/920mm	REF 1610590	LOT
ev3		
CELLO 9F/920mm	REF 1610590	LOT
ev3		

UDI

Manufacturer
Fuji Systems Corporation
Shirakawa Plant
200-2 Aza-Onira, Odakura, Nishigo,
Nishi Shirakawa Gun, Fukushima
961-8061 Japan

Authorized Representative in EU
EC REP MedDevConsult GmbH
Airport Center (Building C),
Flughafenstrasse 52a 22335 Hamburg
Germany
Fax.-No. +49 40 53299-100

Макет маркировки (увеличенно, продолжение): Катетер баллонный направляющий (внутрисосудистый катетер с манжетой) Cello, размер 9F (внешний диаметр 3,0 мм), длина 920 мм



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
37 листа(ов)