

Фотографии медицинского изделия:

Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «Флюарком», в следующих исполнениях: 12ФК1, 12ФК1-01, с принадлежностями
Производство: Акционерное общество «Актобрендтген» (АО «Актобрендтген») Республика Казахстан, 030012 г. Актобе, проспект Санкибай Батыра 24/К.

Список фото:

- I. Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «Флюарком» вариант исполнения, 12ФК1(Рис.1):
 1. Кабина. (Рис.1)
 2. Приемник рентгеновского изображения. (Рис.1)
 3. Кнопка управления. (Рис.1)
 4. Моноблок. (Рис.1)
 5. Диафрагма. (Рис.1)
 6. Компьютер (в составе: системный блок ACER или hp или Dell или Apple или Intel или Samsung; монитор Acer или hp или Dell или Apple или Intel или Samsung; манипулятор типа «мышь») - 2 шт. (Рис.1)
 7. Устройство генераторное(Рис.1)
 8. Стол. (Рис.1)
 9. Блок стыковки. (Рис.1)
 10. Кабель соединительный - 10 шт. (Рис.3)
 11. Кабель высоковольтный. (Рис.3)
 12. Щиток сетевой (с кабелем). (Рис.1)
 13. Кабель RJ45 UTP5 Cat FTP с коннекторами- 2шт. (Рис.2)
- II. Принадлежности к аппарату рентгеновскому флюорографическому стационарному цифровому 12ФК1 «Флюарком» вариант исполнения, 12ФК1(Рис.1):
 14. Принтер Canon или hp или Samsung или Xerox или Ricoh или Kyocera. (Рис.1)
 15. Программное обеспечение «Альфа» на CD-диске. (Рис.1)
 16. Блок силовой. (Рис.1)
 17. Кронштейн – 3шт. (Рис.1)
 18. Труба. (Рис.1)
 19. Фартук гонадной защиты. (Рис.1)
 20. Фартук для защиты щитовидной железы. (Рис.1)
 21. Паспорт аппарата рентгеновского. (Рис.1)
 22. Паспорт рентгеновской трубки. (Рис.1)
 23. Руководство по эксплуатации.

III. Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1

«Флюарком» вариант исполнения, 12ФК1-01(Рис.1,2, 3):

1. Кабина. (Рис.2)
 2. Приемник рентгеновского изображения. (Рис.2)
 3. Кнопка управления. (Рис.3)
 4. Моноблок. (Рис.2)
 5. Диафрагма. (Рис.2)
 6. Компьютер (в составе: системный блок ACER или hp или Dell или Apple или Intel или Samsung; монитор Acer или hp или Dell или Apple или Intel или Samsung; манипулятор типа «мышь») - 2 шт. (Рис.1)
 7. Устройство генераторное(Рис.2)
 8. Стол. (Рис.2,3)
 9. Блок стыковки. (Рис.2)
 10. Кабель соединительный - 10 шт. (Рис.3)
 11. Кабель высоковольтный. (Рис.3)
 12. Щиток сетевой (с кабелем). (Рис.2)
 13. Кабель RJ45 UTP5 Cat FTP с коннекторами – 2шт. (Рис.2)
- IV. Принадлежности к аппарату рентгеновскому флюорографическому стационарному цифровому 12ФК1 «Флюарком» вариант исполнения, 12ФК1-01:
14. Принтер Canon или hp или Samsung или Xerox или Ricoh или Kyocera. (Рис.1)
 15. Программное обеспечение «Альфа» на CD-диске. (Рис.1)
 16. Блок силовой. (Рис.1)
 17. Кронштейн – 3шт. (Рис.1)
 18. Труба. (Рис.1)
 19. Фартук гонадной защиты. (Рис.1)
 20. Фартук для защиты щитовидной железы. (Рис.1)
 21. Паспорт аппарата рентгеновского. (Рис.1)
 22. Паспорт рентгеновской трубки. (Рис.1)
 23. Руководство по эксплуатации.


Генеральный директор

ООО «МедТехКомплект»




А.Г. Трофименко

Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «Флюарком», в следующих исполнениях: 12ФК1, 12ФК1-01, с принадлежностями

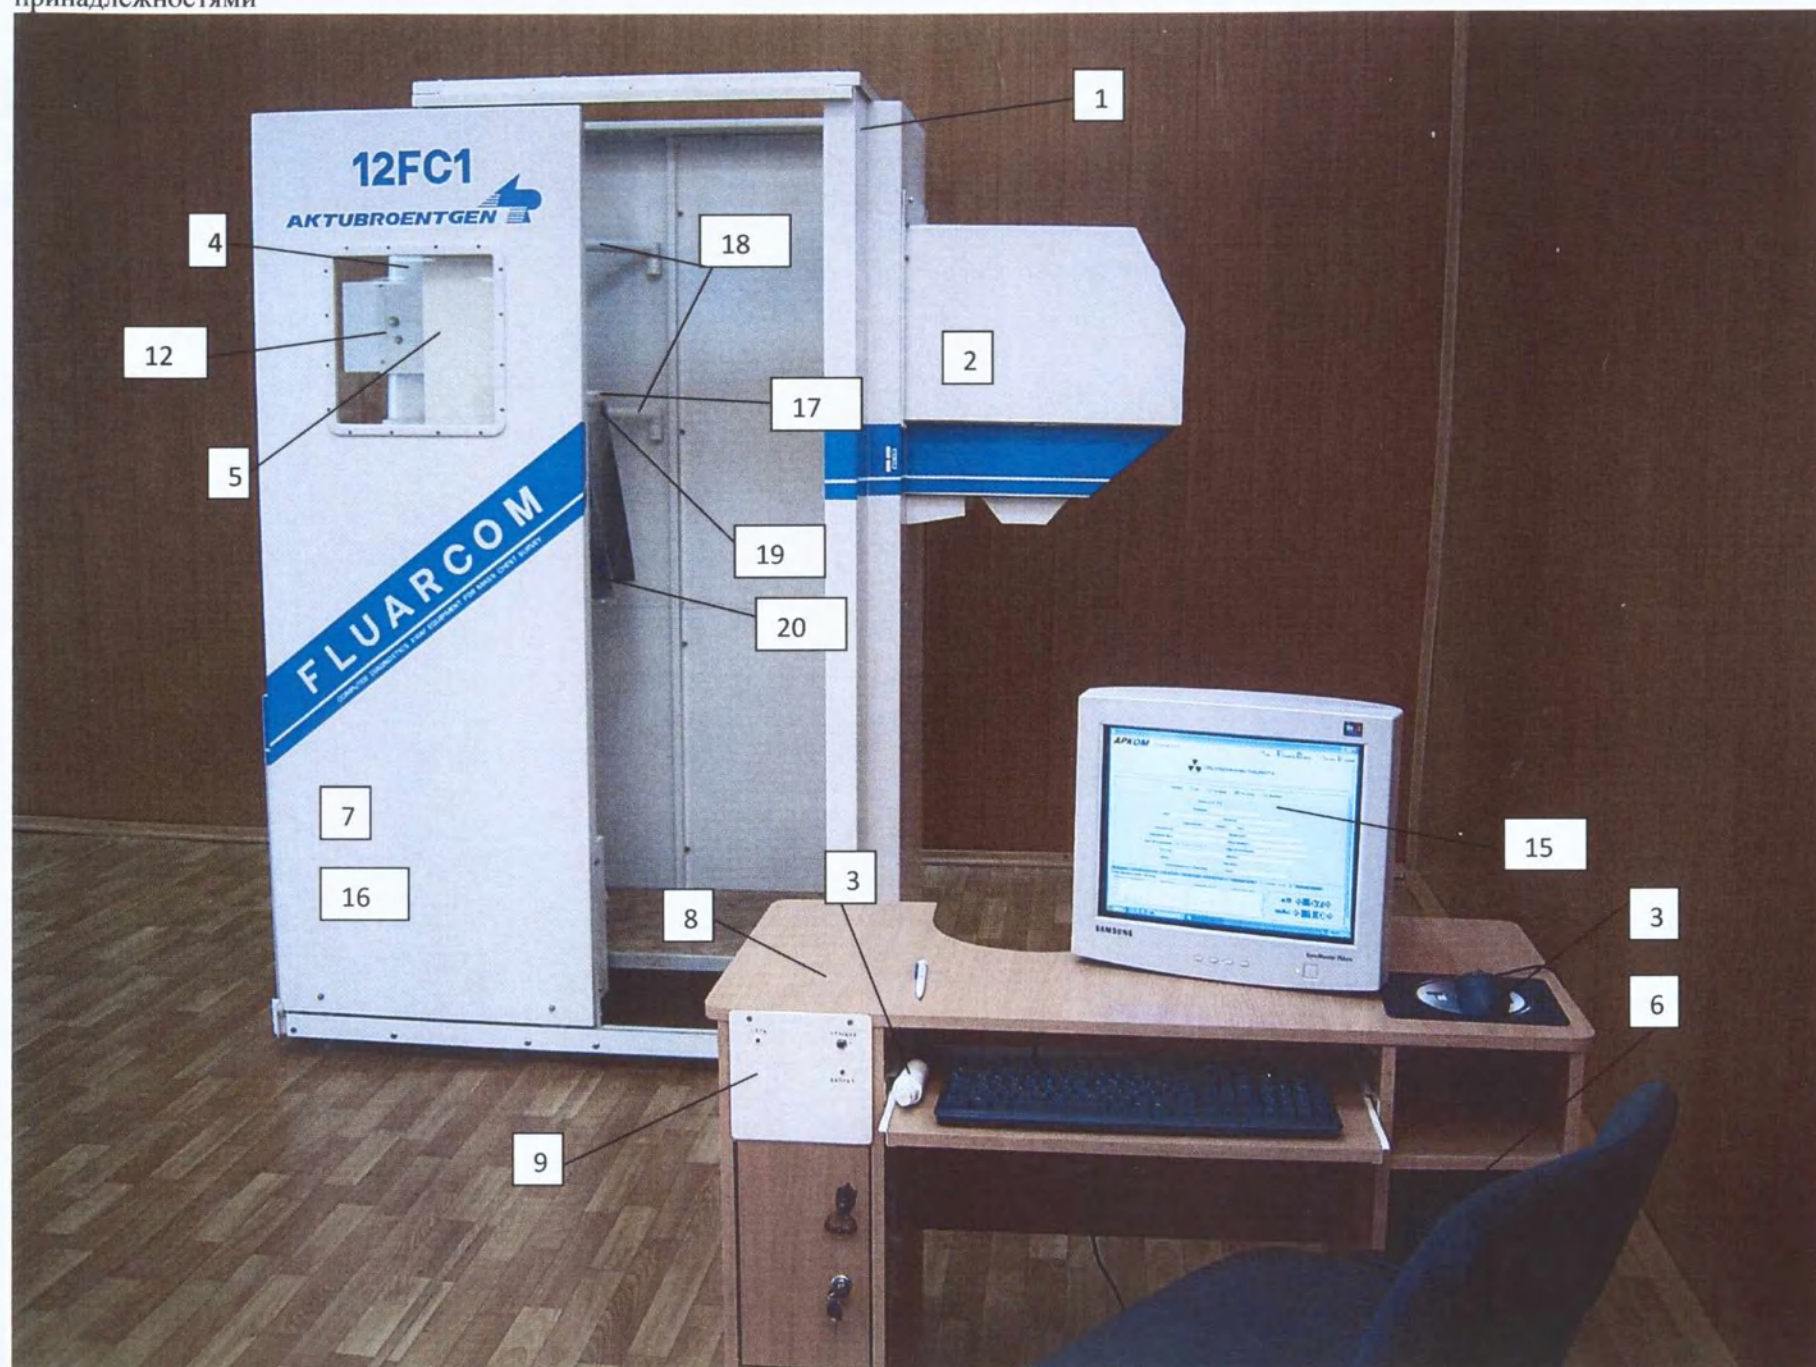


12ФК1 (Рис.1)

аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «Флюарком», в следующих исполнениях: 12ФК1, 12ФК1-01, с принадлежностями

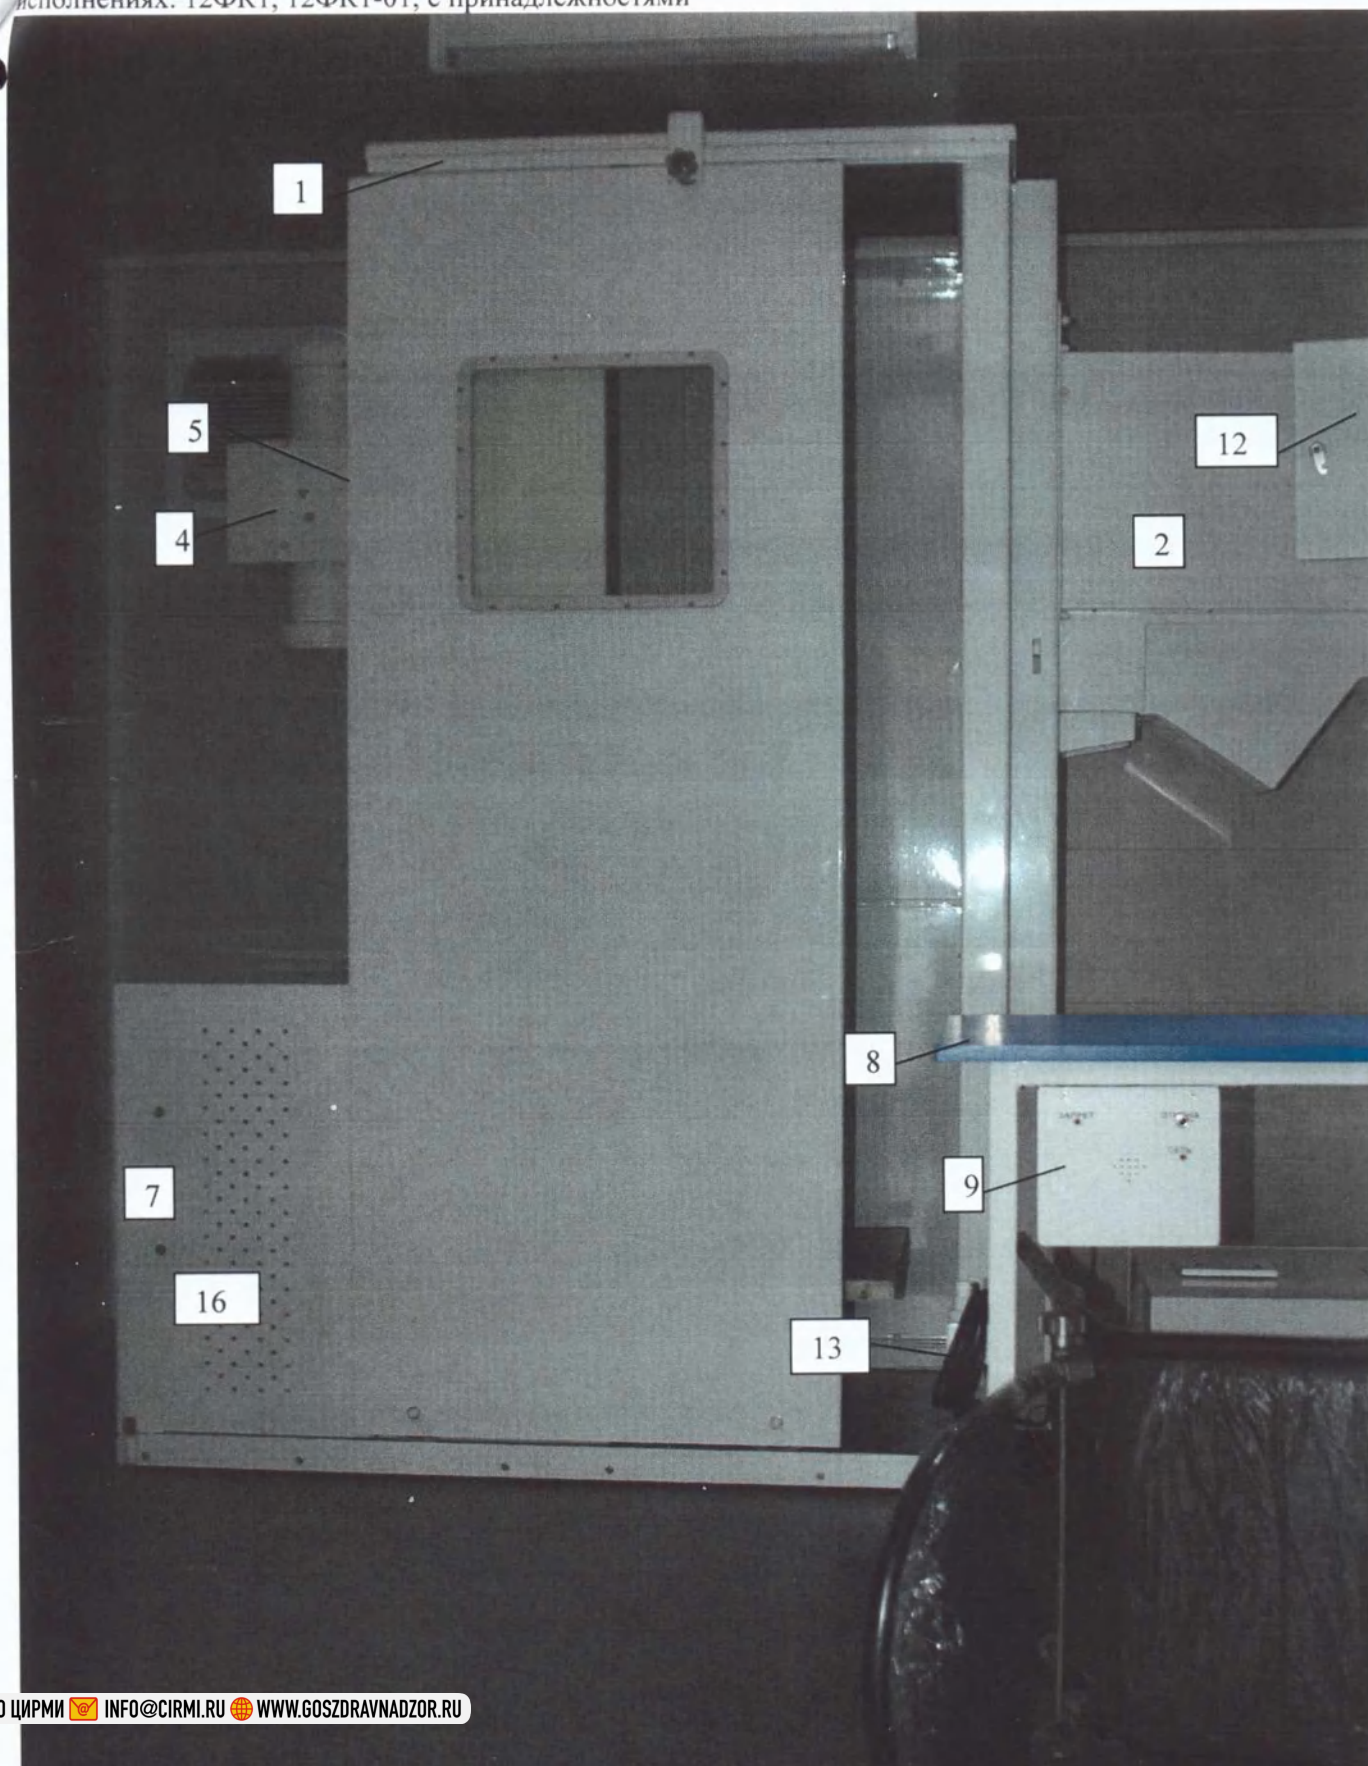

апарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой 12ФК1 «Флюарком», в следующих исполнениях: 12ФК1, 12ФК1-01, с принадлежностями

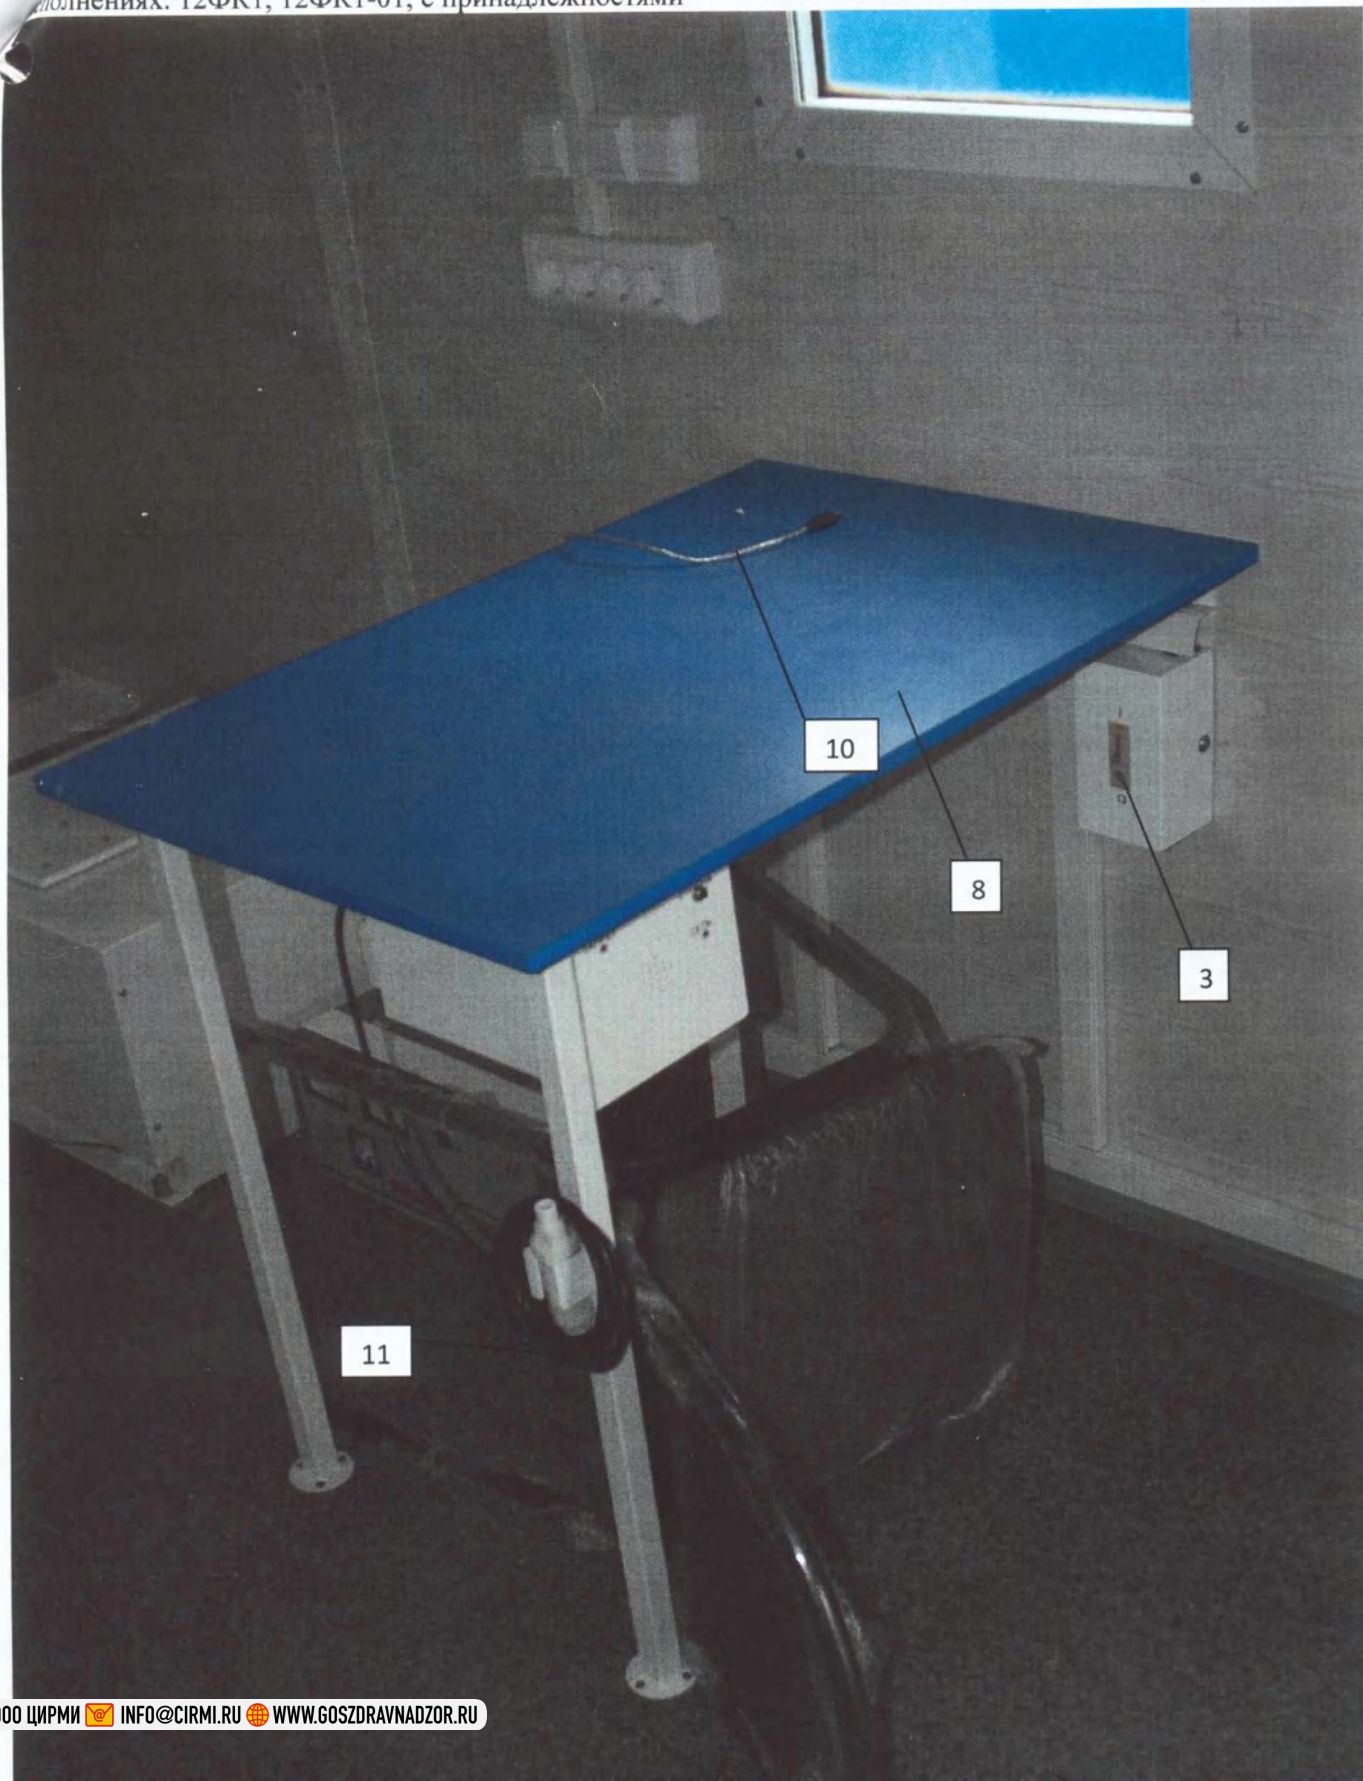

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ лист(ов)
Генеральный директор
"МедТехКомплект"
А.Г. Трофименко

