

**Фотографические изображения
медицинского изделия:**

«Наркозная система с принадлежностями, варианты исполнения
A8, A9.»



Наркозная система с принадлежностями, вариант исполнения А8, основной блок


mindray 迈瑞



Наркозная система с принадлежностями, вариант исполнения, А8, основной блок и кабель питания




Наркозная система с принадлежностями, вариант исполнения, A9, основной блок

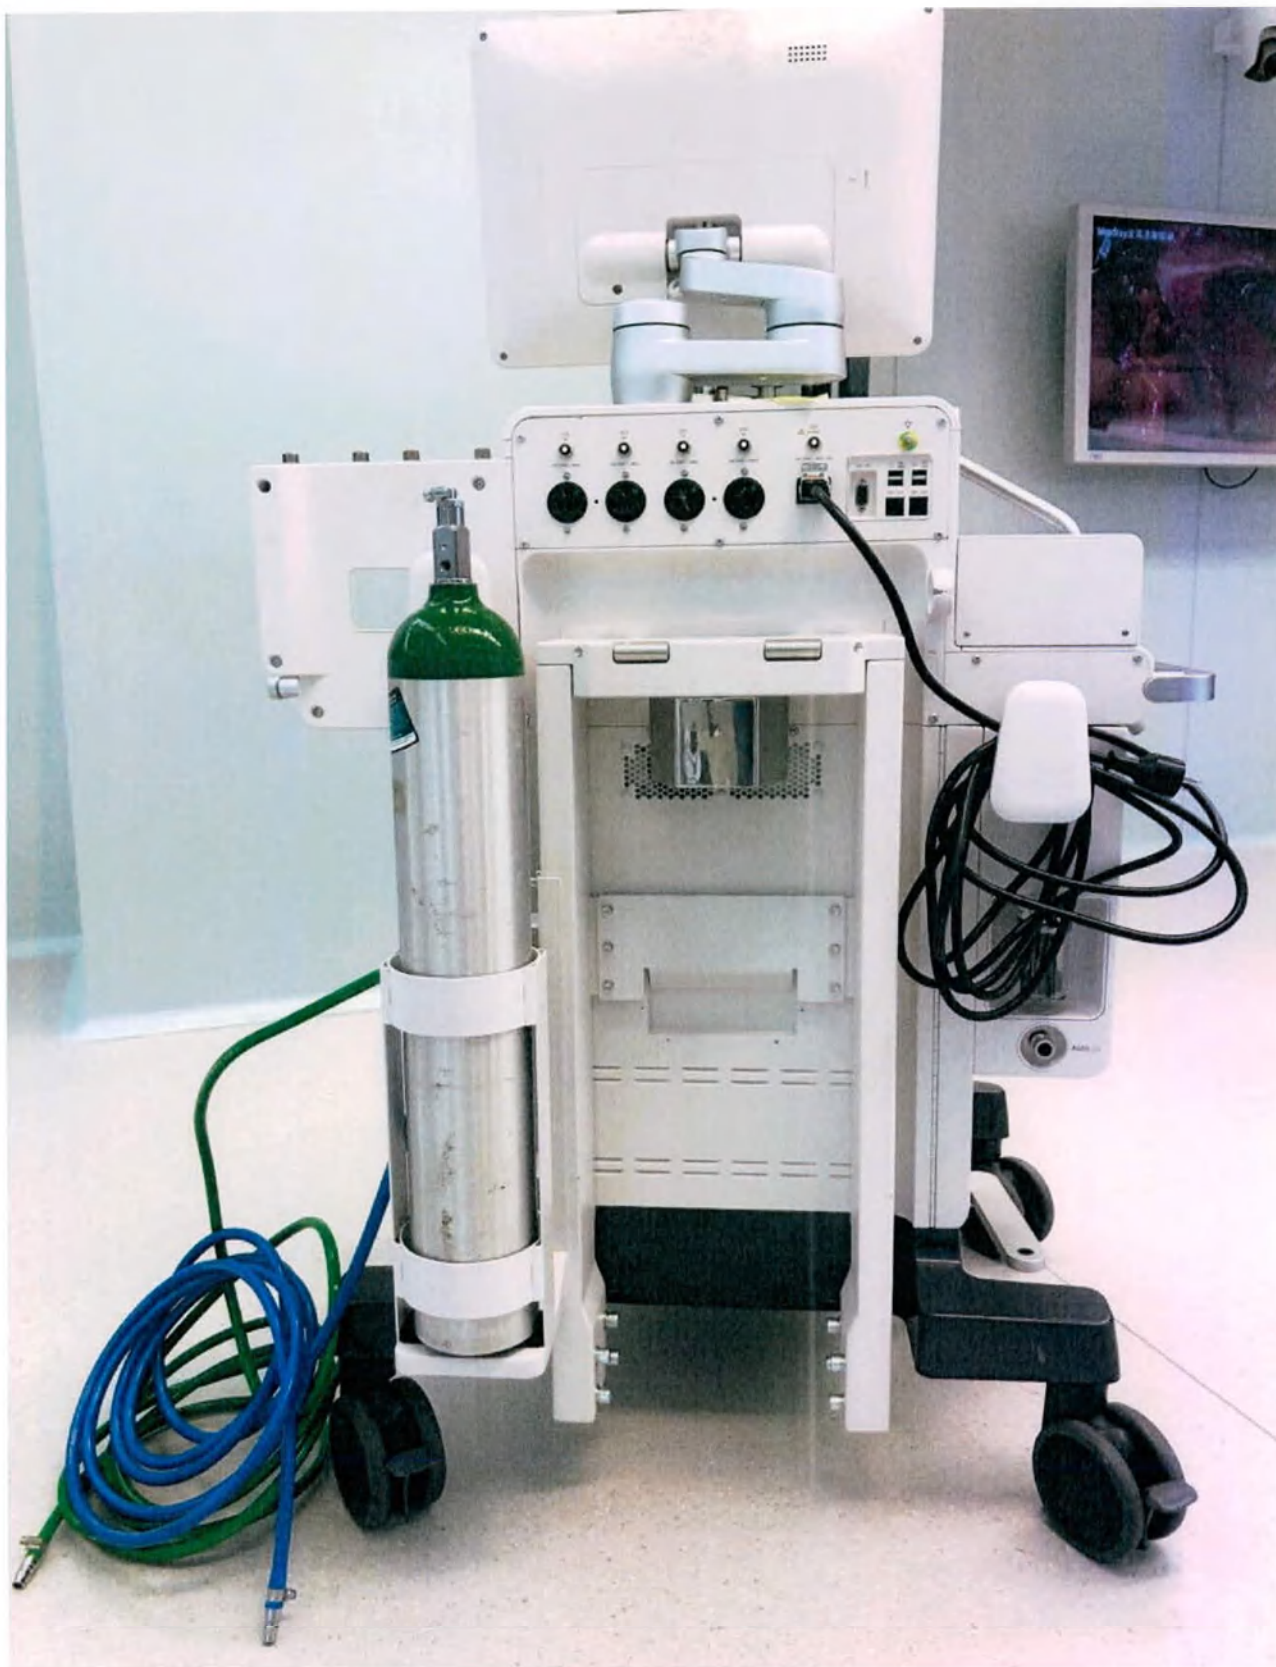

Наркозная система с принадлежностями, вариант исполнения, А9, основной блок и кабель питания



Кабель питания- не более 5 шт

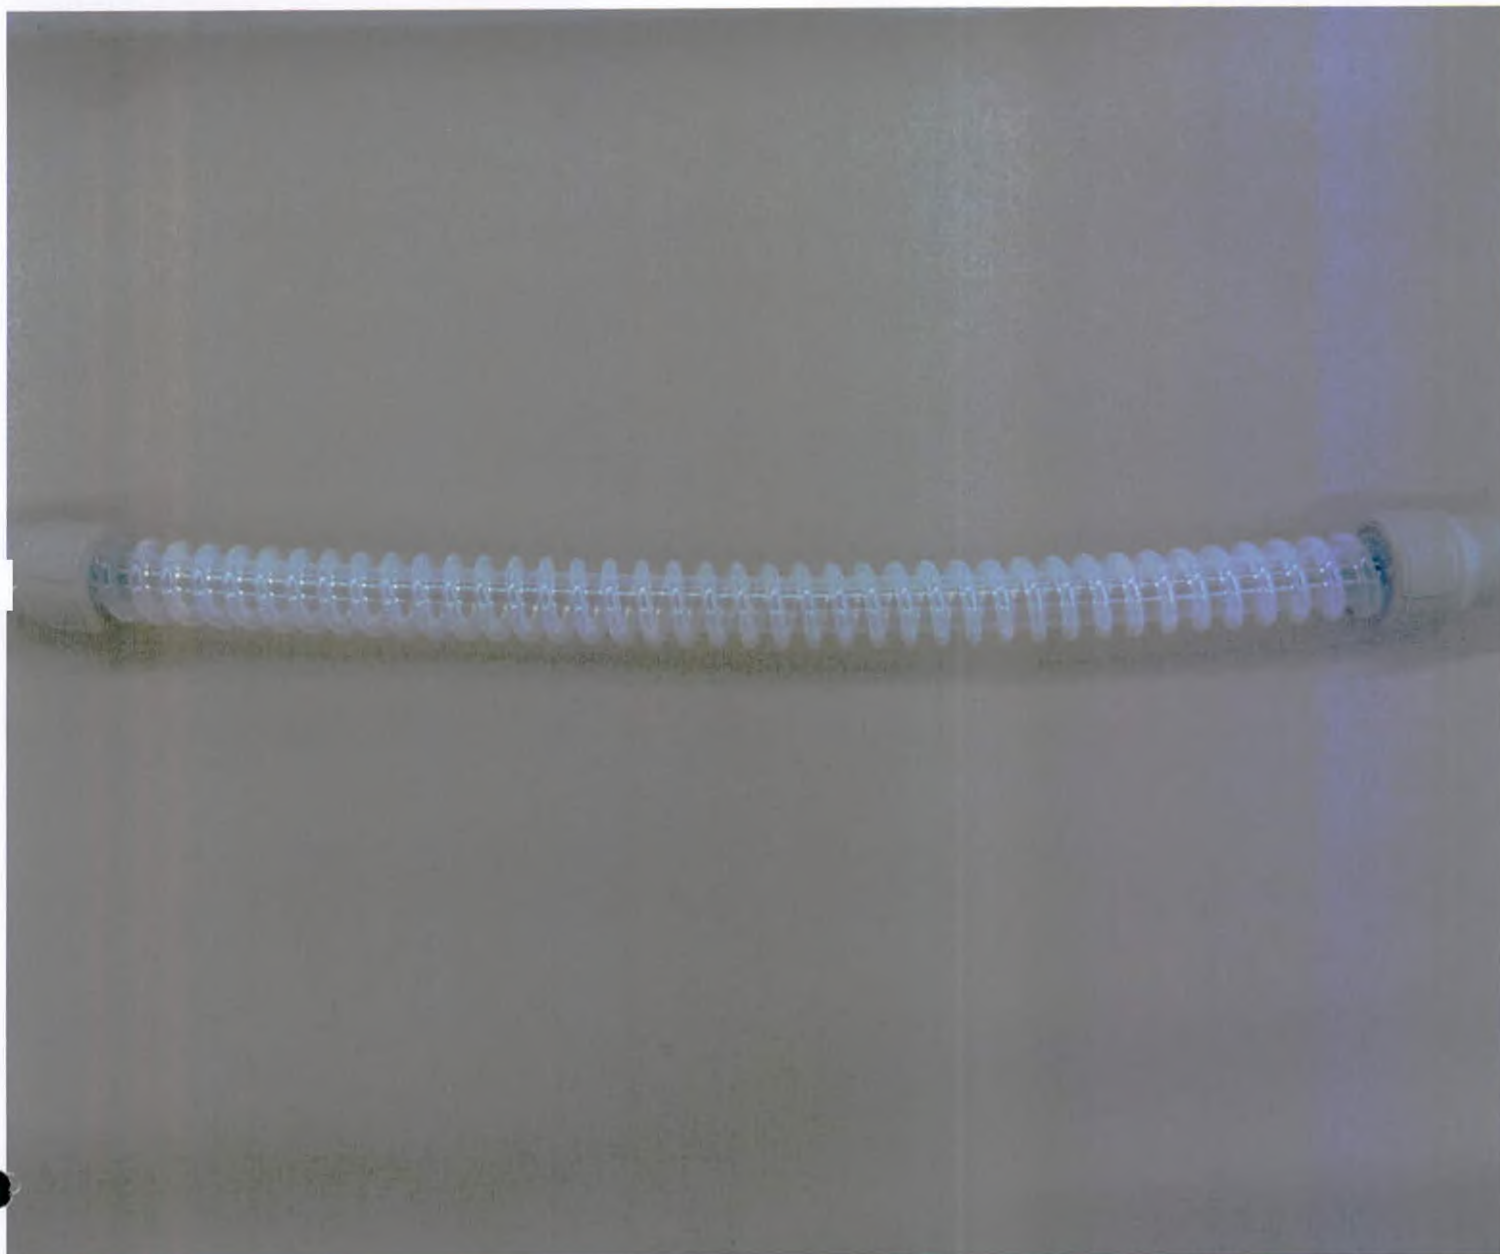

Трубка дыхательная силиконовая для взрослых, гладкоствольная 0.45 м - не более 30 шт. (при необходимости)



Маска силиконовая (размер: 0,1,2,3,4,5) - не более 30 шт. (при необходимости)




Мешок дыхательный, силиконовый (размер: 0.5 л, 1 л, 2 л, 3 л)- не более 30 шт. (при необходимости)



Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для детей, гладкоствольный не более 30 шт. (при необходимости) в составе:

- трубка дыхательная силиконовая гладкоствольная для детей/грудных детей, 1.5 м (2шт)
- мешок дыхательный, силиконовый 1 л (1шт)
- маска дыхательная силиконовая для детей, размер 2 (1шт)
- коннектор Y-образный (1шт)
- коннектор L-образный (1шт)

 ООО ЦПМИ  INFO@CPMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

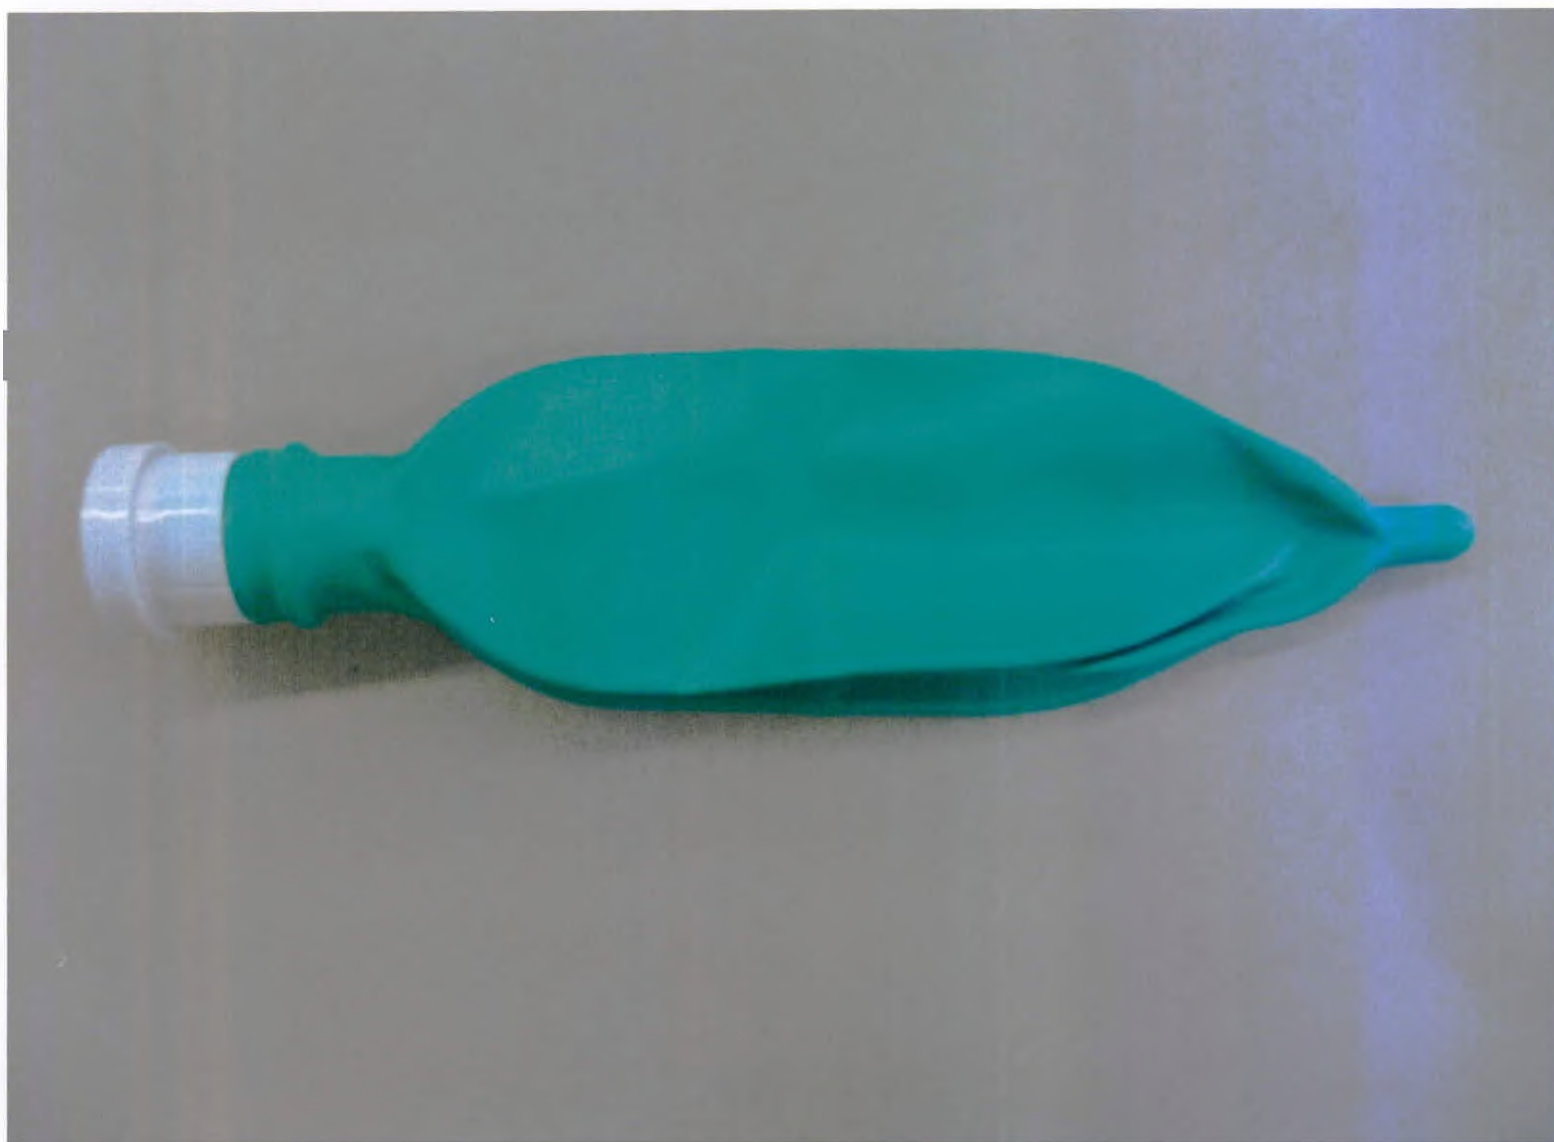

Мешок дыхательный безлатексный, одноразовый (размер 0.5 л, 1 л, 2 л, 3 л) – не более 30 шт.
(при необходимости)



Контур дыхательный, одноразовый для взрослых - не более 30 шт. (при необходимости), в наборе:

- контур дыхательный, взрослый, с Y-образным переходником, 1.5 м - 1 шт
- коннектор L-образный - 1 шт
- коннектор прямой - 1 шт
- фильтр бактериальный - 1 шт
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт
- мешок дыхательный, безлатексный, одноразовый, 3 л - 1 шт



Контур дыхательный, одноразовый для детей - не более 30 шт. (при необходимости), в наборе:

- контур дыхательный, детский, с Y-образным переходником, 1.5 м - 1 шт
- коннектор L-образный - 1 шт.-
- коннектор прямой - 1 шт.
- фильтр бактериальный - 1 шт.
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.
- мешок дыхательный, безлатексный, одноразовый, 1 л - 1 шт.



Фильтр дыхательный, одноразовый – не более 100 шт. (при необходимости)



Контур дыхательный взрослый (тип Mapleson C)- не более 30 шт. (при необходимости), в составе:

- трубка дыхательная 1.8м - 1 шт
- коннектор 22/15М - 1 шт
- мешок дыхательный 2 л - 1 шт
- APL клапан - 1 шт



Контур дыхательный детский (Т-образная система) - не более 30 шт. (при необходимости),
в составе:

- трубка дыхательная 1.8 м - 1 шт
- коннектор 22/15М - 1 шт.;
- мешок дыхательный 0,5 л - 1 шт
- APL клапан - 1 шт



Набор пищеводного катетера в составе:

- Катетер пищеводный с баллоном – 1 шт
- Проводник – 1 шт
- Шприц – 1 шт
- Линия соединительная с краном – 1 шт

 ООО ЦПМИ  INFO@CPMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



18. Комплект одноразовых трубок с обогревом для высокоточной оксигенотерапии - не более 30 шт. (при необходимости), в составе:

- трубка 1 метр- 1 шт
- трубка 1.5 метра- 1 шт



Увлажнитель LIKE SH330, европейский стандарт- не более 30 шт. (при необходимости) в наборе:

- увлажнитель
- увлажняющая камера



Канюля назальная для высокопоточной оксигенотерапии, малого размера, одноразовая—не более 30 шт. (при необходимости)



Канюля назальная для высокопоточной оксигенотерапии, среднего размера, одноразовая— не более 30 шт. (при необходимости)



Канюля назальная для высокопоточной оксигенотерапии, большого размера, одноразовая— не более 30 шт. (при необходимости)



Испаритель изофлурана Pour Fill не более 2 шт. (при необходимости)



Испаритель изофлурана Key Filler не более 2 шт. (при необходимости)



Испаритель севофлурана Pour Fill не более 2 шт. (при необходимости)



Испаритель севофлурана Key Filler не более 2 шт. (при необходимости)



Испаритель севофлурана Quick-Fil не более 2 шт. (при необходимости)



Испаритель галотана Pour Fill не более 2 шт. (при необходимости)



Испаритель галотана Key Filler не более 2 шт. (при необходимости)



Испаритель десфлурана Drager D-Vapor не более 2 шт. (при необходимости)



Испаритель севофлурана, электронный, с адаптером (для варианта исполнения А9)
не более 2 шт. (при необходимости)




Испаритель изофлурана, электронный, с адаптером (для варианта исполнения А9) не более 2 шт.
(при необходимости)



Испаритель десфлурана, электронный, Saf-T-fill (для варианта исполнения A9) не более 2 шт. (при необходимости)



Испаритель севофлурана, электронный, Quik-Fil (для варианта исполнения А9) не более 2 шт. (при необходимости)

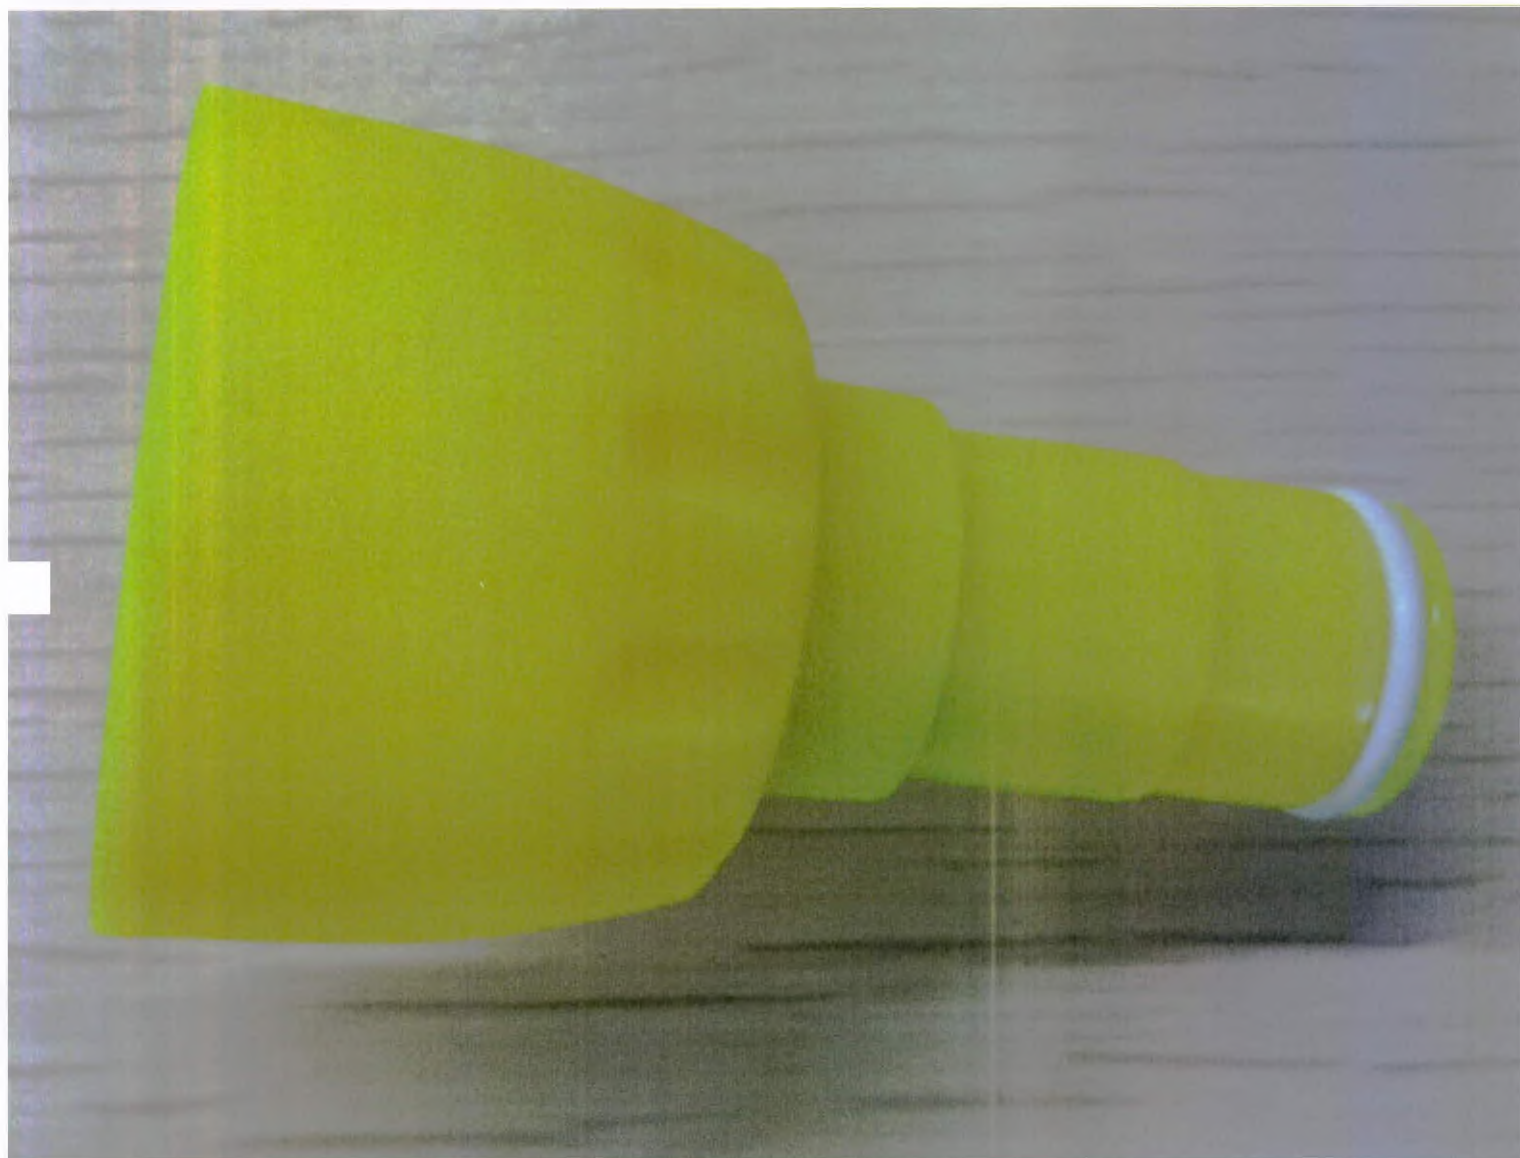

Адаптер для наполнения электронного испарителя севофлурана (для варианта исполнения А9) не более 20 шт. (при необходимости)




Адаптер для наполнения электронного испарителя изофлурана (для варианта исполнения А9) не более 20 шт. (при необходимости)



Адаптер Key Filler для галотана не более 20 шт. (при необходимости)



Адаптер Key Filler для изофлурана не более 20 шт. (при необходимости)

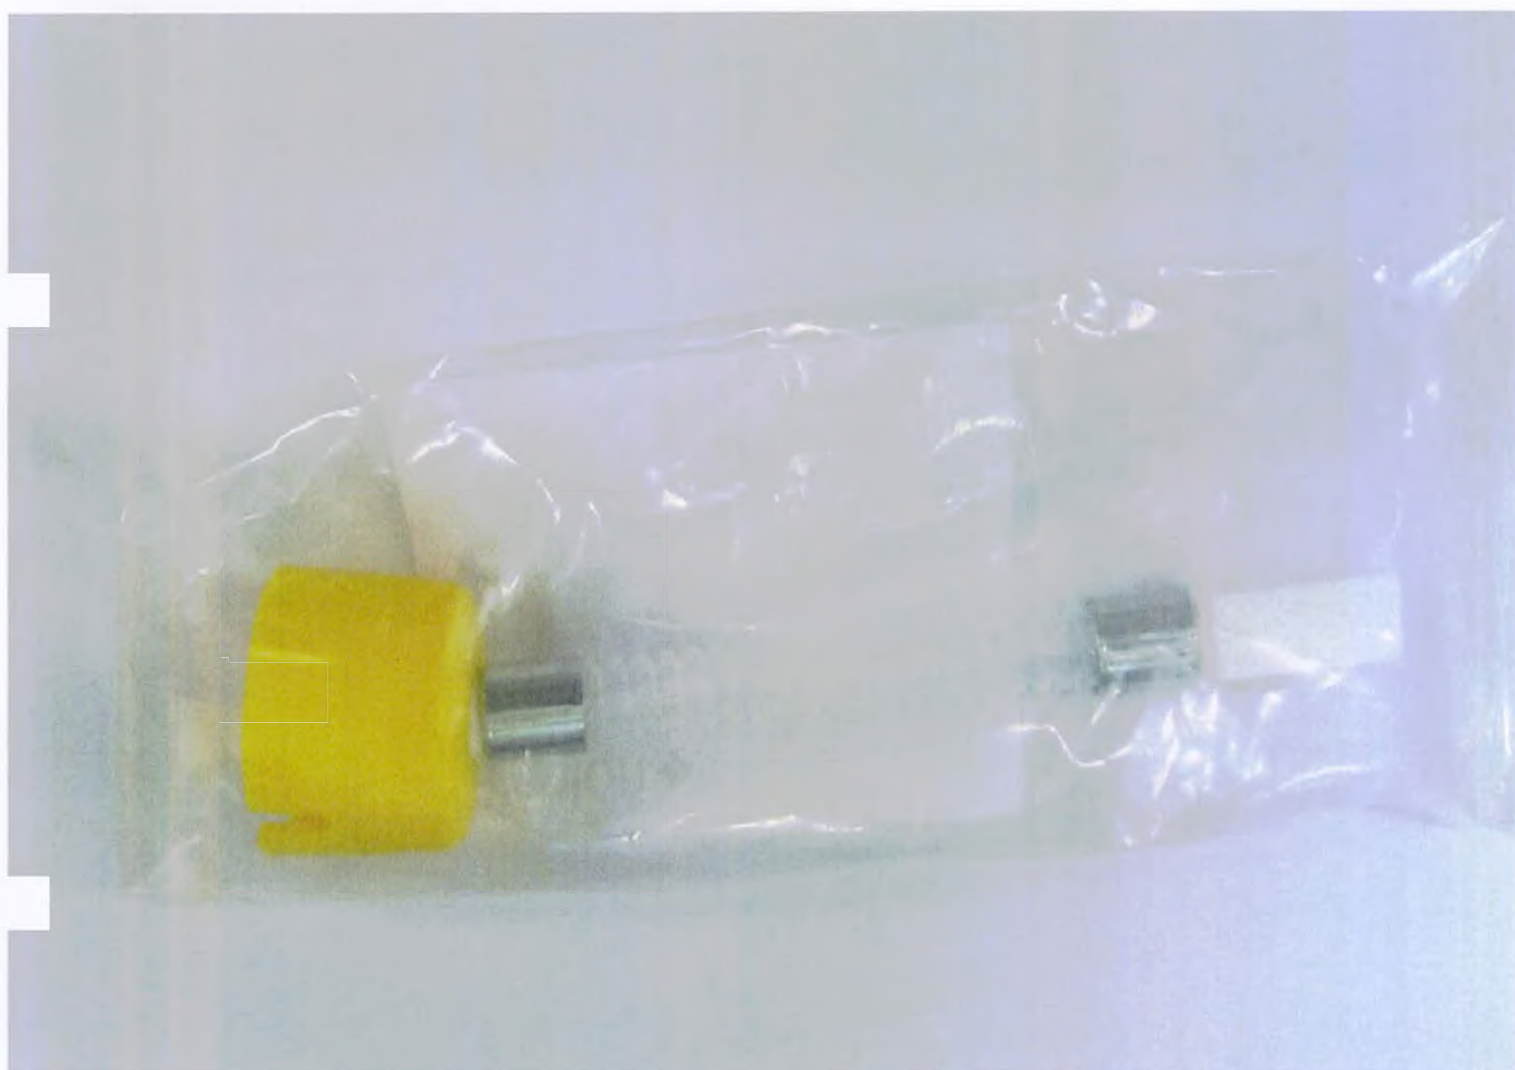

Адаптер Key Filler для севофлурана не более 20 шт. (при необходимости)



Адаптер Quick-Fil для севофлурана не более 20 шт. (при необходимости)



Адаптер Quick-Fil для слива не более 20 шт. (при необходимости)



Датчик потока инспираторный, автоклавируемый не более 20 шт. (при необходимости)



Датчик потока экспираторный, автоклавируемый не более 20 шт. (при необходимости)



Держатель для кислородного датчика не более 20 шт. (при необходимости)




Датчик кислорода не более 10 шт. (при необходимости)



Модуль газоанализа с парамагнитным датчиком кислорода не более 2 шт. (при необходимости)



Модуль газоанализа без парамагнитного датчика кислорода не более 2 шт. (при необходимости)

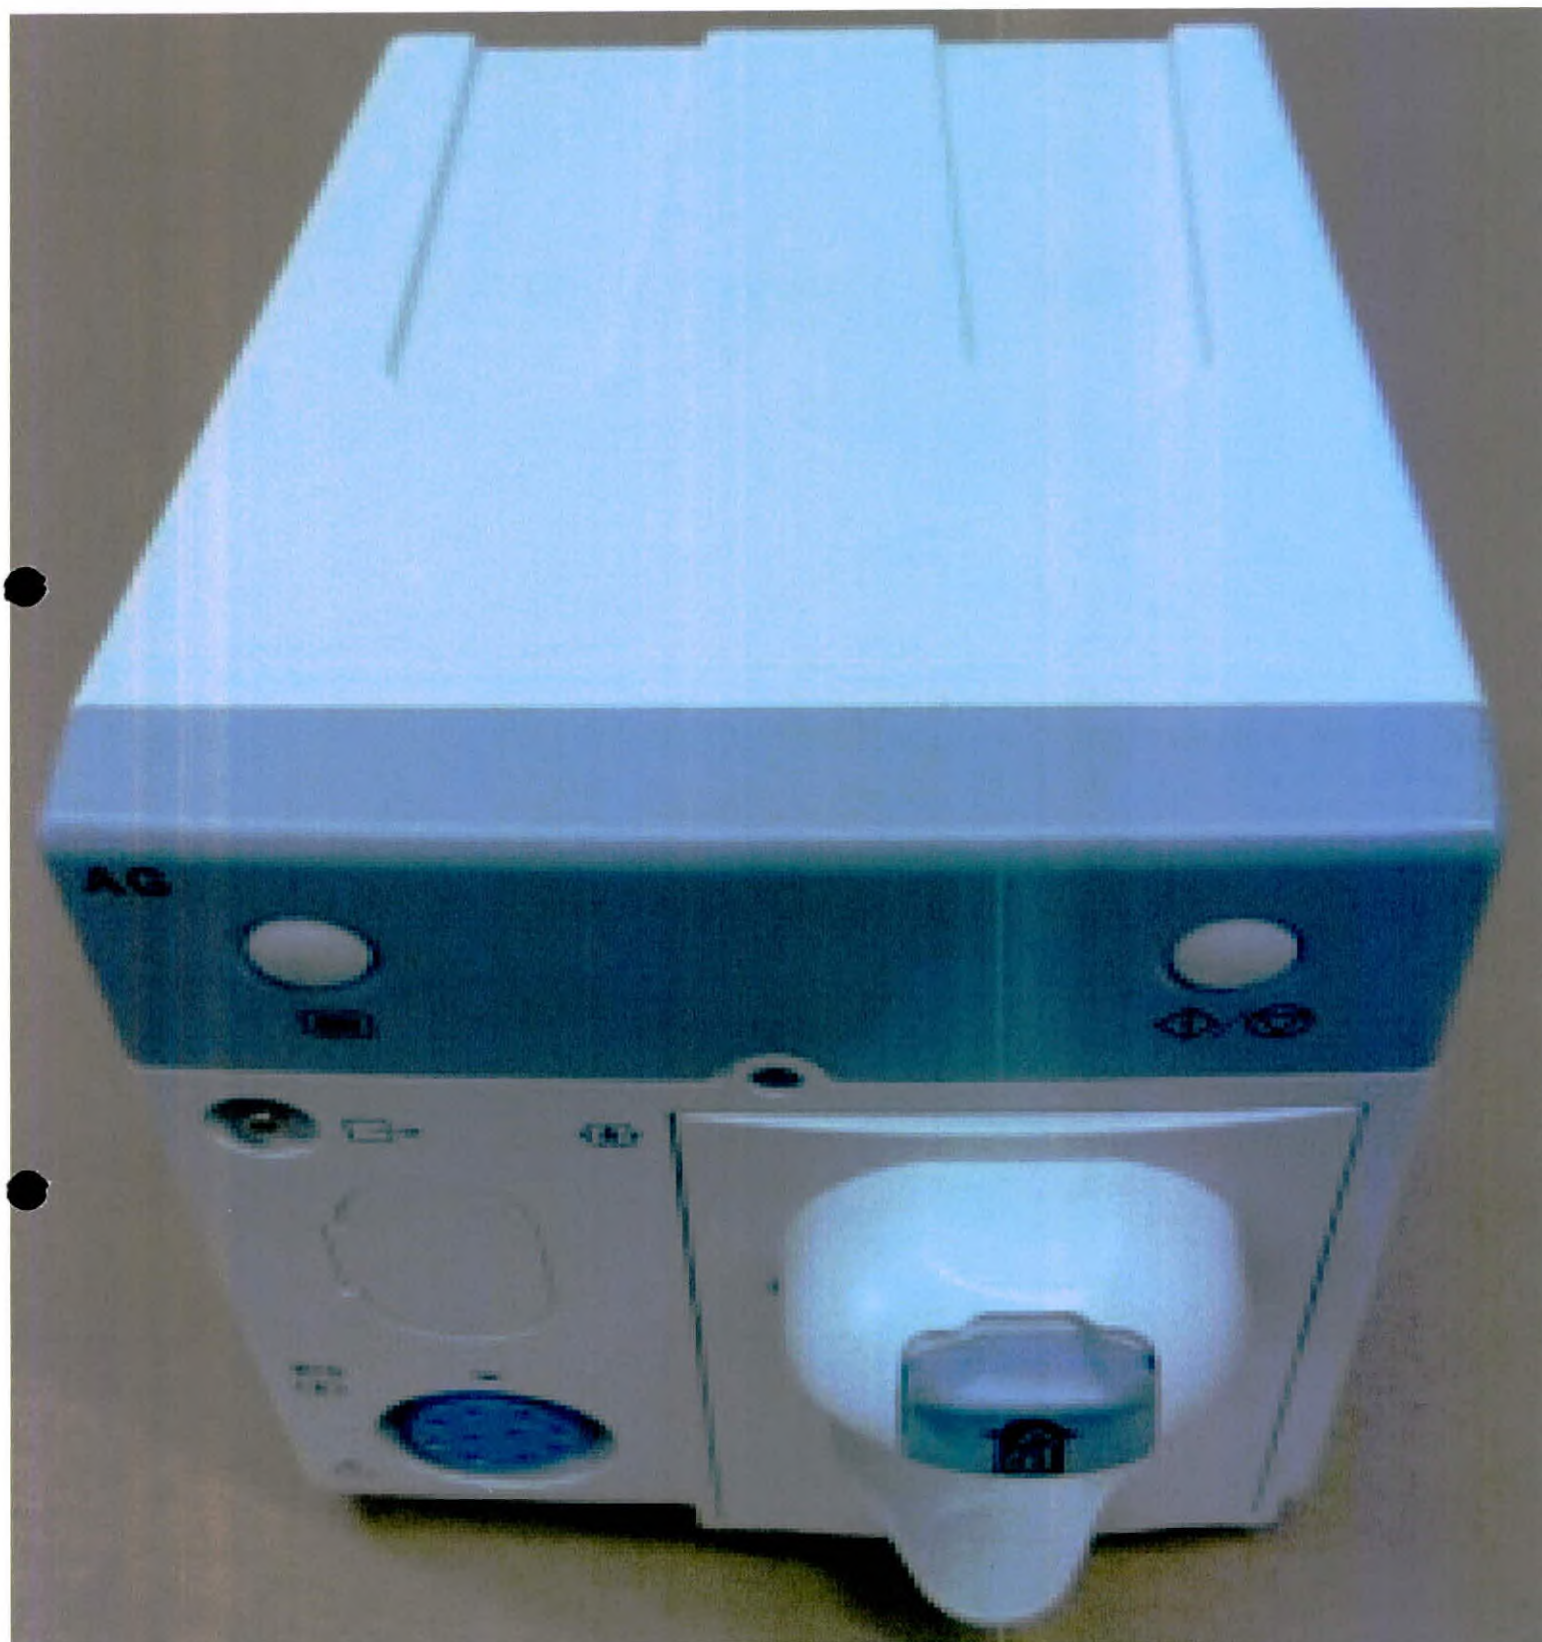

Модуль газоанализа с парамагнитным датчиком кислорода и с BIS не более 2 шт. (при необходимости)



Модуль газоанализа без парамагнитного датчика кислорода и с BIS не более 2 шт.
(при необходимости)



Набор принадлежностей для двухслотового модуля газоанализа— не более 50 шт. (при необходимости), в составе:

- адаптер прямой, взрослый/детский - 2 шт.;
- адаптер неонатальный - 2 шт.;
- влагосорбник взрослый/детский - 2 шт.;
- влагосорбник неонатальный - 2 шт.;
- линия забора пробы газа взрослая/детская - 2 шт.;
- линия забора пробы газа неонатальная - 2 шт.;
- коннектор для возврата пробы газа - 1 шт.



Модуль определения глубины анестезии (BIS) не более 2 шт. (при необходимости)



Датчик BIS для взрослых одноразовый не более 100 шт. (при необходимости)



Датчик BIS для детей одноразовый не более 100 шт. (при необходимости)




Кабель BIS измерительный не более 2 шт. (при необходимости)




Кабель BIS измерительный 4-х канальный не более 2 шт. (при необходимости)



Датчик BIS билатеральный одноразовый не более 20 шт. (при необходимости)

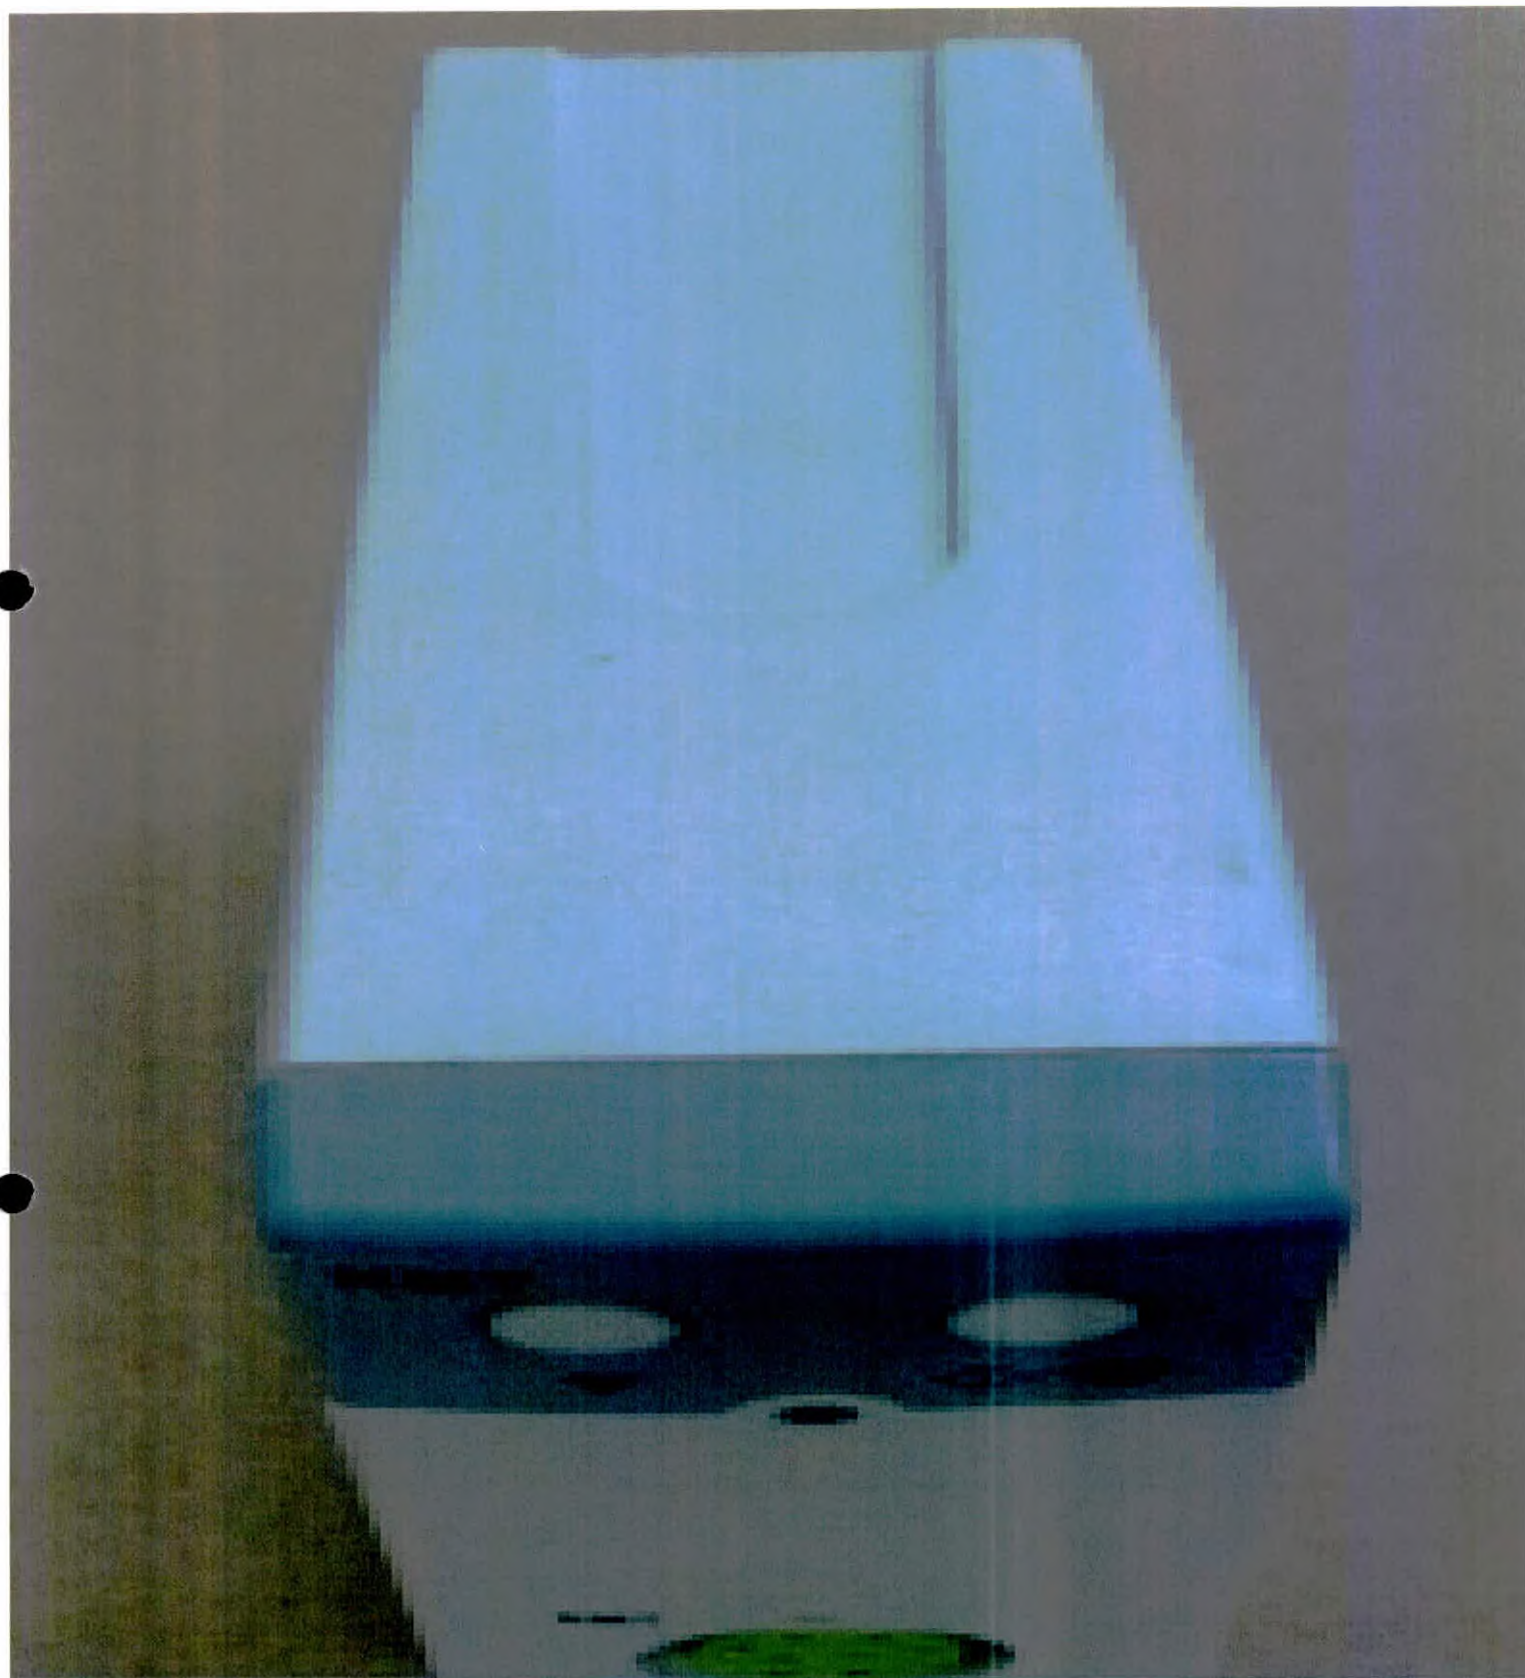


Модуль НМП не более 2 шт. (при необходимости)

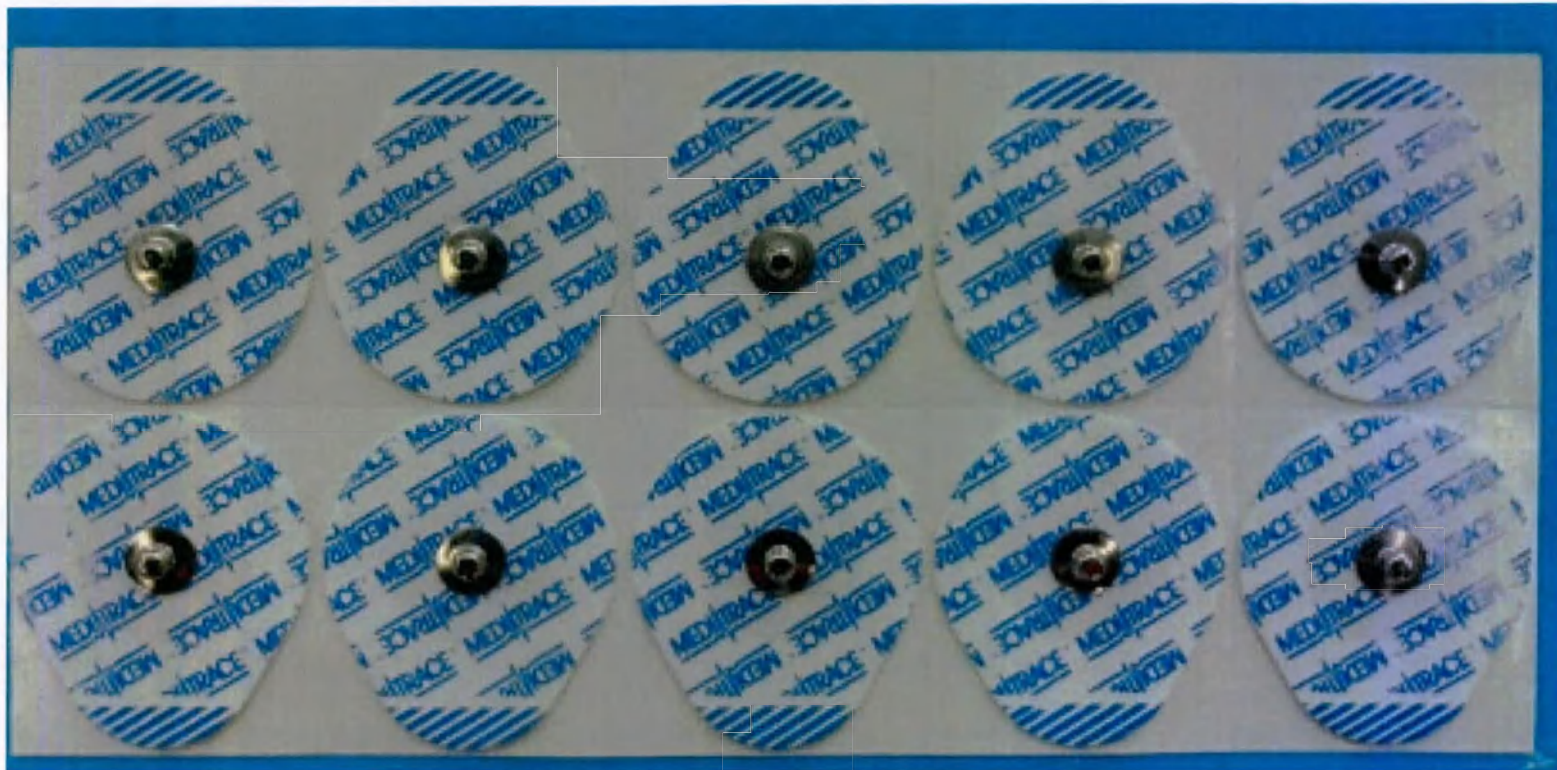

Электрод ЭКГ, взрослый, 10 штук в упаковке – не более 100 шт. (при необходимости)



Кабель НМП не более 10 шт. (при необходимости)

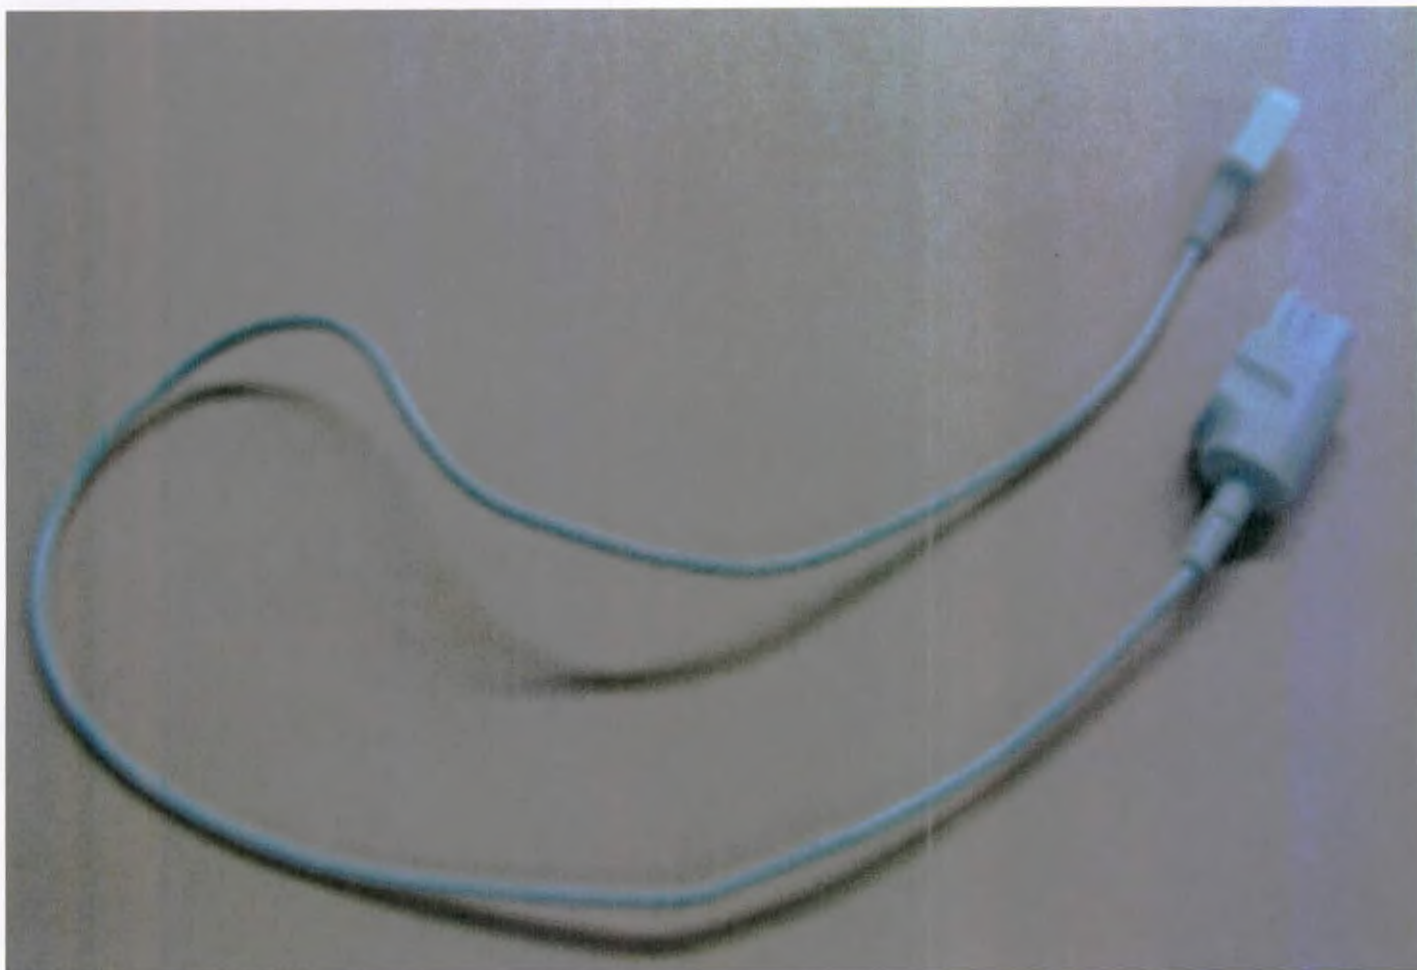

Датчик НМП с кабелем не более 10 шт. (при необходимости)



Кабель НМП стимуляционный не более 10 шт. (при необходимости)



Фиксатор для датчика НМП, одноразовый, 20 шт –не более 30 шт. (при необходимости)



Шланг активной низкотоочной системы удаления газового анестетика не более 5 шт. (при необходимости)



Трехходовой коннектор системы удаления газового анестетика не более 5 шт. (при необходимости)



Шланг пассивной системы удаления газового анестетика не более 5 шт. (при необходимости)




Набор коннекторов для системы удаления газового анестетика-не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- насадка – 1 шт.;
- муфта для насадки – 1 шт.;
- шайба уплотнительная – 1 шт.;
- хомут для трубки – 1 шт.




Магистраль высокого давления для вакуума не более 5 шт. (при необходимости)

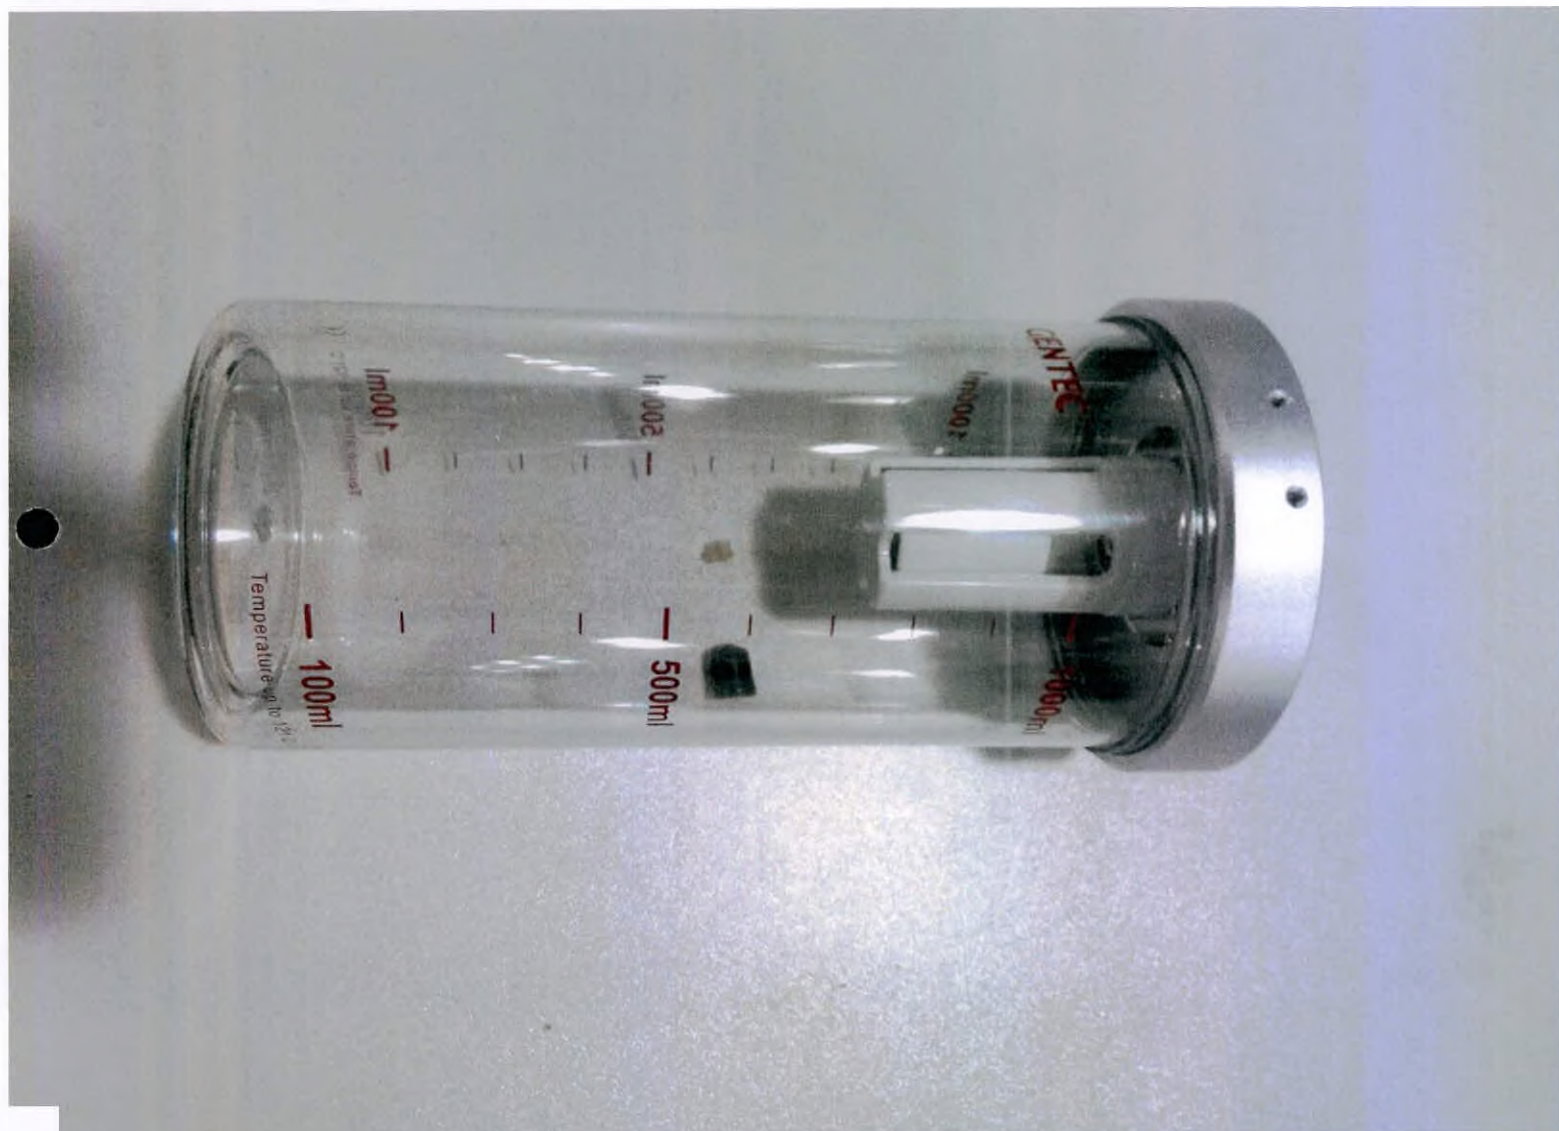

Колба системы аспирации с защитой от переполнения не более 5 шт. (при необходимости)



Колба системы аспирации без защиты от переполнения не более 5 шт. (при необходимости)

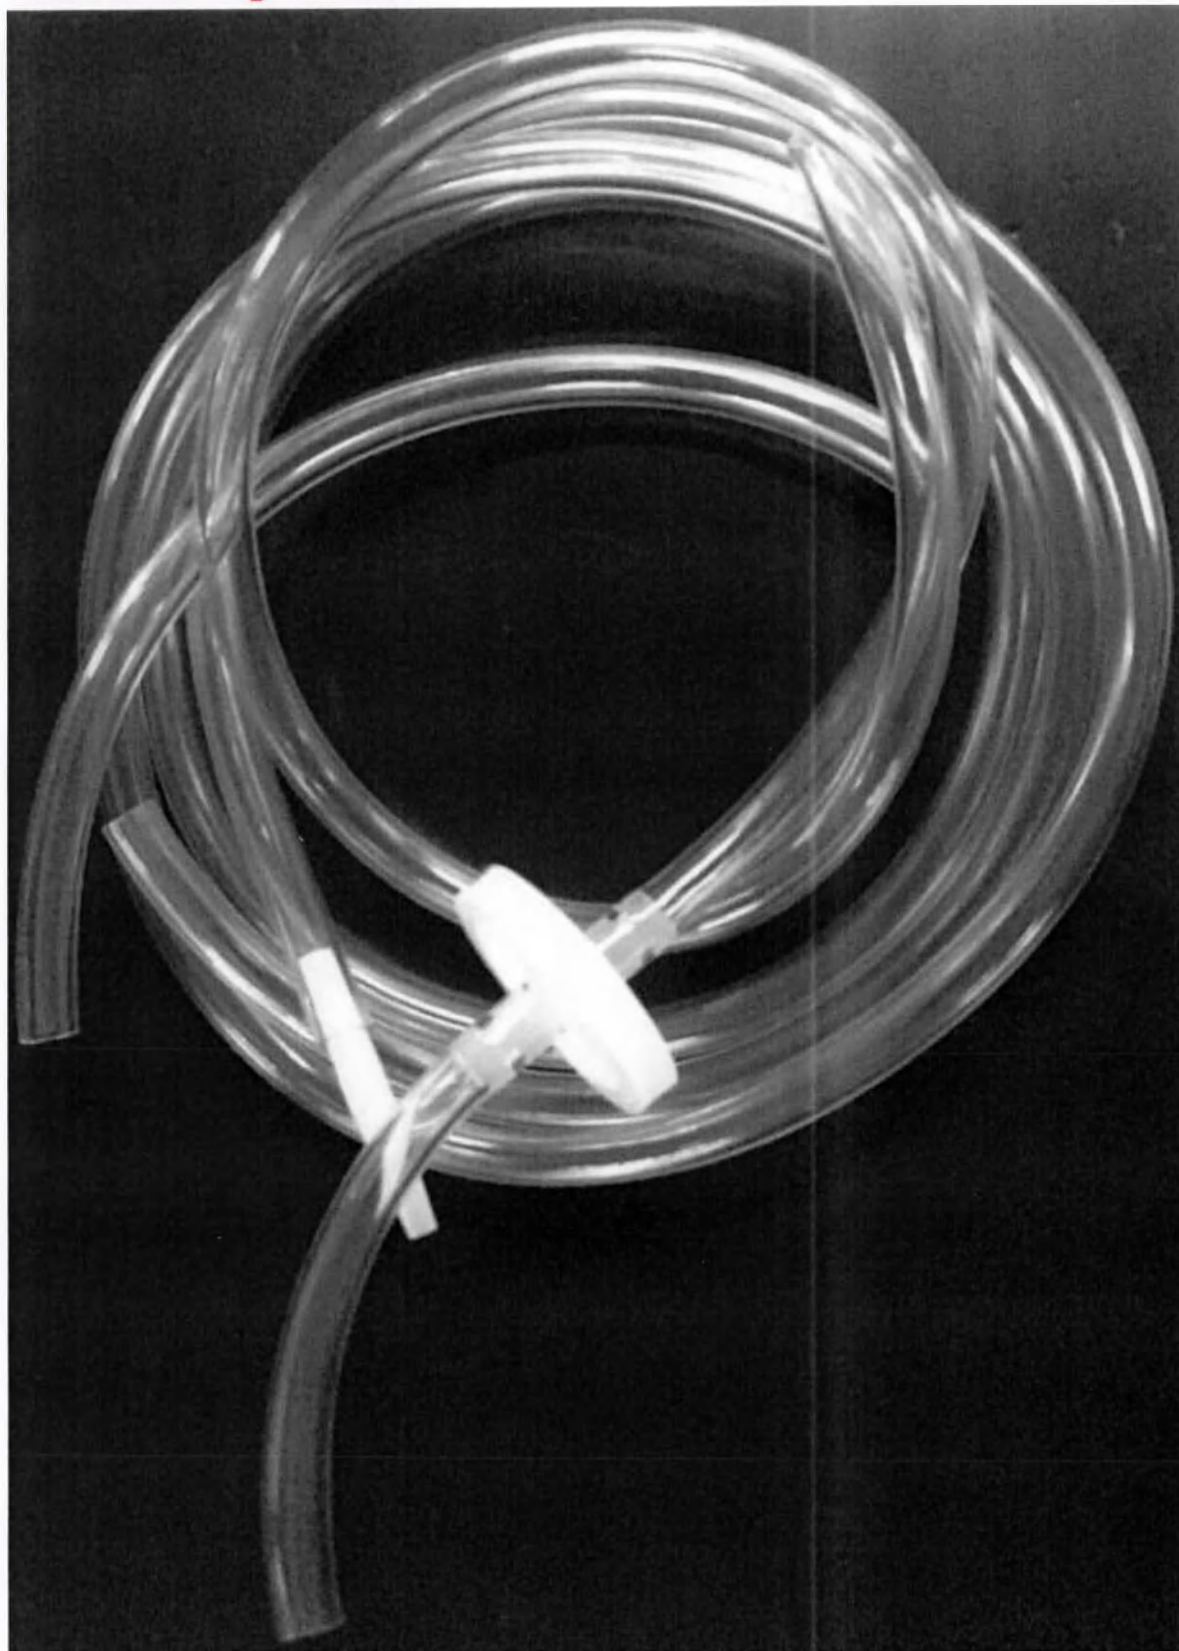

Трубка аспирационная, 3 м, с фильтром не более 5 шт. (при необходимости)




Магистраль высокого давления для кислорода не более 5 шт. (при необходимости)




Магистраль высокого давления для воздуха не более 5 шт. (при необходимости)




Магистраль высокого давления для закиси азота не более 5 шт. (при необходимости)

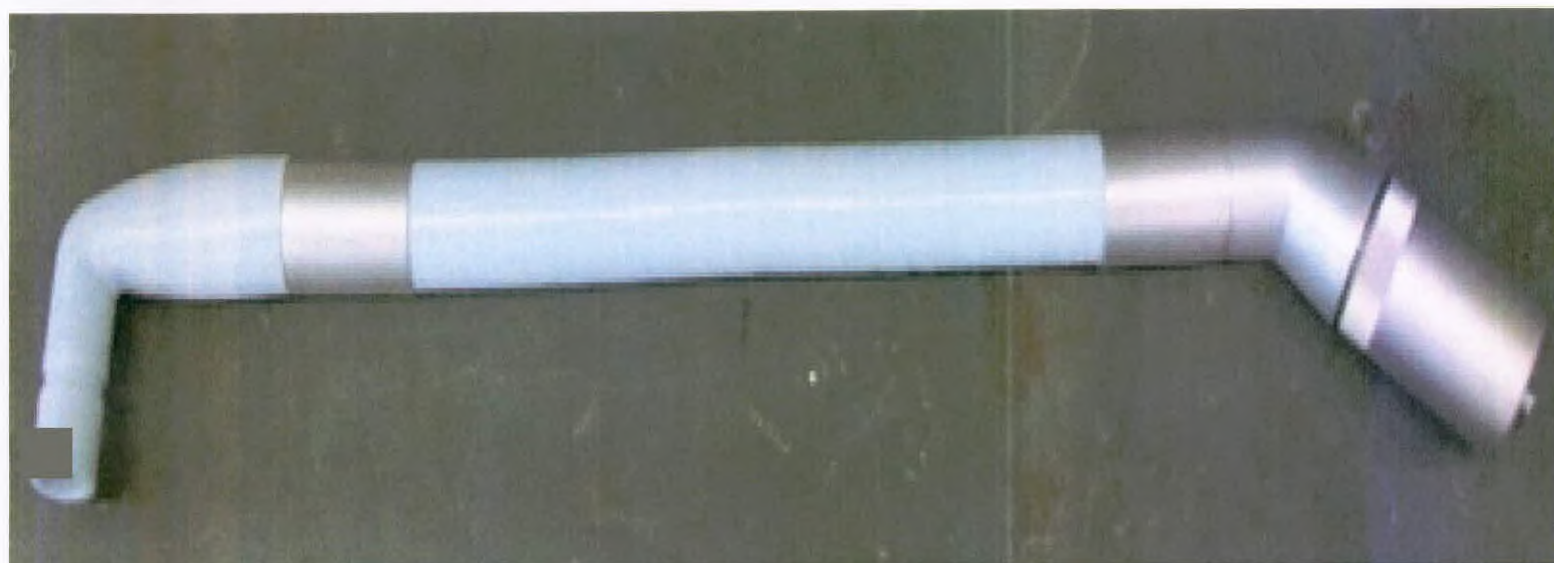


Консоль для мешка ручной вентиляции, гибкая не более 5 шт. (при необходимости)

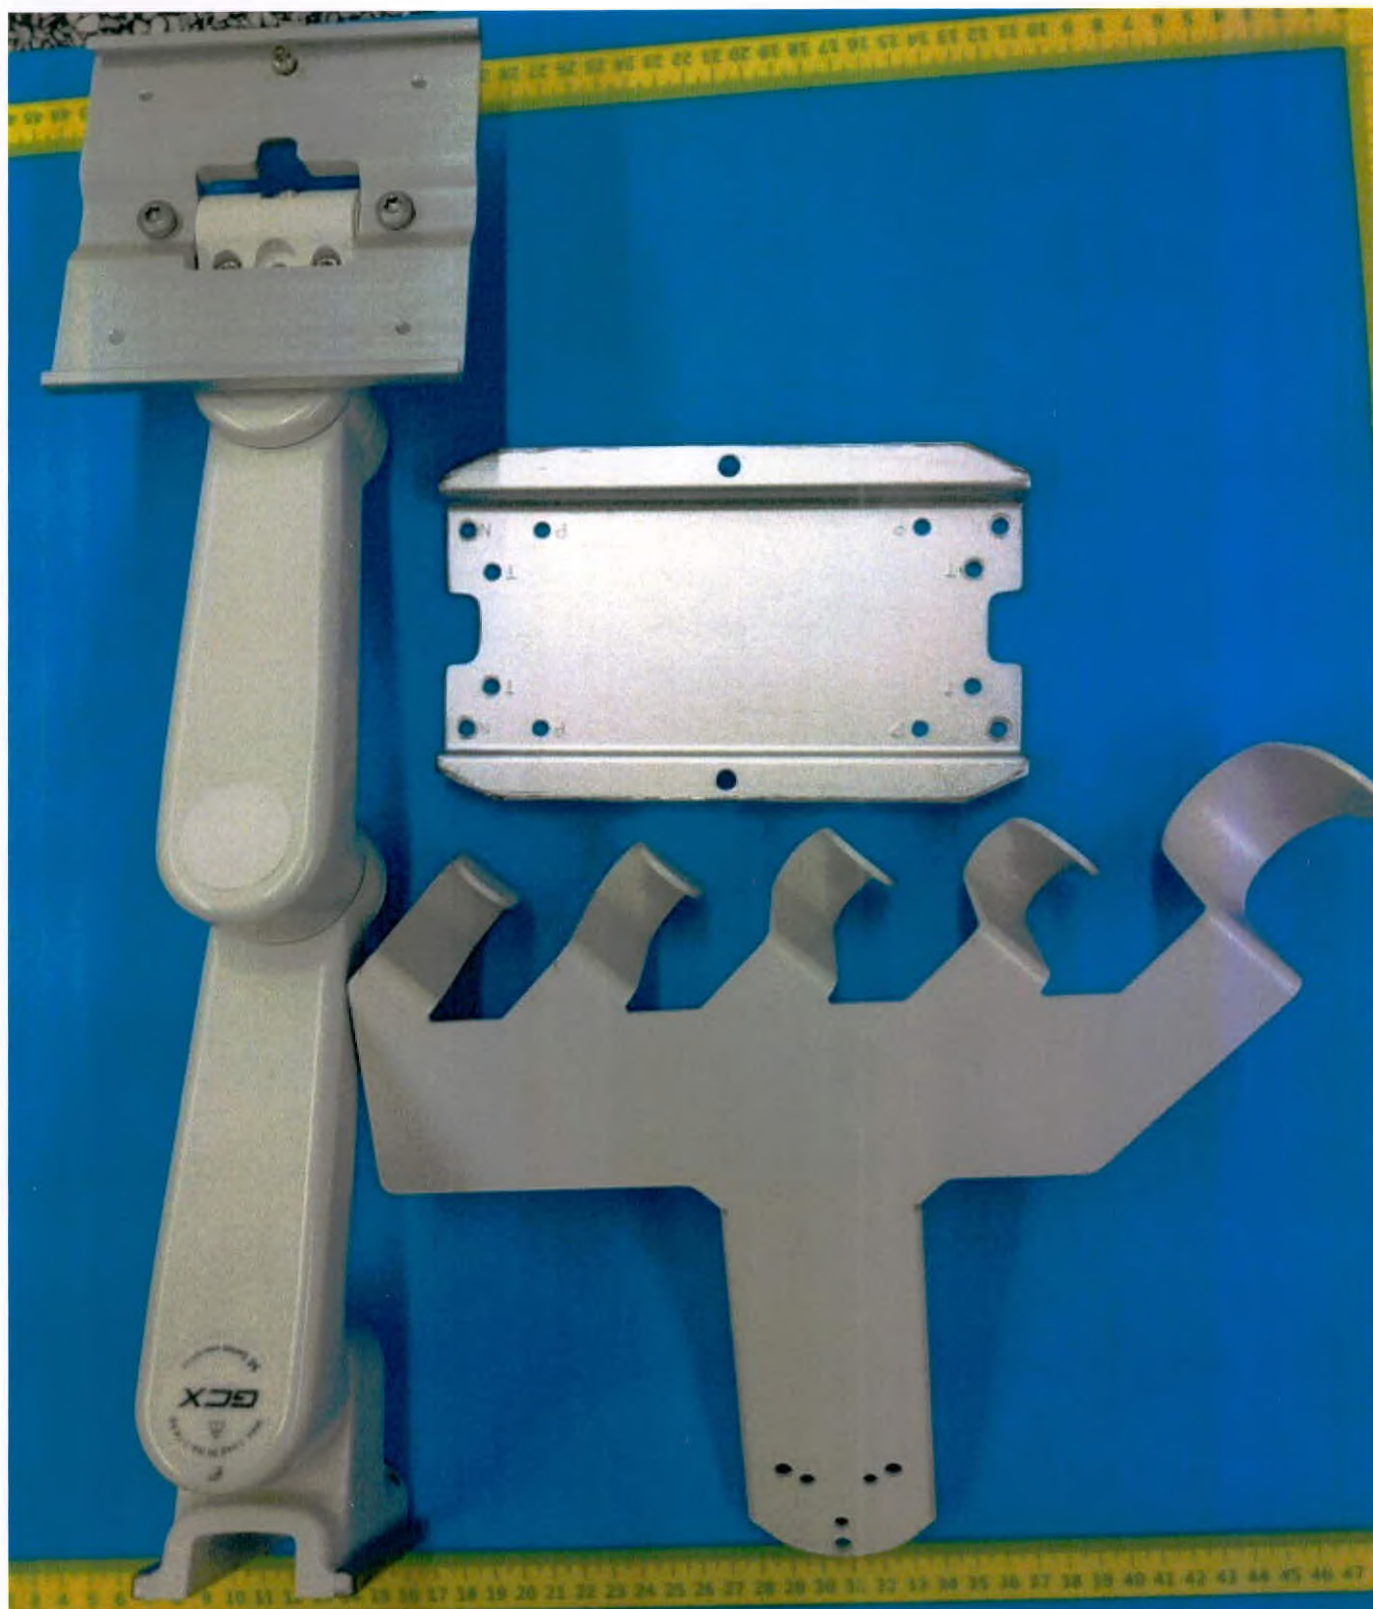


Комплект кронштейнов для крепления монитора Beneview T5, с фиксированной высотой – не более 2 шт.

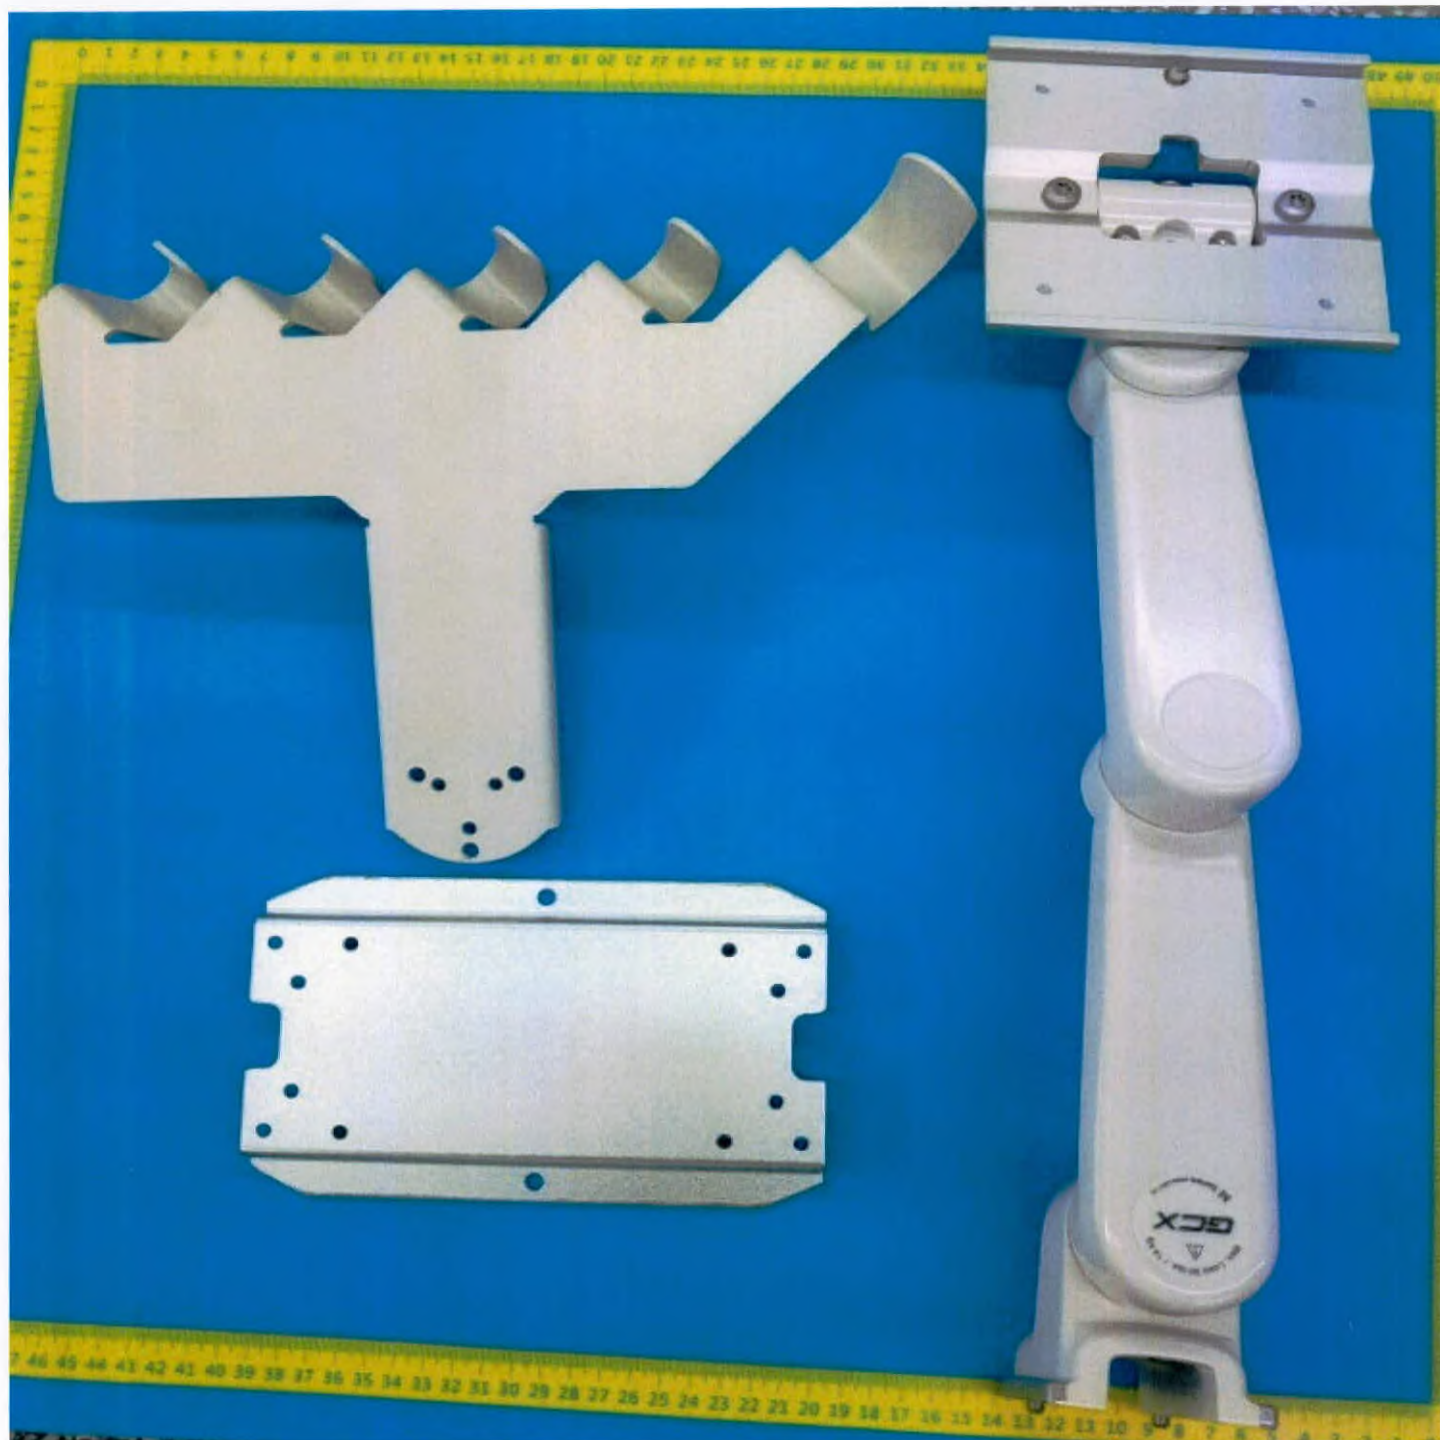


Комплект кронштейнов для крепления монитора N12/15/17/ePM15, с фиксированной высотой – не более 2 шт.

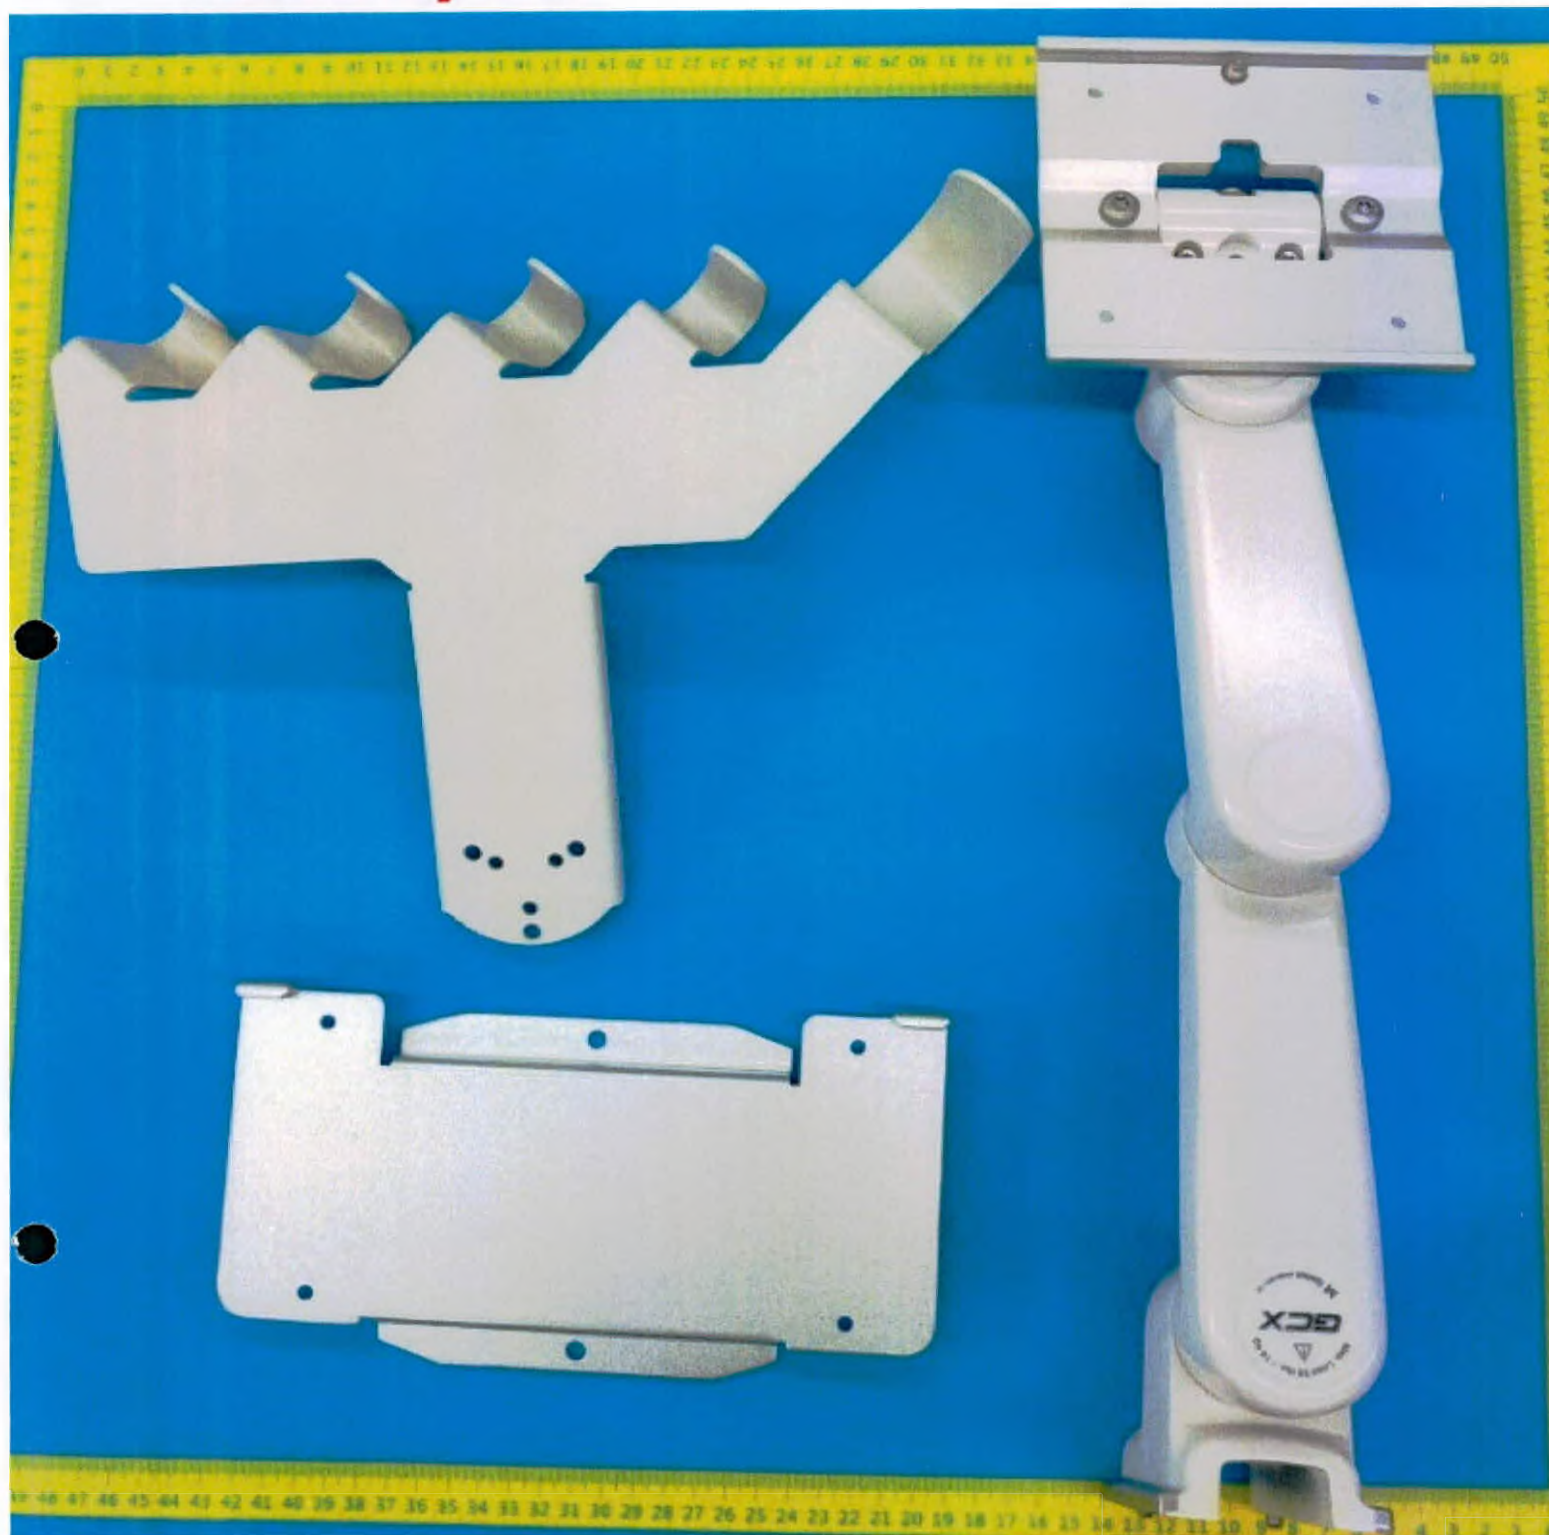


Комплект кронштейнов для крепления монитора Veneview T8, с фиксированной высотой – не более 2 шт.

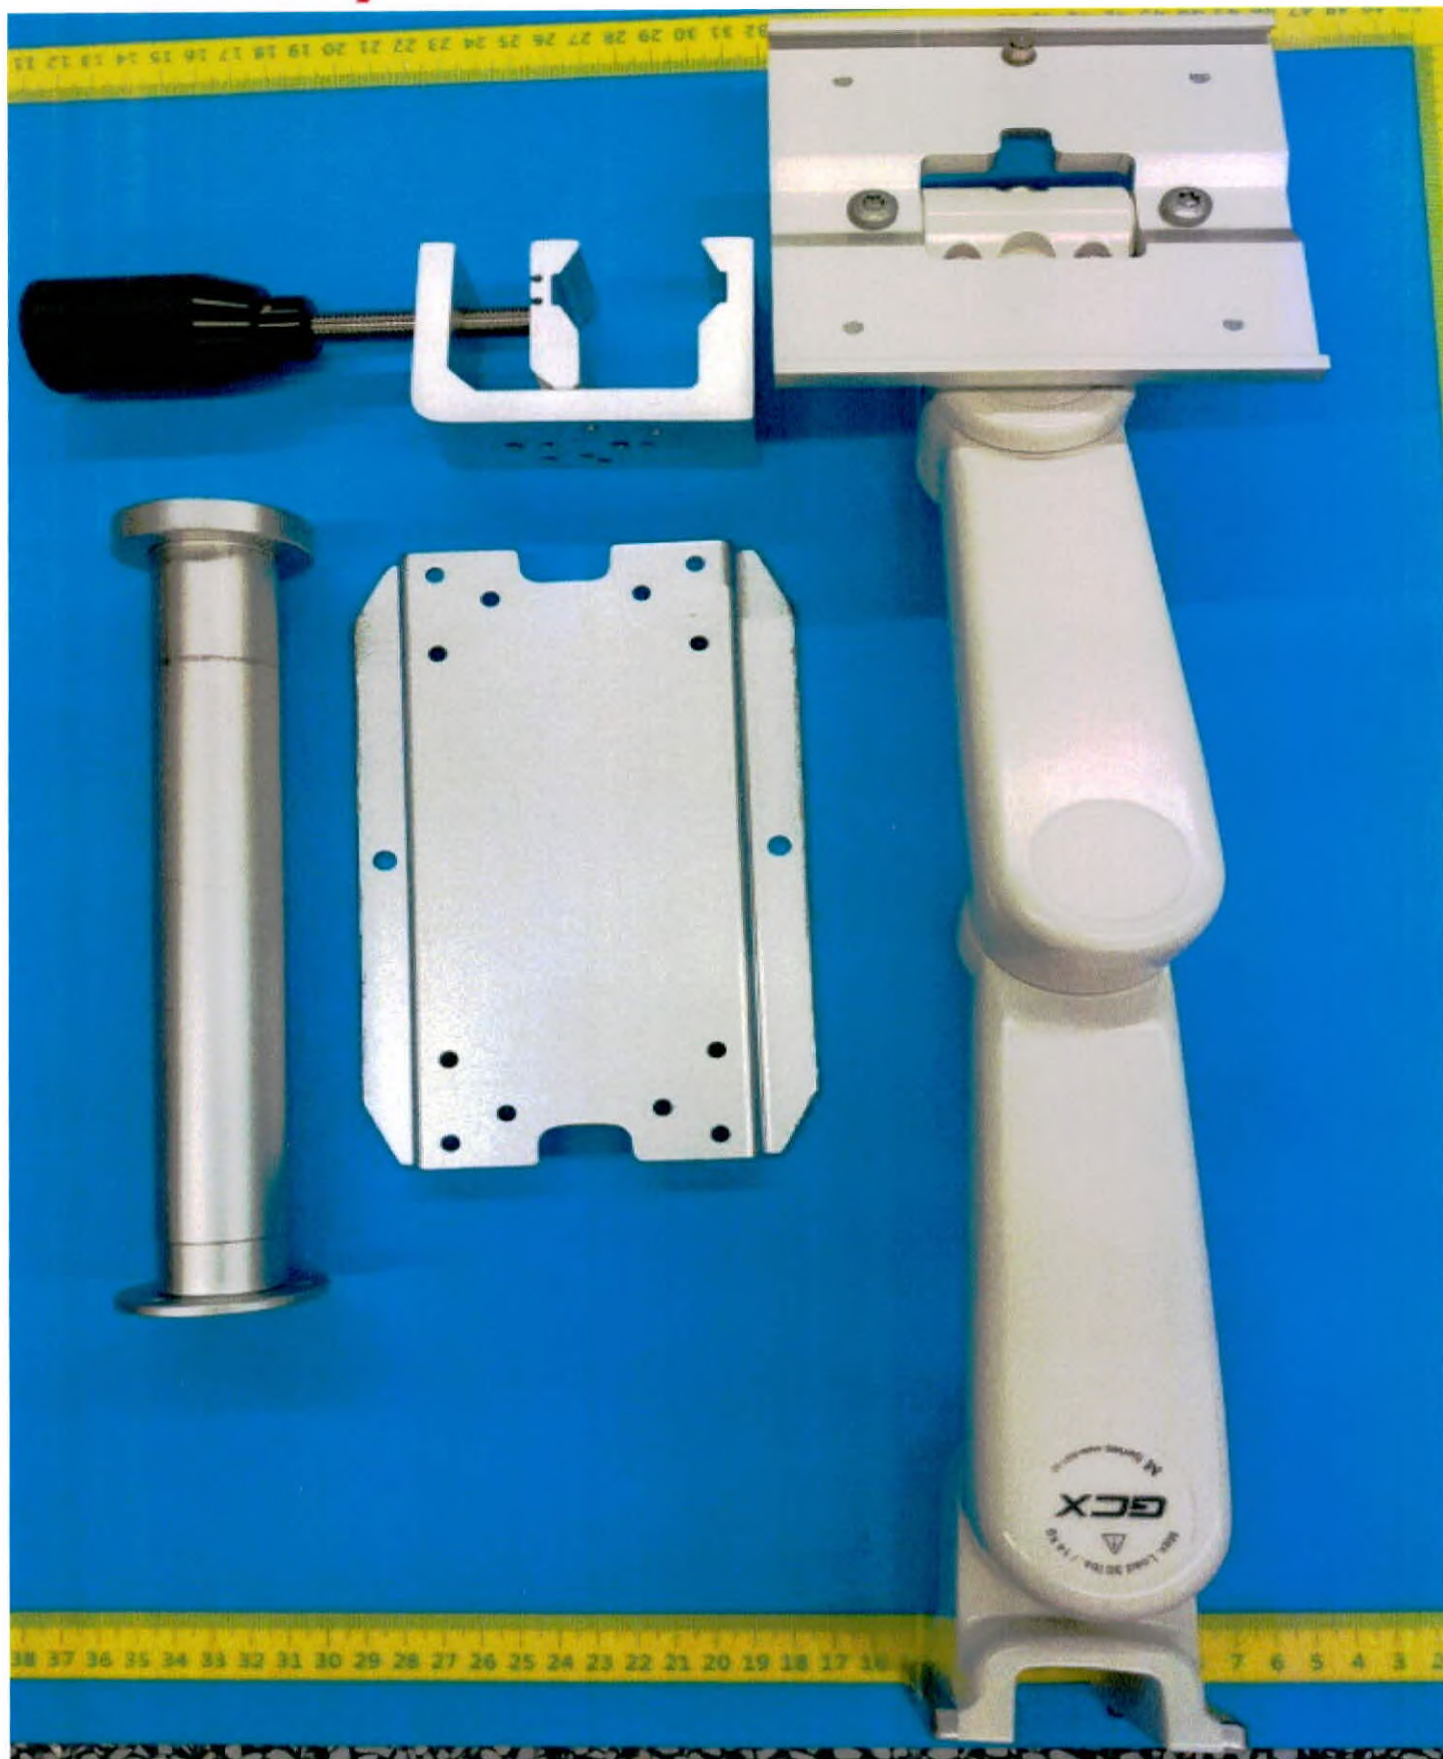


Комплект кронштейнов для крепления монитора Beneview T5 и модуля расширения, с фиксированной высотой – не более 2 шт.

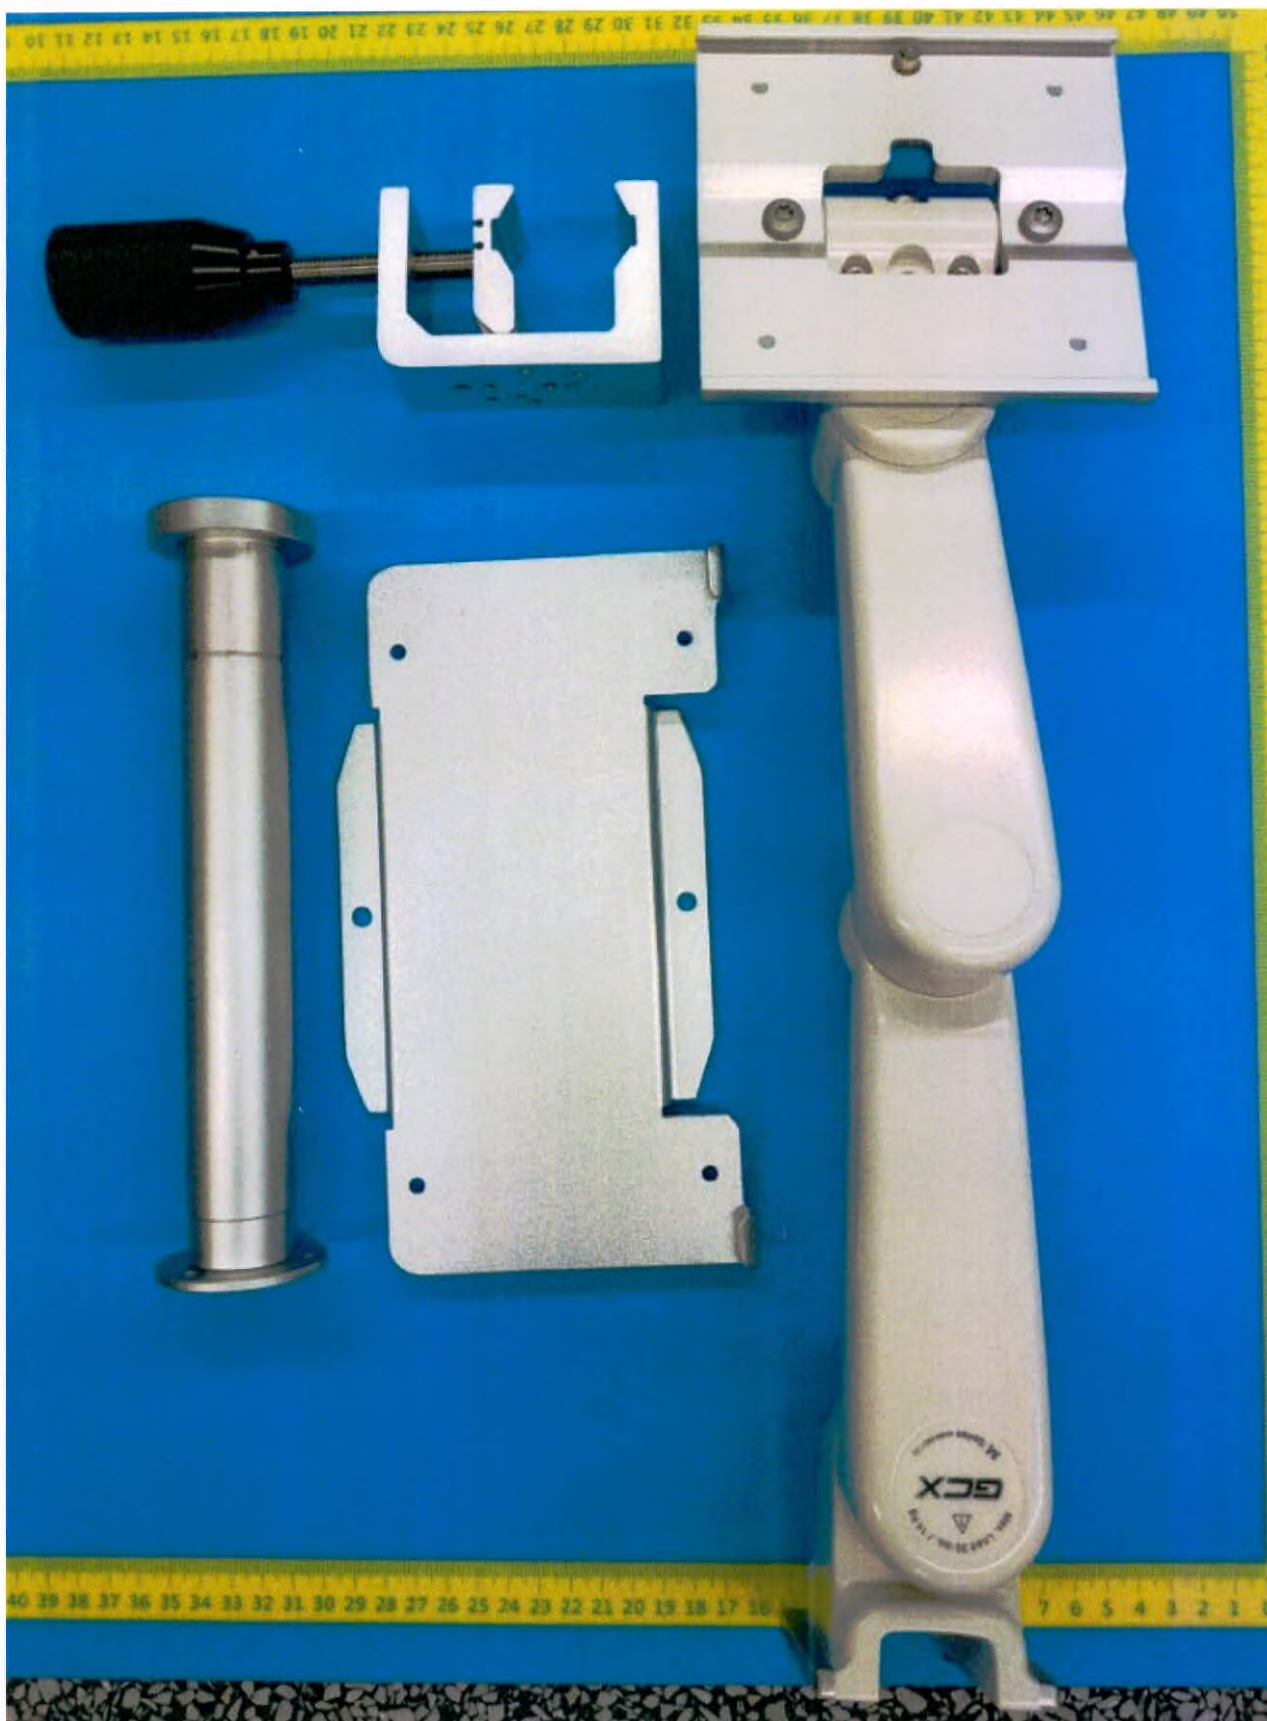

Комплект кронштейнов для крепления монитора Beneview T8 и модуля расширения, с фиксированной высотой – не более 2 шт.

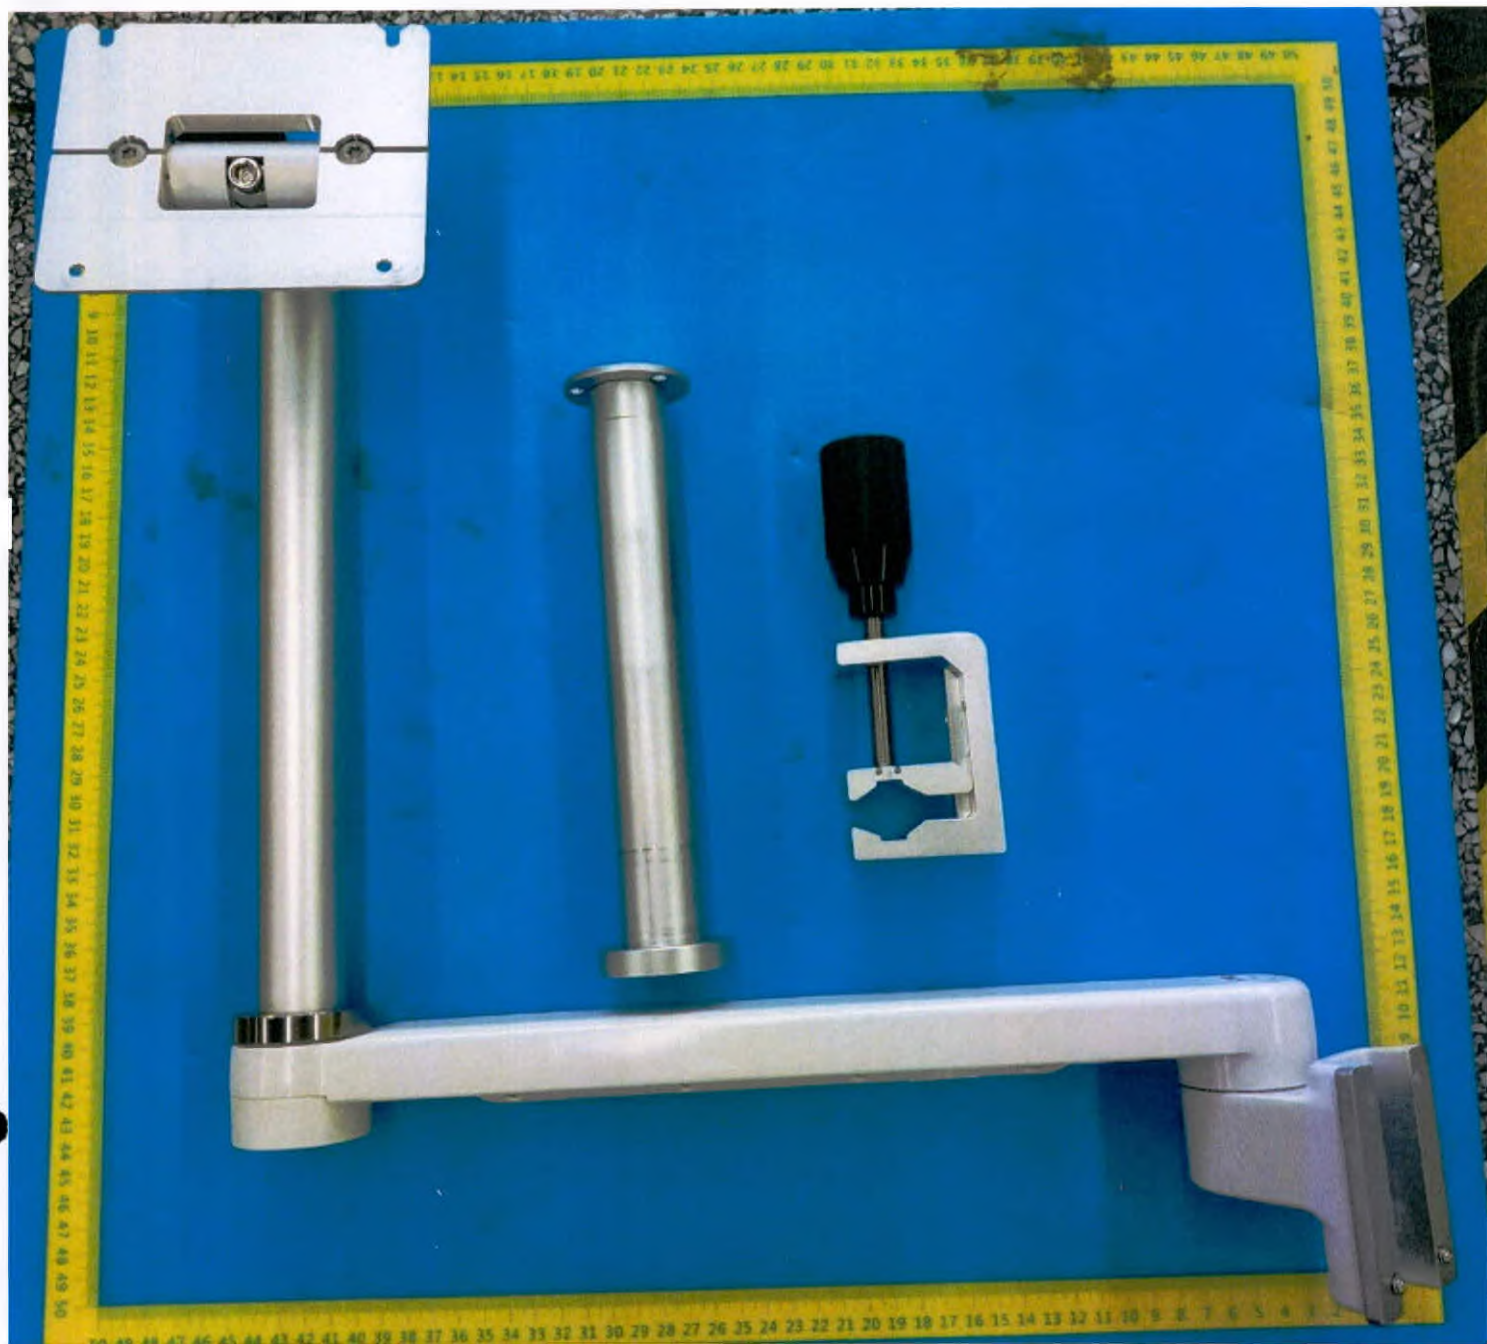


Комплект кронштейнов для крепления монитора N19/N22, с фиксированной высотой – не более 2 шт.

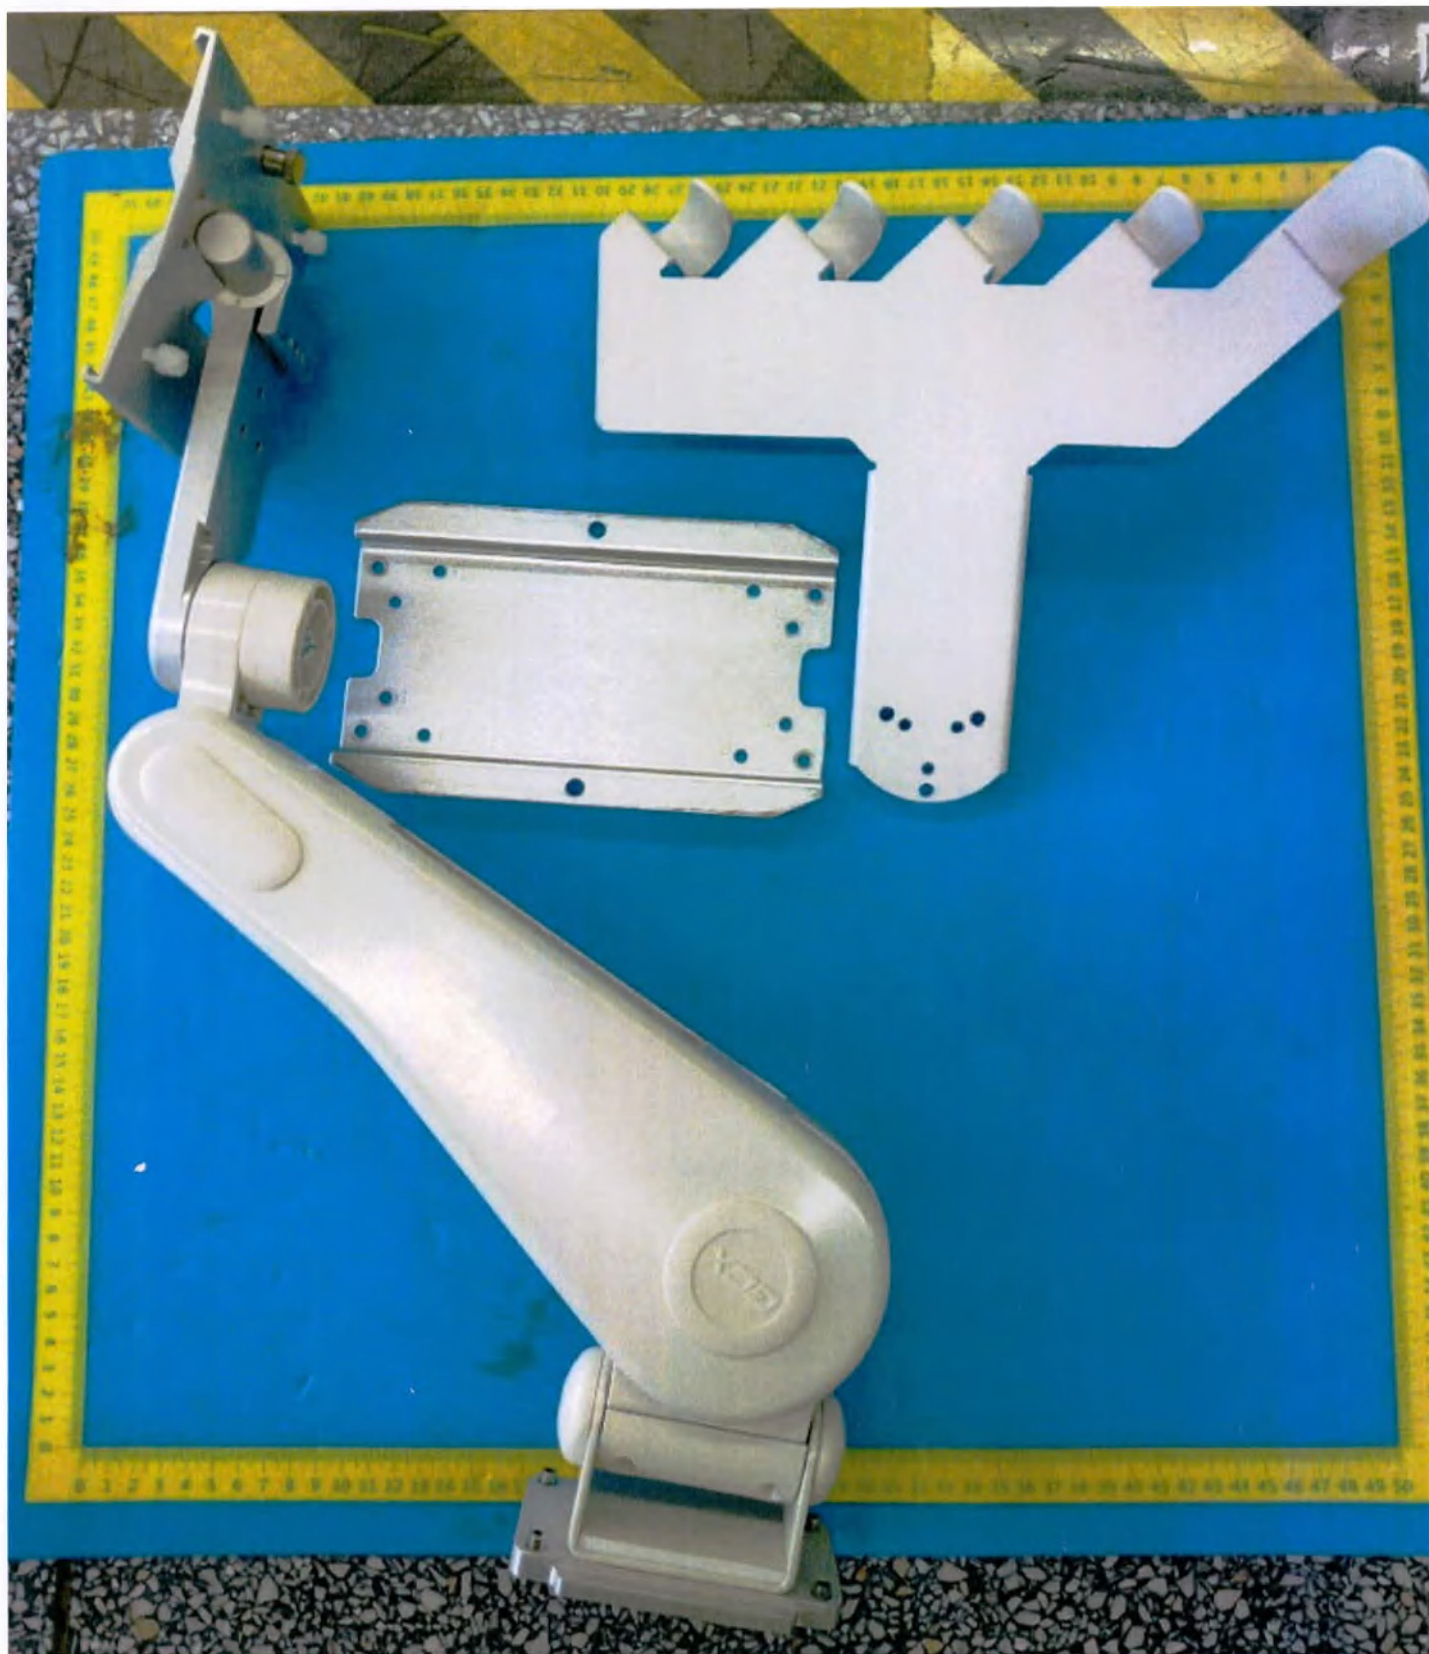

Комплект кронштейнов для крепления монитора N12/N15/N17/ePM15 с регулируемой высотой – не более 2 шт.



Комплект кронштейнов для крепления монитора ePM10//ePM12/uMEC с фиксированной высотой
– не более 2 шт.

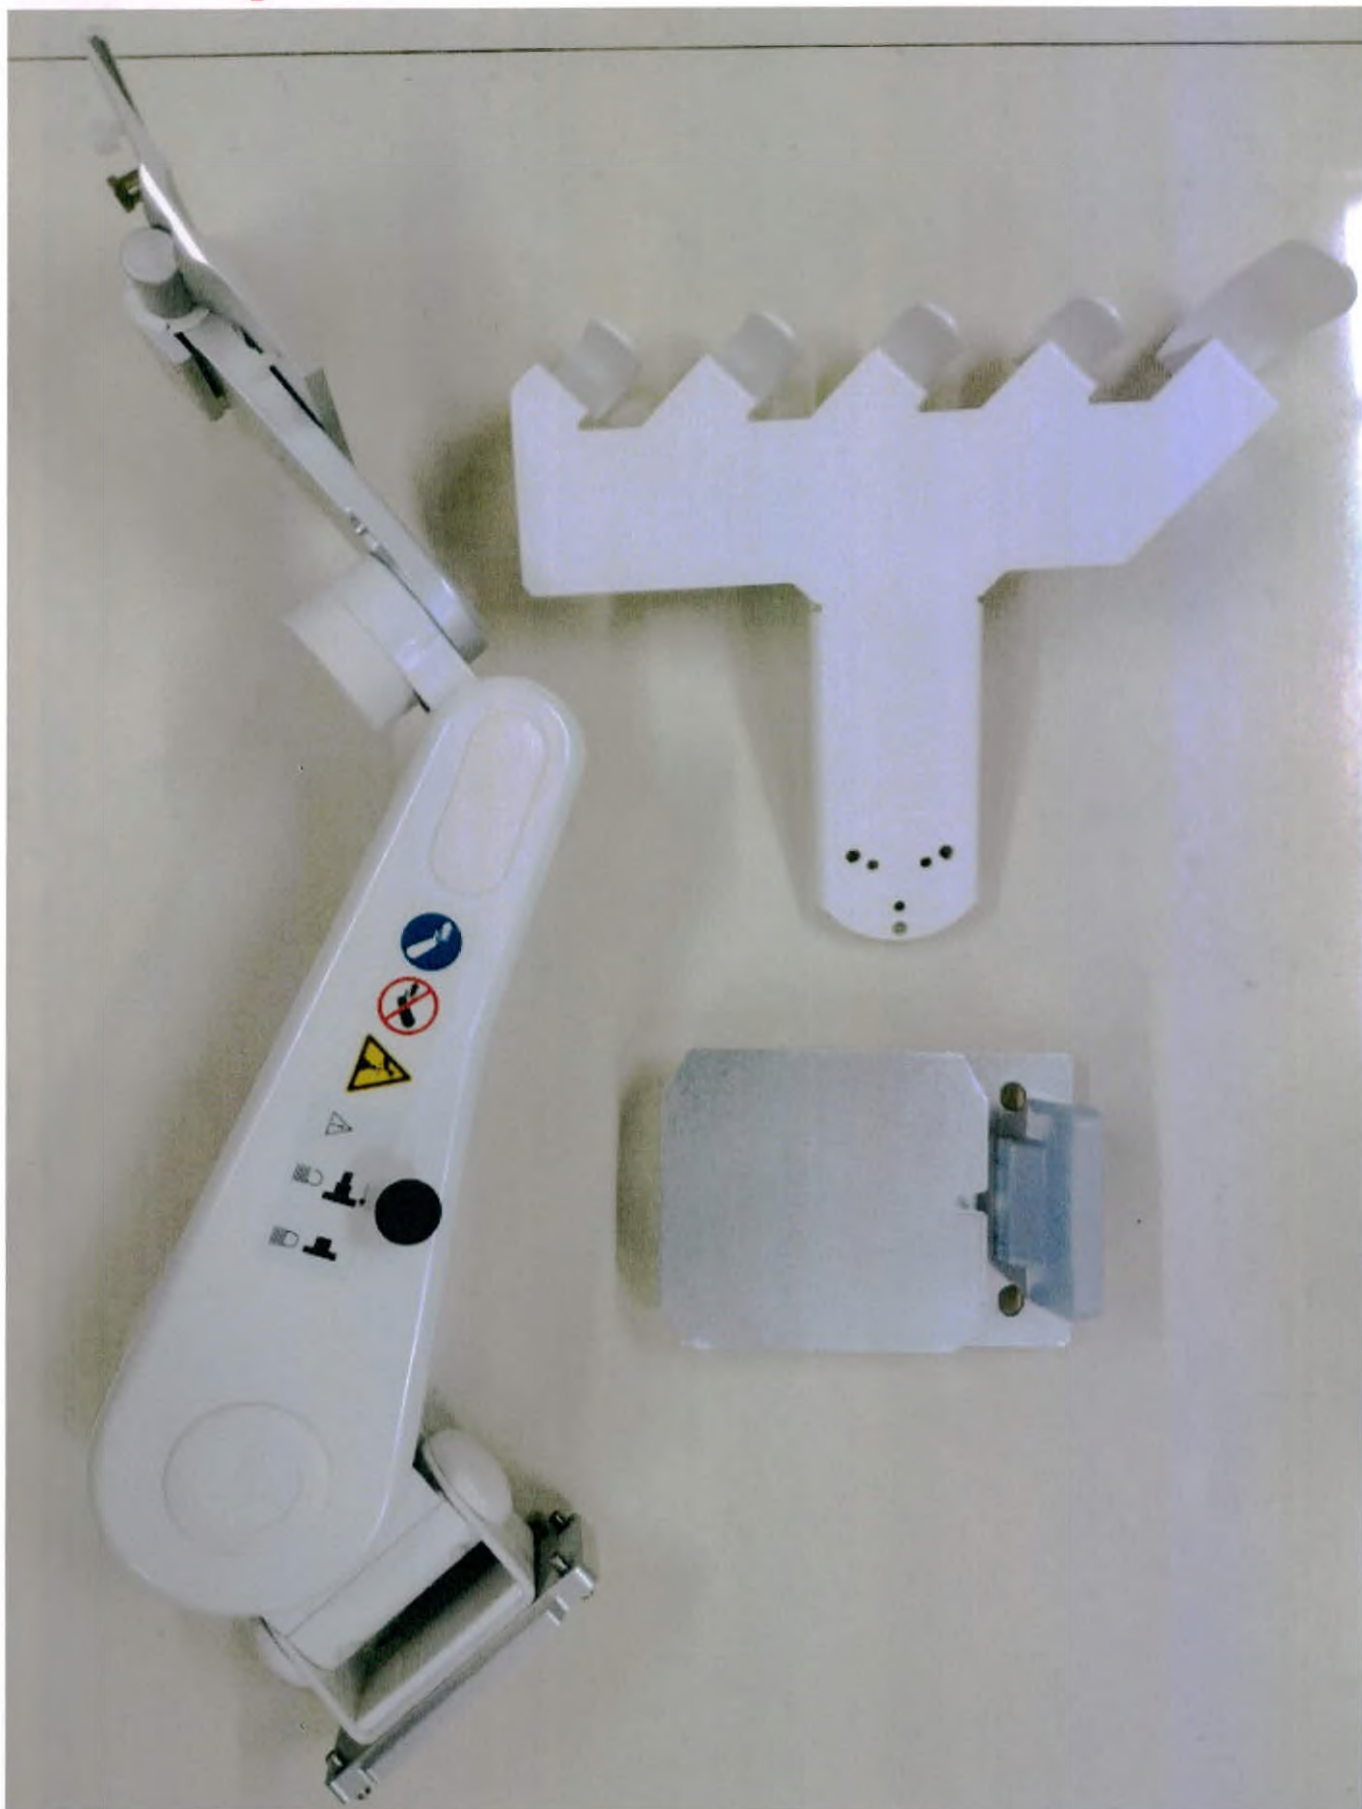

Комплект кронштейнов для крепления монитора ePM10/ePM12/uMEC с регулируемой высотой – не более 2 шт.



Кронштейн с пластиной – не более 2 шт.




Комплект крюков для аксессуаров – не более 10 шт.




Кронштейн артикуляционный с пластиной – не более 2 шт.




Дополнительная рабочая поверхность — не более 2 шт.

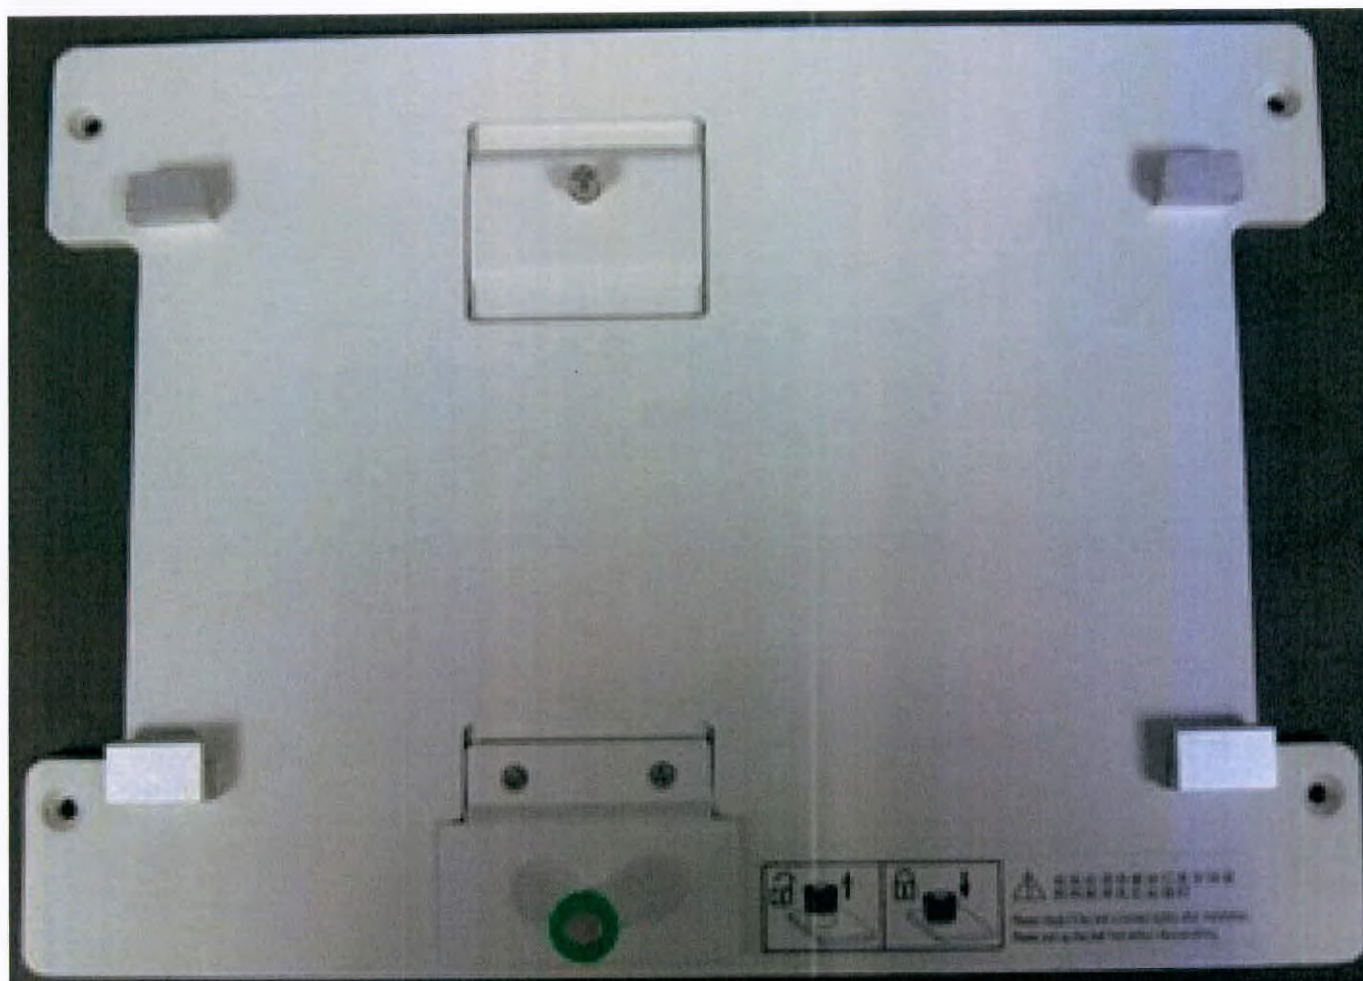


Подставка для установки монитора Beneview T8 – не более 2 шт.

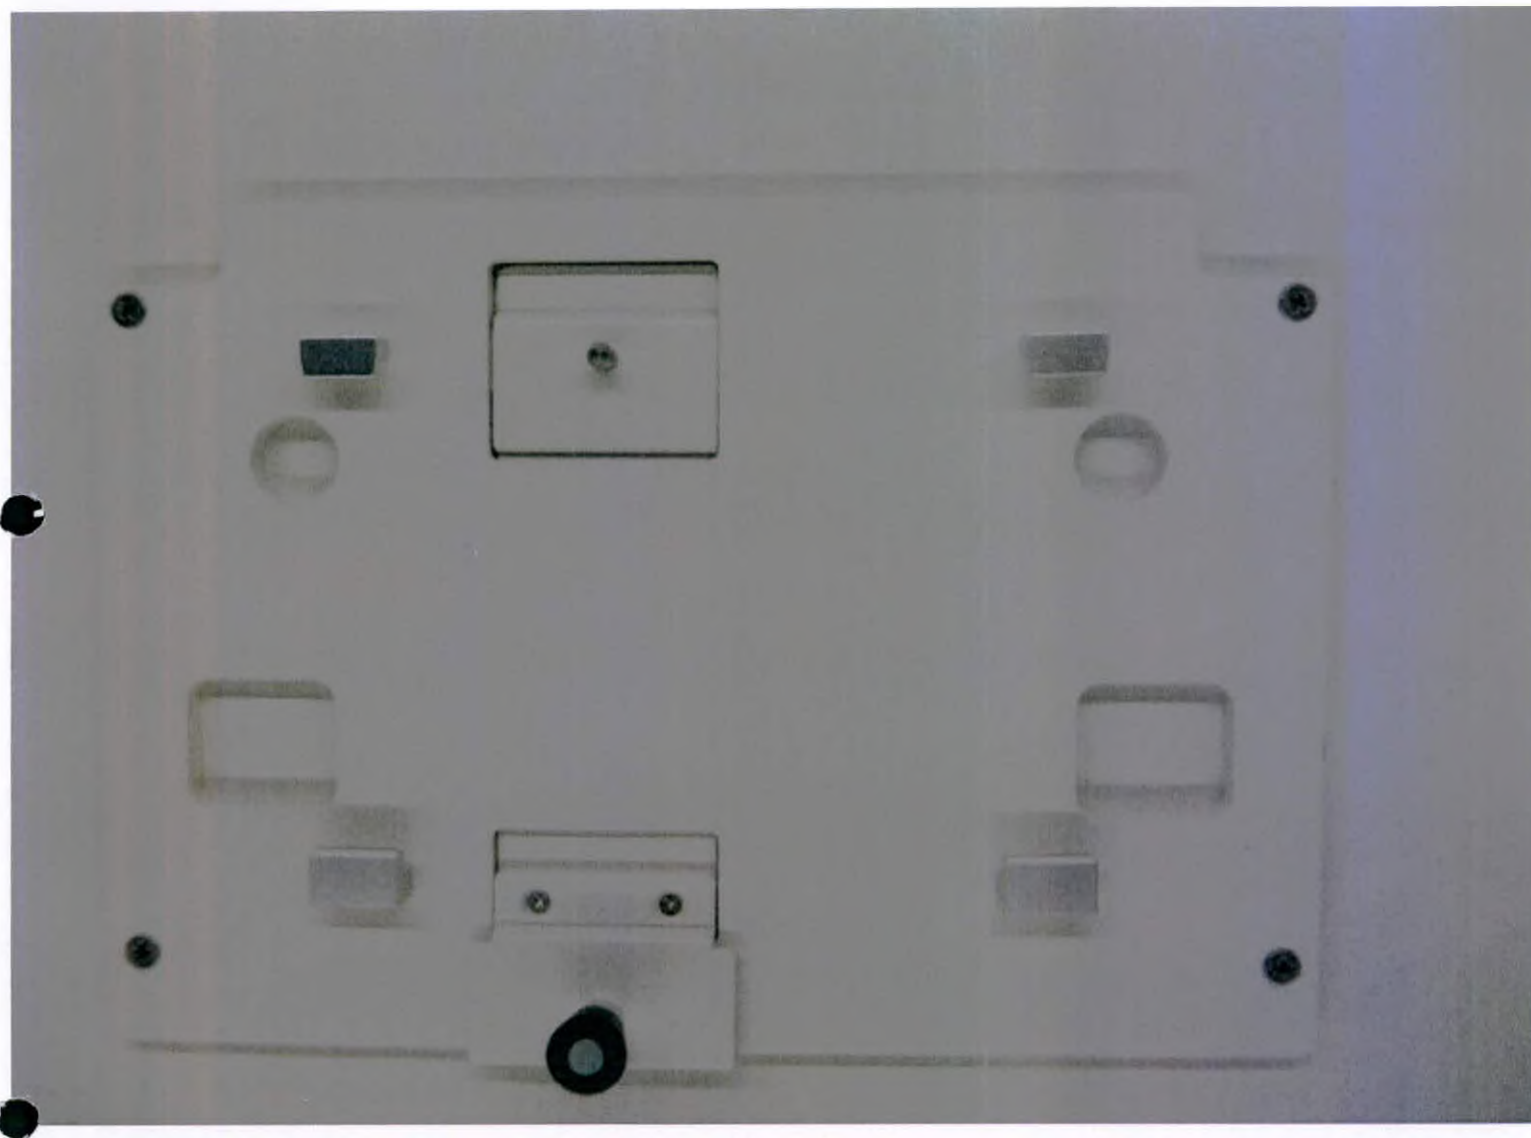


Подставка для установки монитора Beneview T5 –не более 2 шт.

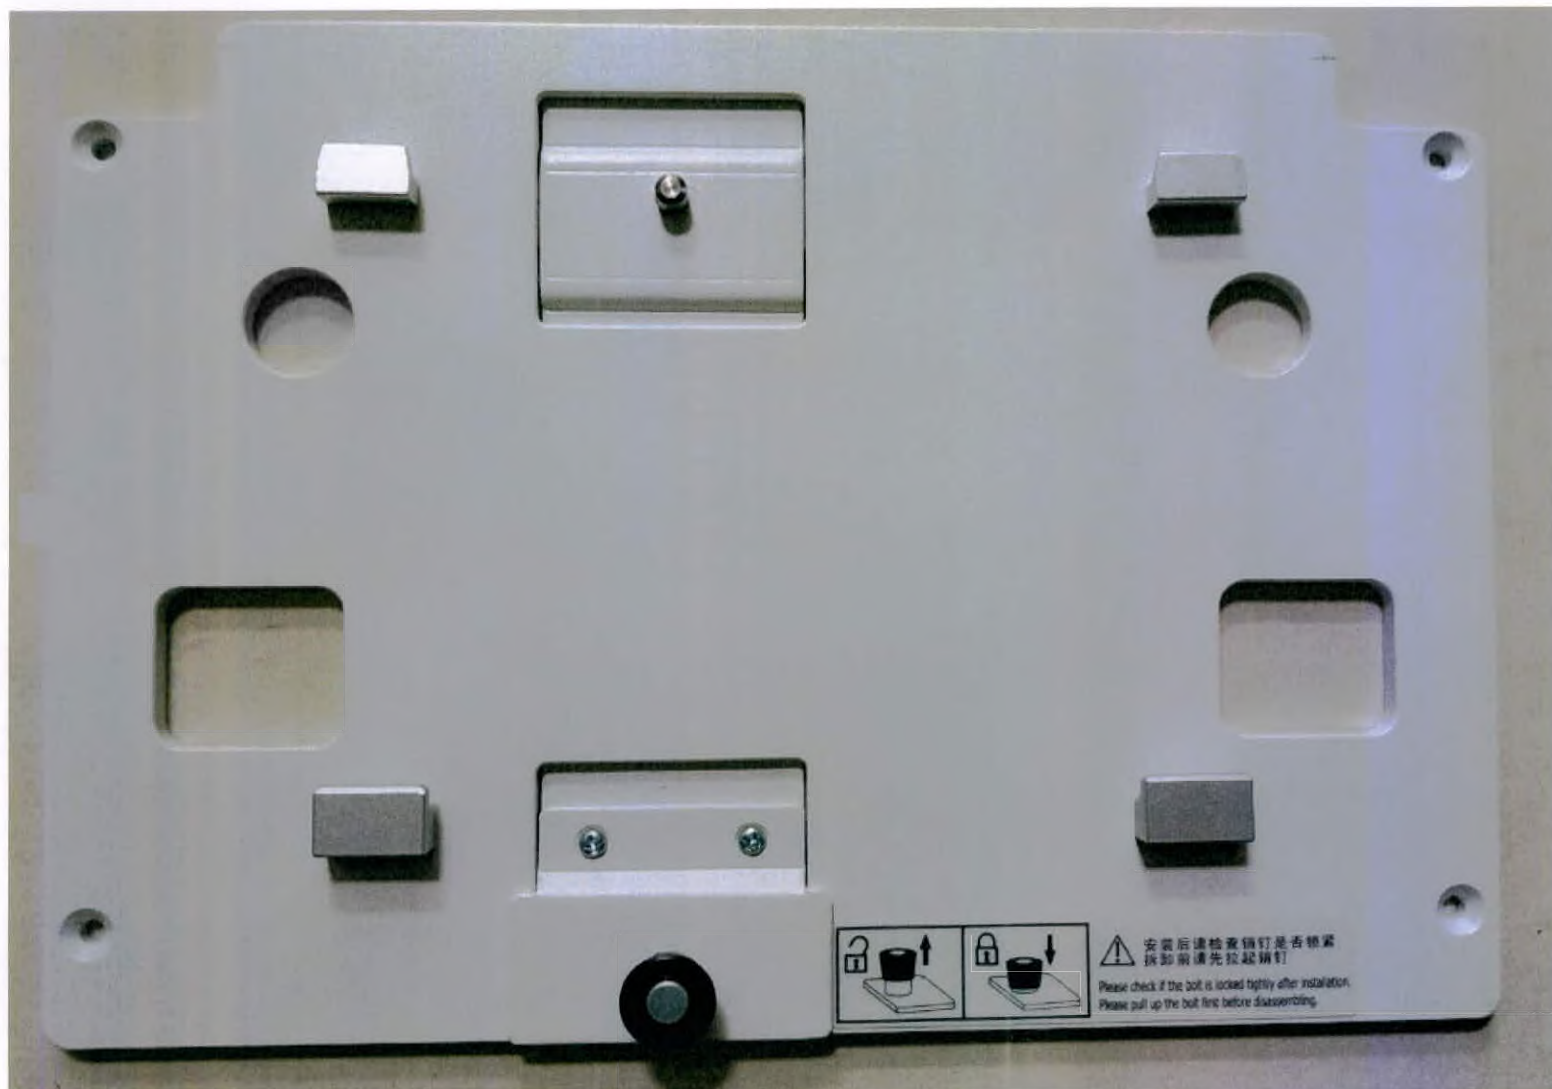


Подставка для установки монитора N15/N17 –не более 2 шт.

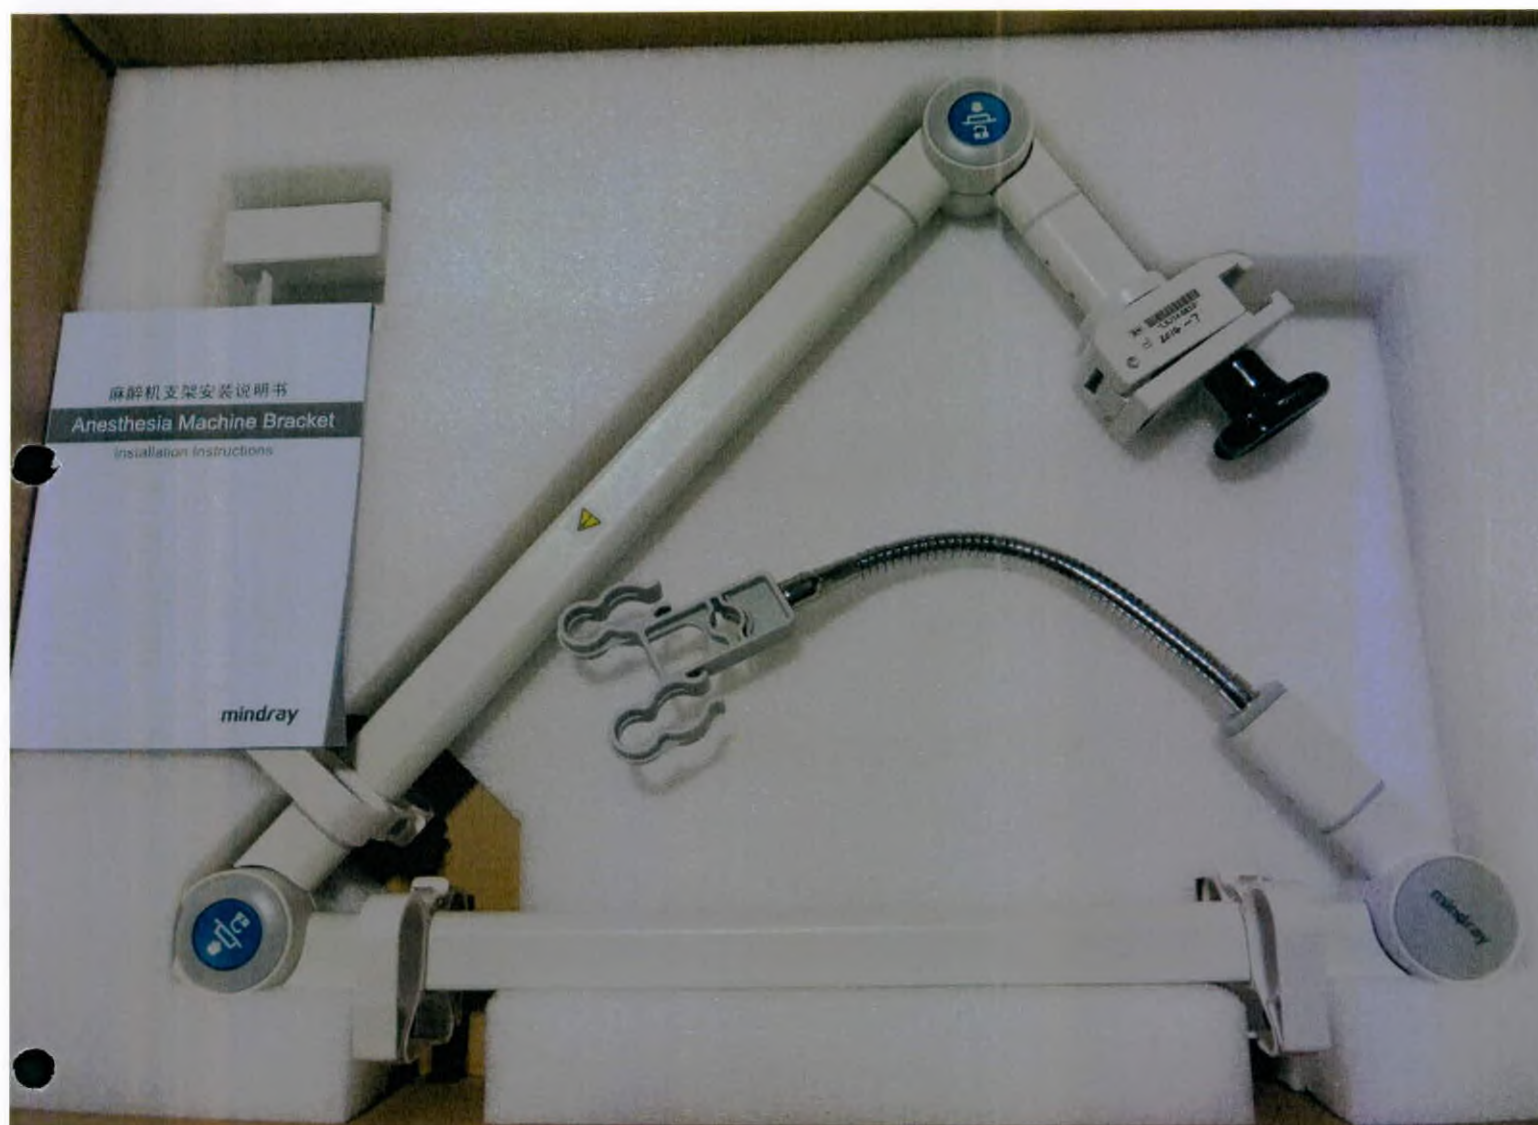


Кронштейн для фиксации дыхательного контура и проводов – не более 2 шт.

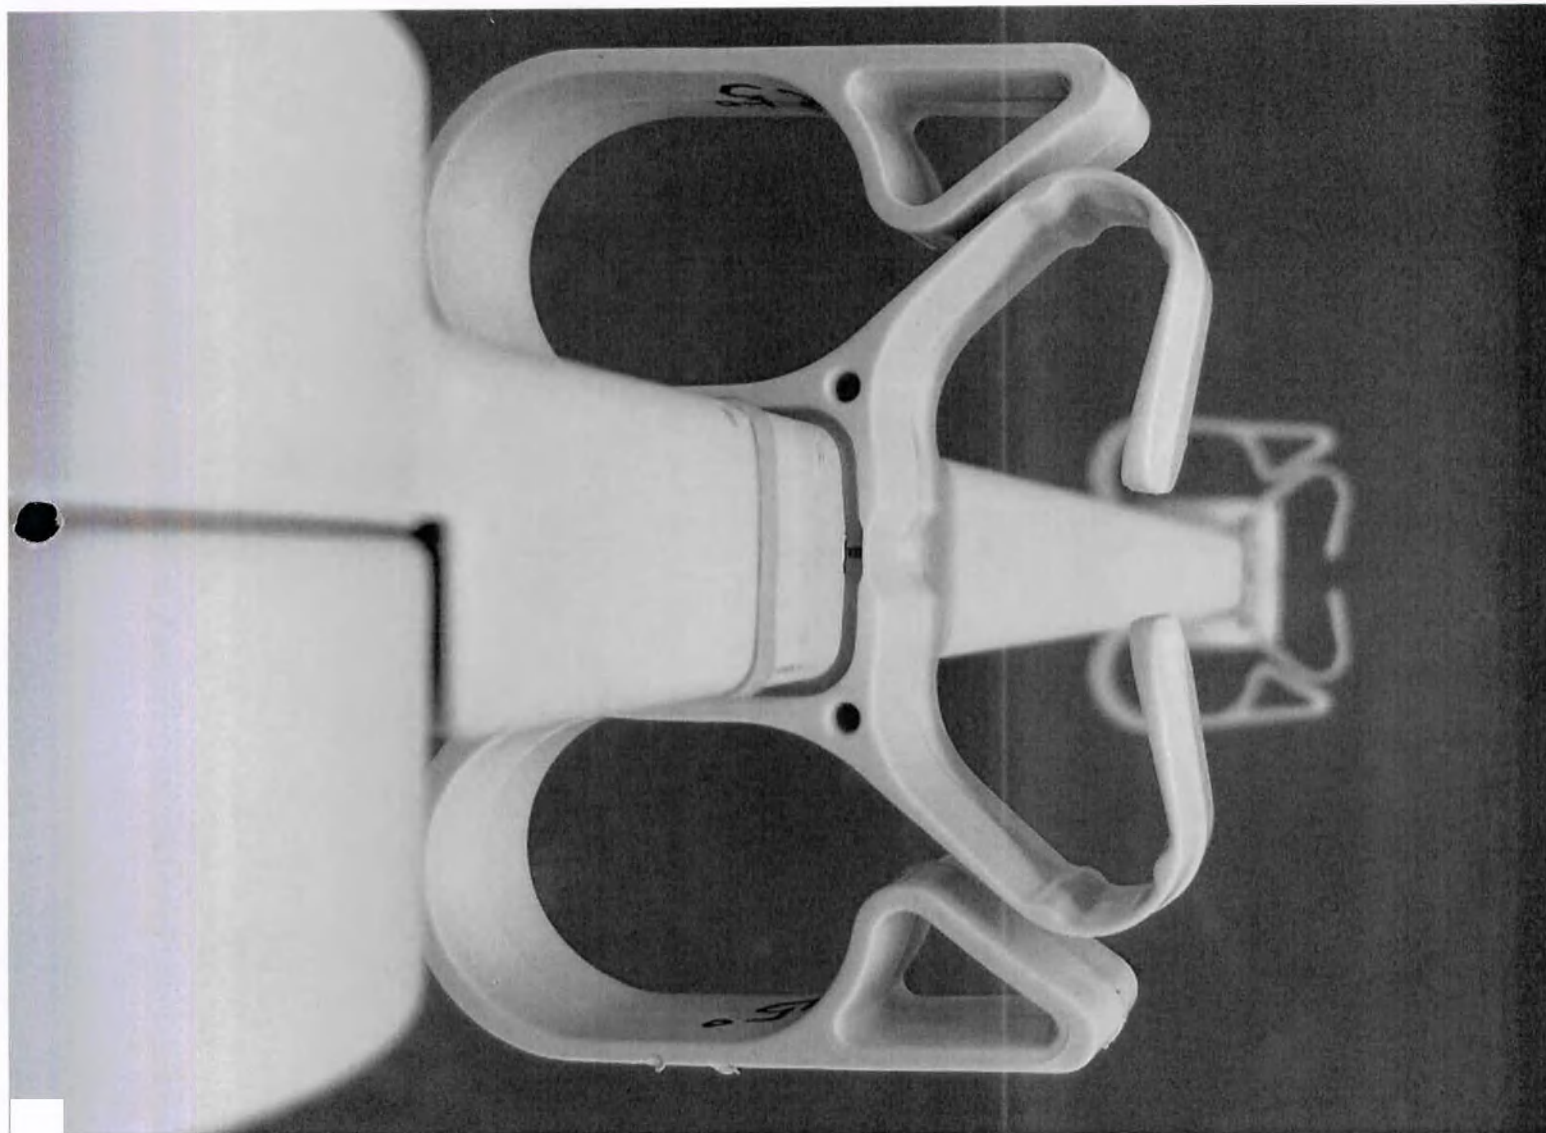


Крепление для стандартных дыхательных шлангов – не более 2 шт.

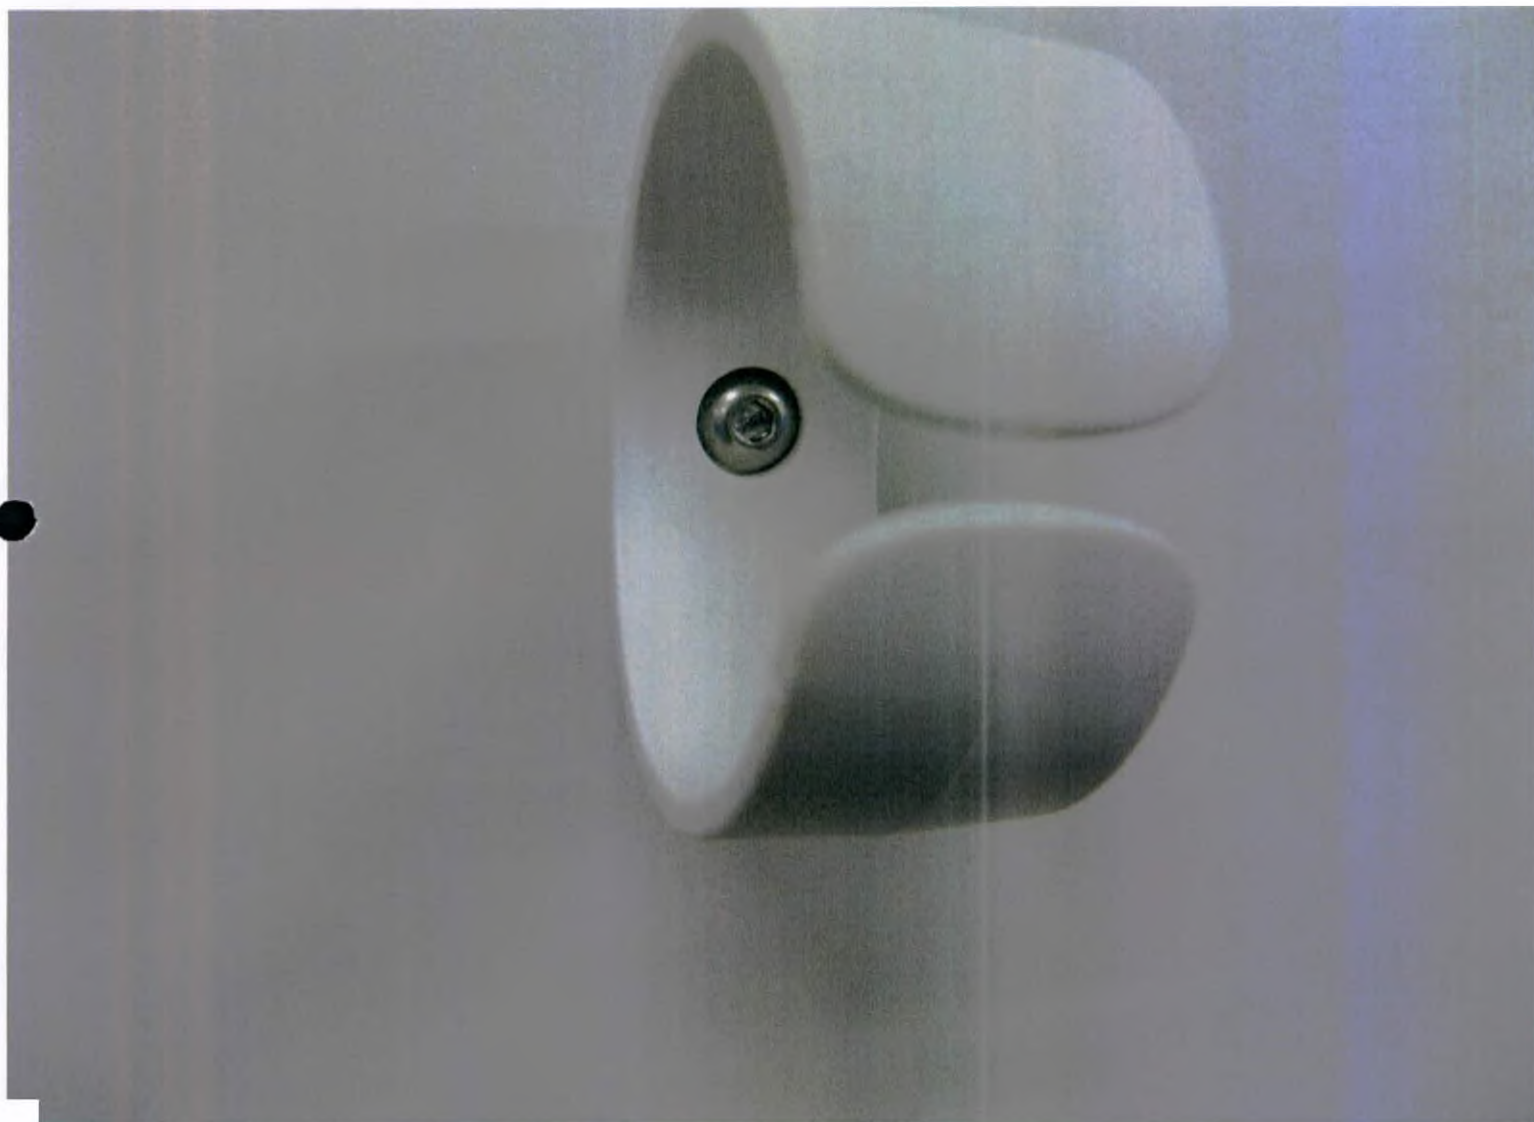


Крепление для коаксиальных дыхательных шлангов – не более 2 шт.

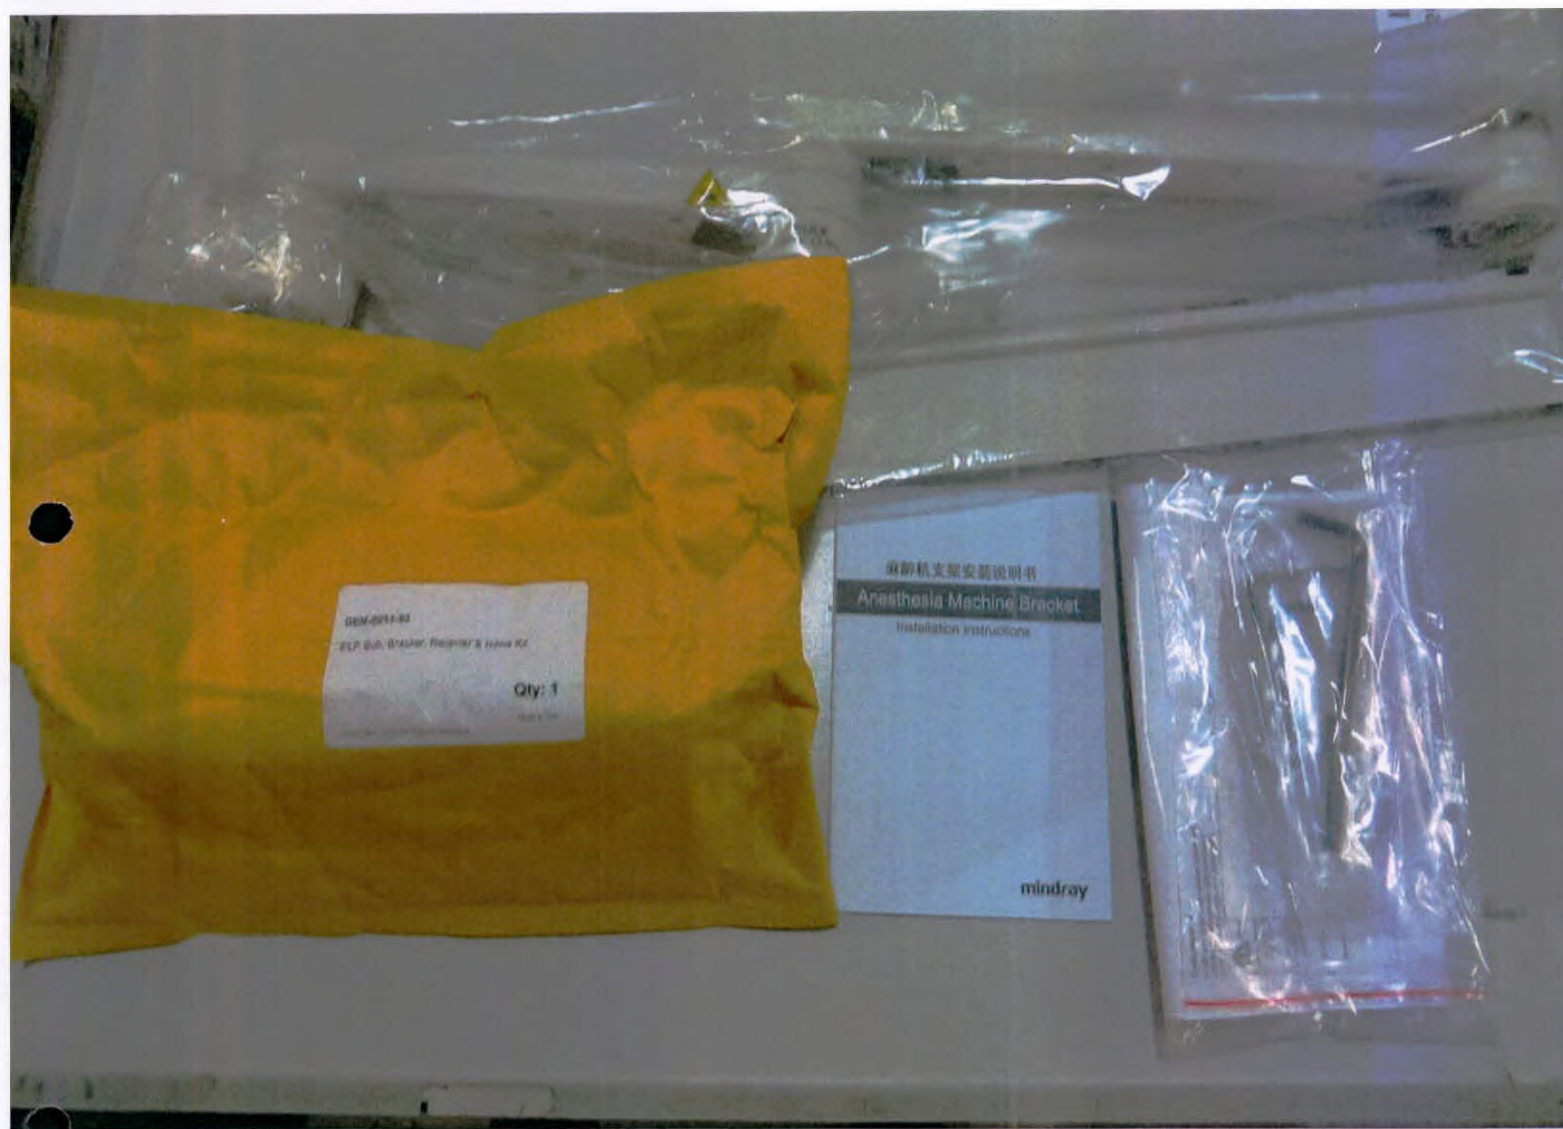


V-образное крепление для кабелей – не более 2 шт.

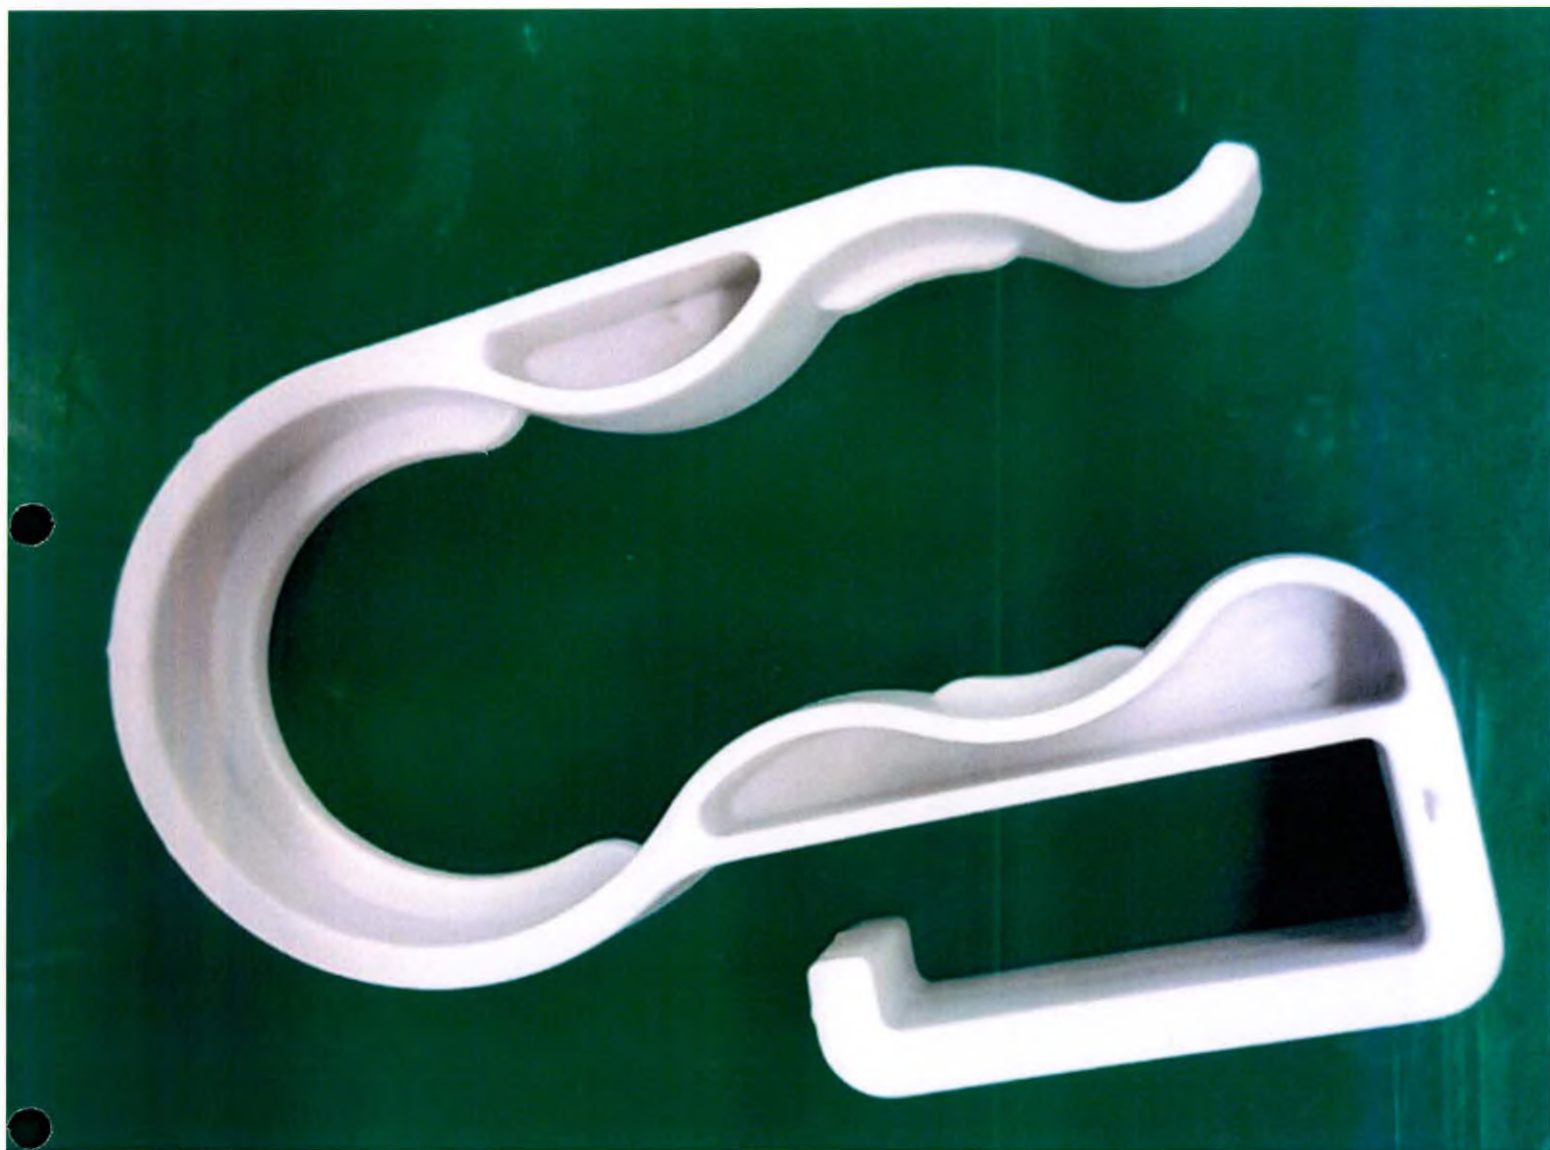


Фиксационный крючок – не более 2 шт.

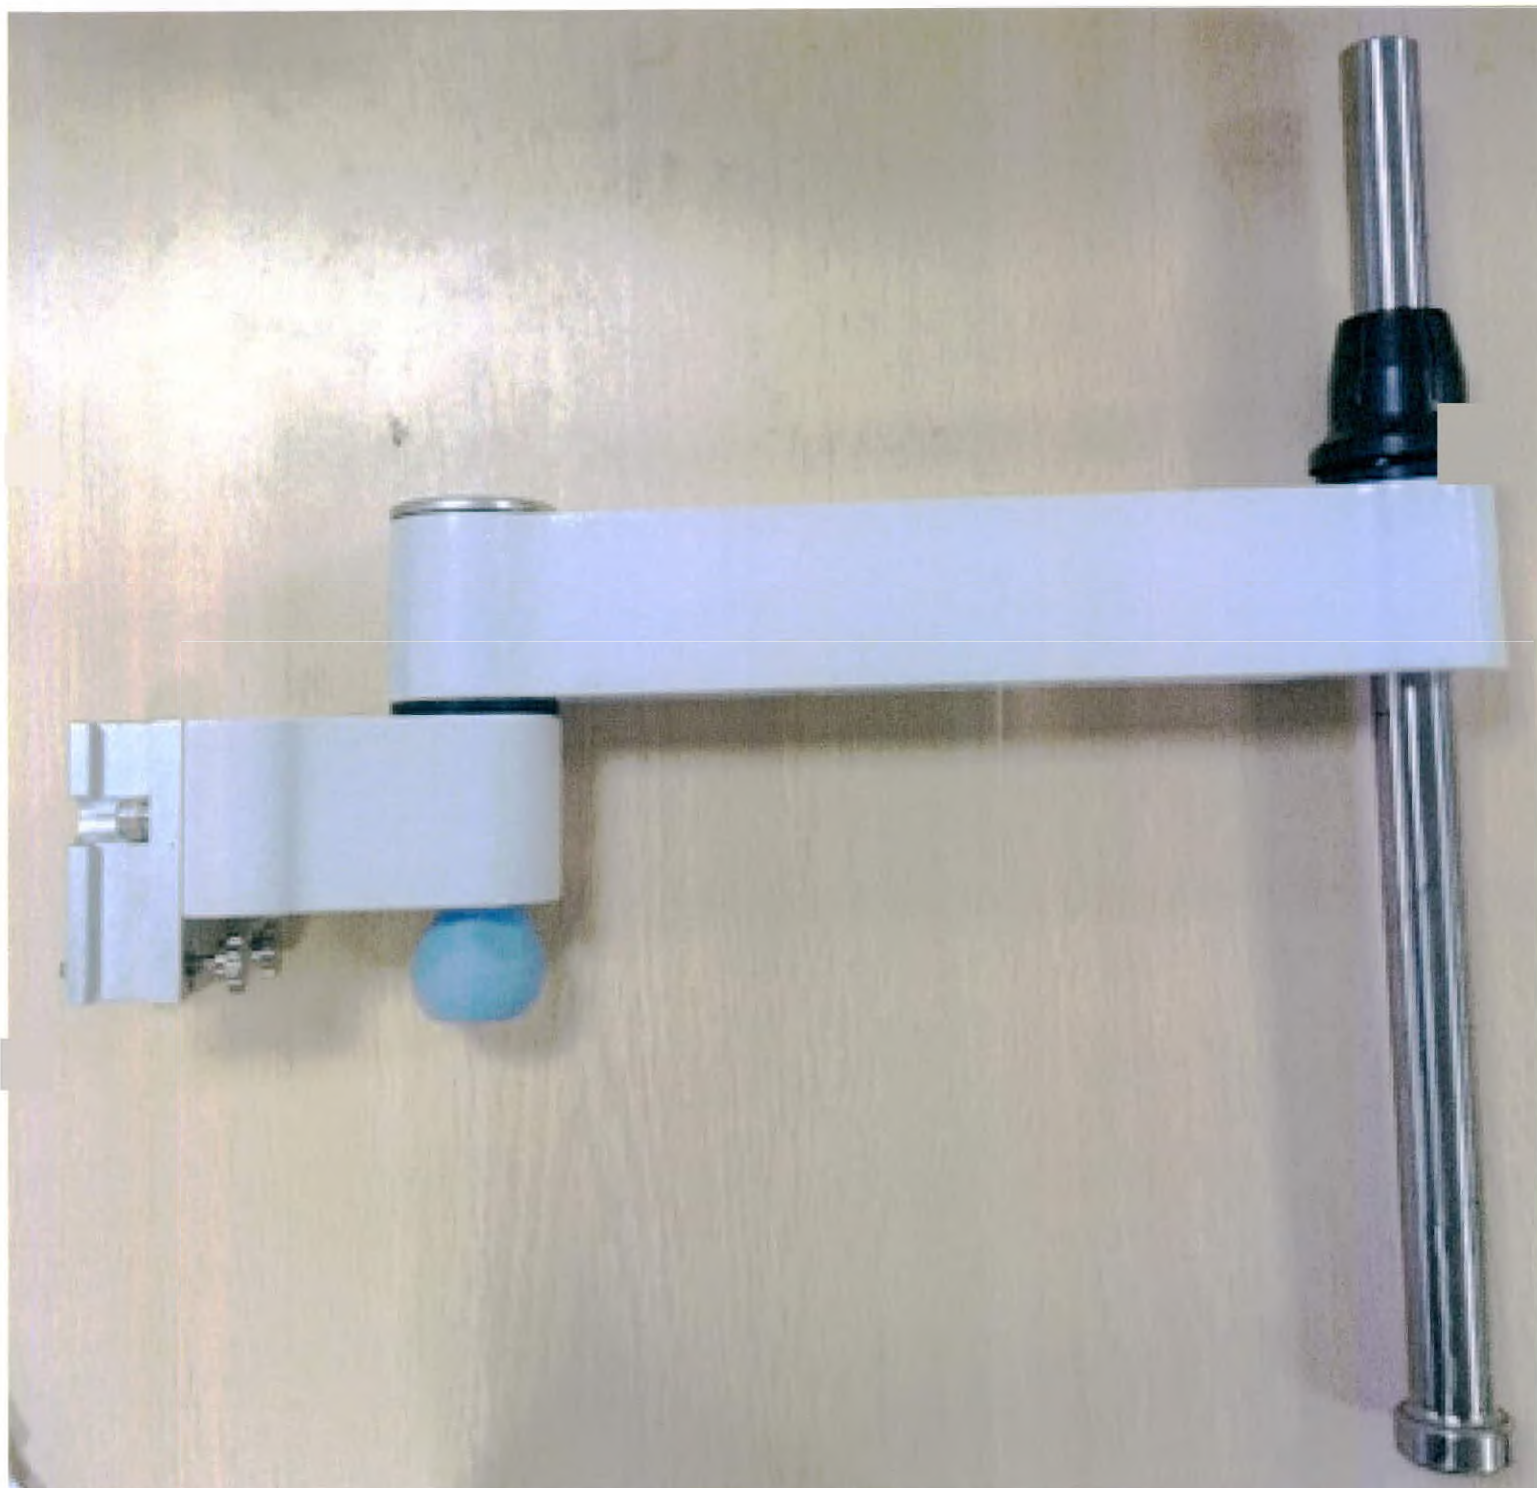


Кронштейн для крепления инфузионной помпы – не более 2 шт.

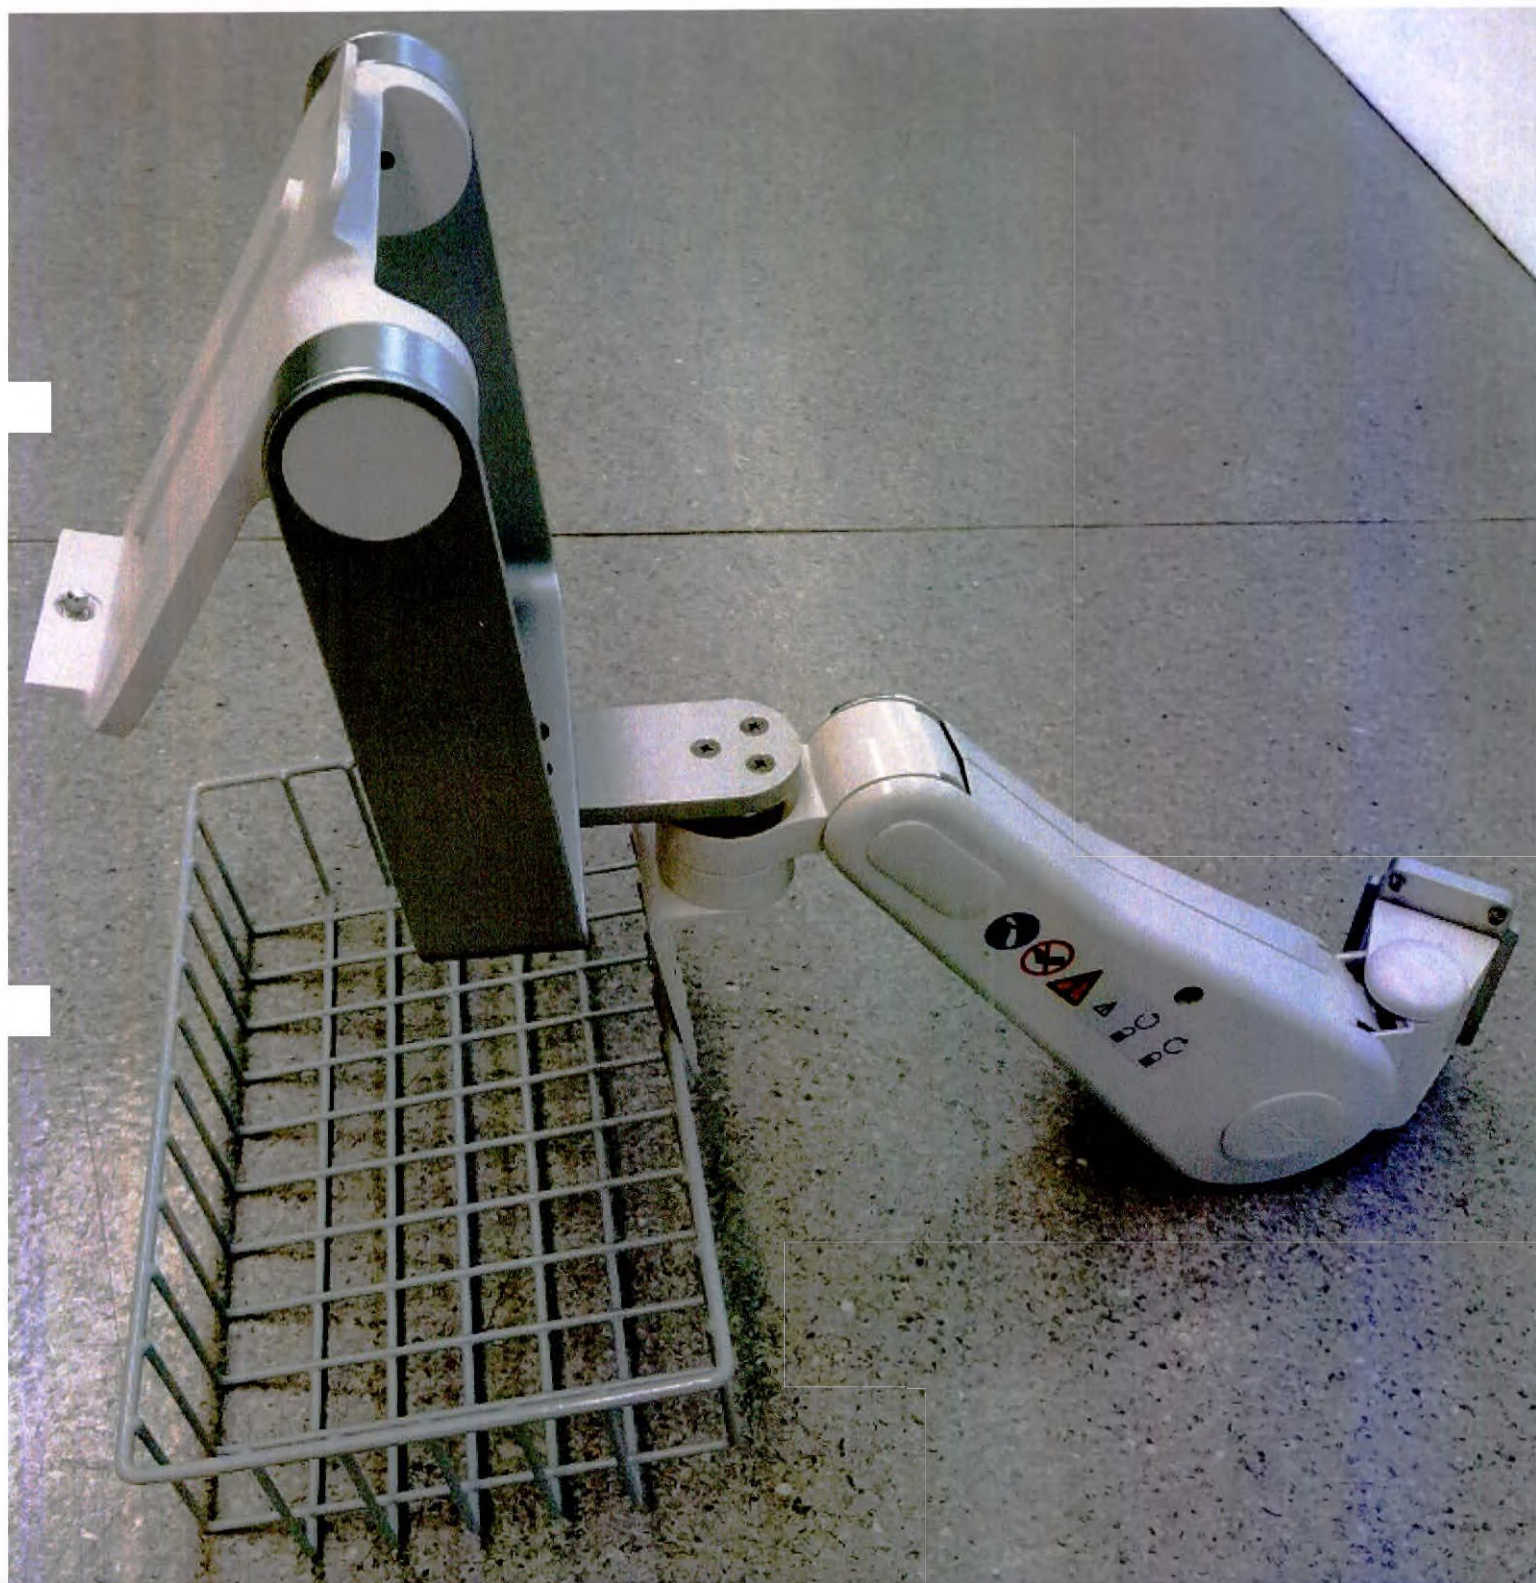


Кронштейн для крепления ультразвукового аппарата TE7 – не более 2 шт.

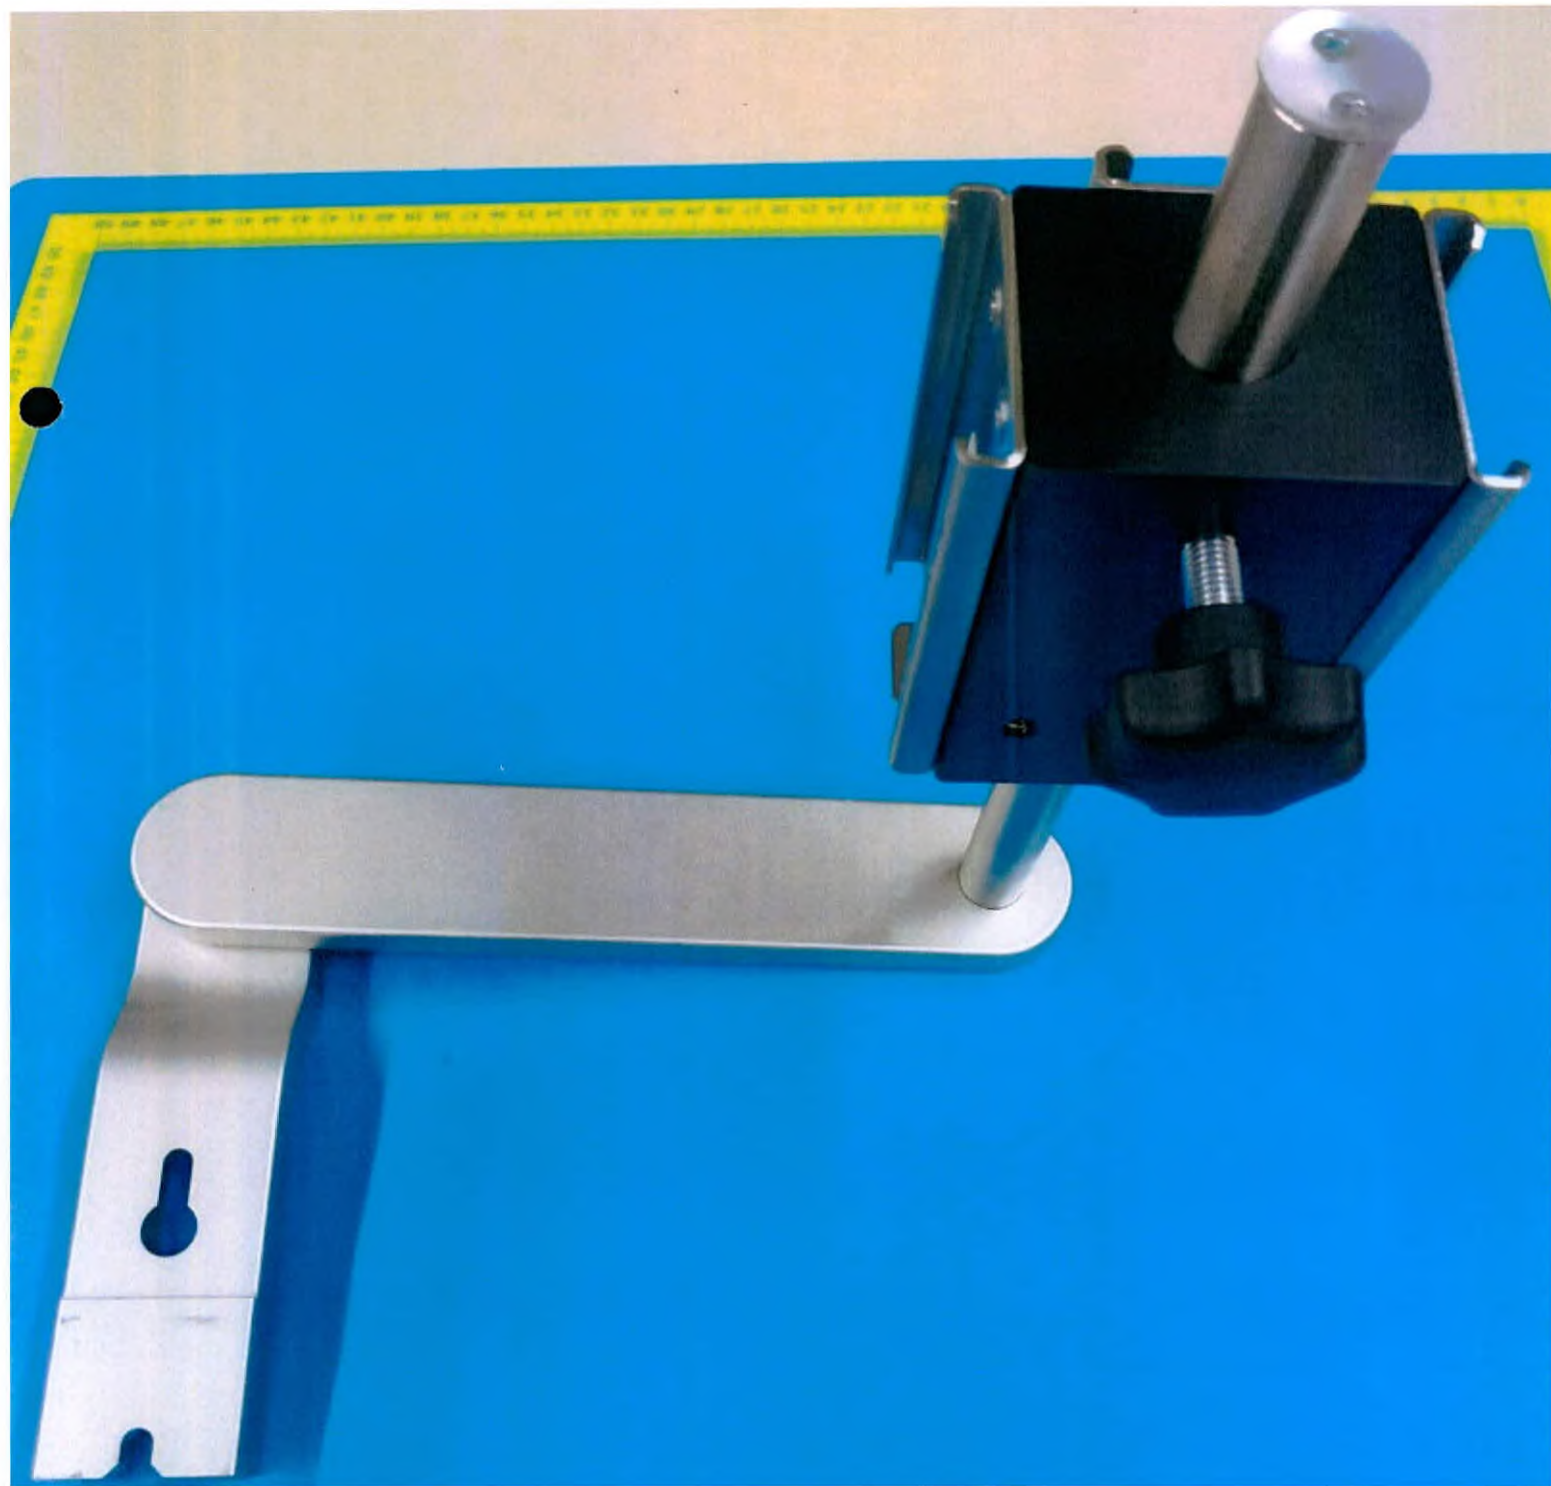

Кронштейн для увлажнителя и колб системы аспирации – не более 2 шт.

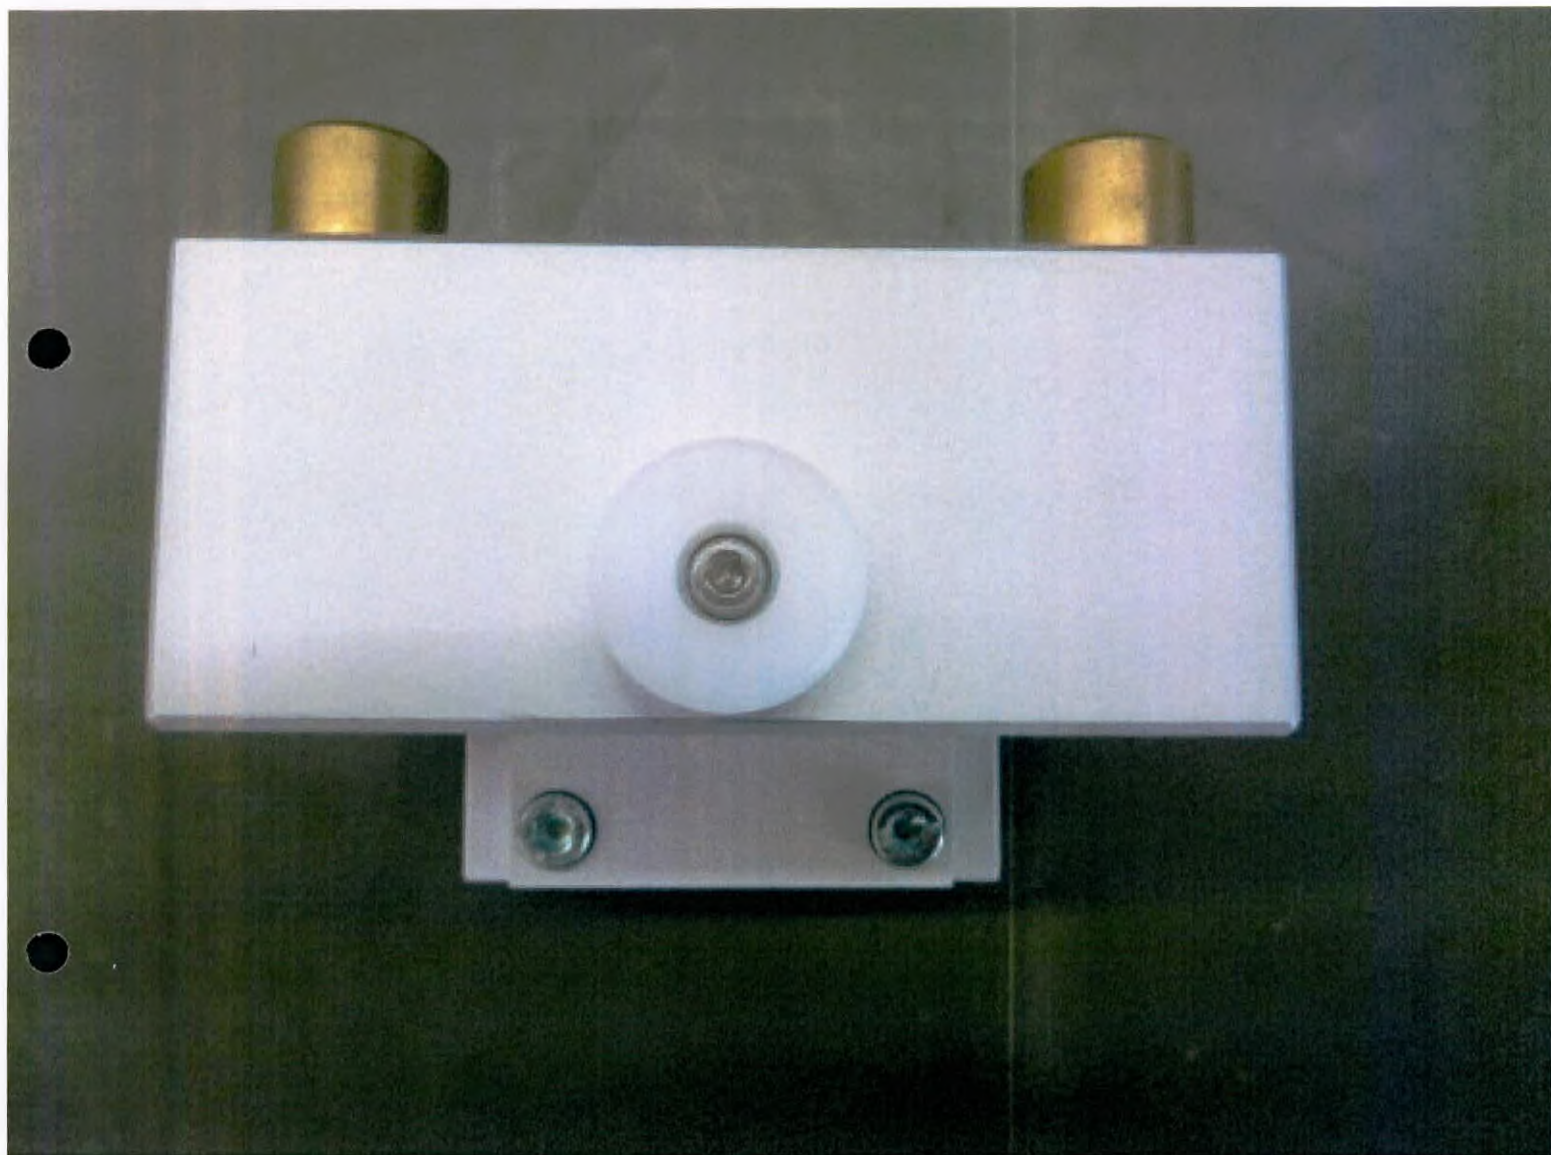

Опорный элемент для испарителя – не более 2 шт.

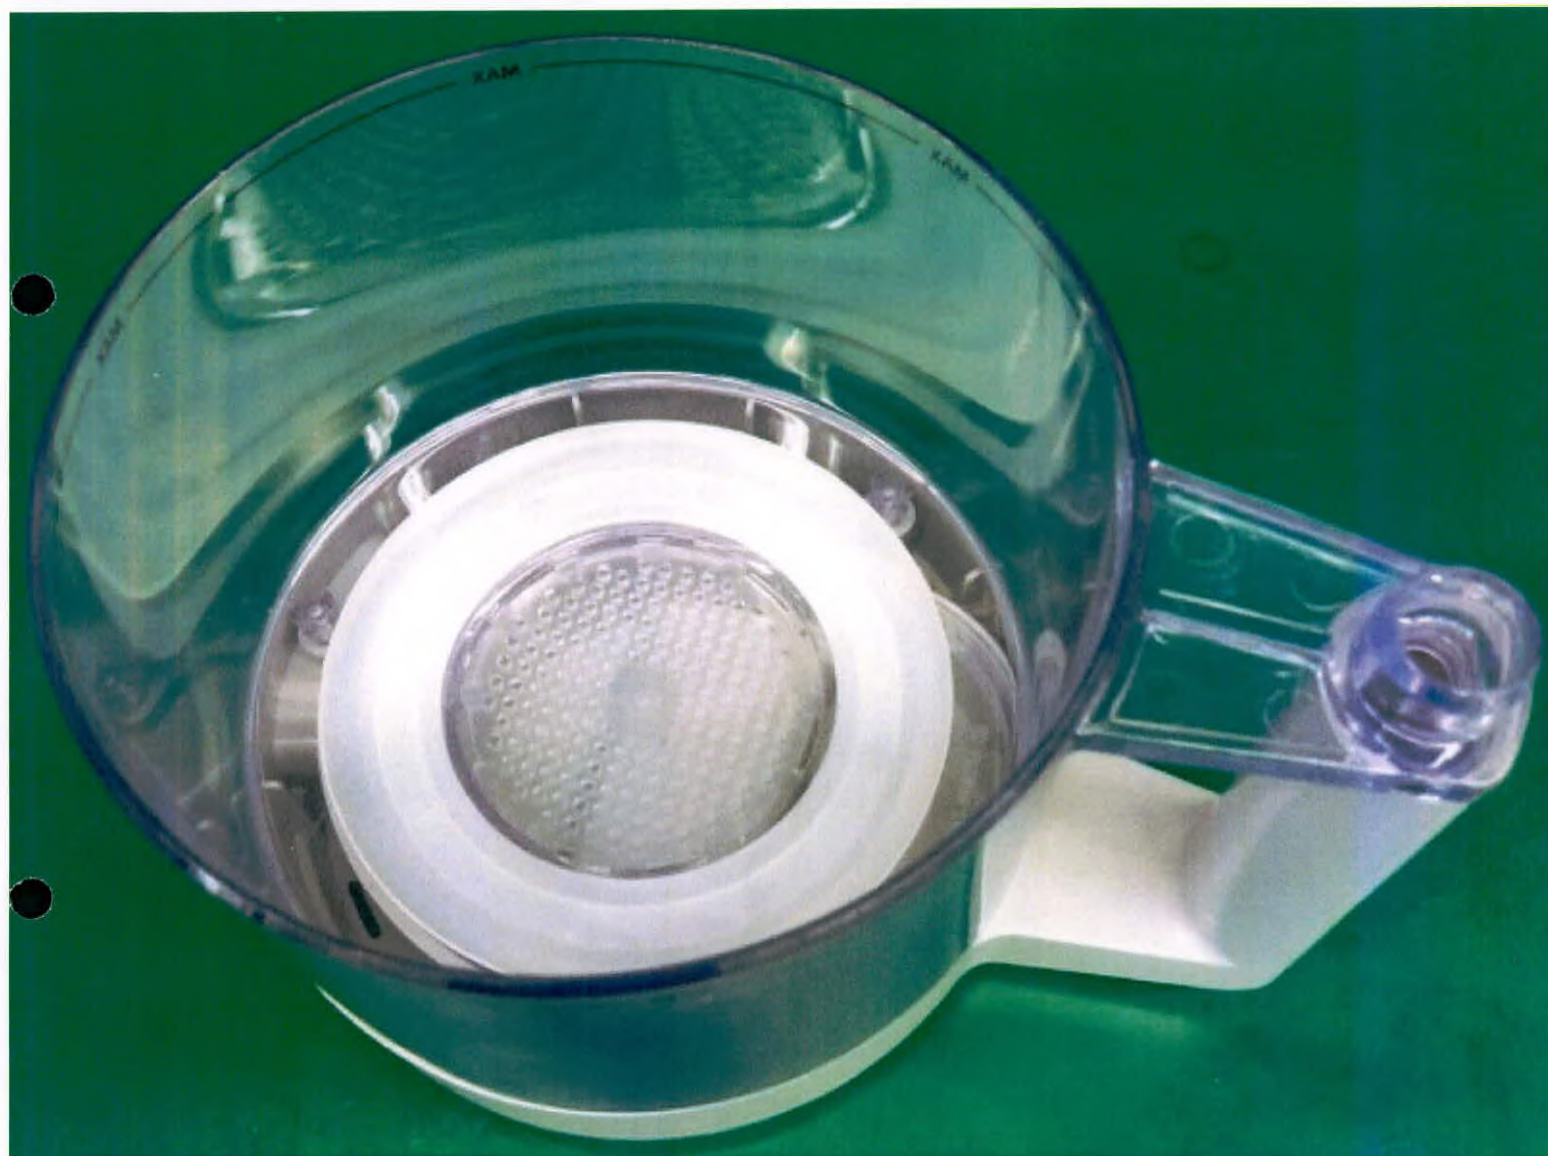

Емкость для абсорбента – не более 5 шт



Уплотнитель для газовых баллонов – не более 5 шт



Ключ для газовых баллонов – не более 5 шт



Линия возврата газа с коннектором – не более 20 шт.



ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТ 08

Сысоев

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСоев Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ