«Утверждаю»
Управляющий
ООО «Контрольный тест»
ИП Син О.В.
«21» декабря 2022

М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного определения антигена SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом в образцах слюны «C-test Ag Covid-19-S (SARS-CoV-2)» по ТУ 21.20.23-010-46753495-2022, Lot 04»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Комплект №1

Состав набора:

- Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) – 1 шт;
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором, 0,3 мл - 1 шт;
- Воронка для забора слюны с пробиркой с насадкой капельницей – 1 шт;
- Инструкция по применению - 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид и маркировка внешней упаковки

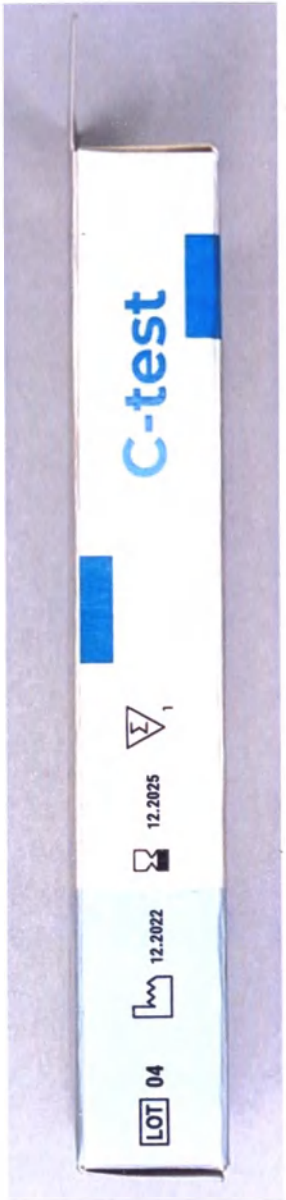

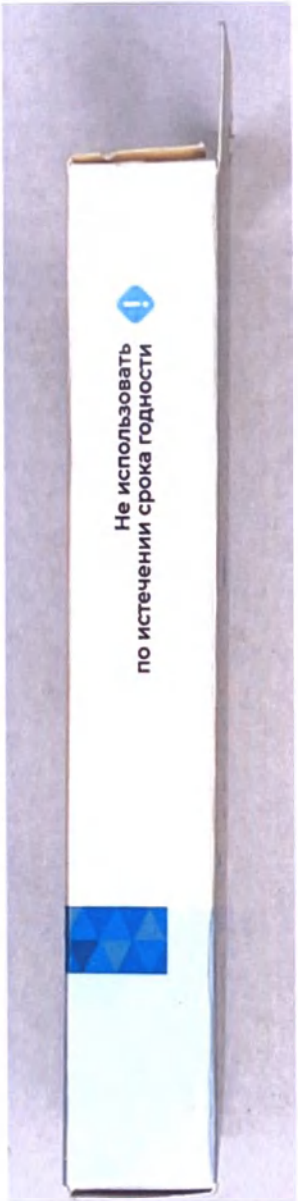

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Содержимое внешней упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем)

Воронка для забора слюны с пробиркой с насадкой капельницей

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором, 0,3 мл

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект №2

Состав набора:

- Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) –2 шт;
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором, 0,3 мл - 2 шт;
- Воронка для забора слюны с пробиркой с насадкой капельницей – 2 шт;
- Инструкция по применению - 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид и маркировка внешней упаковки

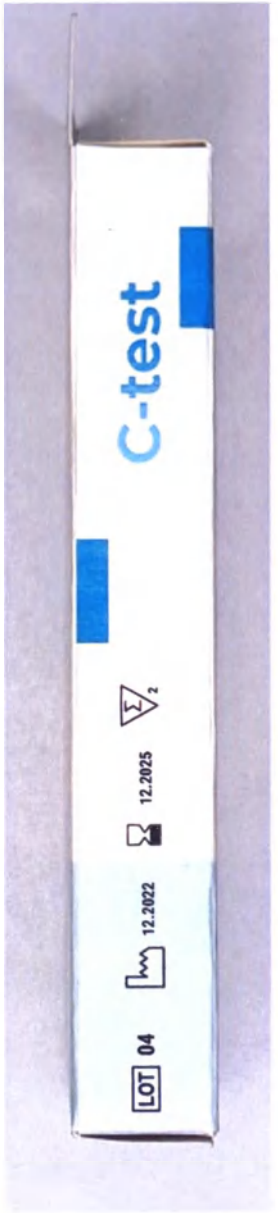

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Содержимое внешней упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем)

Воронка для забора слюны с пробиркой с насадкой капельницей

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором, 0,3 мл

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект №3

Состав набора:

- Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) – 5 шт;
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором, 0,3 мл - 5 шт;
- Воронка для забора слюны с пробиркой с насадкой капельницей – 5 шт;
- Инструкция по применению - 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид и маркировка внешней упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Содержимое внешней упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем)

Воронка для забора слюны с пробиркой с насадкой капельницей

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором, 0,3 мл

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект №4

Состав набора:

- Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) – 25 шт;
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором, 0,3 мл - 25 шт;
- Воронка для забора слюны с пробиркой с насадкой капельницей – 25 шт;
- Инструкция по применению - 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общий вид и маркировка внешней упаковки

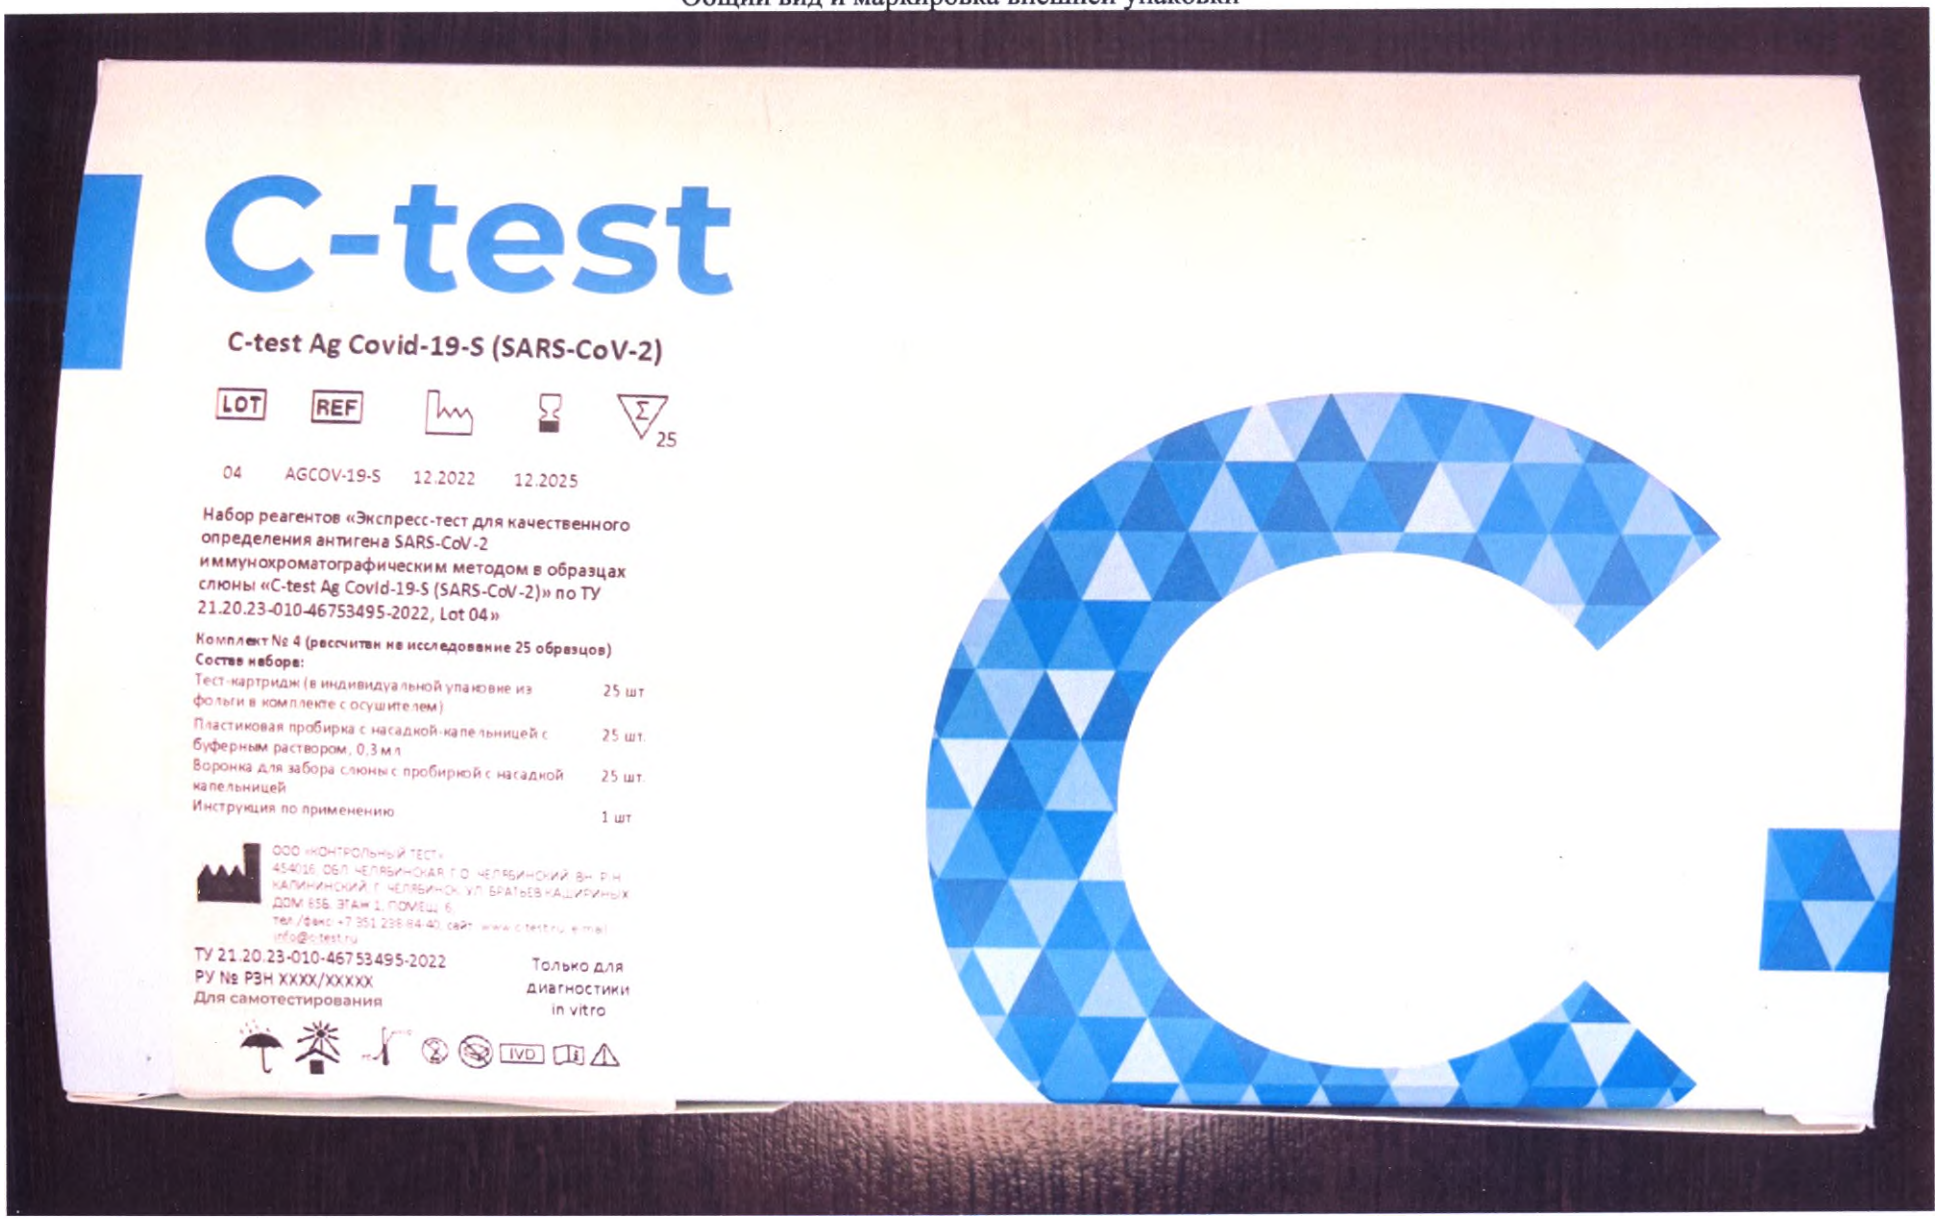

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

C-test
«C-test Ag Covid-19-S (SARS-CoV-2)»
Тест-картридж
LOT 04
12.2025
C-test
«C-test Ag Covid-19-S (SARS-CoV-2)»
Тест-картридж
LOT 04
12.2025
C-test
C-test
C-test

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

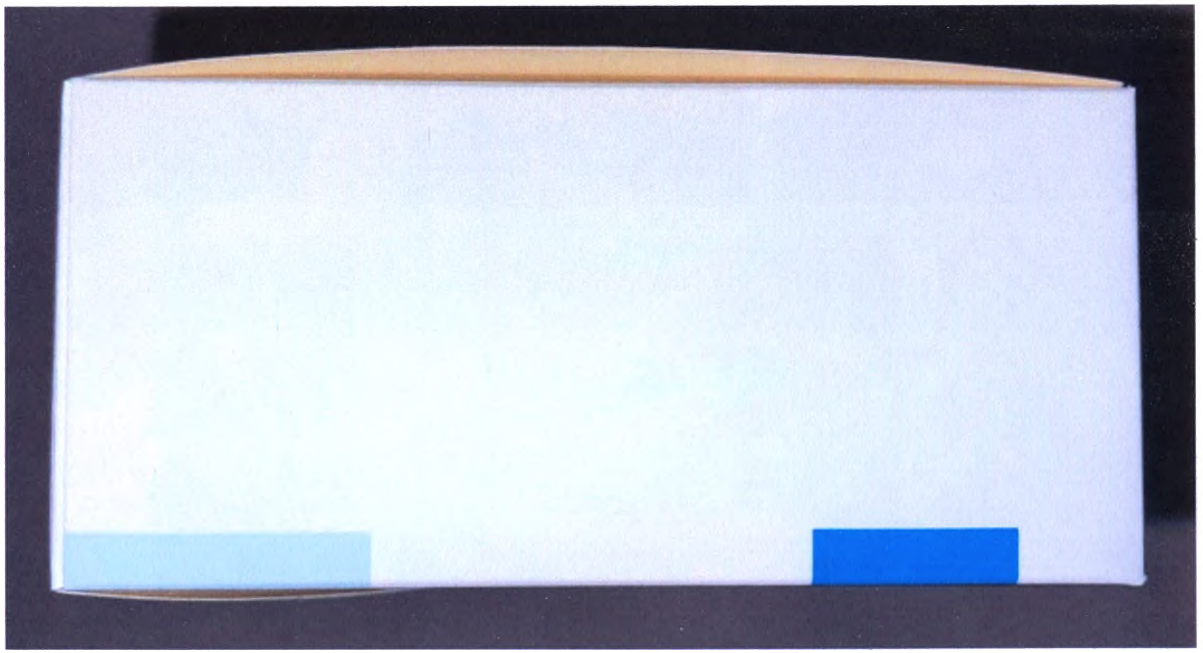

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Содержимое внешней упаковки

Тест-картридж (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем)

Воронка для забора слюны с пробиркой с насадкой капельницей

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором, 0,3 мл

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 23 листов.
Управляющий
ООО «Контрольный тест»
ИП Син О. I
М.П.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU