



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПТ «Мелитта»



Я. А. Гольдштейн

2023 г.

Установка импульсная ультрафиолетовая с дистанционным пультом управления и автоматической установкой времени работы для обеззараживания воздуха помещений 1-5-ой категории объемом до 75 м³ при отсутствии людей "Альфа-05" по ТУ 9451-005-39577448-2004


Фотографии

Комплект поставки


Установка импульсная ультрафиолетовая с дистанционным пультом управления и автоматической установкой времени работы для обеззараживания воздуха помещений 1-5-ой категории объемом до 75 м³ при отсутствии людей "Альфа-05" по ТУ 9451-005-39577448-2004 в составе:

- | | |
|---|-------|
| 1. Основной блок Установки | 1 шт. |
| 2. Шнур питания основного блока Установки | 1 шт. |
| 3. Пульт дистанционного управления | 1 шт. |
| 4. Ключ включения/выключения | 2 шт. |
| Эксплуатационная документация в составе: | |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |


Основной блок Установки (вид спереди)

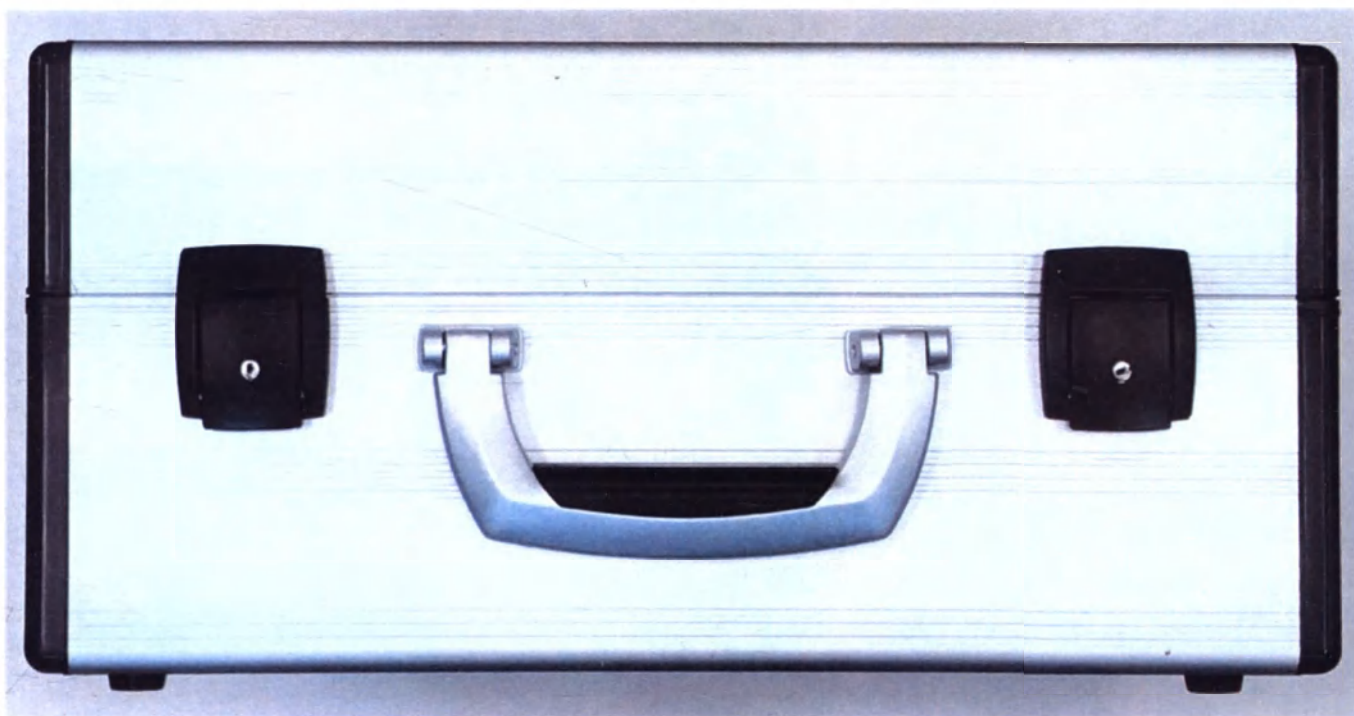


Основной блок Установки (вид сзади)

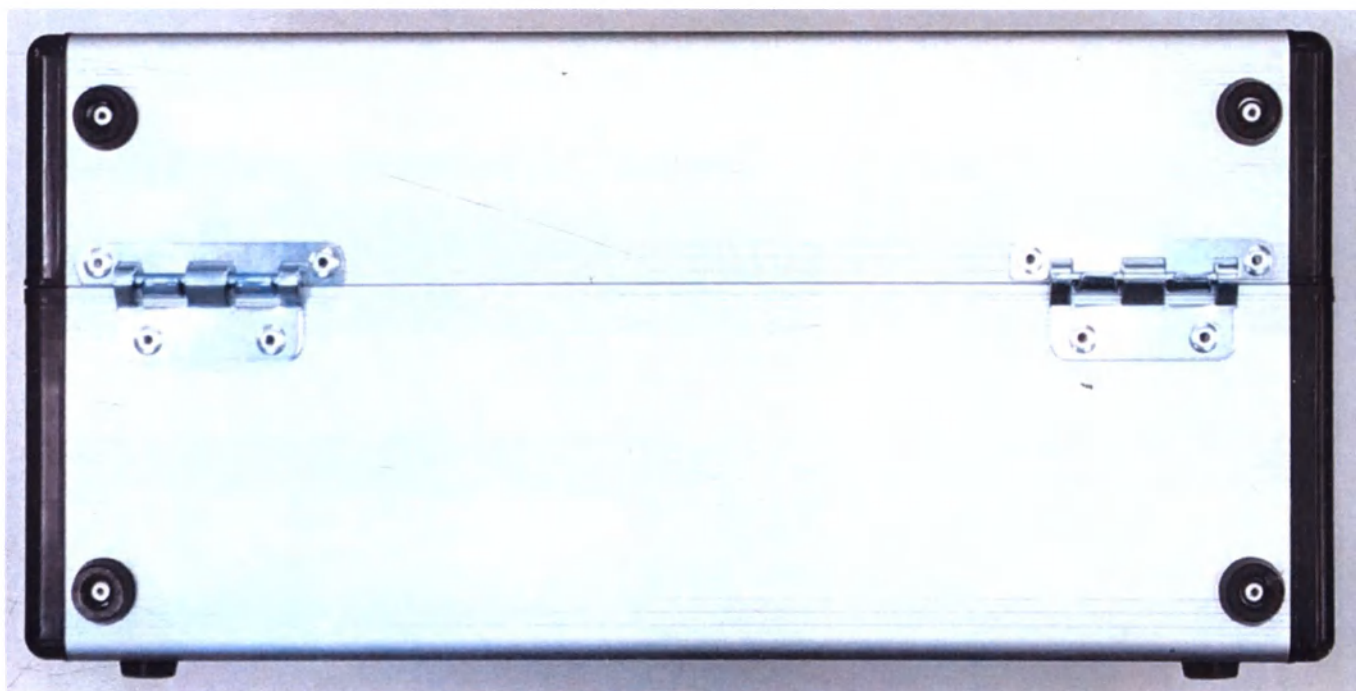

Основной блок Установки (вид слева)

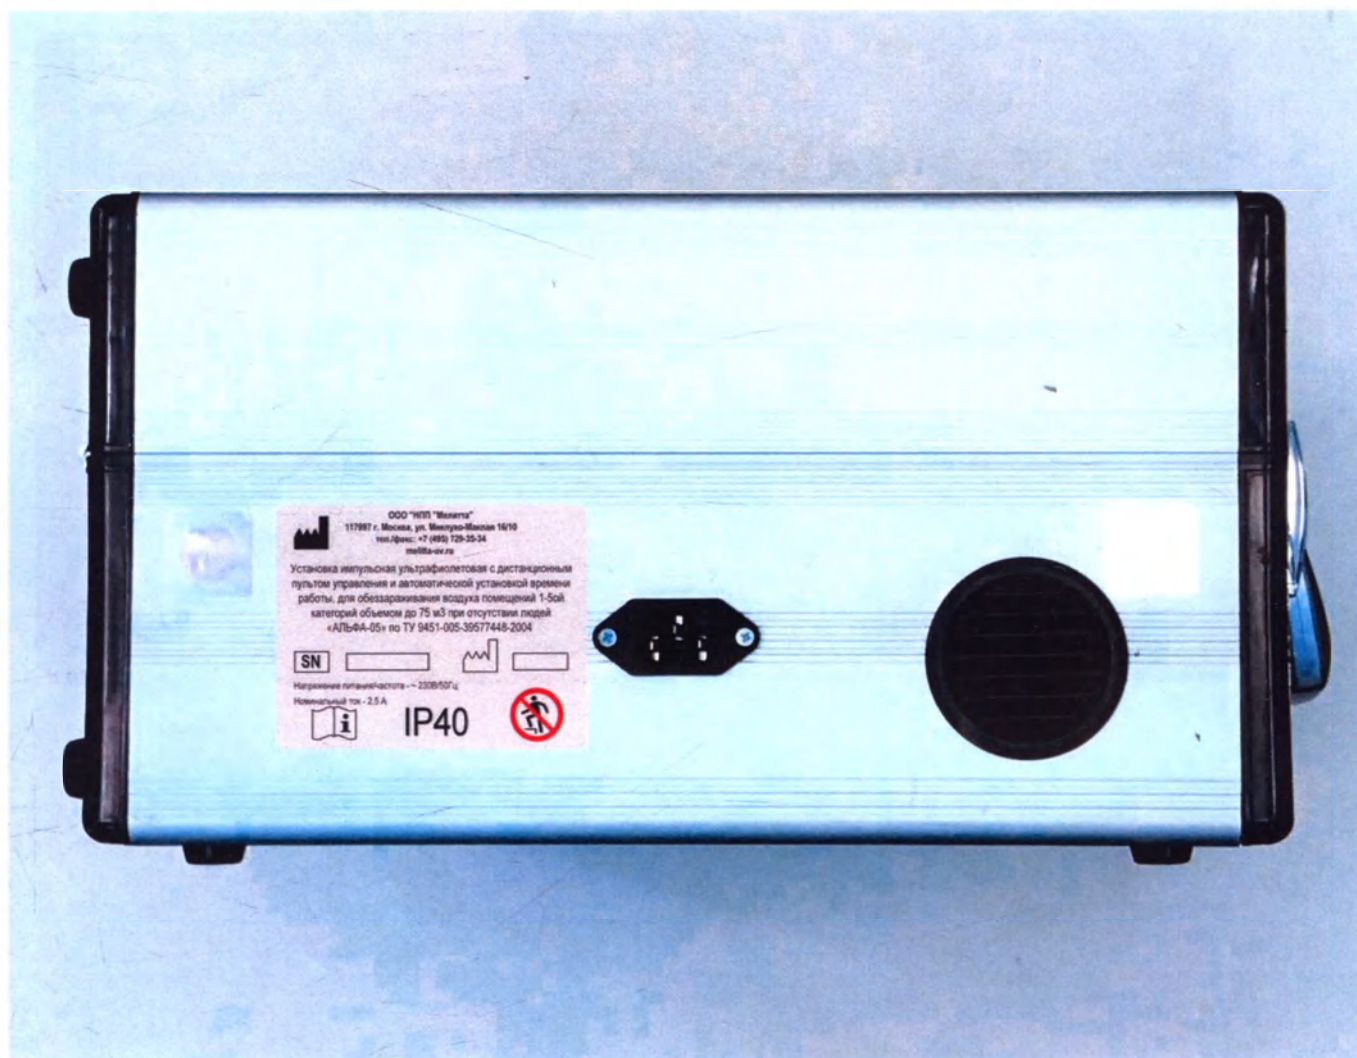


Основной блок Установки (вид справа)

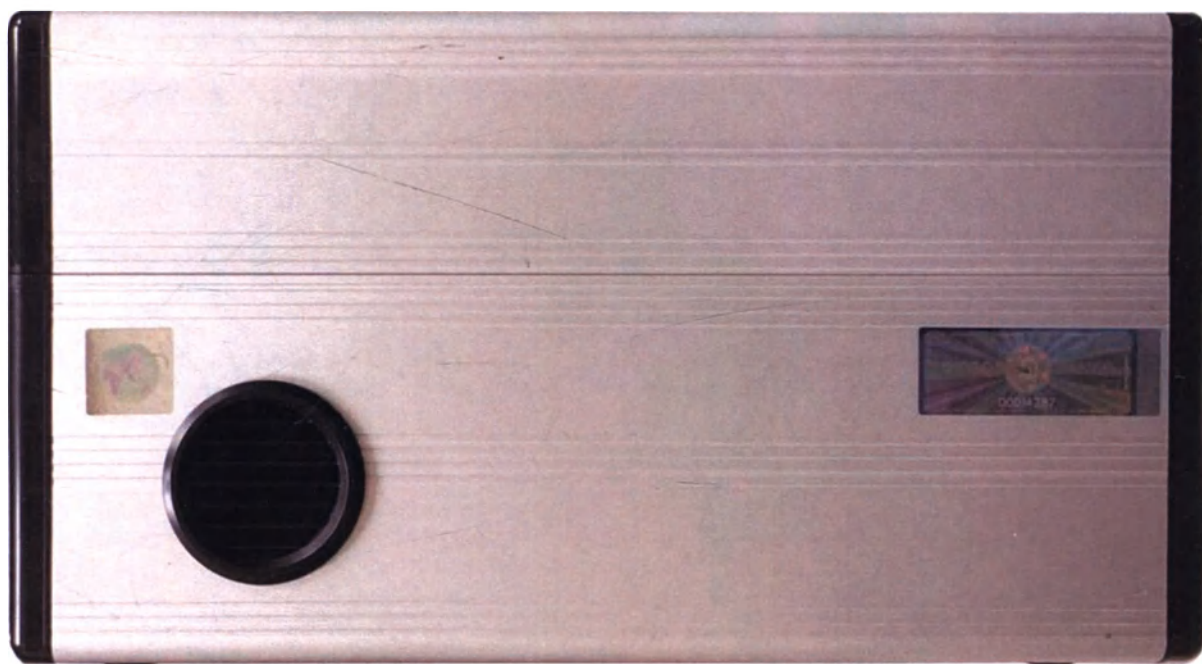

Основной блок Установки (вид сверху)



**Основной блок Установки (вид сверху) с ключом включения/выключения.
Рабочее положение**

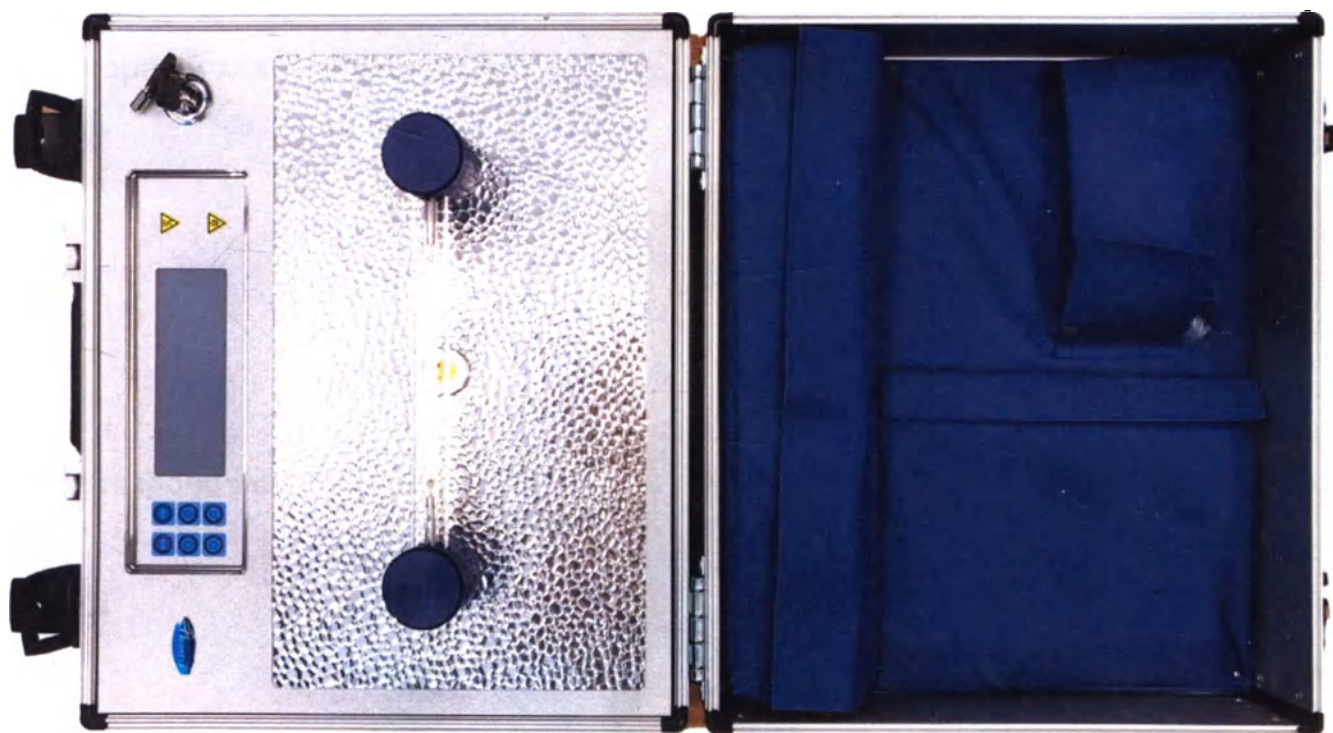

Маркировка наружной части

Товарный знак производителя




Маркировочная табличка



Пломбировочная наклейка



Пломбировочная наклейка

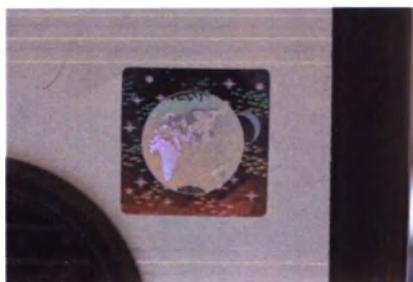

Пломбировочная наклейка



Шнур питания основного блока Установки



Пульт дистанционного управления



Паспорт

ОКПД2 32.50.50.190
ТН ВЭД 9018 2000 0

ПАСПОРТ

МЮРА.941712.015ПС

Установка импульсная ультрафиолетовая
с дистанционным пультом управления
и автоматической установкой времени работы
для обеззараживания воздуха помещений
1–5ой категории объемом до 75 м³ при отсутствии людей

«АЛЬФА-05»

по ТУ 9451-005-39577448-2004



ОКПД2 32.50.50.190
ТН ВЭД 9018 2000 0

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЮРА.941712.015РЭ

Установка импульсная ультрафиолетовая
с дистанционным пультом управления
и автоматической установкой времени работы
для обеззараживания воздуха помещений
1–5ой категории объемом до 75 м³ при отсутствии людей

«АЛЬФА-05»

по ТУ 9451-005-39577448-2004



Всего прошнуровано и скреплено
печатью 13/01/2016 лист (ов)

Генеральный директор
Тольдштейн Я.А.

