

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«5» апреля 2023 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197
КУСАВЛО Р. В.


Фотографические изображения изделия:

Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV)


«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 50 тестов»

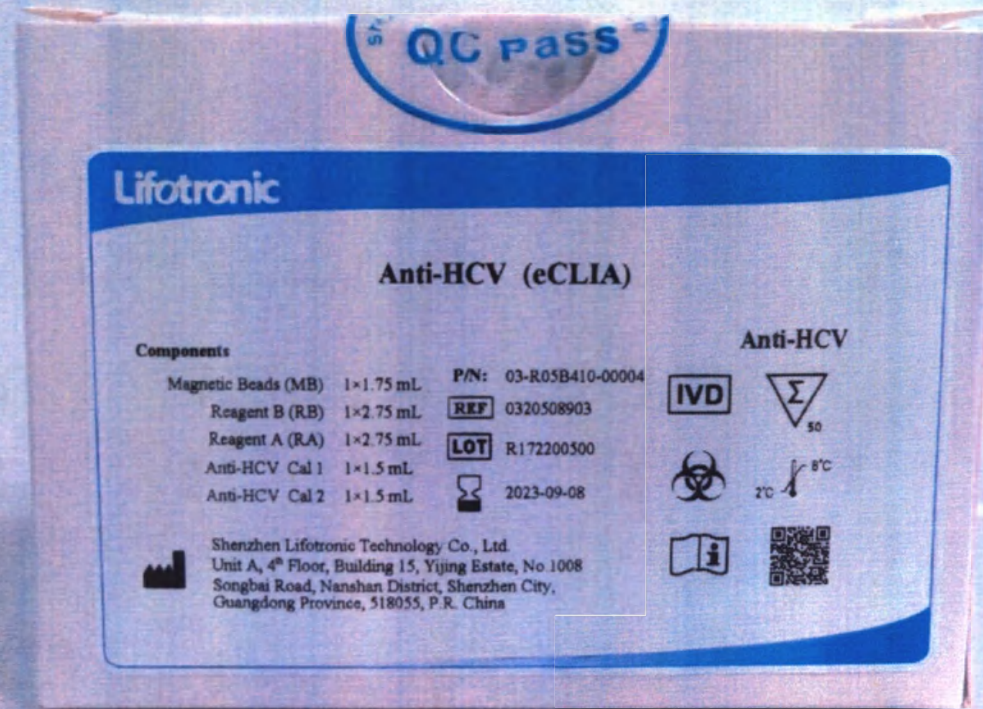

Потребительская упаковка МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 50 тестов»

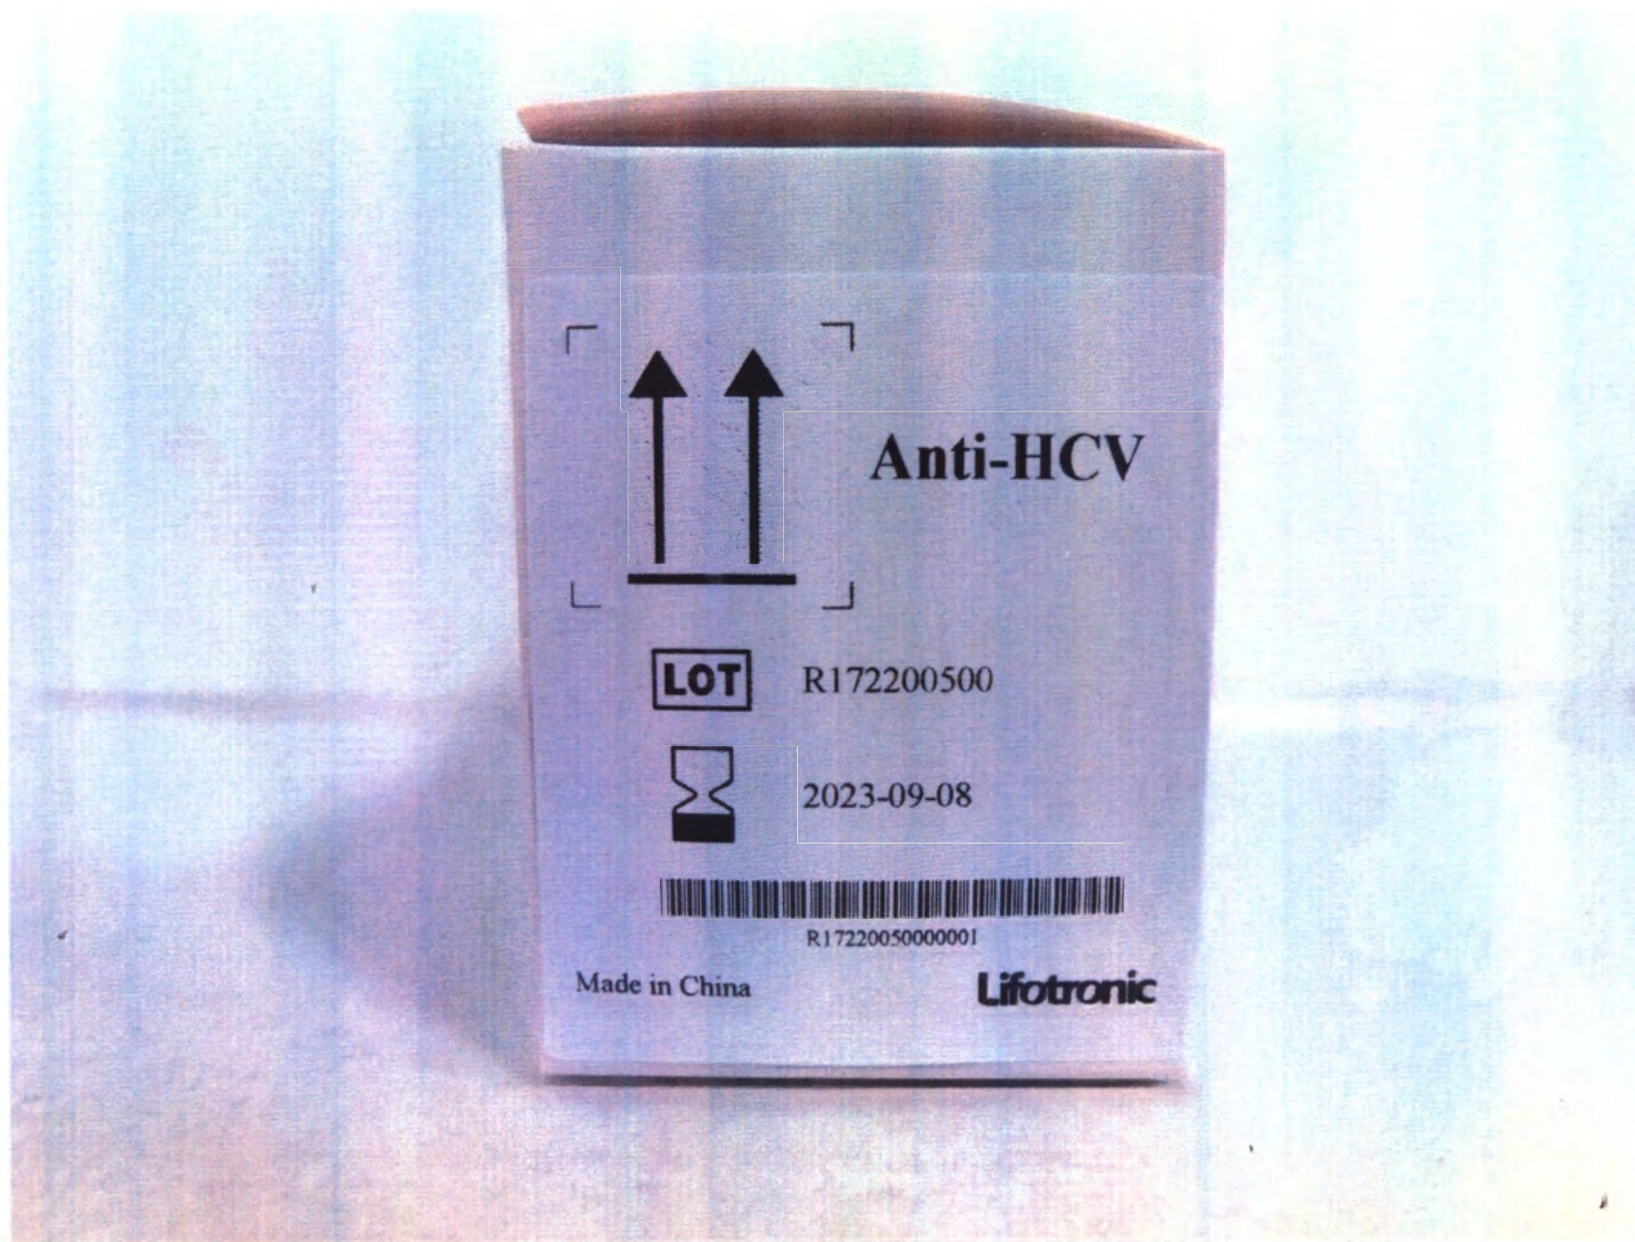


Потребительская упаковка МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 50 тестов»




Кассета с реагентами МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-НСV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 50 тестов»



Калибратор 1 (Cal 1) и Калибратор 2 (Cal 2) МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 50 тестов»

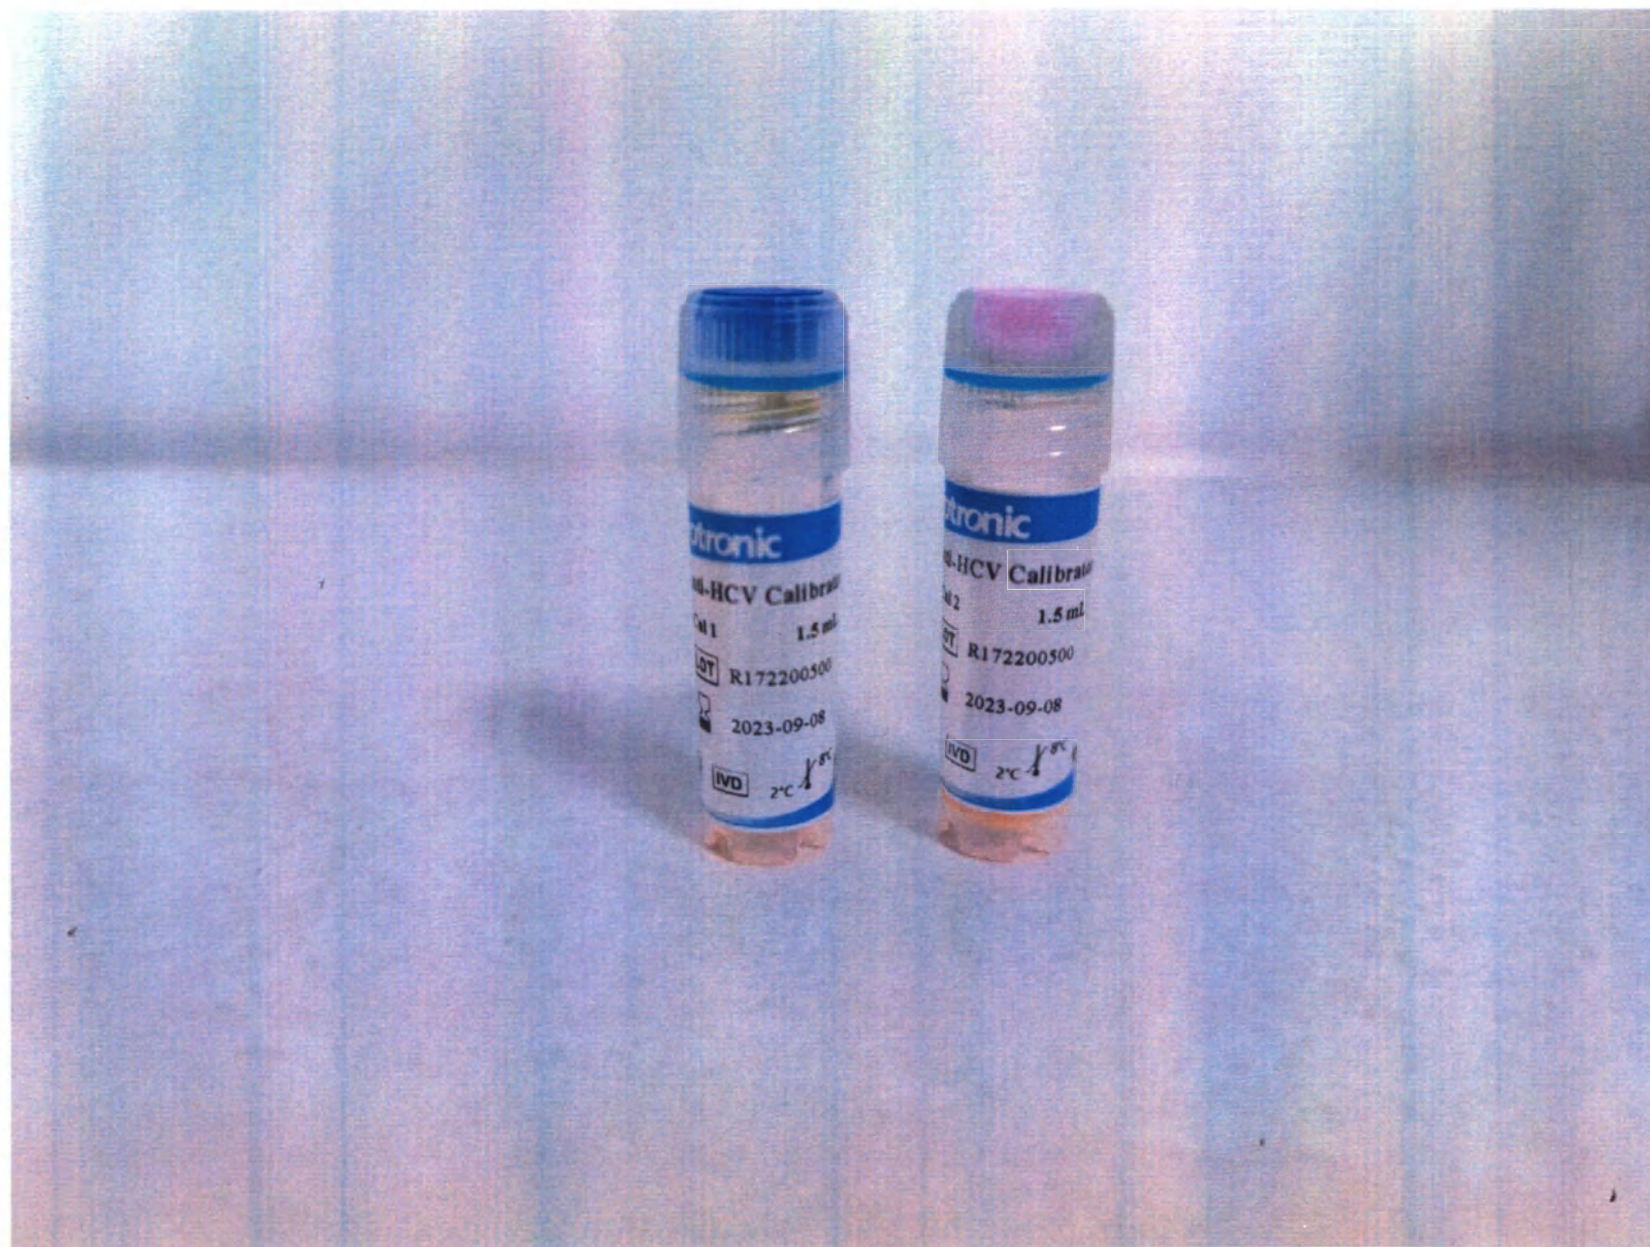

Калибратор 1 (Cal 1) и Калибратор 2 (Cal 2) МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 50 тестов»

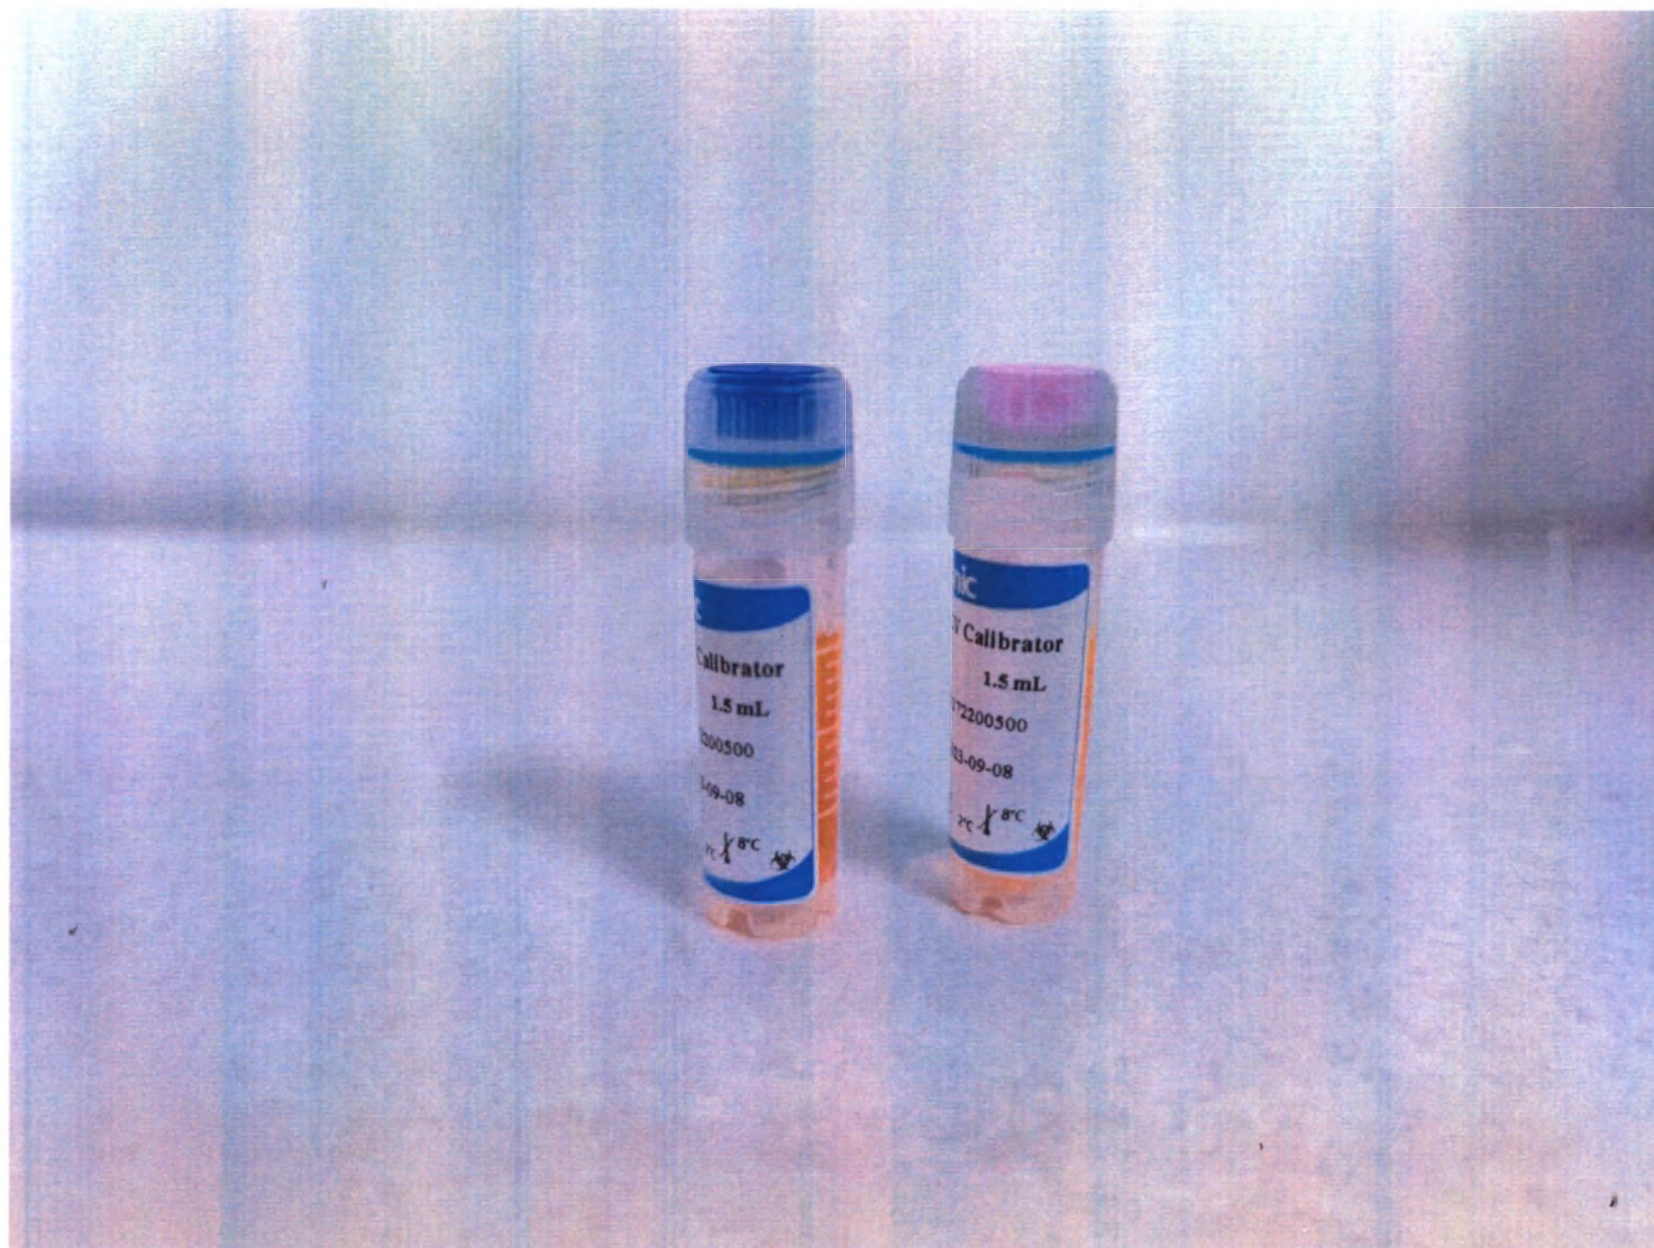

Калибратор 1 (Cal 1) и Калибратор 2 (Cal 2) МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 50 тестов»



Общий вид МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 100 тестов»



Lifotronic

Anti-HCV (eCLIA)

Components

Magnetic Beads (MB)	1×3.5 mL	P/N:	03-R05B410-00001
Reagent B (RB)	1×5.5 mL	REF	0320508901
Reagent A (RA)	1×5.5 mL	LOT	R172200300
Anti-HCV Cal 1	1×1.5 mL		
Anti-HCV Cal 2	1×1.5 mL		2023-11-07



Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No 1008
Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, 518055, P.R. China

Anti-HCV




100



2°C 8°C



Потребительская упаковка МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-НСV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 100 тестов»

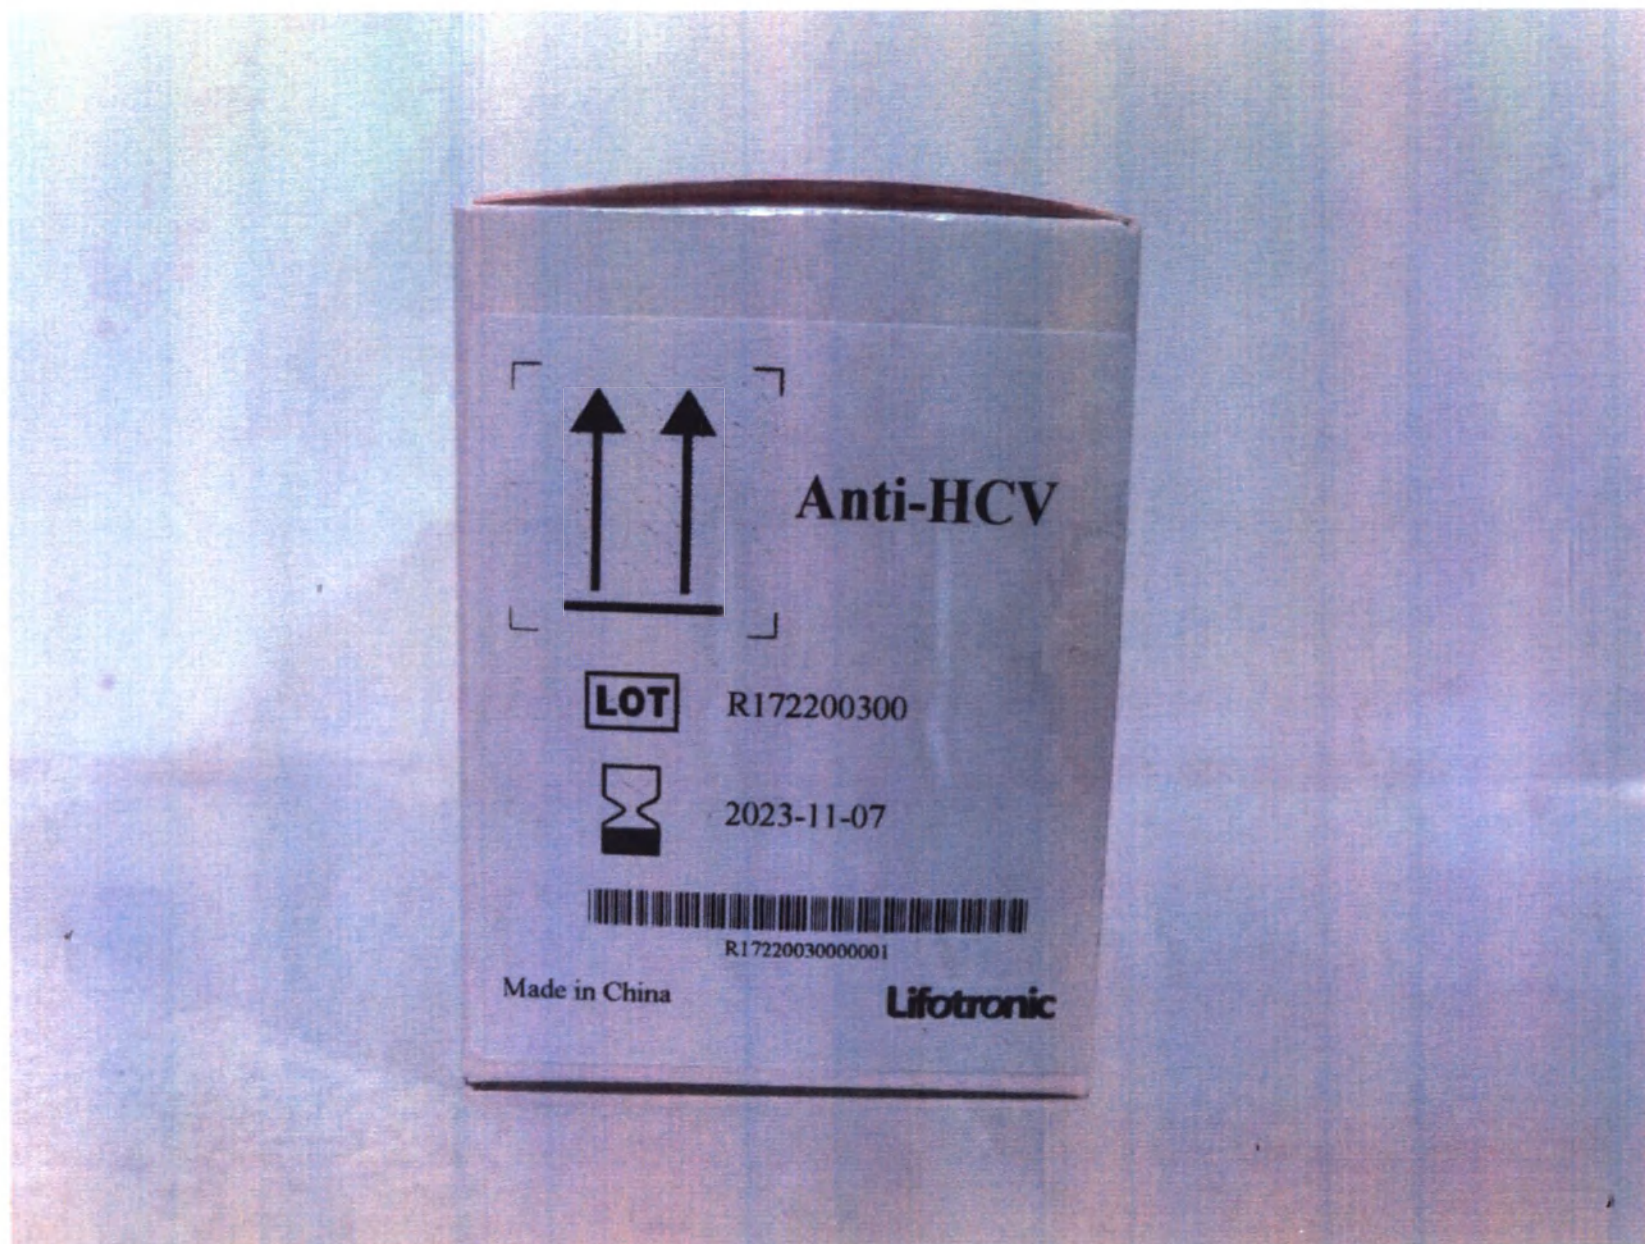


Потребительская упаковка МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-НСV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 100 тестов»




Кассета с реагентами МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 100 тестов»



Калибратор 1 (Cal 1) и Калибратор 2 (Cal 2) МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 100 тестов»

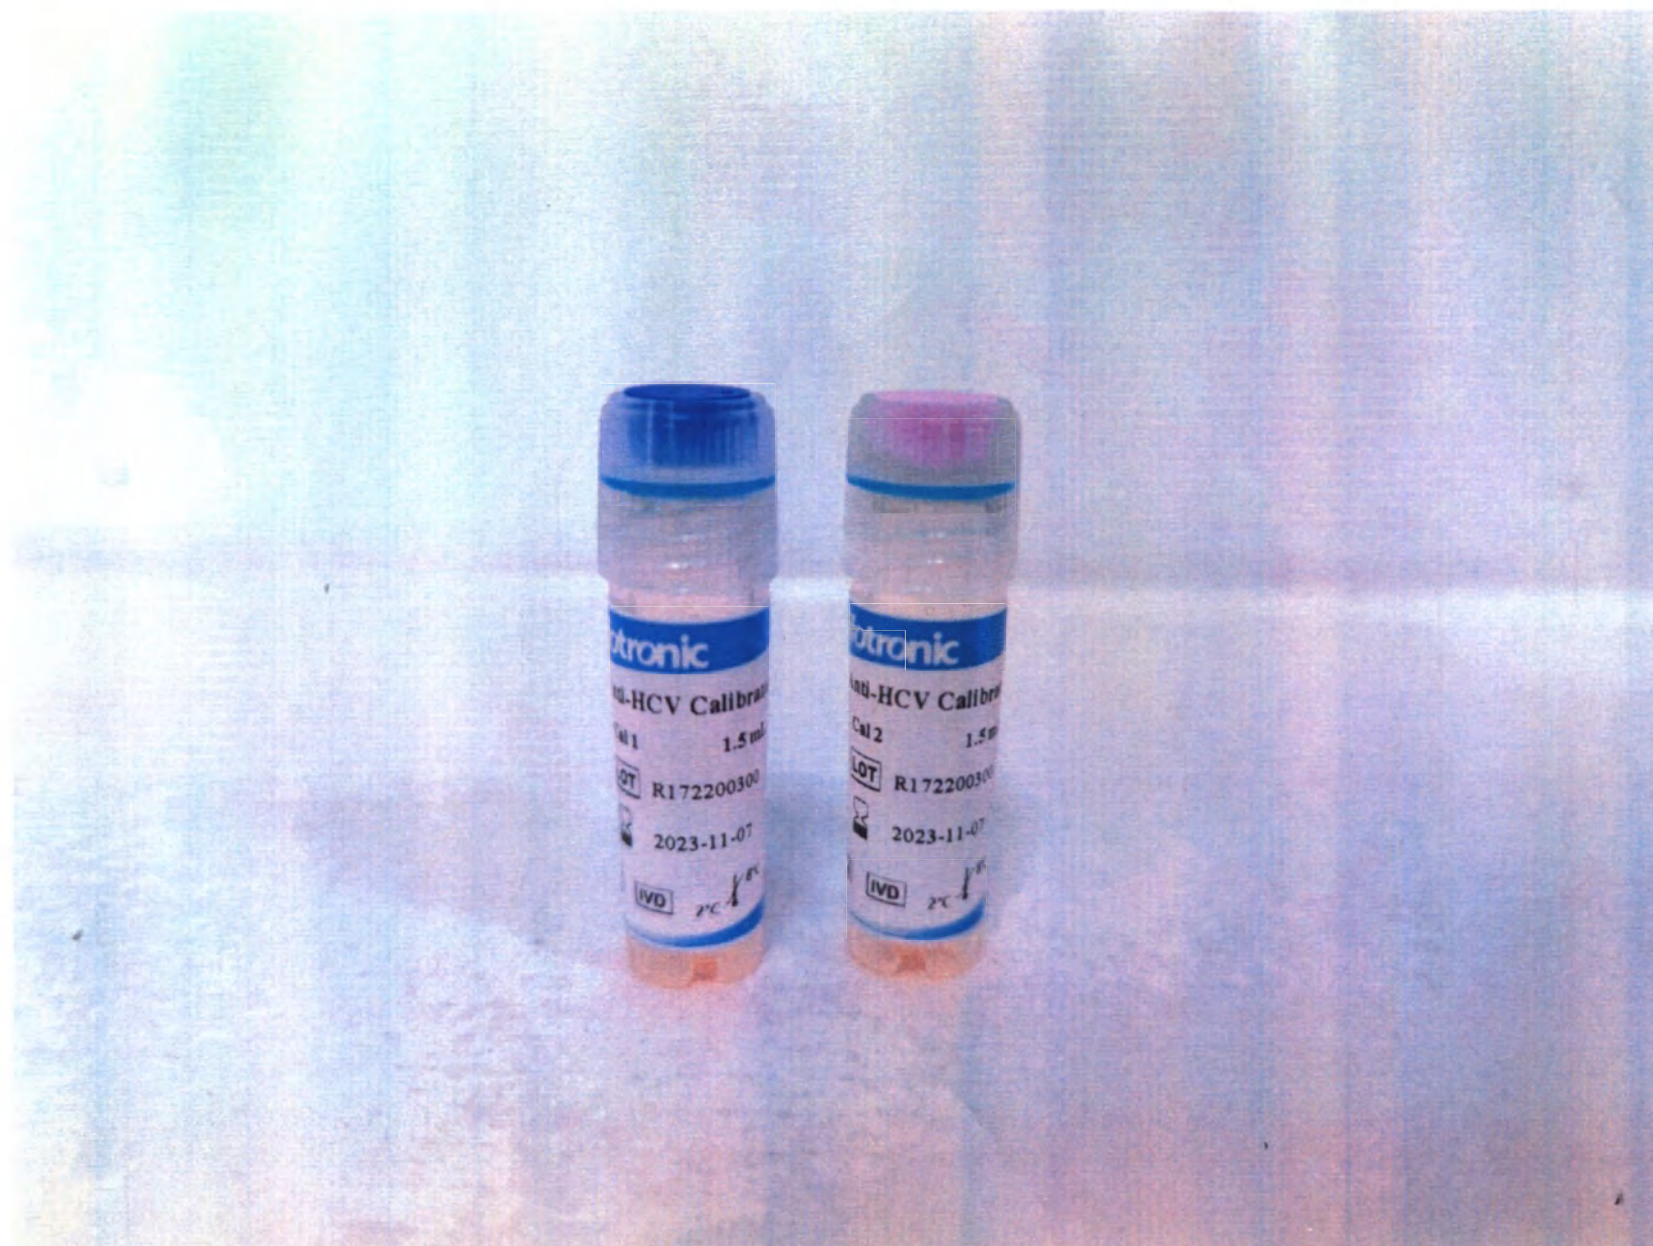


Калибратор 1 (Cal 1) и Калибратор 2 (Cal 2) МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 100 тестов»

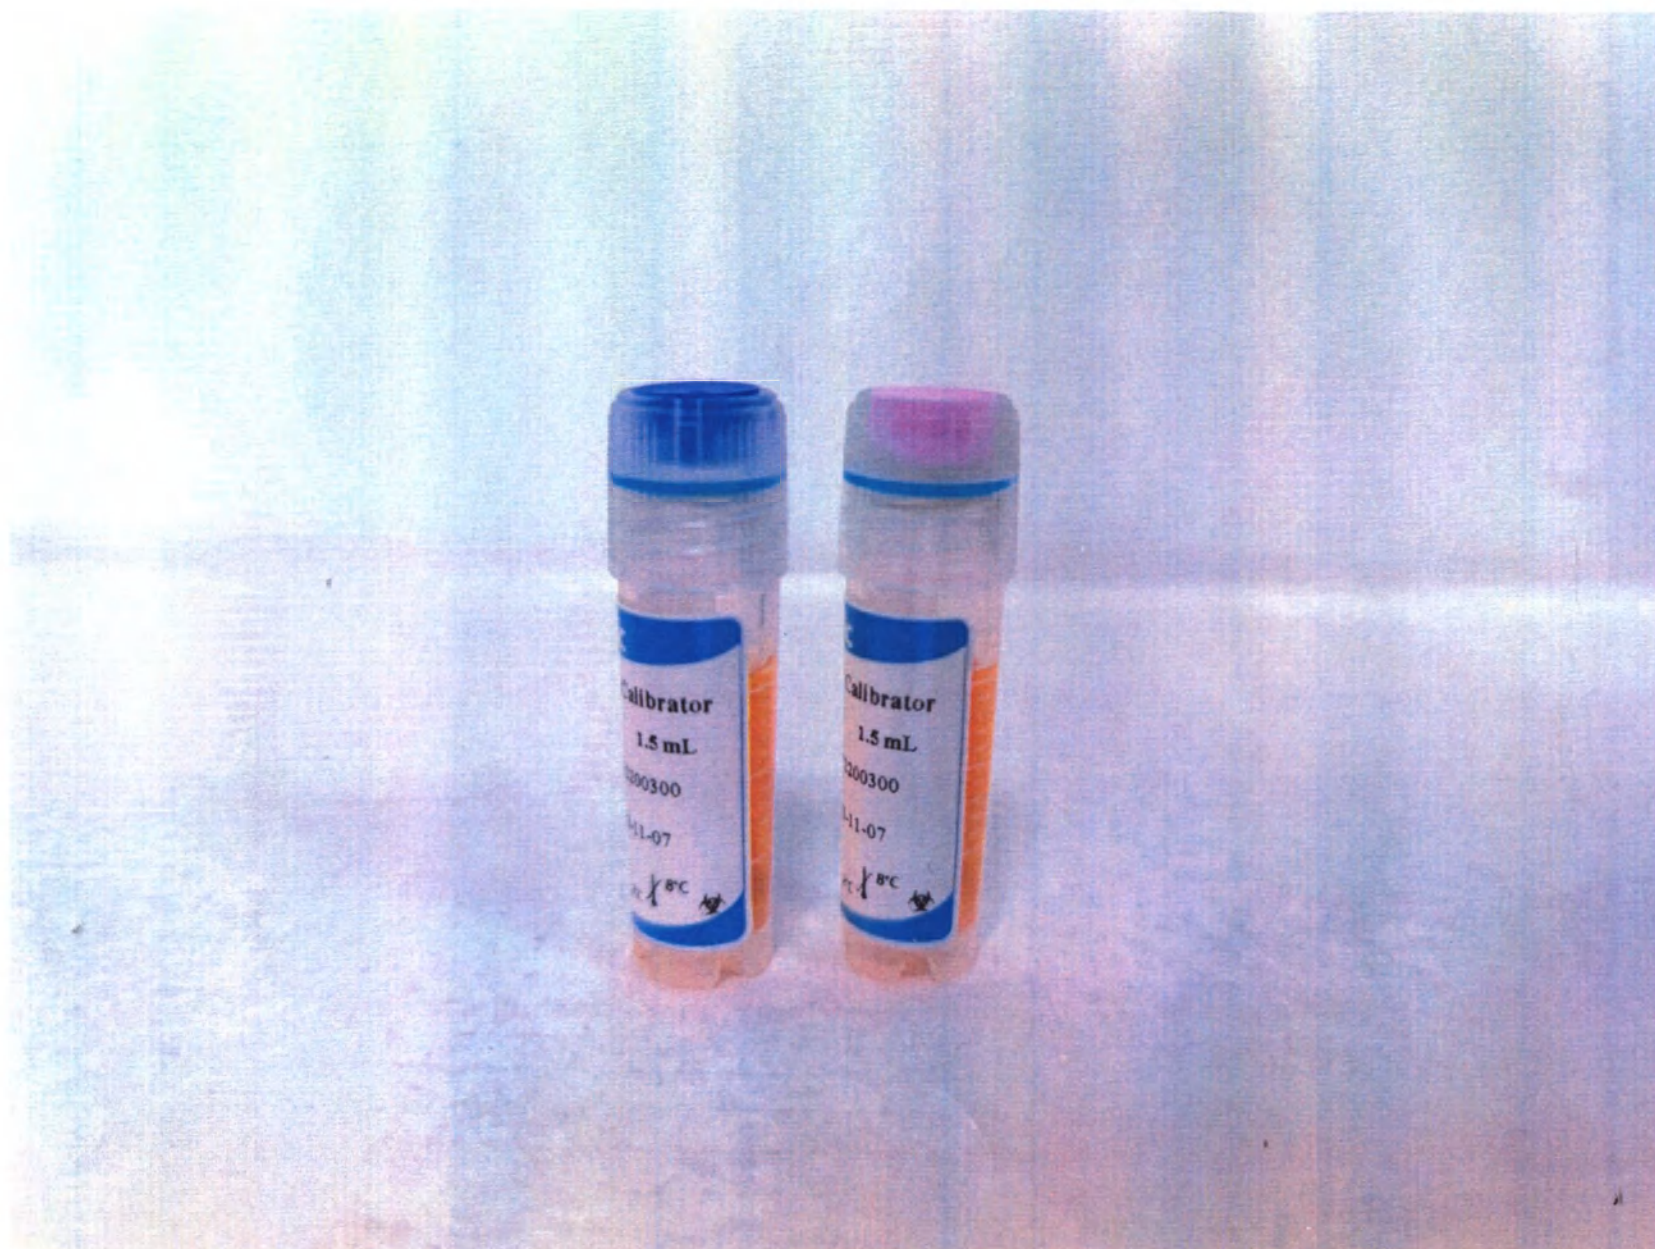

Калибратор 1 (Cal 1) и Калибратор 2 (Cal 2) МИ «Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-НСV)

электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-HCV (eCLIA) / Anti-HCV), в варианте исполнения 100 тестов»

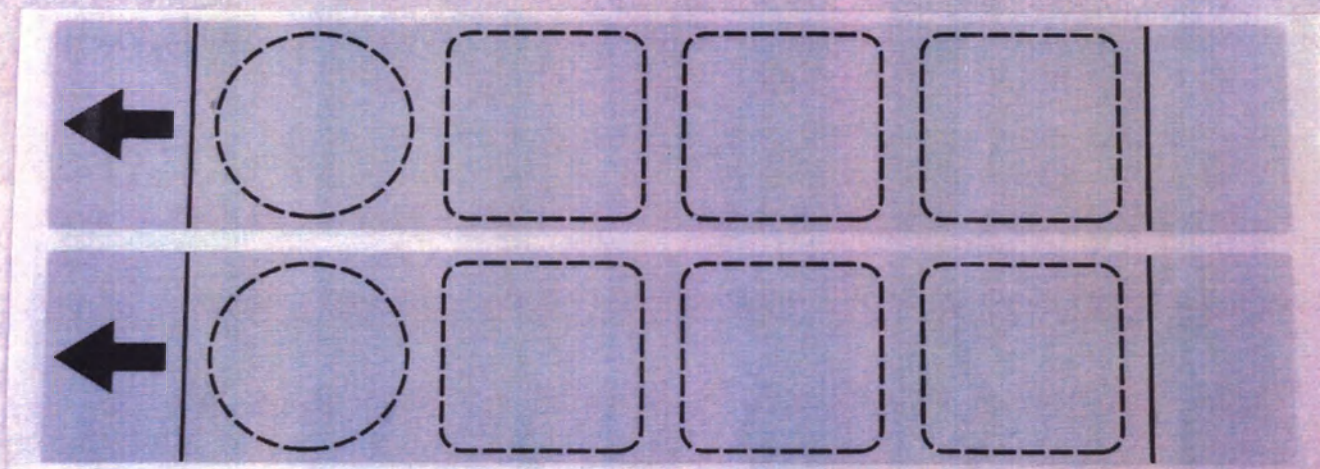

Этикетки для запечатывания флаконов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 16 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Иосова Т.А
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197
КУСАЙЛО Р.В.