



PHILIPS

Руководитель
по нормативному регулированию ООО «ФИЛИПС»

Горкуша Д.В.



«12» _____ 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система ультразвуковая диагностическая CX50»


Система ультразвуковая диагностическая CX50 в составе.





1. Основной блок аппарата с панелью управления



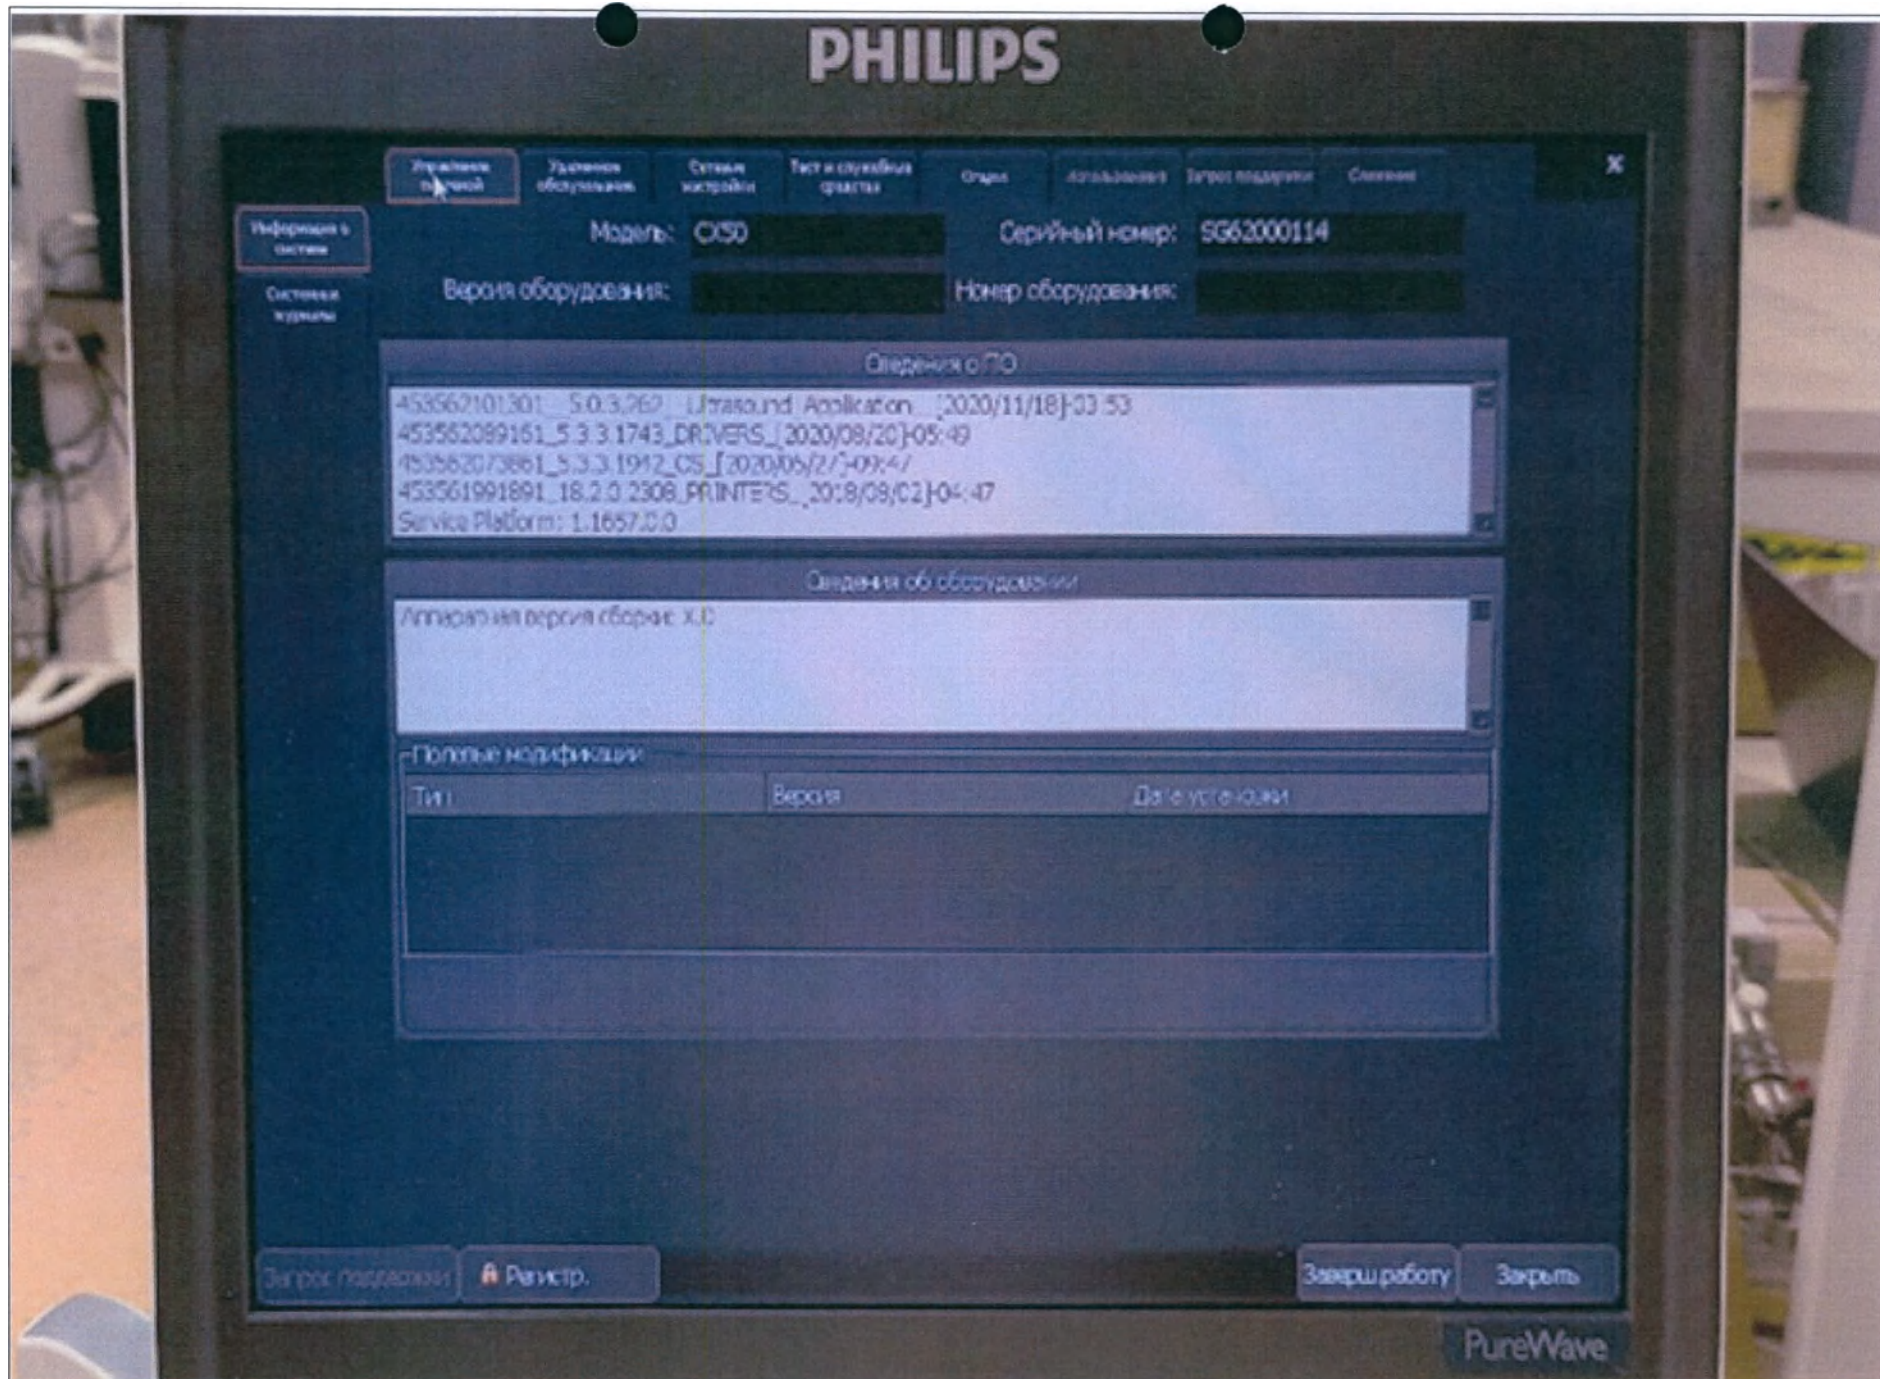


3. Специальное программное обеспечение


Принадлежности:



1. Тележка мобильная

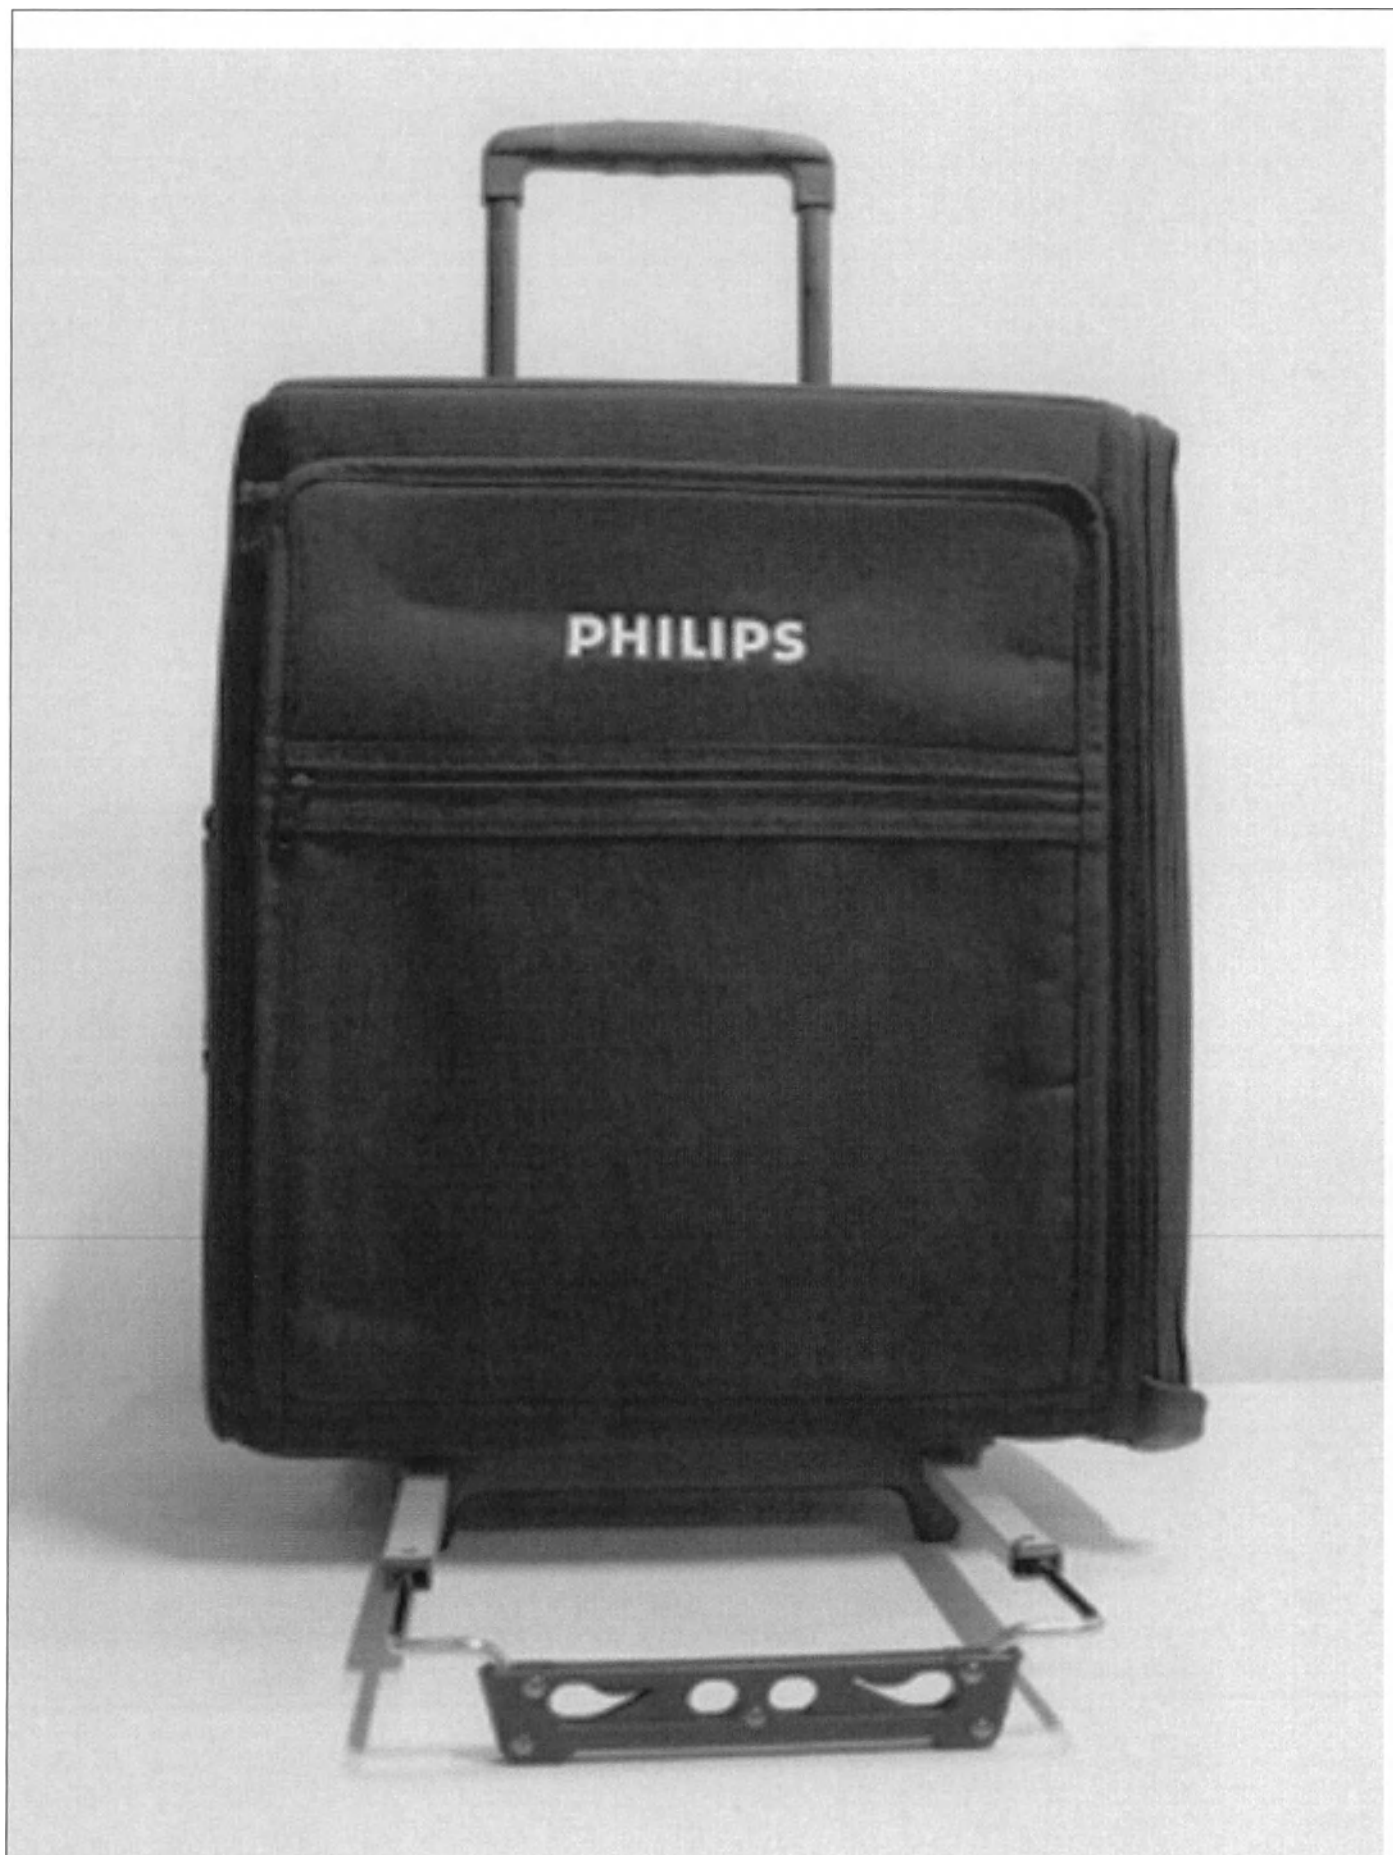

2. Переносная сумка чемодан

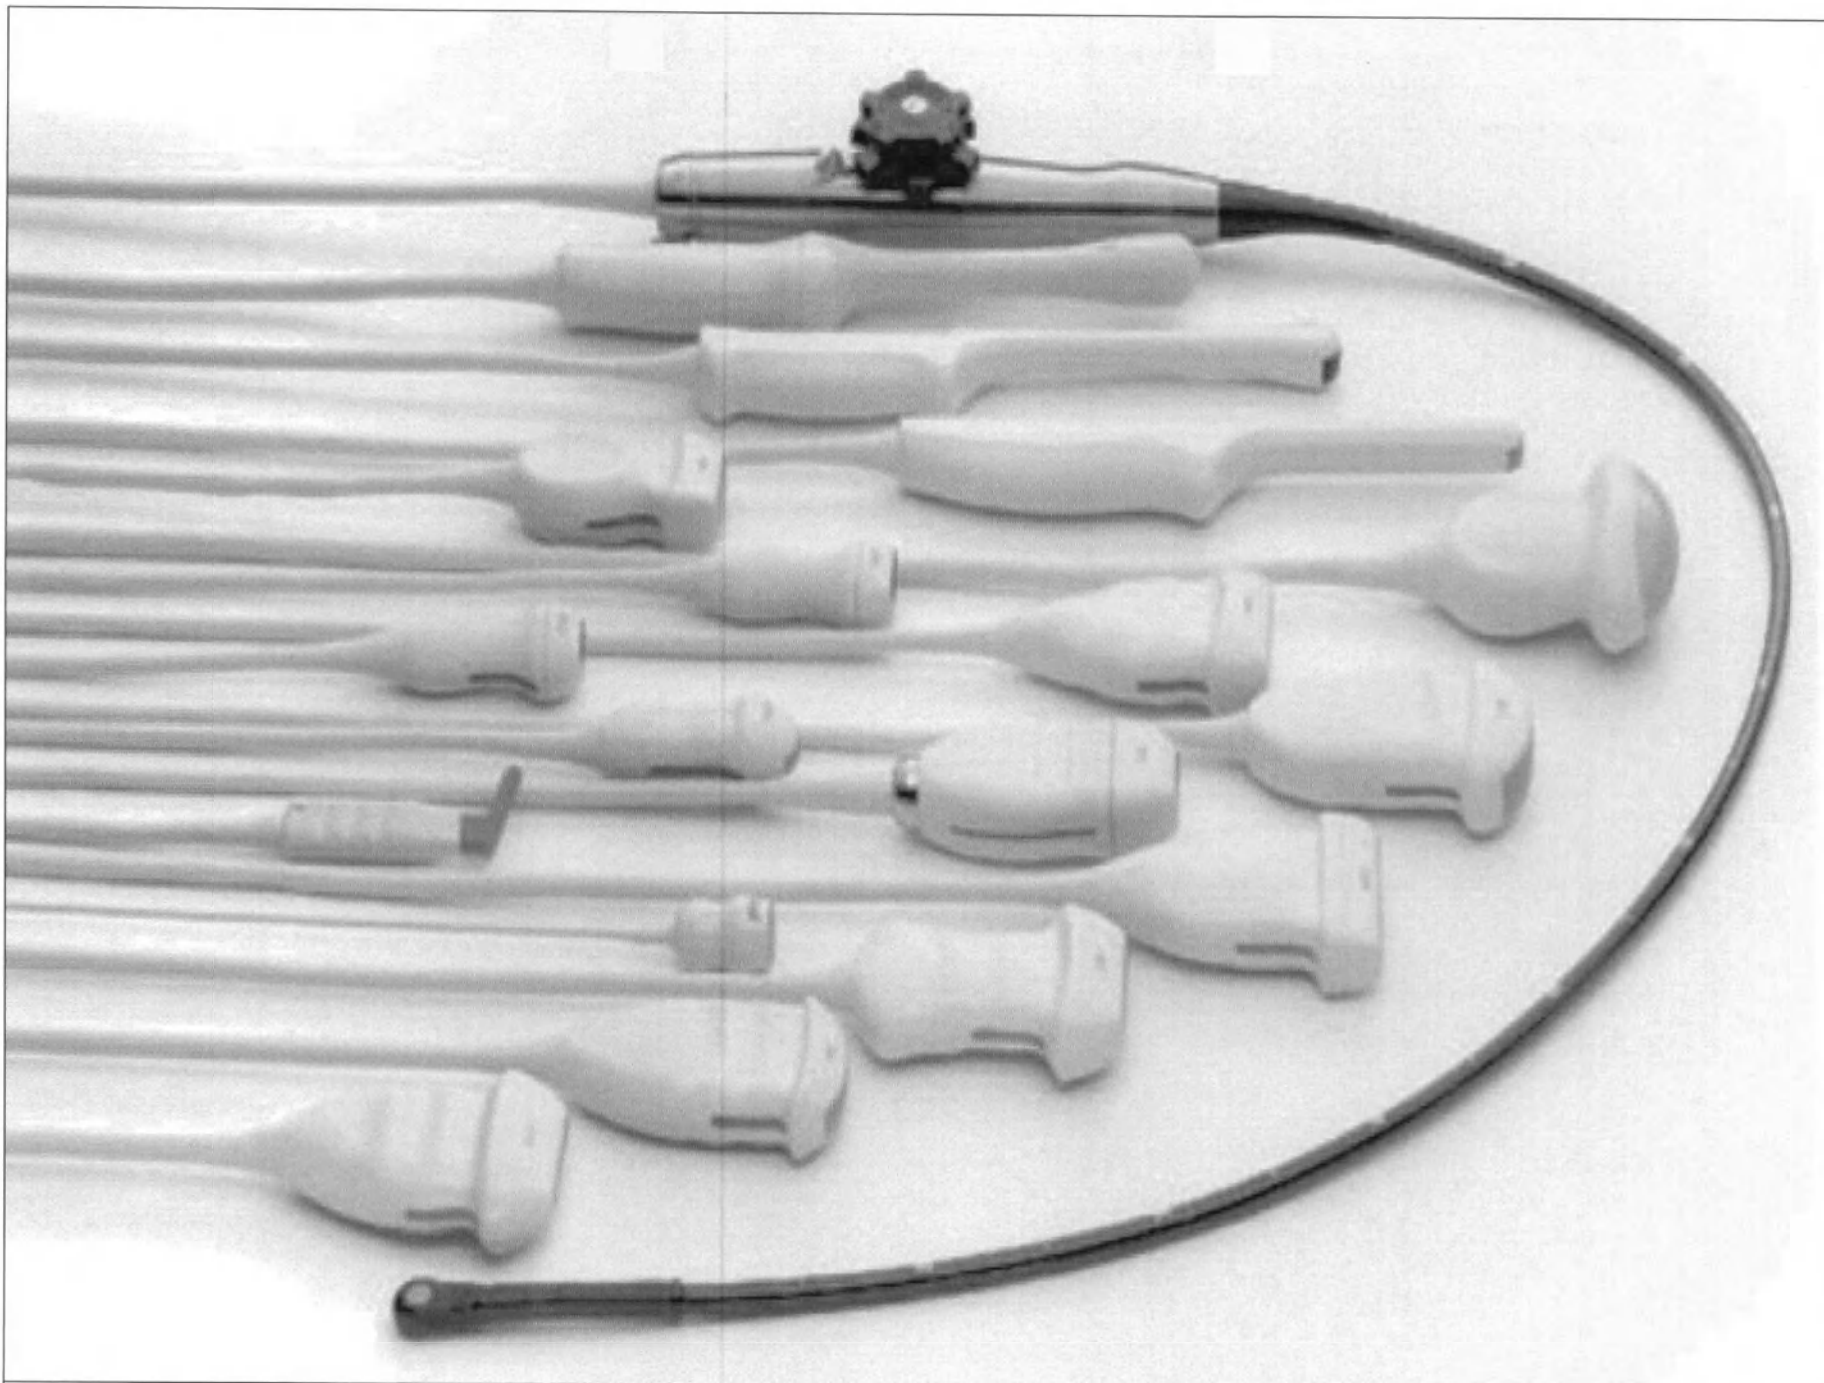

4. Датчики ультразвуковые



5. Гель для пациента




6.1. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол для ультразвуковых датчиков С5-2



6.2. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол singl для ультразвуковых датчиков C5-2




6.3. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол Ergo для ультразвуковых датчиков C5-2

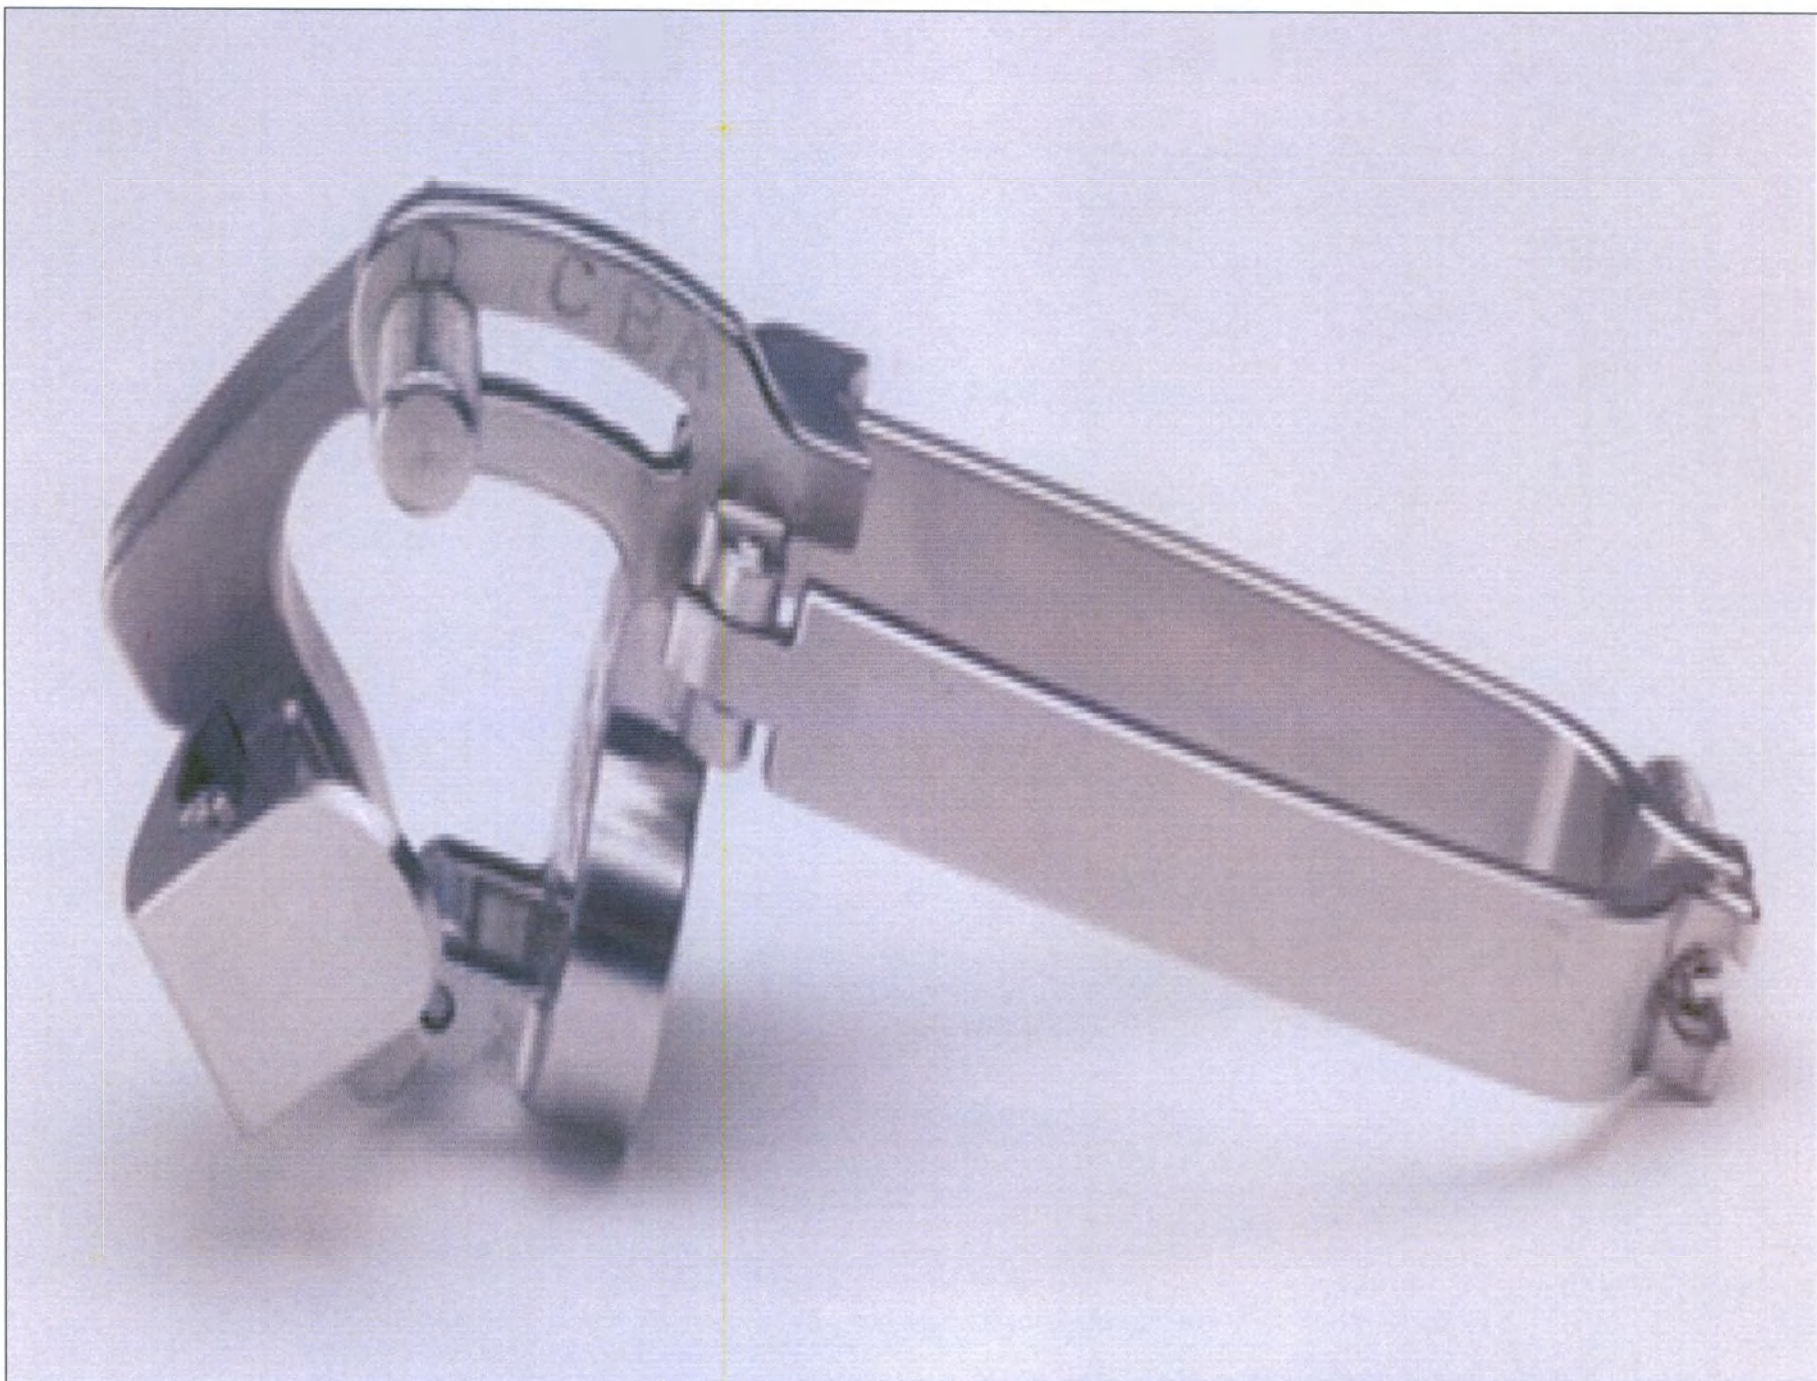

6.4. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол Ergo (stainless steel) для ультразвуковых датчиков C5-2.



6.5. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол для ультразвуковых датчиков С8-5.

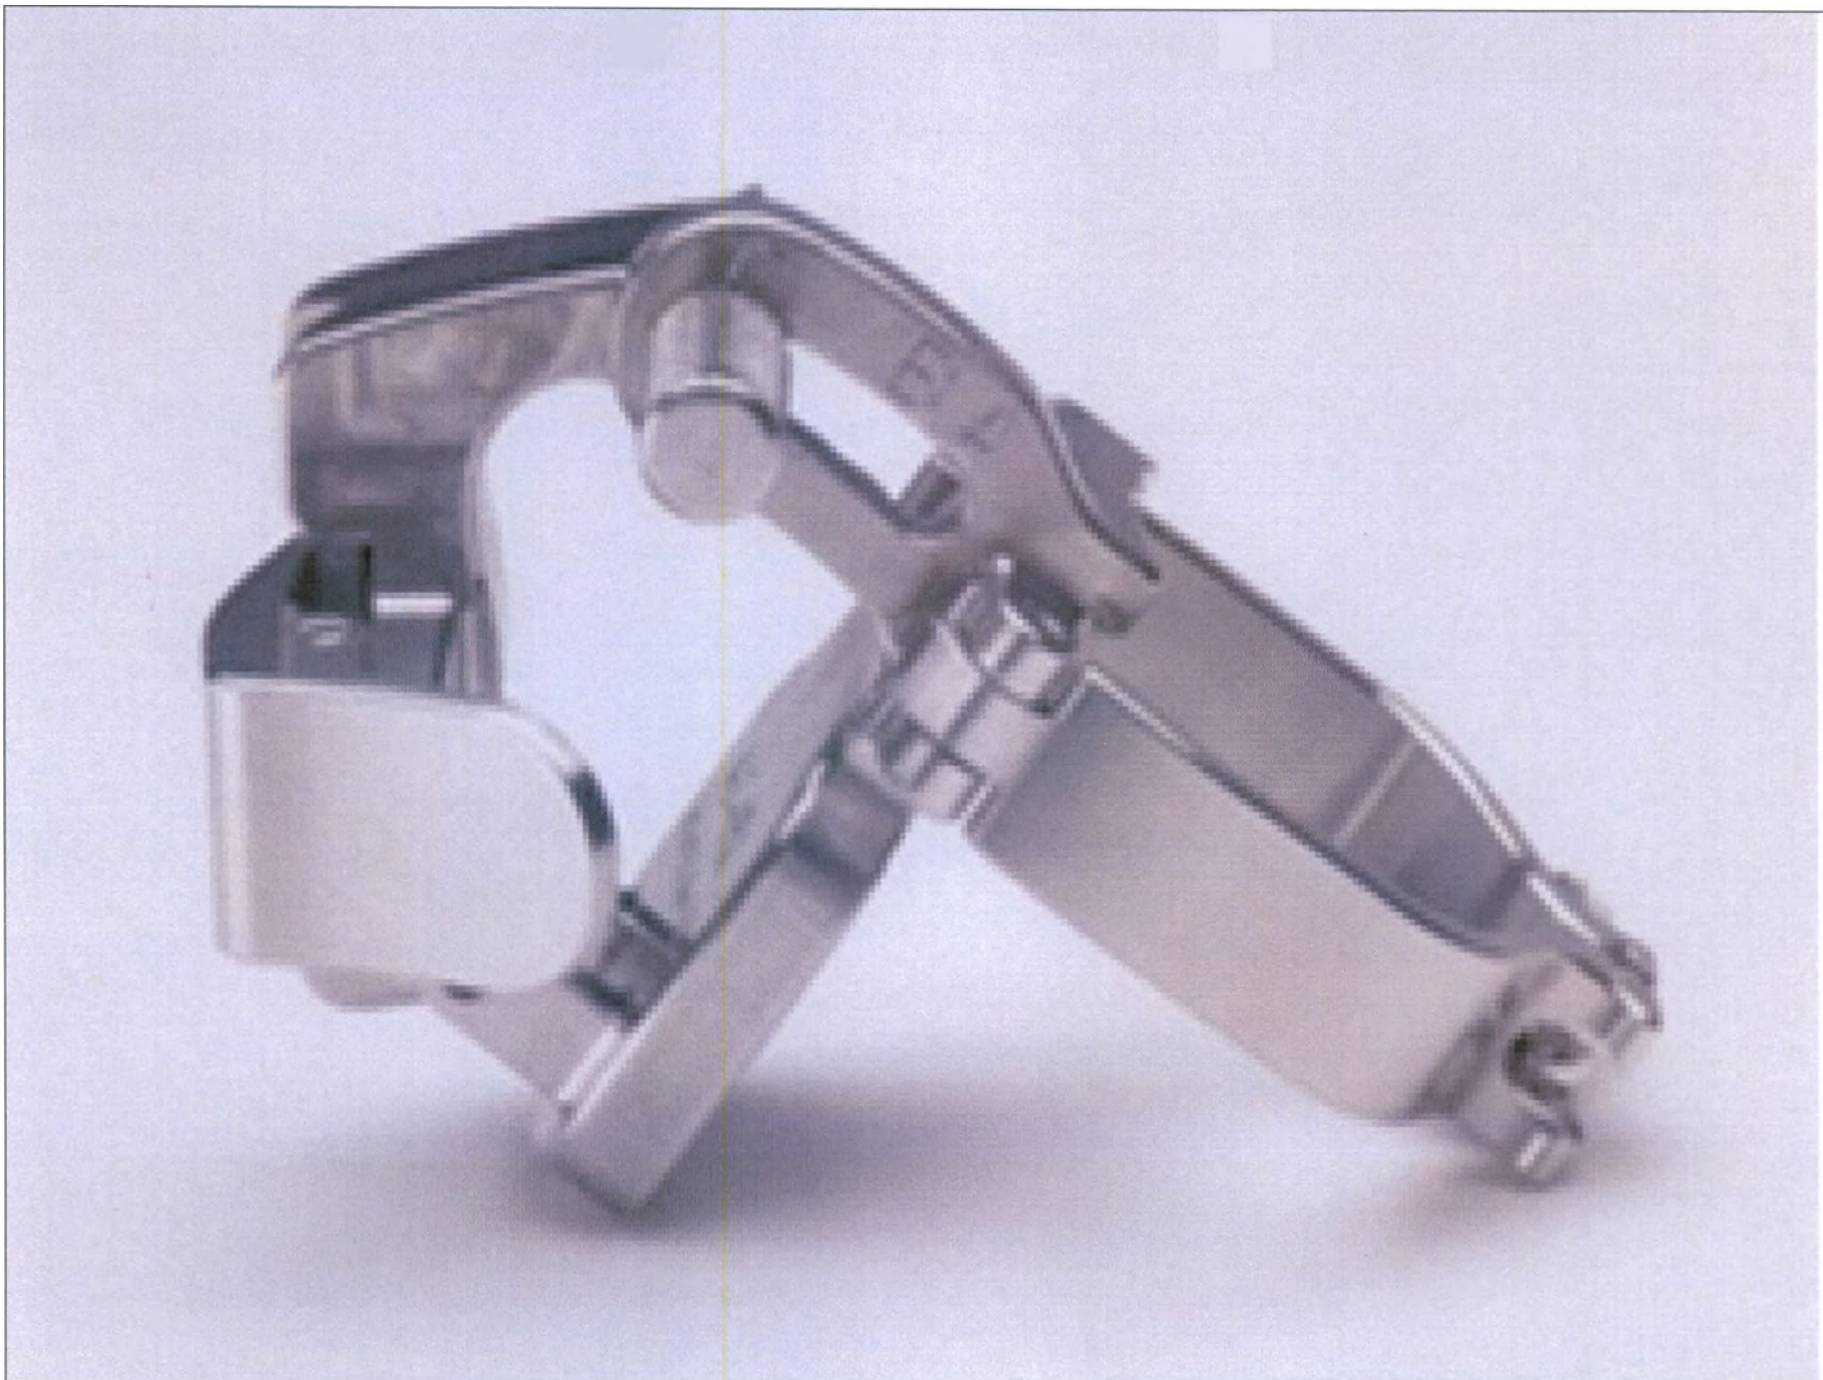

6.6. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол для ультразвуковых датчиков С8-5.



6.7. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол для ультразвуковых датчиков С9-4.




6.8. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол Ergo для ультразвуковых датчиков S4-2.



6.9. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол Ergo (stainless steel) для ультразвуковых датчиков S4-2.



6.10. Насадки для ультразвуковых датчиков для проведения биопсии. Нестерильный биопсийный угол для ультразвуковых датчиков V6-2.

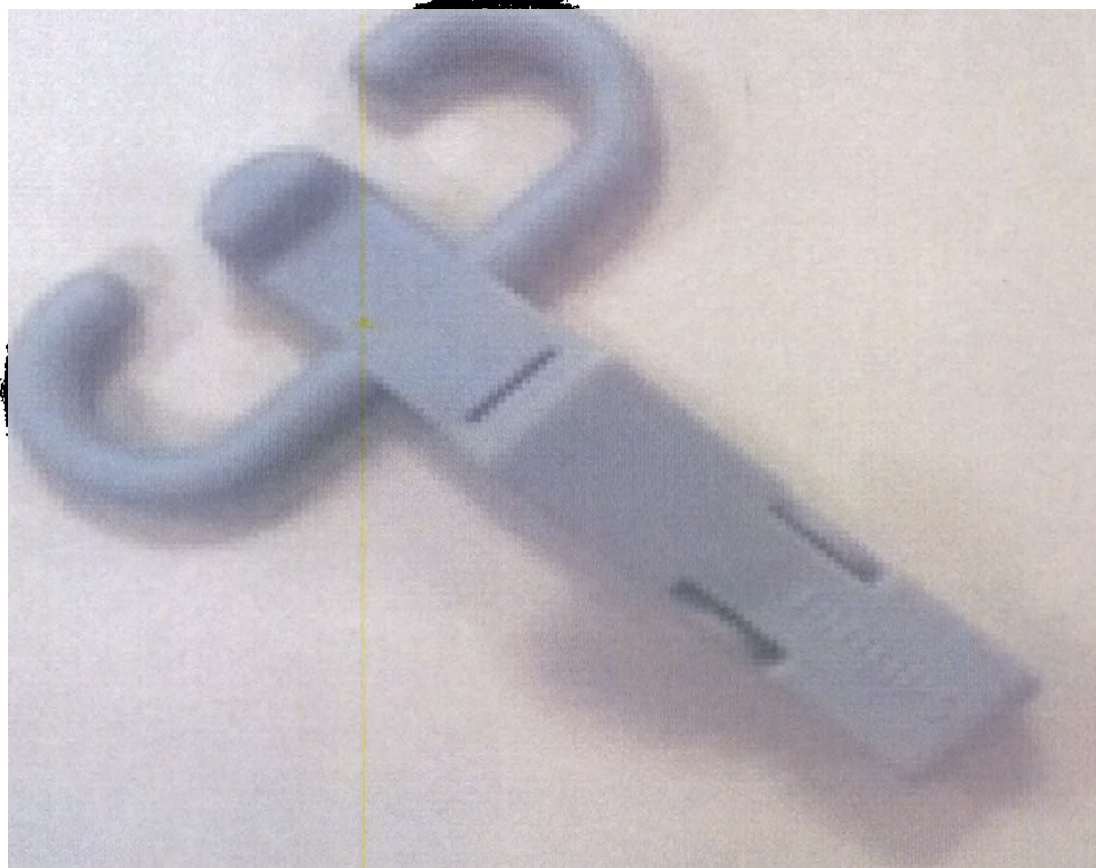

7.1. Пластмассовые фиксаторы для датчиков и кабелей



7.2. Пластмассовые фиксаторы для датчиков и кабелей



7.3. Пластмассовые фиксаторы для датчиков и кабелей



7.4 Пластмассовые фиксаторы для датчиков и кабелей



8.1. Принтер специальный Sony UP-D23MD



8.2. Принтер специальный Sony UP-D55MD



9.1. Специальная термическая бумажная лента



9.2. Специальная термическая бумажная лента




9.3. Специальная термическая бумажная лента



10. Ножной переключатель (педаль)



11. ЭКГ отведения

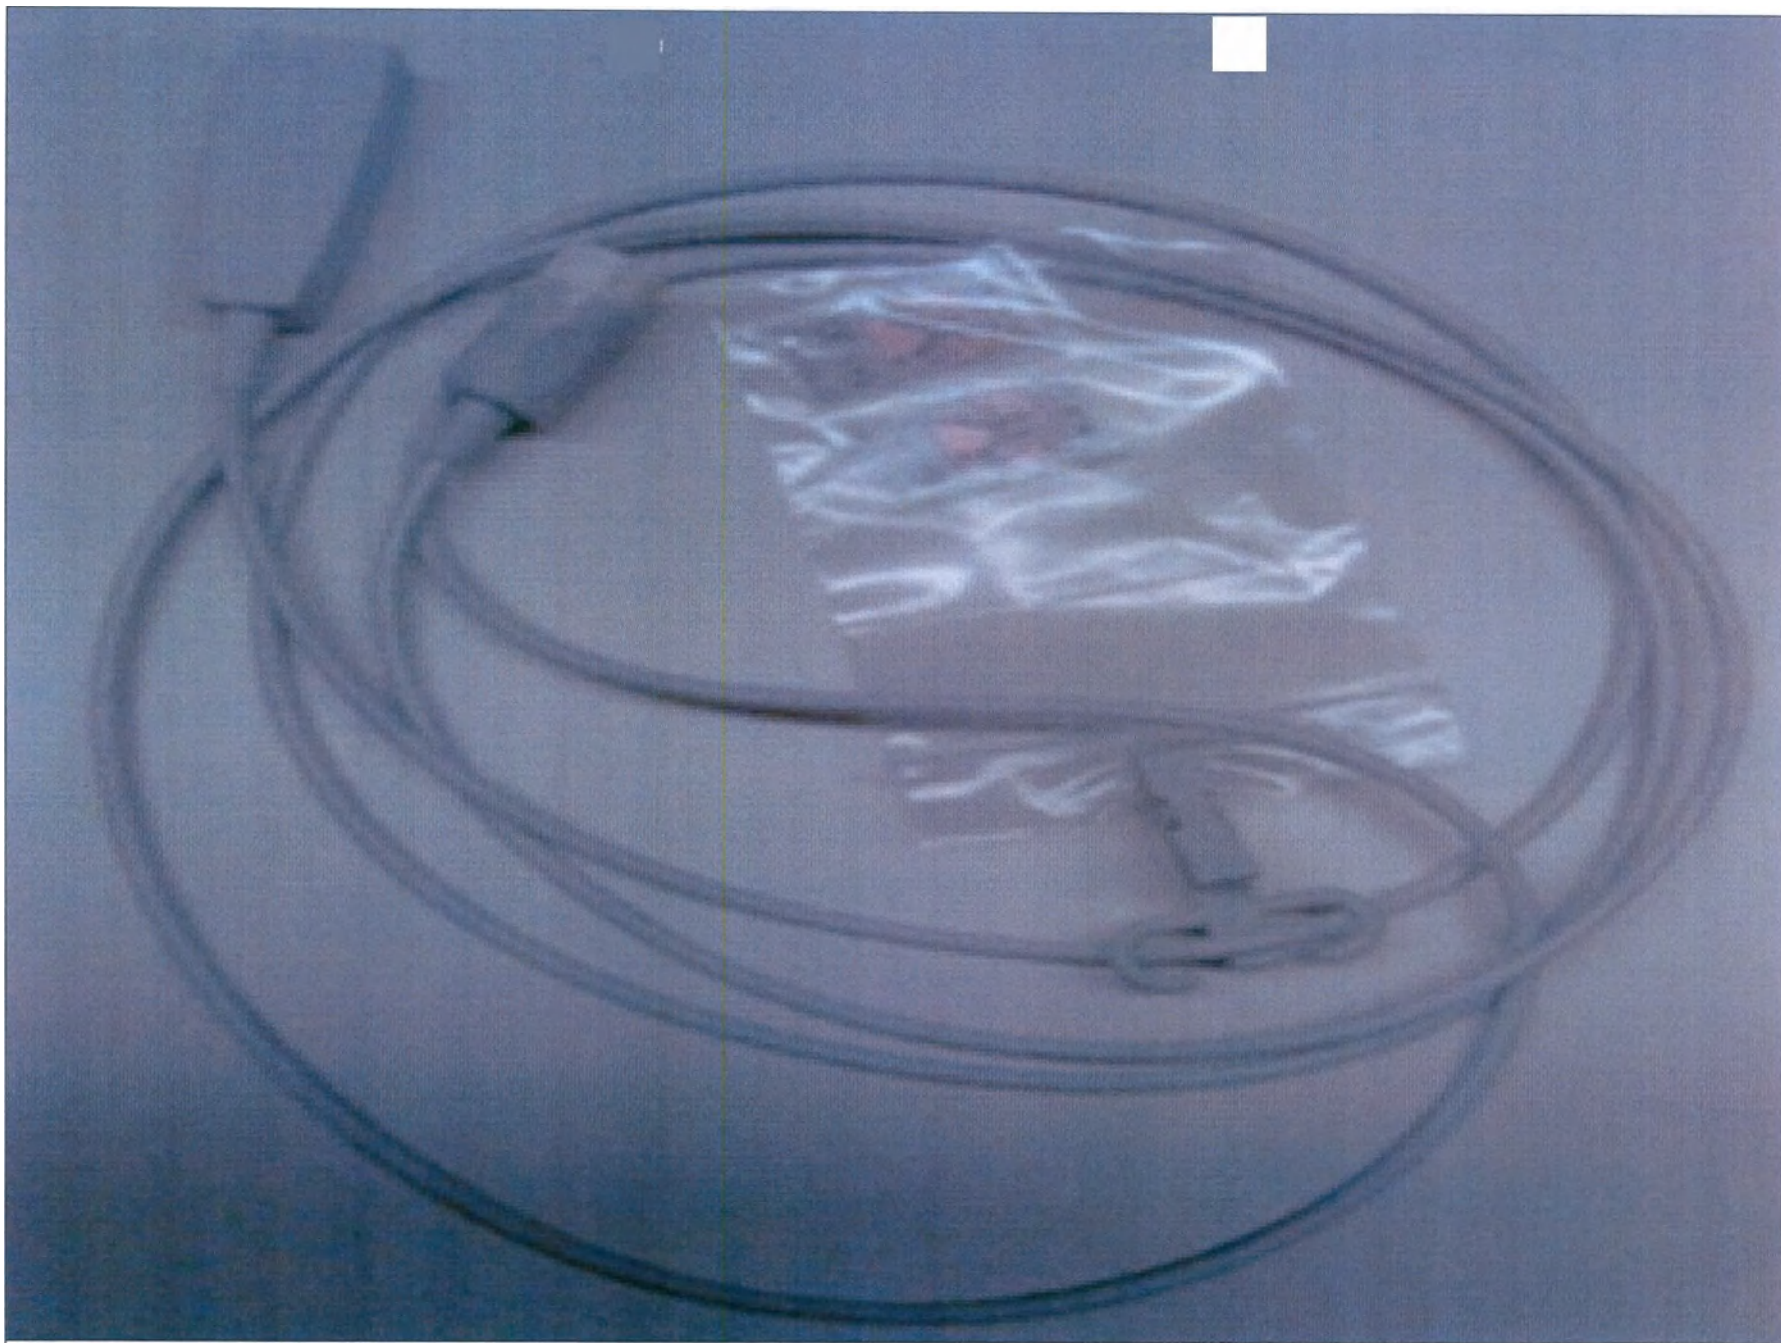

12. ЭКГ электроды



13. Концентраторы USB



14.1 Кабели



14.2 Кабели



Руководство
пользователя

Русский


Ультразвуковая система CX50

PHILIPS


15. Инструкция для пользователя на электронном или бумажном носителе



16. Устройство обеспечения бесперебойного питания

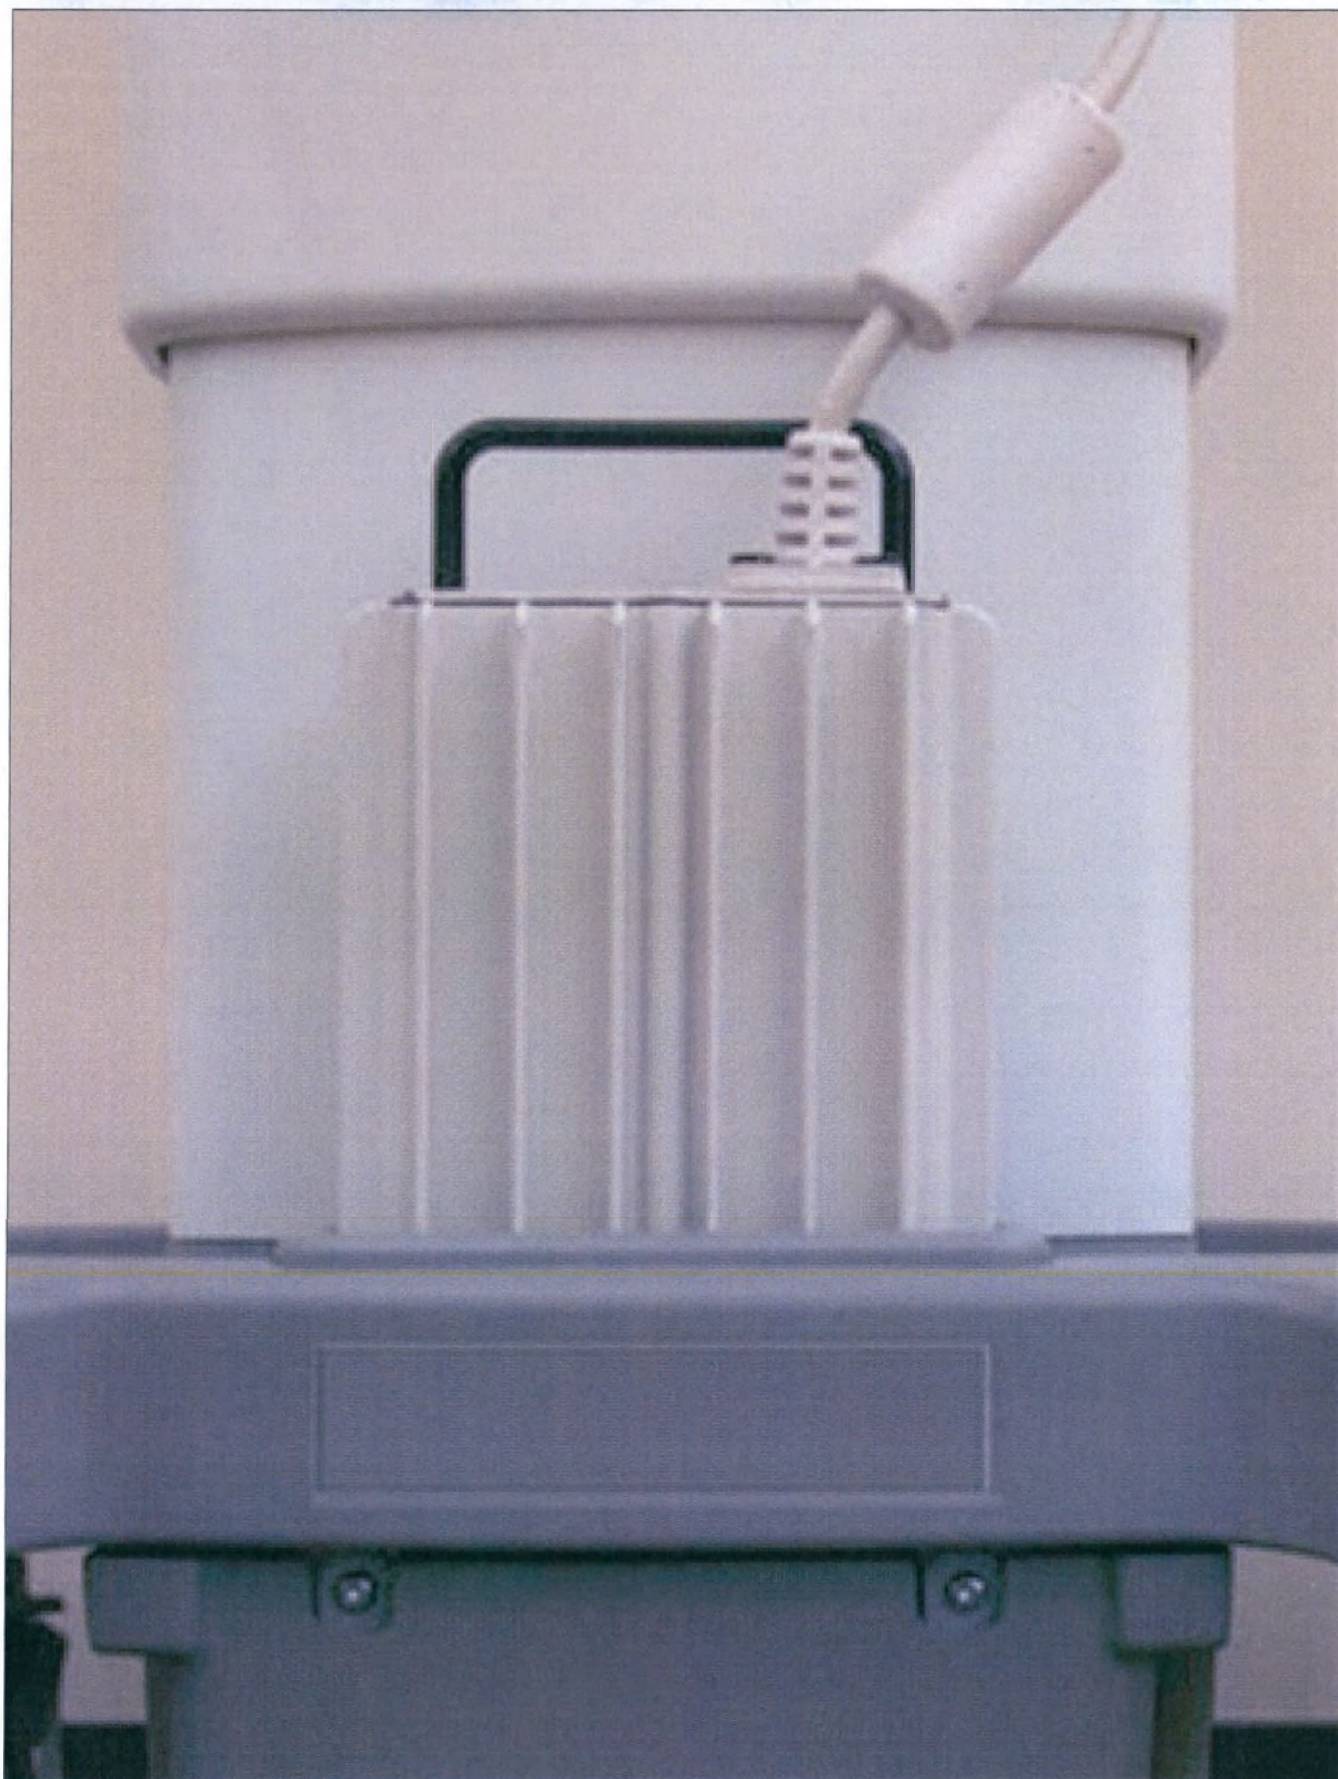

17.1. Блоки питания

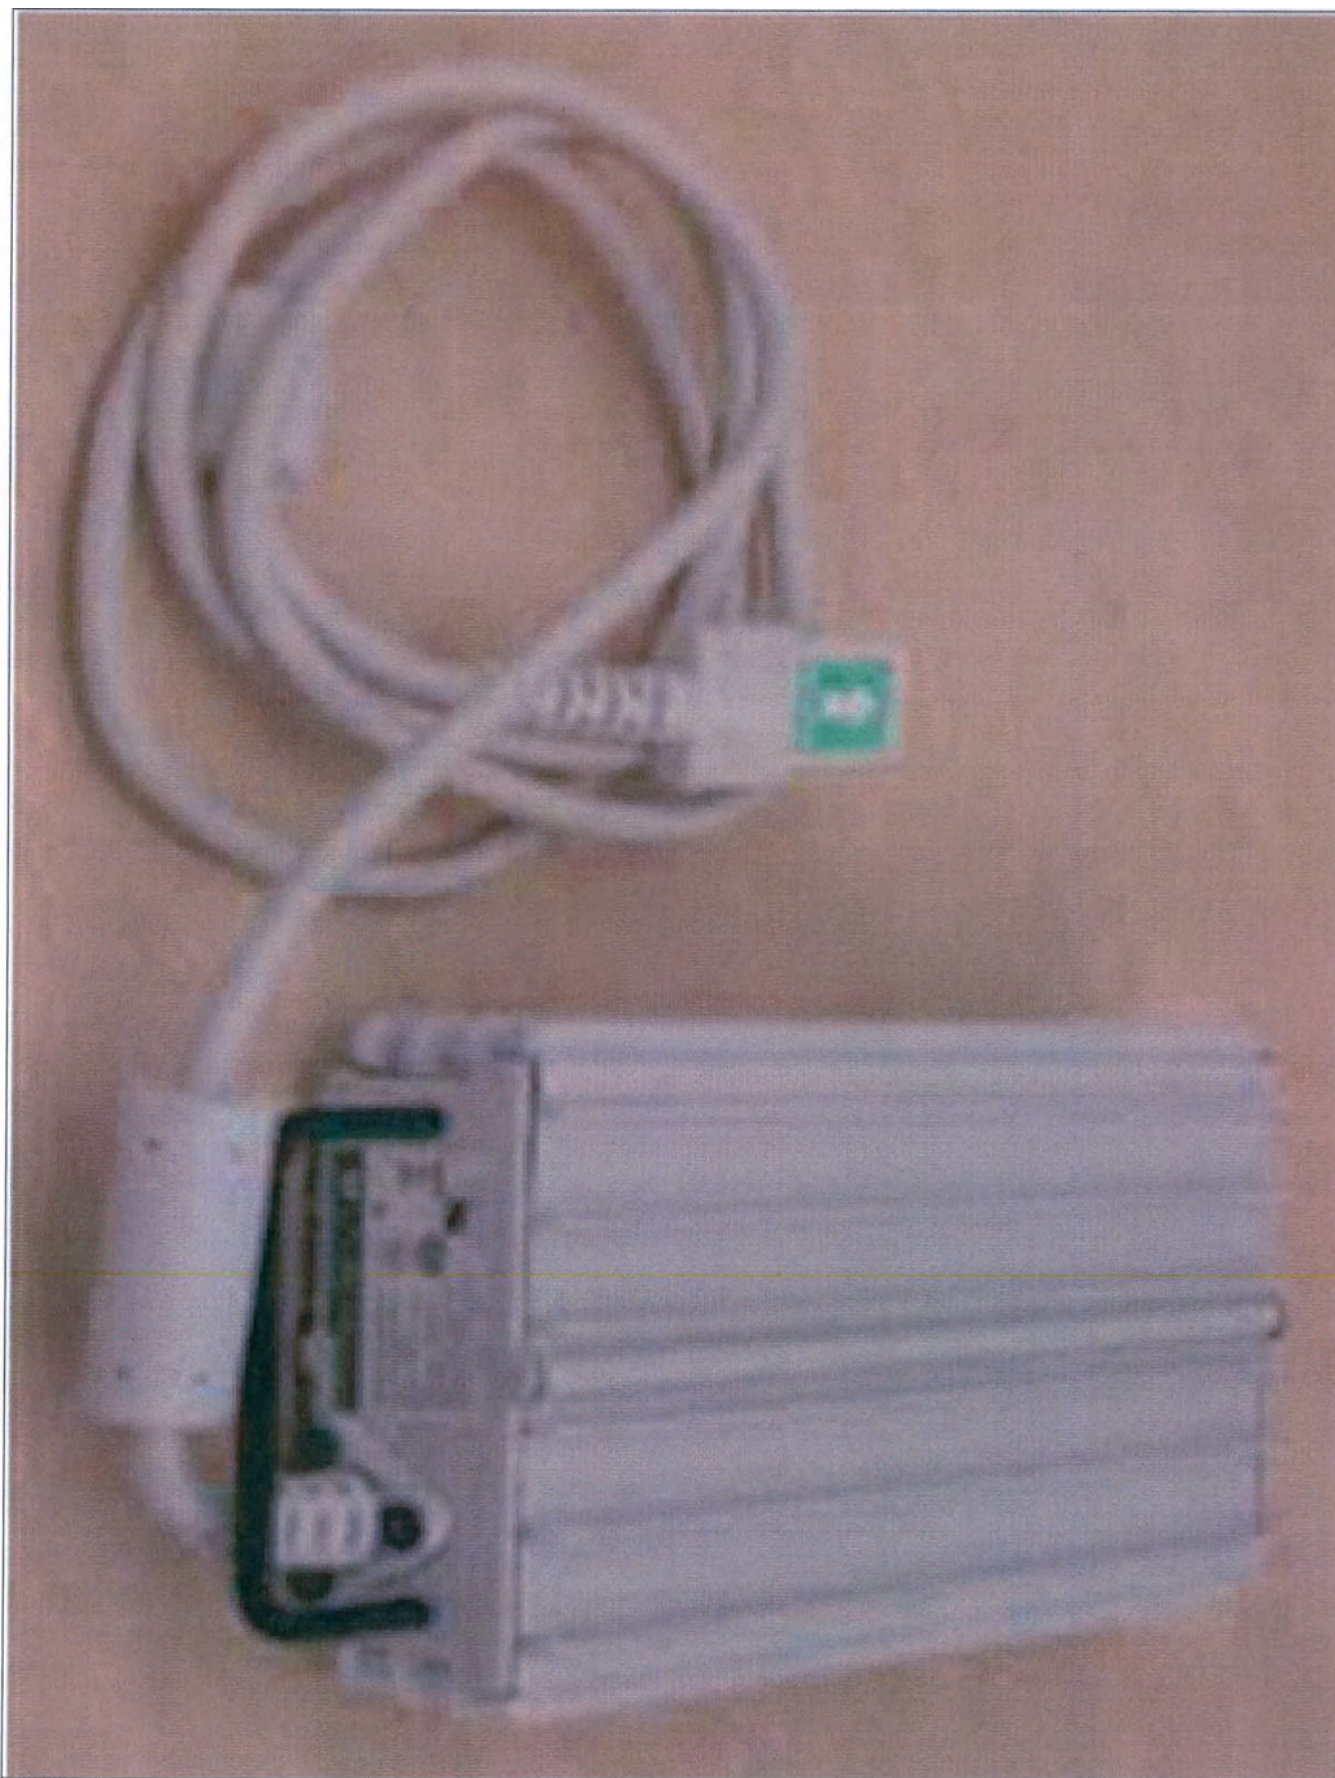

17.2. Блоки питания



18.1. Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе.



18.2. Программное обеспечение на оптическом и/или электронном и/или виртуальном носителе.



19. Ванночка для дезинфекции датчиков.

Производитель:	«Филипс Ультрасаунд, ЛЛС», (США) Philips Ultrasound, LLC, 22100 Bothell Everett Highway, Bothell, WA, 98021, USA
Место производства:	Sanmina – SCI System Singapore Pte Ltd., 2 Chai Chee Drive, Singapore, 469044, Singapore
Медицинское Изделие:	Система ультразвуковая диагностическая CX50
Серийный номер/номер партии:	см. на основной маркировке
Дата изготовления:	см. на основной маркировке
Номинальный режим работы:	см. 
Предупреждения и знаки опасности:	см. 
Регистрационное удостоверение:	№ ФСЗ 2009/03999



Проект русскоязычной маркировки системы CX50

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 43 листа (ов)

ООО «Филипс»

