



ООО «Лойер Медикал»
Генеральный директор

Самсонов В. Ю.
(Подпись)

М.П.

2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

**Тумбочка медицинская прикроватная
ADA для тяжелобольных**

Оглавление:

Тумбочка медицинская прикроватная ADA для тяжелобольных в составе:

- 1. Столик поворотный с изменяемой высотой - 1 шт.**
- 2. Ящик выдвижной из ABS-пластика - 2 шт.:**
 - верхний ящик с замком - 1 шт.;**
 - нижний ящик - 1 шт.**
- 3. Колеса блокирующиеся, диаметром 75 мм - 4 шт.**
- 4. Вильчатый гаечный ключ - 1 шт.**
- 5. Ключ для верхнего ящика с замком - 1 шт.**
- 6. Поверхность столешницы защитная из ABS пластика – 1 шт. (при необходимости).**
- 7. Корзина для листа медицинского назначения больного пациента – 1 шт. (при необходимости).**
- 8. Корзина для мочеприемника – 1 шт. (при необходимости).**
- 9. Адаптер для установки устройства вызова медсестры – 1 шт. (при необходимости).**
- 10. Держатель инфузионного флакона/бутыли – 1 шт. (при необходимости).**
- 11. Лента противоскользящая для поворотного столика – 1 шт. (при необходимости).**
- 12. Инфузионная стойка для внутривенных вливаний - 1 шт. (при необходимости).**
- 13. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.**

Тумбочка медицинская прикроватная ADA для тяжелобольных в составе:



MANUFACTURED IN FINLAND				Lojer Oy Putajantie 42 FI - 38210 SASTAMALA www.lojer.com	 2020/04/01 (YYYY/MM/DD)
PRODUCT NAME: ADA BEDSIDE CABINET					
REF 100009160	SN LOLA202004123456				
 = 40 kg			 + 40 °C - 10 °C		
   		YYMMDD (11)200401 LOT (10)123456 SN (21)LOLA202004123456			

1. Столик поворотный с изменяемой высотой – 1 шт.




2. Ящик выдвижной из ABS-пластика – 2 шт.:
- верхний ящик с замком – 1 шт.;



- нижний ящик — 1 шт.



3. Колеса блокирующие, диаметром 75 мм – 4 шт.

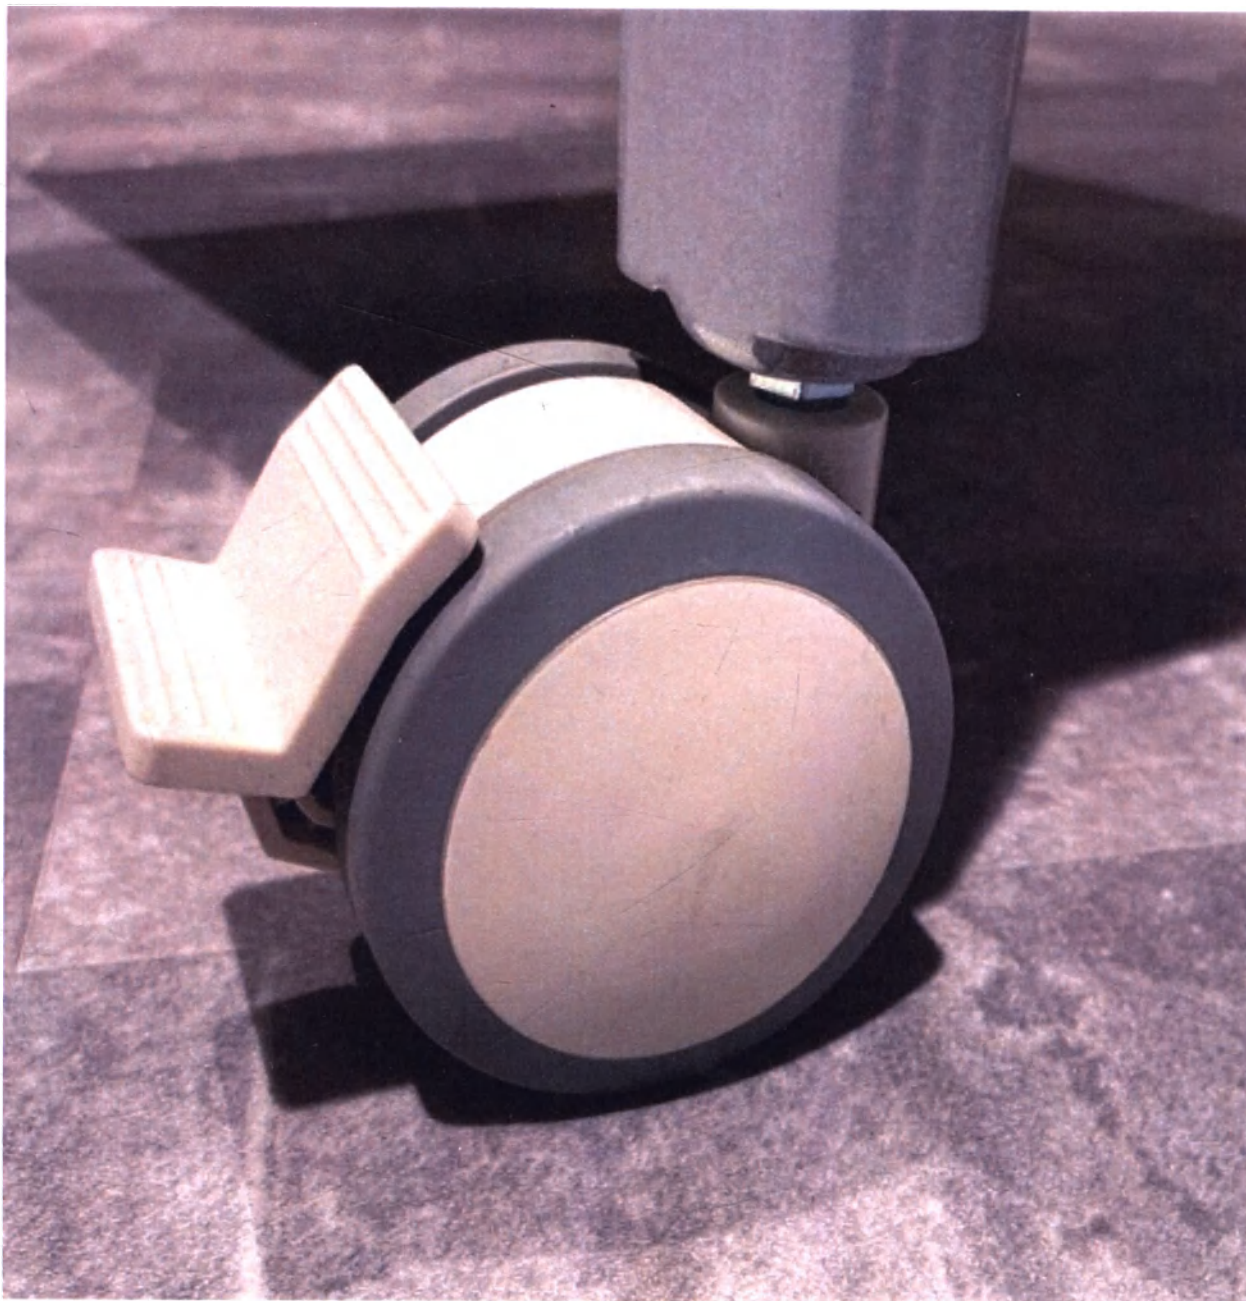

4. Вильчатый гаечный ключ - 1 шт.



5. Ключ для верхнего ящика с замком - 1 шт.



6. Поверхность столешницы защитная из ABS пластика – 1шт. (при необходимости).




7. Корзина для листа медицинского назначения больного пациента – 1 шт. (при необходимости).



8. Корзина для мочеприемника – 1шт. (при необходимости).




9. Адаптер для установки устройства вызова медсестры – 1 шт. (при необходимости).

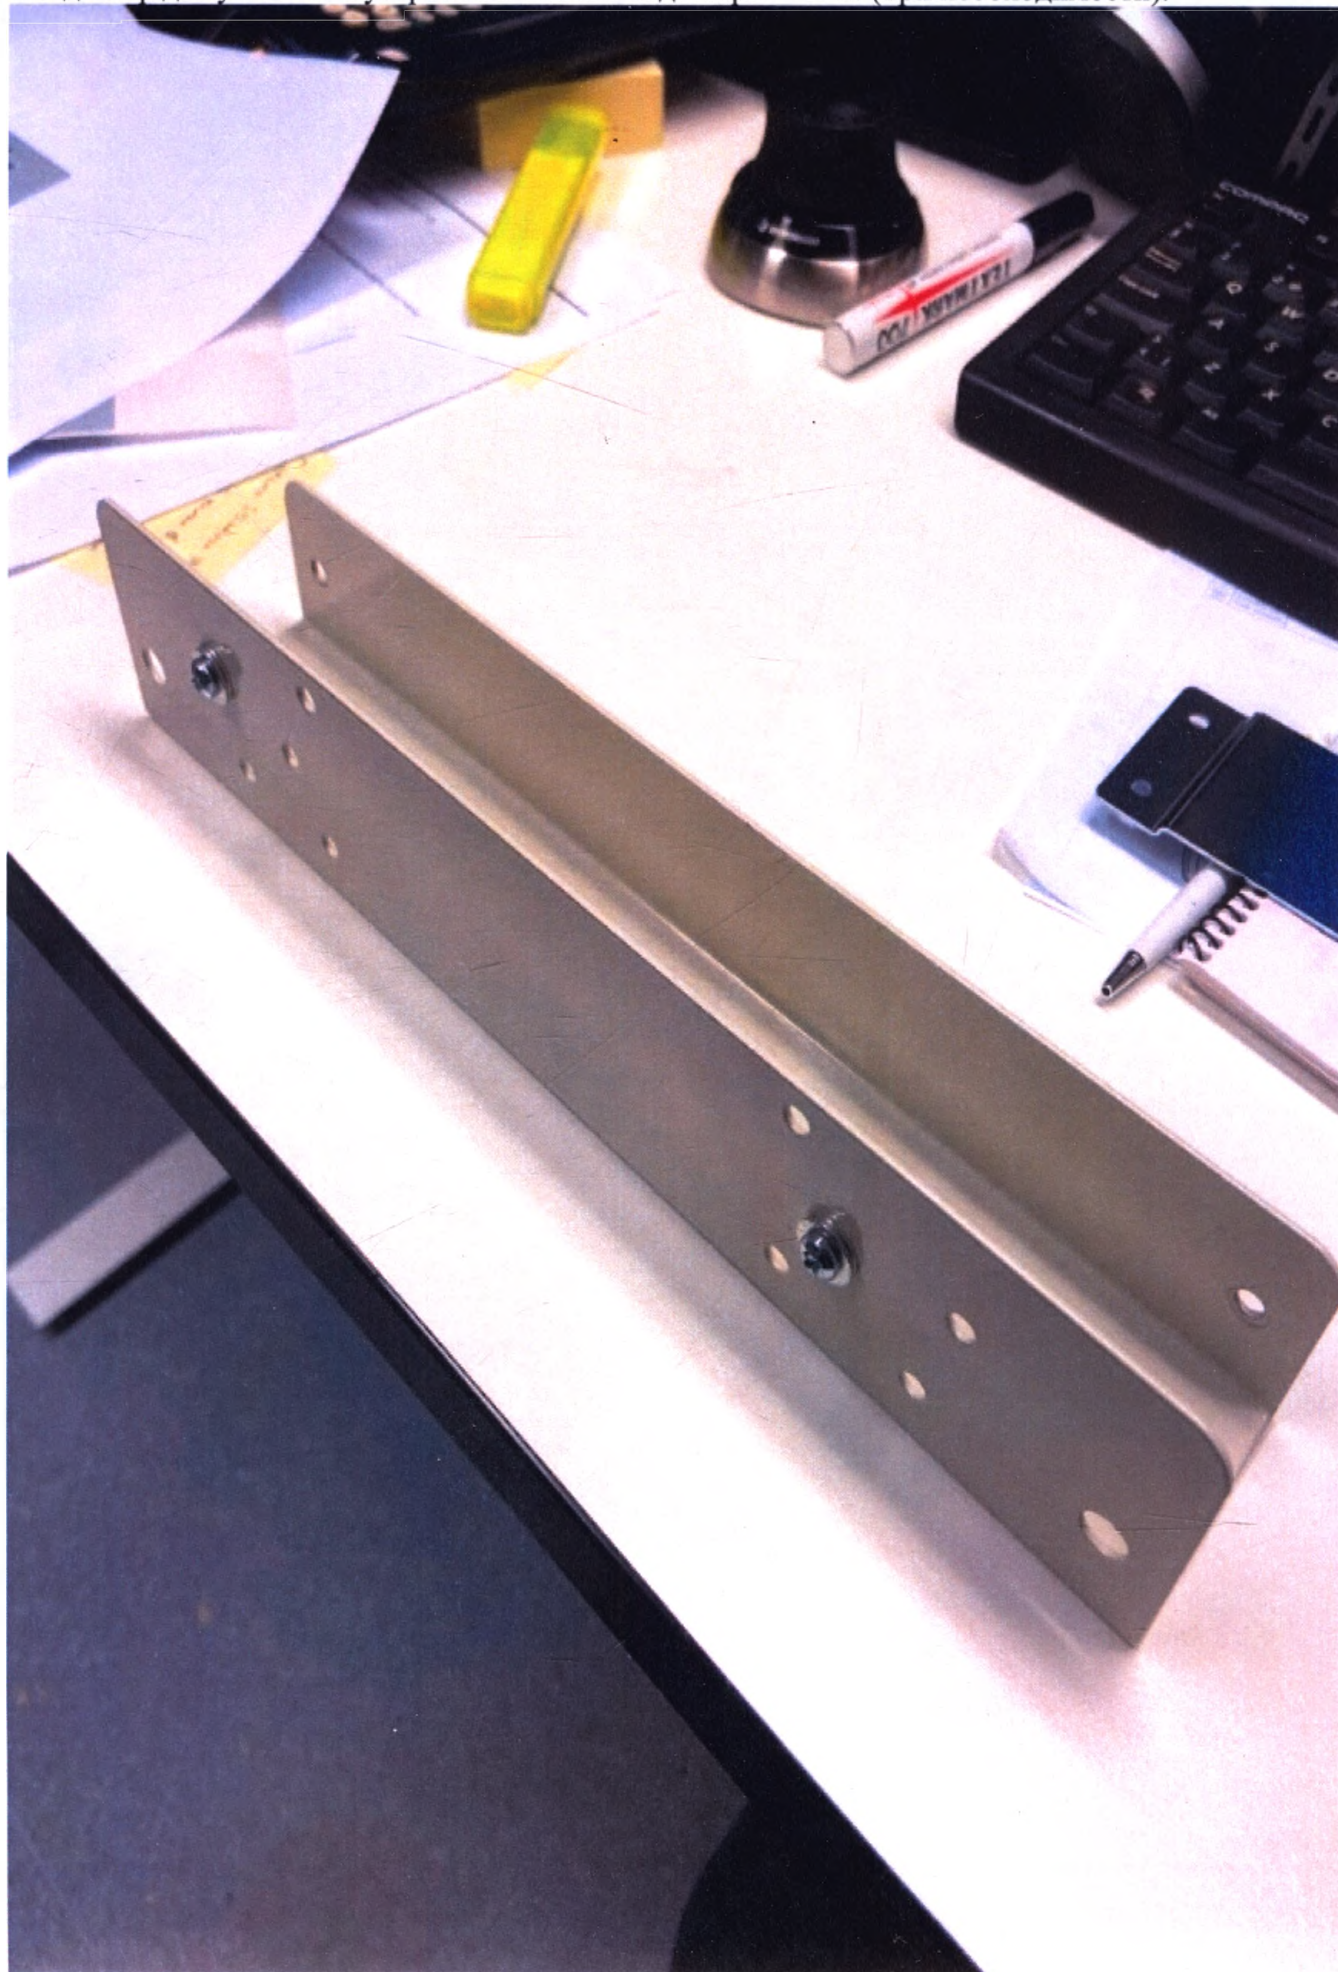


10. Держатель инфузионного флакона/бутыли – 1 шт. (при необходимости).



11. Лента противоскользящая для поворотного столика – 1 шт. (при необходимости).

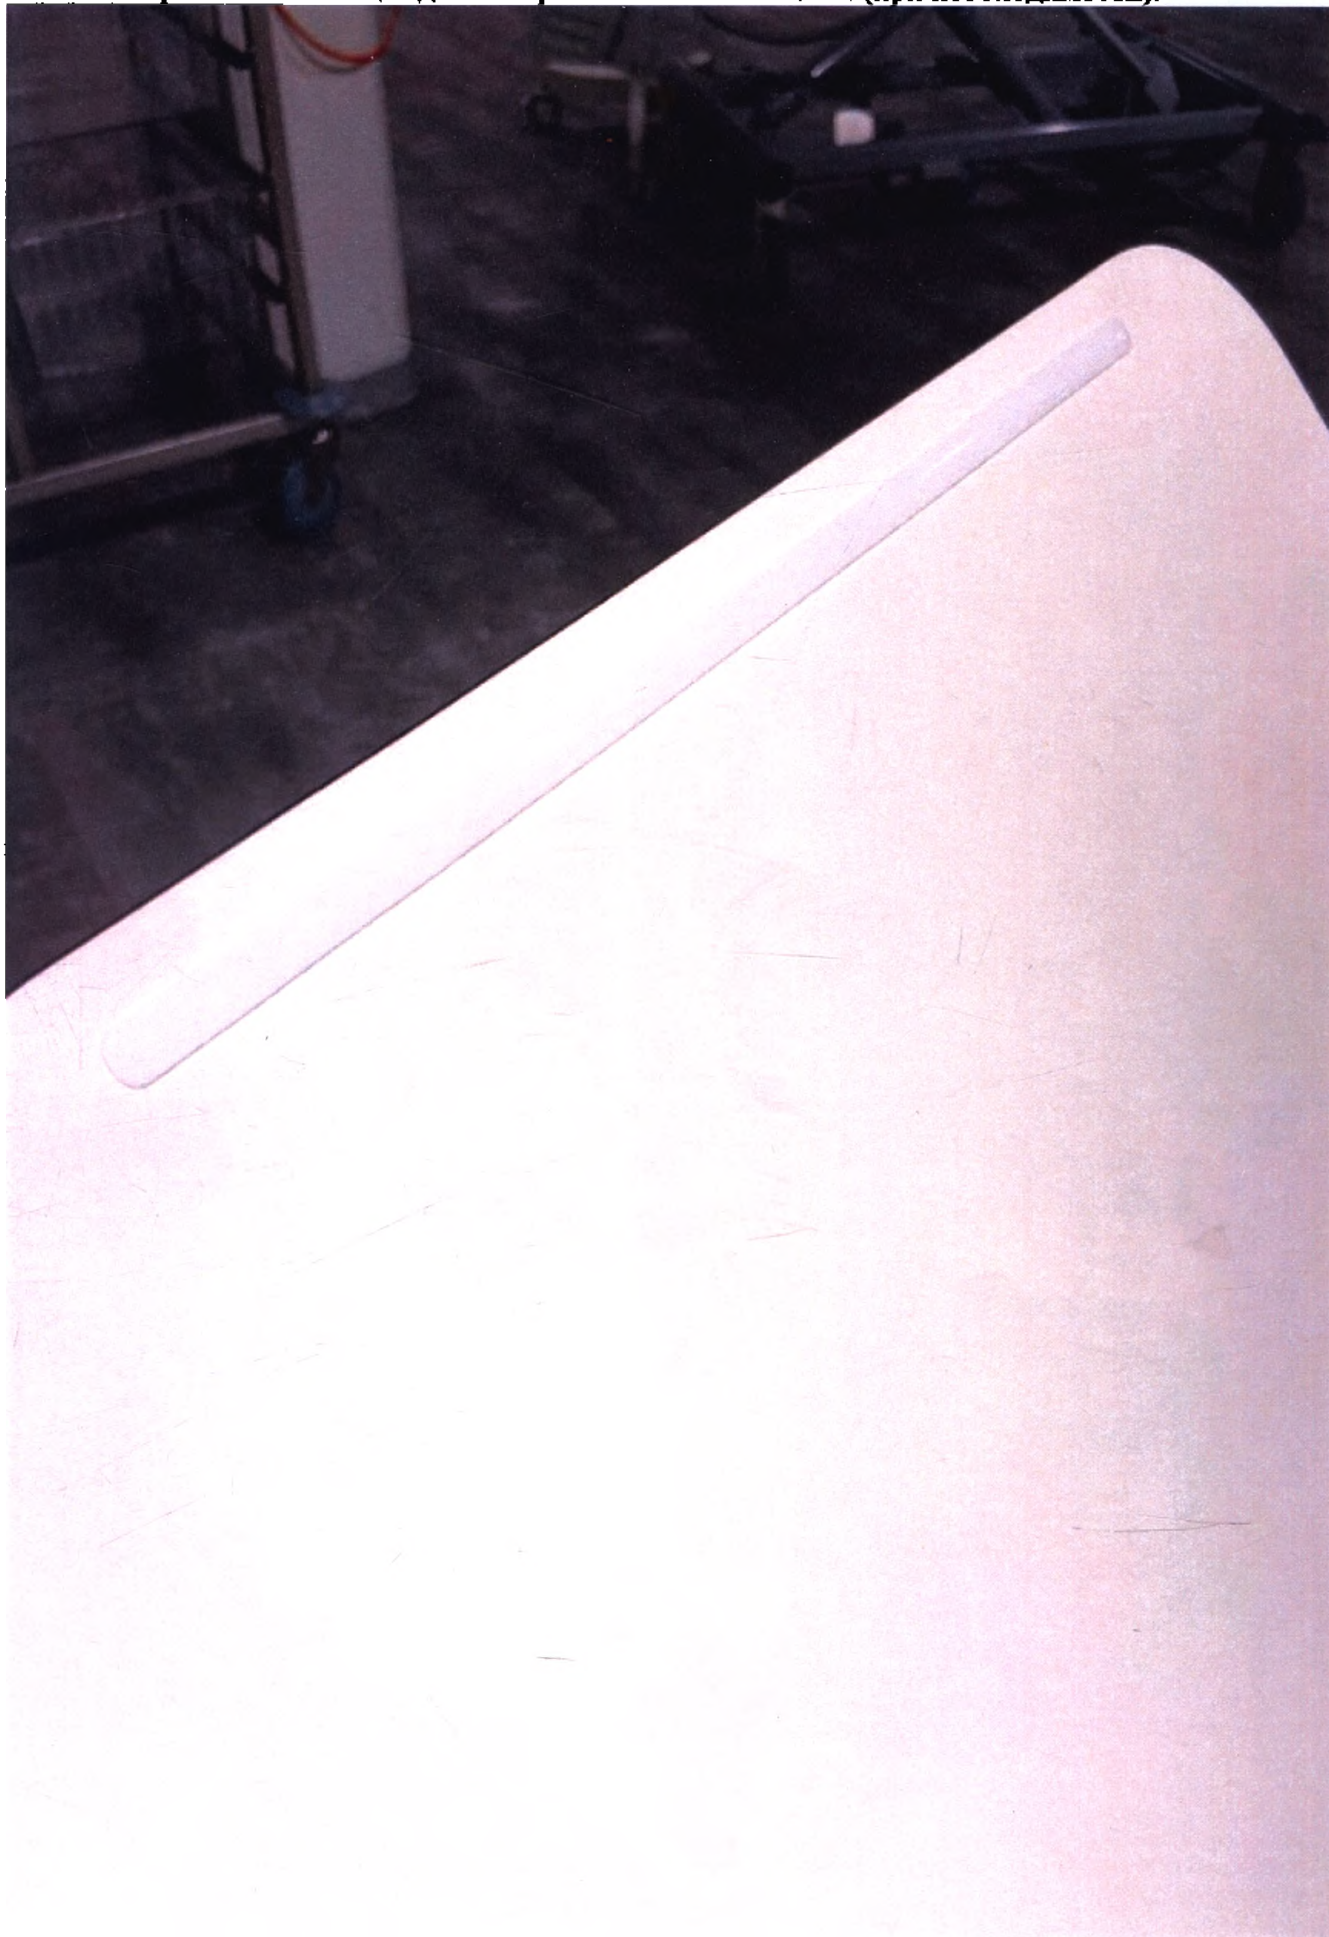

12. Инфузионная стойка для внутривенных вливаний - 1 шт. (при необходимости).

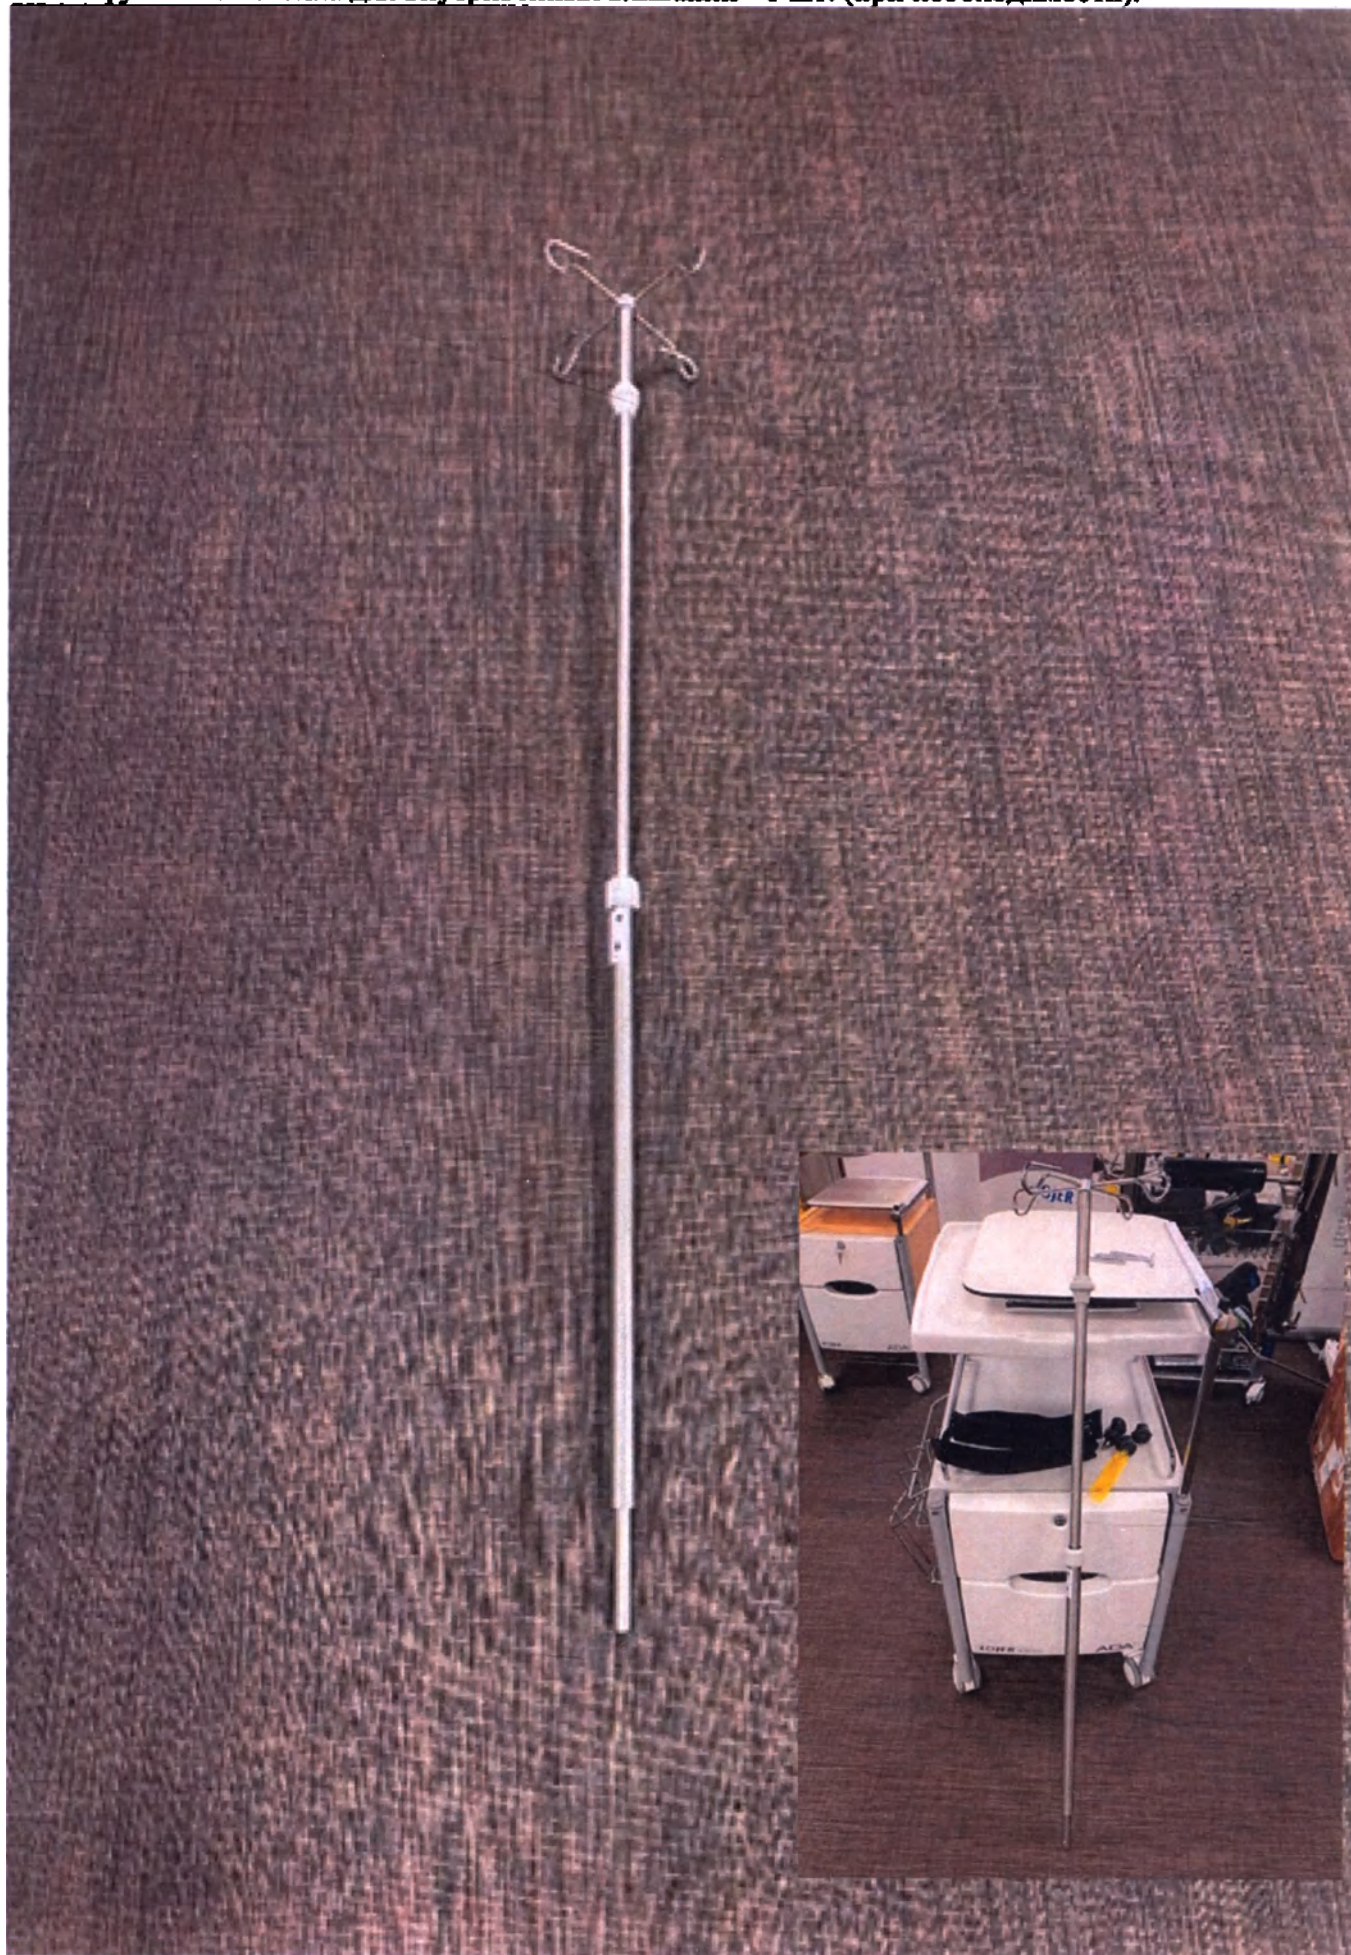

Задняя стенка регистрируемого медицинского изделия с установленной инфузионной стойкой.




Тумбочка медицинская прикроватная ADA для тяжелобольных с установленной инфузионной стойкой



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУМБОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ
ПРИКРОВАТНАЯ АДА ДЛЯ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ

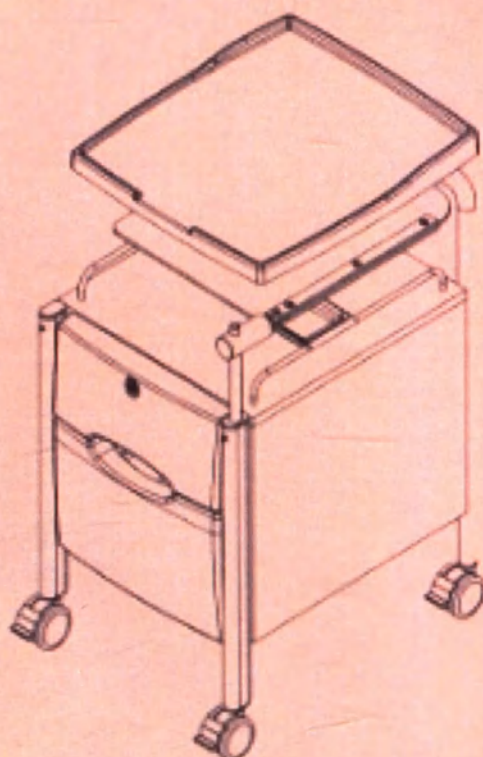

ВЕРСИЯ: 1.0



LOJER

Lojer Corp.
Pulscombe 42
E11 3QD14 Sotomela, FRA, AHO
Tel: +358 10 830 6700
Fax: +358 10 830 6702
info@lojer.com

ООО «Лойер Медикал»

Генеральный директор _____

Самсонов В. Ю.

Количество листов (а): _____

19



09 ЯНВ 2023