

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro*
диагностике, варианты комплектации
производства Bio-Rad («Био-Рад»), Франция.**

2023



Рис. 1. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации: Диски бензилпенициллин 1 ME (BENZYL PENICILLIN 1 IU), (4x50) шт/1 уп.



Рис. 2. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) и пластиковых картриджей (первичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации: Диски бензилпенициллин 1 ME (BENZYL PENICILLIN 1 IU), (4x50) шт/1 уп.



Рис. 3. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации: Диски цефотаксим + клавулановая кислота 5/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 5/10 µg), (4x50) шт/1 уп.



Рис. 4. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) и пластиковых картриджей (первичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации: Диски цефотаксим + клавулановая кислота 5/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 5/10 µg), (4x50) шт/1 уп

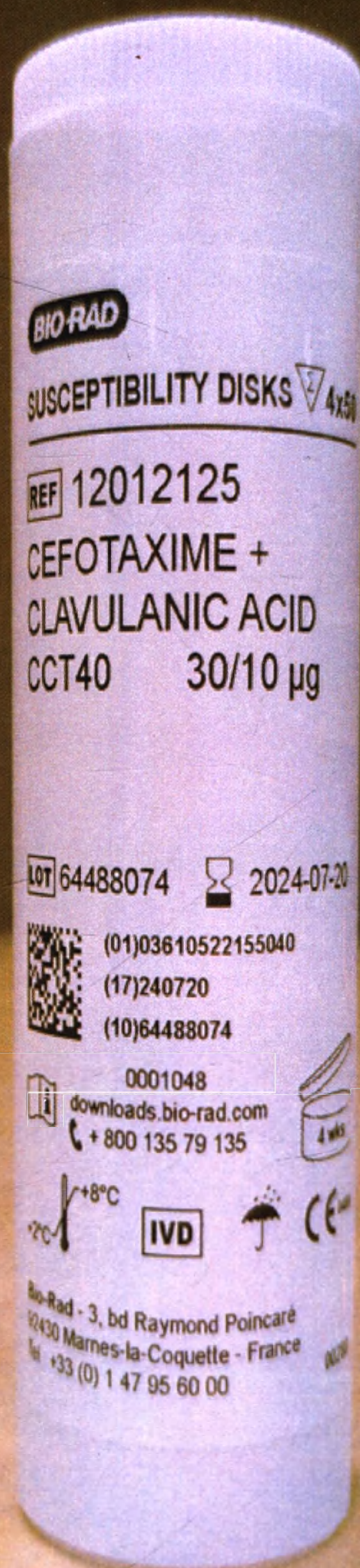


Рис. 5. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в in vitro диагностике, вариант комплектации: Диски цефотаксим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

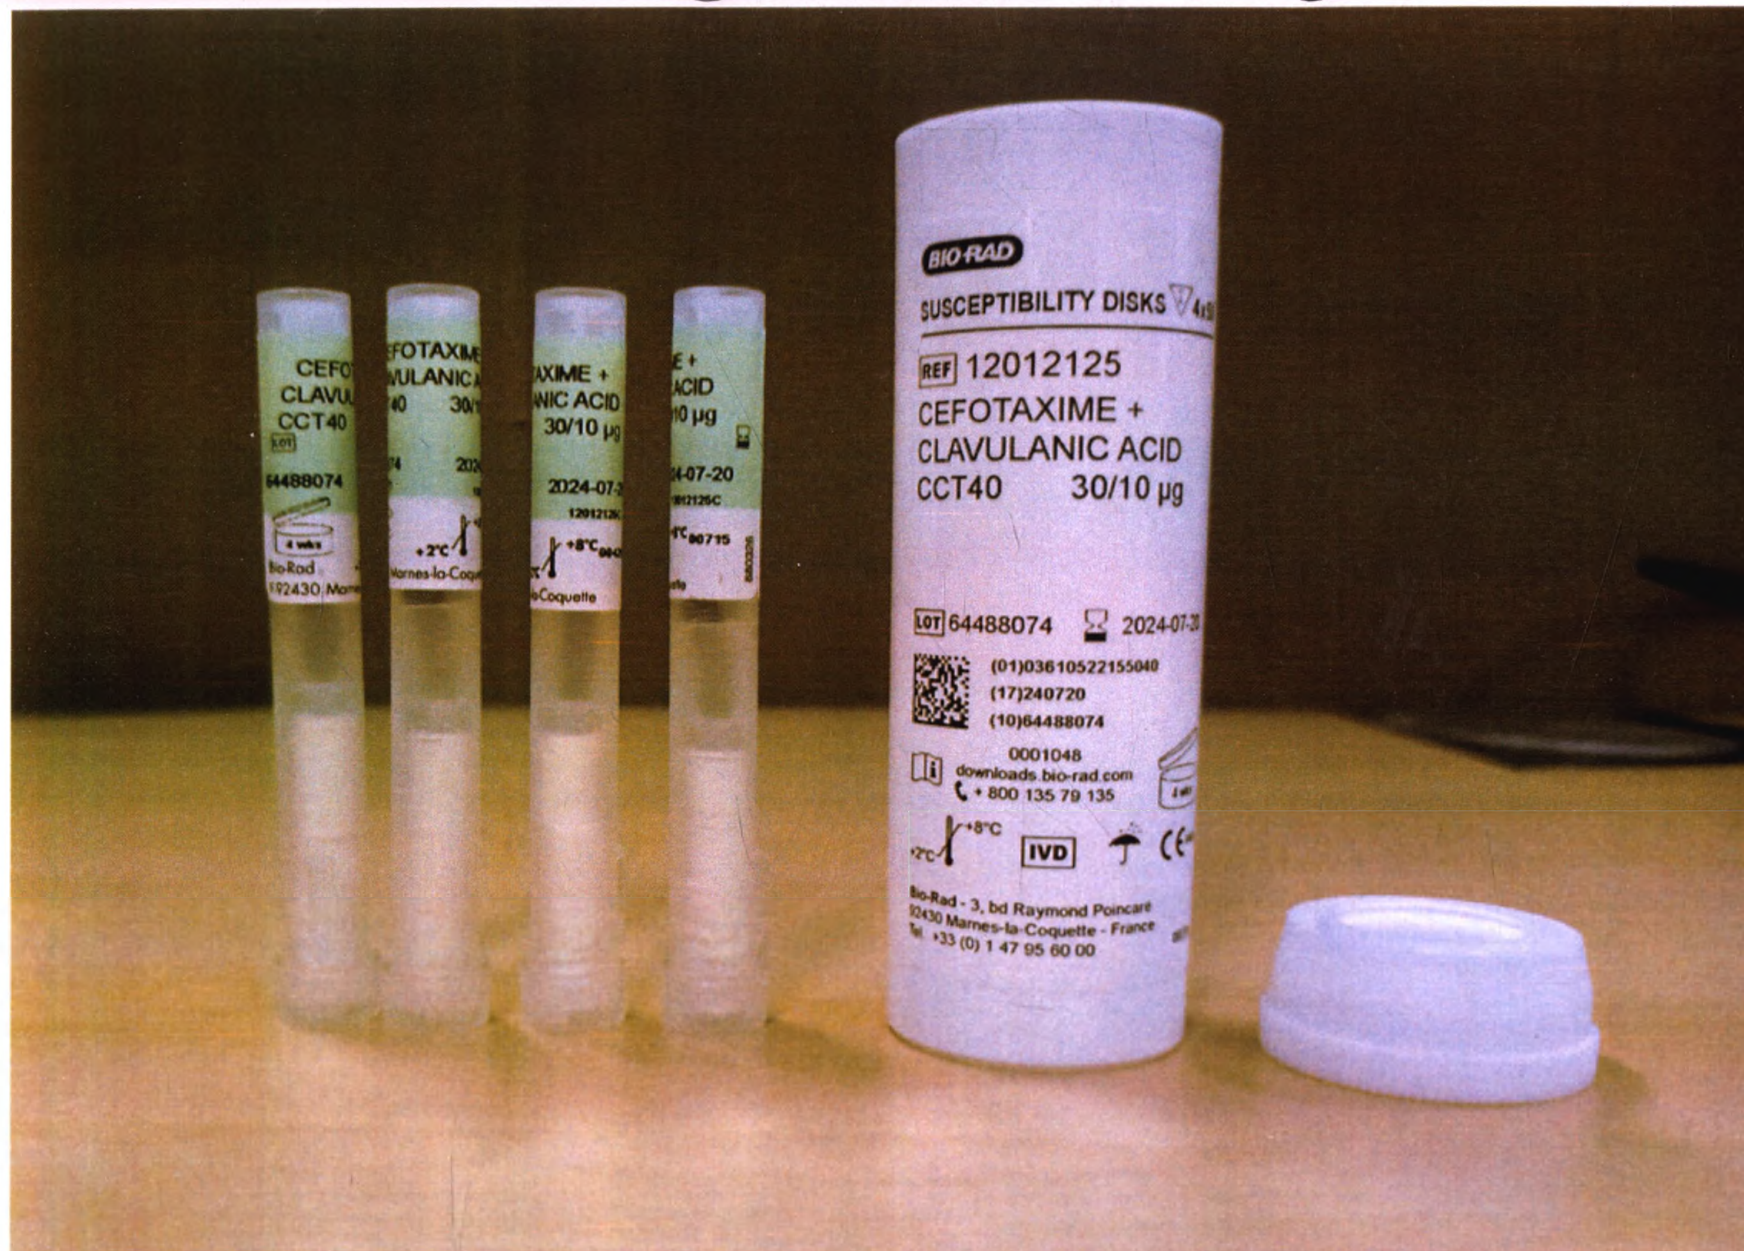


Рис 6. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) и пластиковых картриджей (первичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации: Диски цефотаксим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

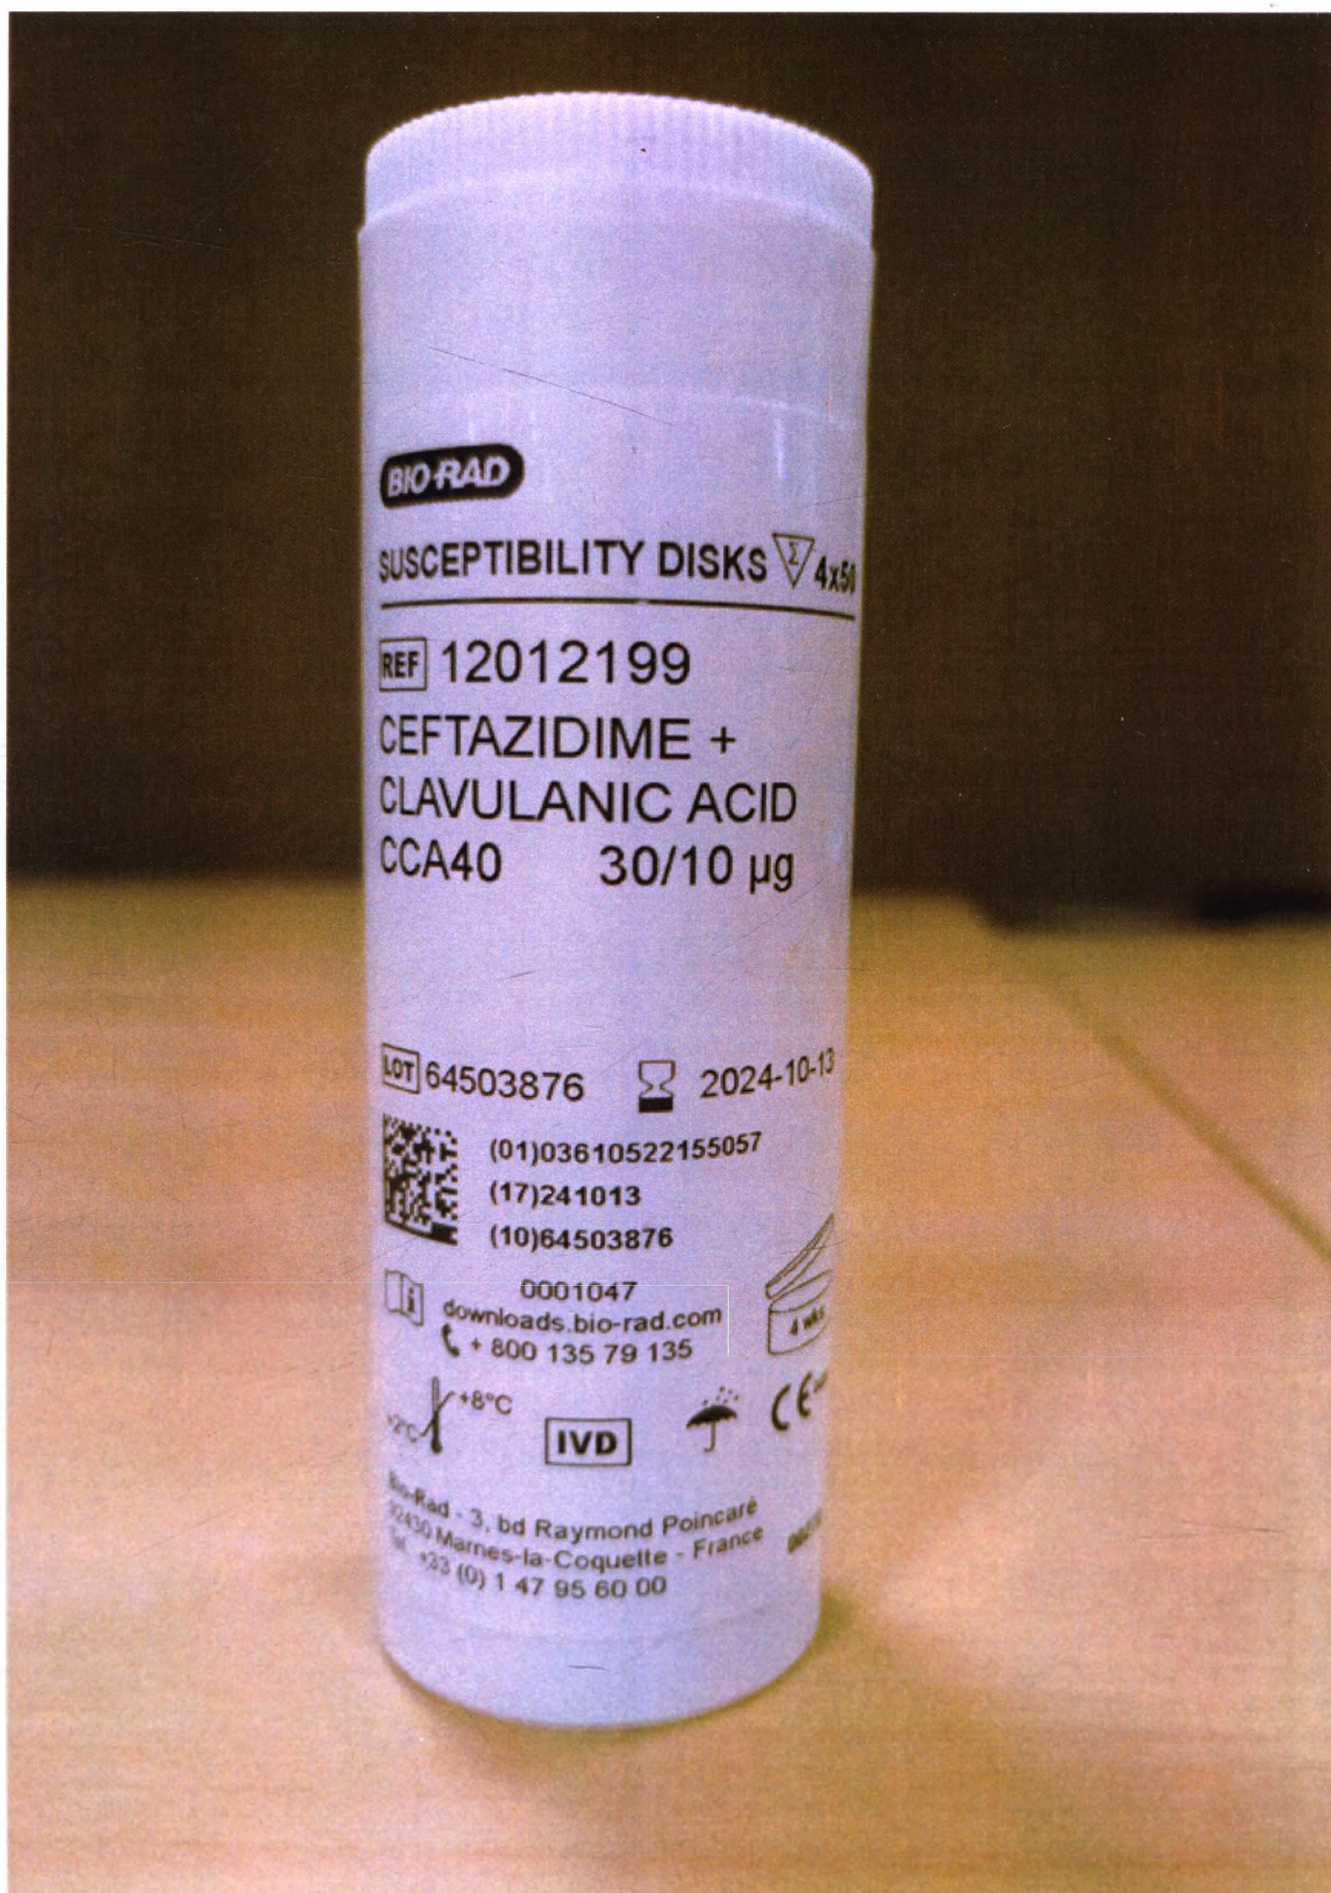


Рис. 7. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в in vitro диагностике, вариант комплектации: Диски цефтазидим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.



Рис. 8. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) и пластиковых картриджей (первичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации: Диски цефтазидим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

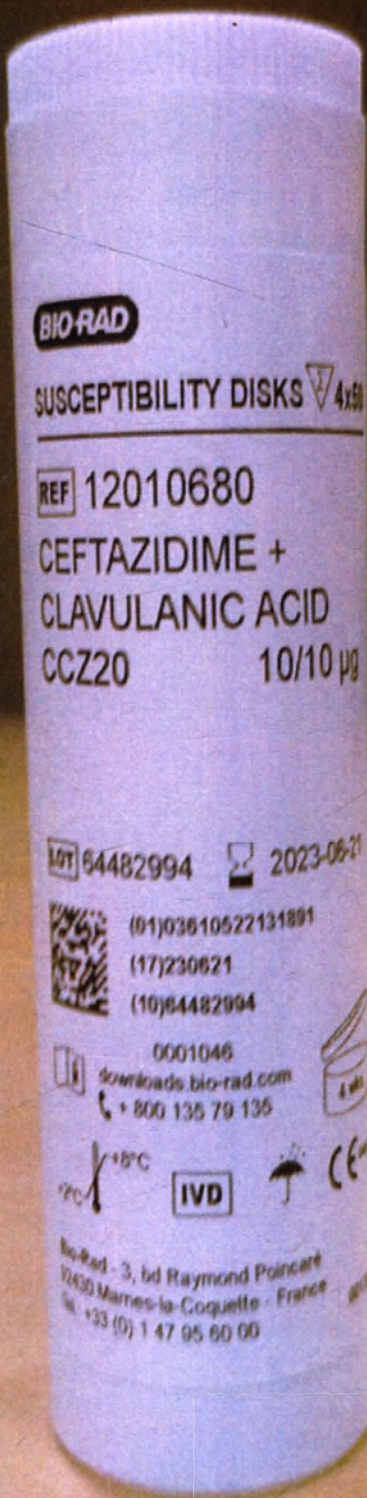


Рис. 9. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации: Диски цефтазидим + клавулановая кислота 10/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 10/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

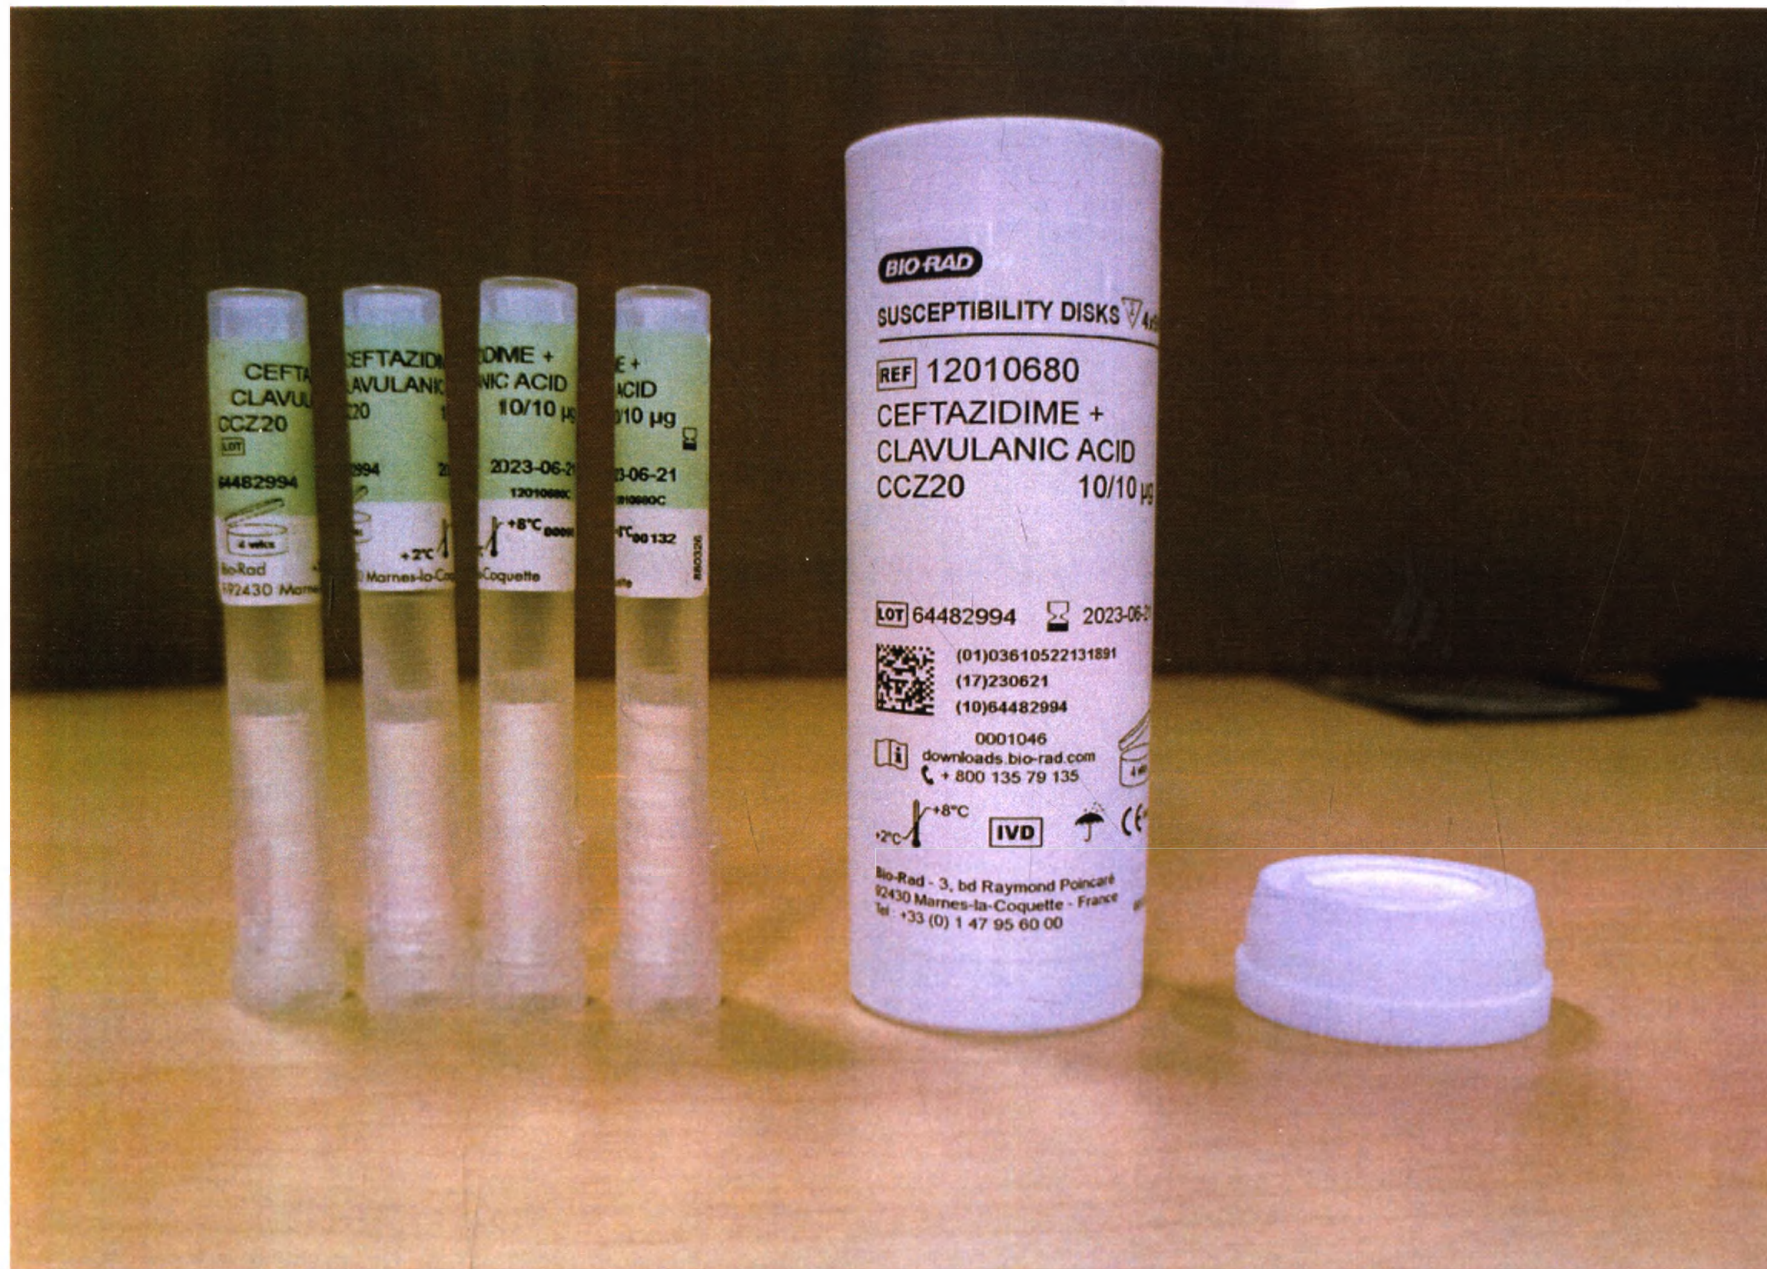


Рис. 10. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) и пластиковых картриджей (первичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации: Диски цефтазидим + клавулановая кислота 10/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 10/10 µg), (4x50) шт/1 уп.



Рис. 11. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации: Диски цефепим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFEPIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

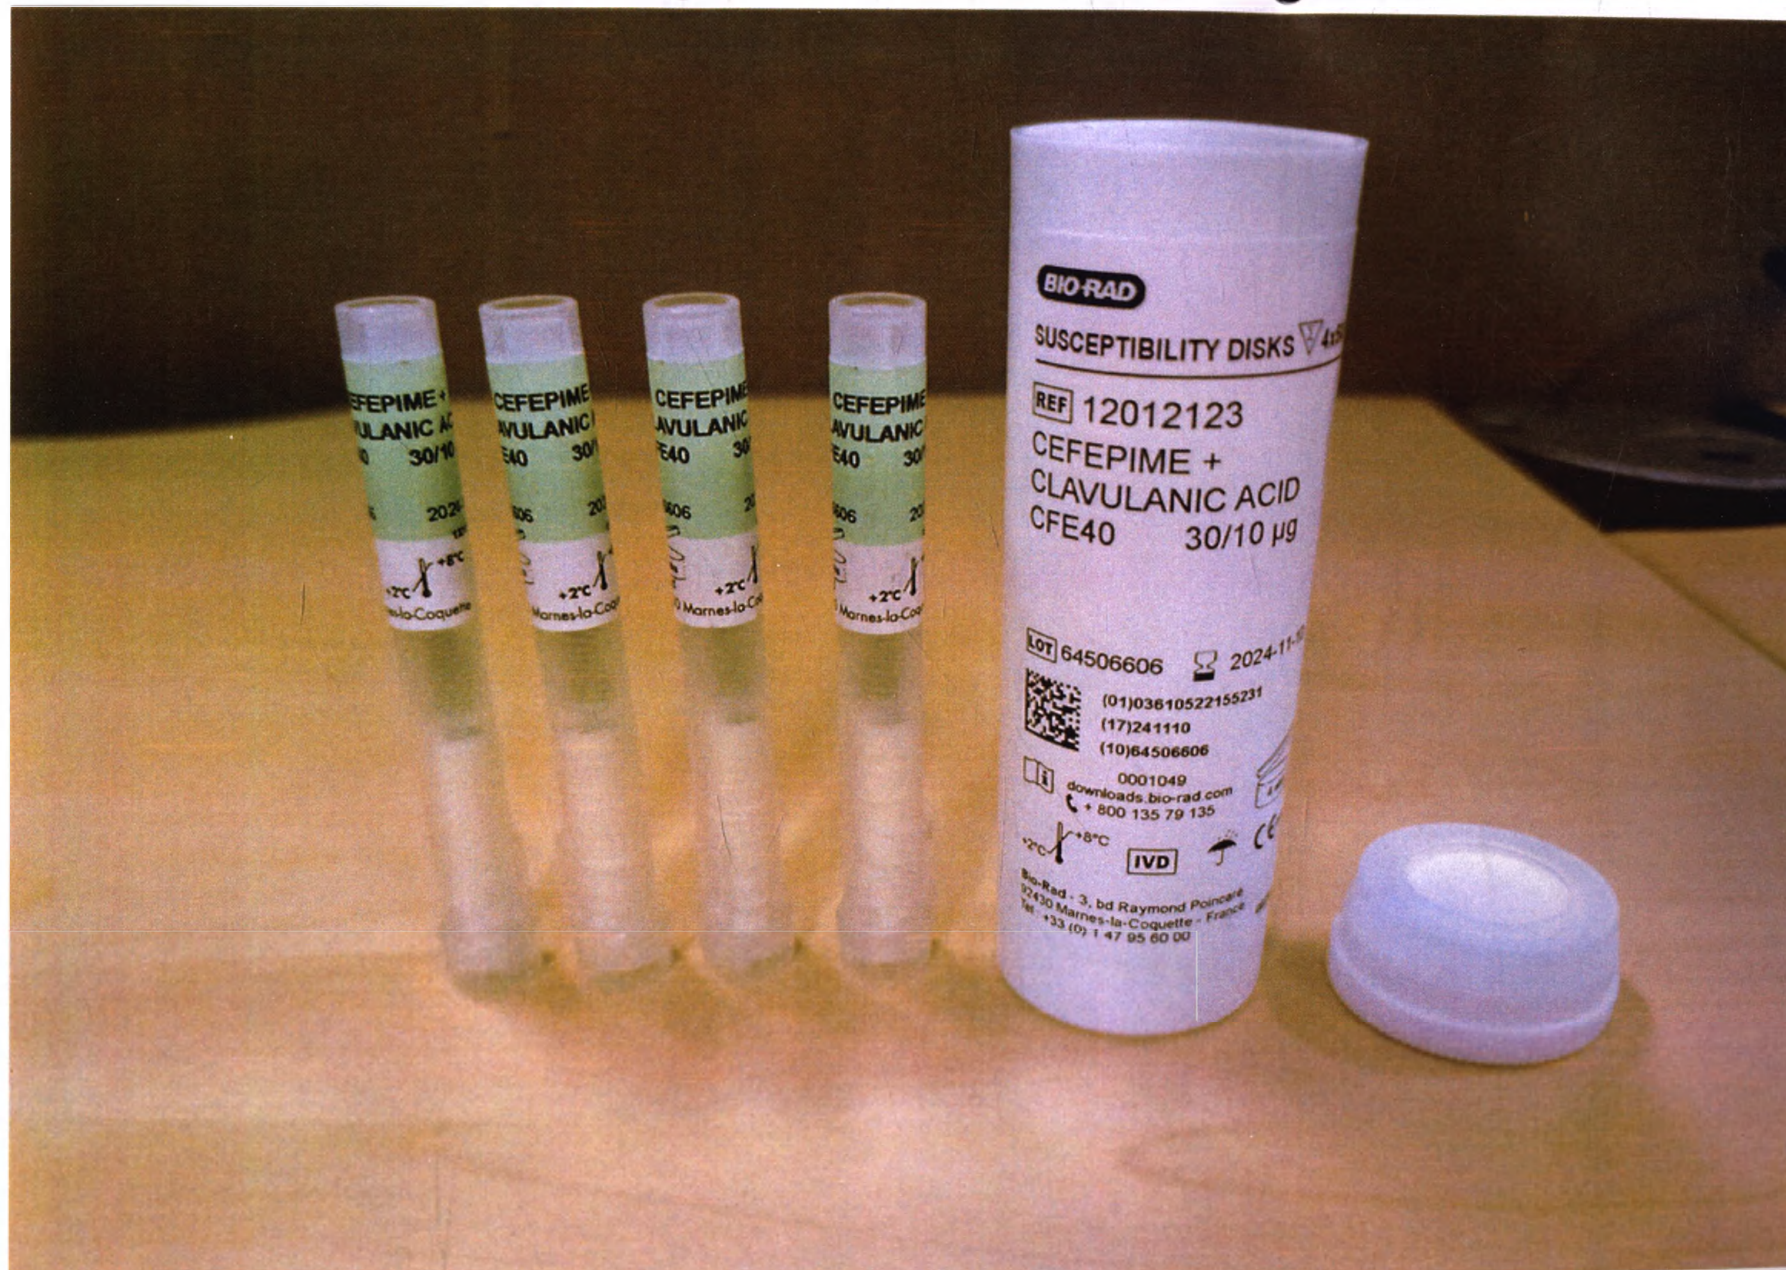


Рис. 12. Общий вид пластикового контейнера (вторичная упаковка) и пластиковых картриджей (первичная упаковка) медицинского изделия: Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в in vitro диагностике, вариант комплектации: Диски цефепим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFEPIME + CLAVULANIC ACID 30/10 мкг) (4x50) шт/1 уп.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 13 листа (ов)





УТВЕРЖДАЮ

Специалист по регистрации

ООО "Био-Рад Лаборатории"

Е.В. Рябчук

«06» февраля 2023 г.

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Диски для определения чувствительности к антибактериальным
препаратам в in vitro диагностике, варианты комплектации**

производства

Bio-Rad («Био-Рад»), Франция

2023

Следующие символы могут **быть** использованы для маркировки:

Символ	Определение
	Обратитесь к инструкции по применению
	Знак CE с кодом нотифицирующего органа
	Температурные ограничения
	QR-код
	Номер по каталогу
	Только для диагностики in vitro
	Использовать до
	Код партии
	Срок годности после вскрытия упаковки
	Содержимого достаточно для проведения n-количества тестов
	Беречь от влаги
	Соответствует основным требованиям директив ЕС
	Логотип компании – производителя


Примечание: Цвет нанесения текста маркировки и его расположение на первичной и вторичной упаковках может отличаться от партии к партии при неизменности самого текста. Данные отличия не влияют на качество, безопасность и эффективность медицинского изделия.

Макет маркировки пластиковых картриджей (первичная упаковка)

Диски бензилпенициллин 1 ME (BENZYL PENICILLIN 1 IU), (4x50) шт/1 уп.



Диски цефотаксим + клавулановая кислота 5/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 5/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

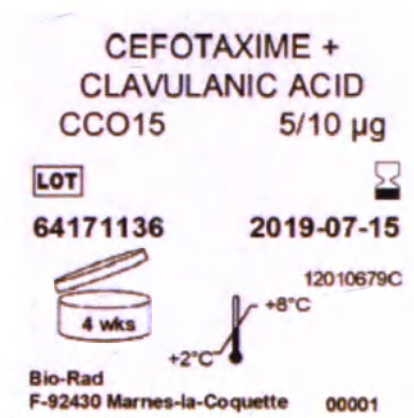


Диски цефотаксим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.



Диски цефтазидим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.



Диски цефтазидим + клавулановая кислота 10/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 10/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

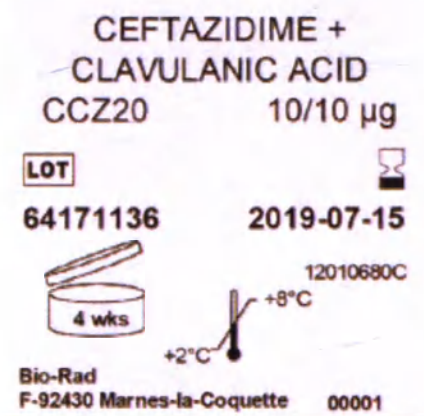

Диски цефепим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFEPIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.



Маркировка первичной упаковки может содержать следующую информацию и символы:

- краткое наименование изделия;
- символы обозначающие диски, состоящие из 3 букв и числового значения, обозначающего общую концентрацию активных веществ в диске;
- концентрацию каждого активного вещества в диске;
- символ «Код партии»;
- символ «Использовать до ...»;
- наименование, адрес производителя;
- символ «Температурные ограничения»;
- символ «Срок годности после вскрытия упаковки» (указывается в случае, если срок годности после вскрытия упаковки равен или менее 4 недель)

Макет маркировки пластикового контейнера (вторичная упаковка)

Диски бензилпенициллин 1 ME (BENZYL PENICILLIN 1 IU), (4x50) шт/1 уп.





ООО Био-Рад
Лаборатории

105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр. 5А
Тел.: +7 (495) 721-14-04
Факс: +7 (495) 721-14-12
E-mail: info_russia@bio-rad.com

Диски цефотаксим + клавулановая кислота 5/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 5/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

BIO-RAD
SUSCEPTIBILITY DISKS **4x50**
REF 12010679
CEFOTAXIME +
CLAVULANIC ACID
CCO15 5/10 µg

LOT 64125836 2019-07-15
 (01)03610522131884
(17)190715
(10)64125836
0001045
downloads.bio-rad.com
+ 800 135 79 135
 4 wks
 +2°C +8°C **IVD** 0489
Bio-Rad - 3, bd Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette - France
Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 **00001**

Диски цефотаксим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

BIO-RAD
SUSCEPTIBILITY DISKS **4x50**
REF 12012125
CEFOTAXIME +
CLAVULANIC ACID
CCT40 30/10 µg

LOT 64350098 2022-06-11
 (01)03610522155040
(17)220611
(10)64350098
0001048
downloads.bio-rad.com
+ 800 135 79 135
 4 wks
 +2°C +8°C **IVD** 0489
Bio-Rad - 3, bd Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette - France
Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 **00001**



ООО Био-Рад
Лаборатории

105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр. 5А
Тел.: +7 (495) 721-14-04
Факс: +7 (495) 721-14-12
E-mail: info_russia@bio-rad.com

Диски цефтазидим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

BIO-RAD

SUSCEPTIBILITY DISKS  4x50

REF 12012199

CEFTAZIDIME +
CLAVULANIC ACID
CCA40 30/10 µg

LOT 64357979  2022-04-09



(01)03610622156057
(17)220409
(10)64357979



www.bio-rad.com
12012199-2021/01



IVD



CE 0409

Bio-Rad - 3, bd Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette - France
Tel: +33 (0) 1 47 95 60 00

00001

Диски цефтазидим + клавулановая кислота 10/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 10/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

BIO-RAD

SUSCEPTIBILITY DISKS  4x50

REF 12010680

CEFTAZIDIME +
CLAVULANIC ACID
CCZ20 10/10 µg

LOT 64171136  2019-07-15



(01)03610622131891
(17)190715
(10)64171136



www.bio-rad.com
2019-06



IVD



CE

Bio-Rad - 3, bd Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette - France
Tel: +33 (0) 1 47 95 60 00

00001

Диски цефепим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFEPIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

BIO-RAD
SUSCEPTIBILITY DISKS  **4x50**
REF 12012123
CEFEPIME +
CLAVULANIC ACID
CFE40 30/10 µg

LOT 64350856  **2022-09-27**



(01)03610522155231
(17)220927
(10)64350856



0001049
downloads.bio-rad.com
+ 800 135 79 135



Bio-Rad - 3, bd Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette - France
Tel. +33 (0) 1 47 95 60 00

00001

Маркировка каждого пластикового контейнера может содержать следующую информацию и символы:

- наименование, адрес и логотип производителя;
- краткое наименование изделия;
- символы обозначающие диски, состоящие из 3 букв и числового значения, обозначающего общую концентрацию активных веществ в диске;
- надпись «SUSCEPTIBILITY DISKS» (диски для определения чувствительности к антибиотикам);
- символ «Содержимого достаточно для проведения n-количества тестов»;
- символ «Номер по каталогу»;
- символ «Код партии»;
- краткое наименование изделия;
- символ «Использовать до ...»;
- QR – код;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Температурные ограничения»;
- символ «Знак CE с кодом нотифицирующего органа»;
- символ «Только для диагностики in vitro»;
- символ «Бережь от влаги»;
- символ «Срок годности после вскрытия упаковки» (указывается в случае, если срок годности после вскрытия упаковки равен или менее 4 недель)



ООО Био-Рад
Лаборатории

105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр. 5А
Тел.: +7 (495) 721-14-04
Факс: +7 (495) 721-14-12
E-mail: info_russia@bio-rad.com

Макет маркировки на русском языке для обращения на территории Российской Федерации

Диски бензилпенициллин 1 ME (BENZYLPENICILLIN 1 IU), (4x50) шт/1 уп.

REF 67788

IVD

Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации:

Диски бензилпенициллин 1 ME (BENZYLPENICILLIN 1 IU), (4x50) шт/1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, каталожный номер, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Производитель: Bio-Rad («Био-Рад»), 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette, France (Франция)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: info_russia@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Франция

Диски цефотаксим + клавулановая кислота 5/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 5/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

REF 12010679

IVD

Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации:

Диски цефотаксим + клавулановая кислота 5/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 5/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, каталожный номер, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Производитель: Bio-Rad («Био-Рад»), 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette, France (Франция)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: info_russia@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Франция



ООО Био-Рад
Лаборатории

105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр. 5А
Тел.: +7 (495) 721-14-04
Факс: +7 (495) 721-14-12
E-mail: info_russia@bio-rad.com

Диски цефотаксим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

REF 12012125

IVD

Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации:

Диски цефотаксим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFOTAXIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, каталожный номер, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Производитель: Bio-Rad («Био-Рад»), 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette, France (Франция)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: info_russia@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Франция

Диски цефтазидим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

REF 12012199

IVD

Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации:

Диски цефтазидим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, каталожный номер, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Производитель: Bio-Rad («Био-Рад»), 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette, France (Франция)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: info_russia@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Франция



**ООО Био-Рад
Лаборатории**

105064 г. Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр. 5А
Тел.: +7 (495) 721-14-04
Факс: +7 (495) 721-14-12
E-mail: info_russia@bio-rad.com

Диски цефтазидим + клавулановая кислота 10/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 10/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

REF 12010680

IVD

Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации:

Диски цефтазидим + клавулановая кислота 10/10 мкг (CEFTAZIDIME + CLAVULANIC ACID 10/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, каталожный номер, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Производитель: Bio-Rad («Био-Рад»), 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette, France (Франция)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: info_russia@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Франция

Диски цефепим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFEPIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

REF 12012123

IVD

Диски для определения чувствительности к антибактериальным препаратам в *in vitro* диагностике, вариант комплектации:

Диски цефепим + клавулановая кислота 30/10 мкг (CEFEPIME + CLAVULANIC ACID 30/10 µg), (4x50) шт/1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, каталожный номер, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Производитель: Bio-Rad («Био-Рад»), 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette, France (Франция)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: info_russia@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Франция

Всего пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью 11 листа 403

